



Фотографические изображения  
медицинского изделия

***Аппарат наркозно-дыхательный Aisys CS2 с при-  
надлежностями***

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента  
регистрации и сертификации  
России и СНГ

ООО «Джи Хэлскеа»



С.Б. Парахина

« 21 » марта 2018 г.

Аппарат наркозно-дыхательный Aisys CS2 с принадлежностями



Аппарат наркозно-дыхательный Aisys CS2 с принадлежностями (пример маркировки )





**REF**

**SN**

**UDI**



**AISYS CS2**



**1011-9050-000**



**APWW01654**




**(01)00840682102292(21)APWW01654(11)171004**

**2017-10-04**


**Datex-Ohmeda Inc.  
3030 Ohmeda Drive,  
PO Box 7550,  
Madison, WI 53707-7550 USA  
Сделано в США**



I.Состав: 1.Блок основной с газовыми входами на тележке.

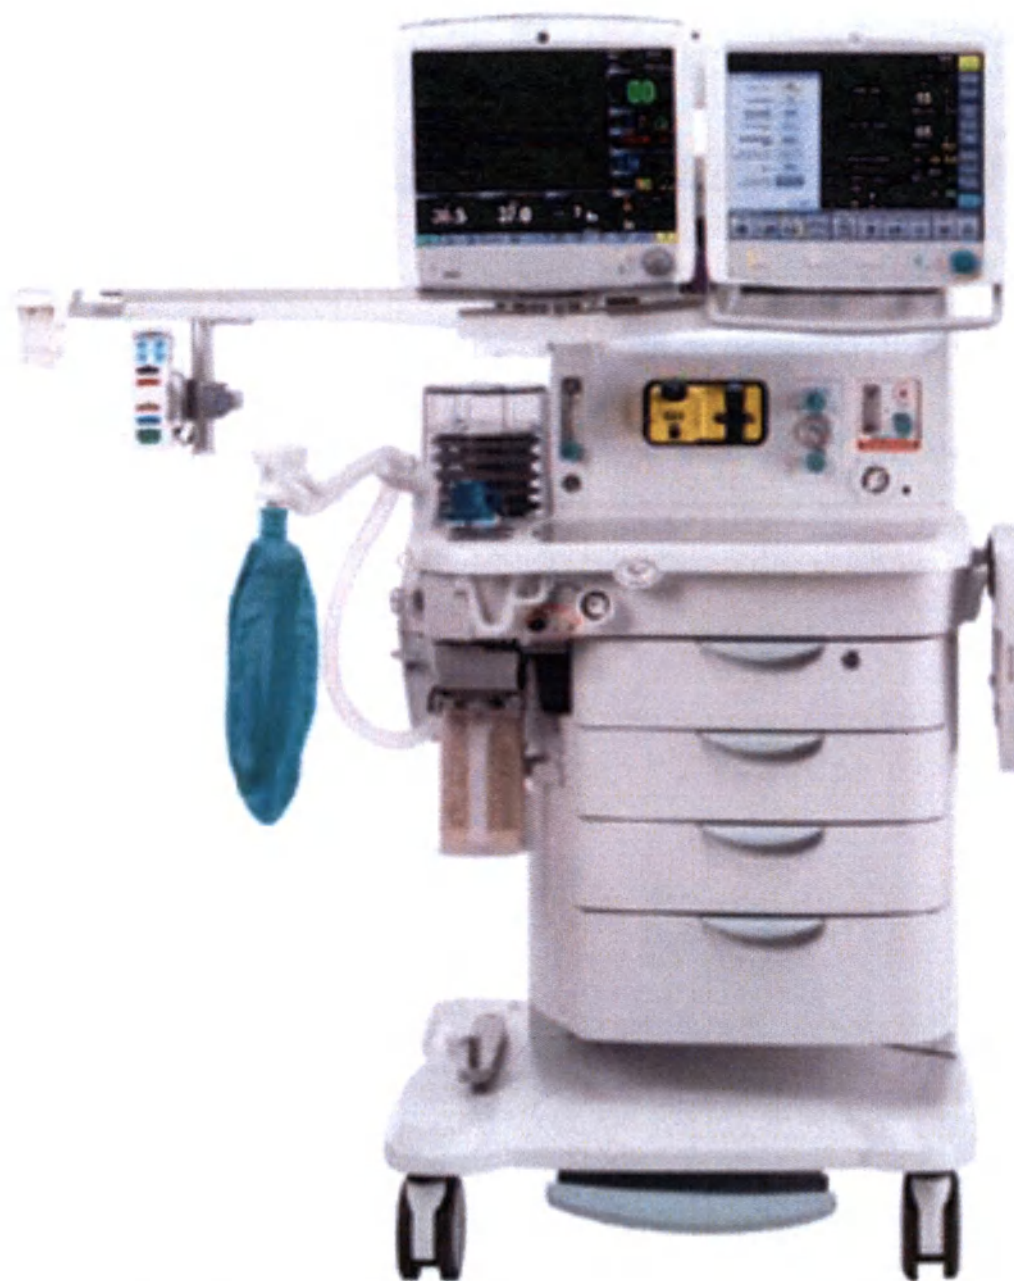

## 2. Вентилятор.

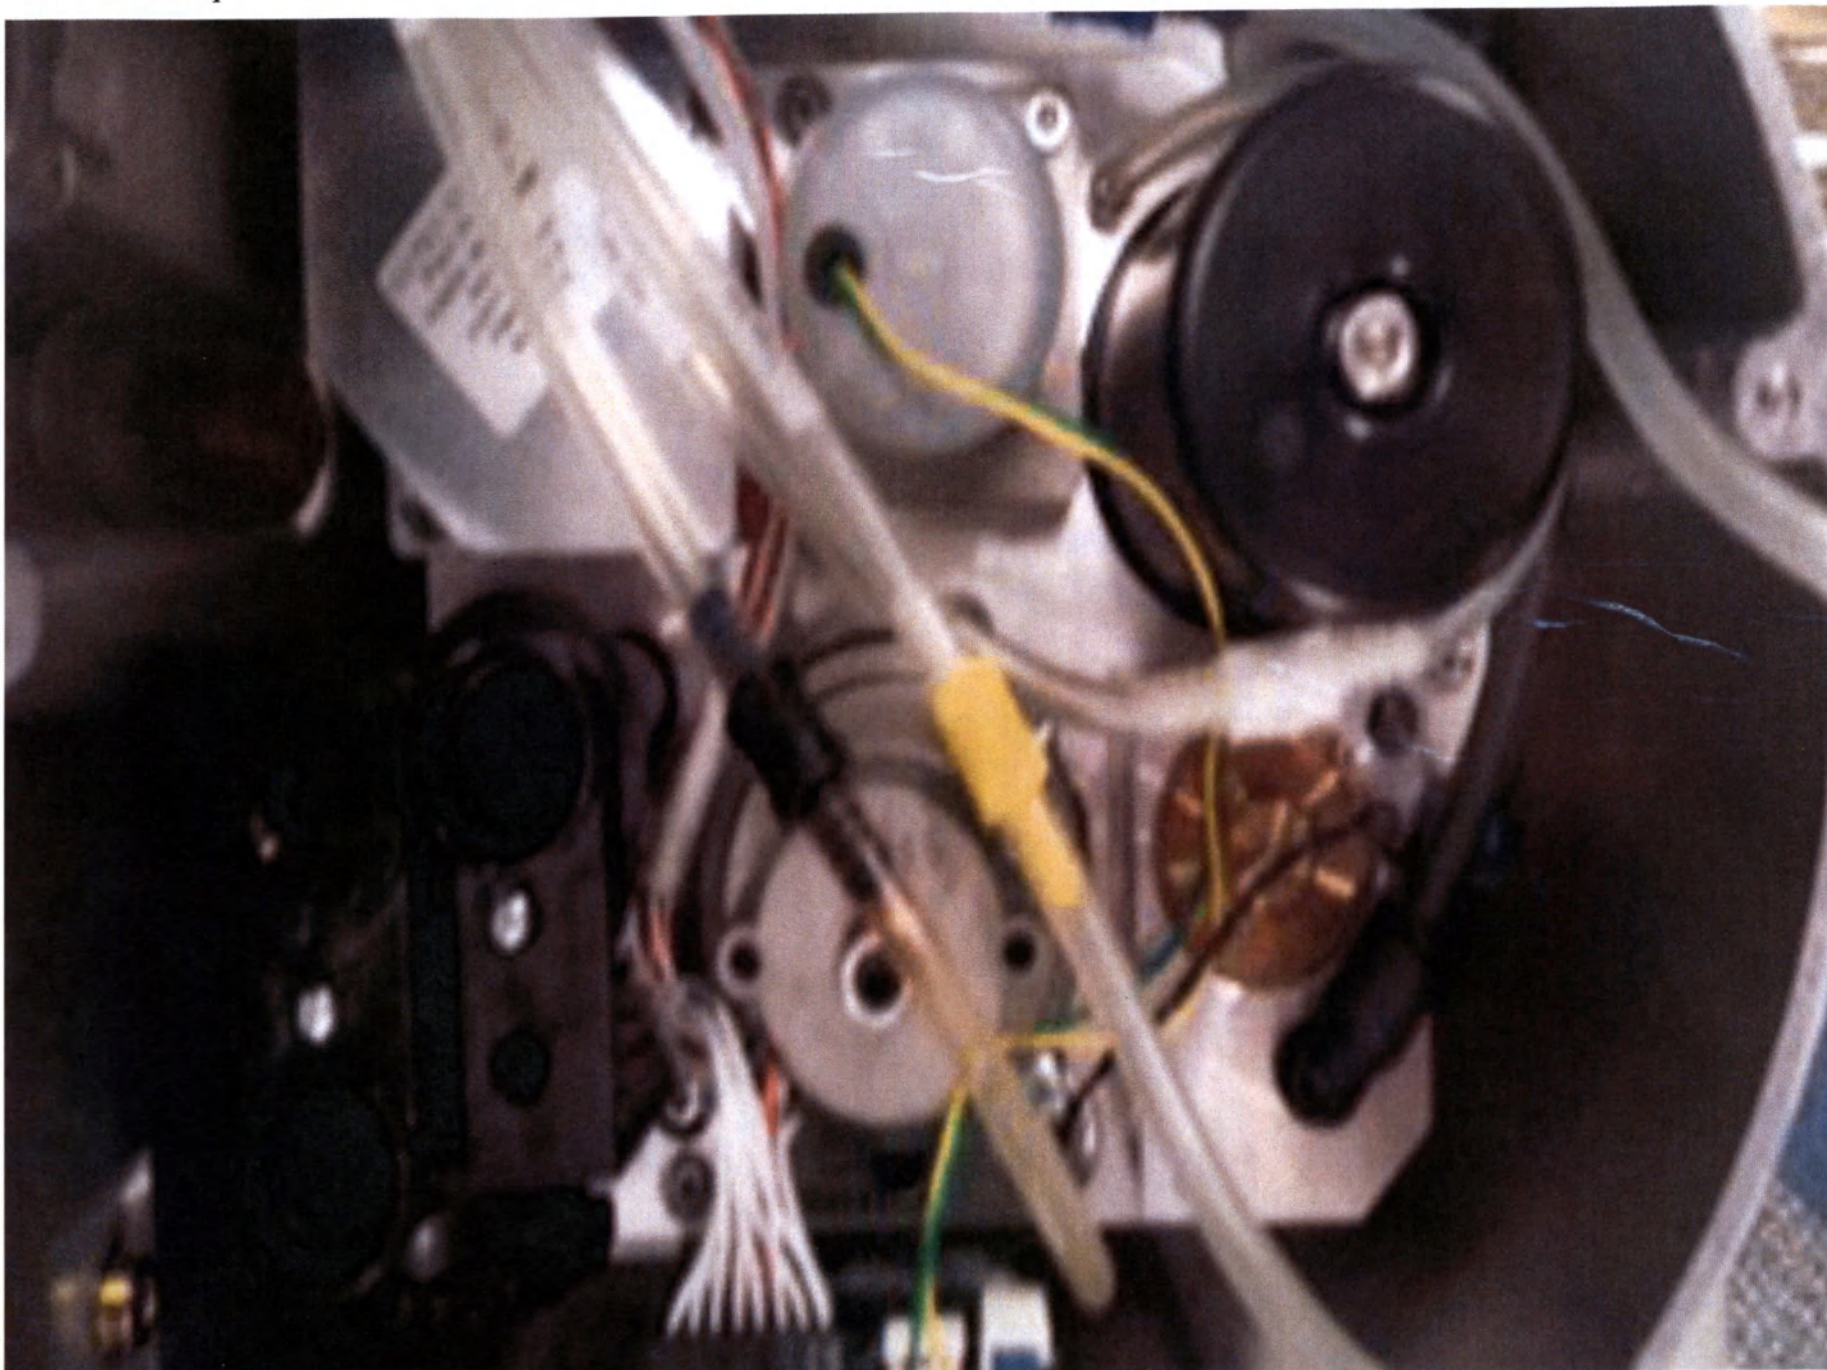



#### 4.Экран вентилятора.





### 3. Шнур электропитания.



## Aisys CS<sup>2</sup>

### Руководство по эксплуатации

Версия программного обеспечения 11





II. Принадлежности: 1. Флоуметр кислорода интегрированный.





## 2. Дыхательный компактный интегрированный модуль.





### 3. Шланг высокого давления для кислорода с коннектором.





#### 4. Шланг высокого давления для воздуха с коннектором.





5. Шланг высокого давления для закиси азота с коннектором.





6. Шланг высокого давления для вакуума с коннектором.





## 7. Шланг высокого давления для кислорода.










## 9. Шланг высокого давления для закиси азота.






## 10. Шланг высокого давления для вакуума.

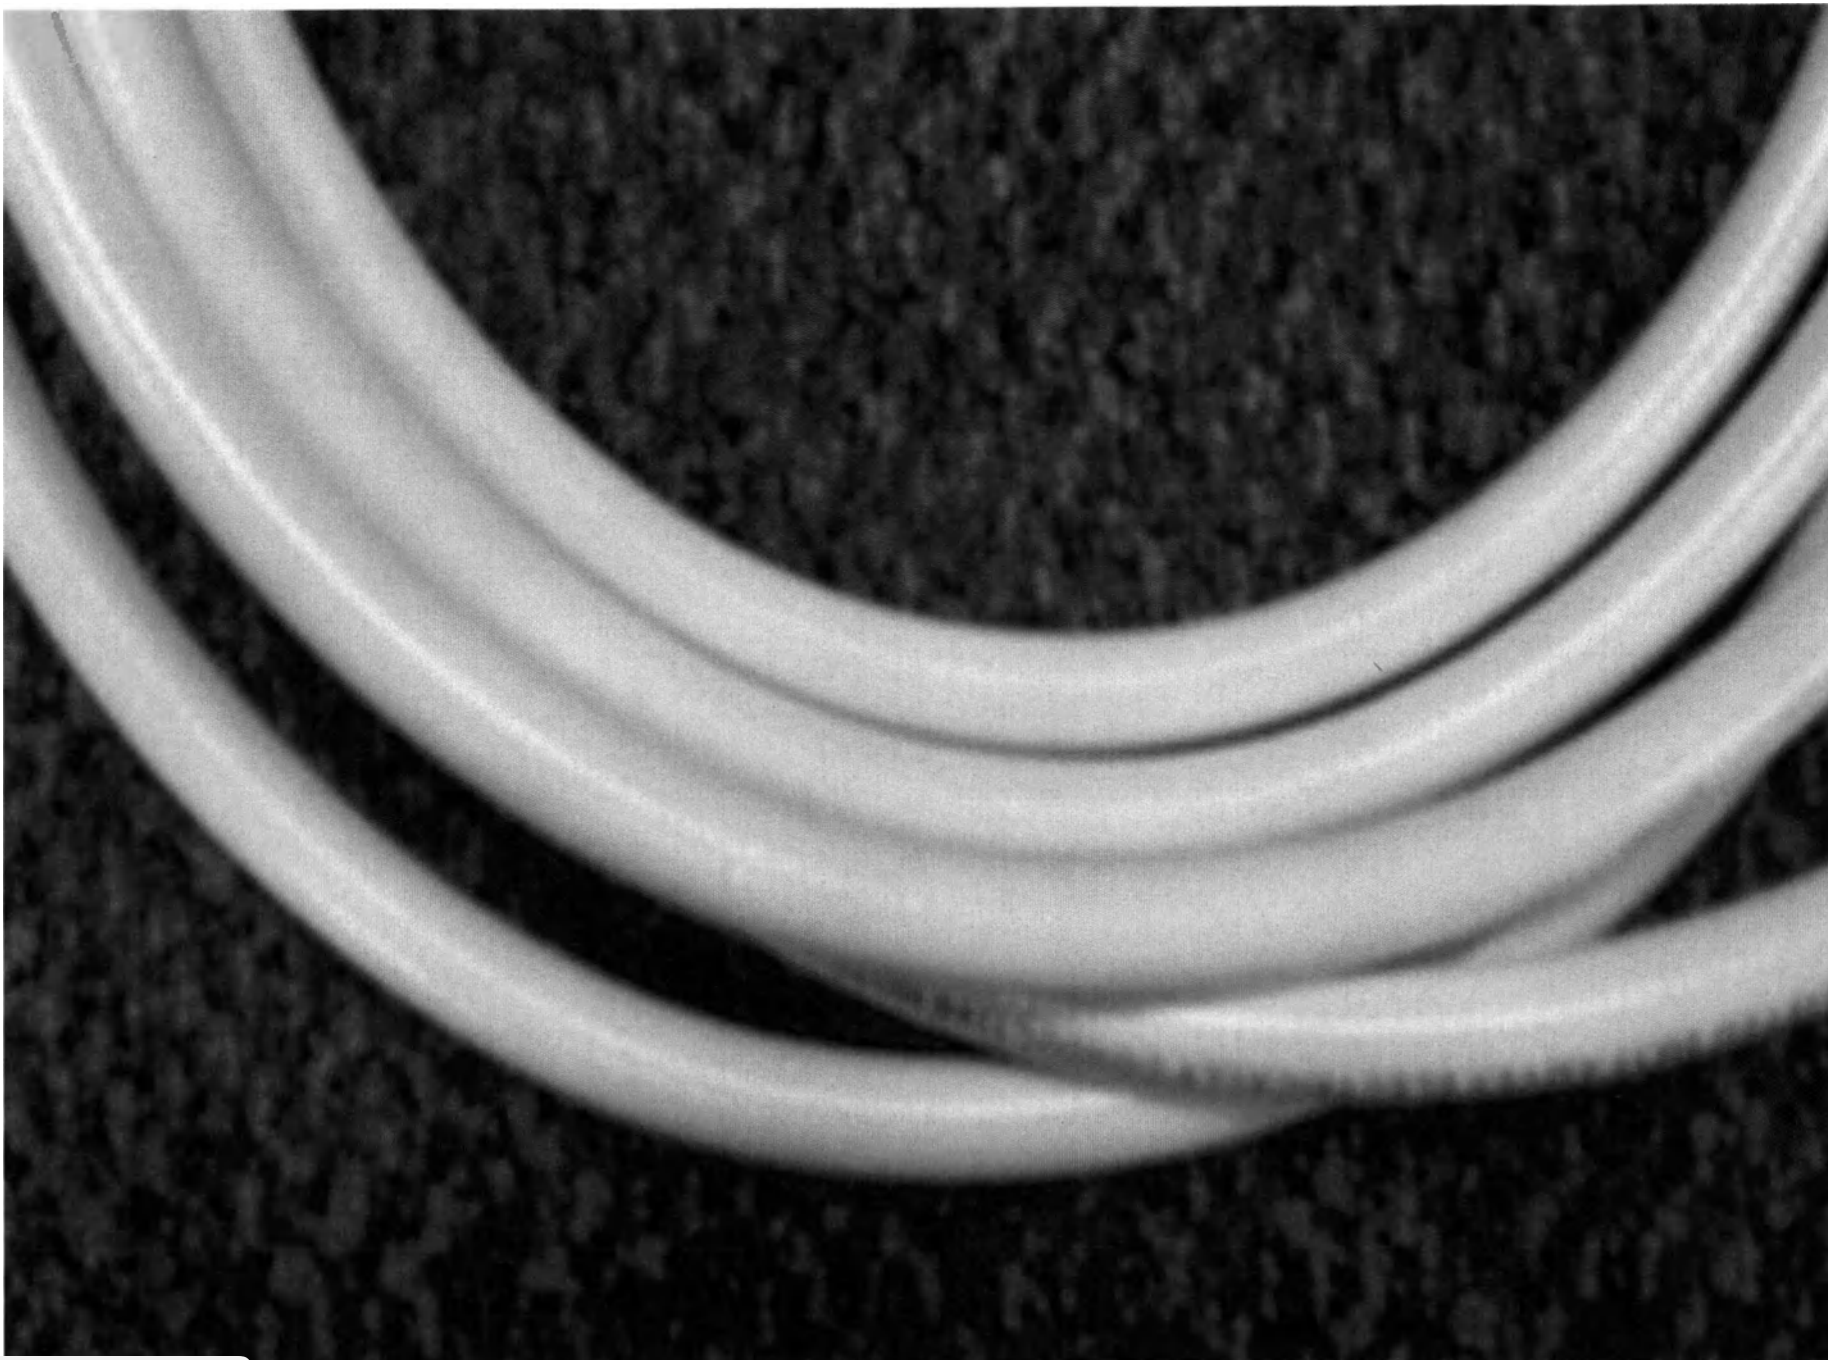



# 11. Адаптеры для подключения шлангов подачи кислорода.

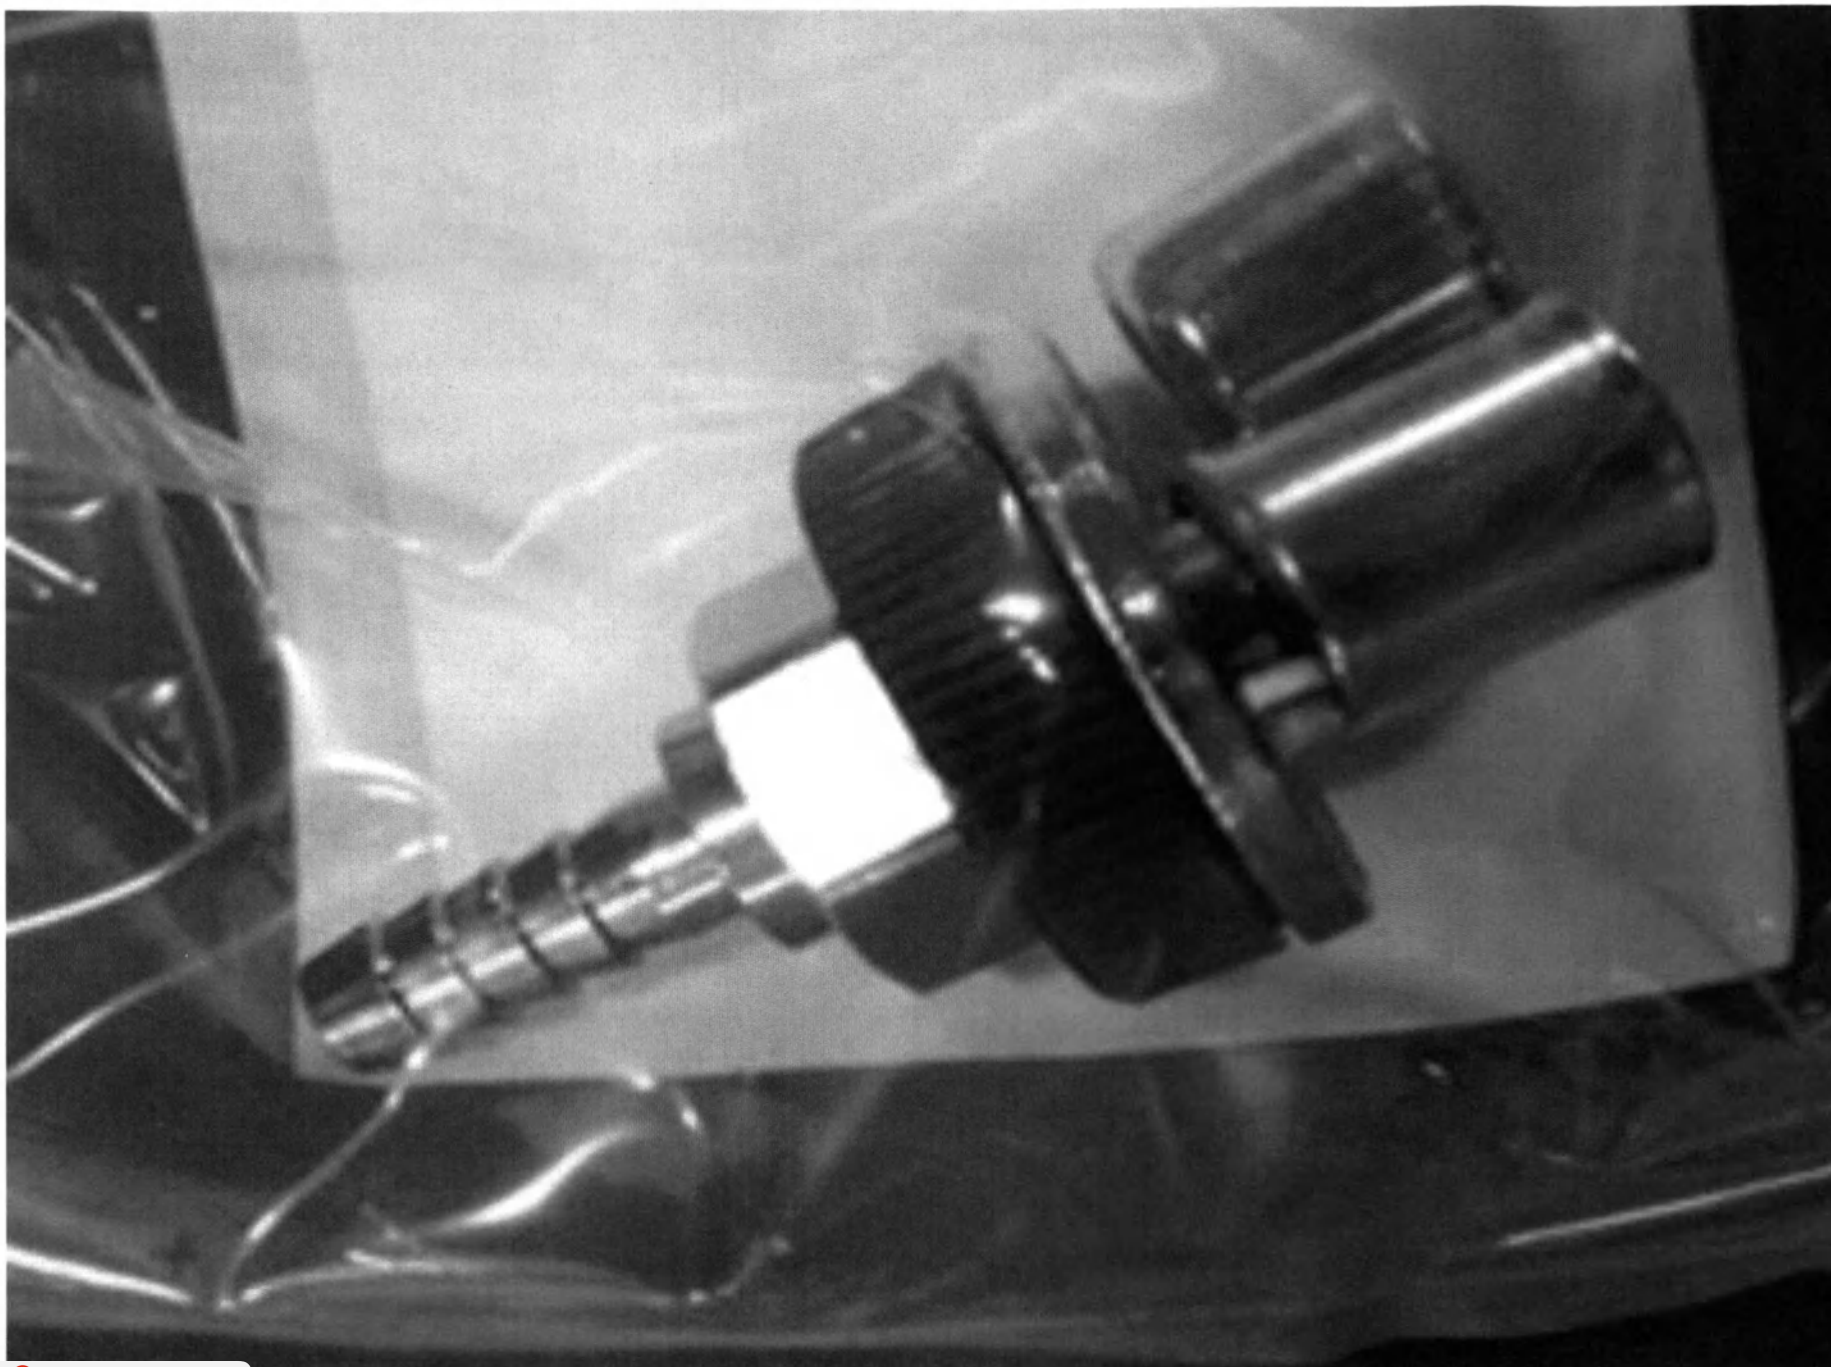



## 12. Адаптеры для подключения шлангов подачи вакуума.











#### 14. Адаптеры для подключения шлангов подачи воздуха.

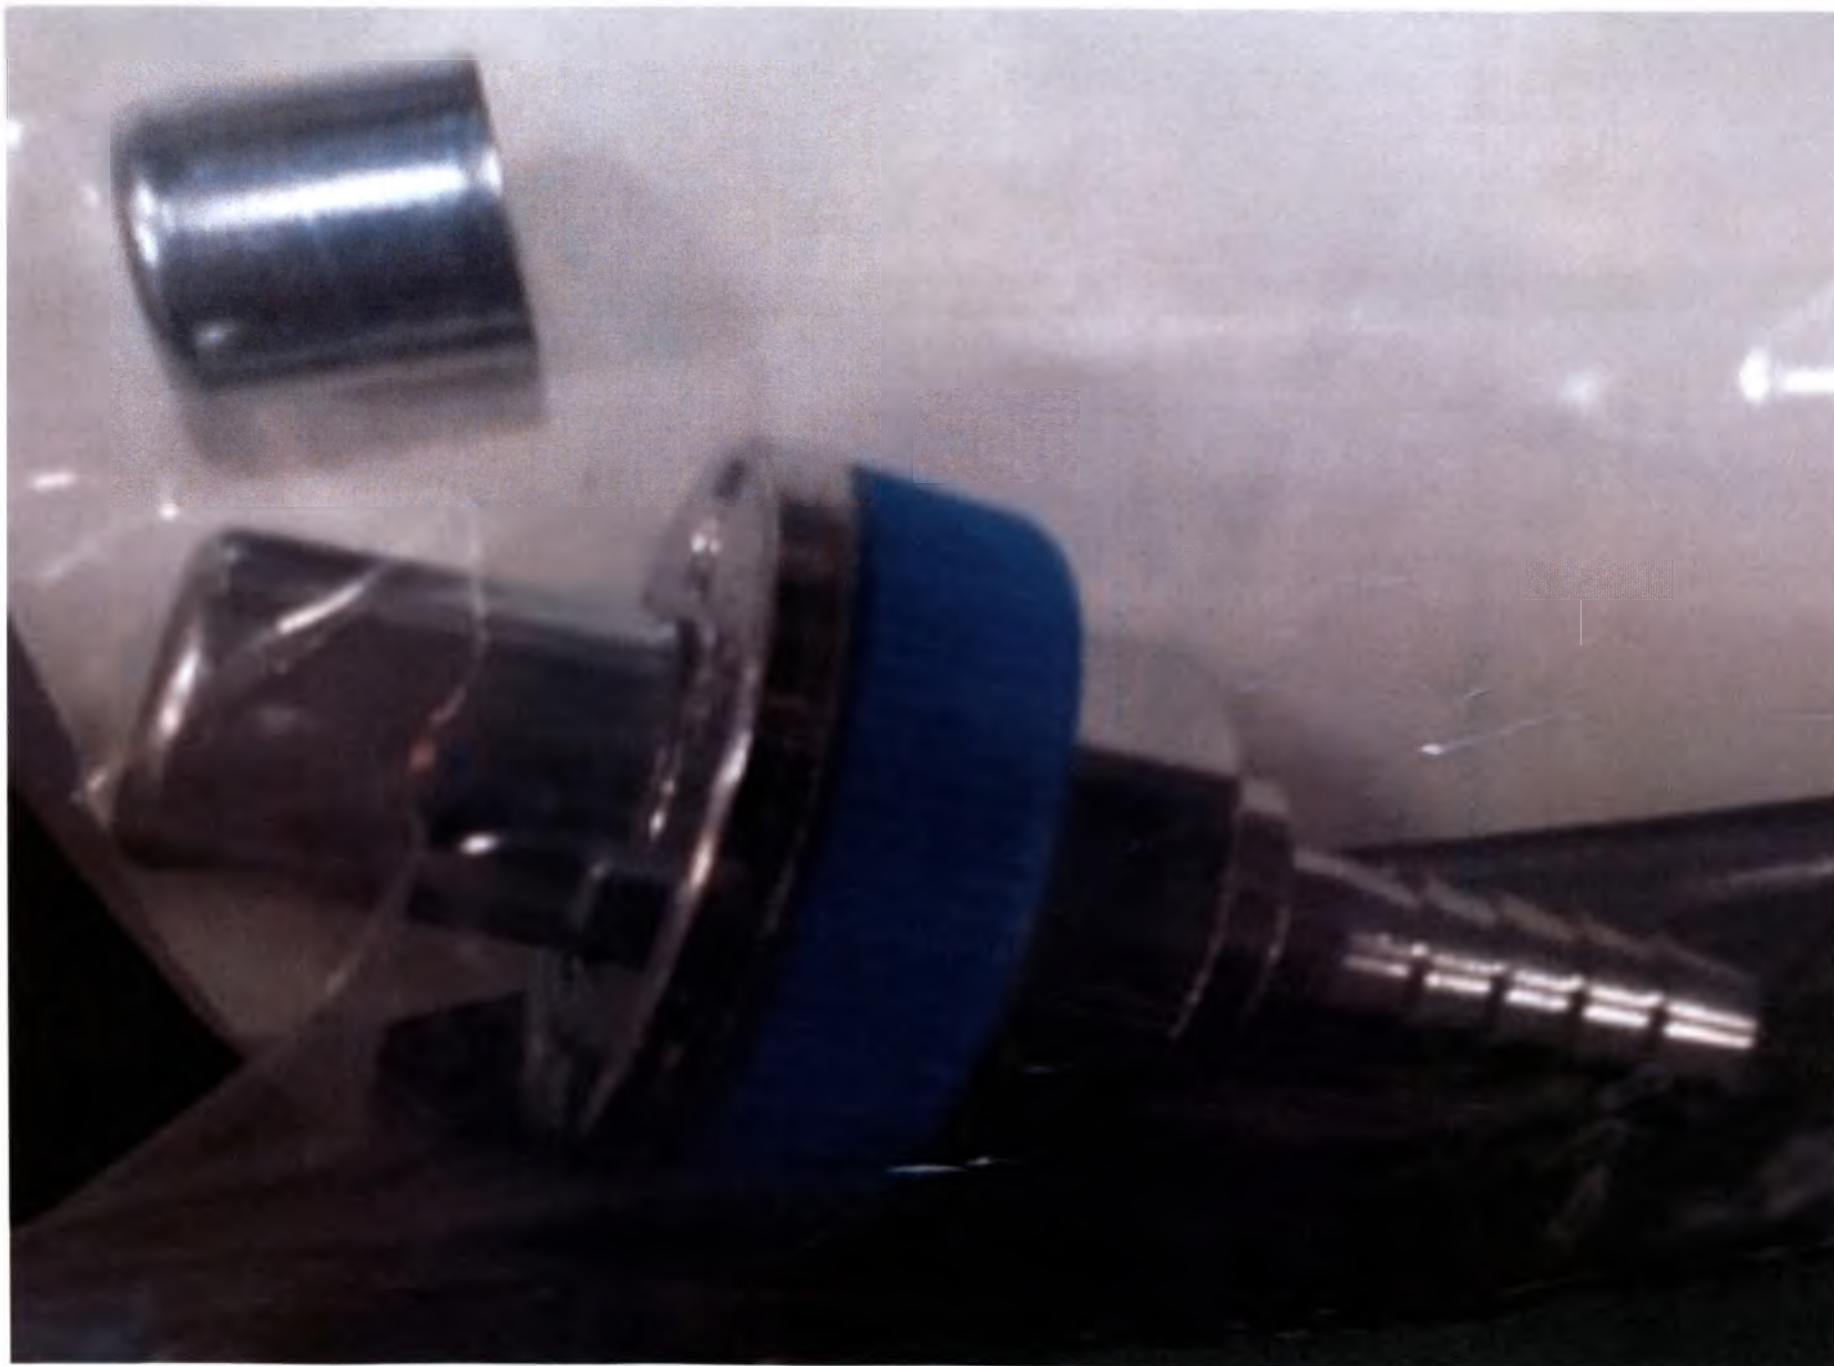








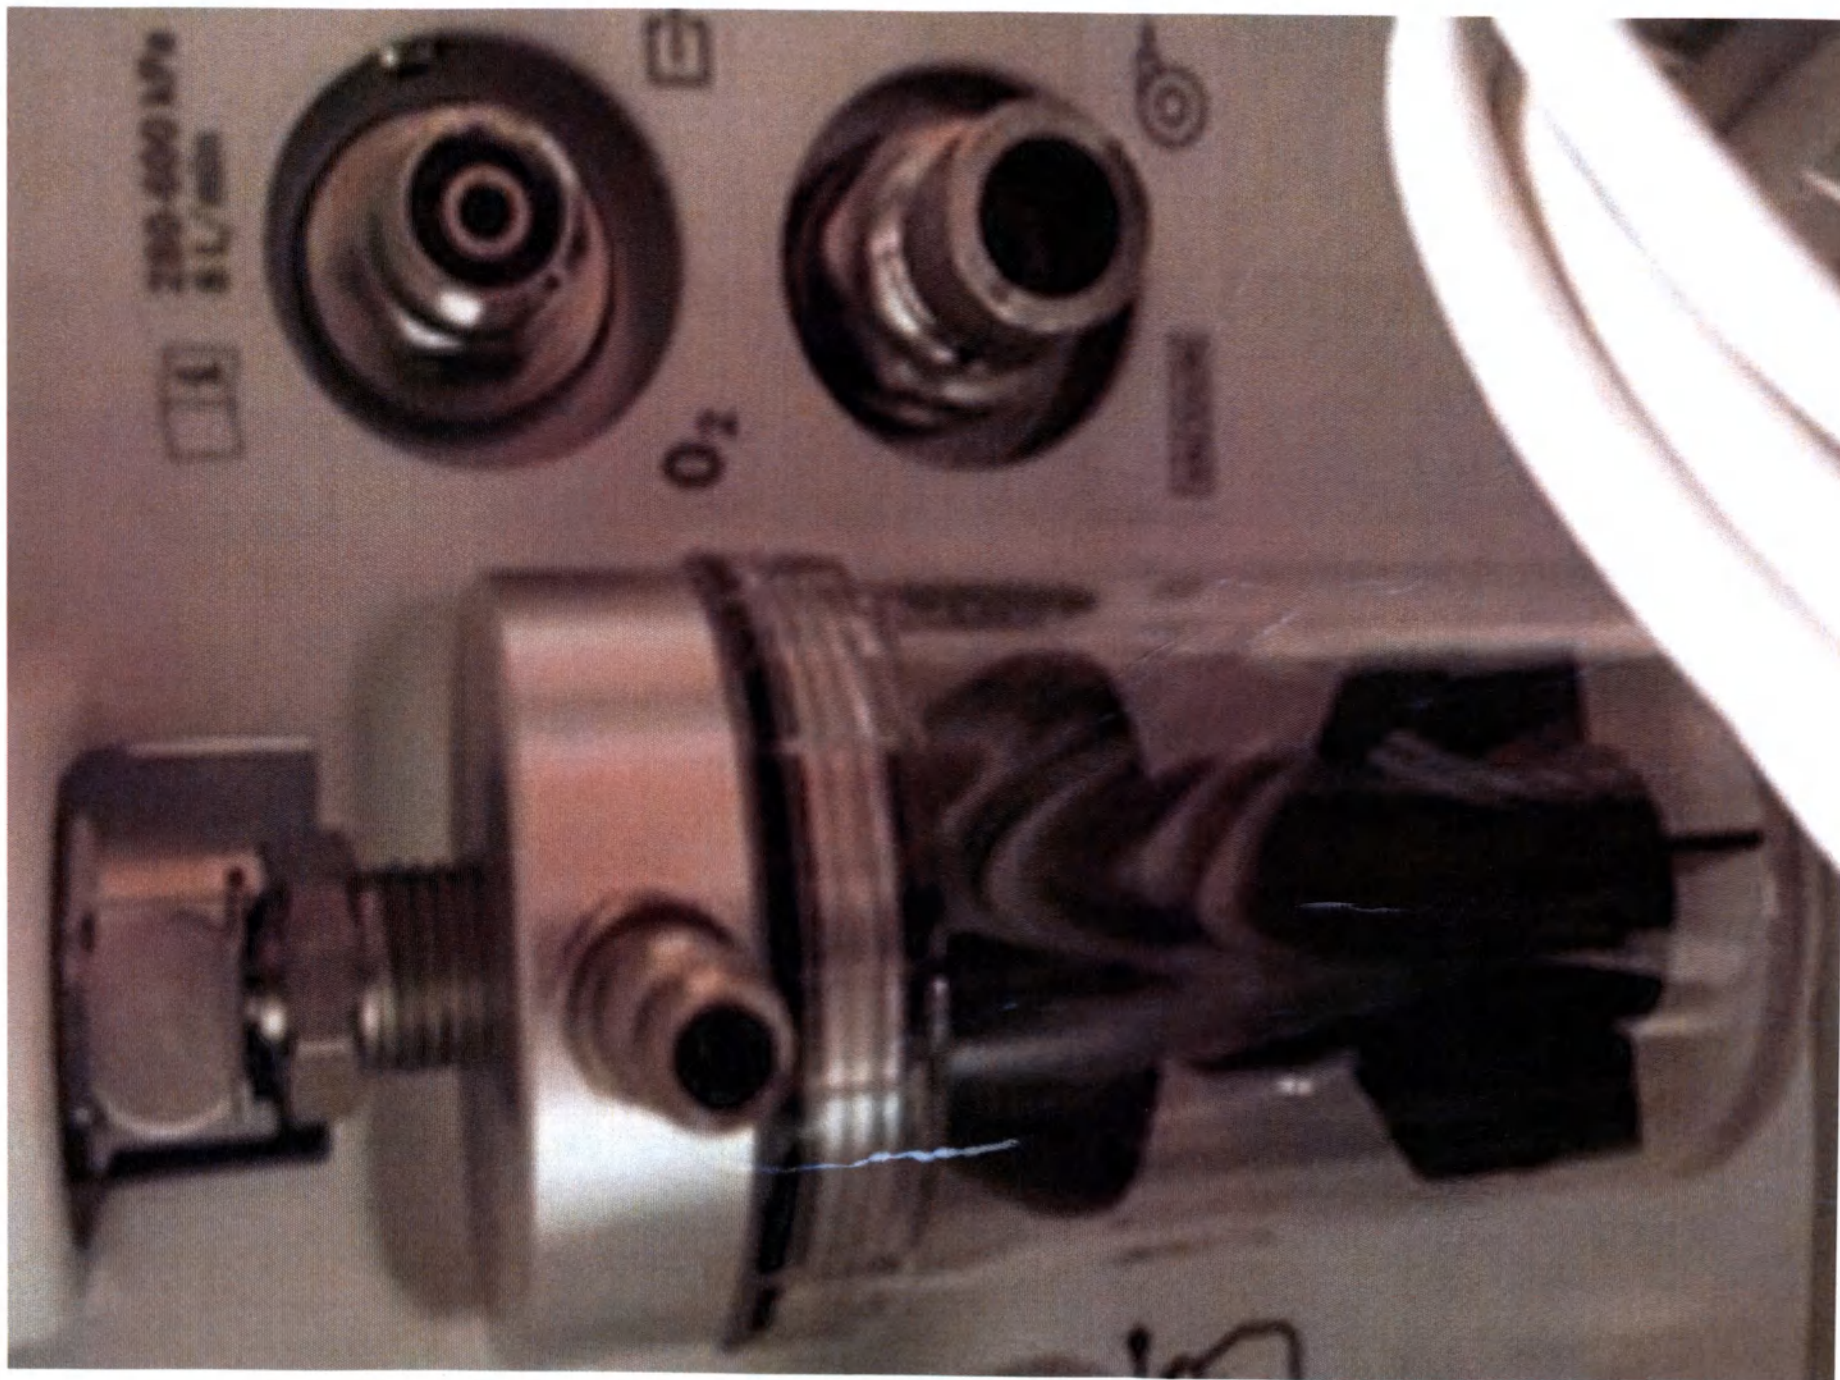





17. Стойка для крепления бронхоотсоса.

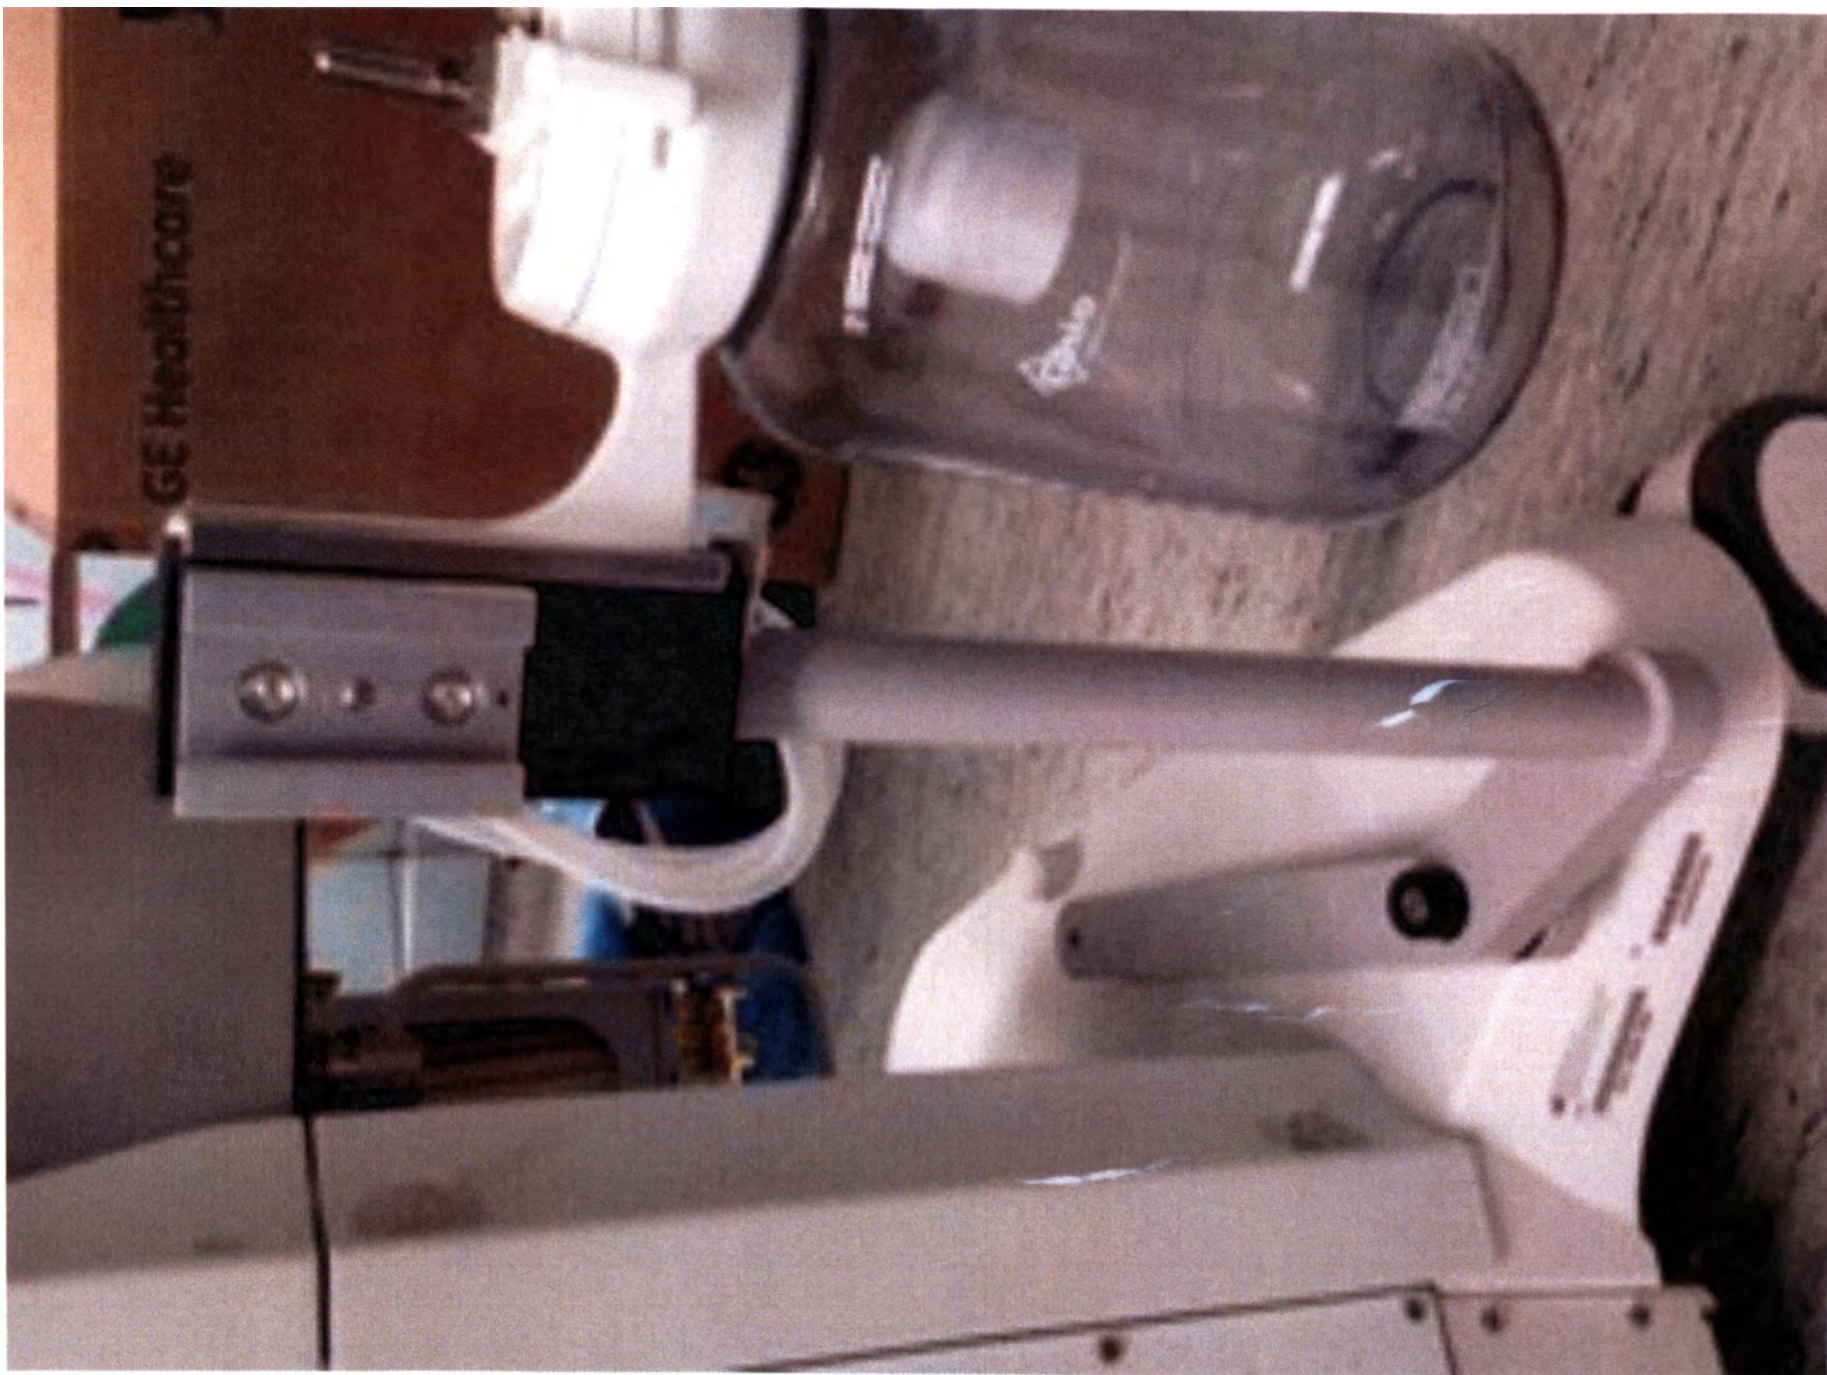



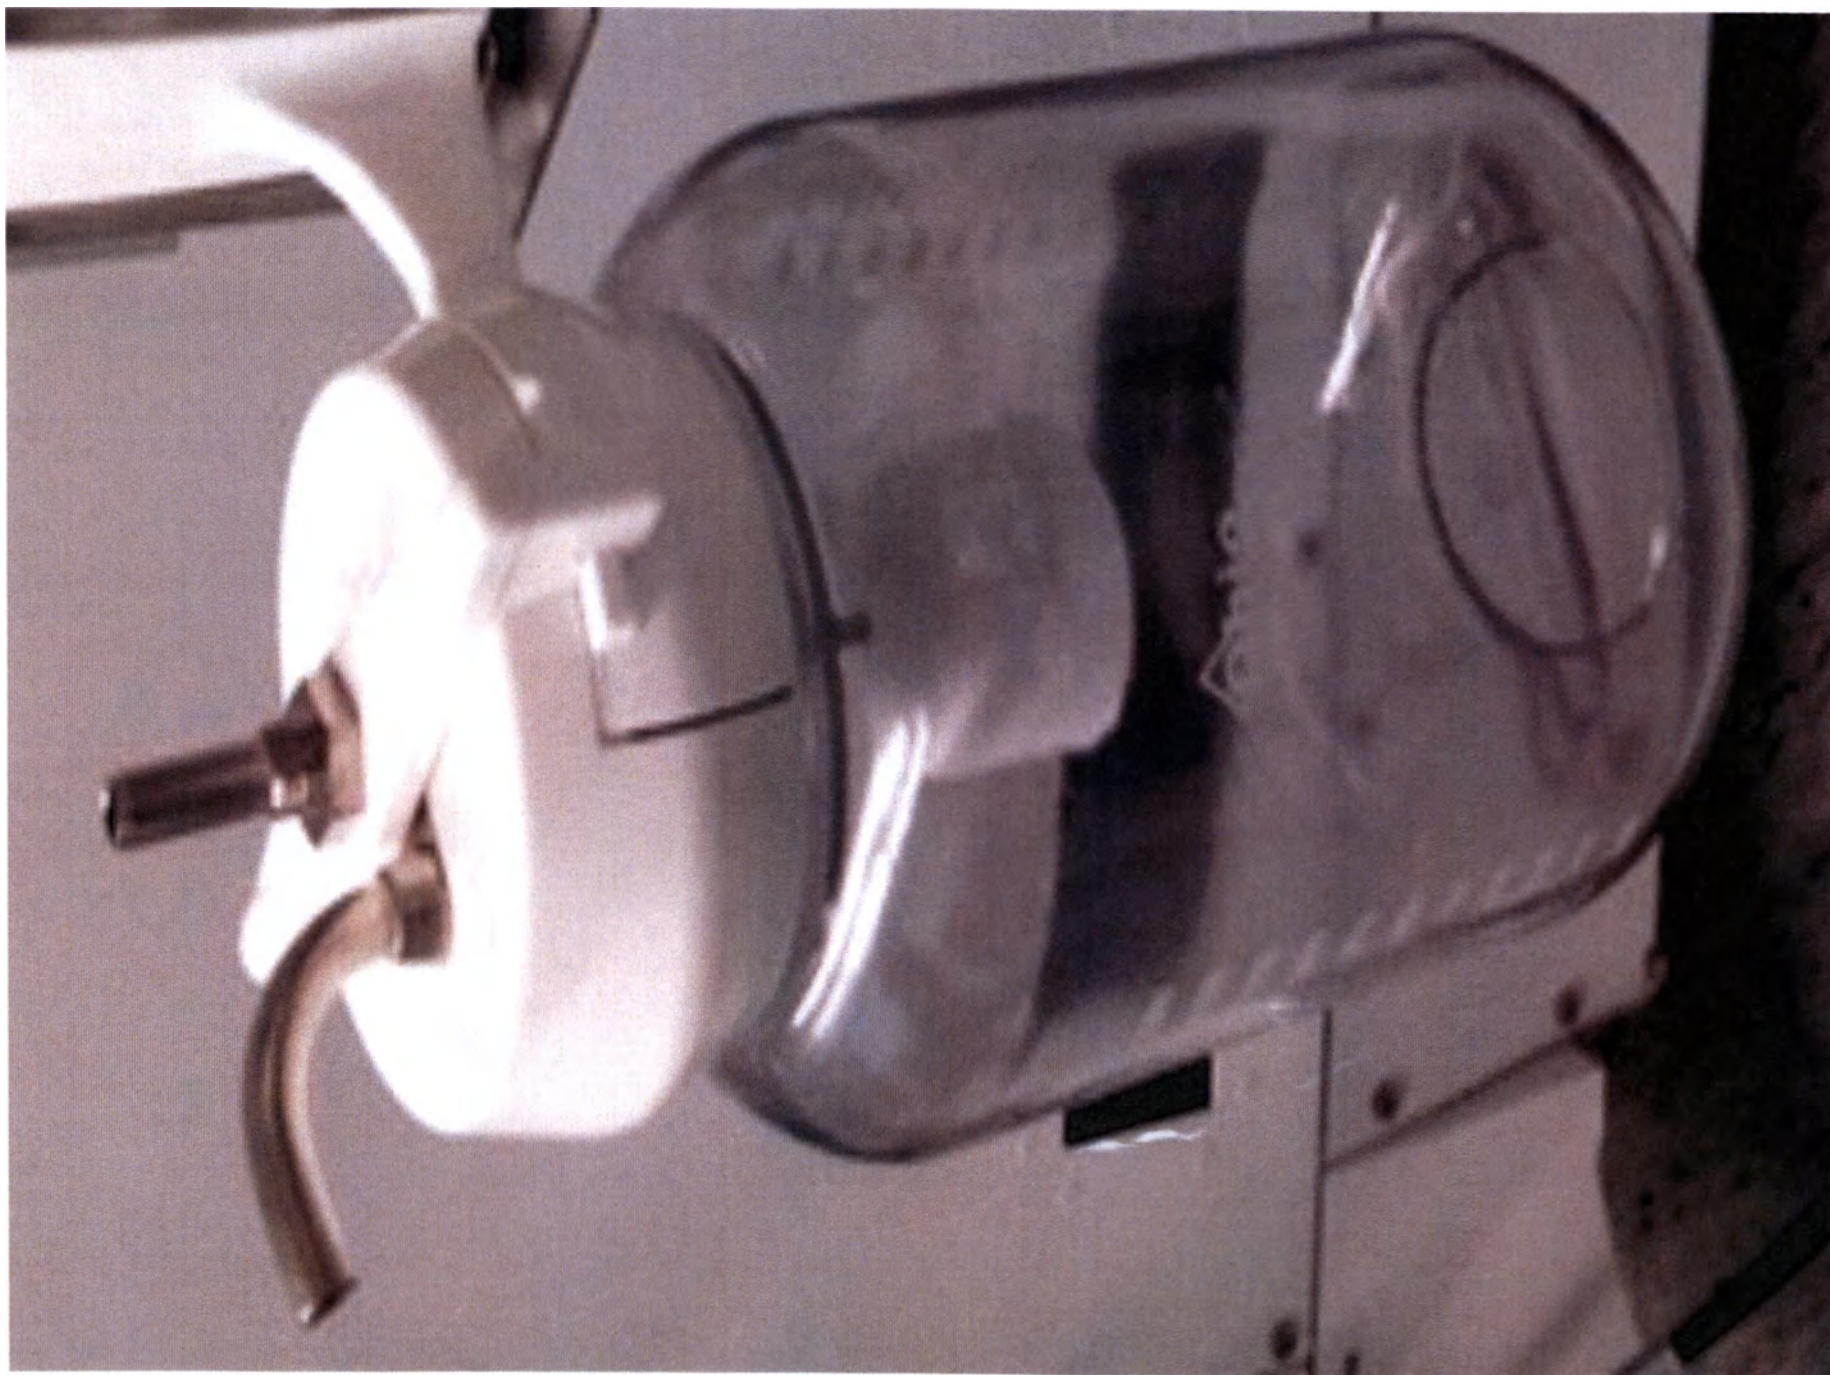



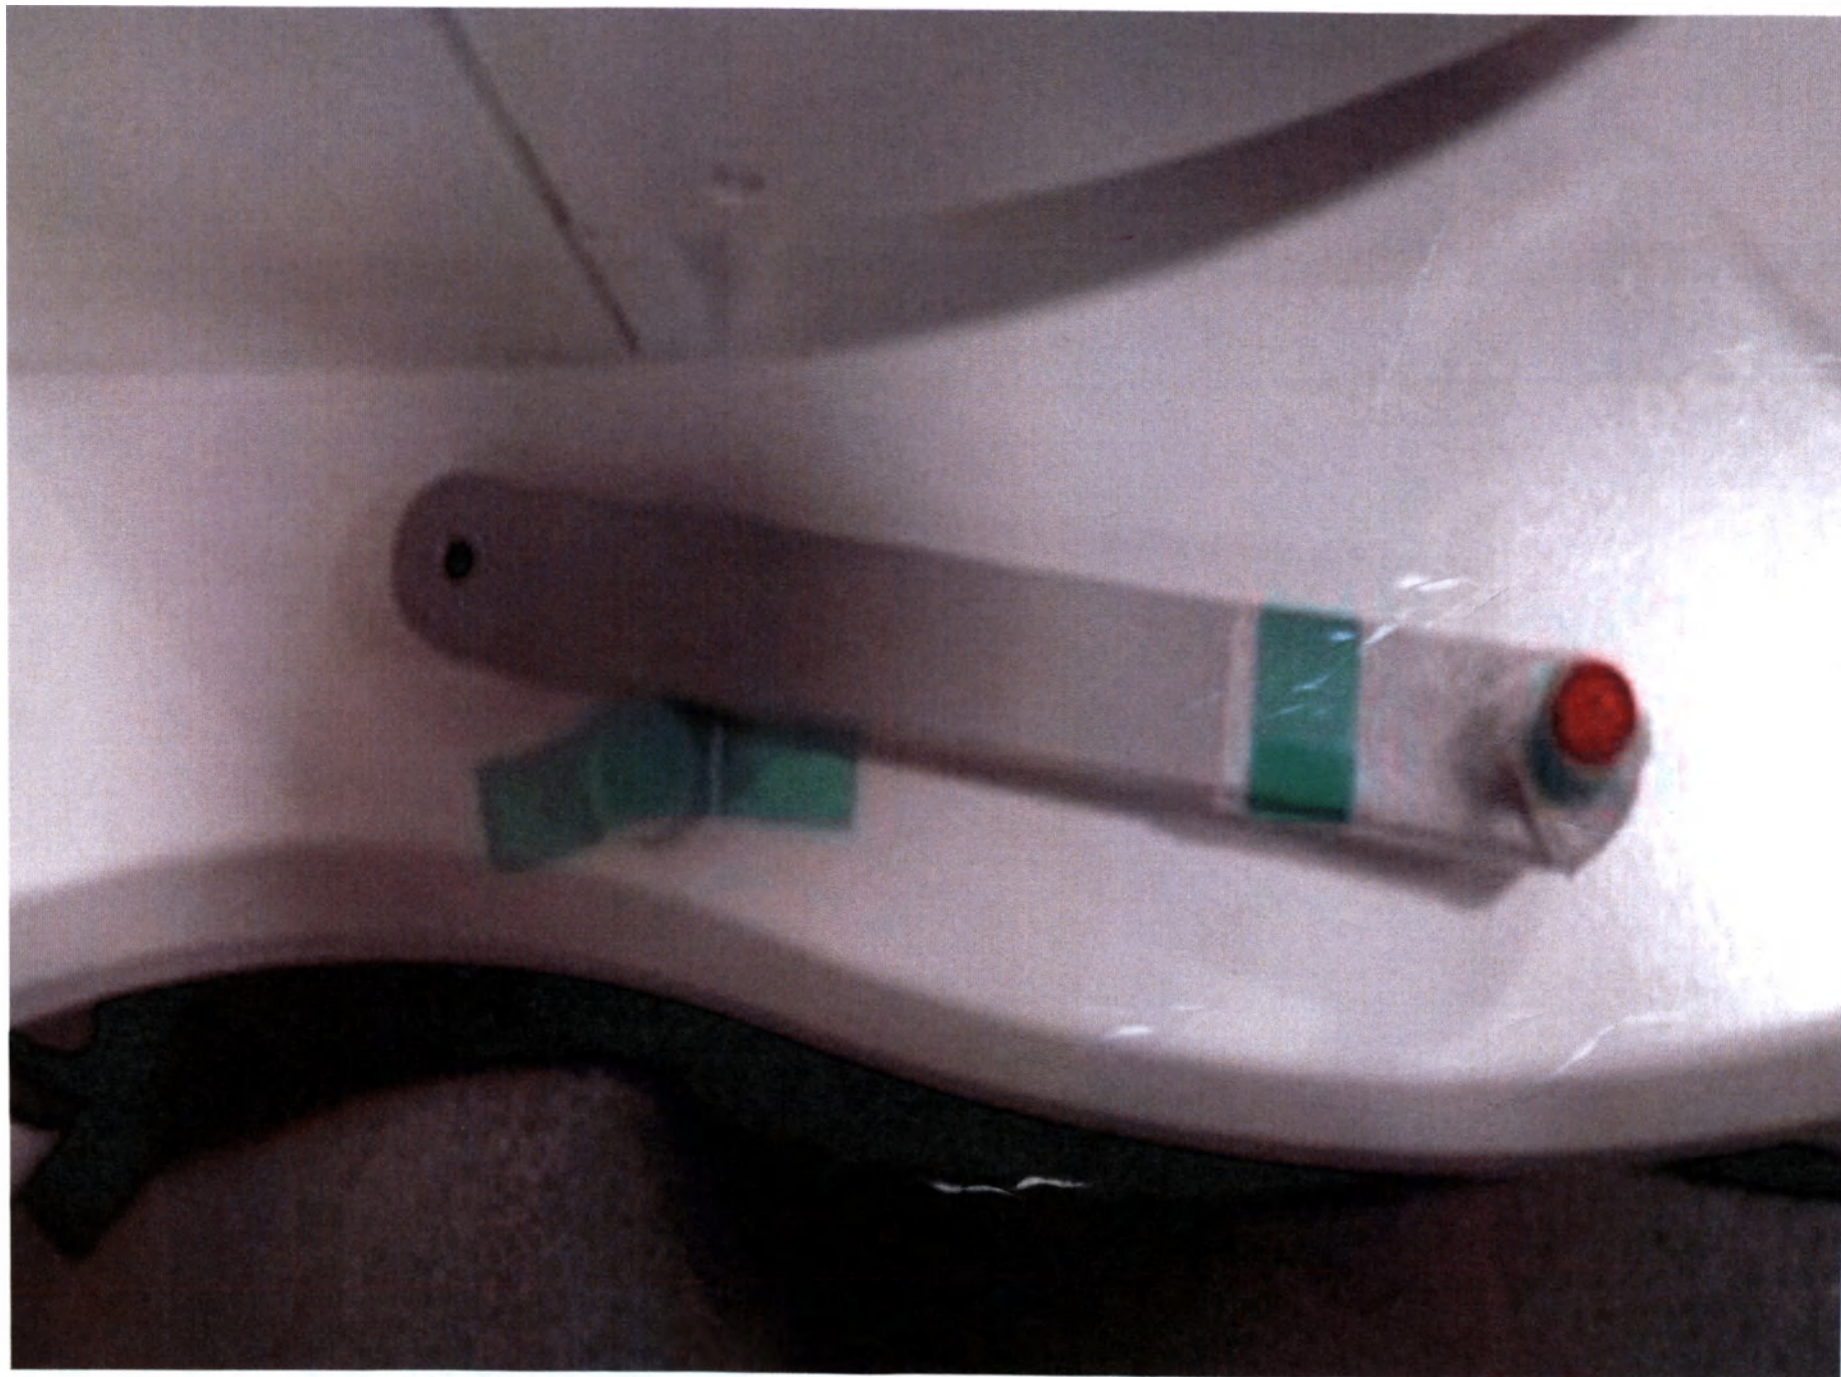



## 20. Кронштейн для банки бронхоотсоса.







21. Шланг для банки бронхоотсоса.





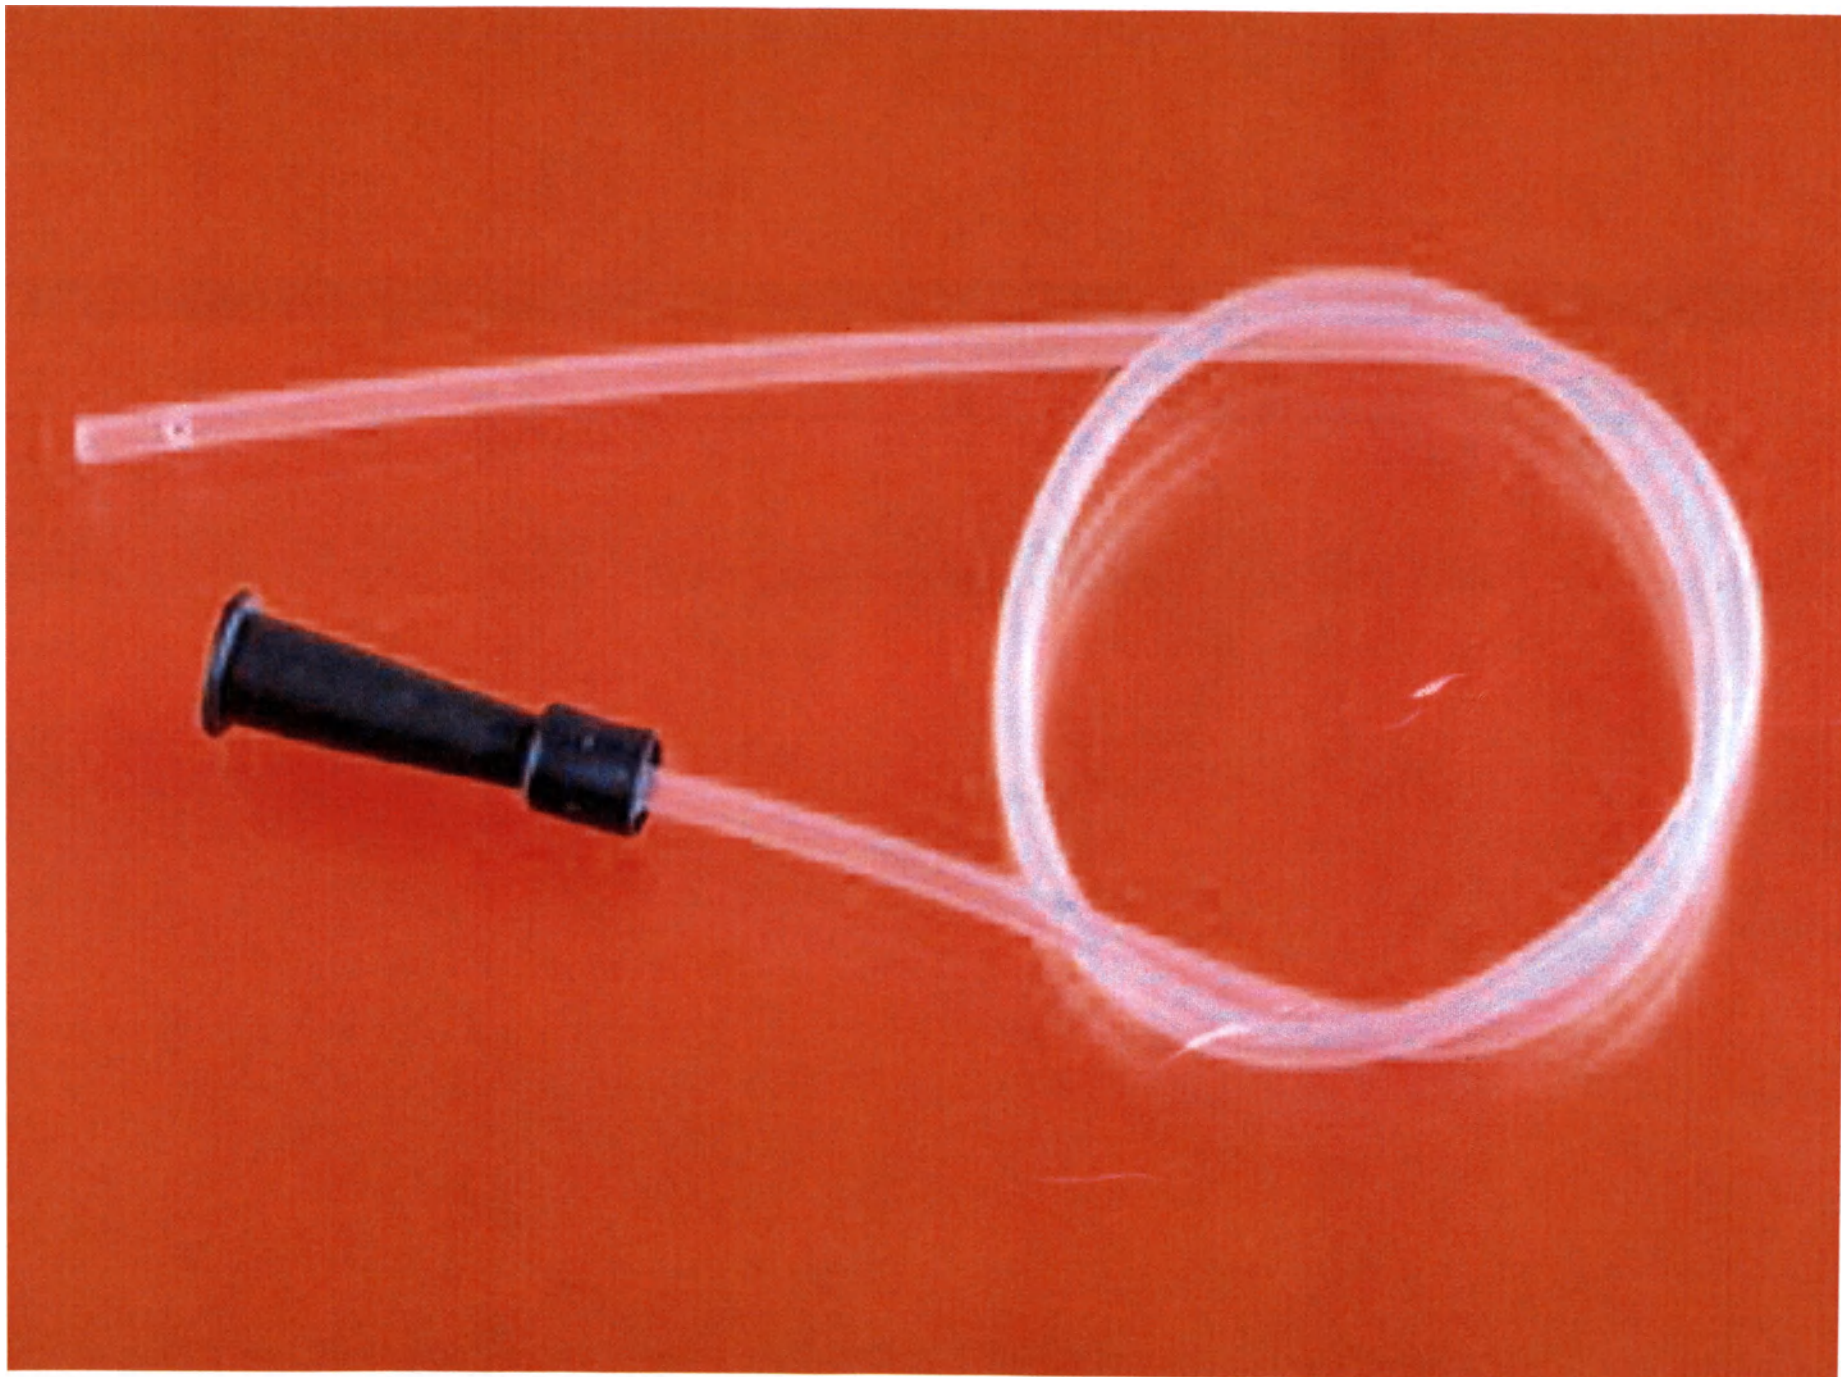



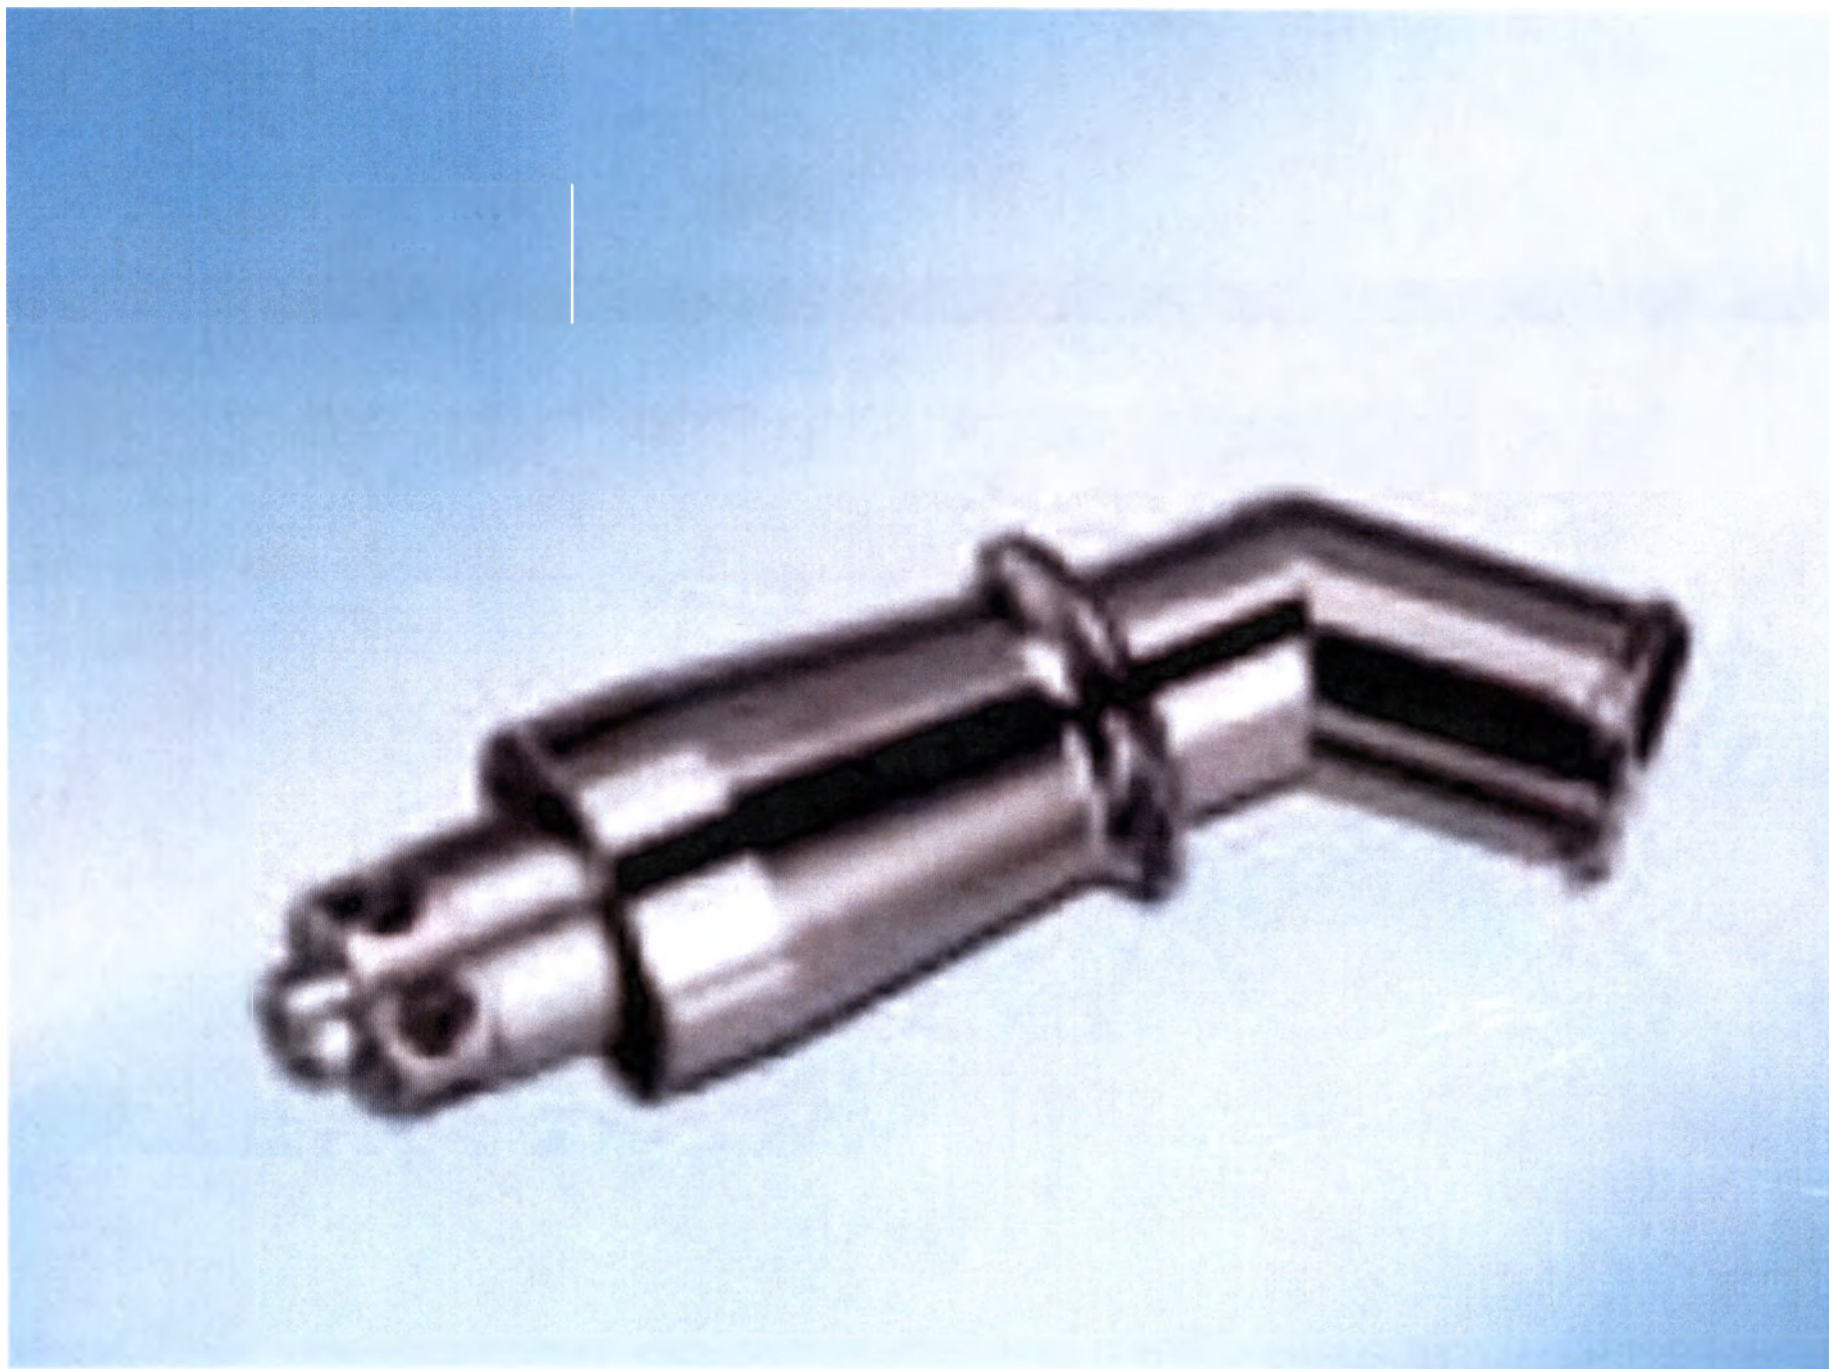



24. Разъем для подсоединения шланга воздуха.





25. Разъем для подсоединения шланга кислорода.





26. Тележка на колесах с двумя ящиками.





27. Тележка на колесах с тремя ящиками.





28. Тележка на колесах с четырьмя ящиками без возможности установки модулей.










30. Ручка для транспортировки аппарата.

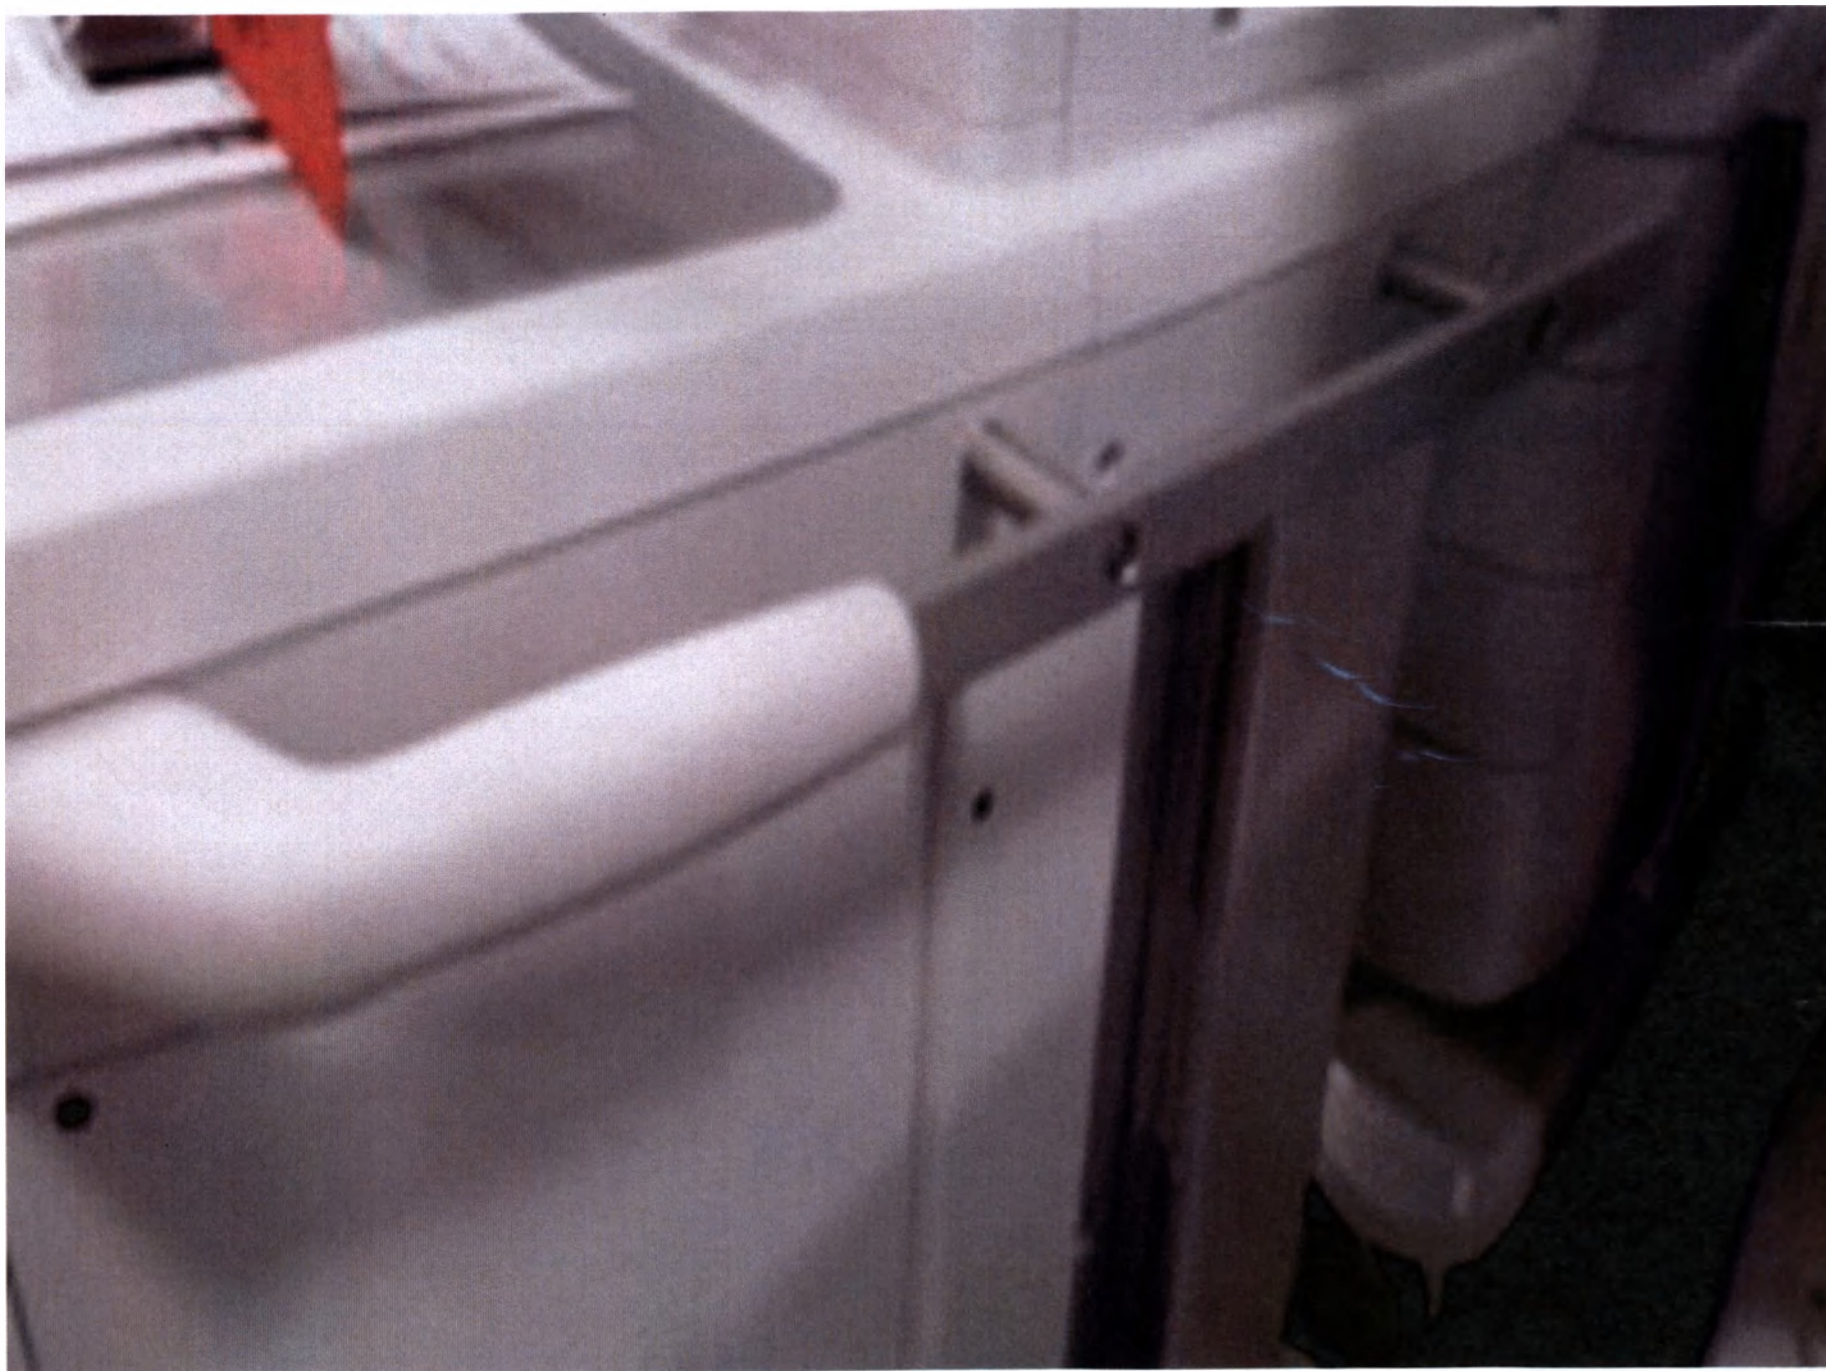




### 31. Столик для инструментов.






### 32. Устройство для крепления аппарата на консоль.

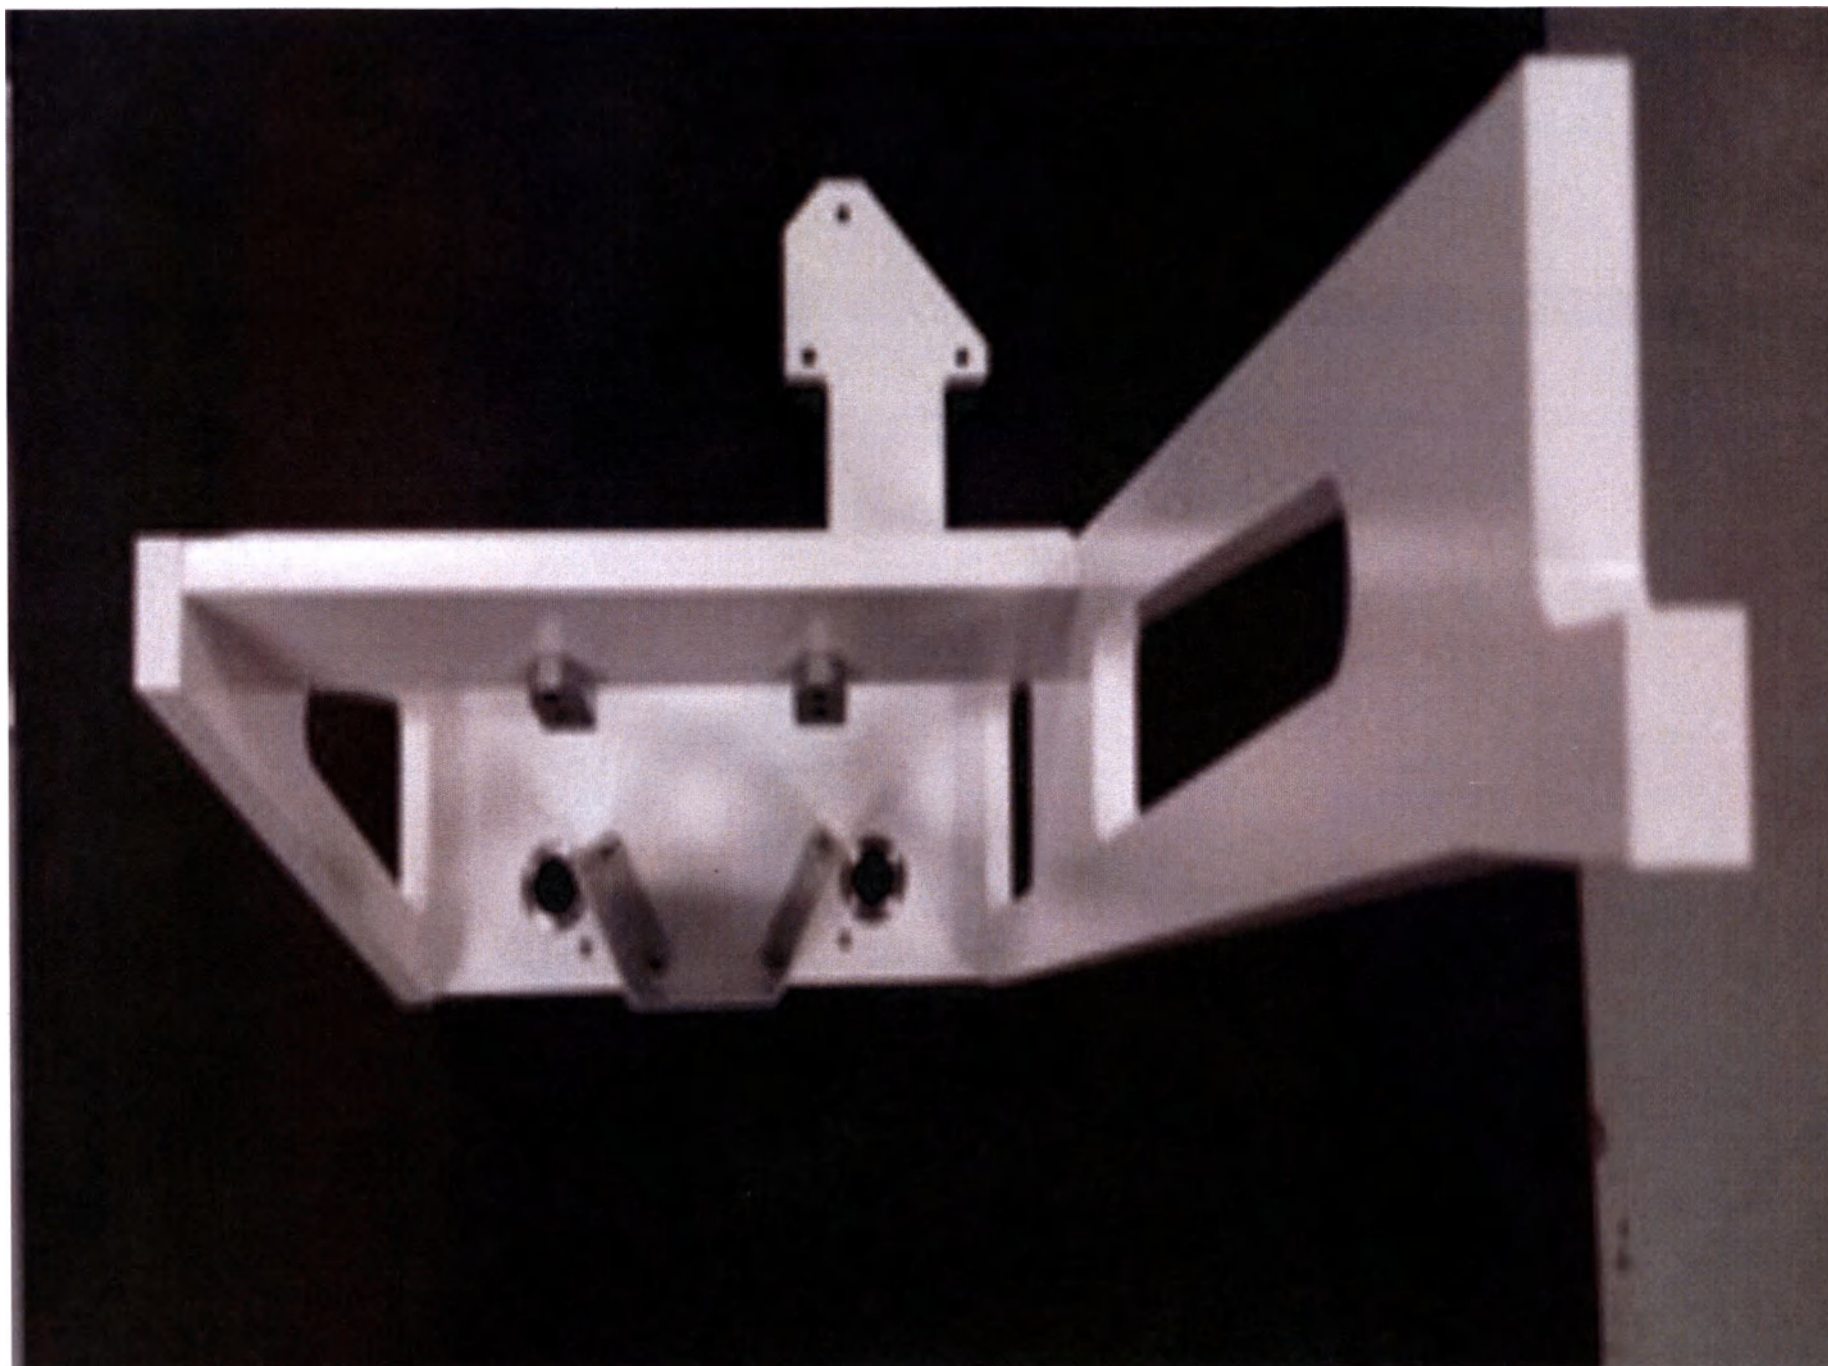




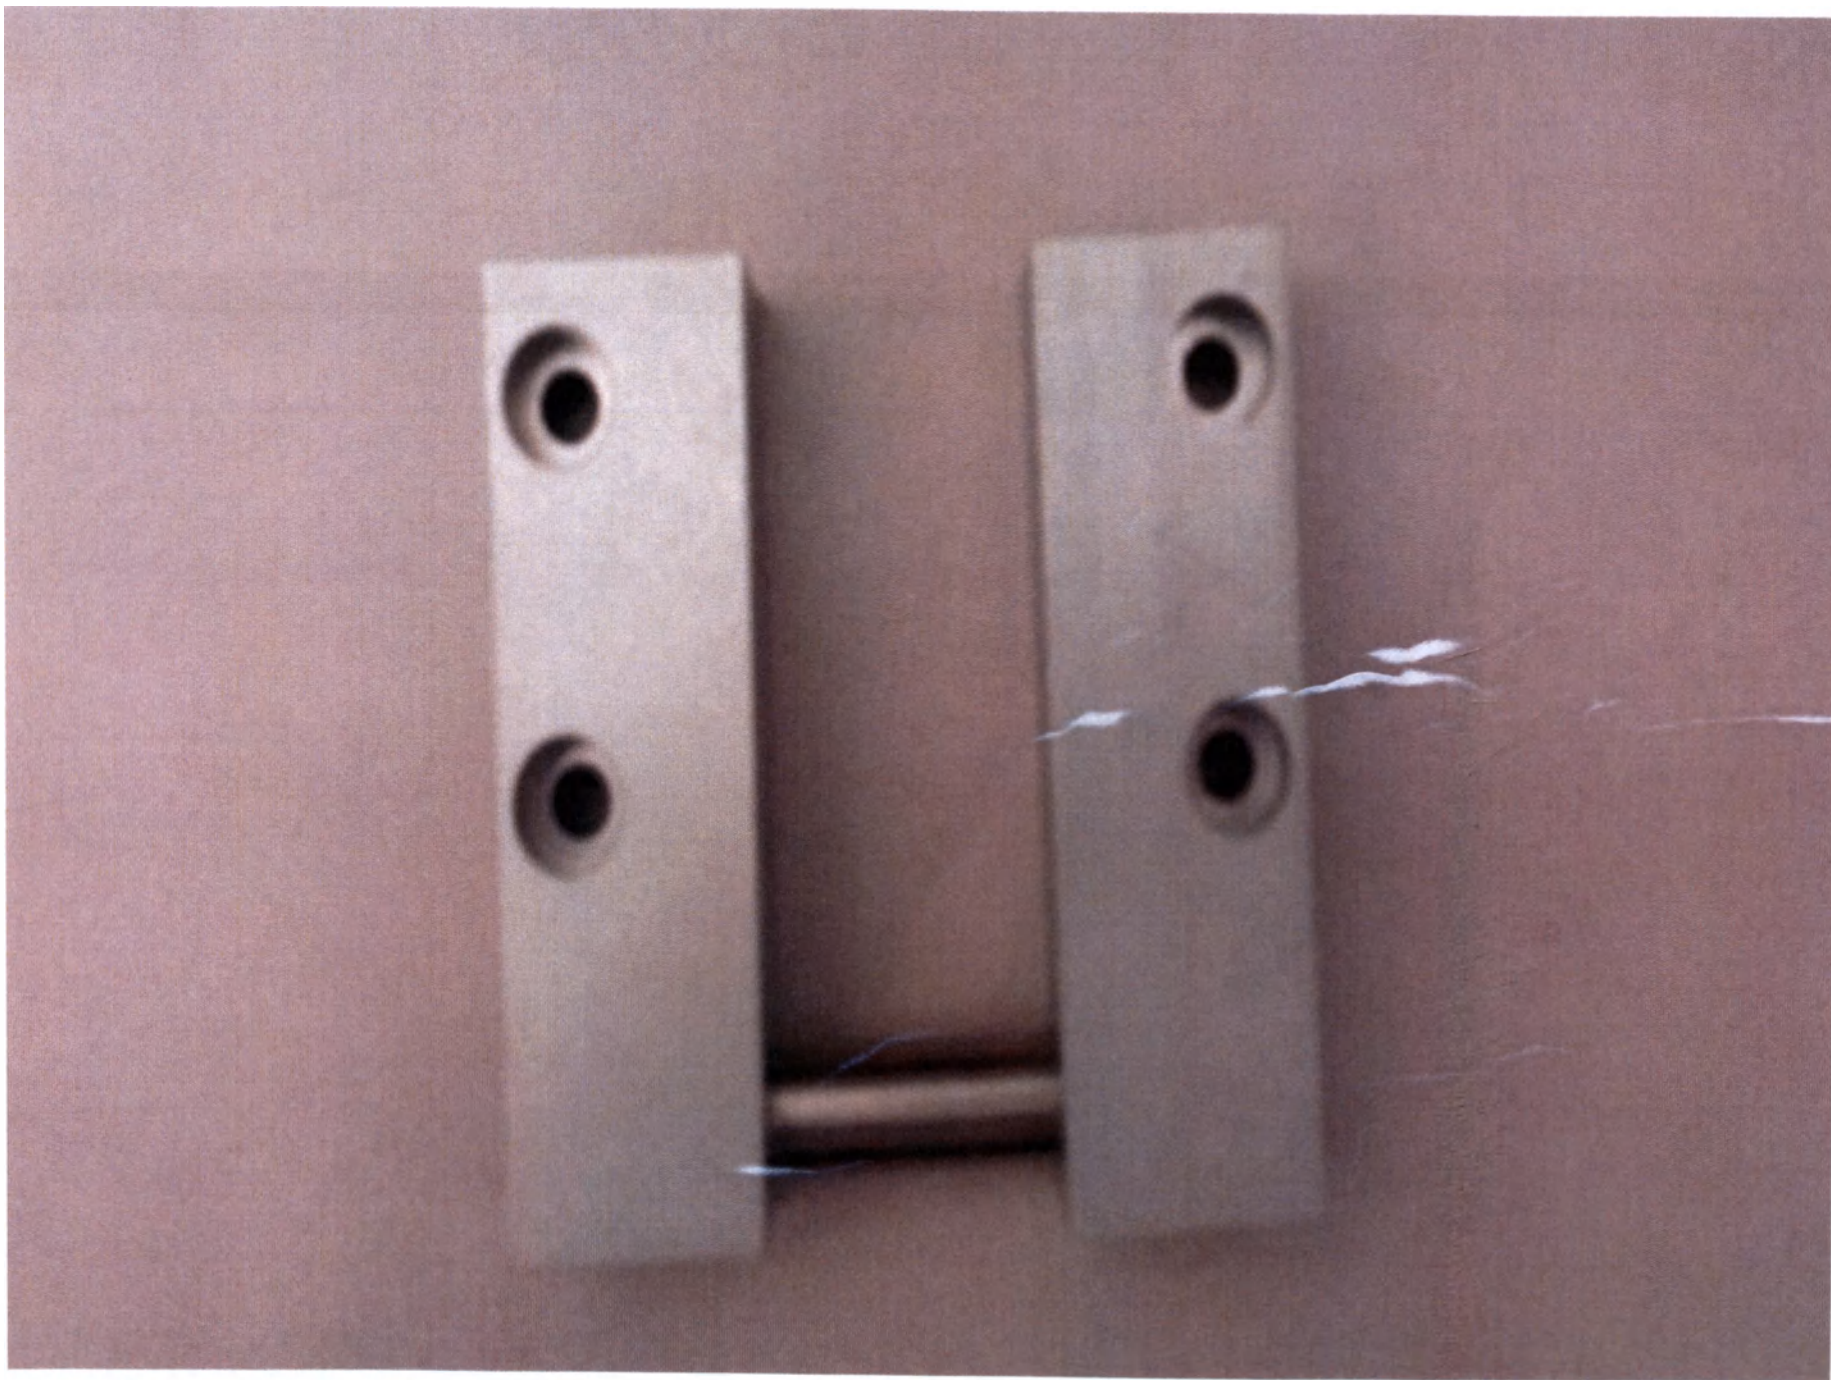



34. Держатель кабелей короткий.

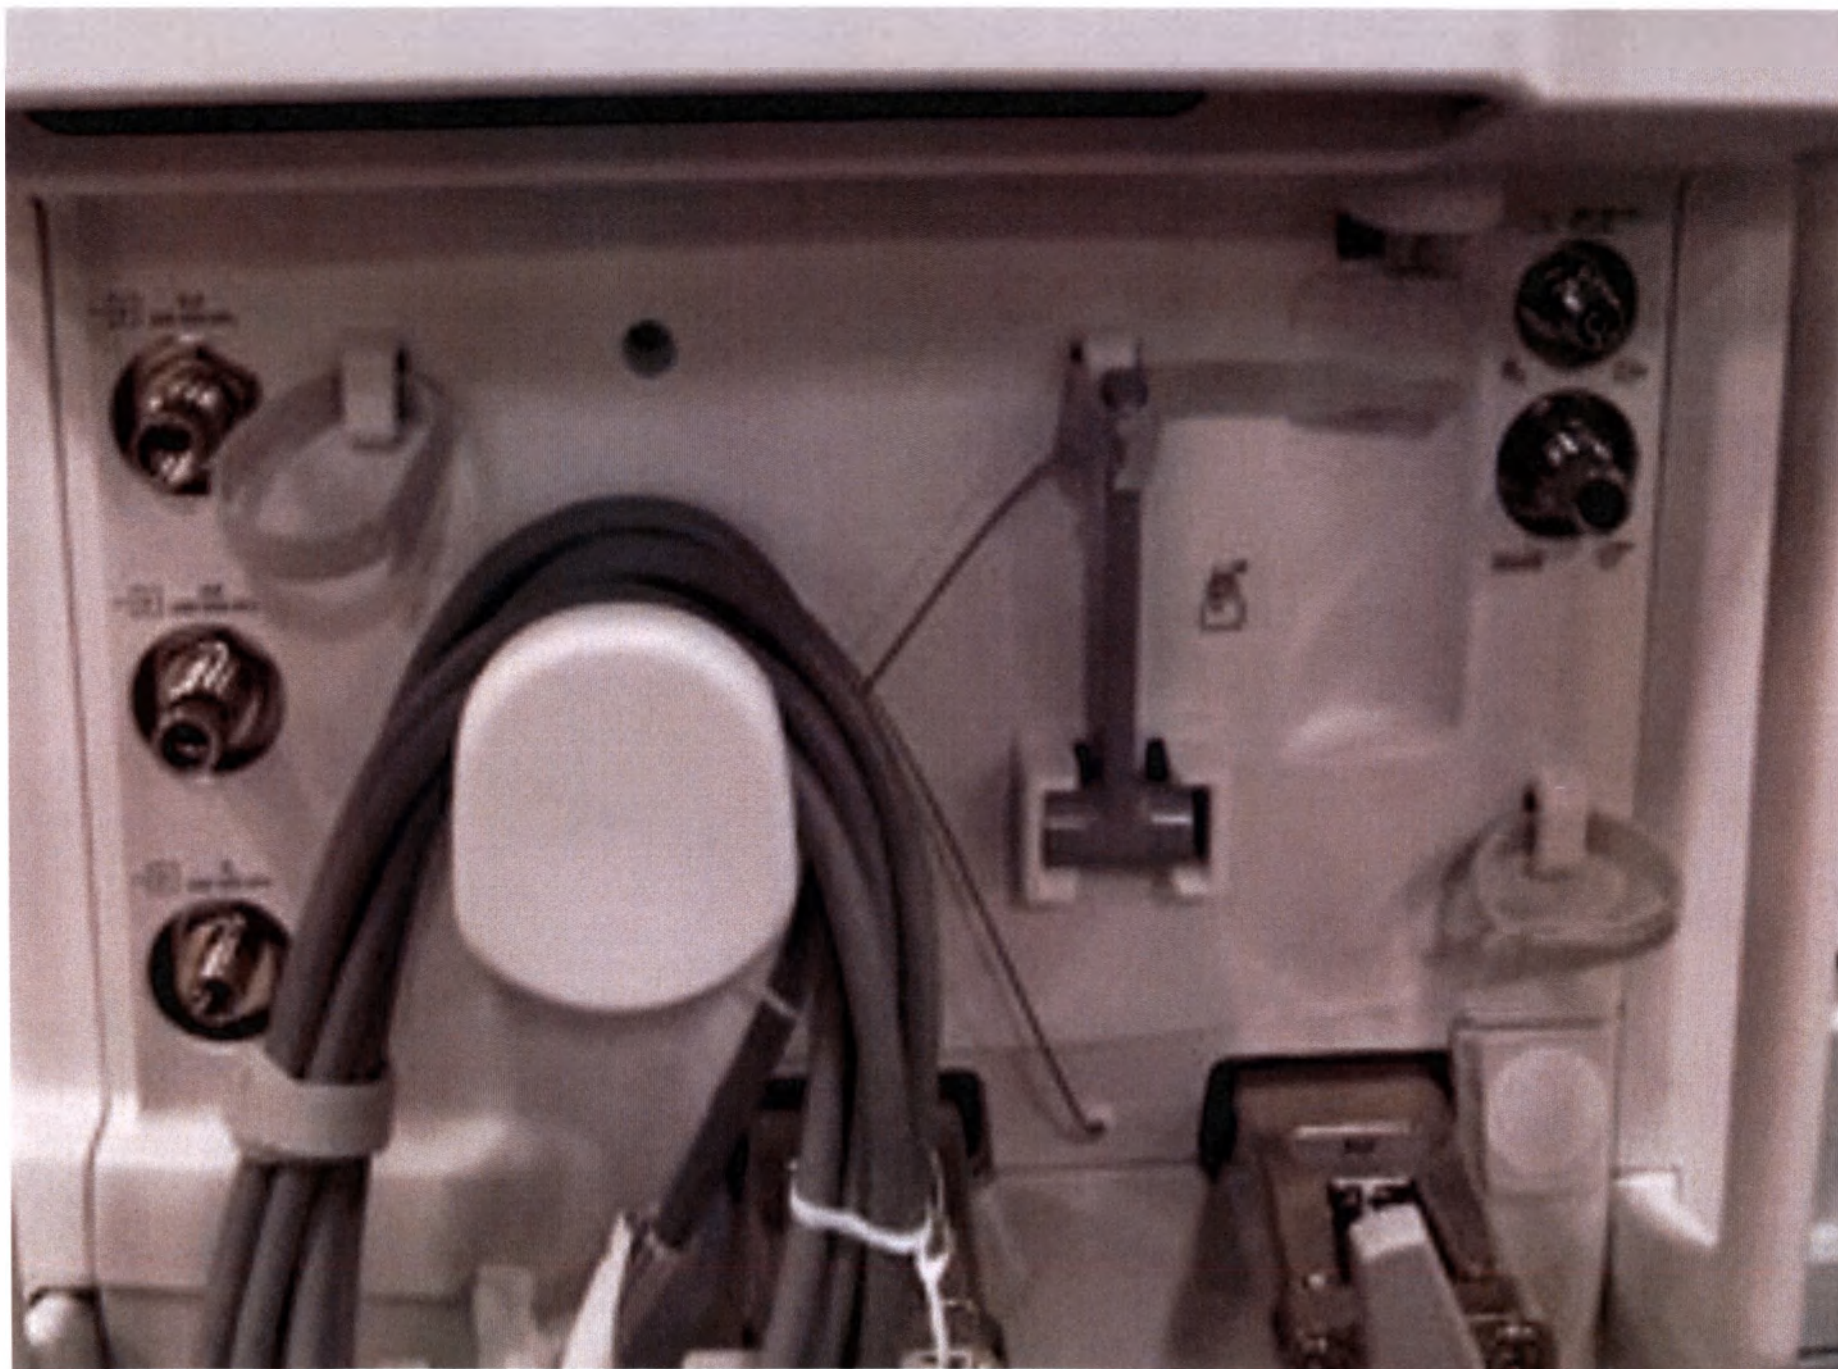







### 36. Держатель кабелей монитора.





37. Держатель монитора пациента горизонтальный.













40. Крюк для крепления принадлежностей.





41. Защита для колес пластиковая.







42. Стойка 50 см.






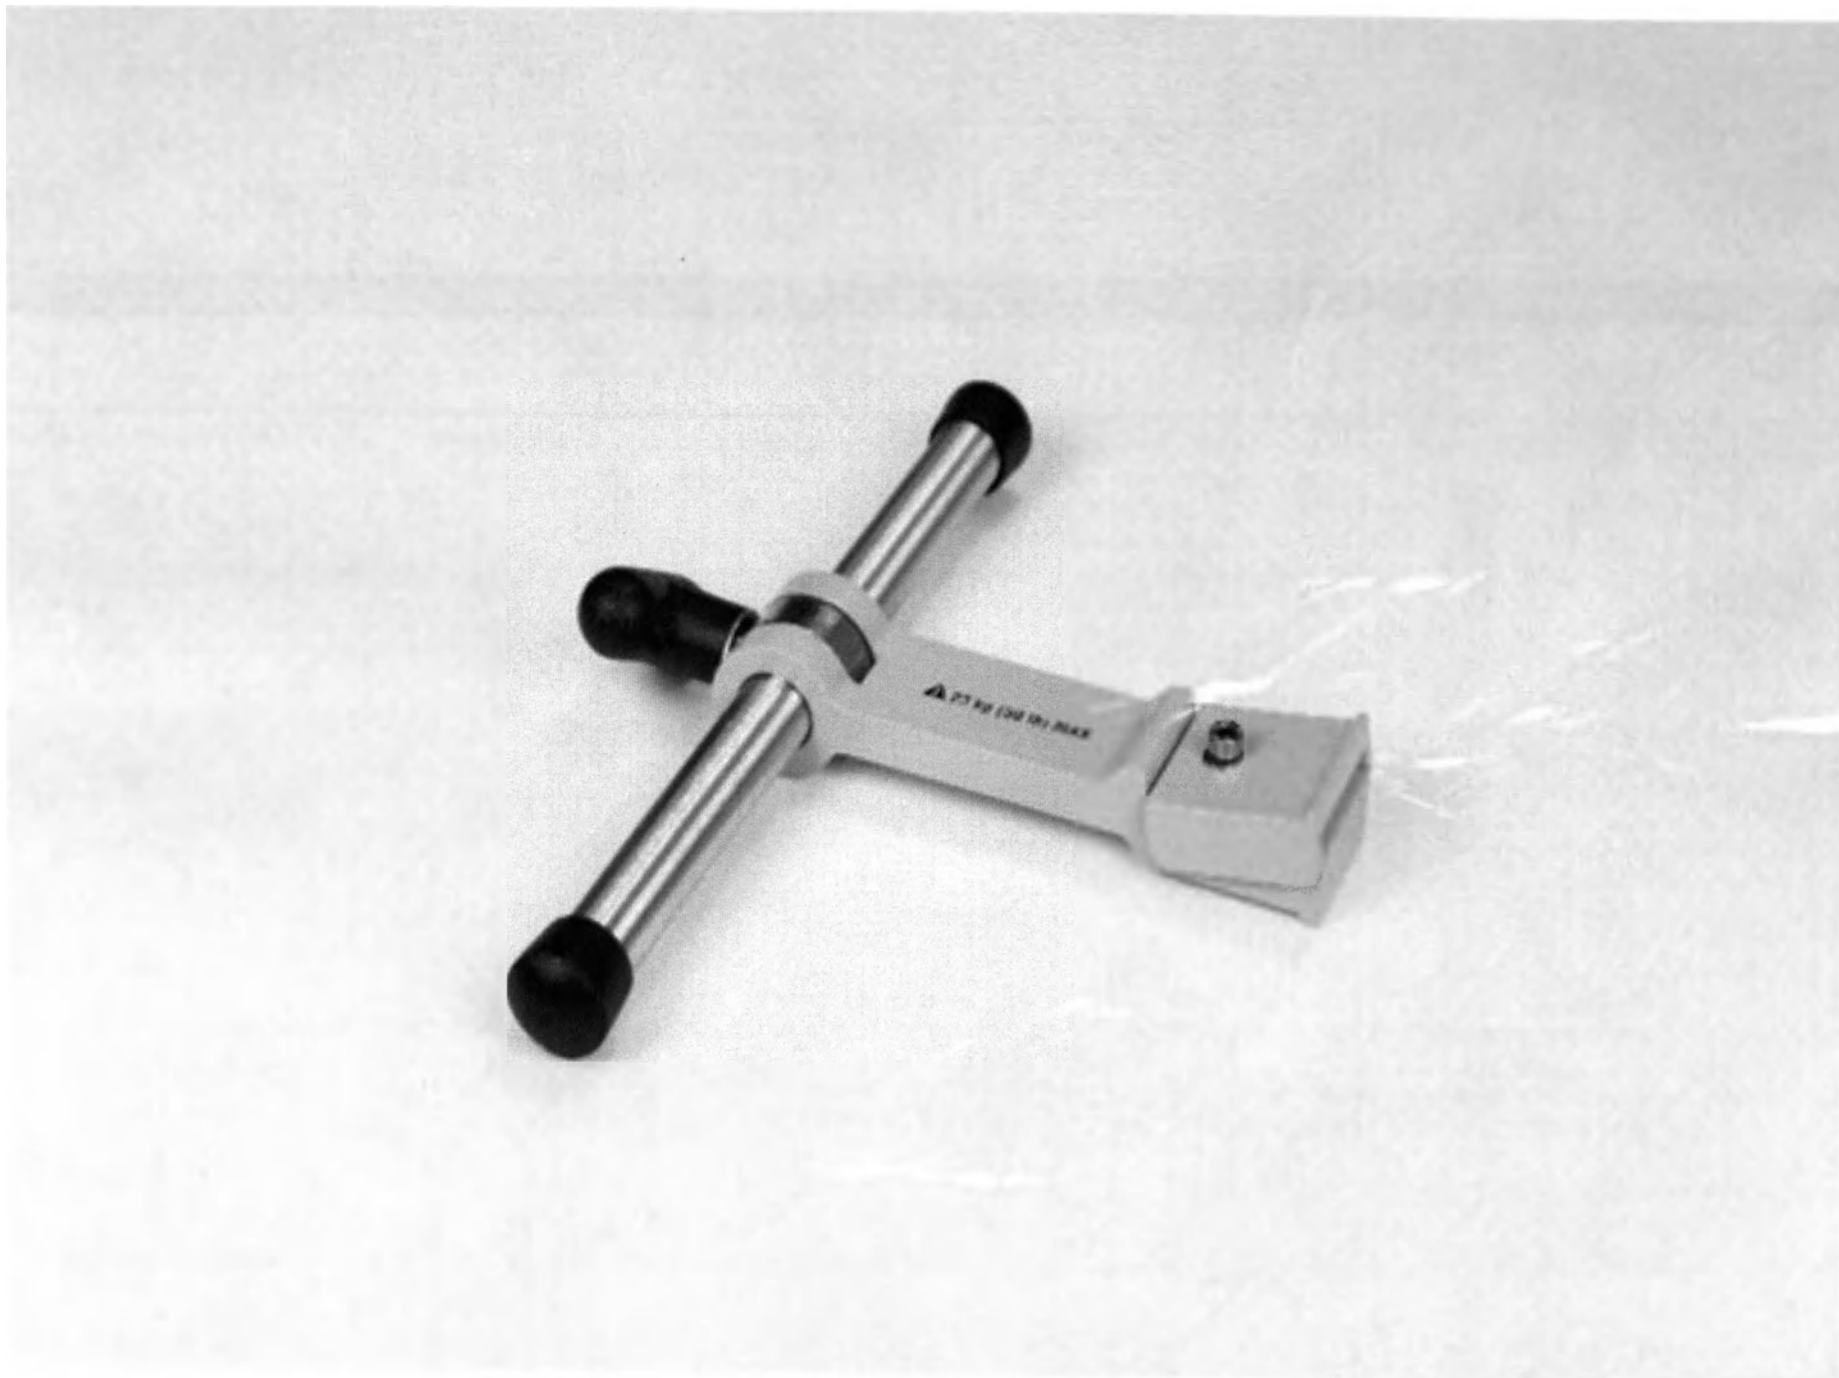




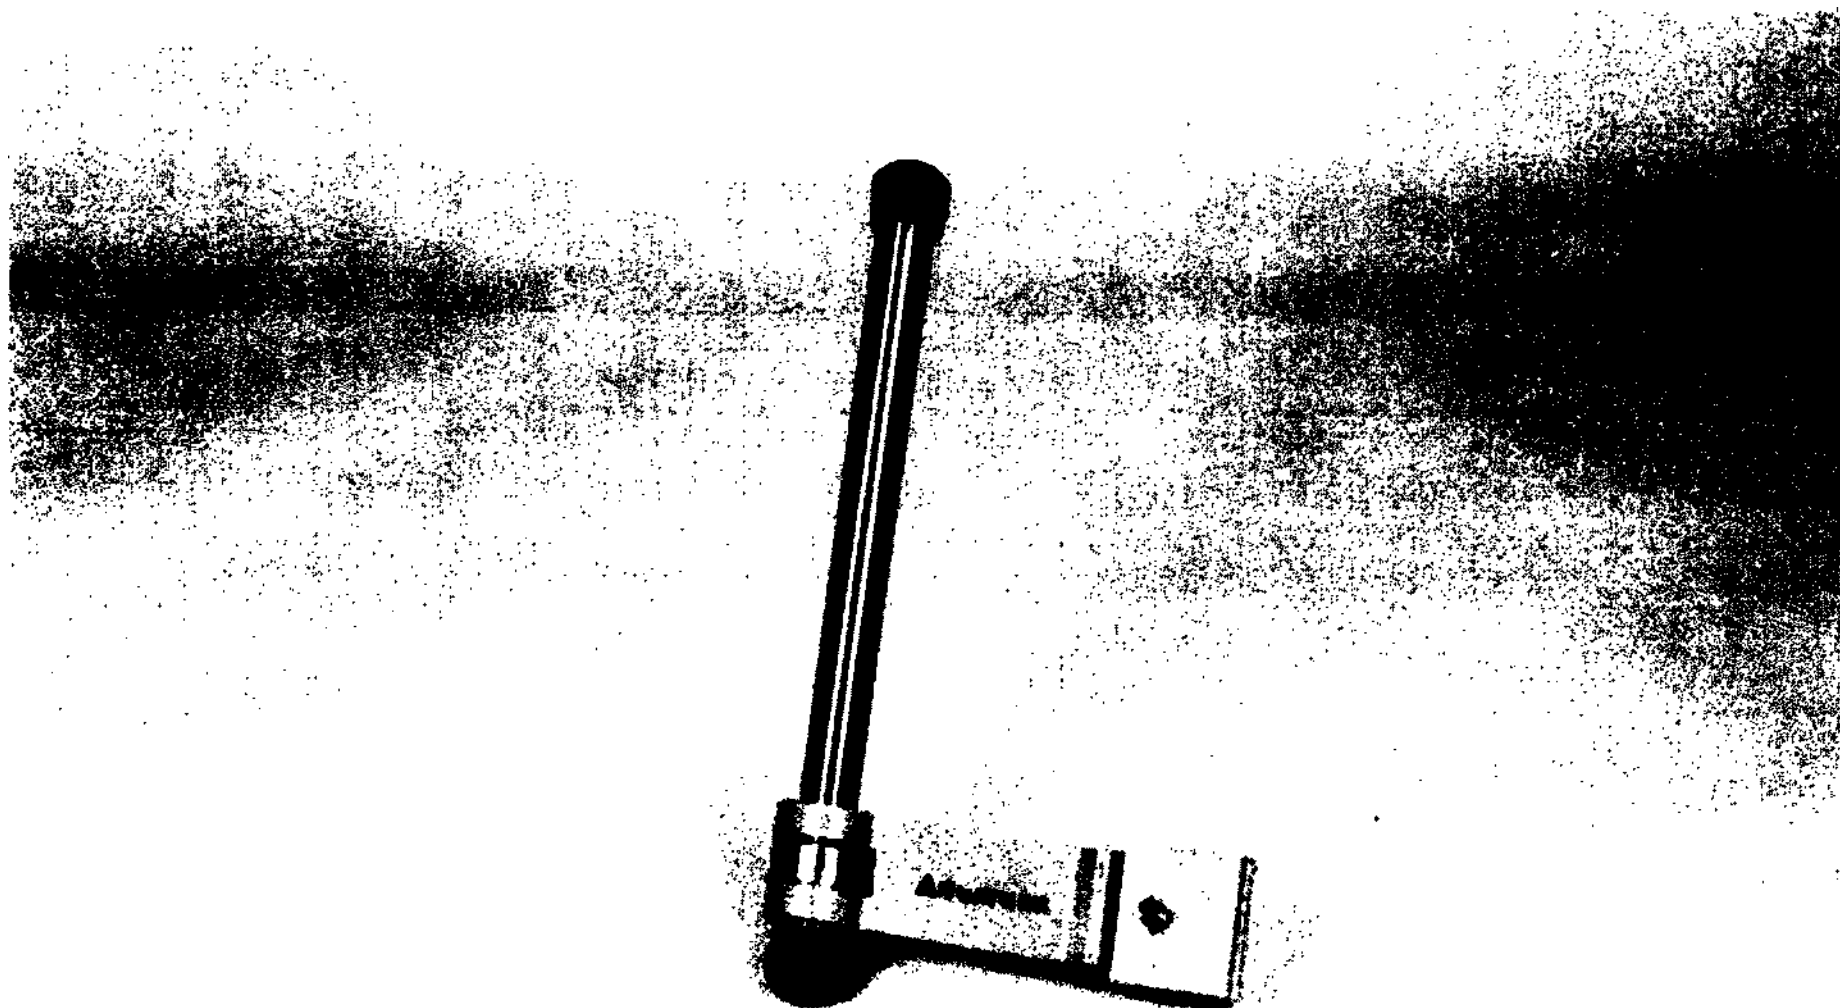




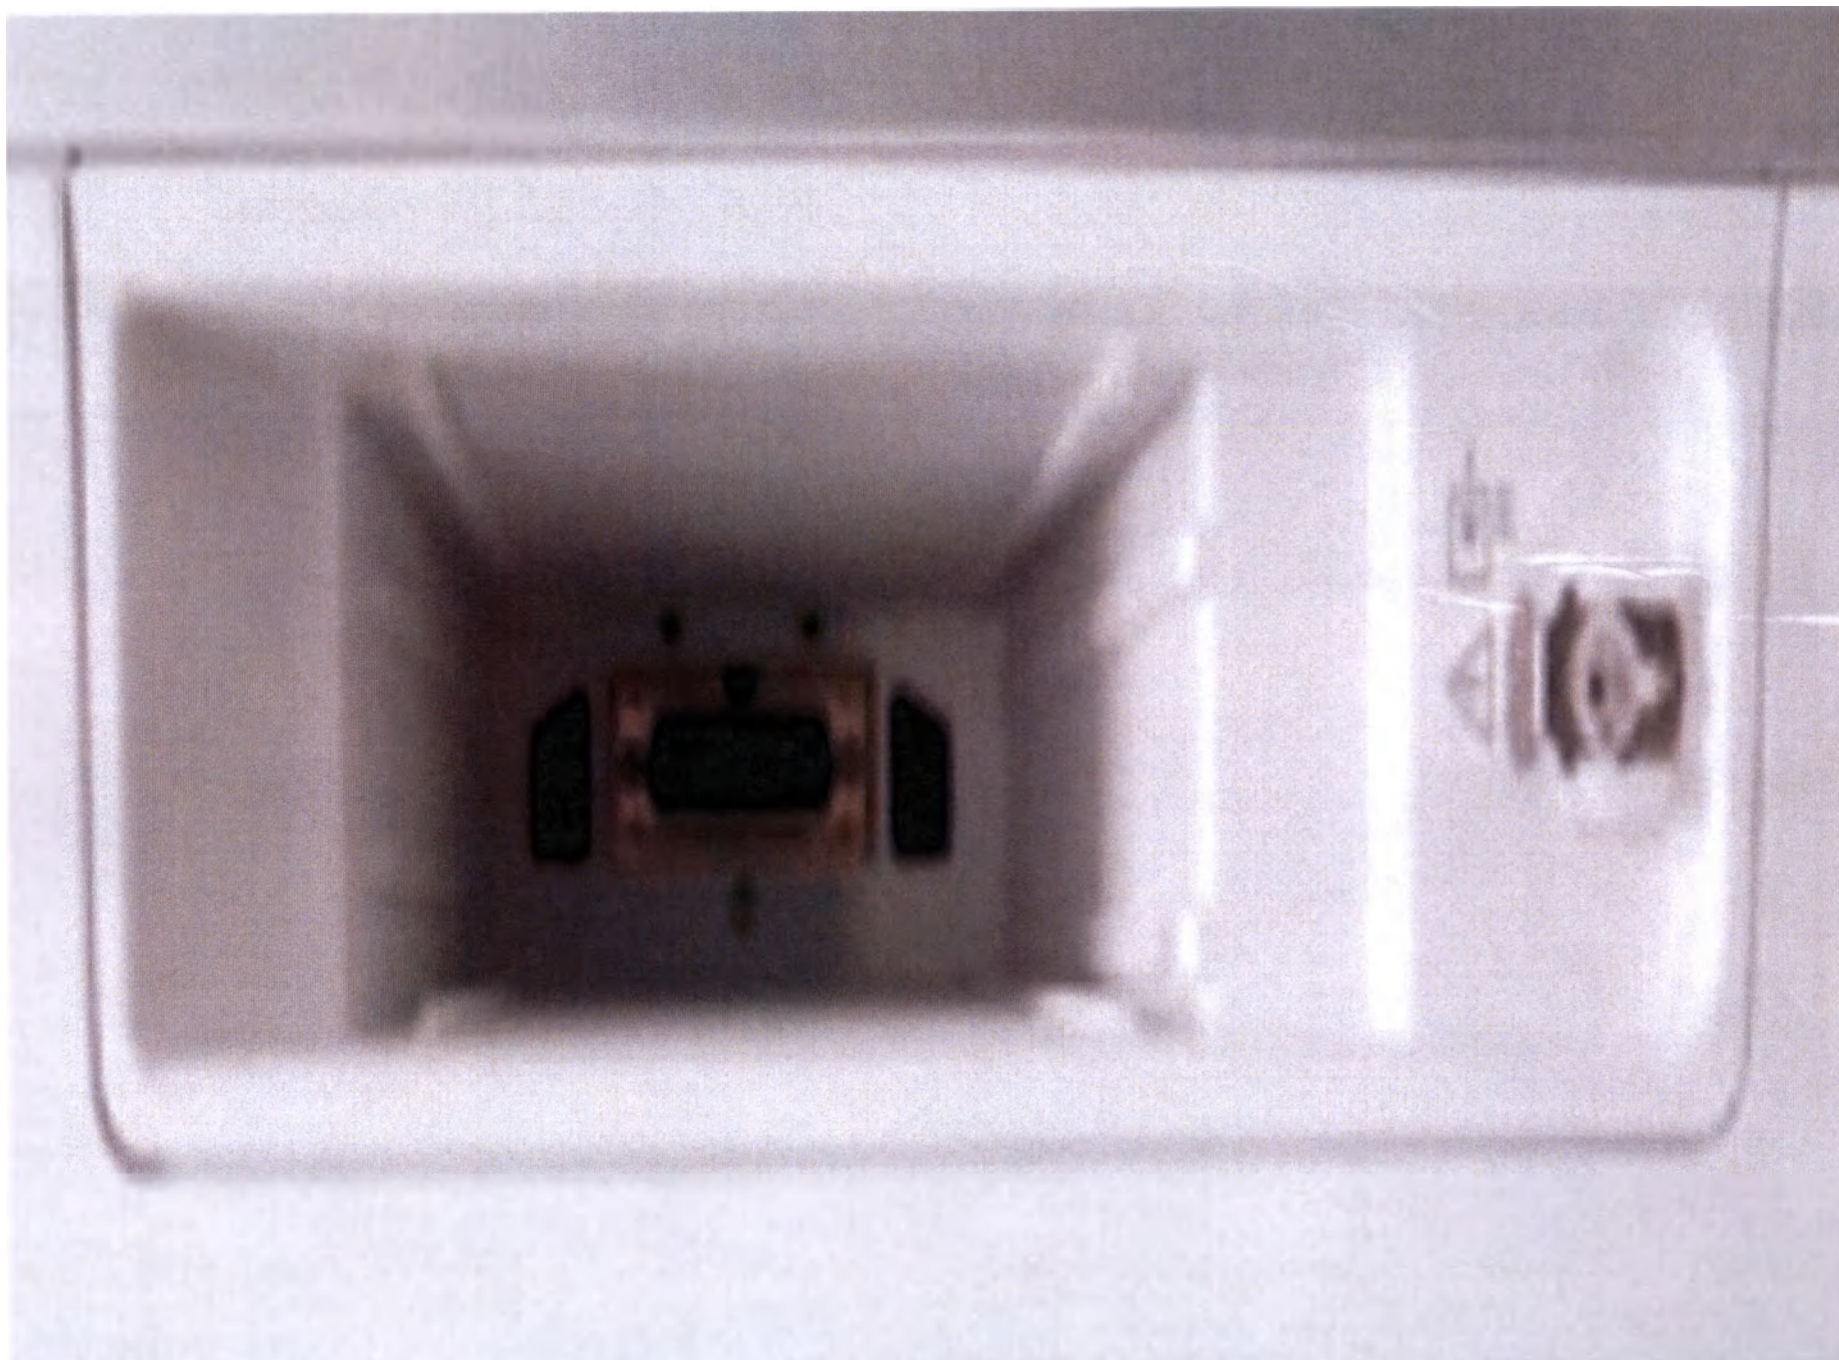




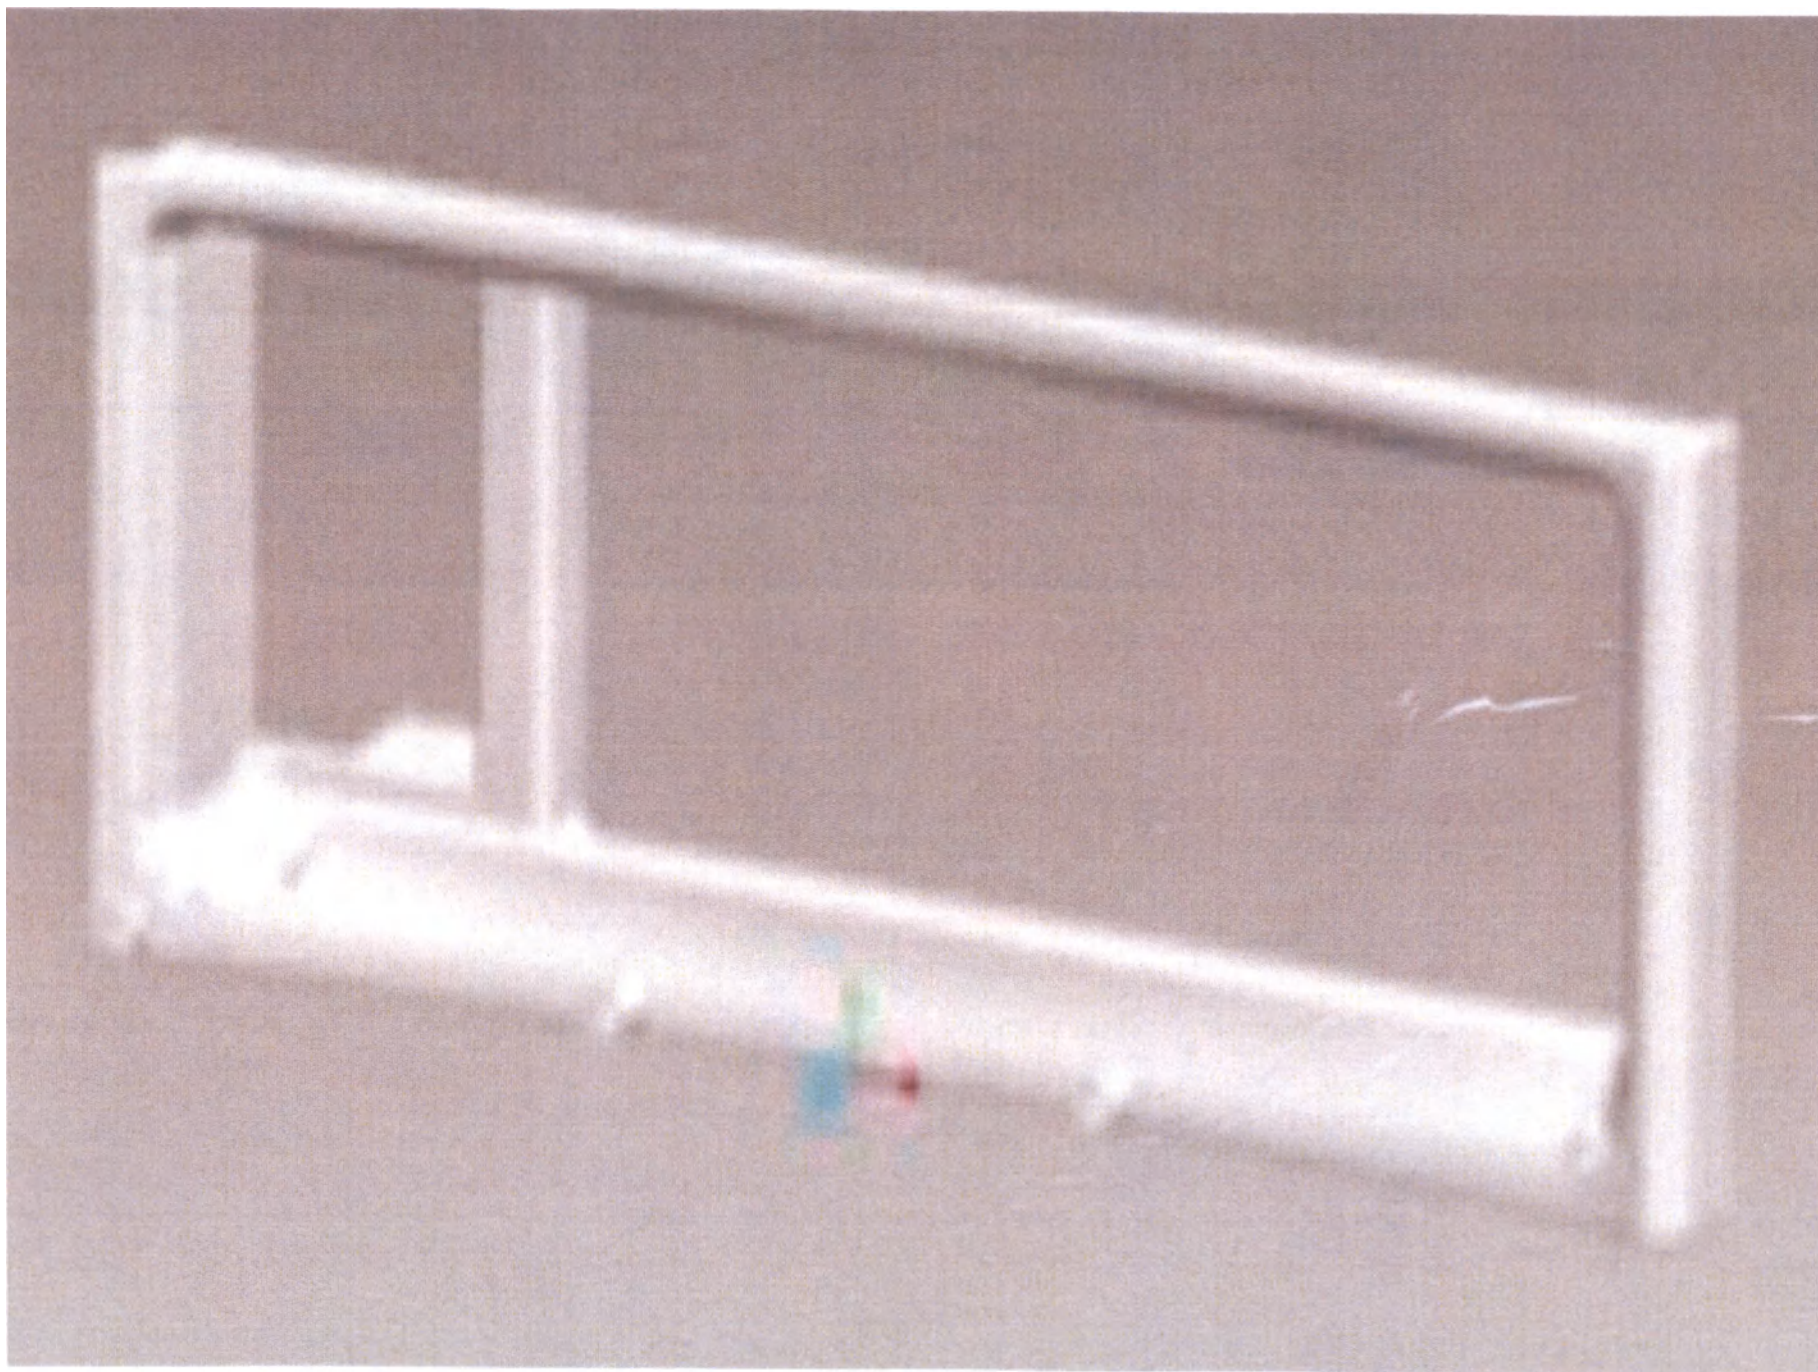




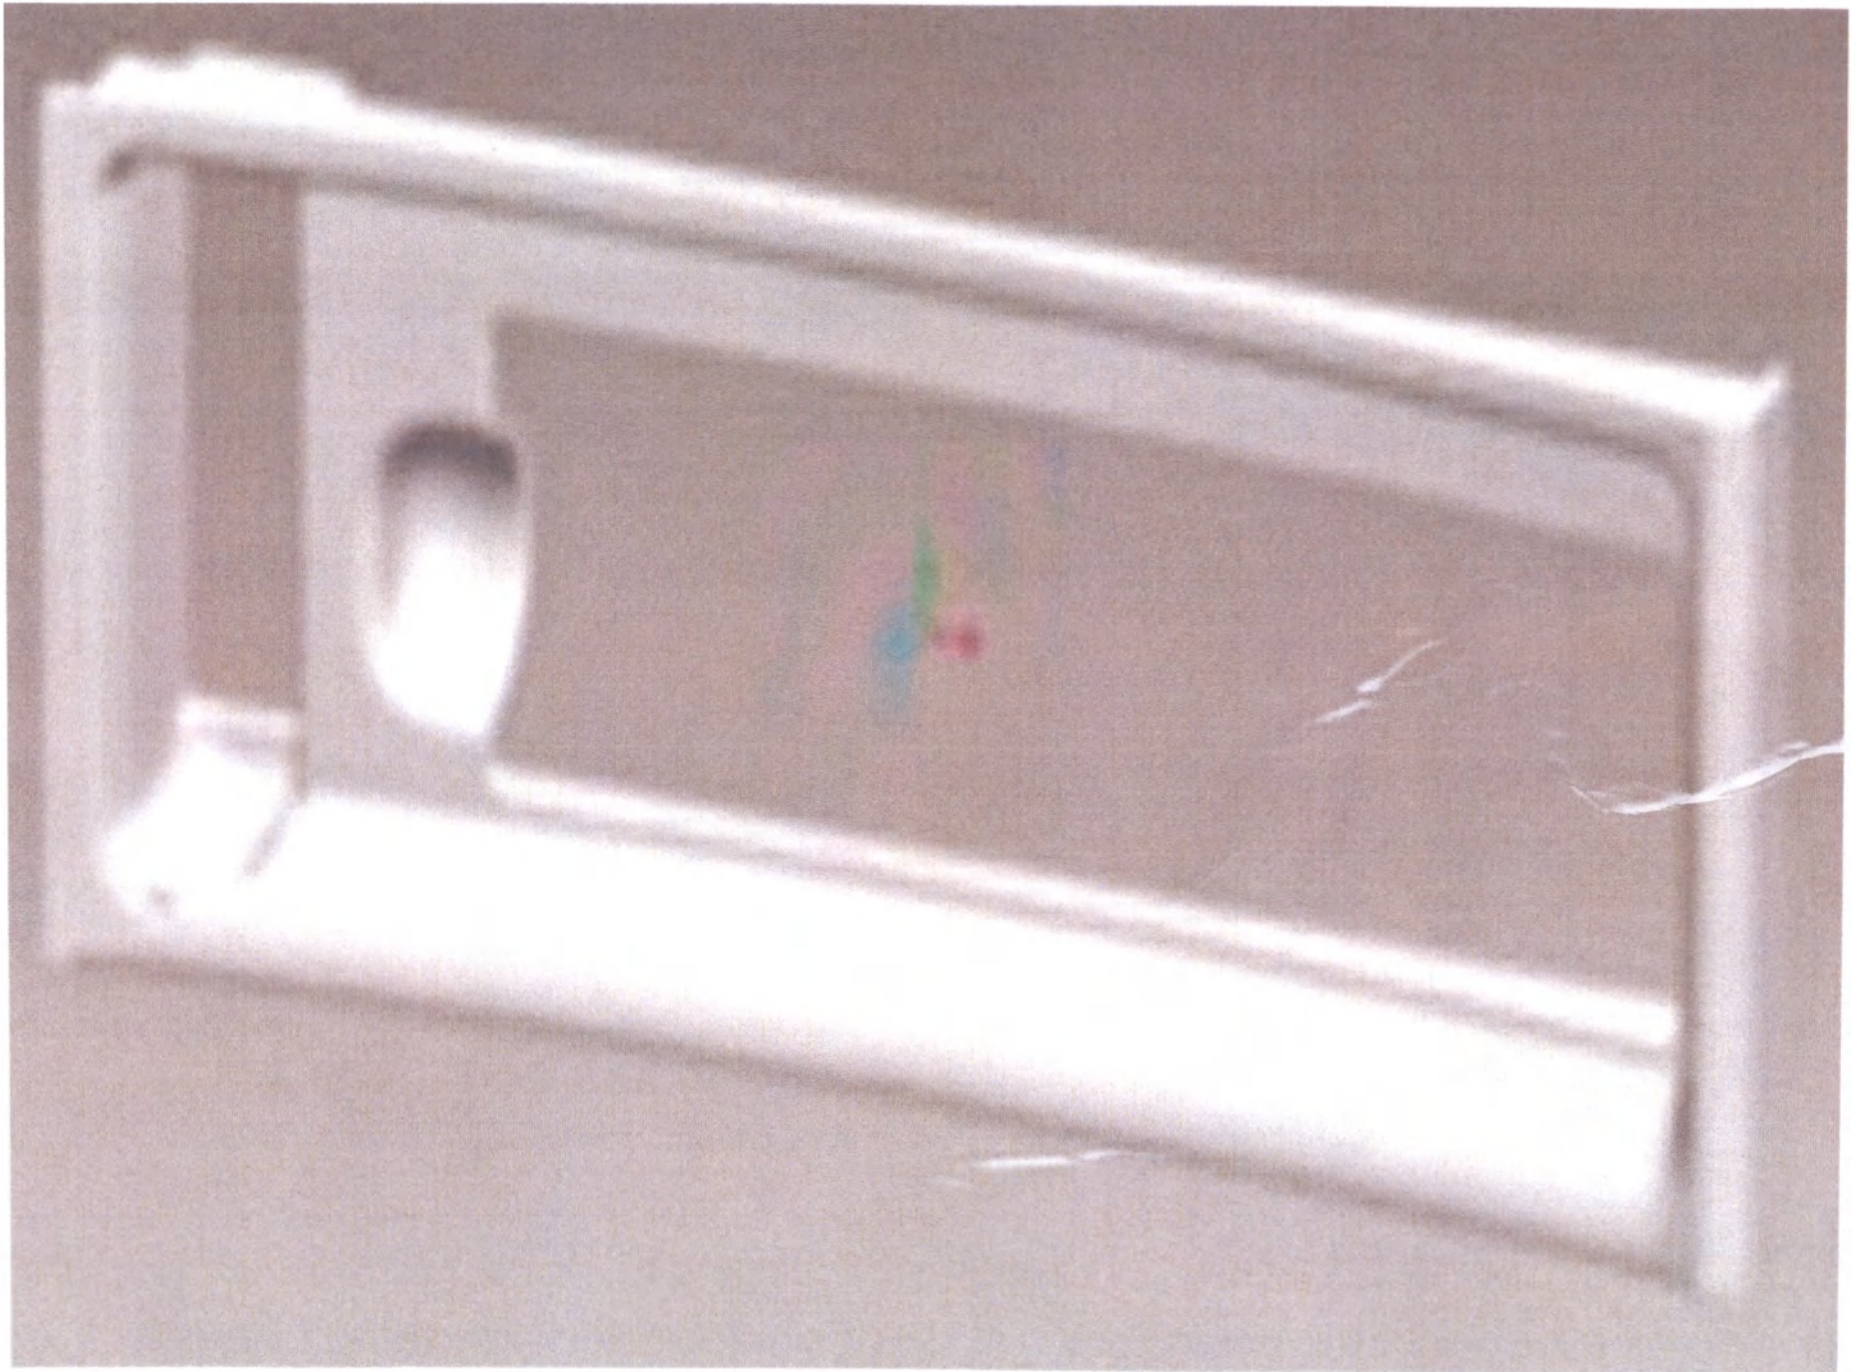



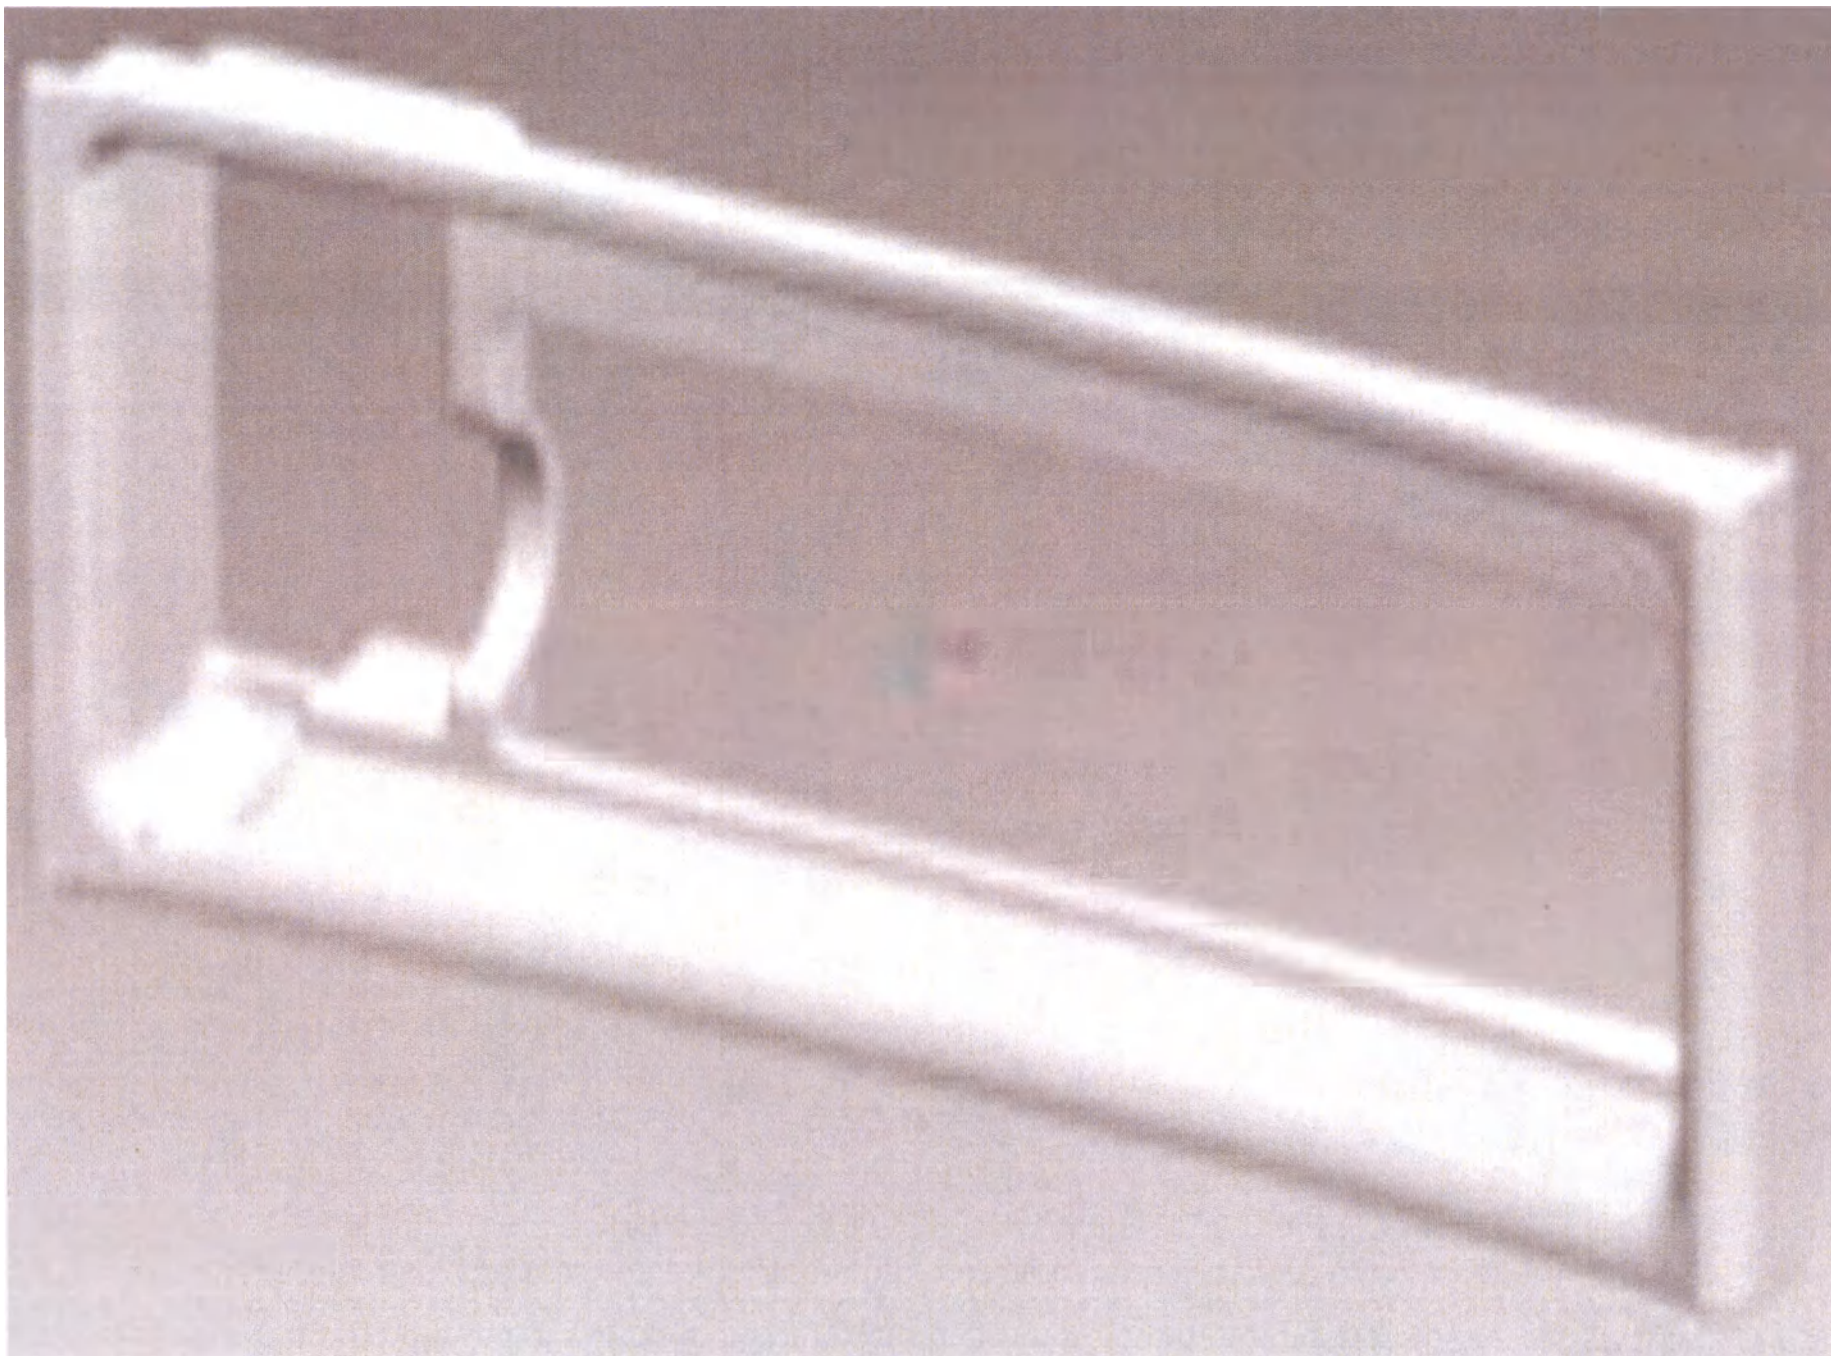




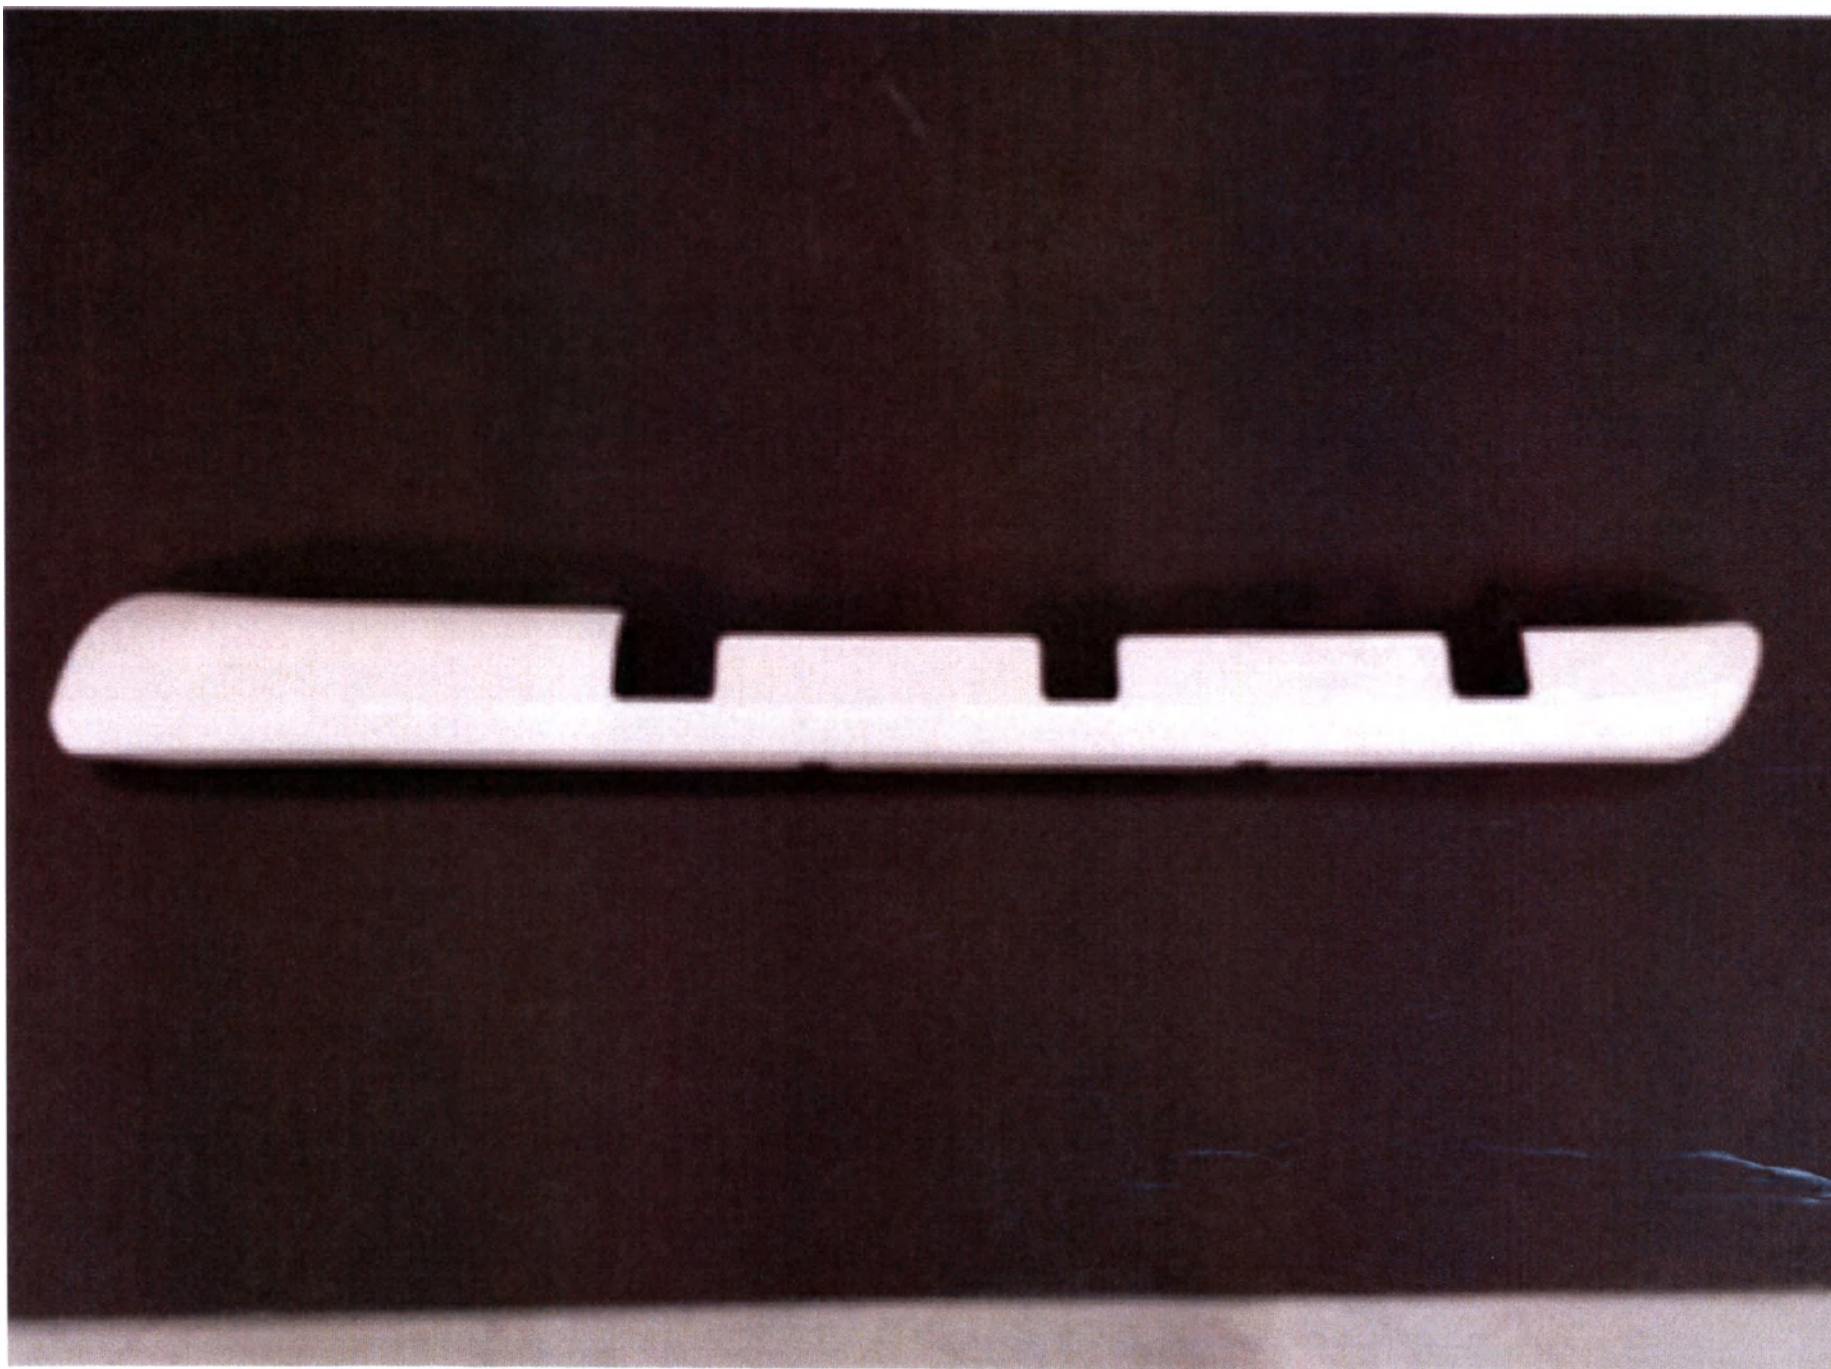



50. Держатель кабелей.

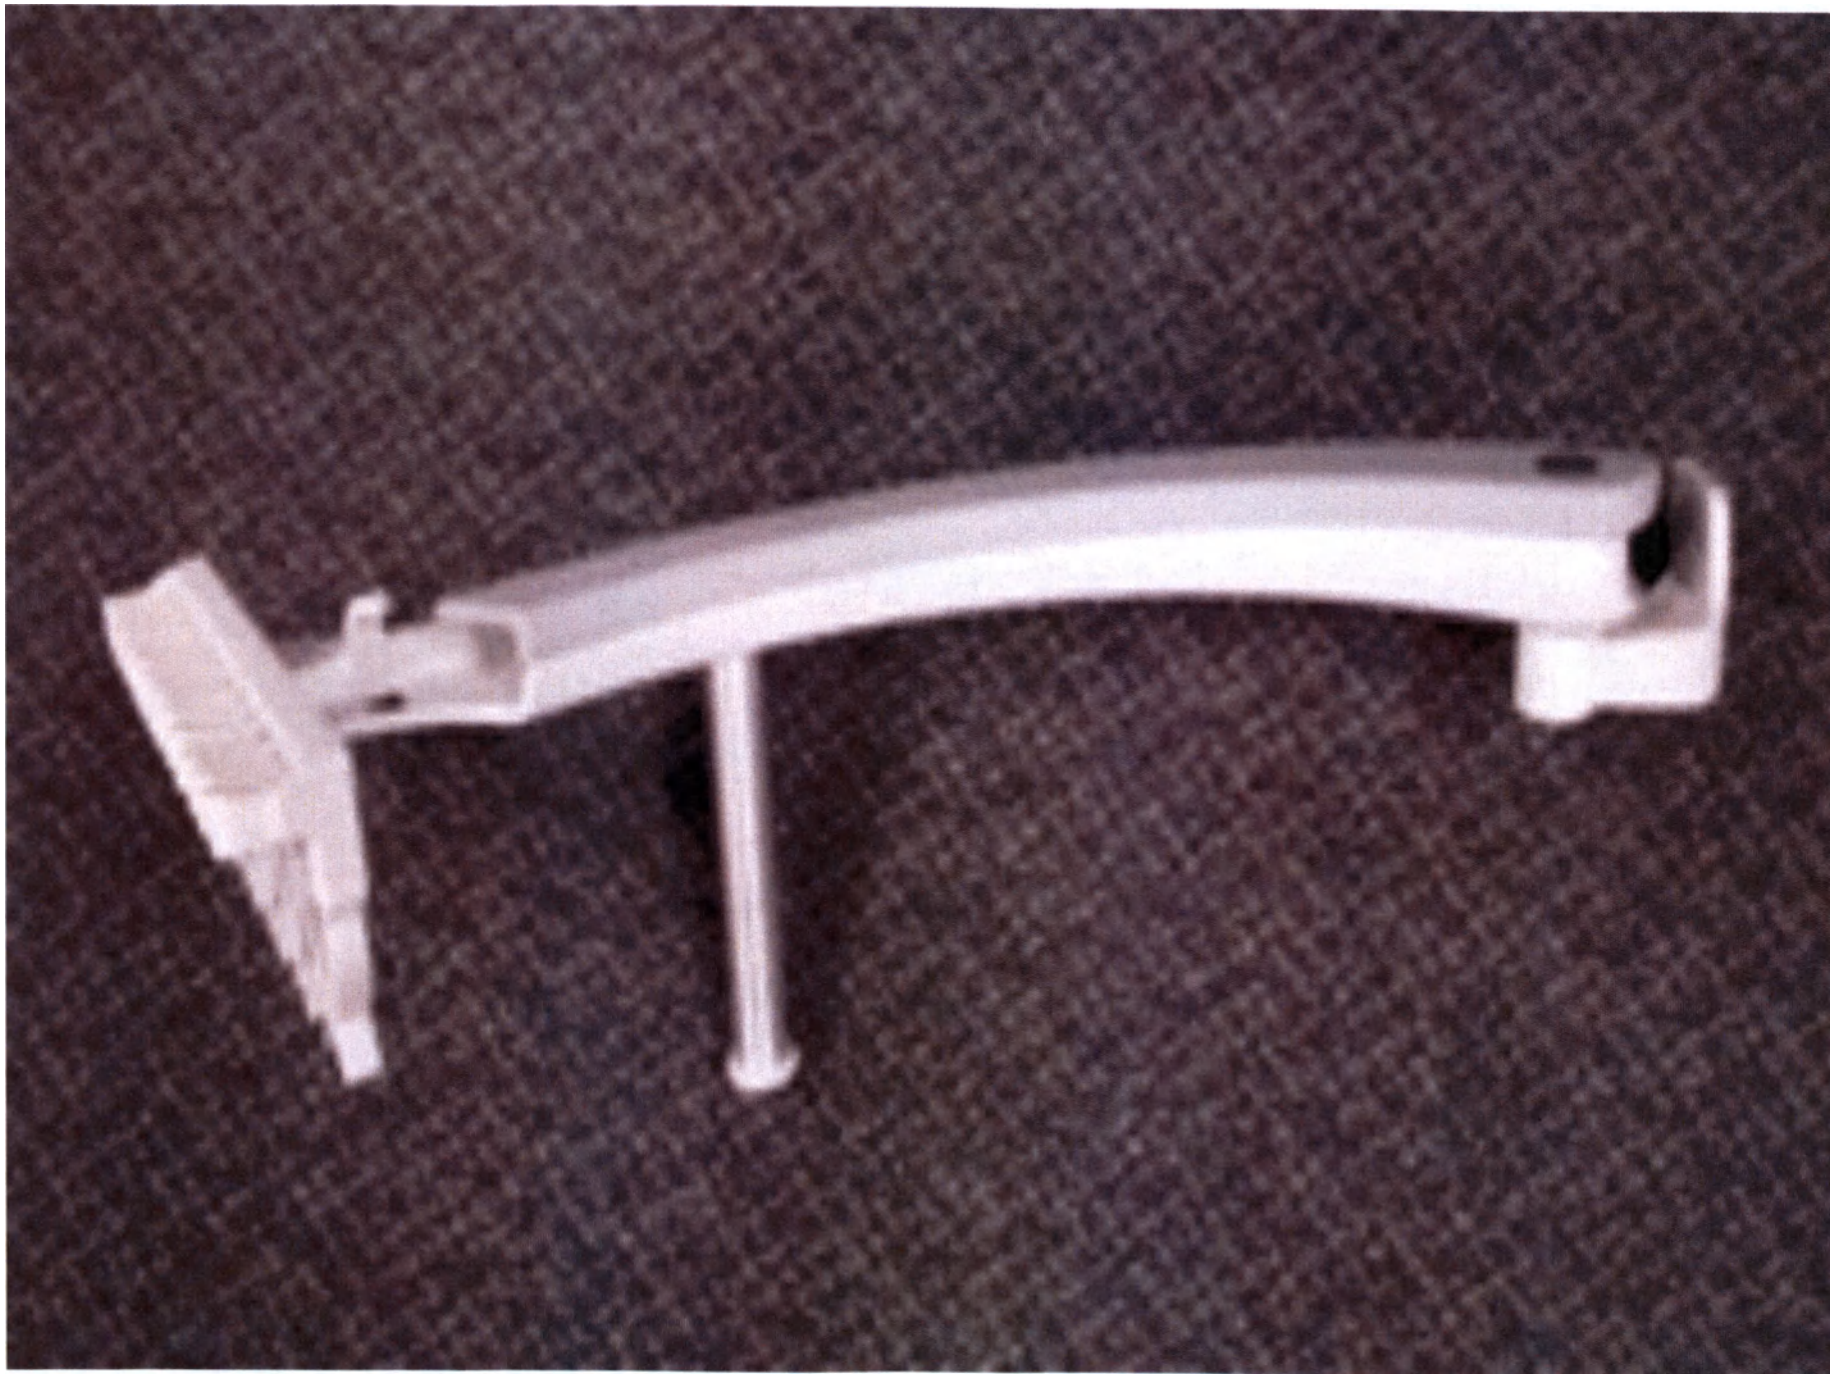









52. Держатель кабелей монитора пациента короткий.

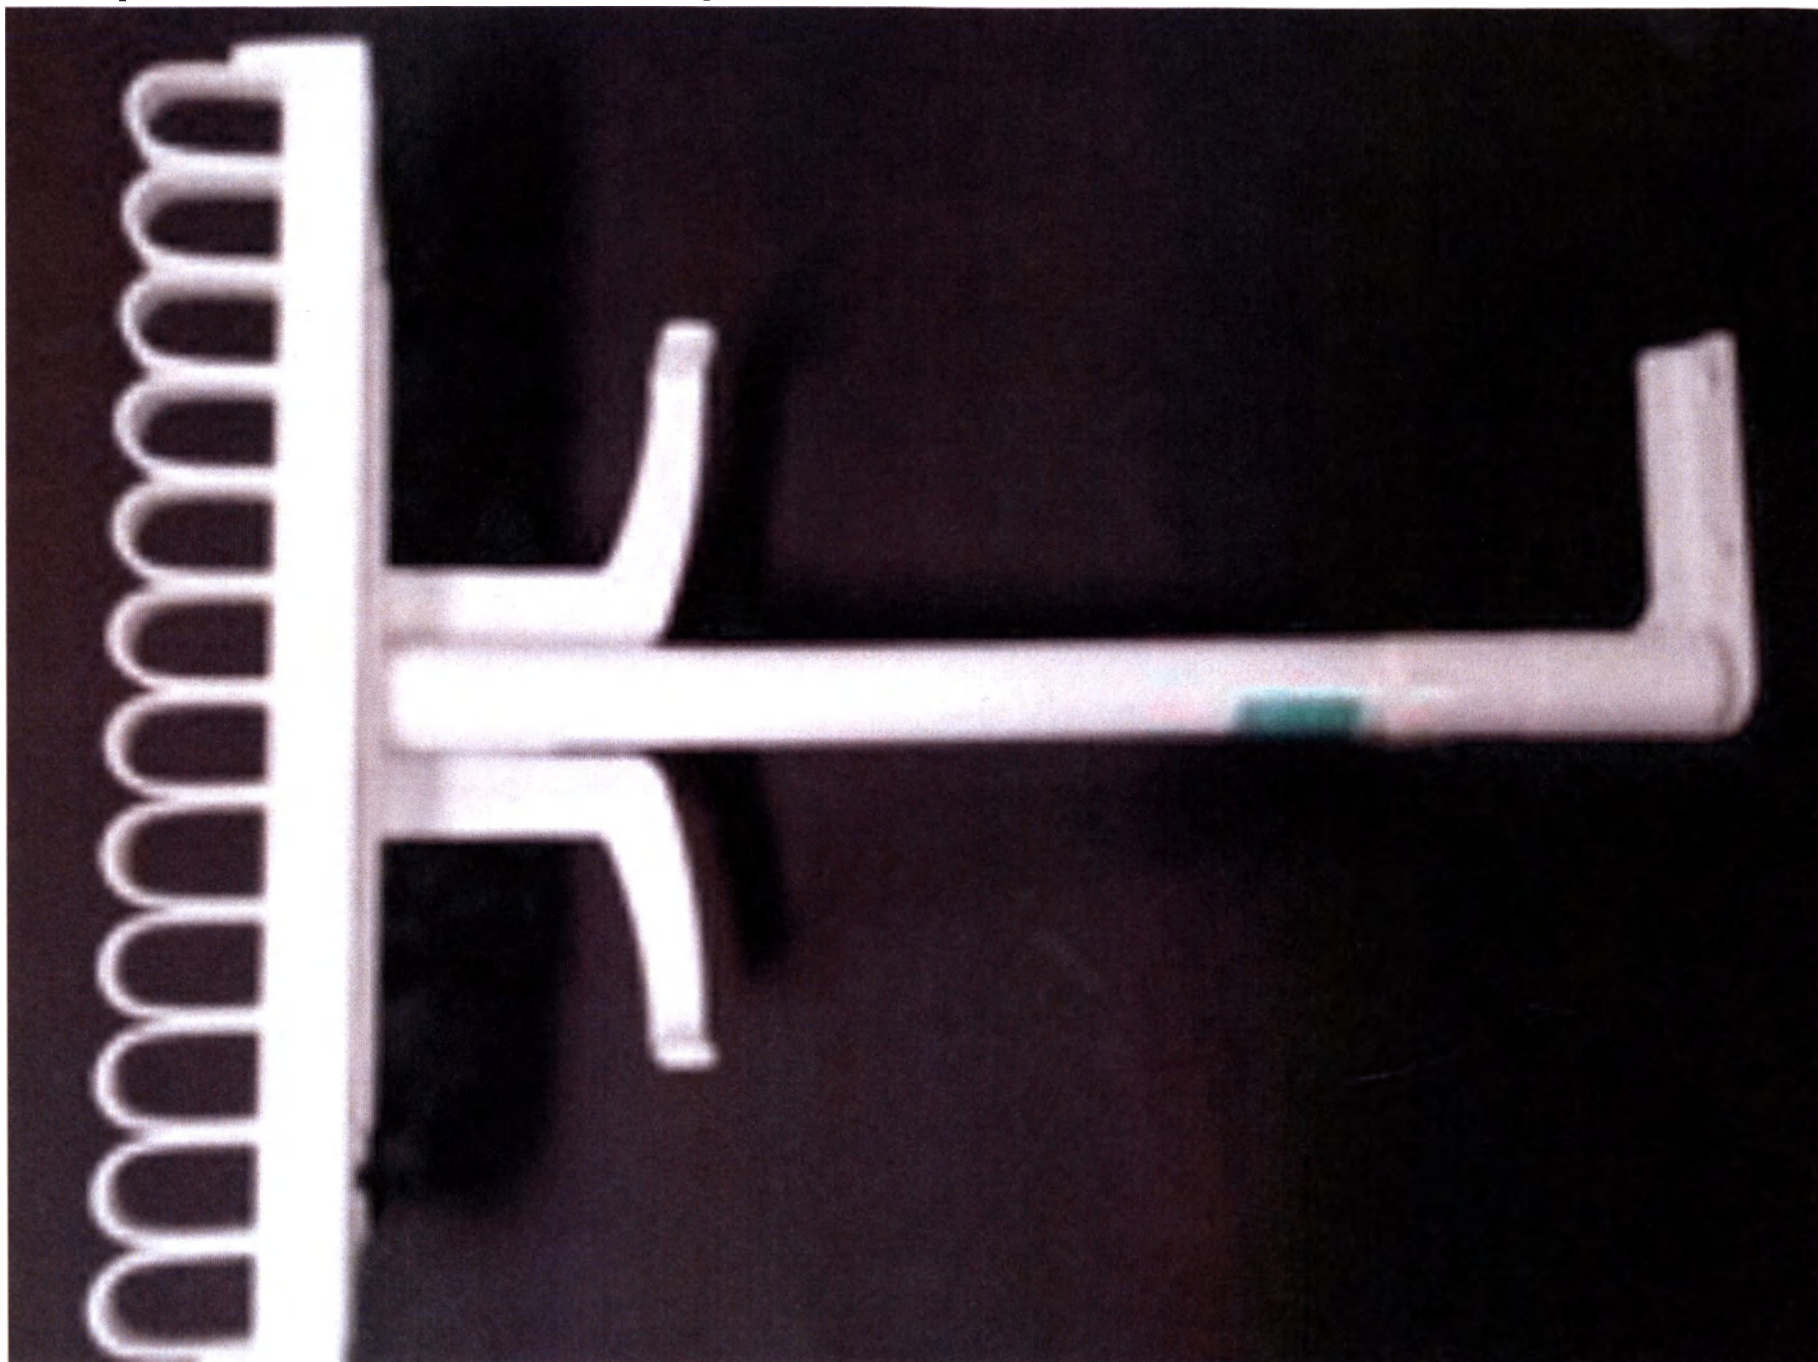




53. Крепление для рамы модулей на верхней полке аппарата.

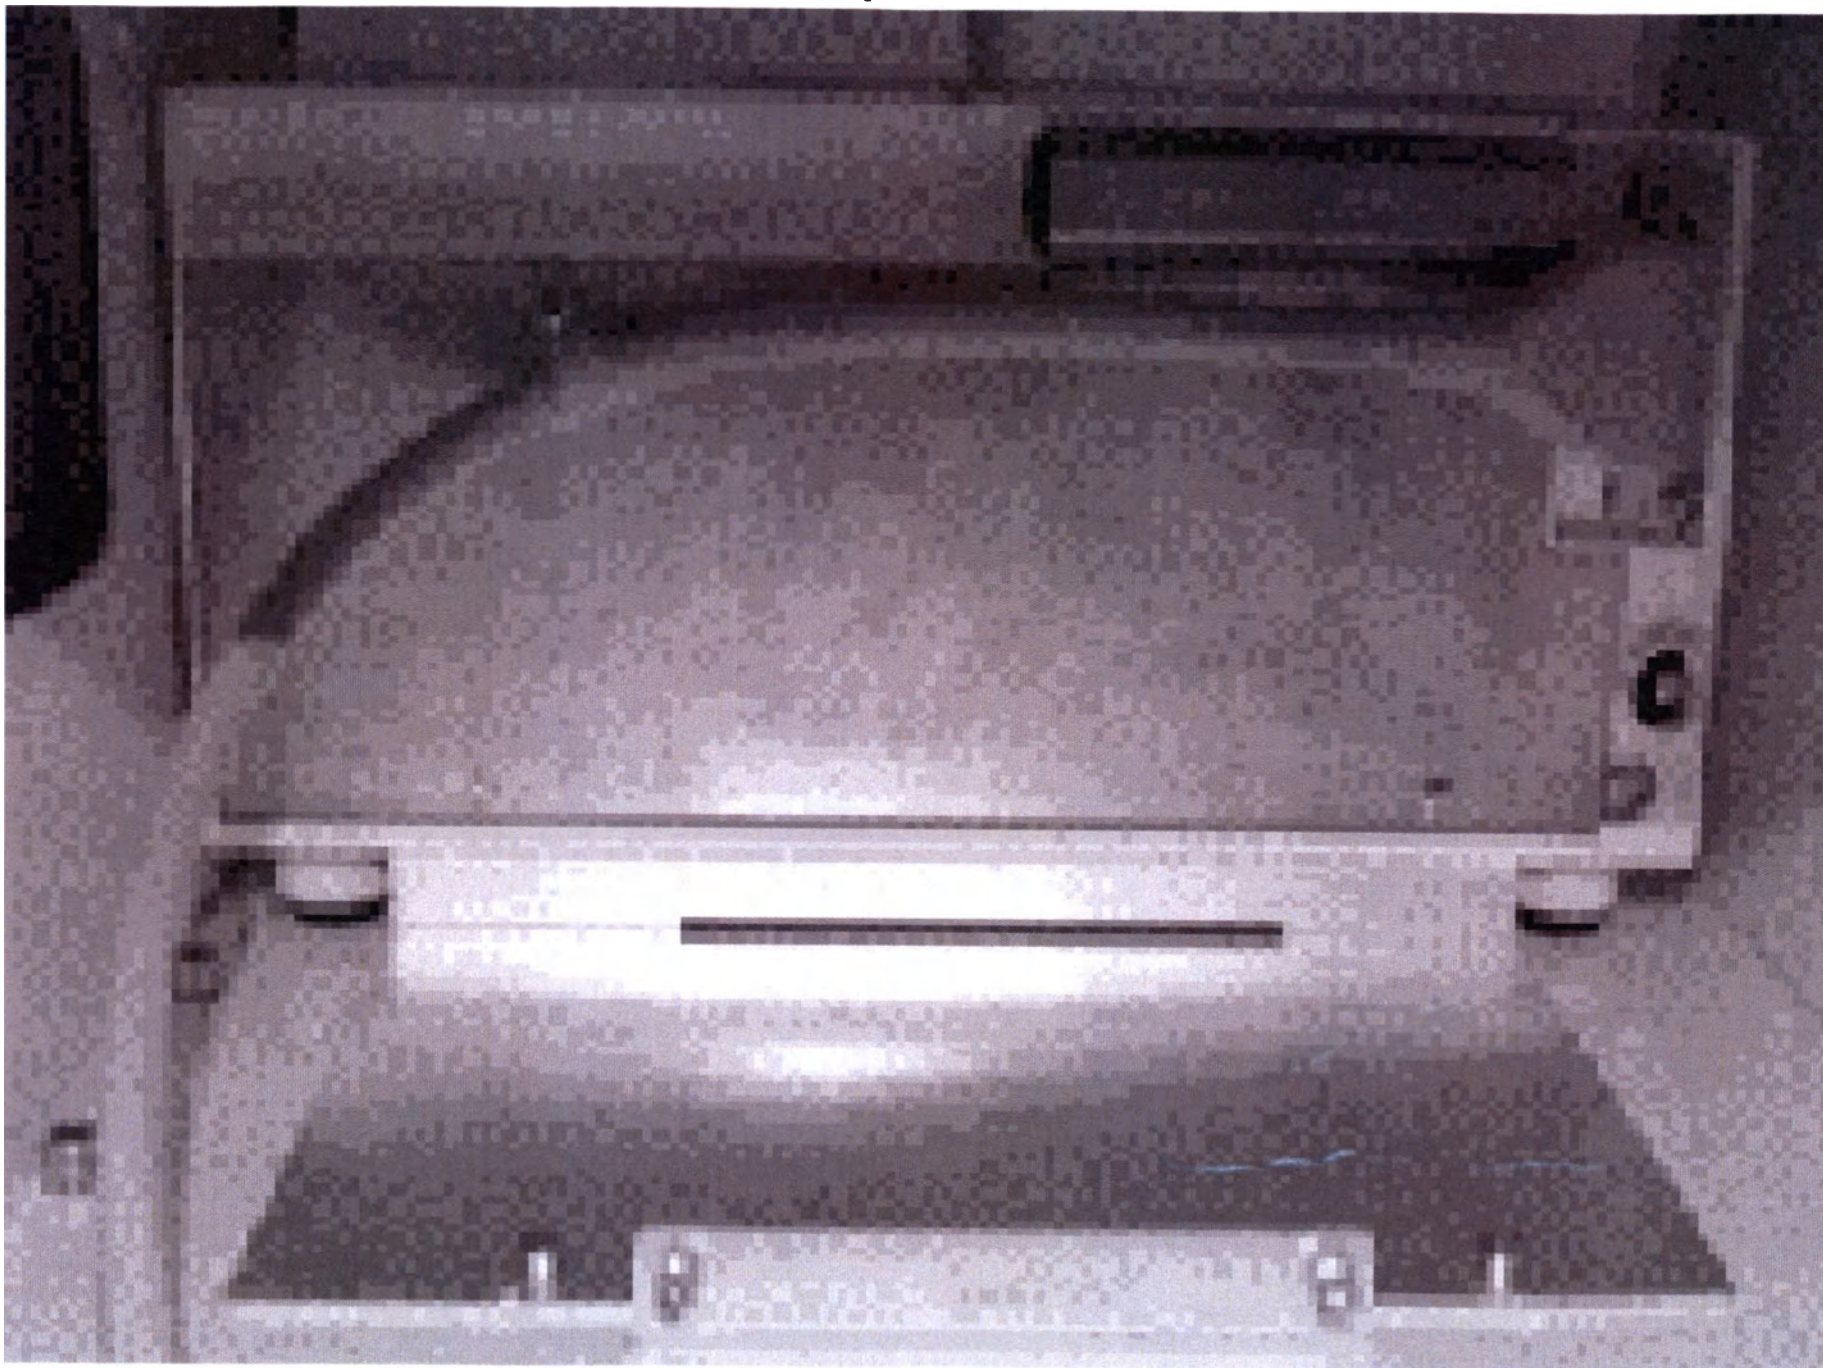




54. Крепление для дополнительных устройств четырехстороннее.

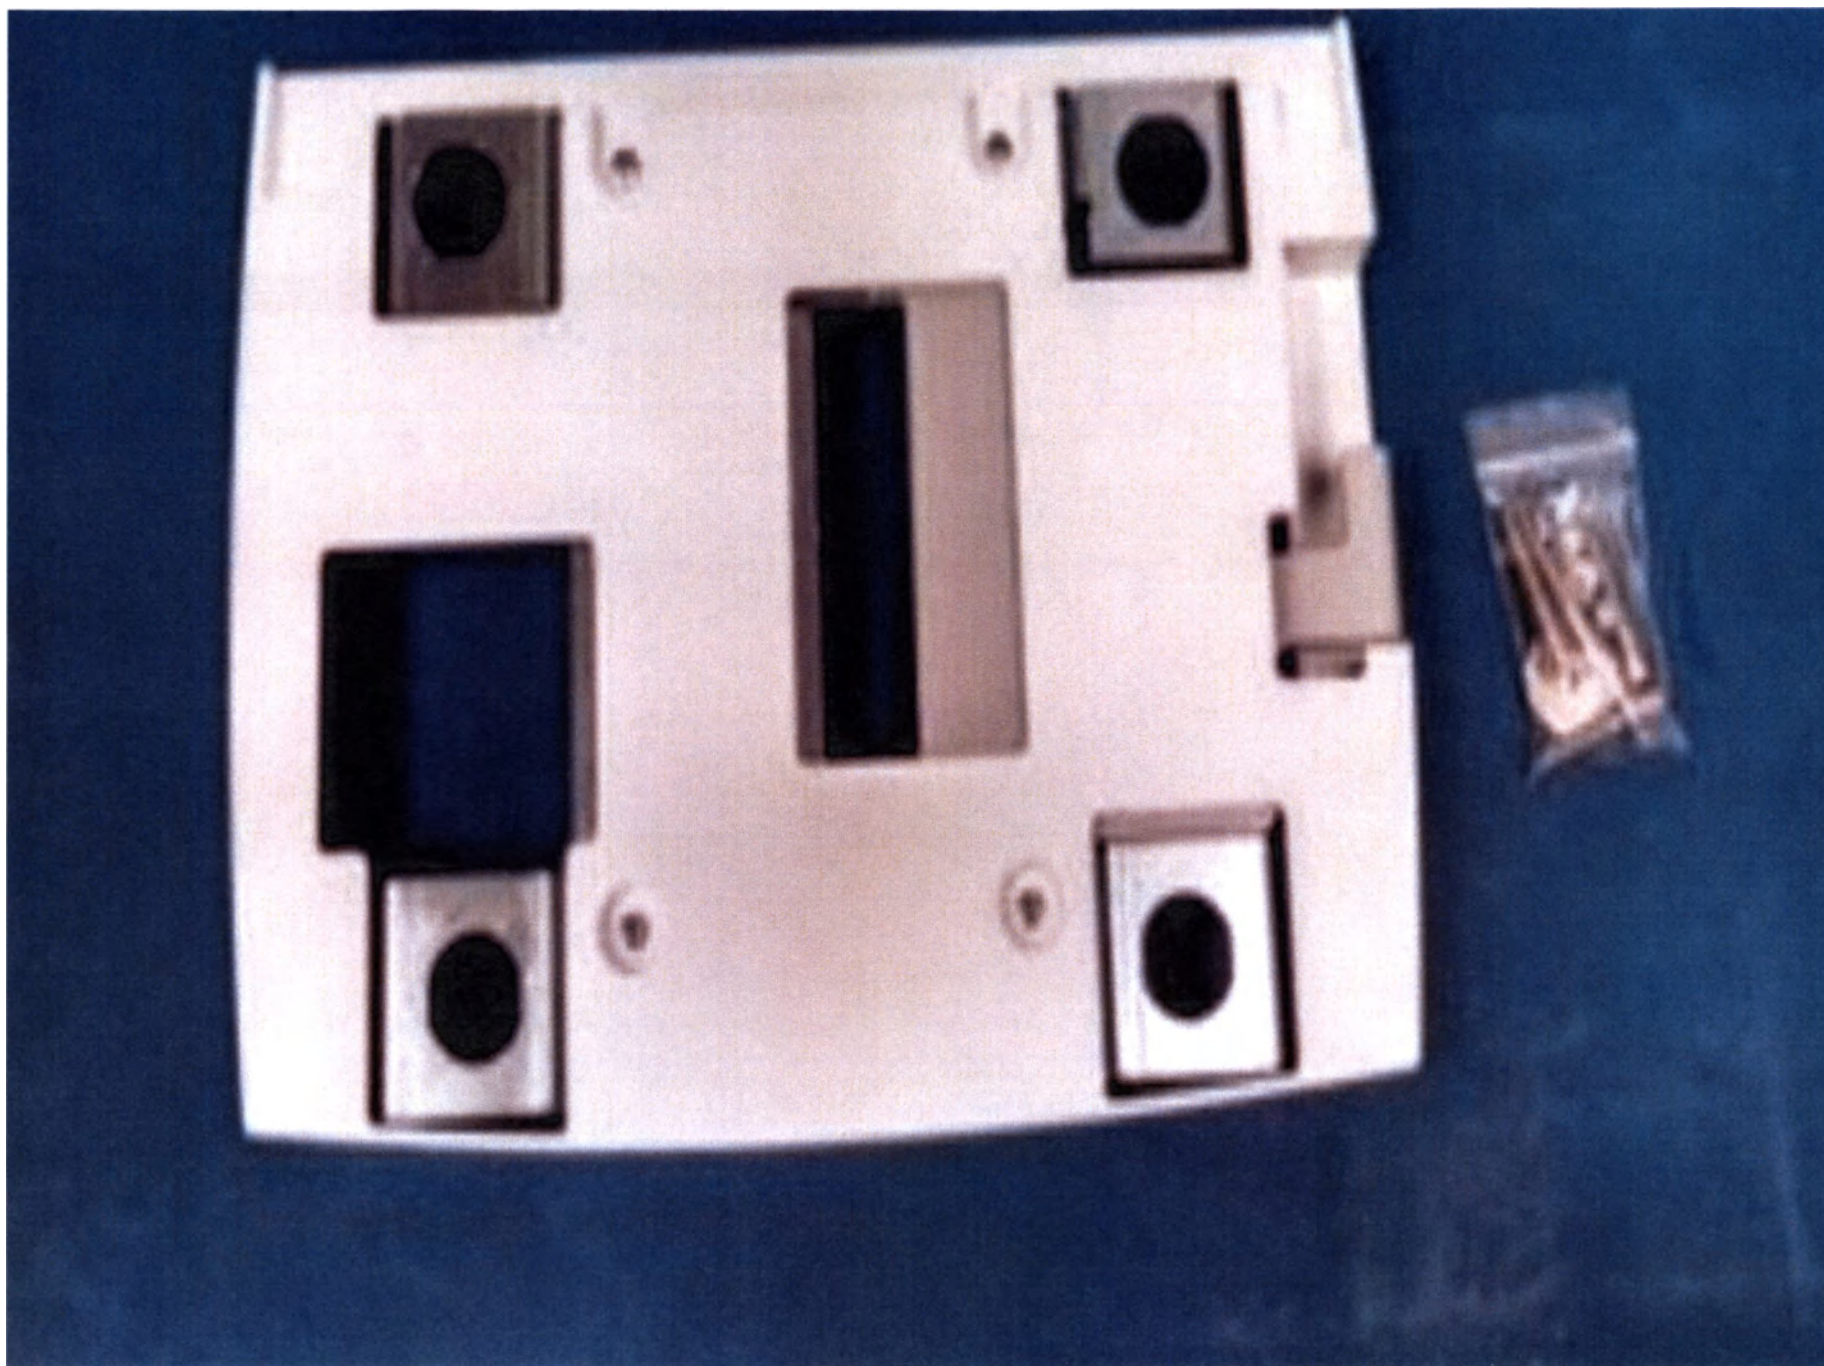



55. Крепление для монитора четырехстороннее.

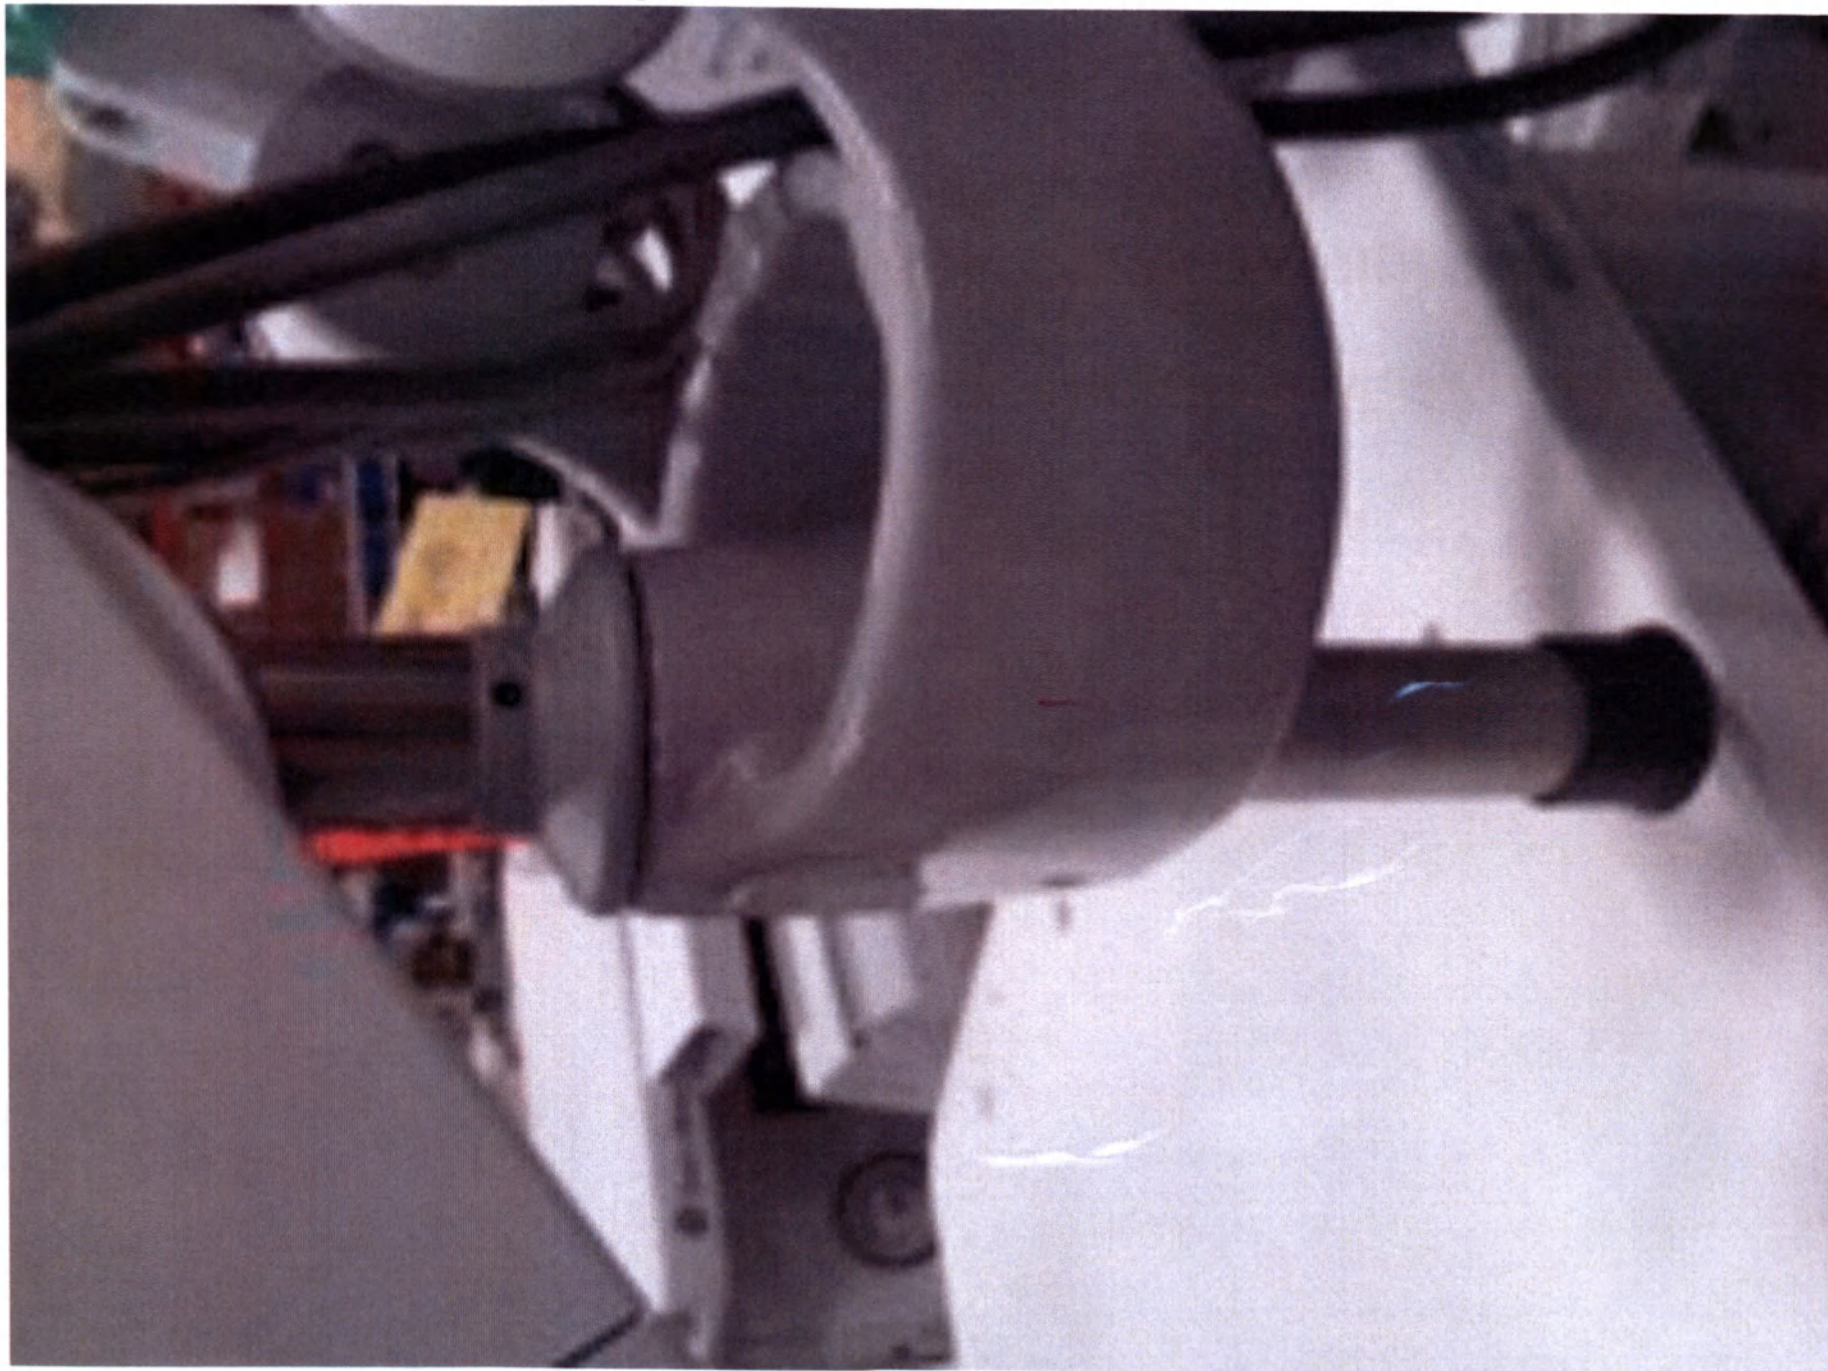



56. Вход для установки дыхательного мешка.





57. Кронштейн для дыхательного мешка.





58. Модуль для подключения к пассивной системе сброса газов.





59. Модуль для подключения к активной системе сброса газов.






60. Адаптеры одноразовые для системы сброса газов (не более 50 шт.).






61. Шланги для сброса газов (не более 50 шт.).

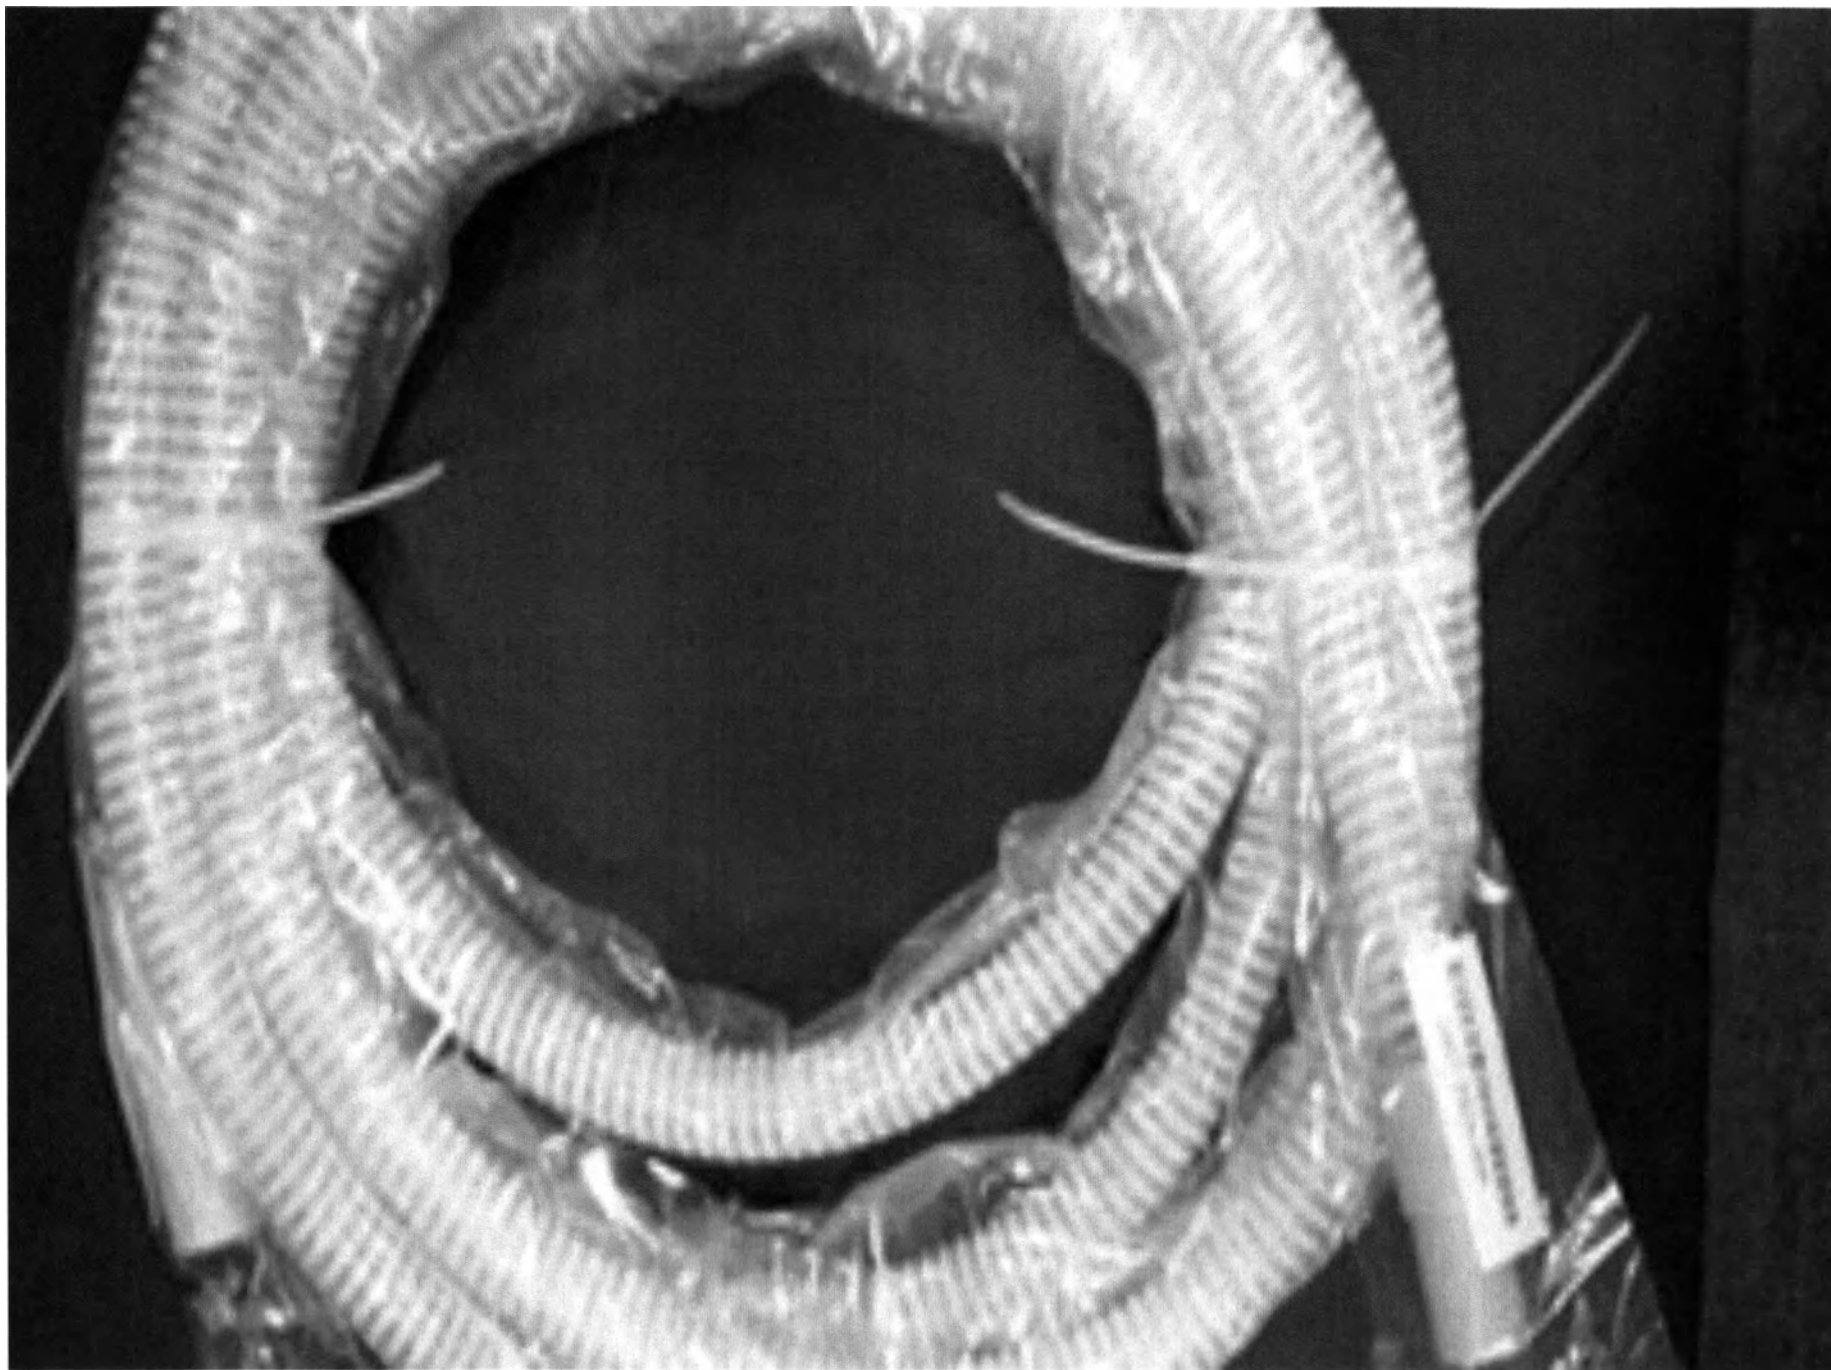



62. Коннекторы многоцветные (не более 5 шт.).

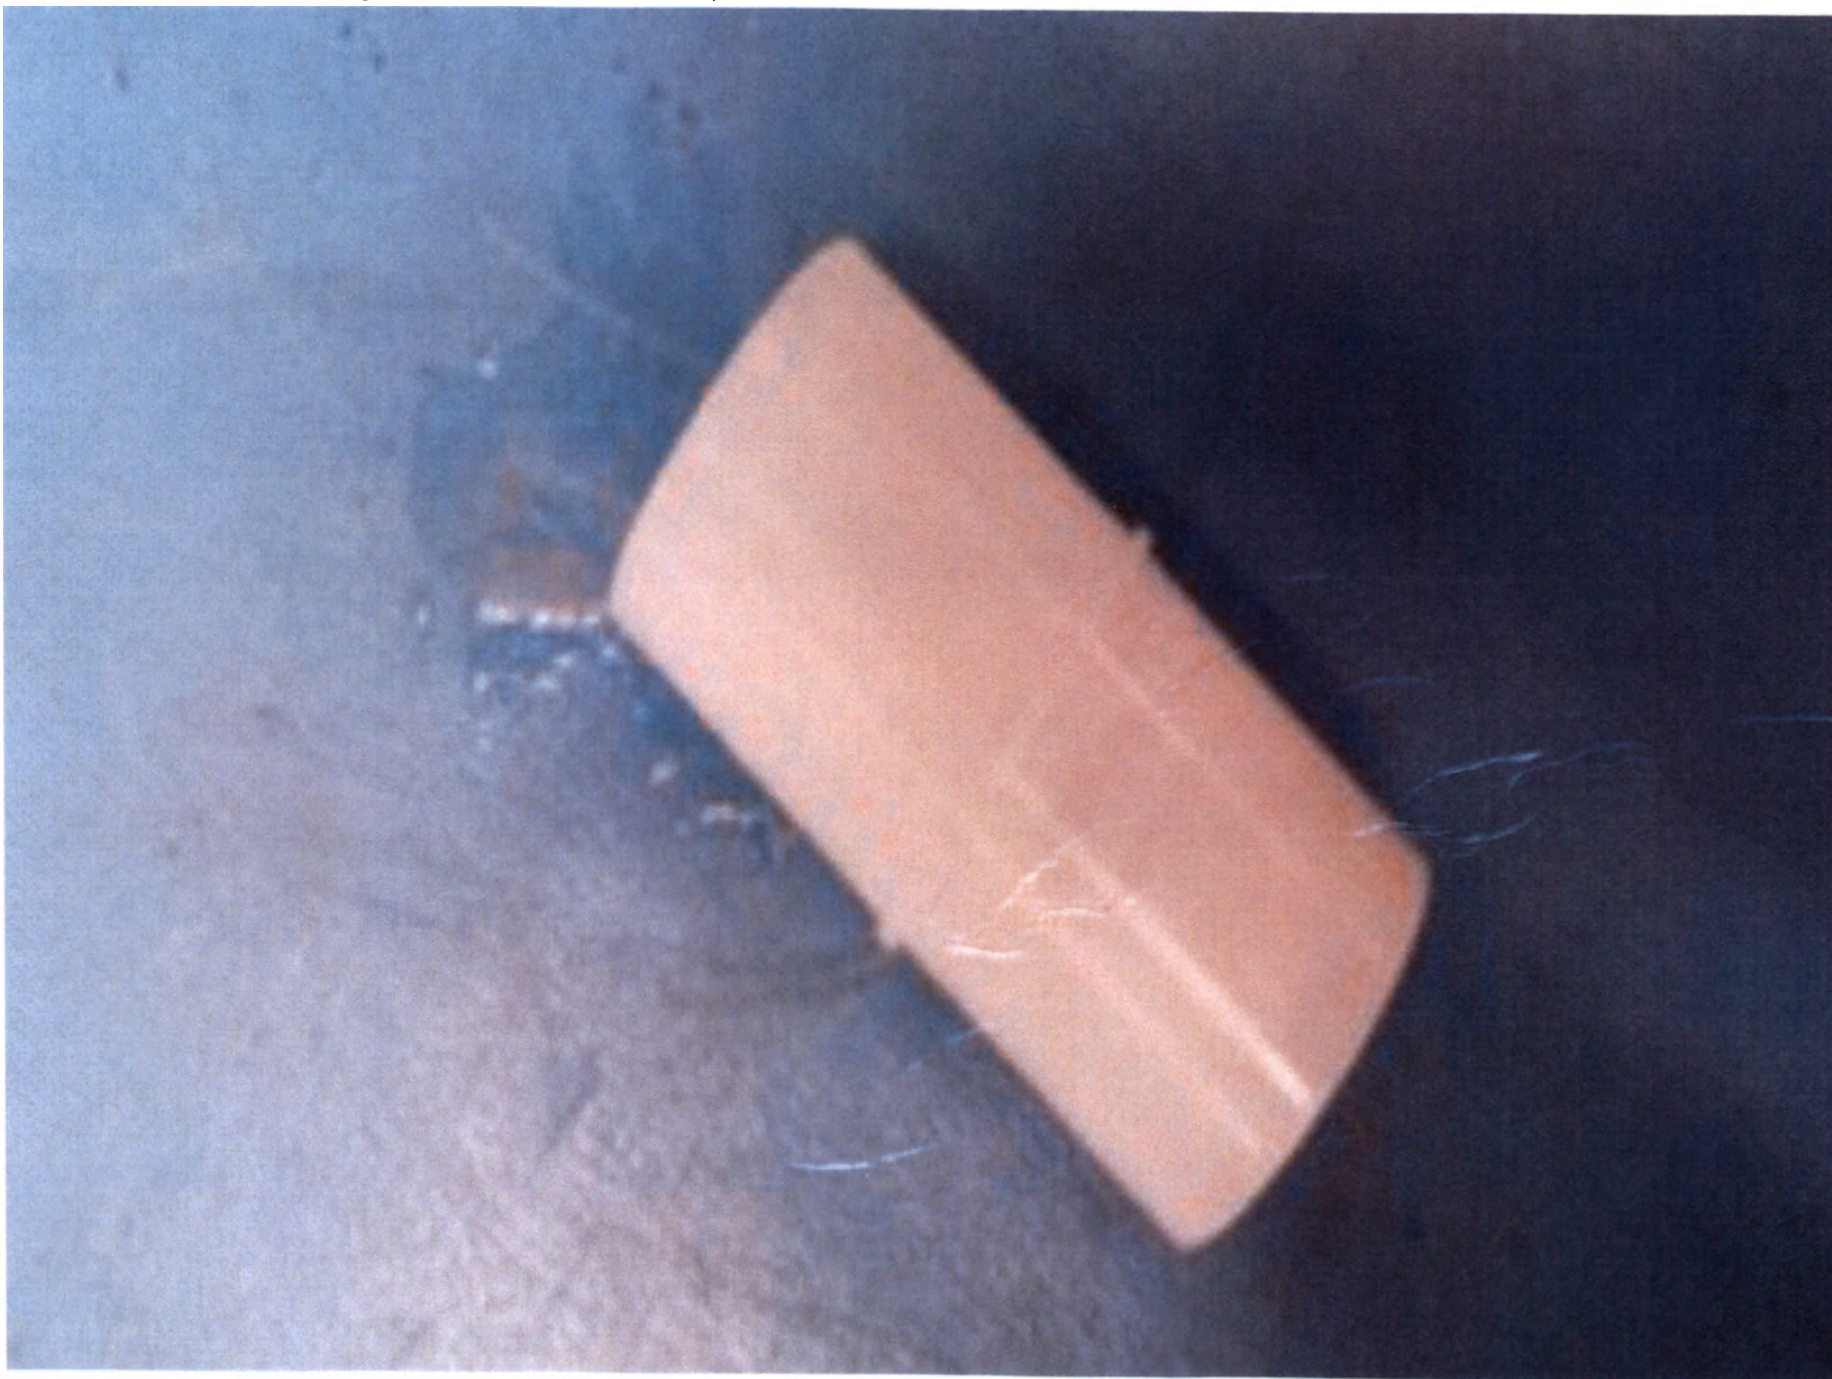




63. Трубка сброса отработанных газов (не более 50 шт.).





64. Мешок для сброса отработанных газов (не более 50 шт.).

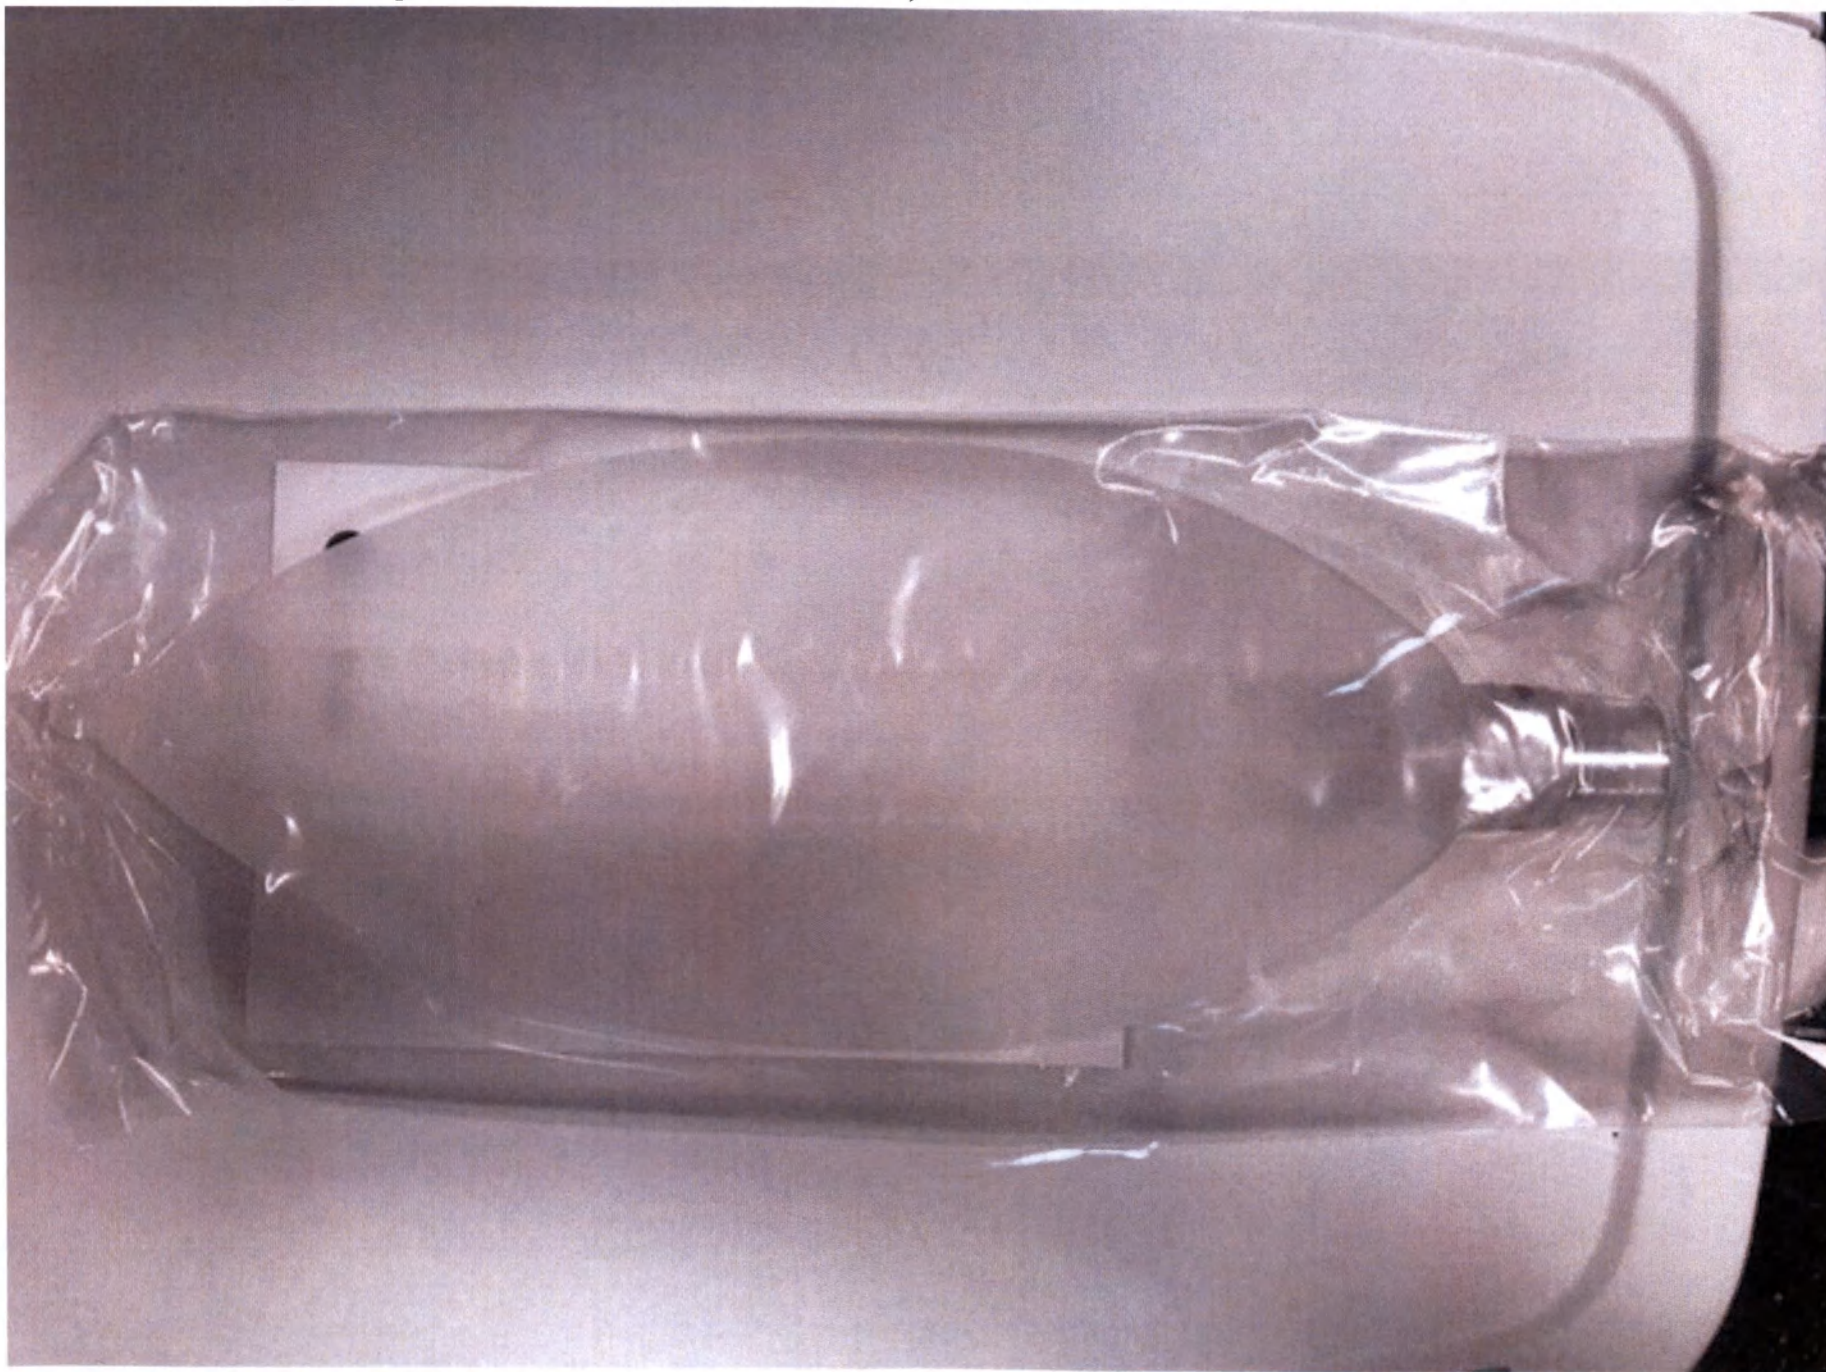




65. Переходники для подсоединения дыхательного мешка (не более 50 шт.).






66. Линии возврата газа (не более 100 шт.).

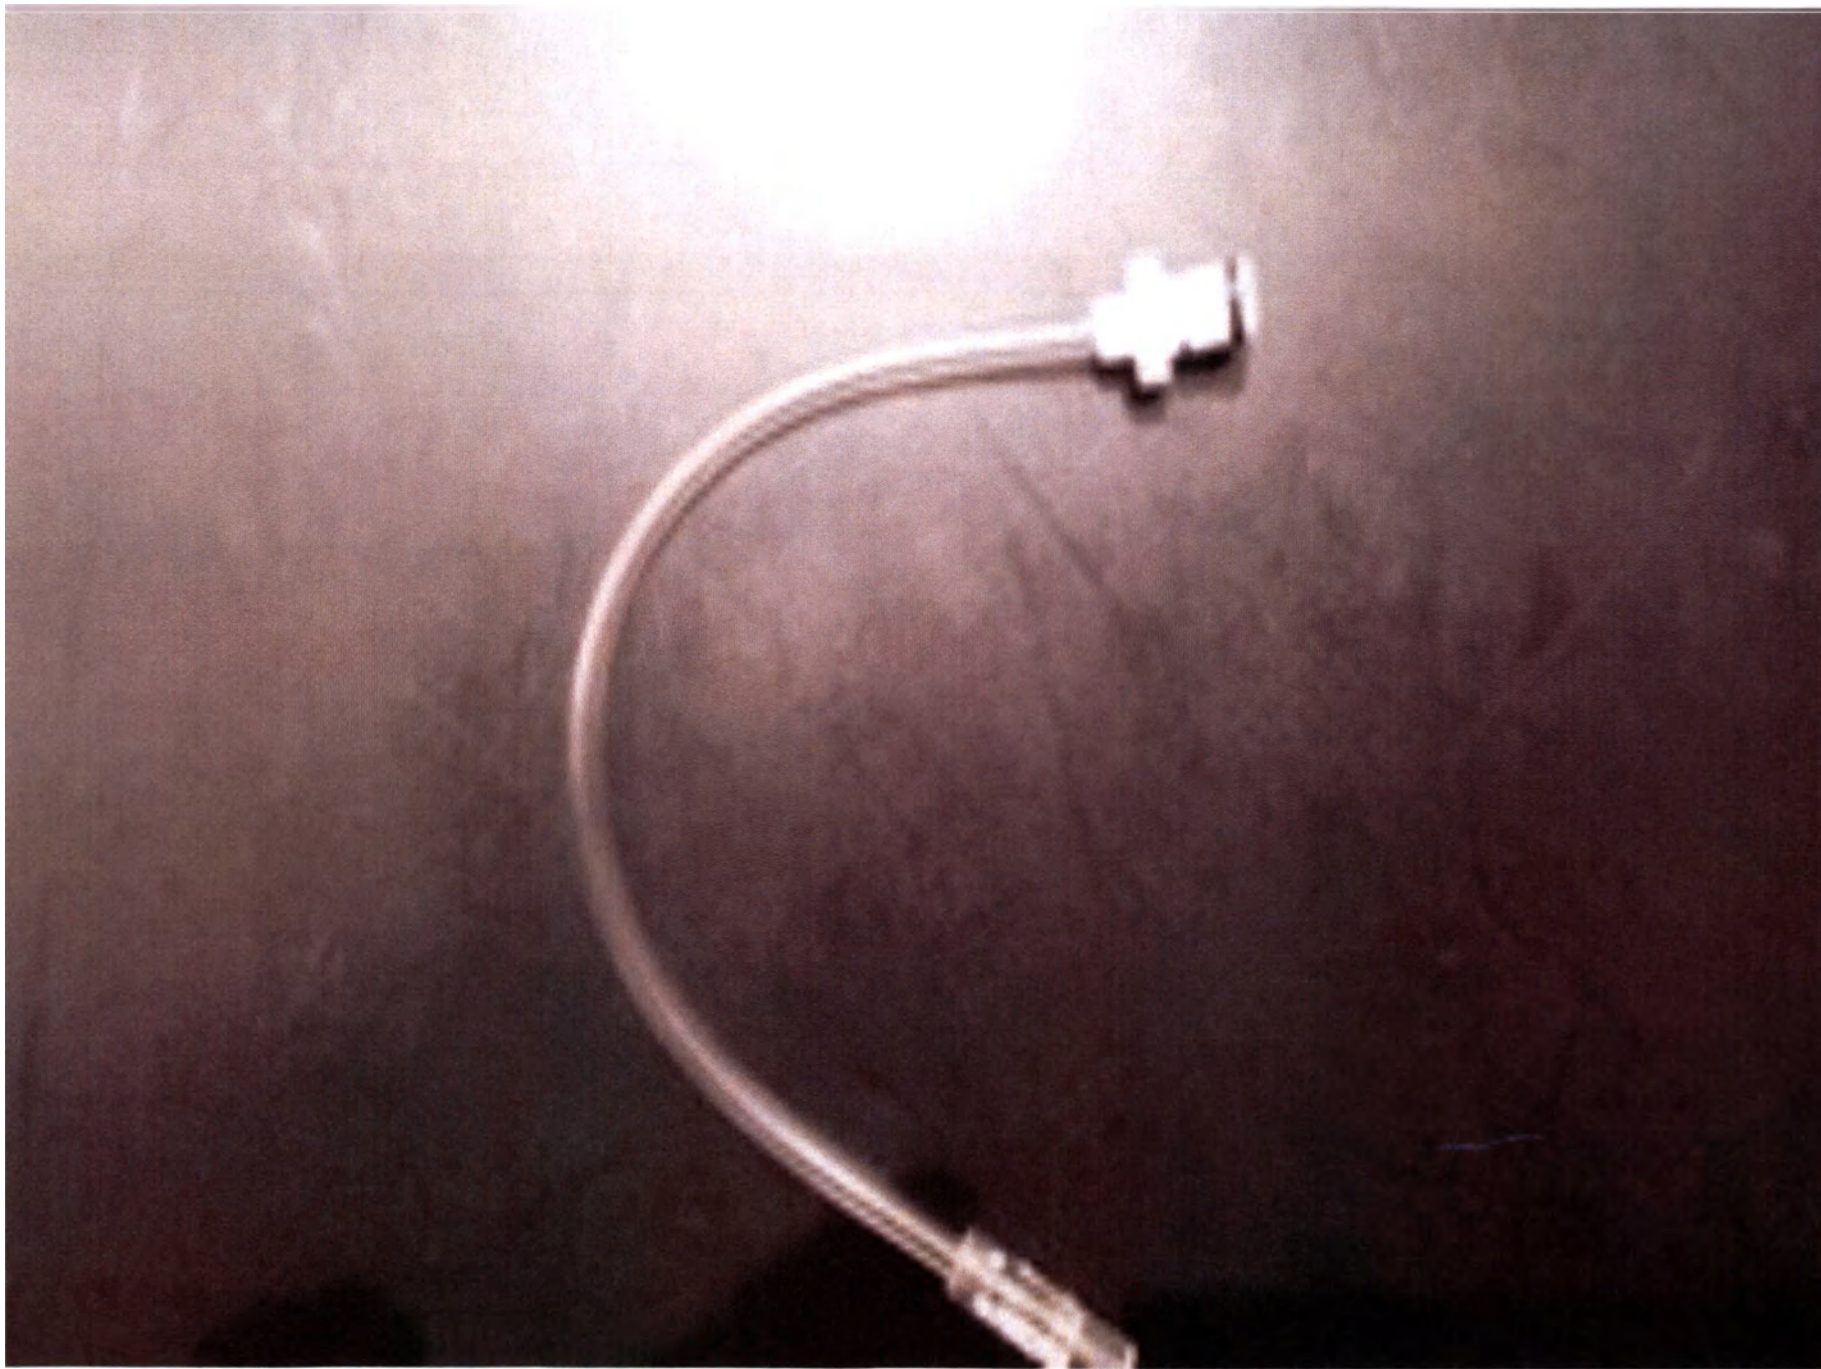




67. Линии отбора проб газа (не более 300 шт.).

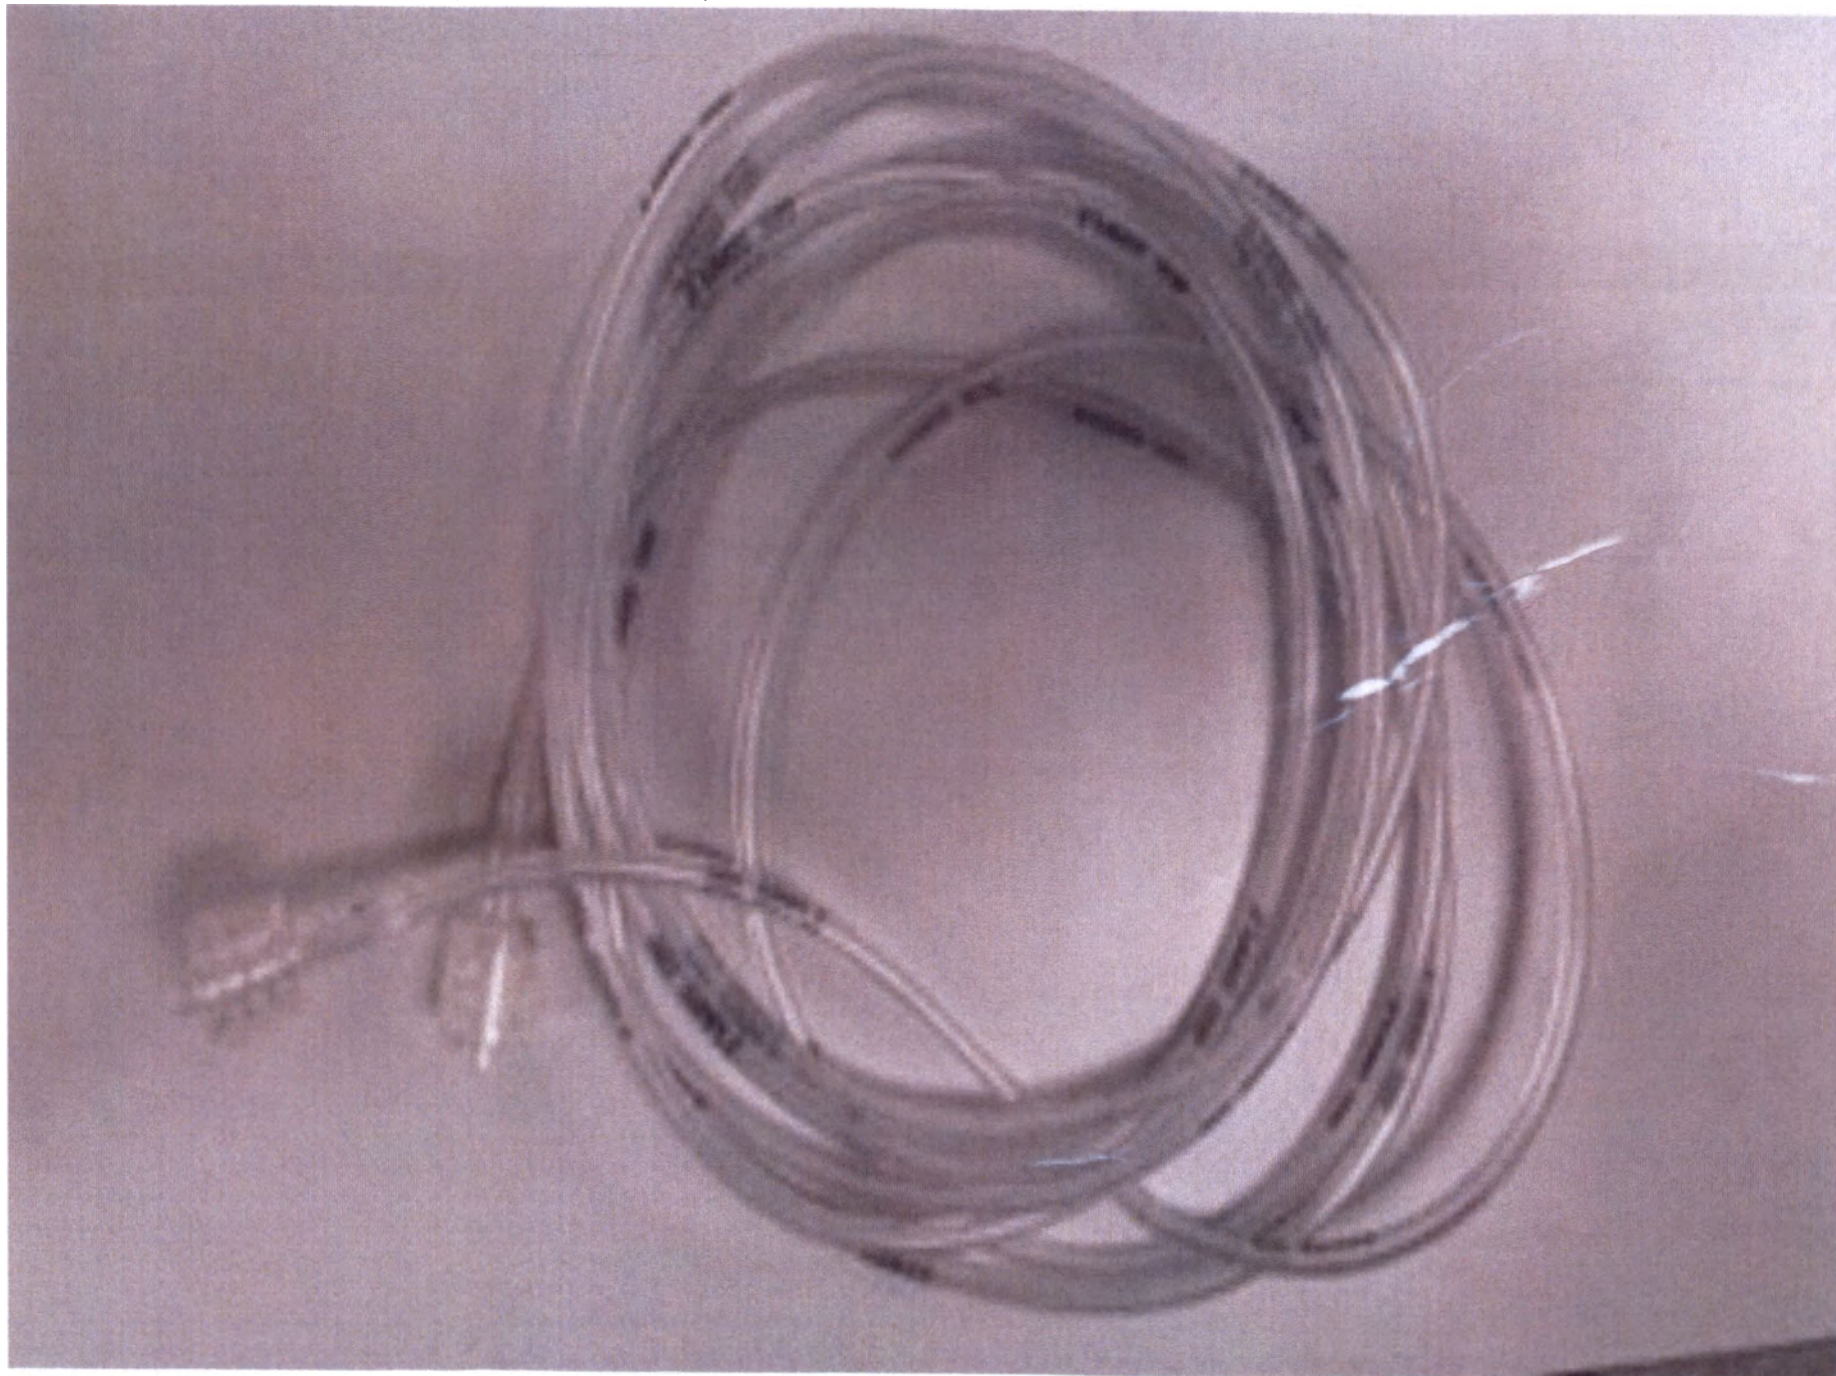



68. Полка верхняя для крепления процессора монитора.

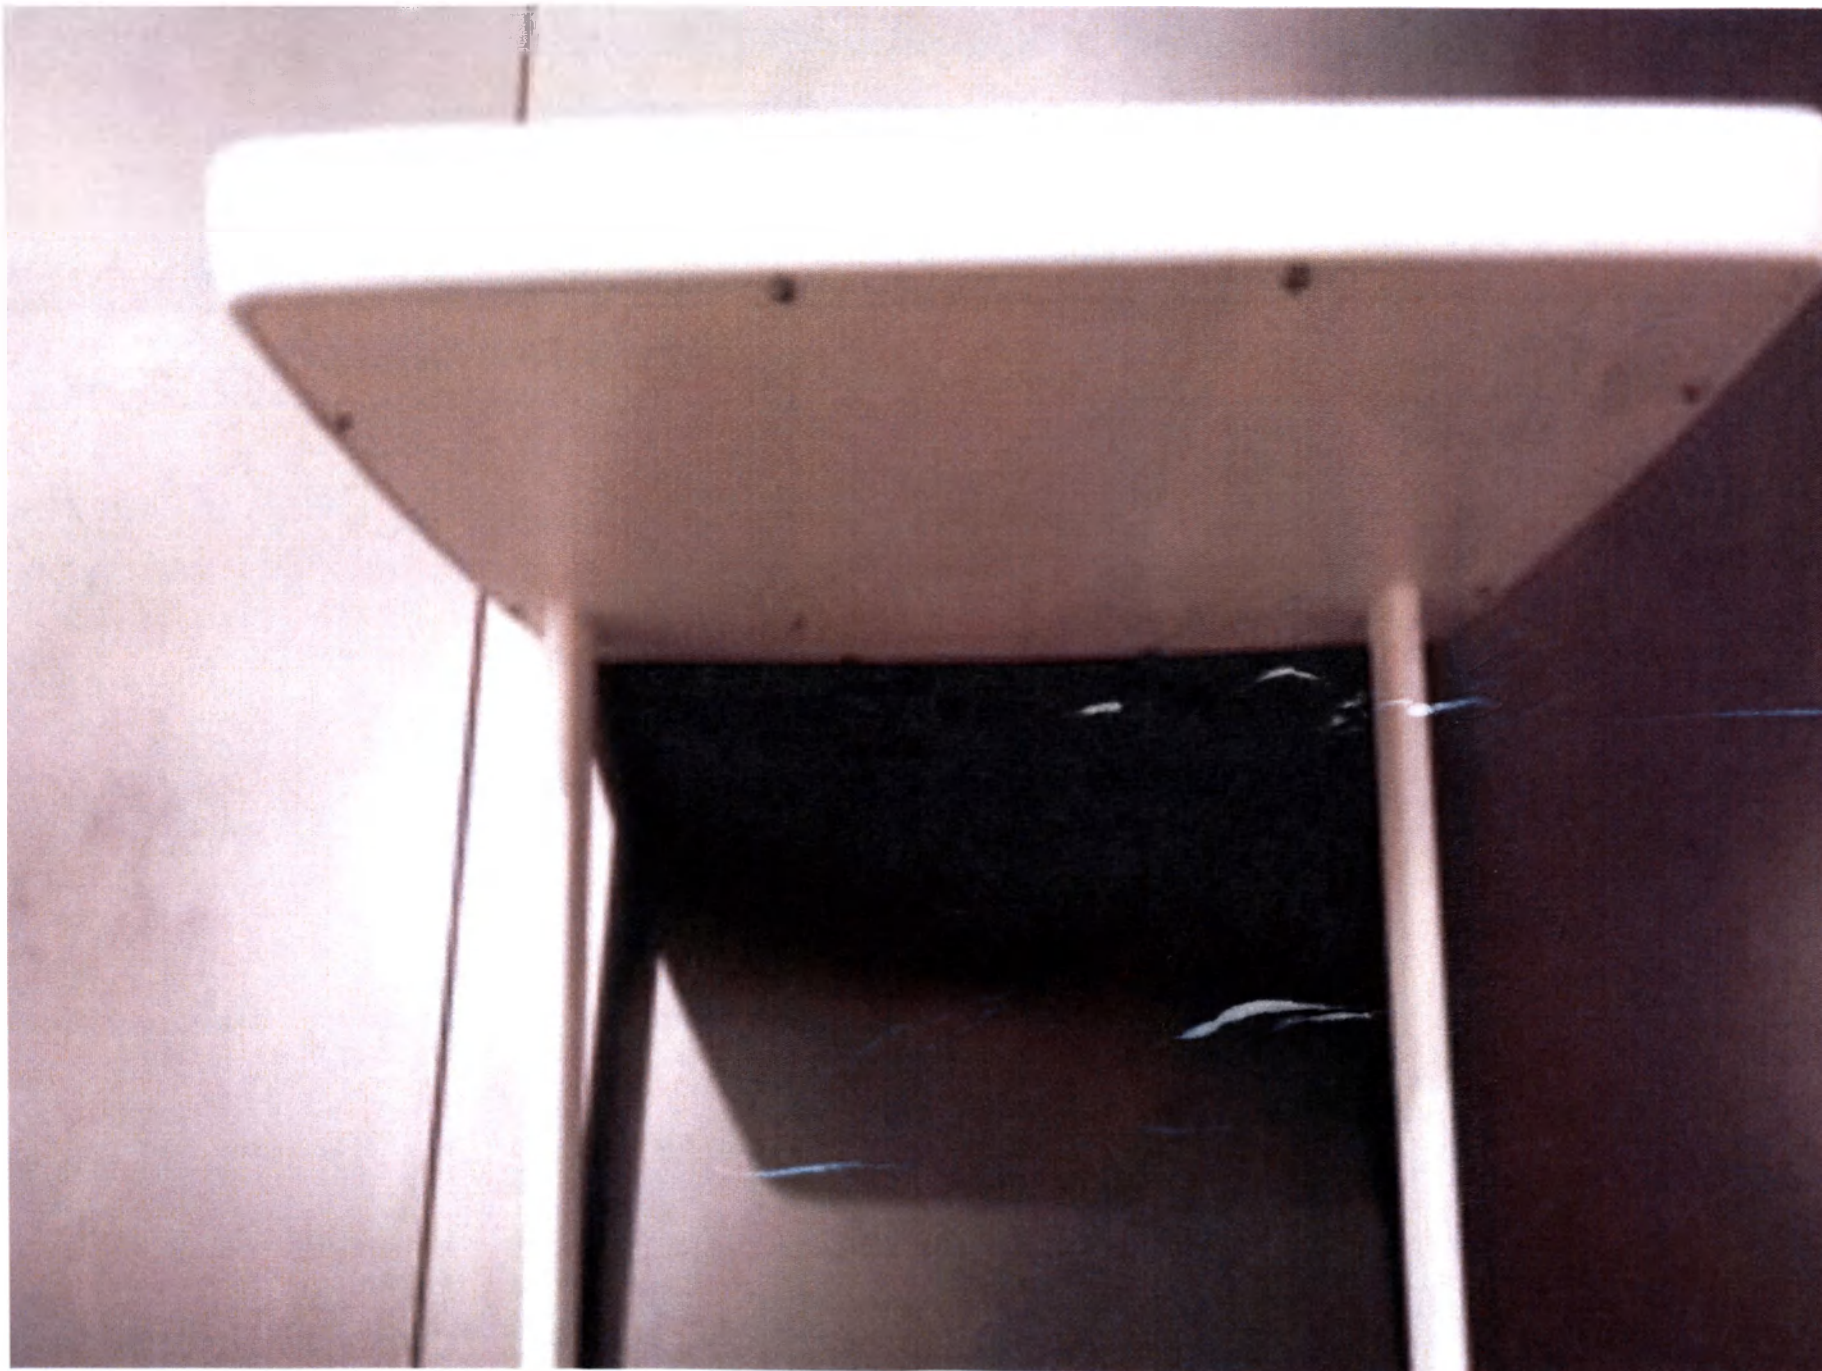




69. Текстильная застежка «липучка» текстильная для крепления процессора монитора.





70. Скоба для текстильной застежки для крепления монитора.

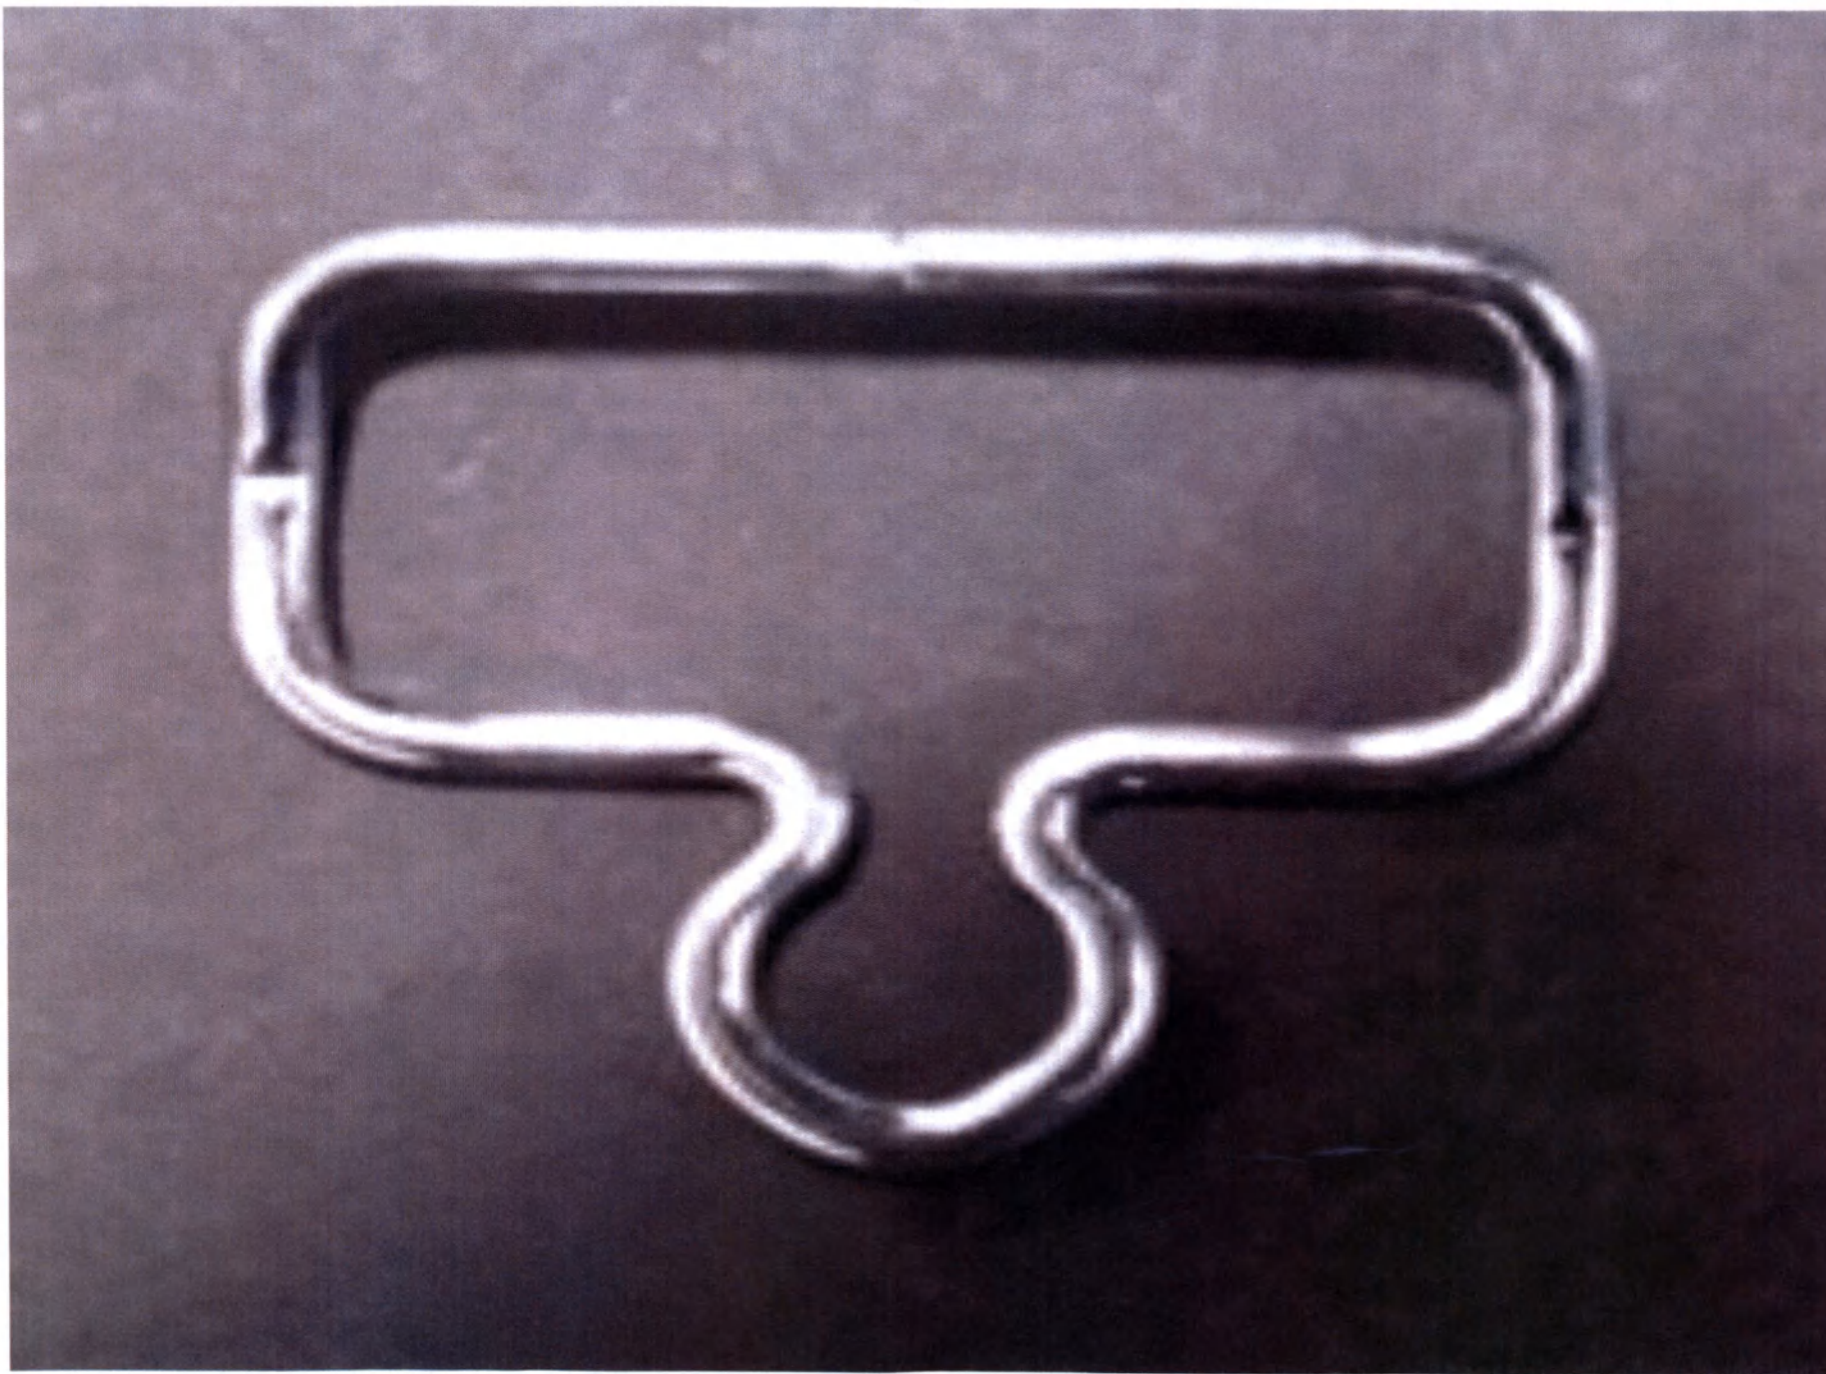




71. Крышка защитная для процессора монитора.





72. Крепление для устройства сопряжения сети Unity ID.

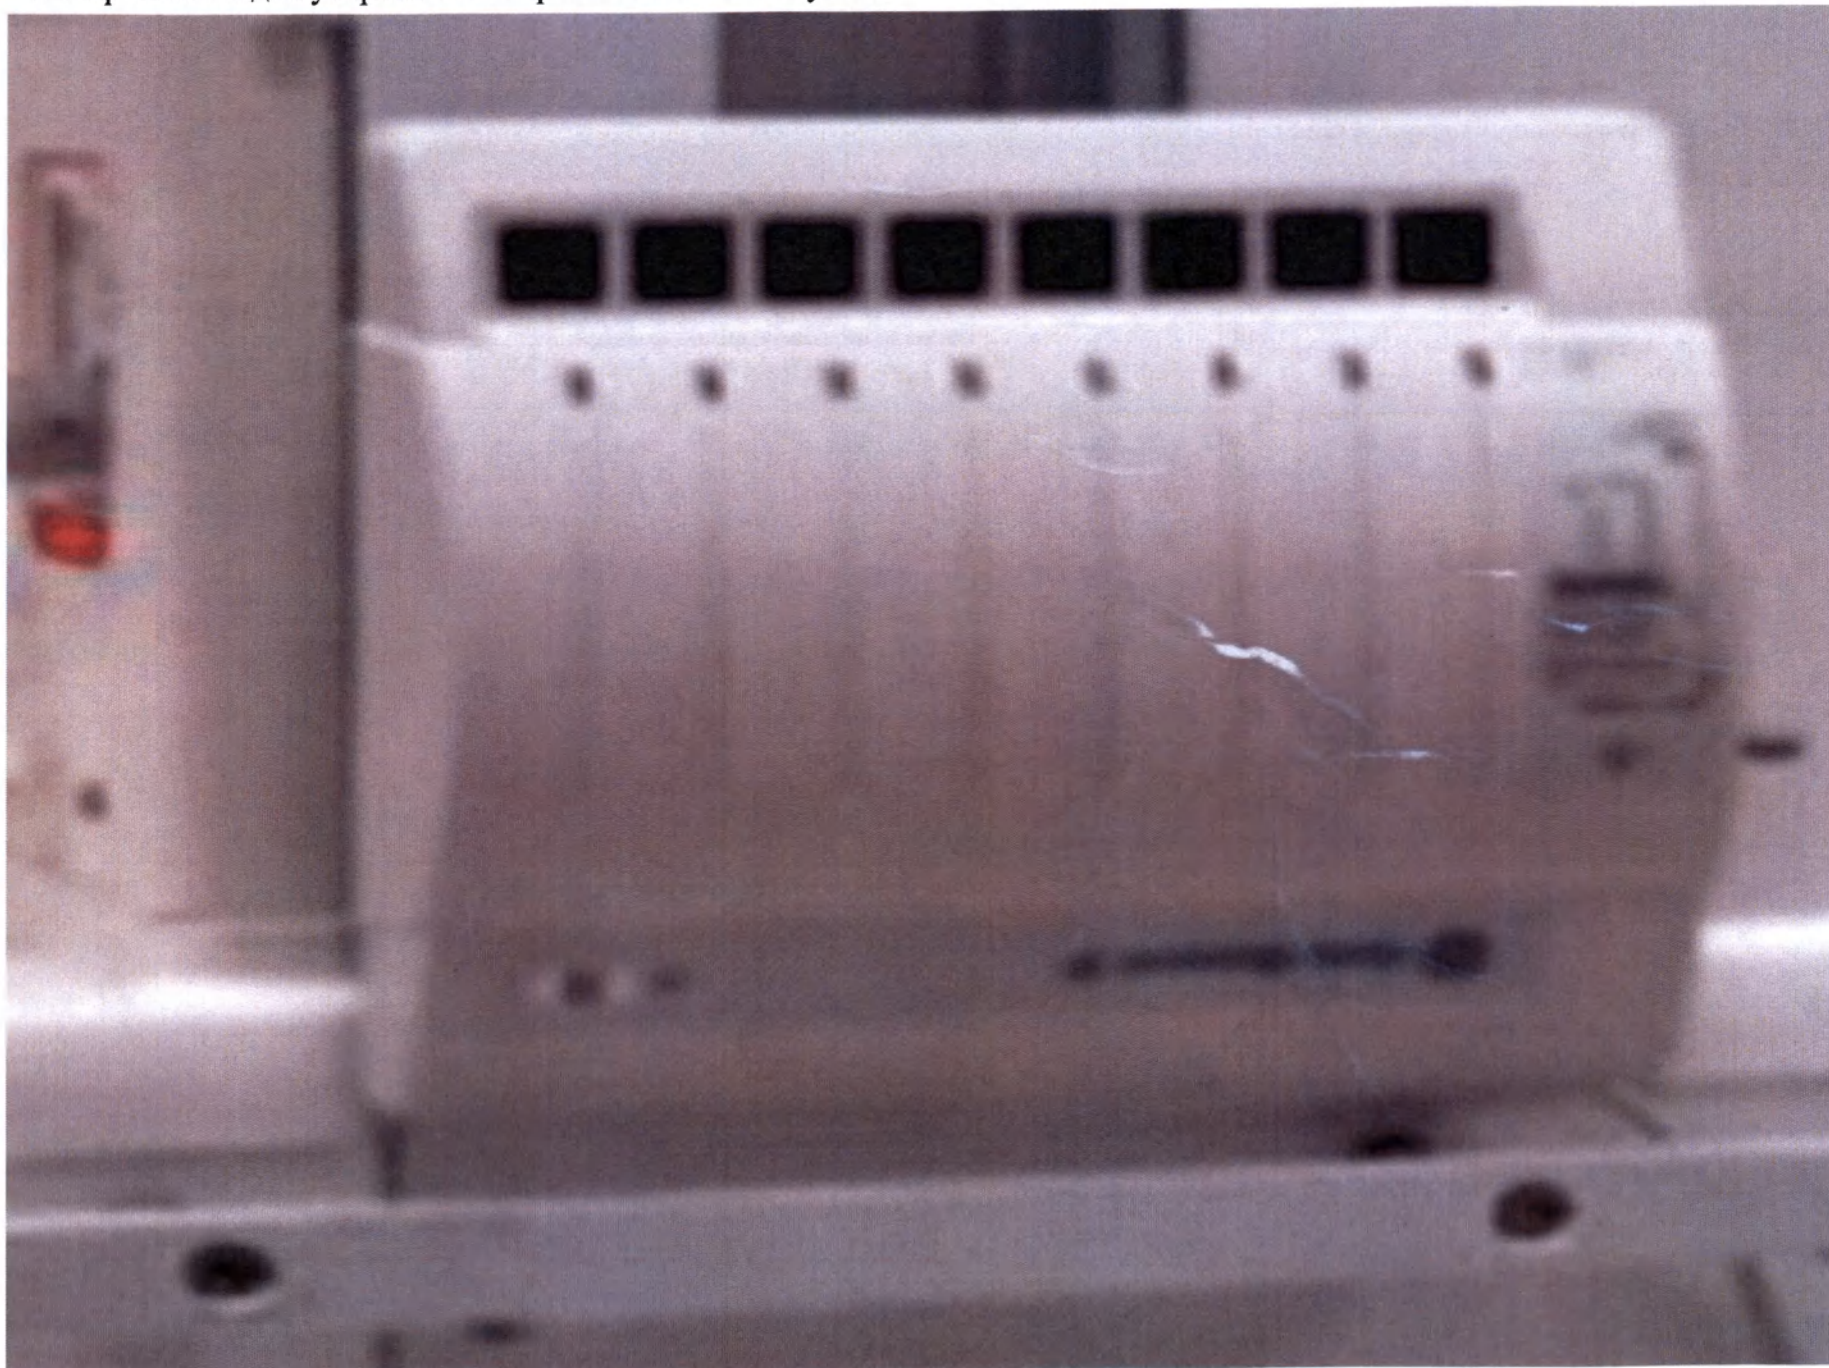




### 73. Крепление для принтера.






## 74. Крепление модулей.

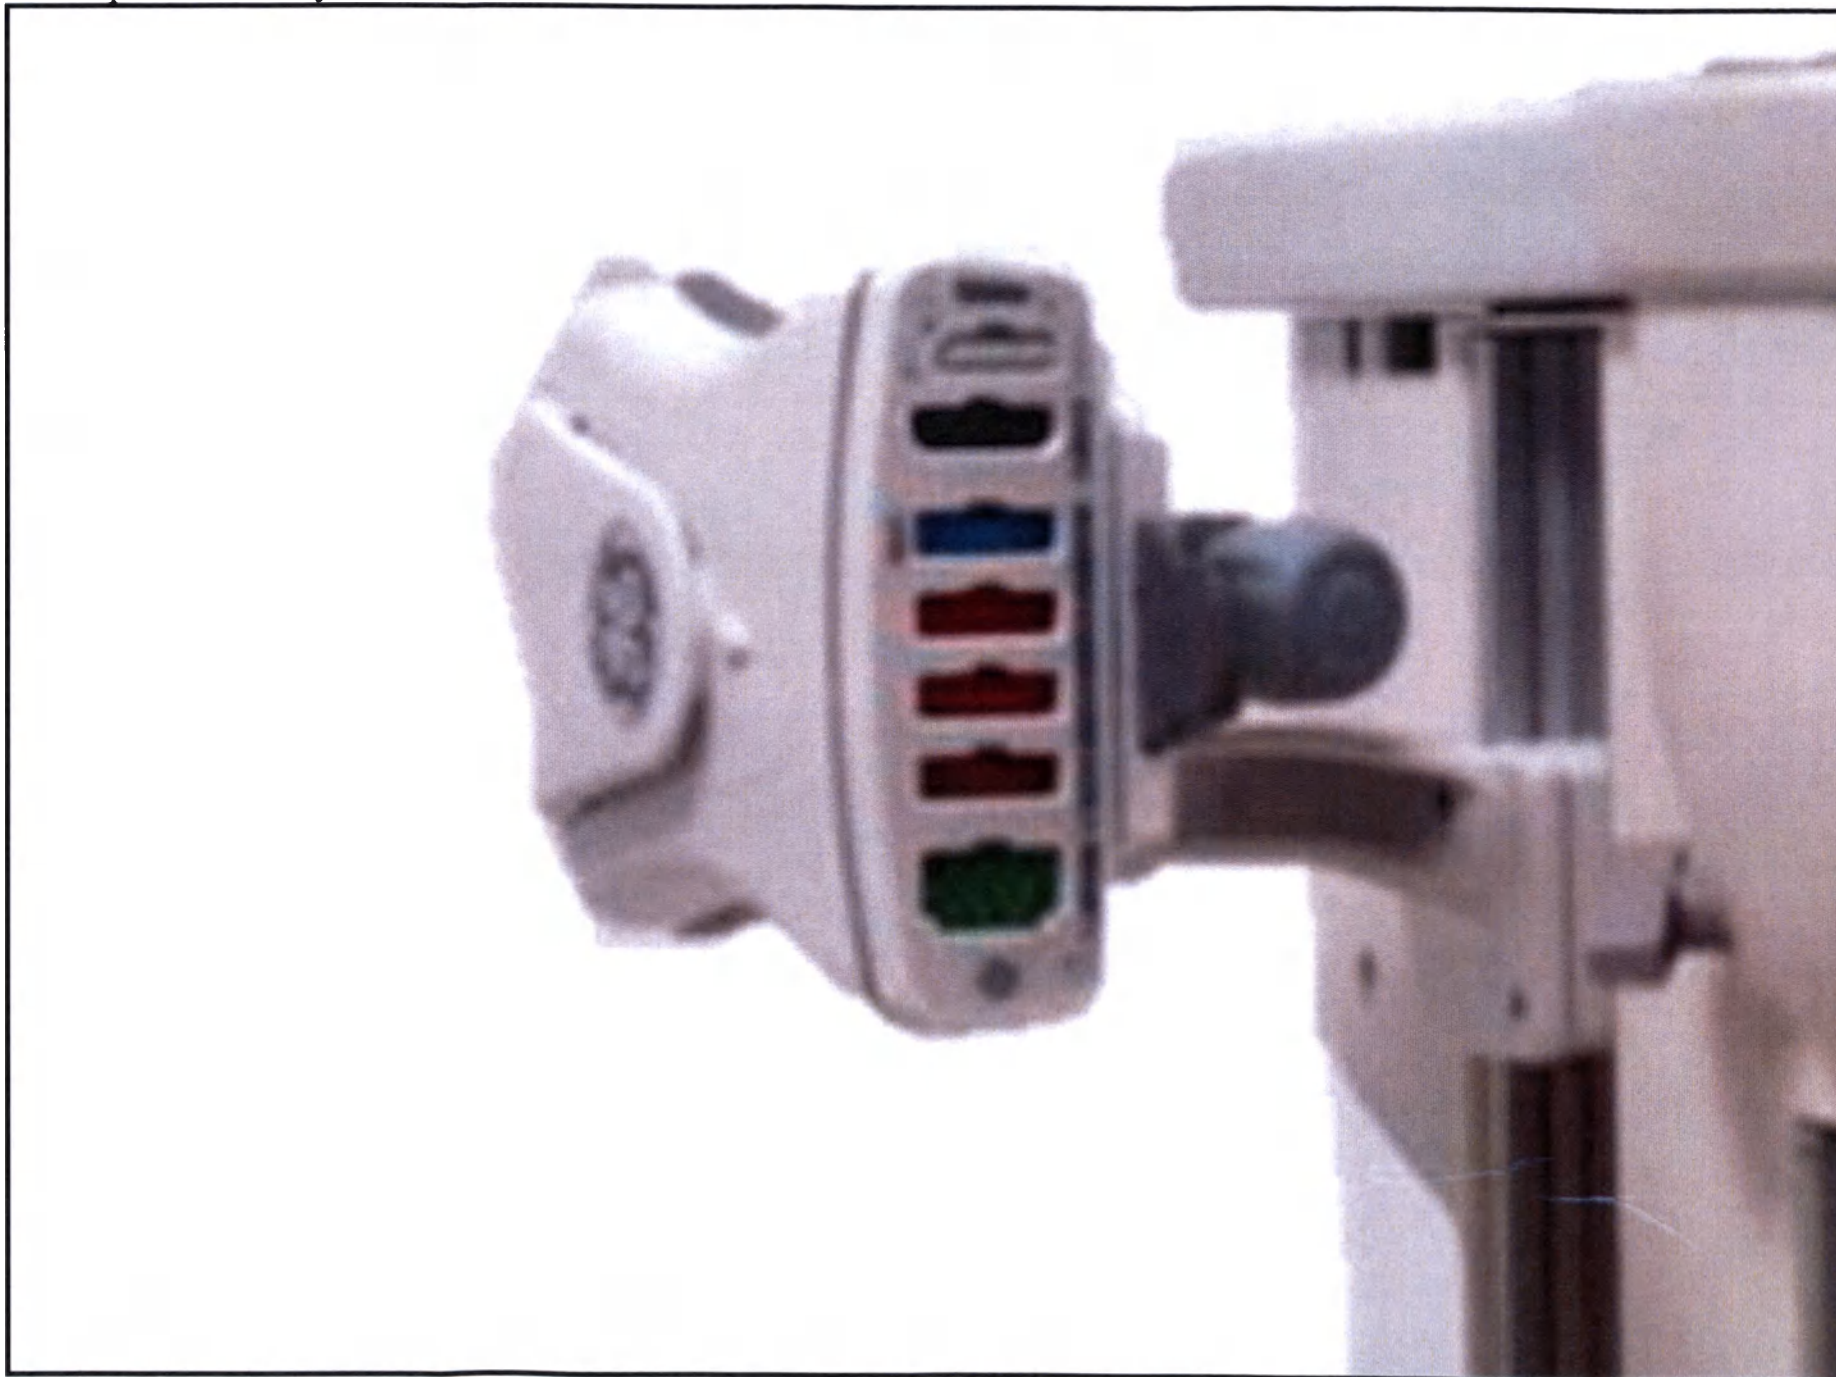



## 75. Крепление модуля PDM.

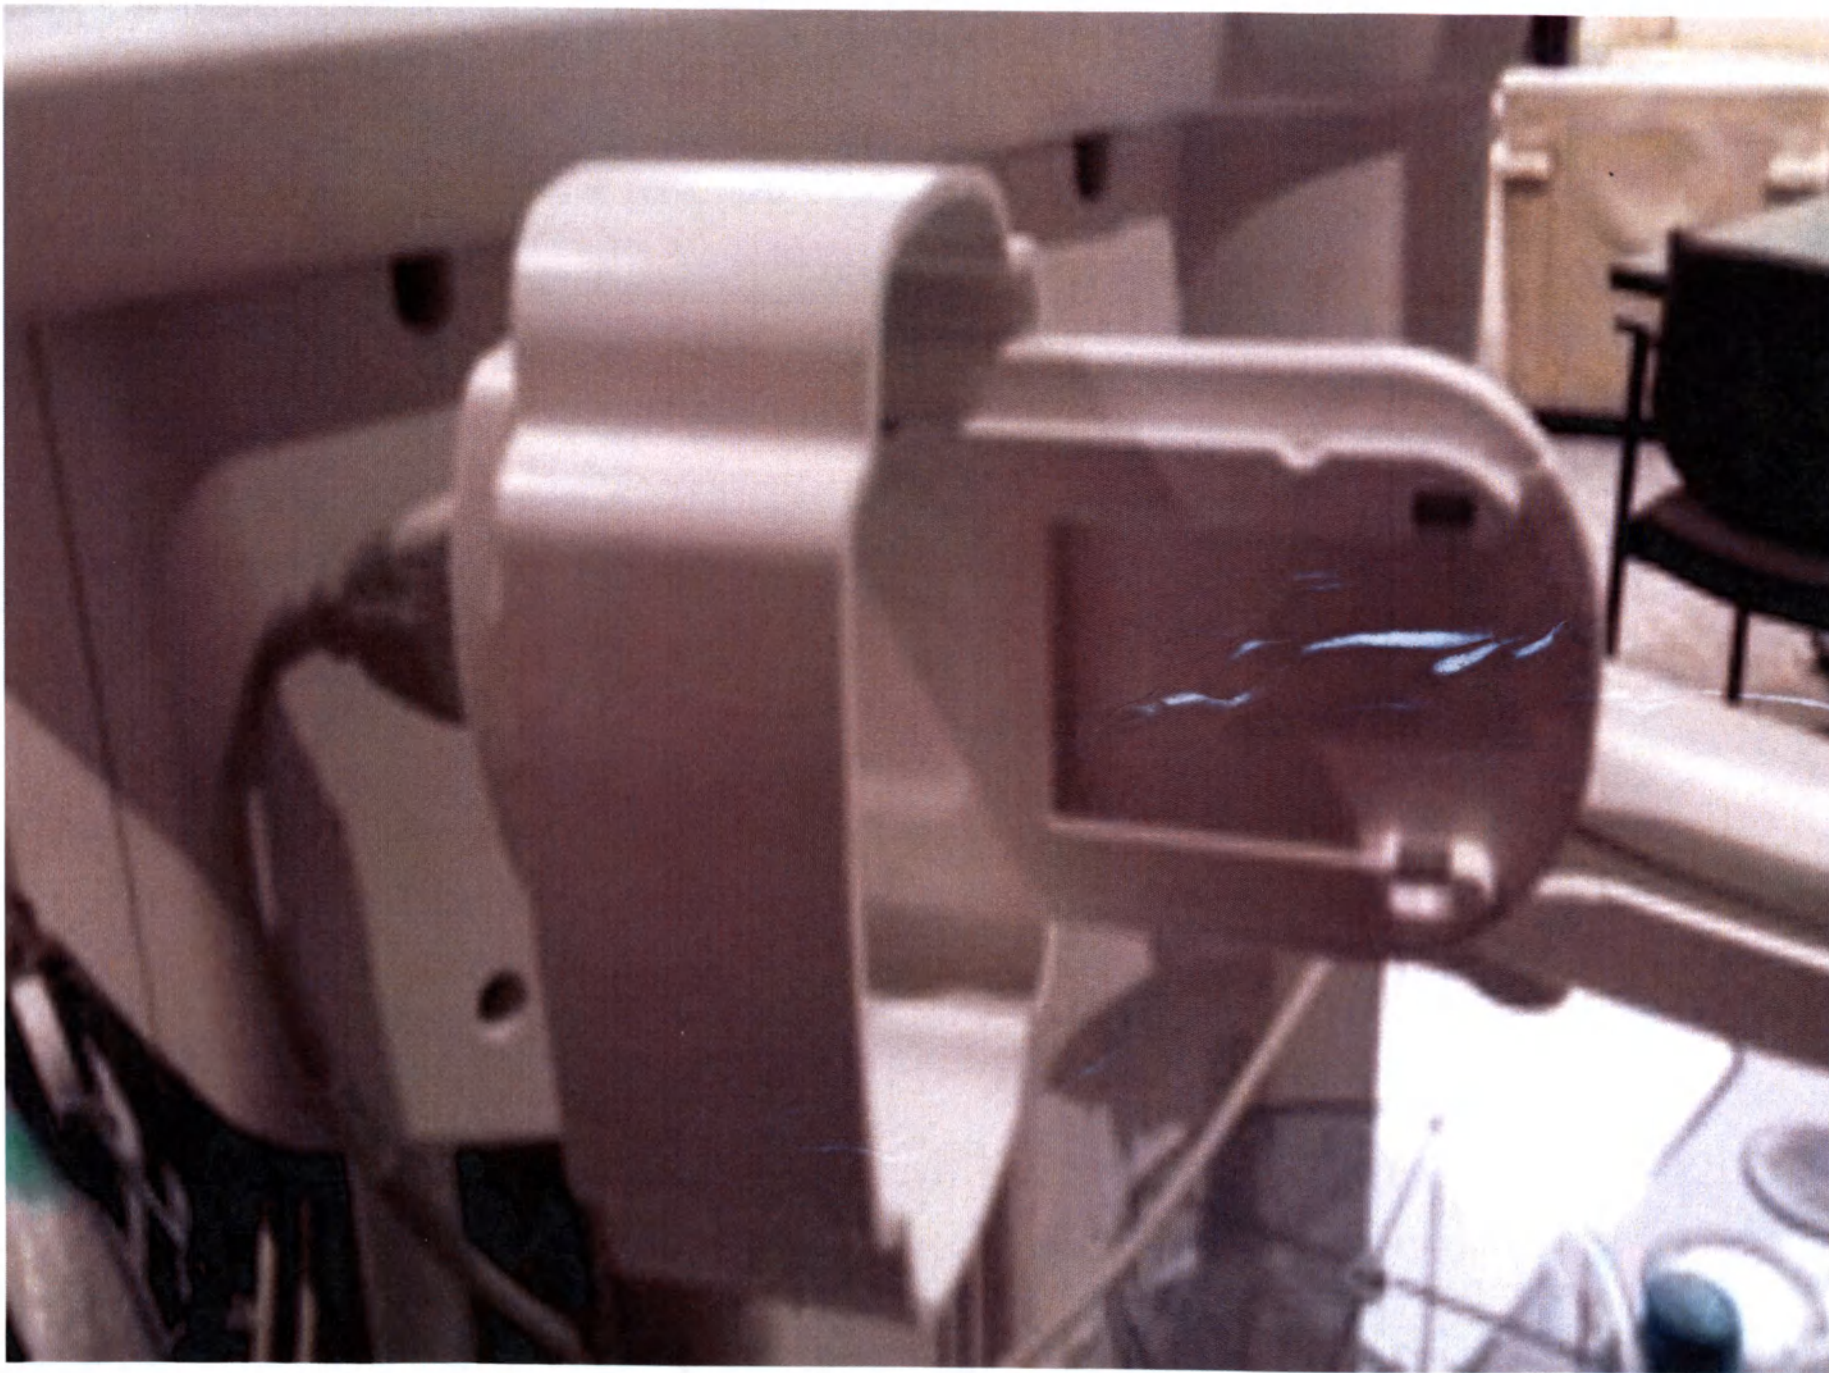








## 77. Крепление модуля PSM.

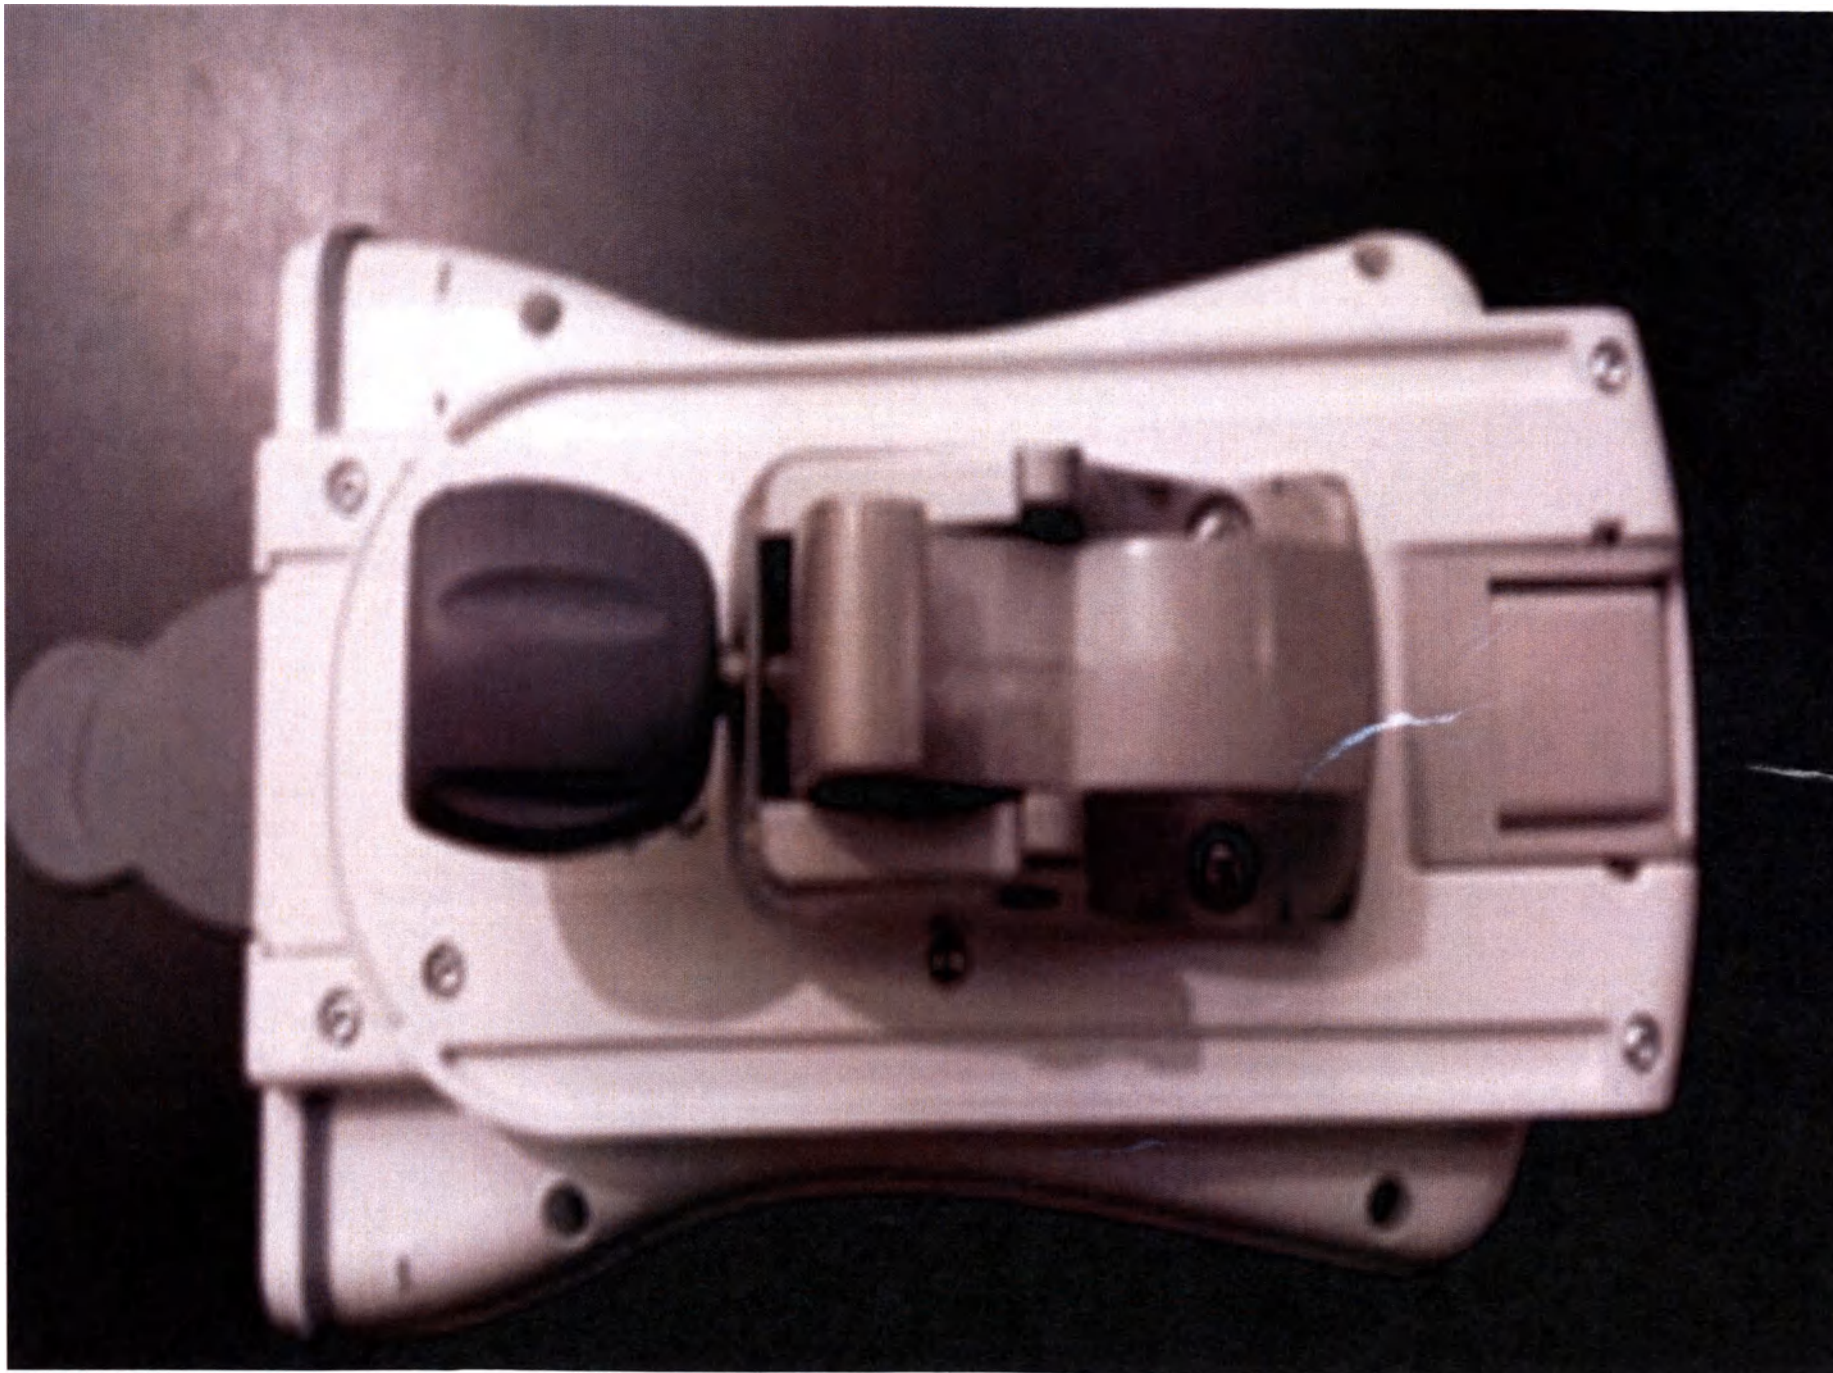



## 78. Программное обеспечение.





## 79. Опция программного обеспечения Pressure Mode Option.





80. USB карта для активации опции программного обеспечения - Pressure Mode Option.






## 81. Опция программного обеспечения Pressure + Spontaneous Option.






82. USB карта для активации опции программного обеспечения Pressure + Spontaneous Option.

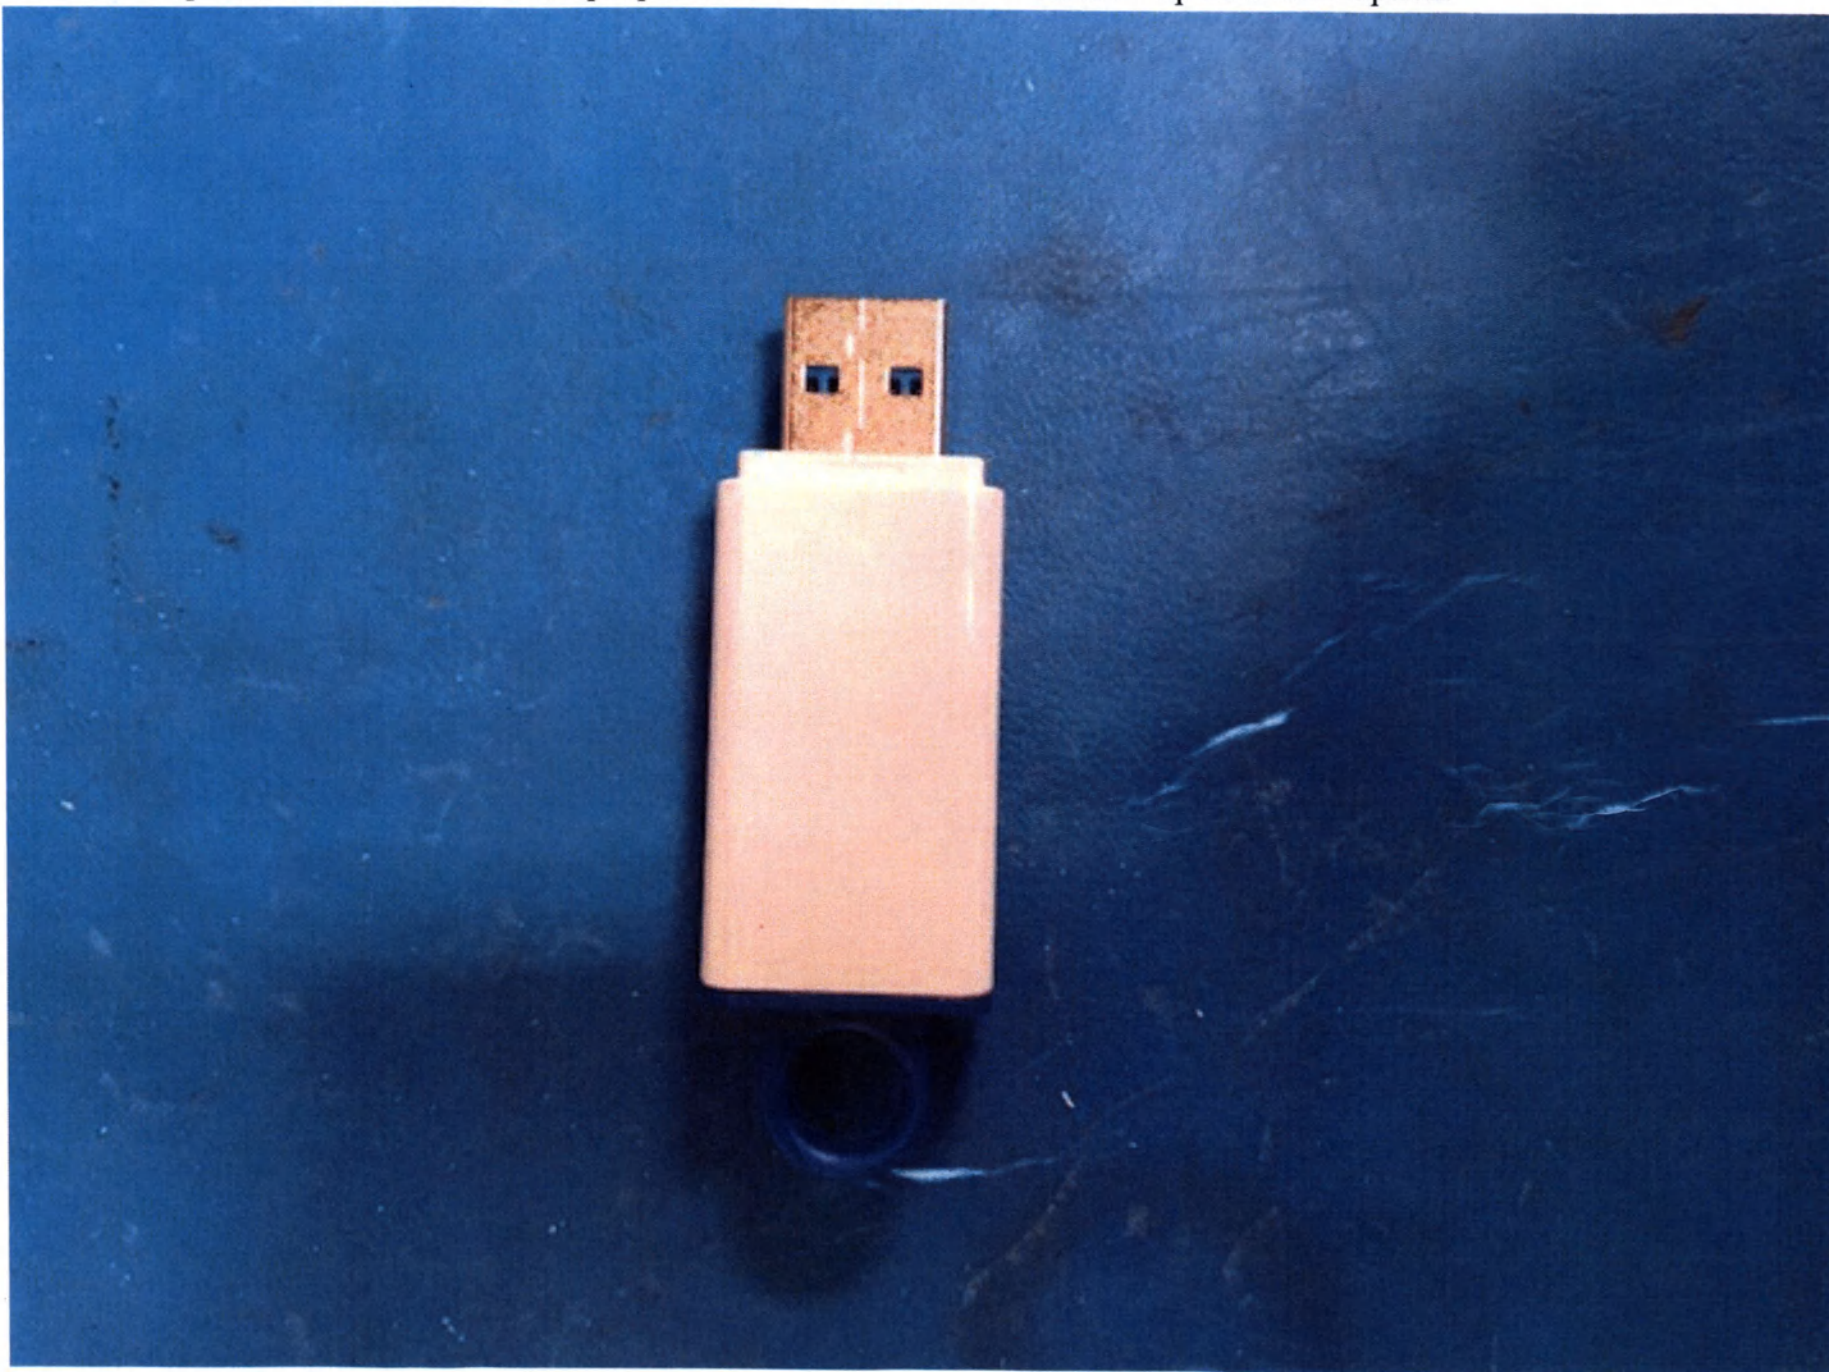




## 83. Опция программного обеспечения VCV Cardiac Bypass.

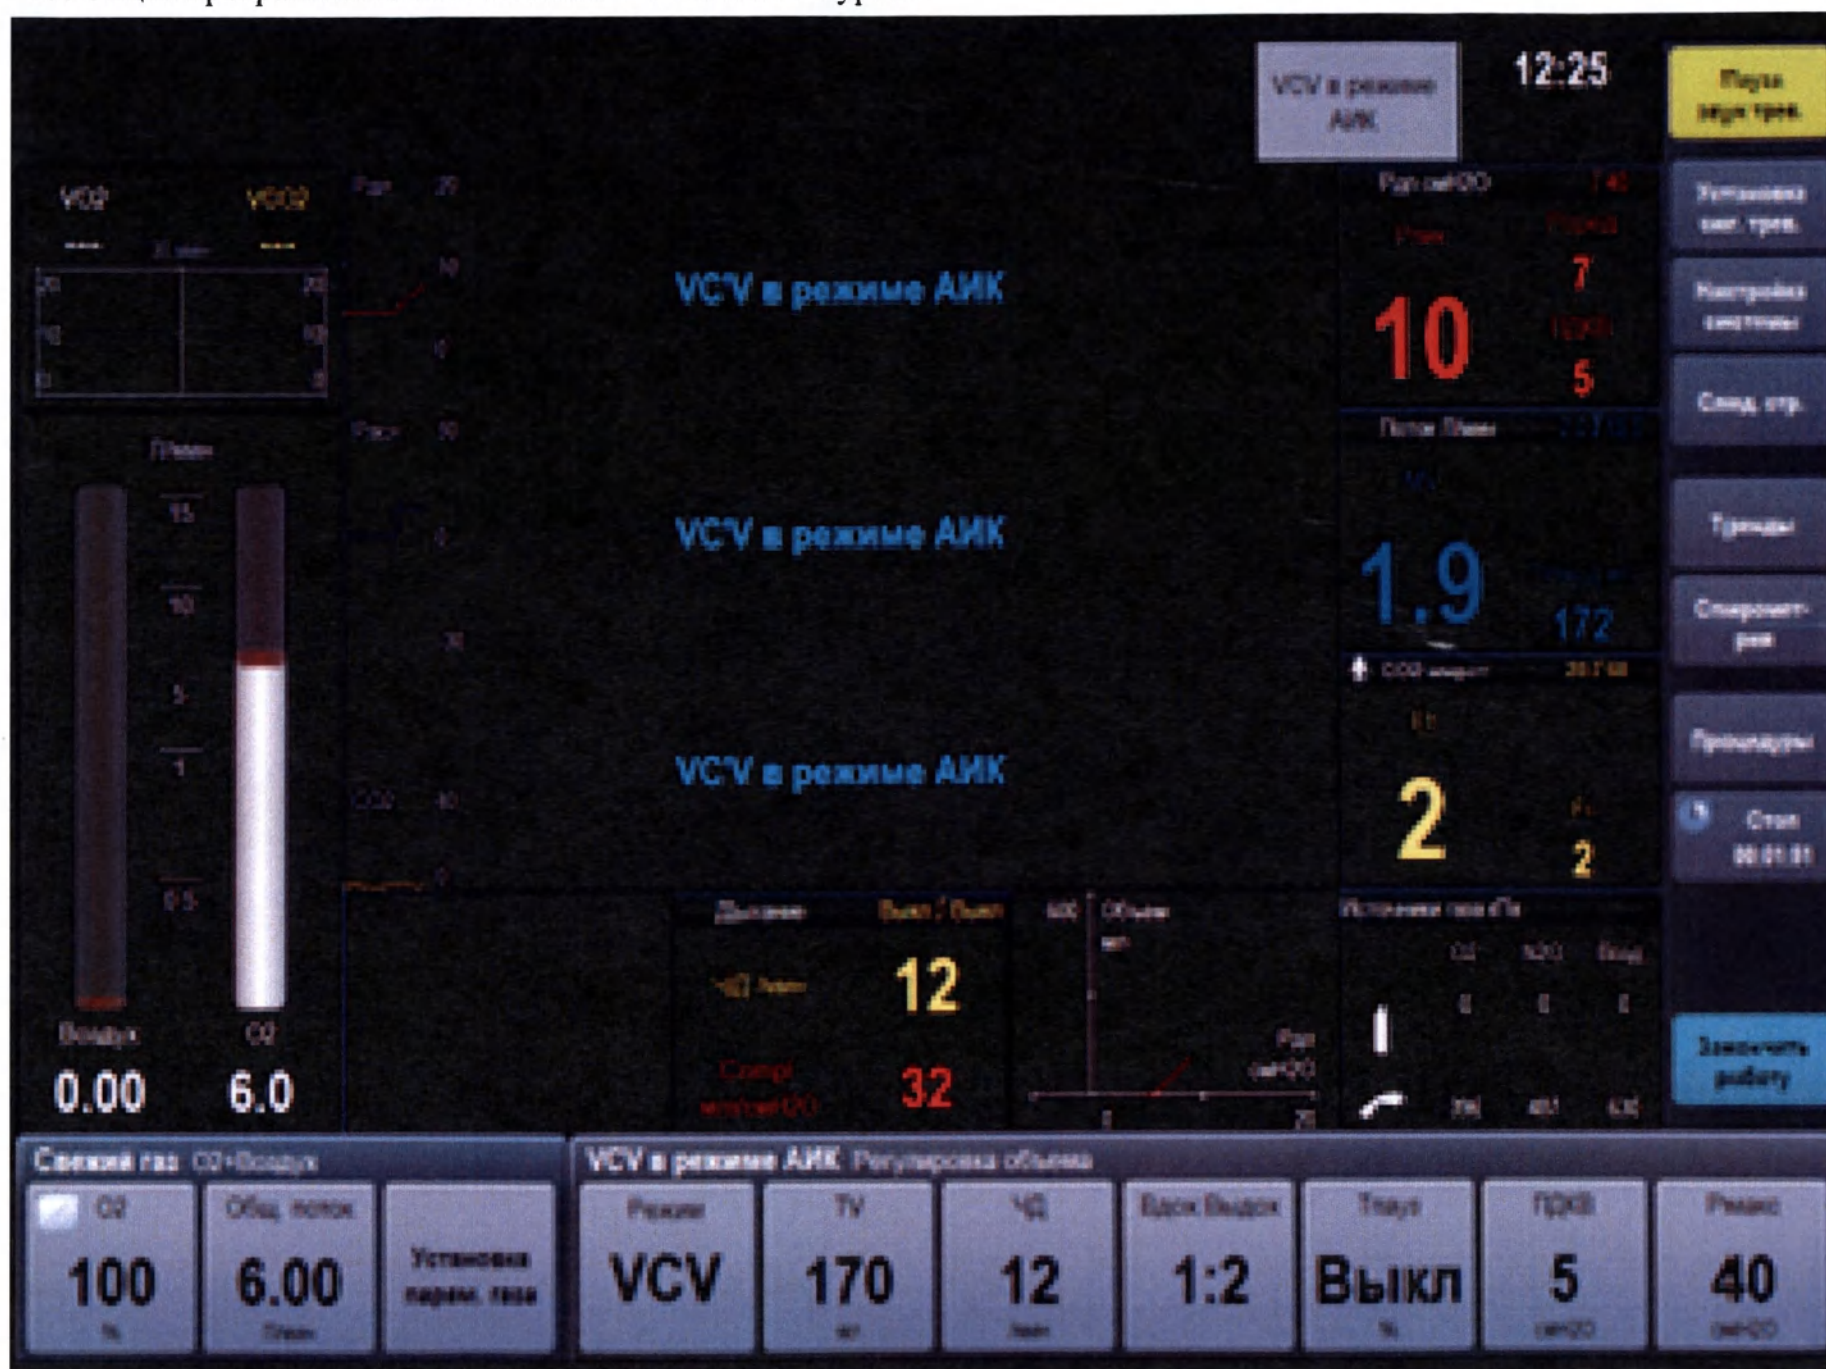



84. USB карта для активации опции программного обеспечения VCV Cardiac Bypass (field upgrade).

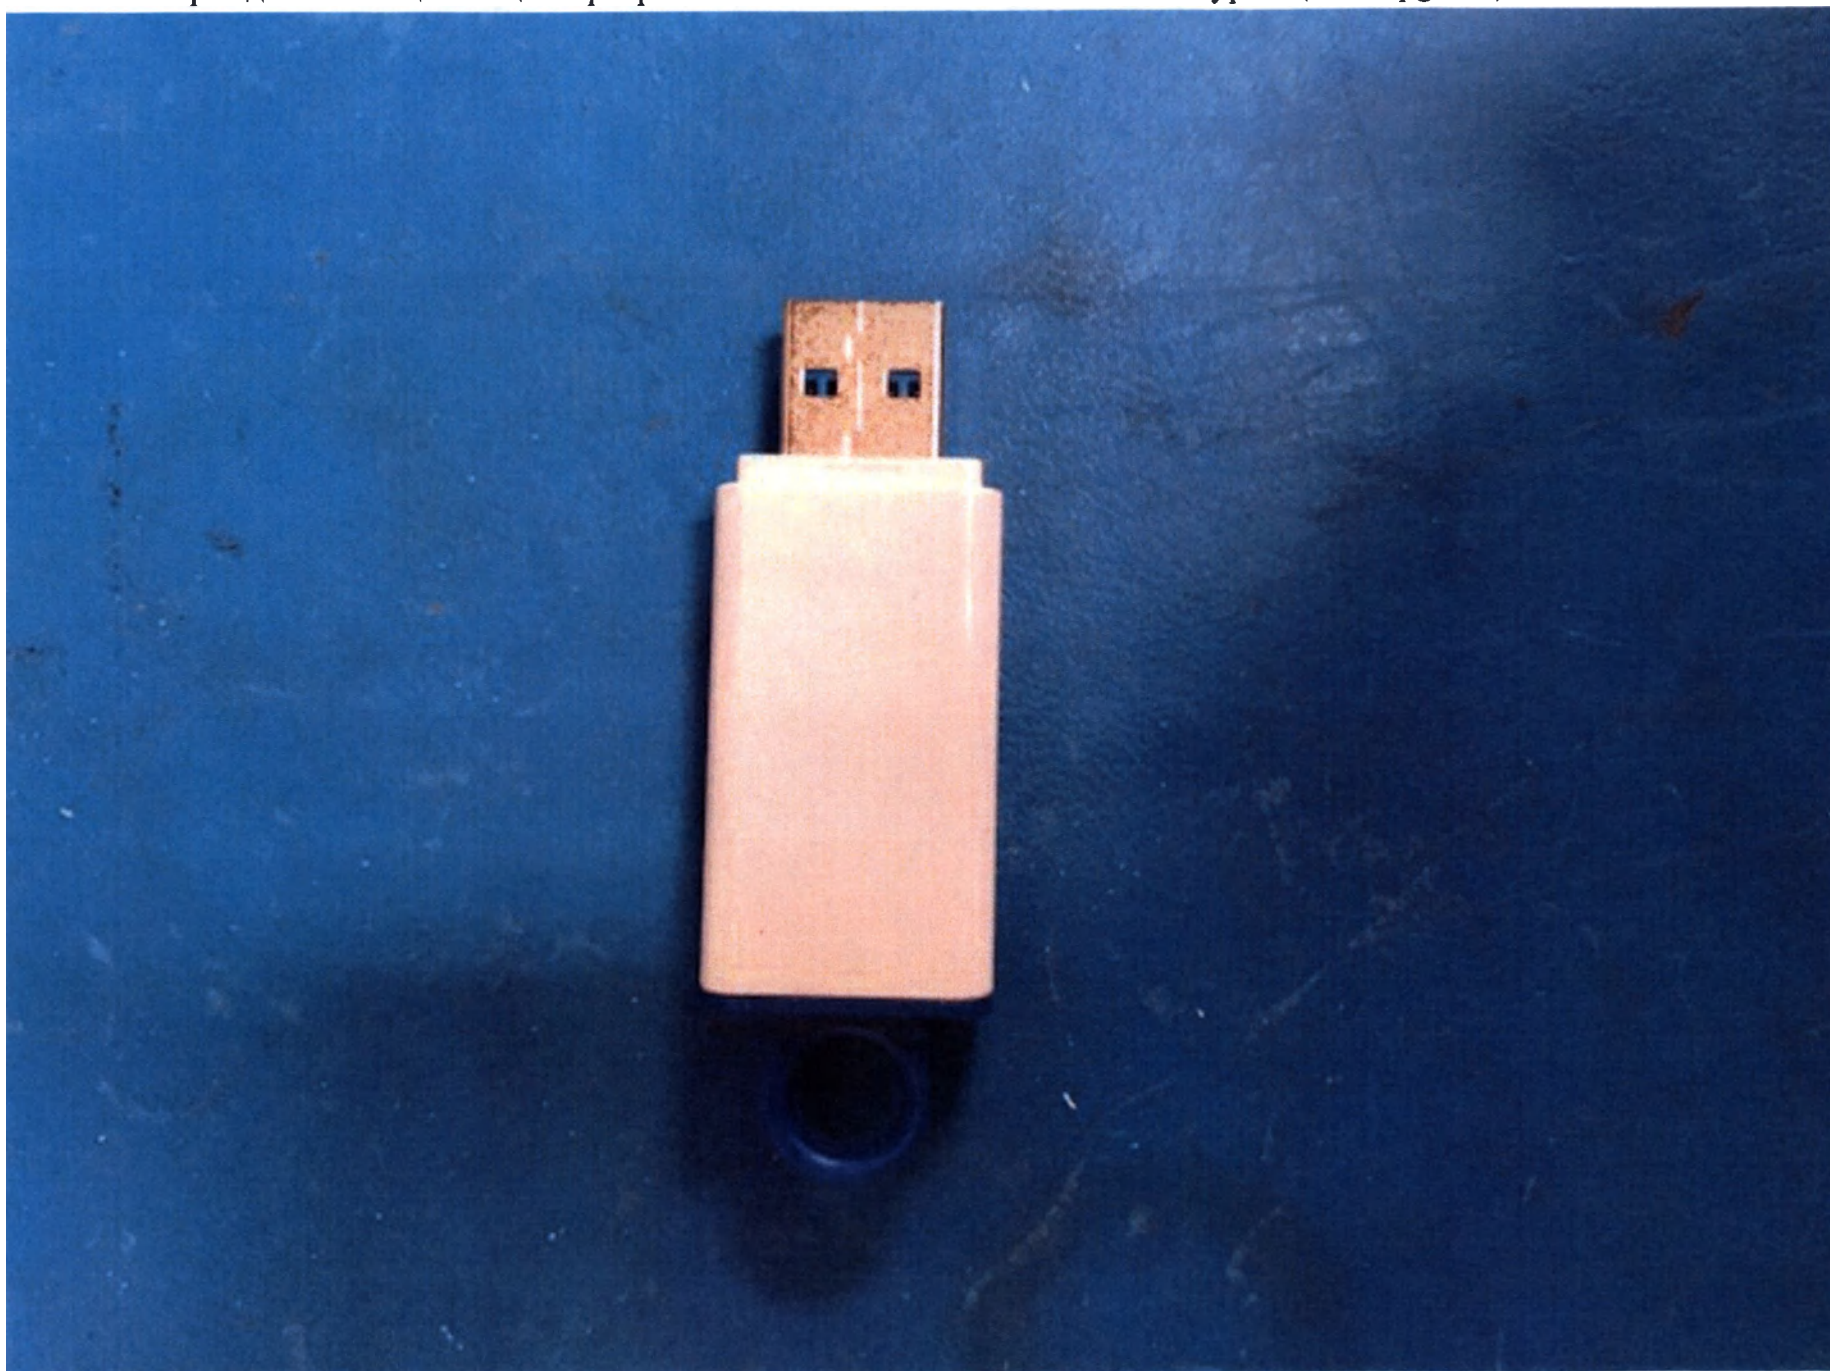




## 85. Опция программного обеспечения ET CONTROL.





86. USB карта для активации опции программного обеспечения ET CONTROL.

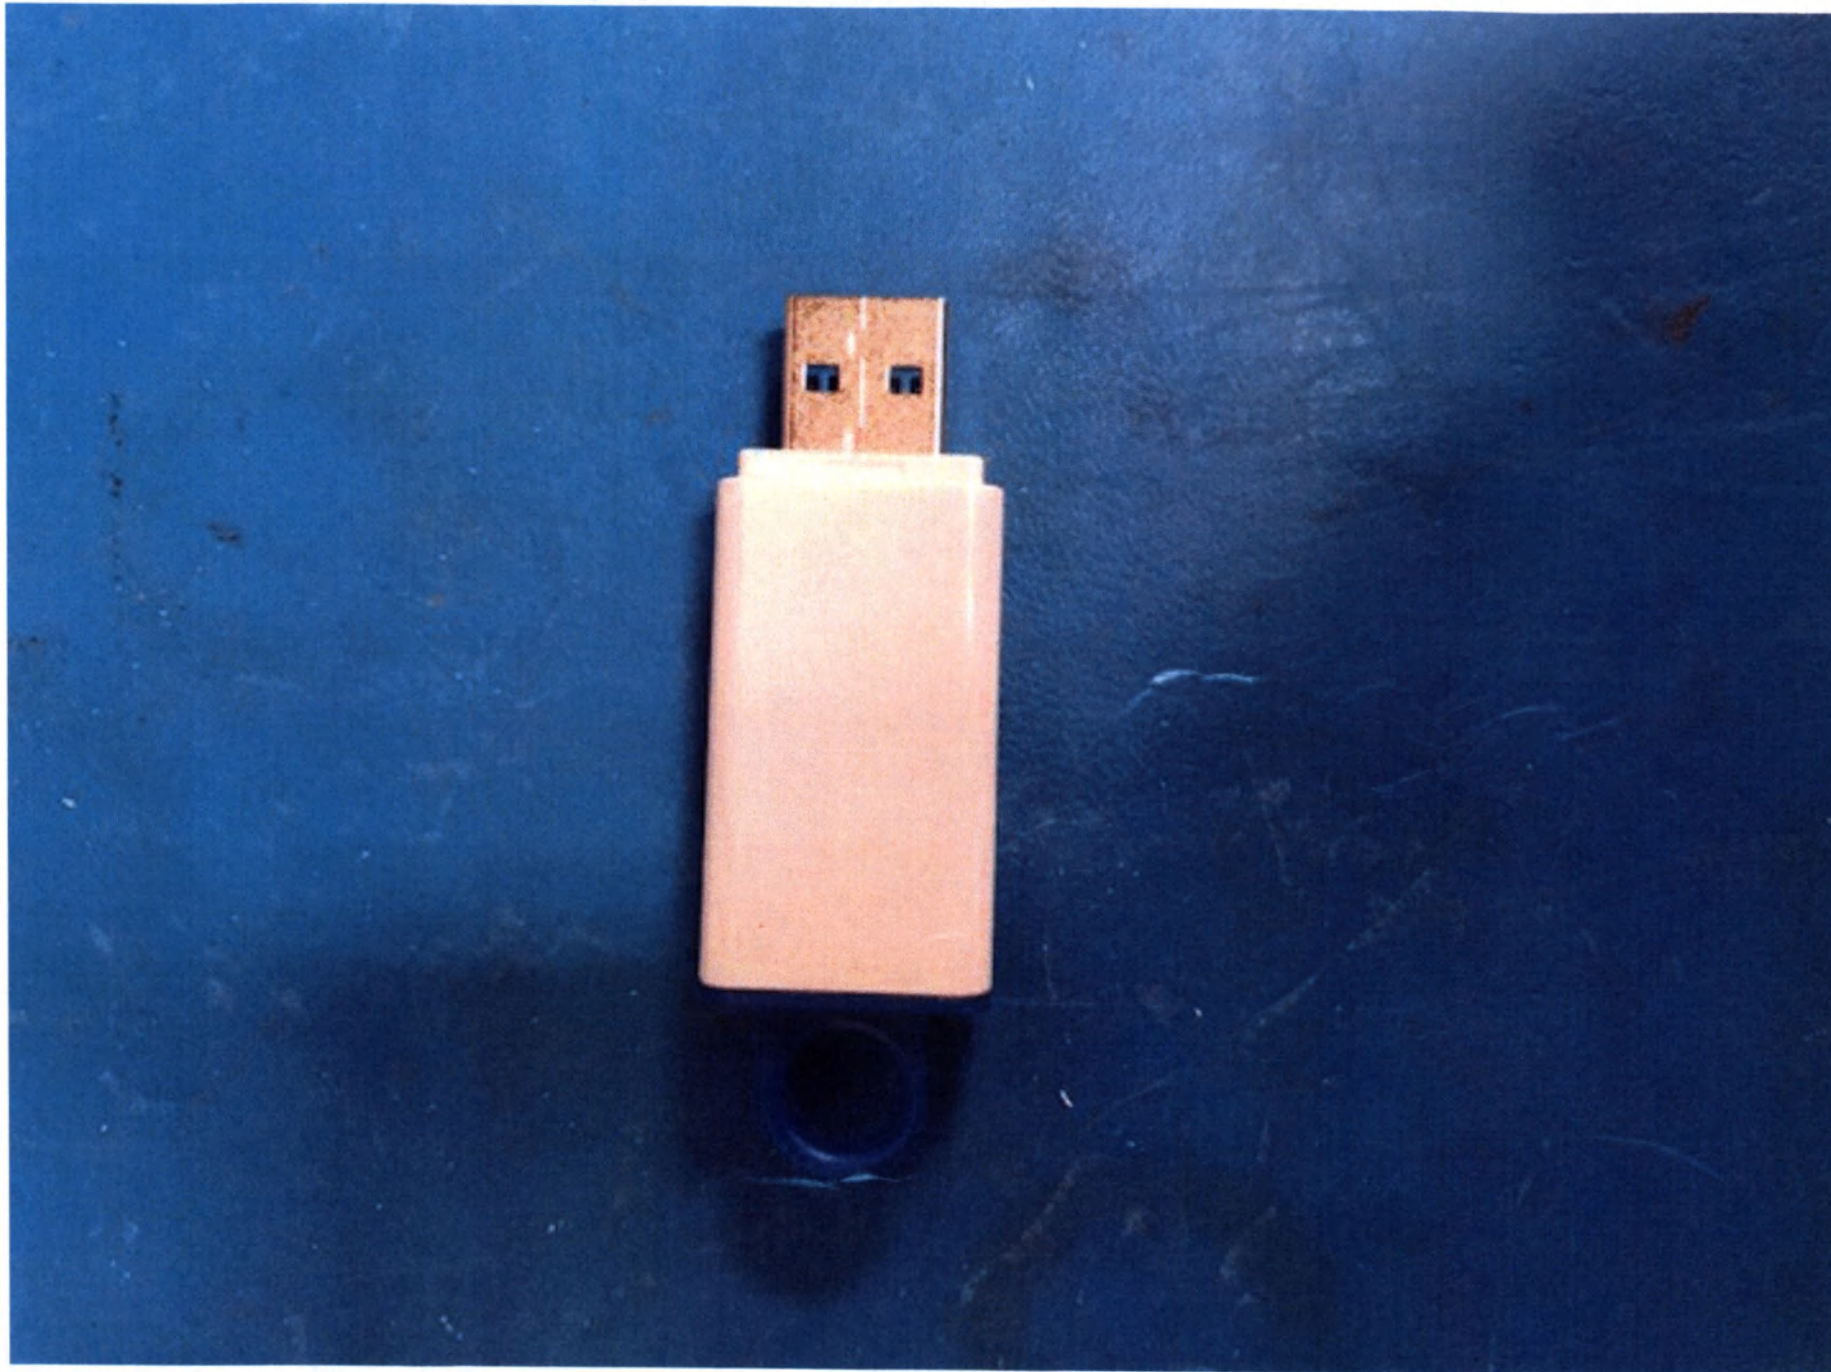




## 87. Опция программного обеспечения CPAP/PSV.





88. USB карта для активации опции программного обеспечения СРАР/PSV.

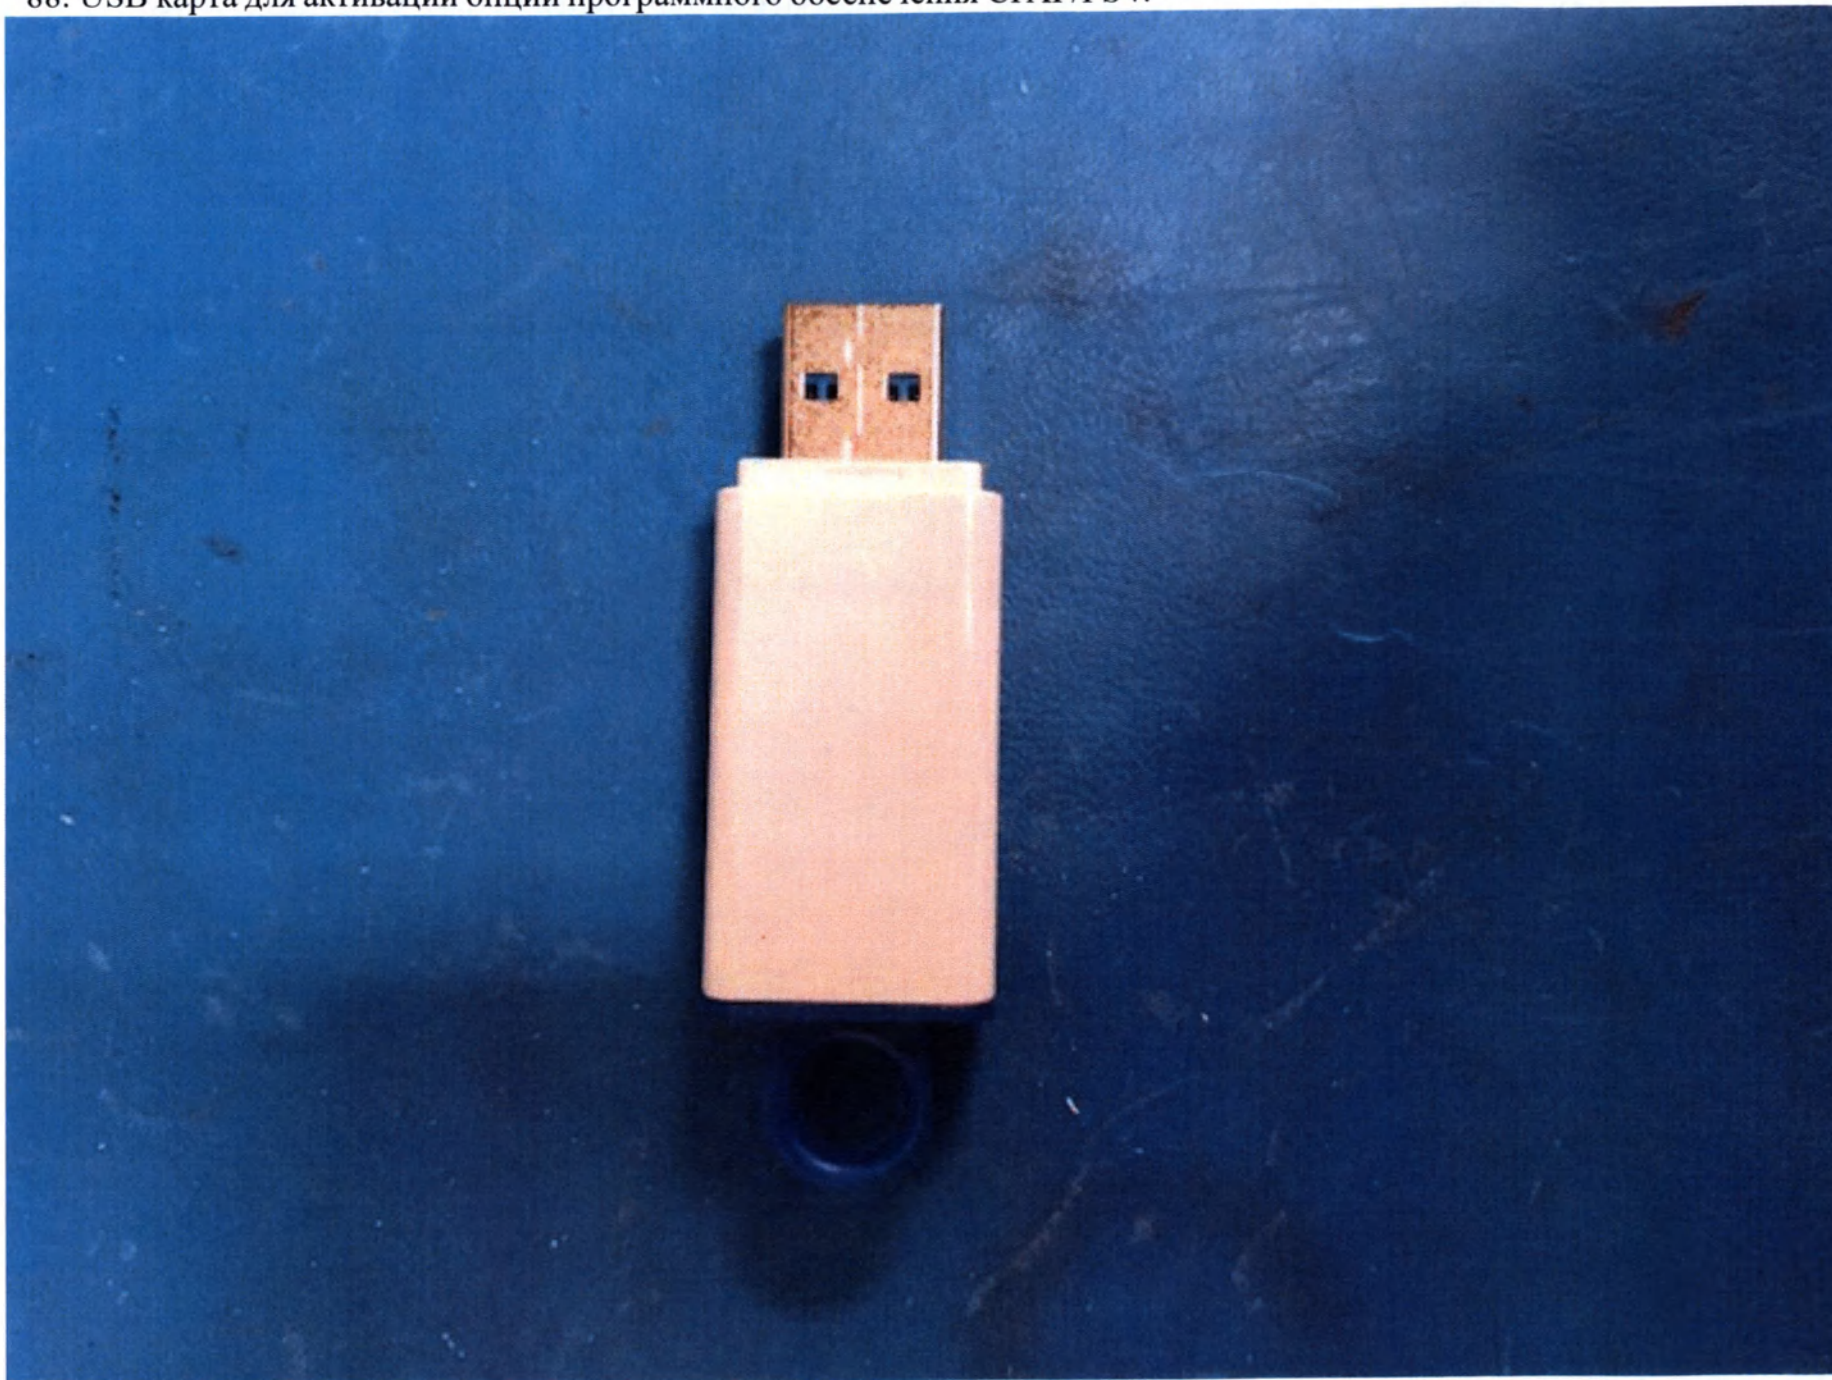



## 89. Опция программного обеспечения ESO-flow.






90. USB карта для активации опции программного обеспечения Eсо-flow.





## 91. Вход электропитания.

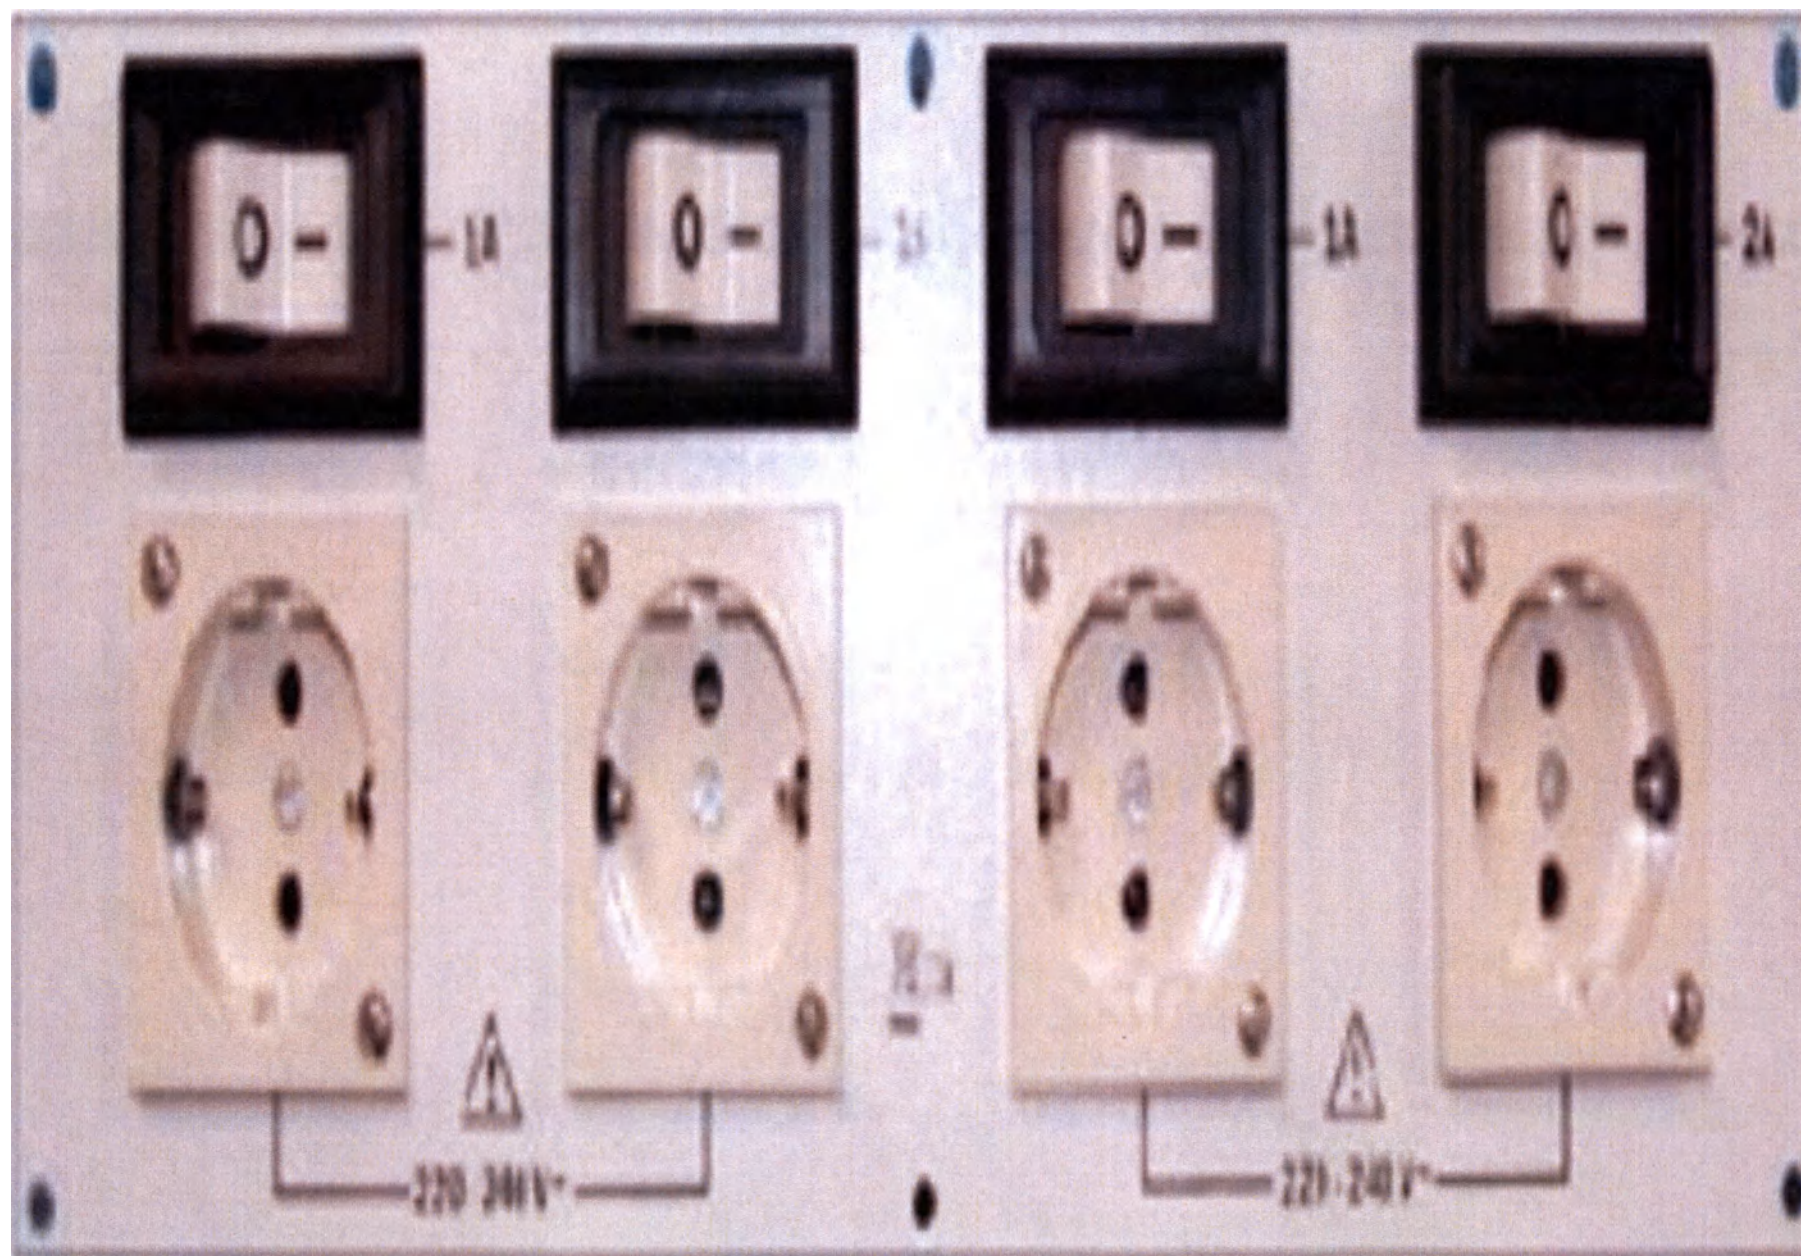








93. Держатель баллонов Air Liquid.

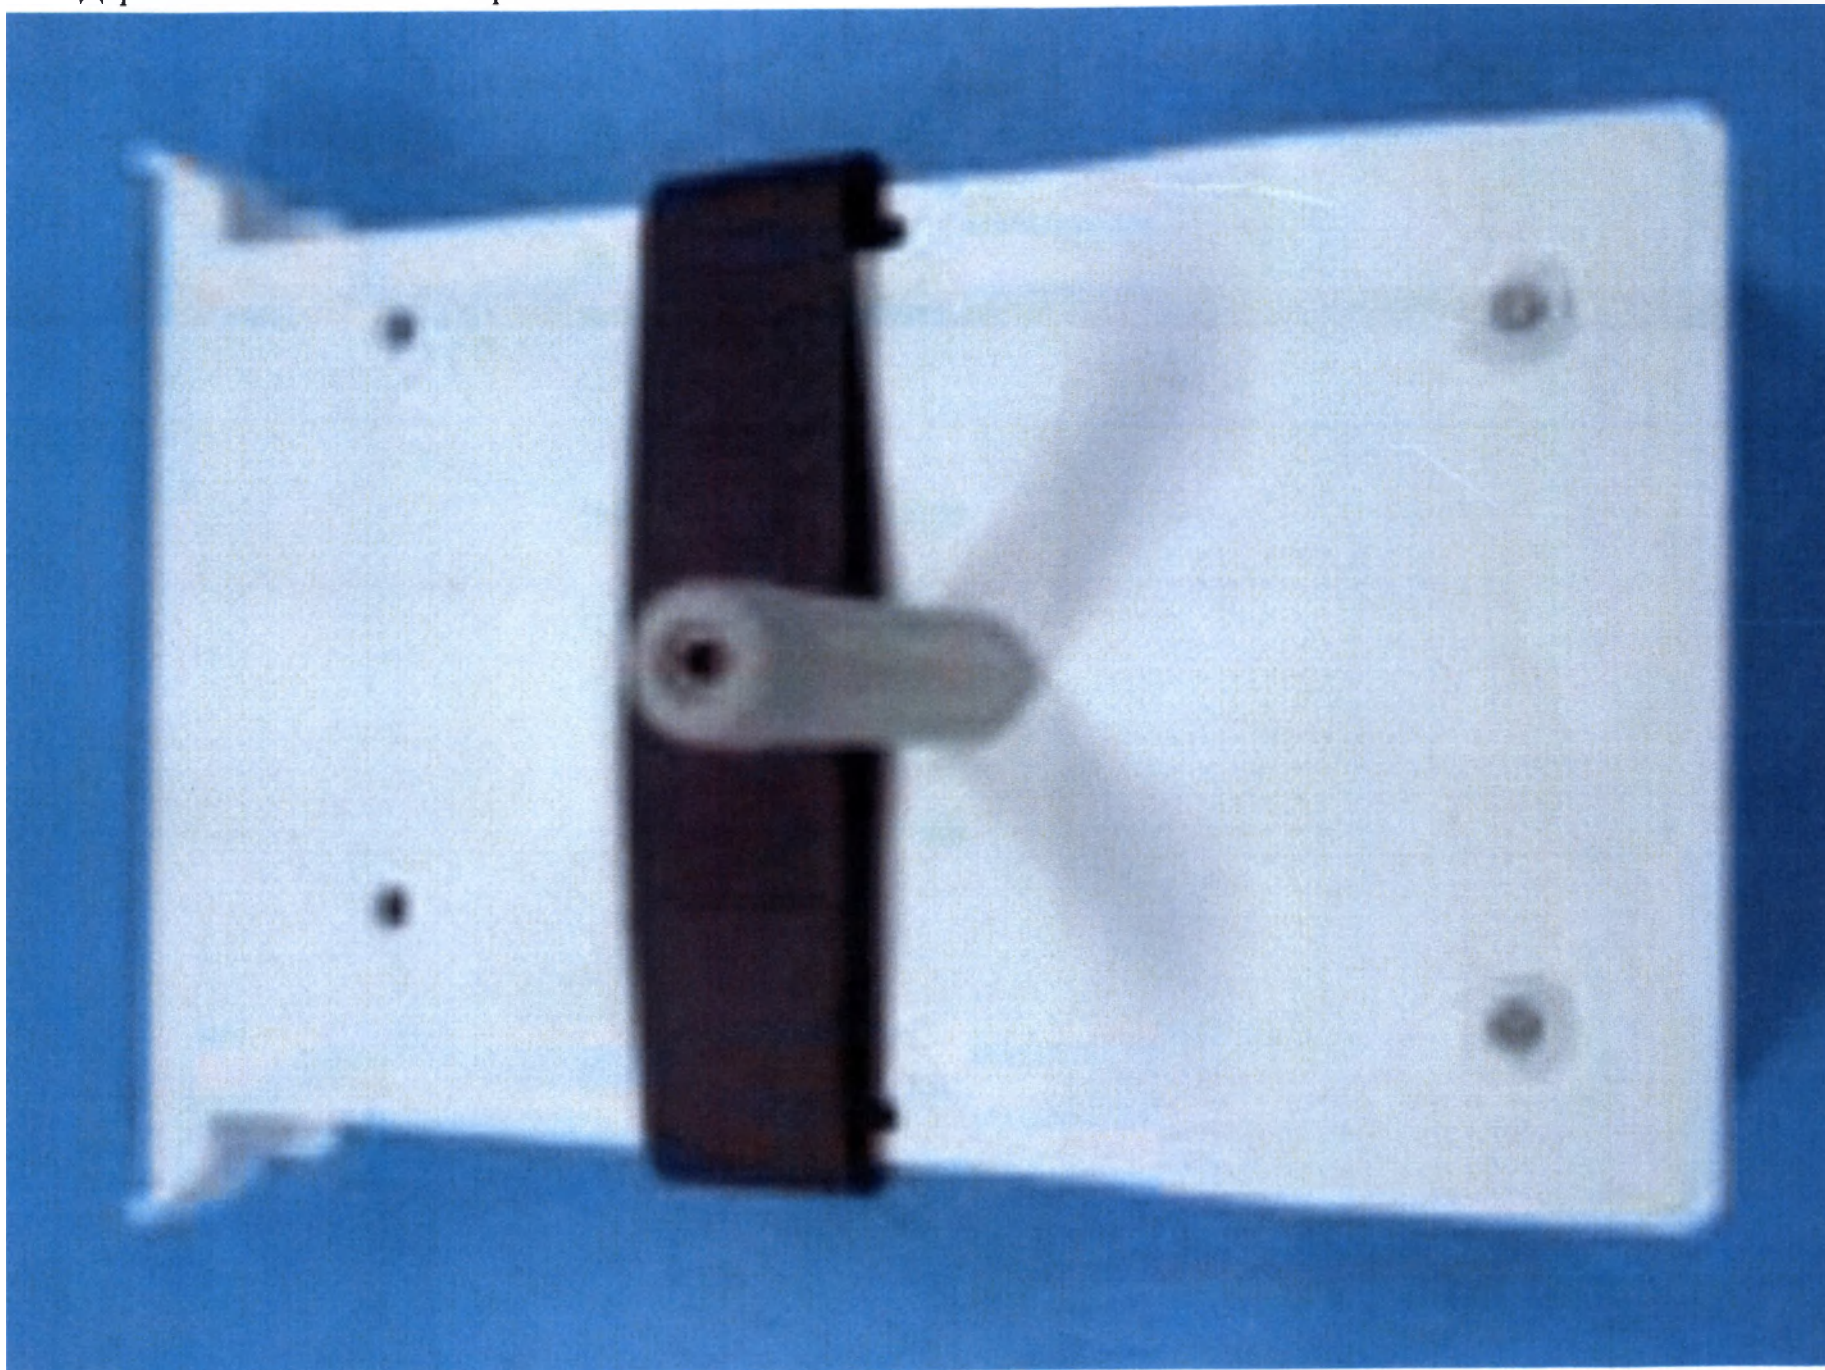



94. Крышка защитная для баллонов.





## 95. Разъем DISS.






## 96. Разъем Euro Aisys Pneu.





97. Разъем для подсоединения баллона кислорода.

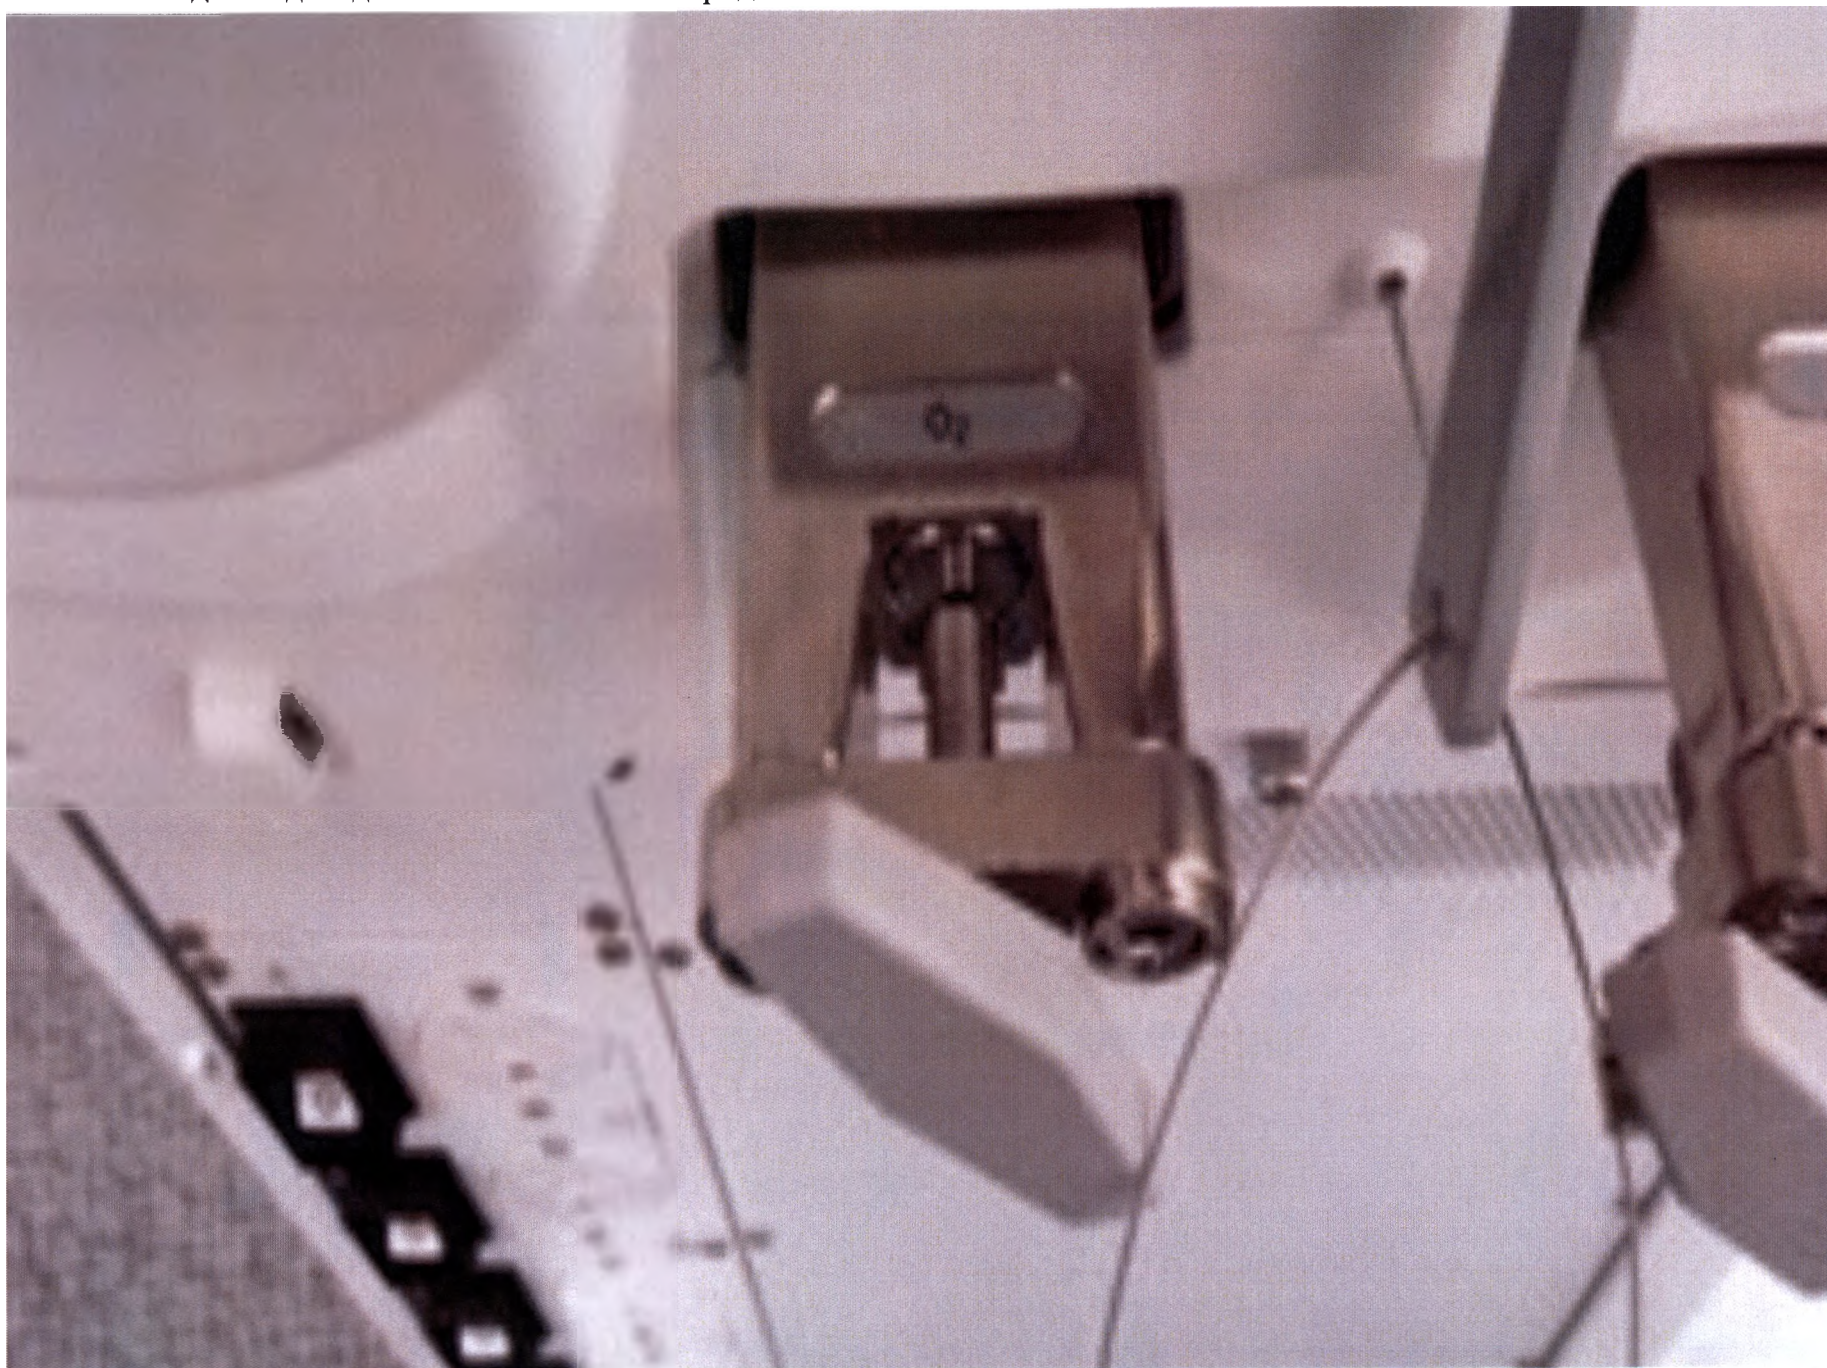



98. Разъем для подсоединения баллона воздуха.





99. Разъем для подсоединения баллона закиси азота.





100. Разъем для подсоединения закиси азота.






101. Выход свежего газа дополнительный.




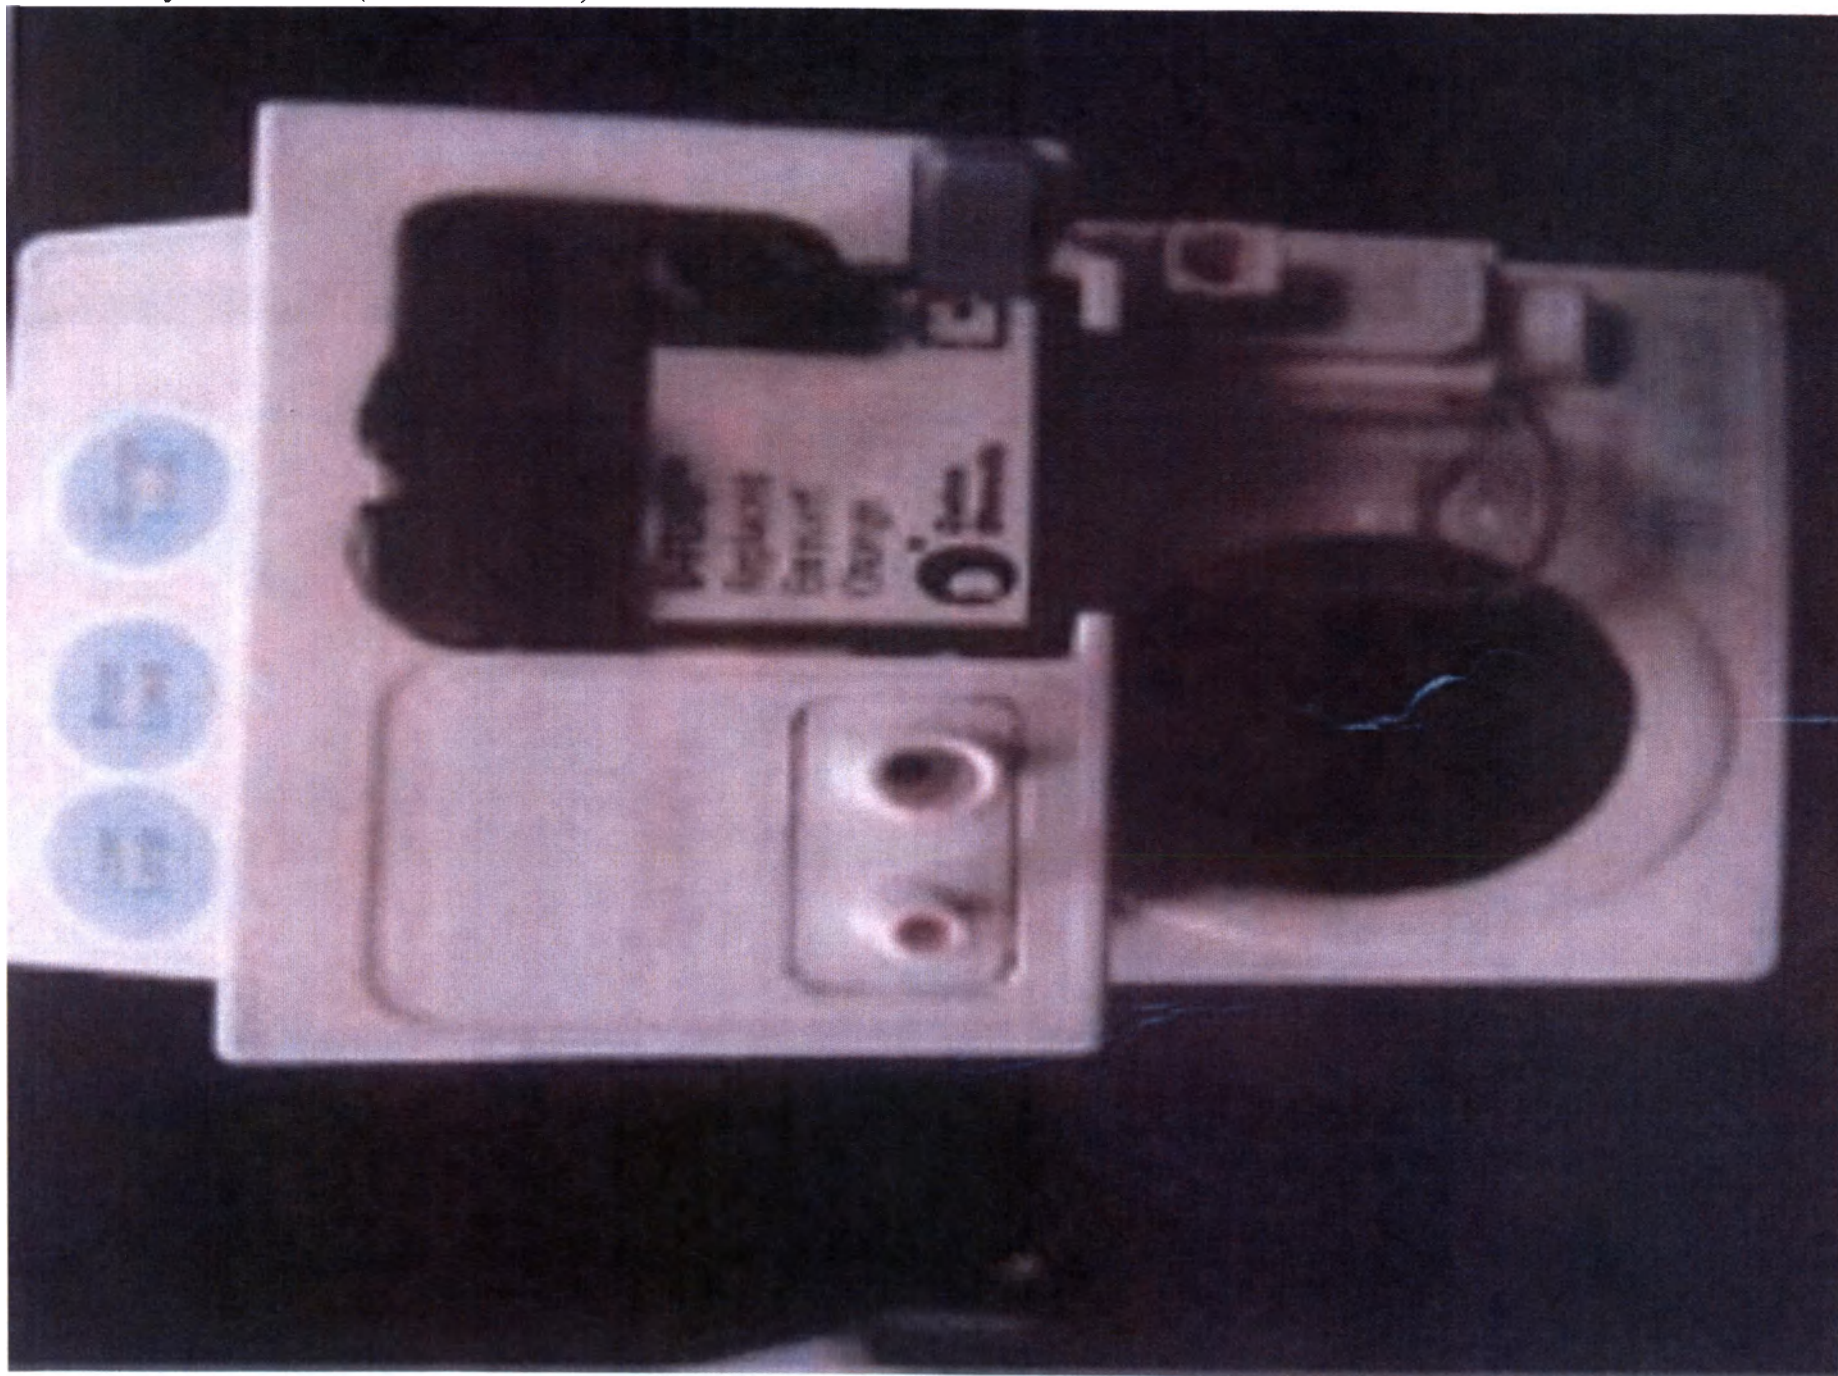

**102. Модули газовые (не более 5 шт.).**




## 103. Заглушка газового модуля.

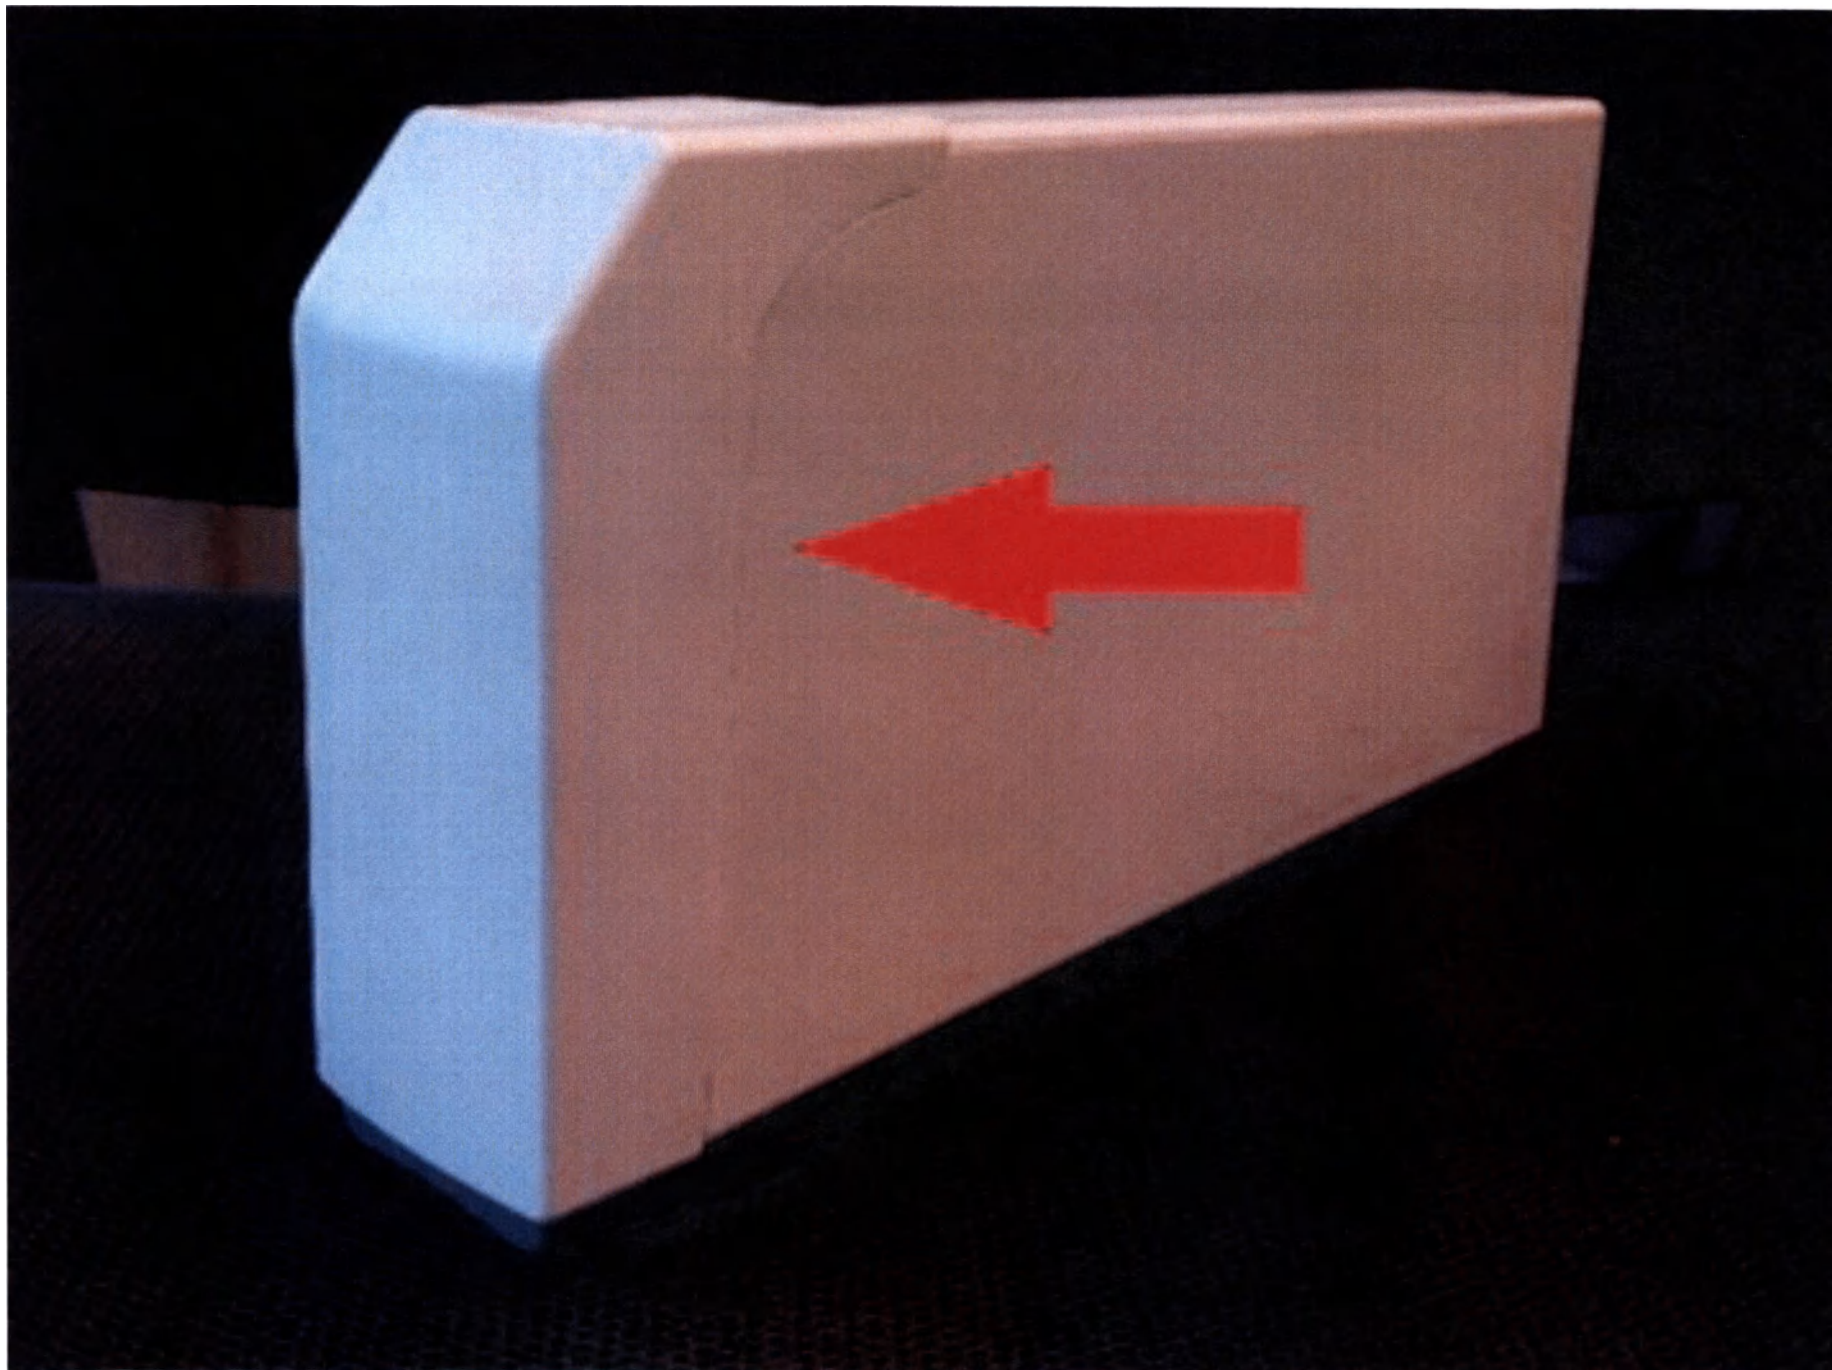




104. Коллектор дыхательный.

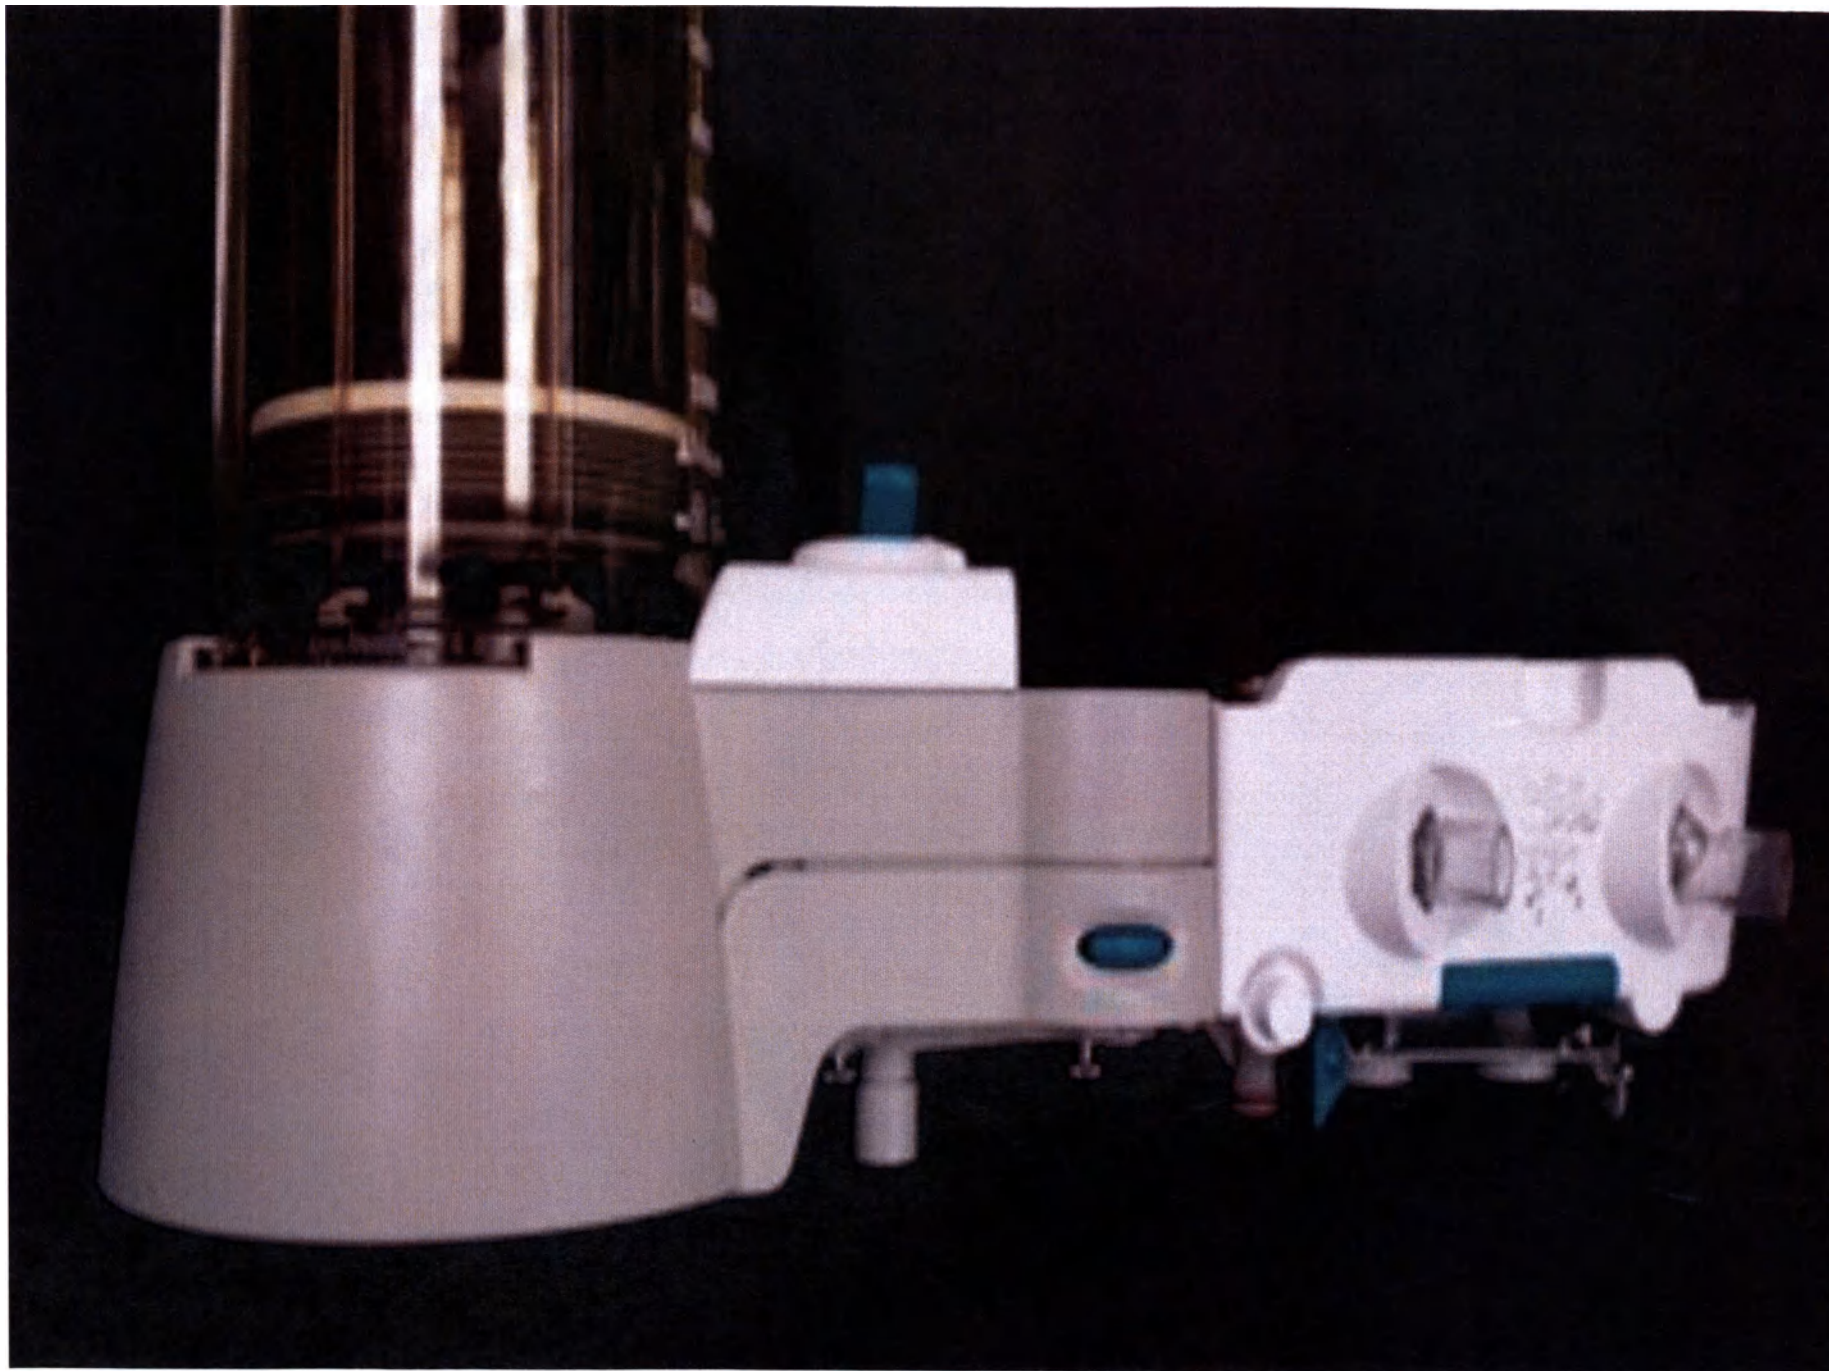



105. Контейнер для конденсата.

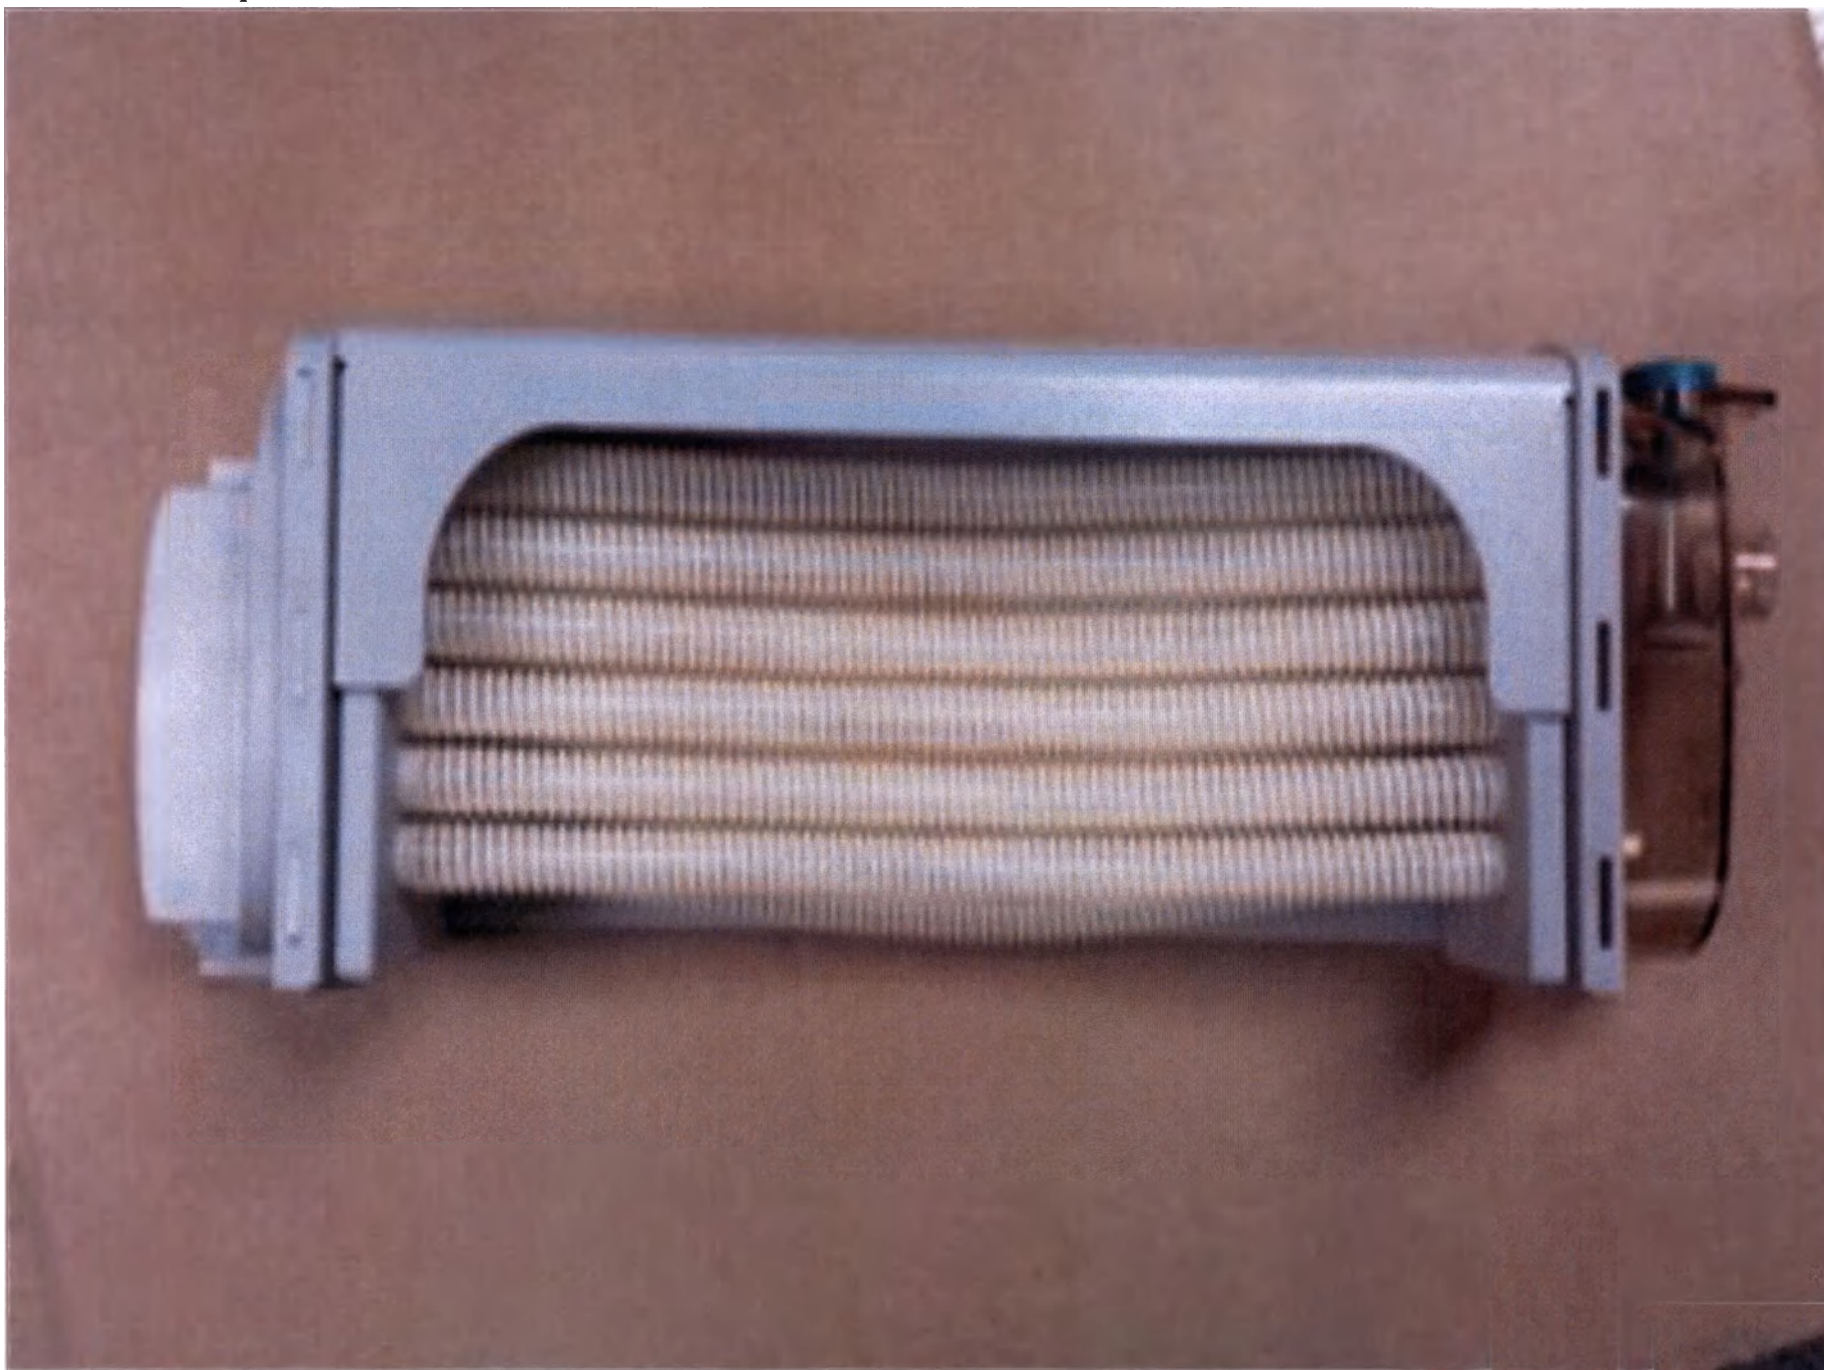




106. Устройство для смены канистры абсорбера EZchange™ с контейнером для конденсата.






107. Устройство для смены канистры EZchange™.

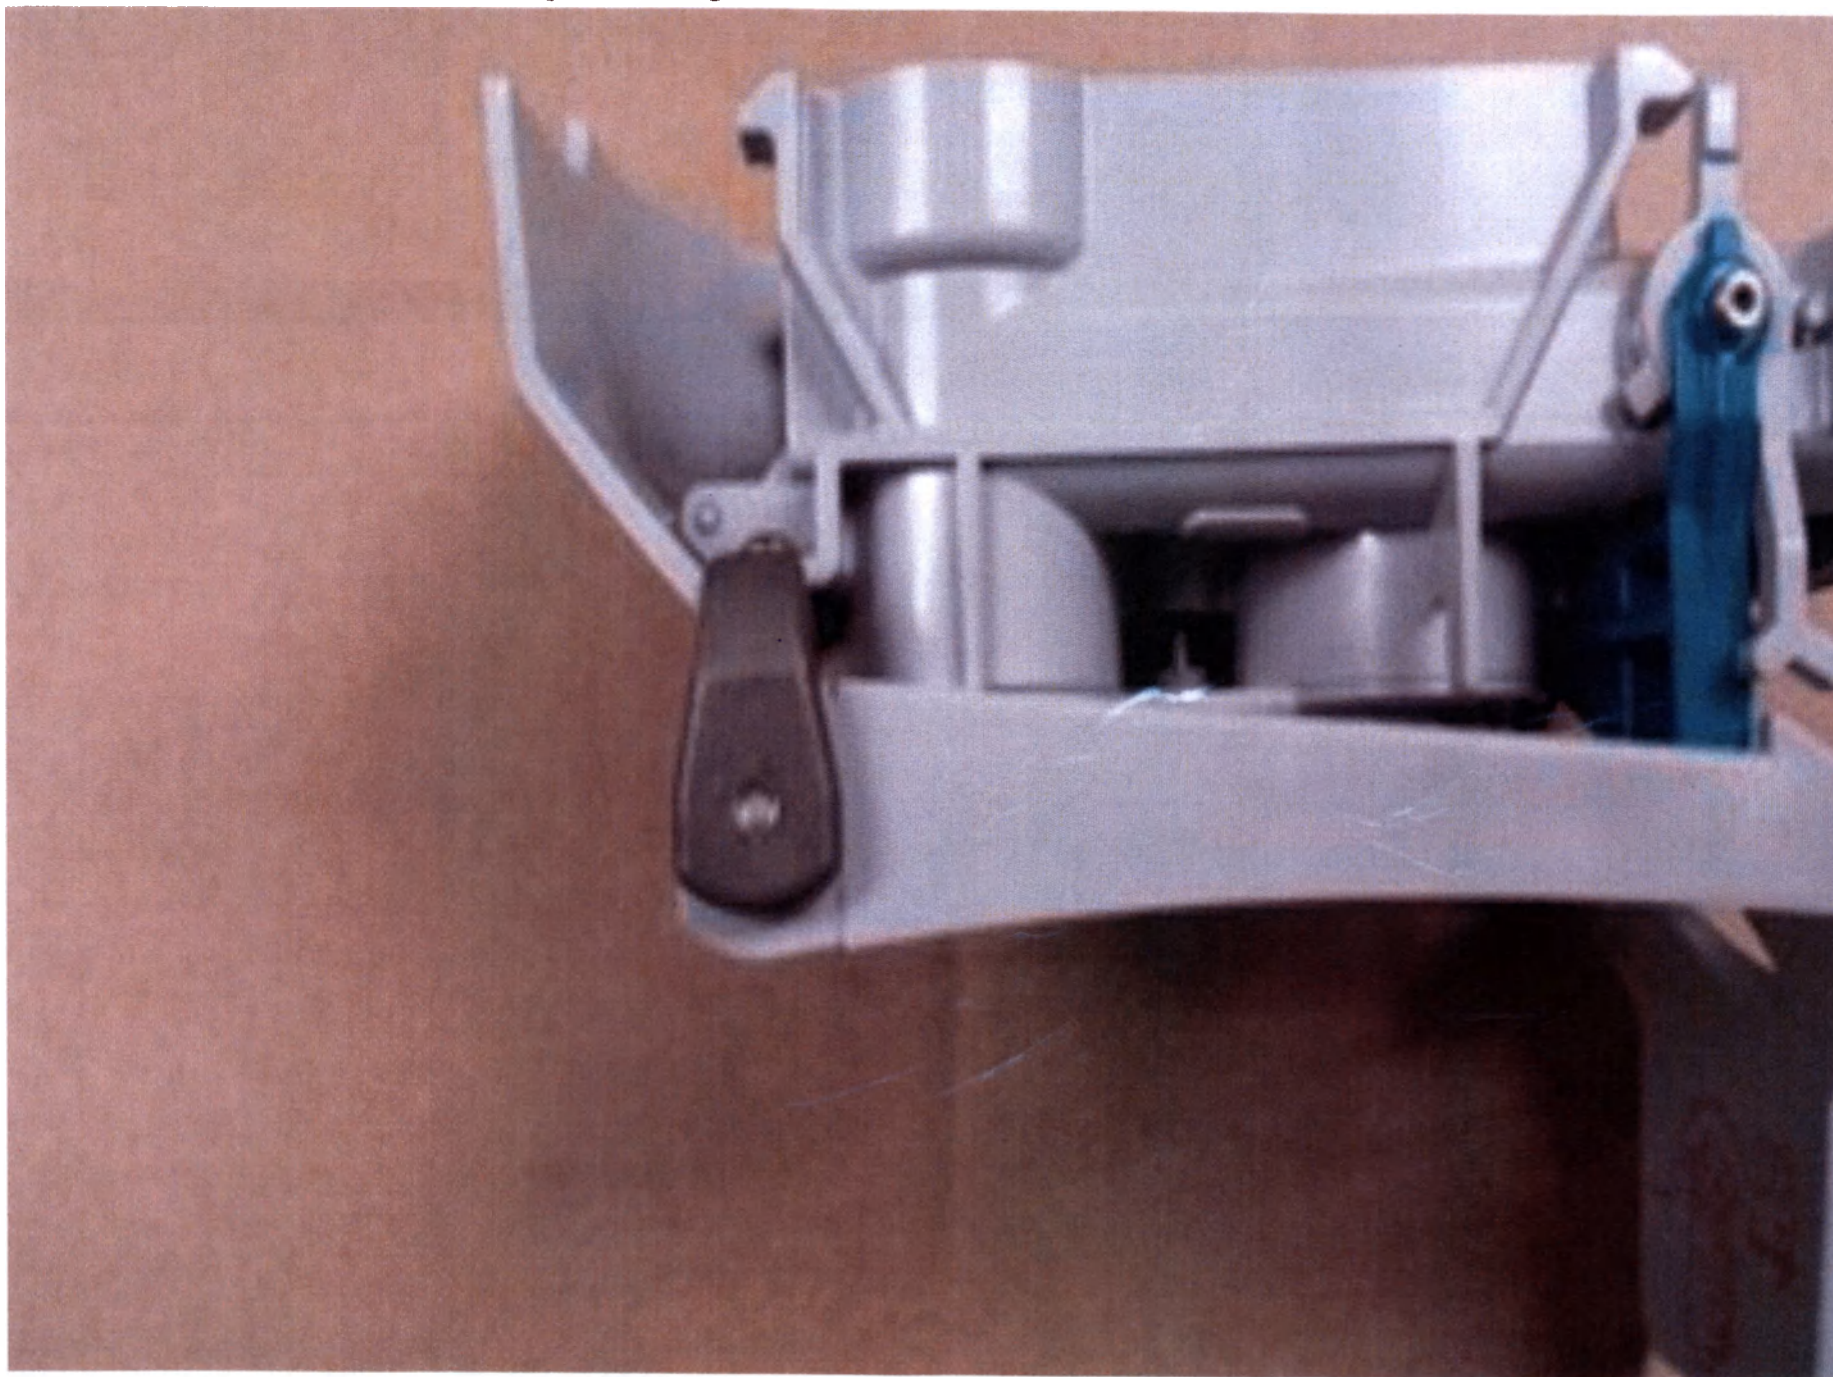



108. Выход для подключения конденсатора.

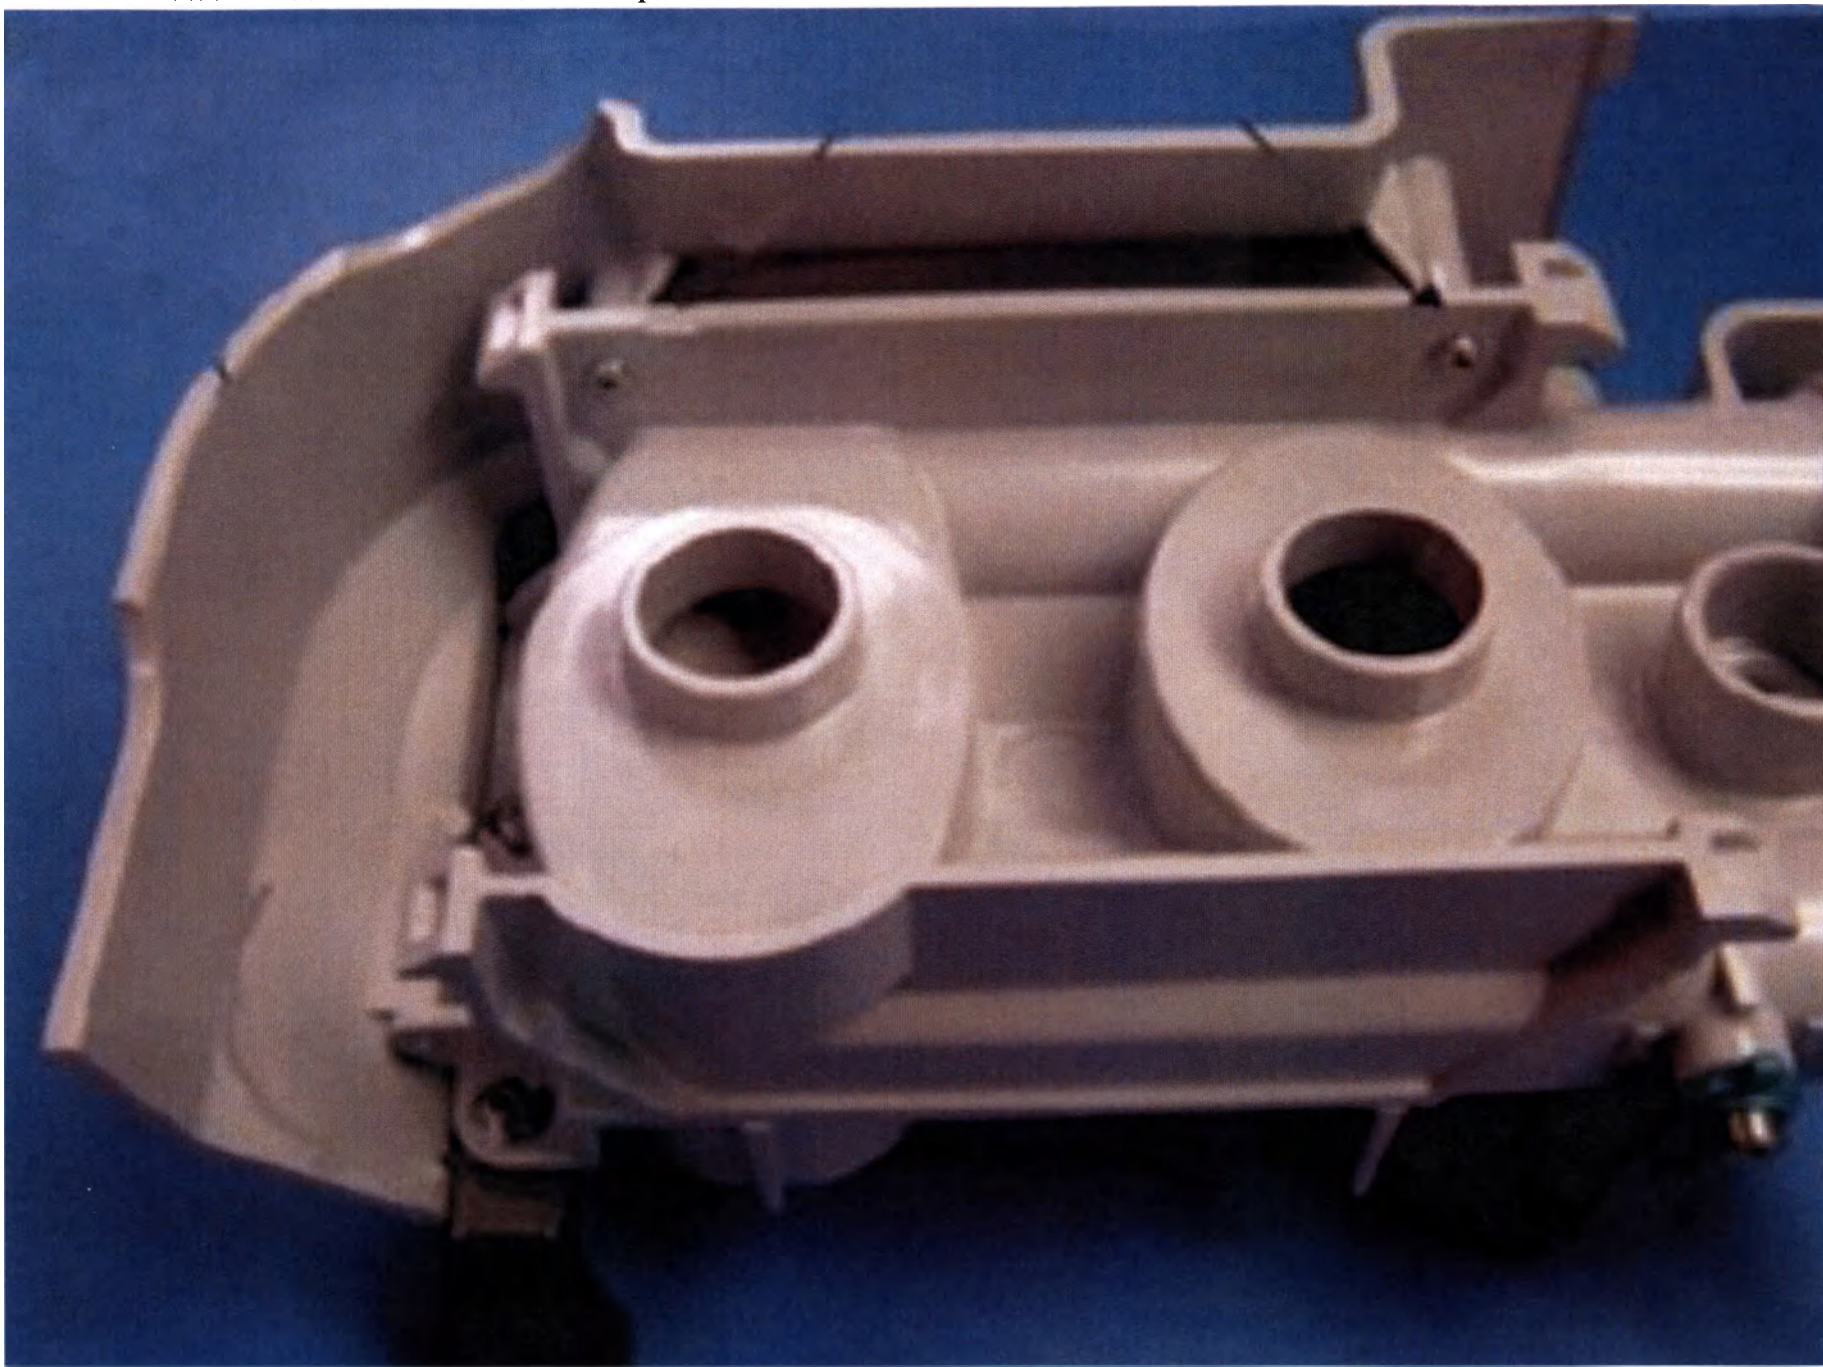




# 109. Защита для конденсатора.





110. Модуль датчиков потока.

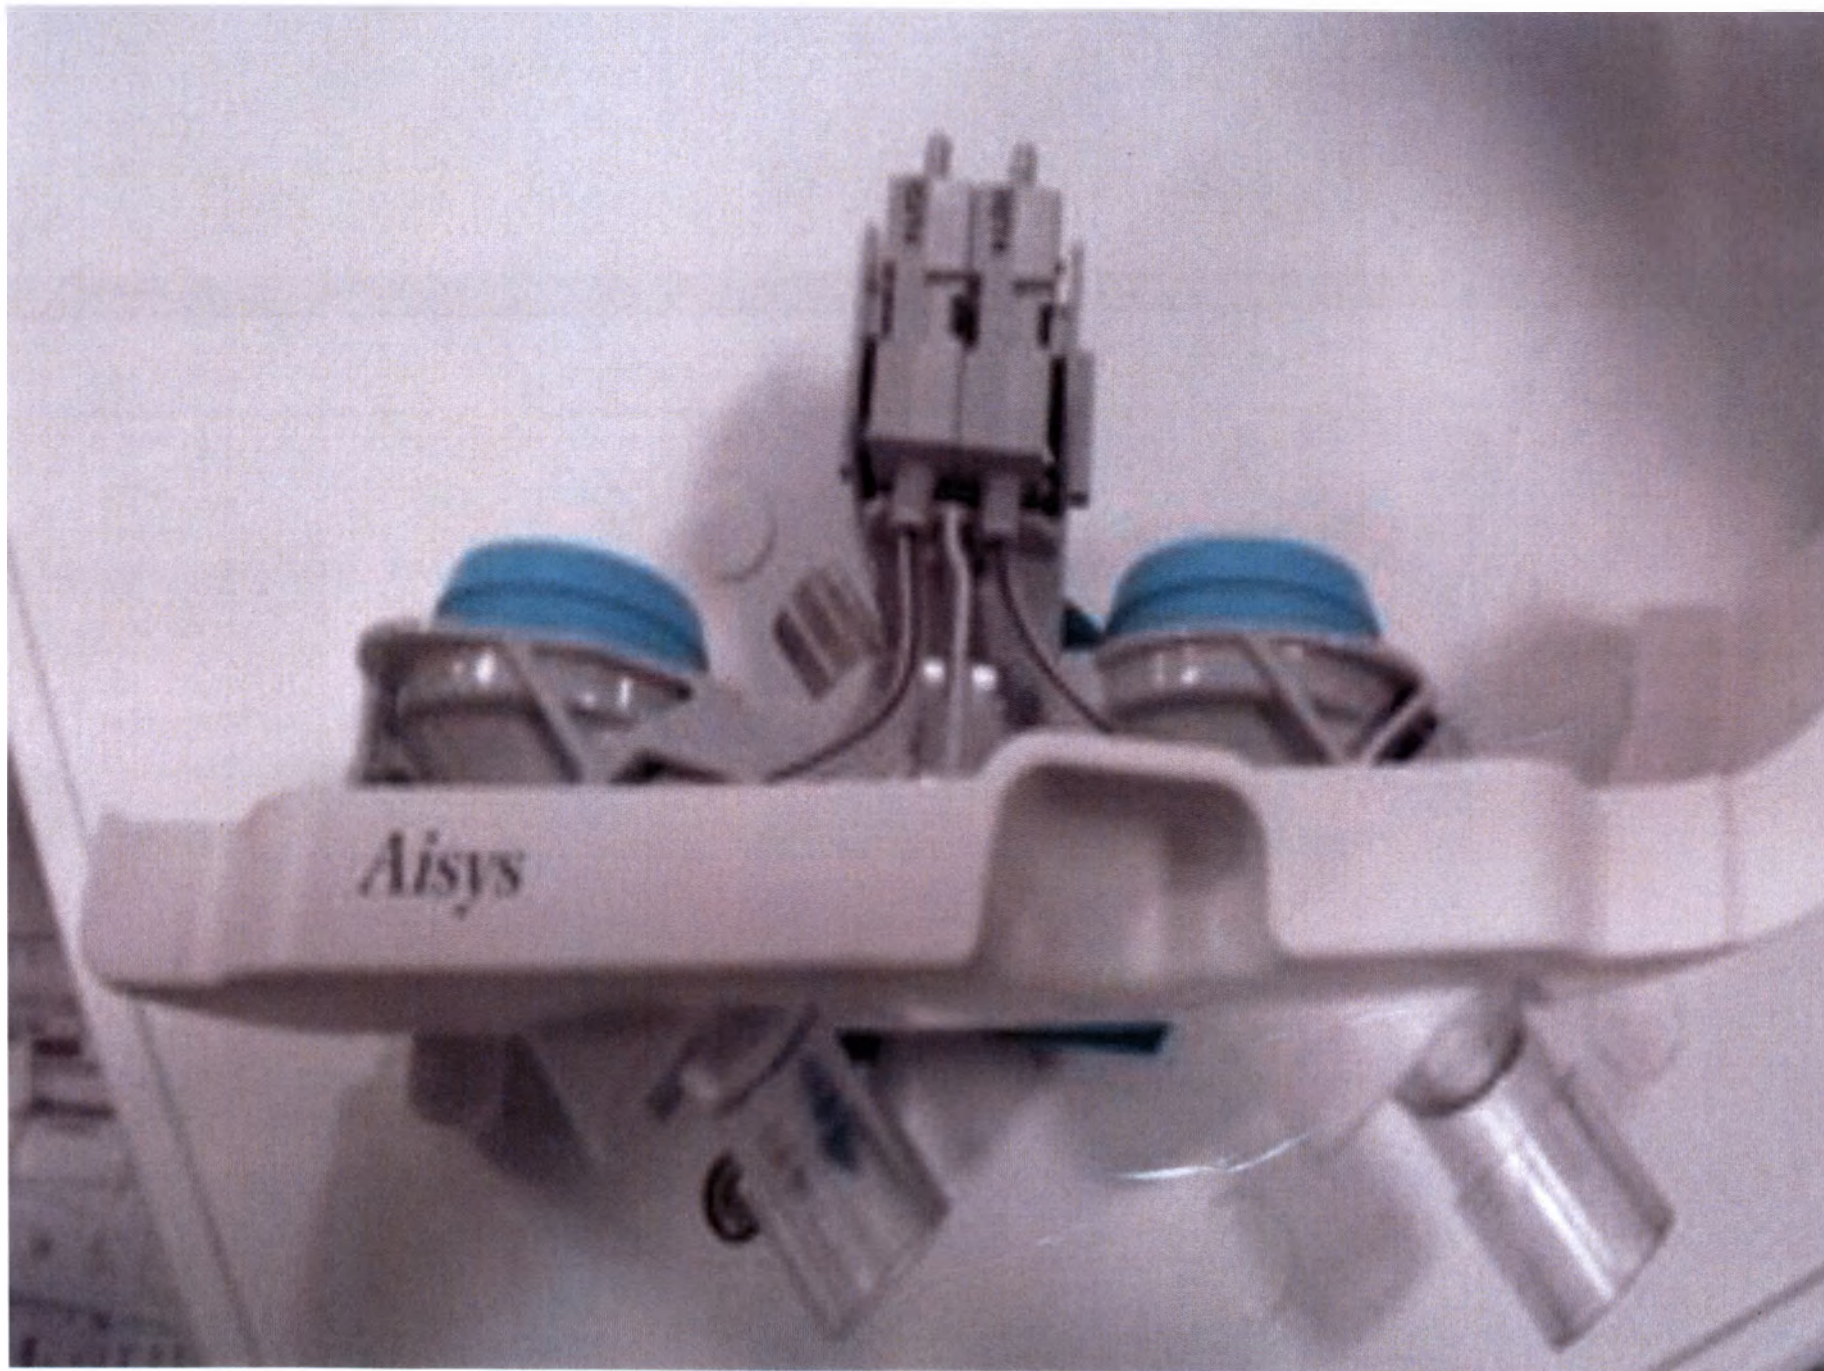



111. Канистры абсорбера, многоразовые (не более 10 шт.).





112. Канистры абсорбера одноразовые (не более 300 шт.).






113. Абсорбент Medisorb Quick-fil (не более 300 шт.).





114. Вставки для абсорбера поролоновые (не более 300 шт.).

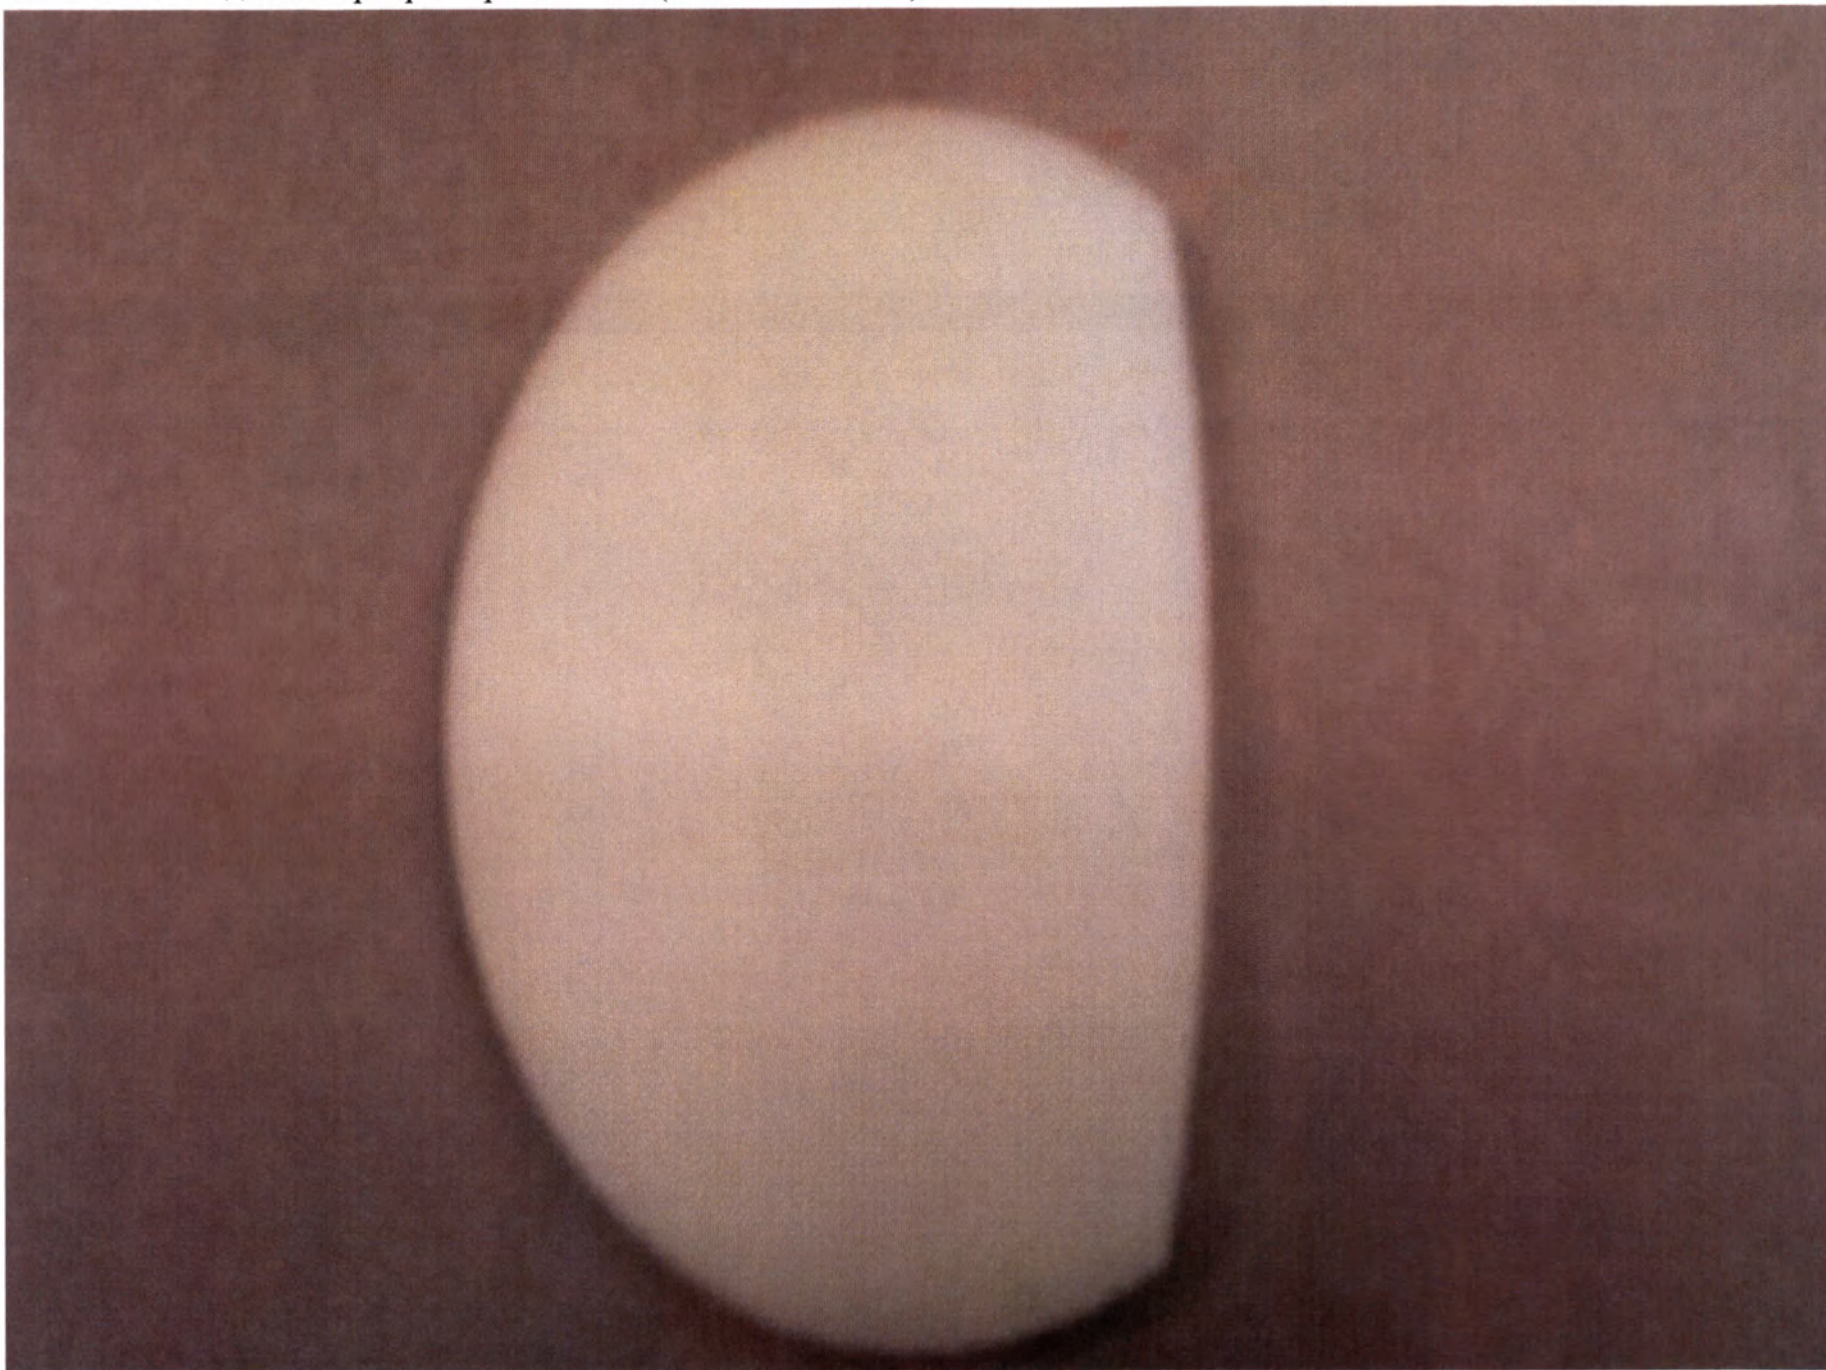




115. Датчик кислорода (не более 10 шт.).





116. Заглушка для разъема подключения датчика потока.

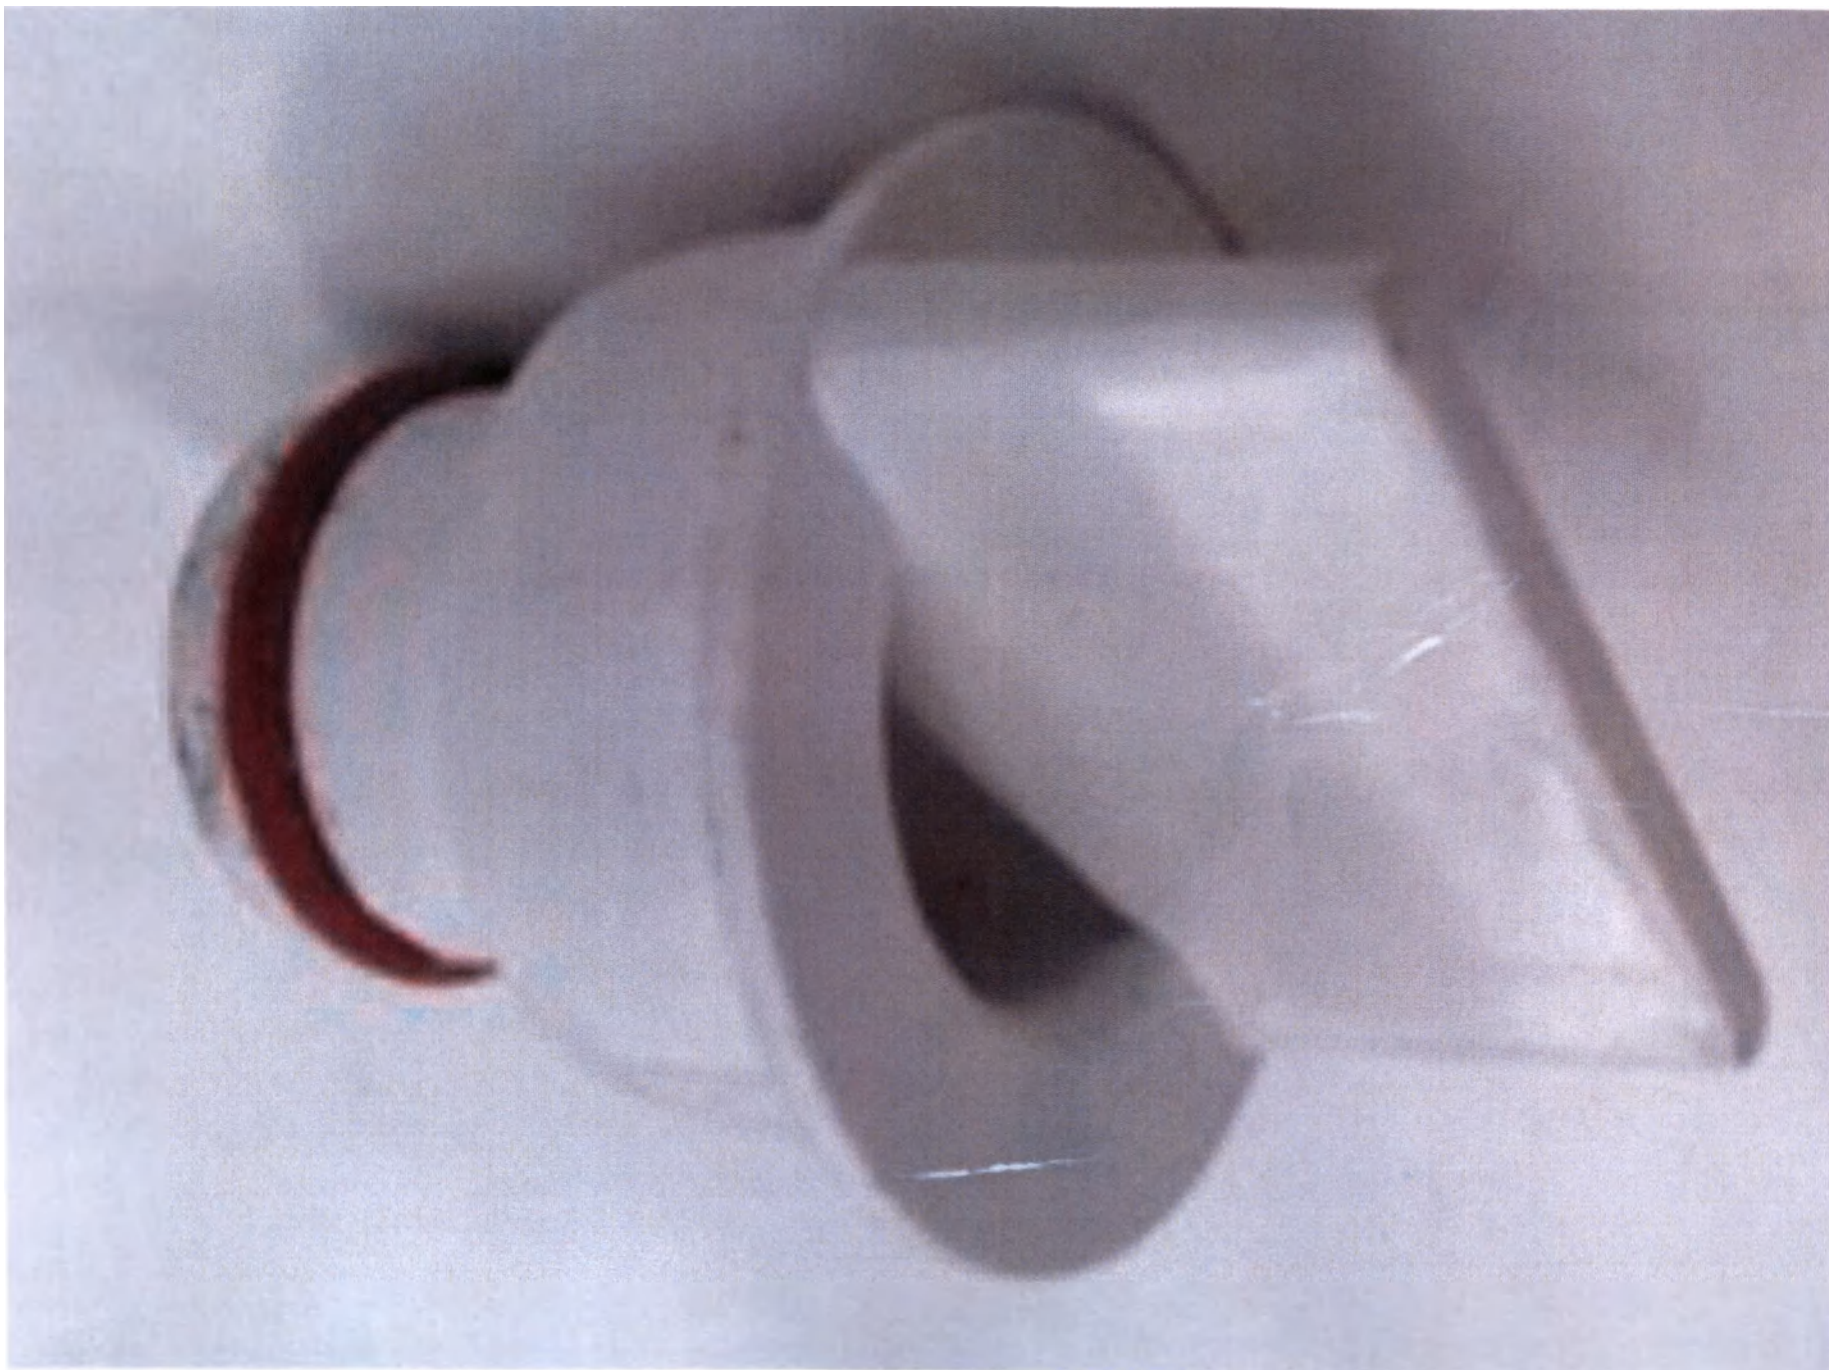




117. Кабель для подсоединения датчика кислорода (не более 10 шт.).





118. Датчик потока улучшенной конфигурации.

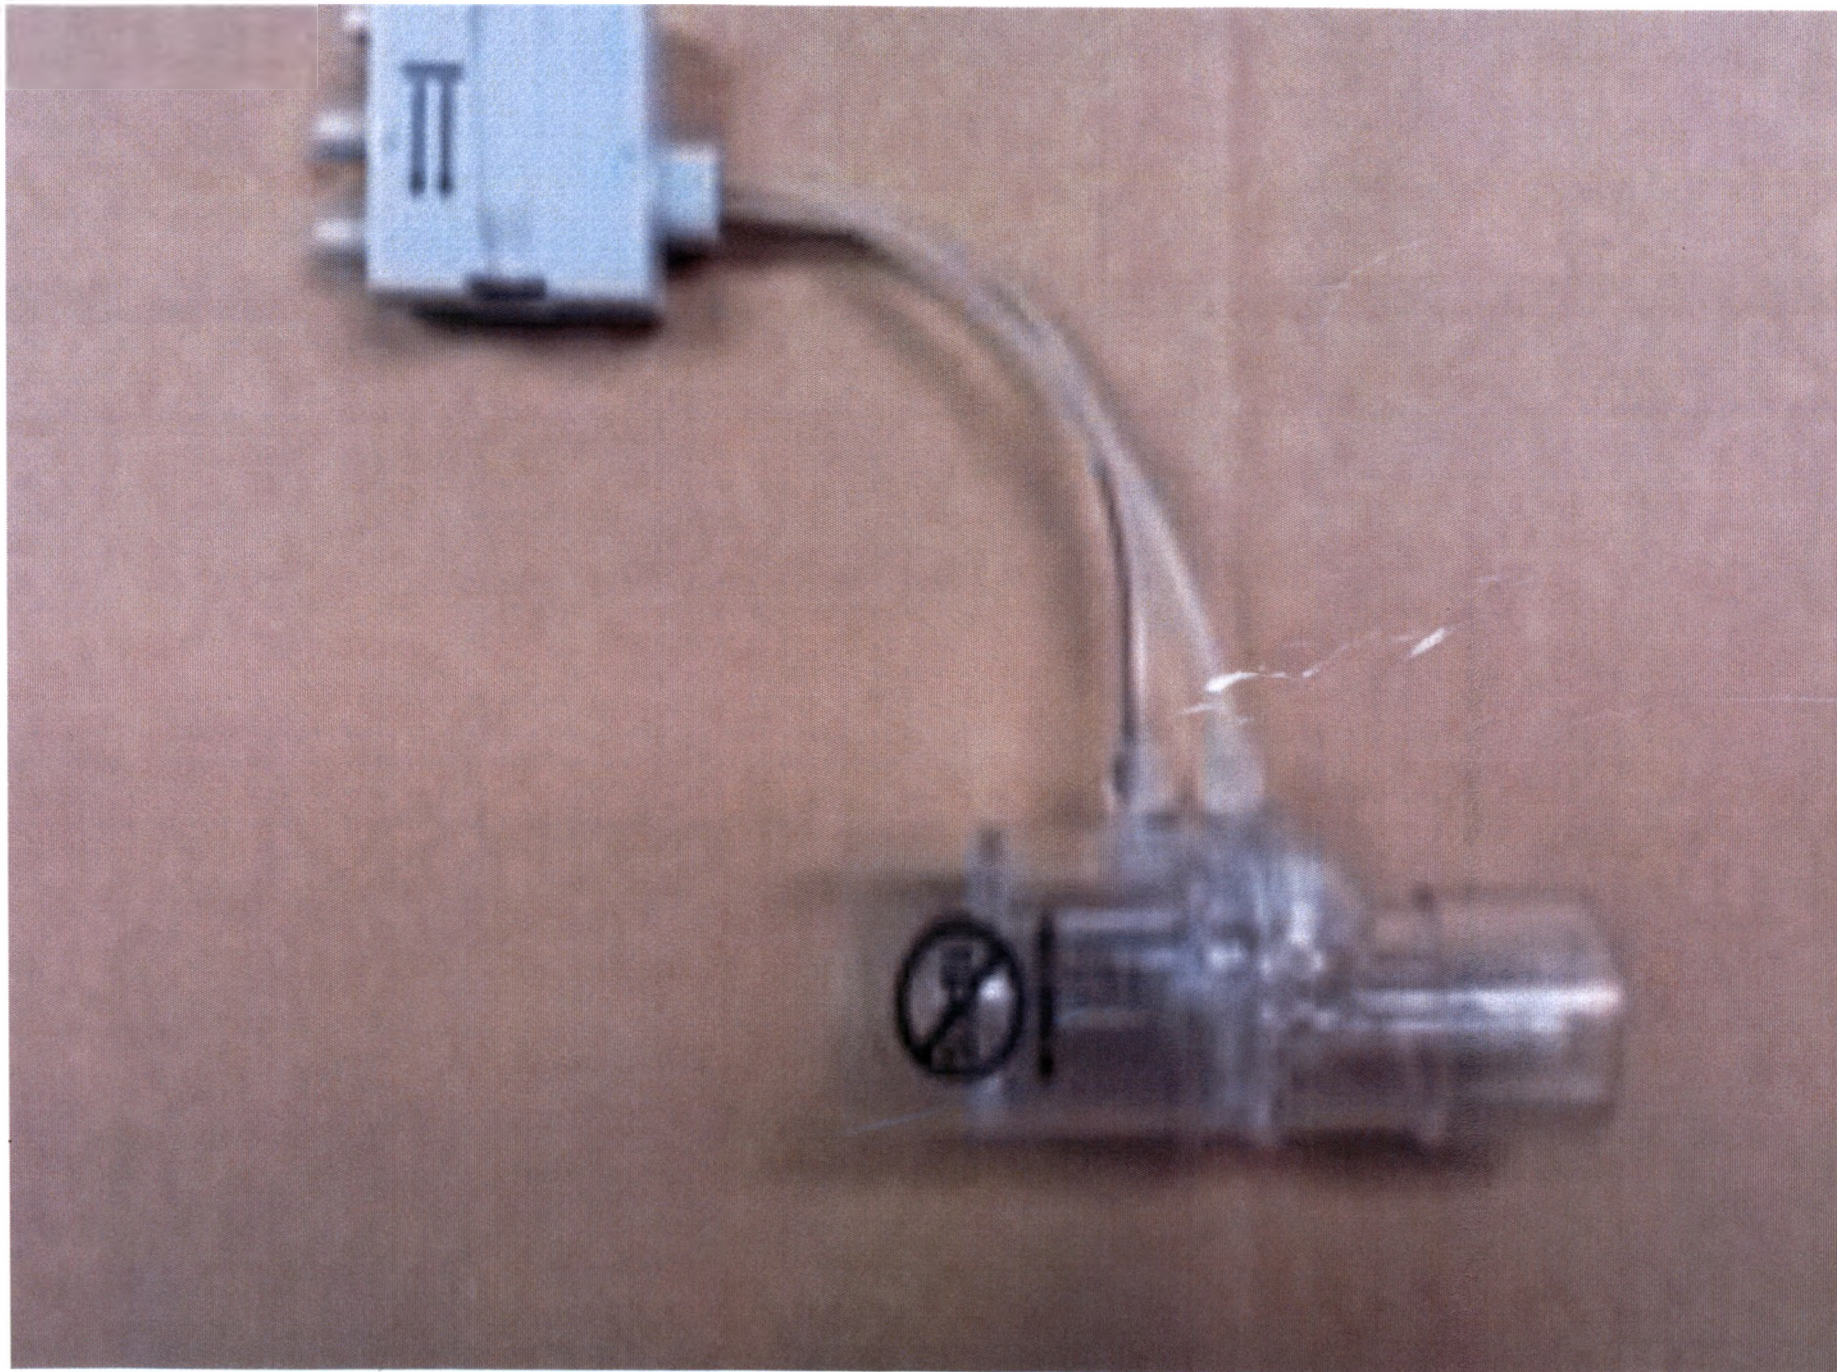




119. Датчик потока многоразовый (не более 10 шт.).





120. Датчик потока одноразовый (не более 300 шт.).

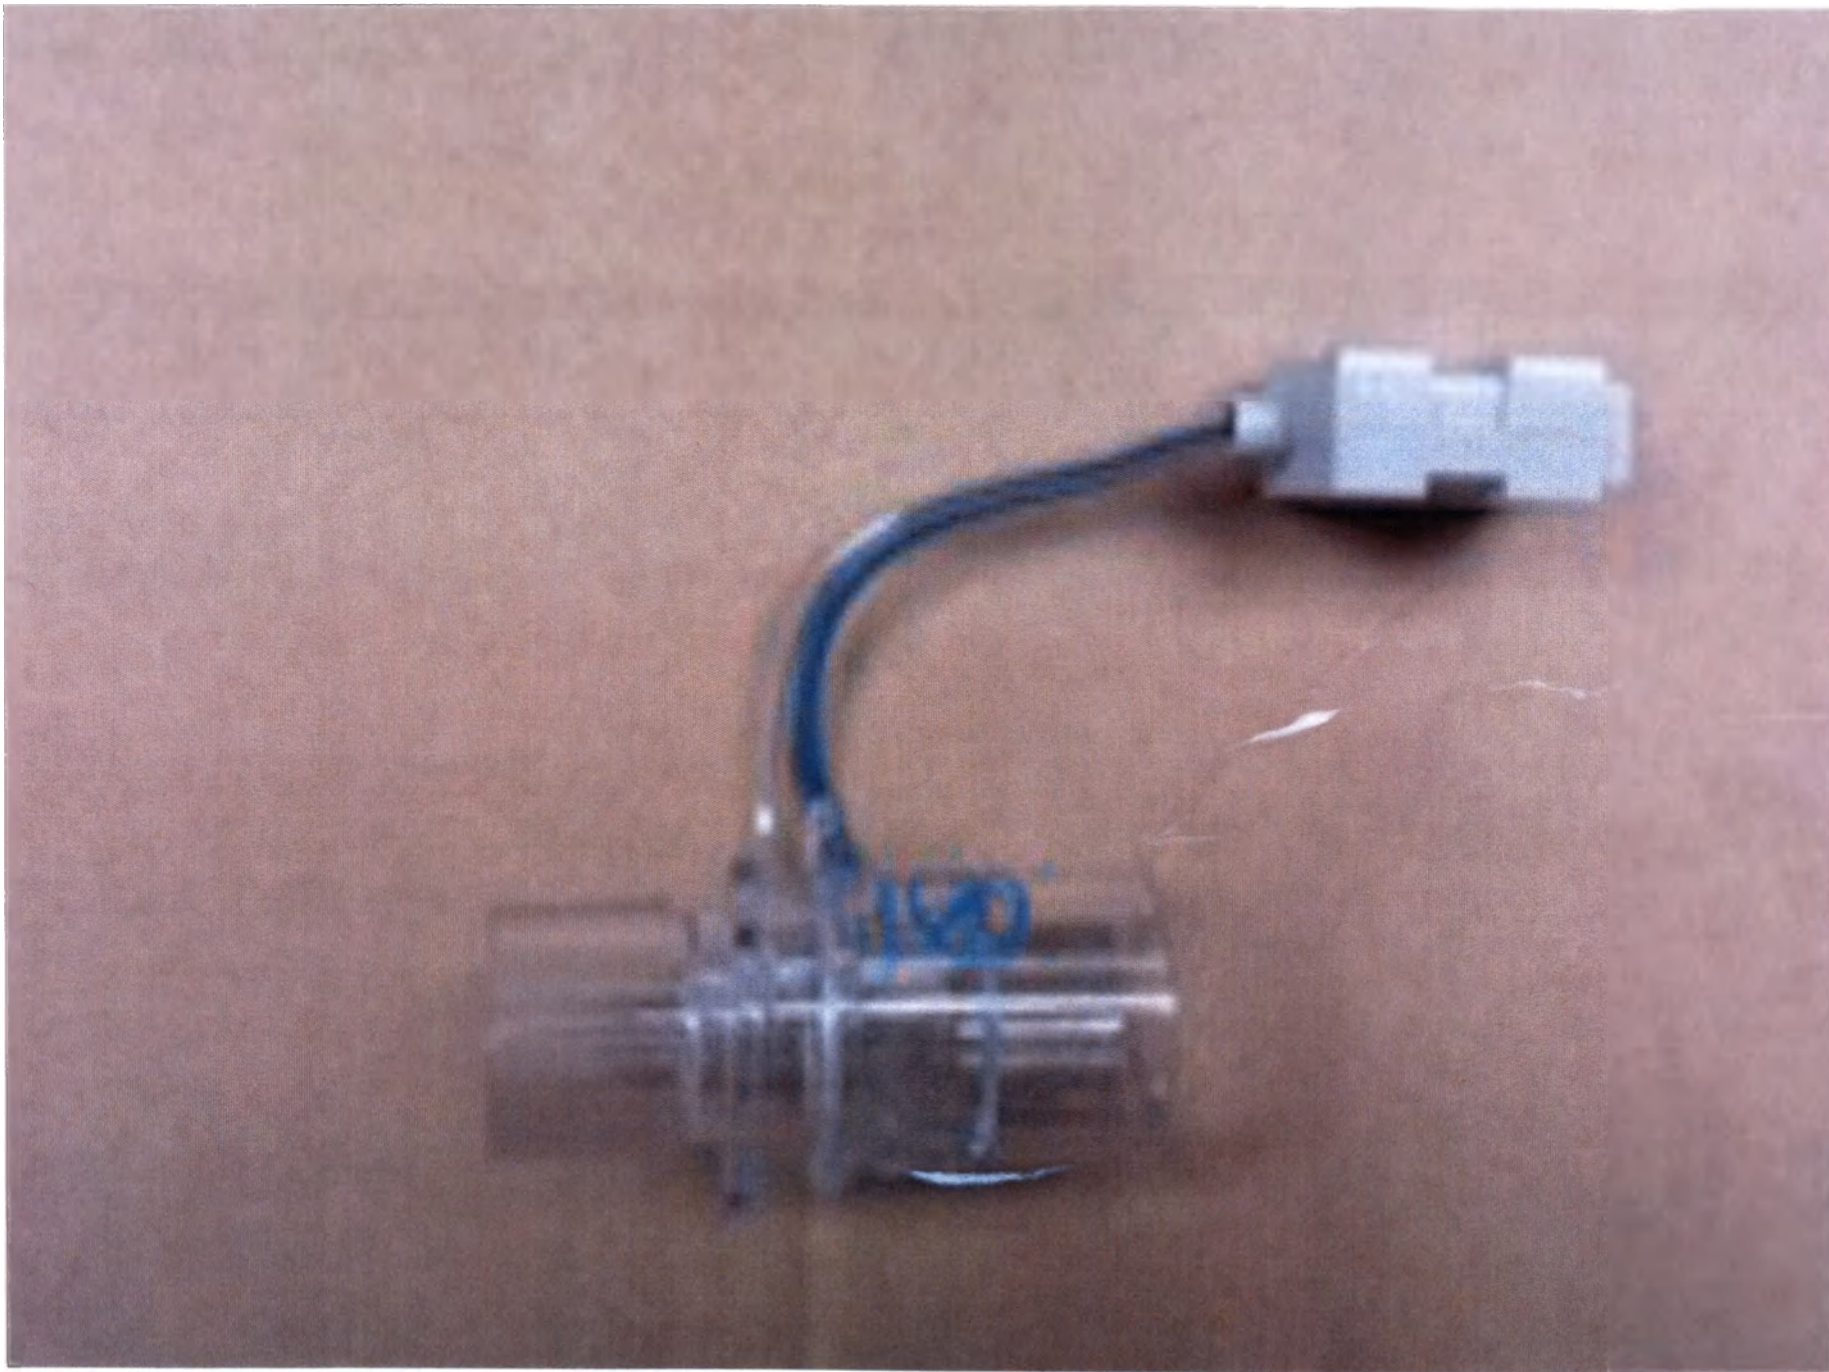



121. Испаритель для энфлюрана.





122. Испаритель для изофлюрана.





122. Испаритель для изофлюорана.





123. Испаритель для севофлорана.






123. Испаритель для севофлюрана.






124. Набор для чистки датчиков потока, в составе: - устройство для чистки датчиков потока; .- трубка для чистки датчиков потока.

135

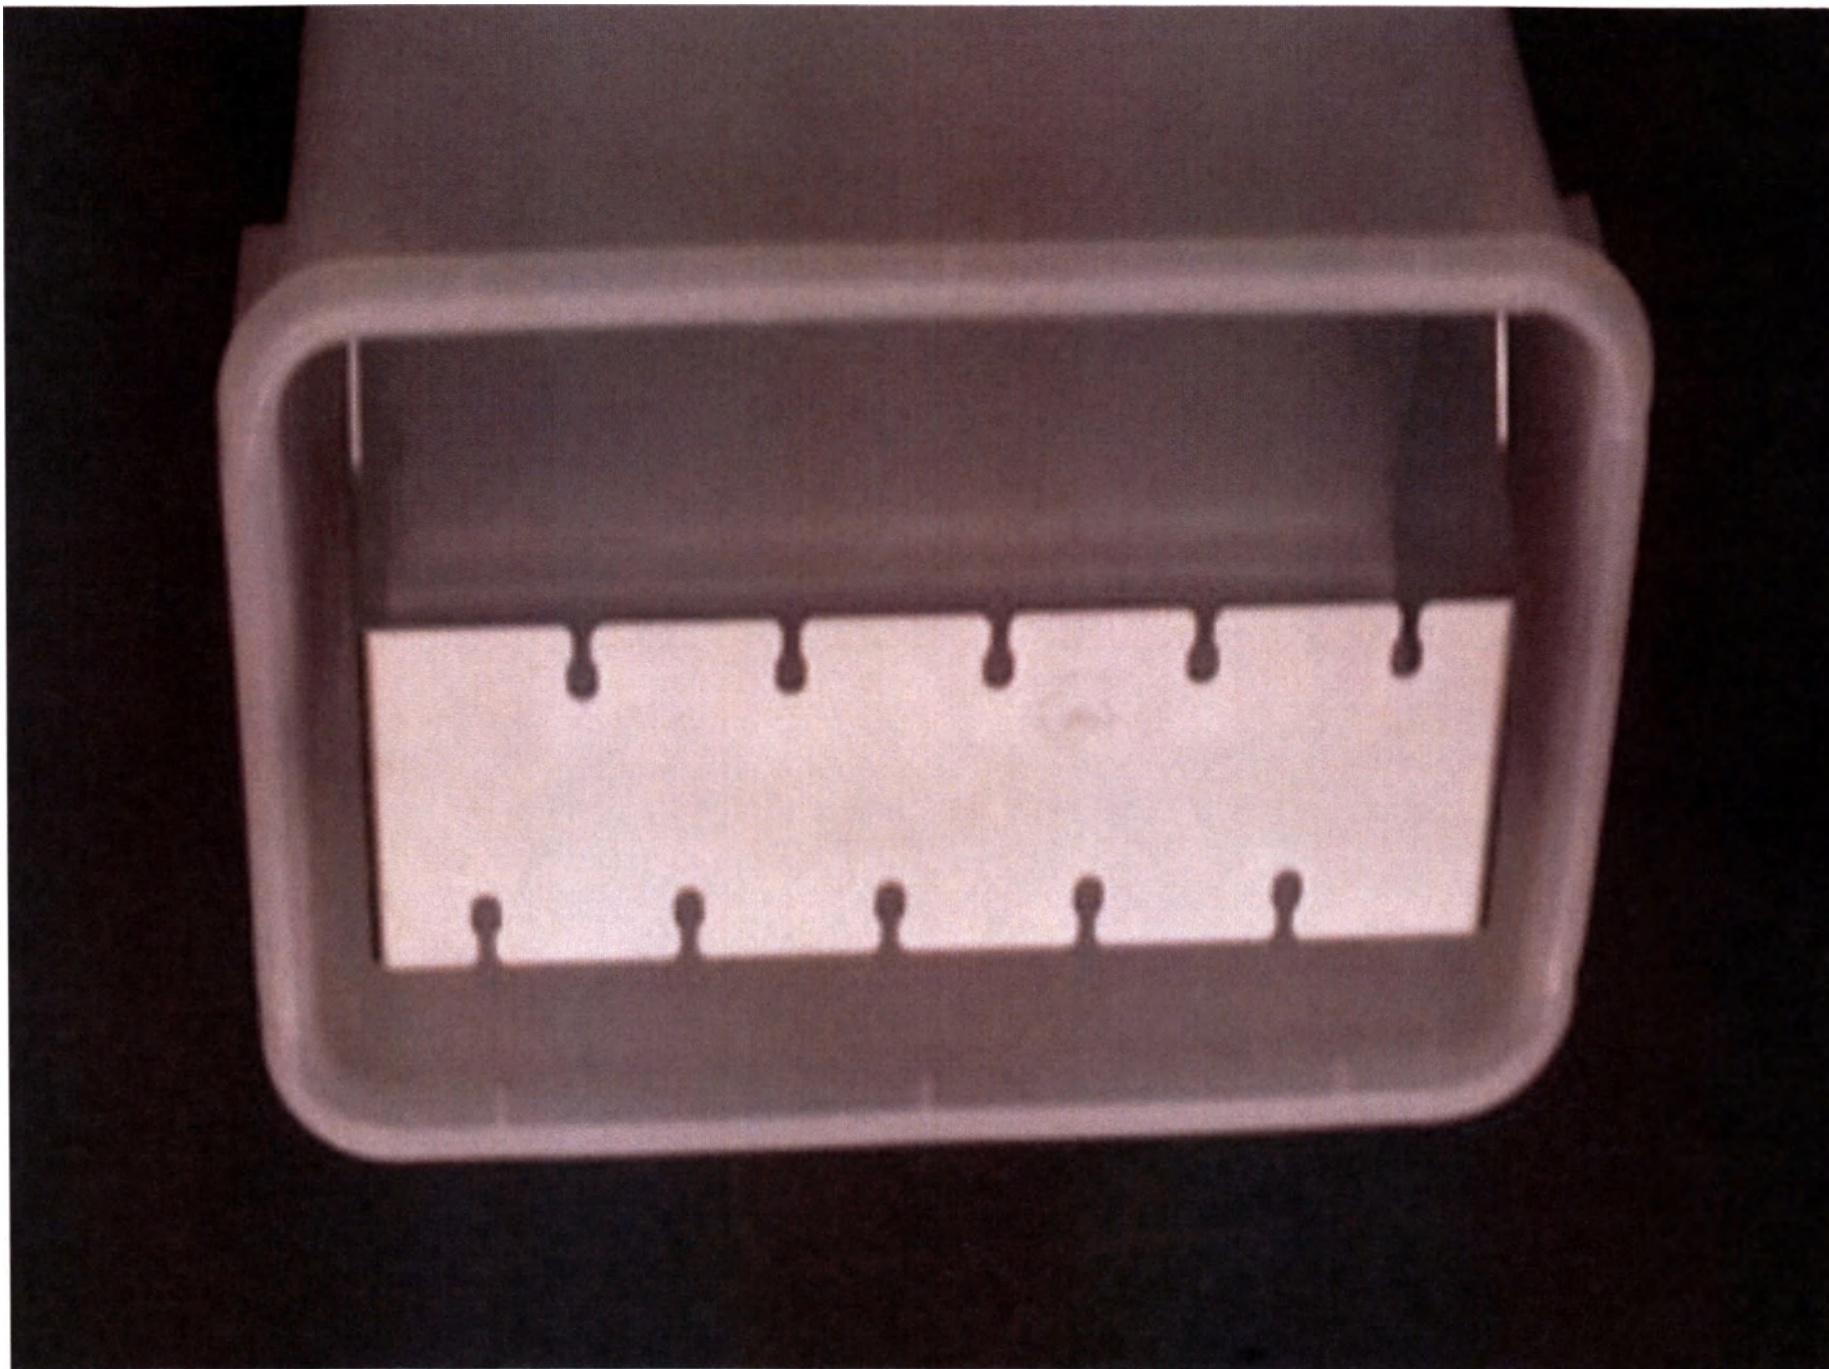



125. Устройство для чистки датчиков потока.

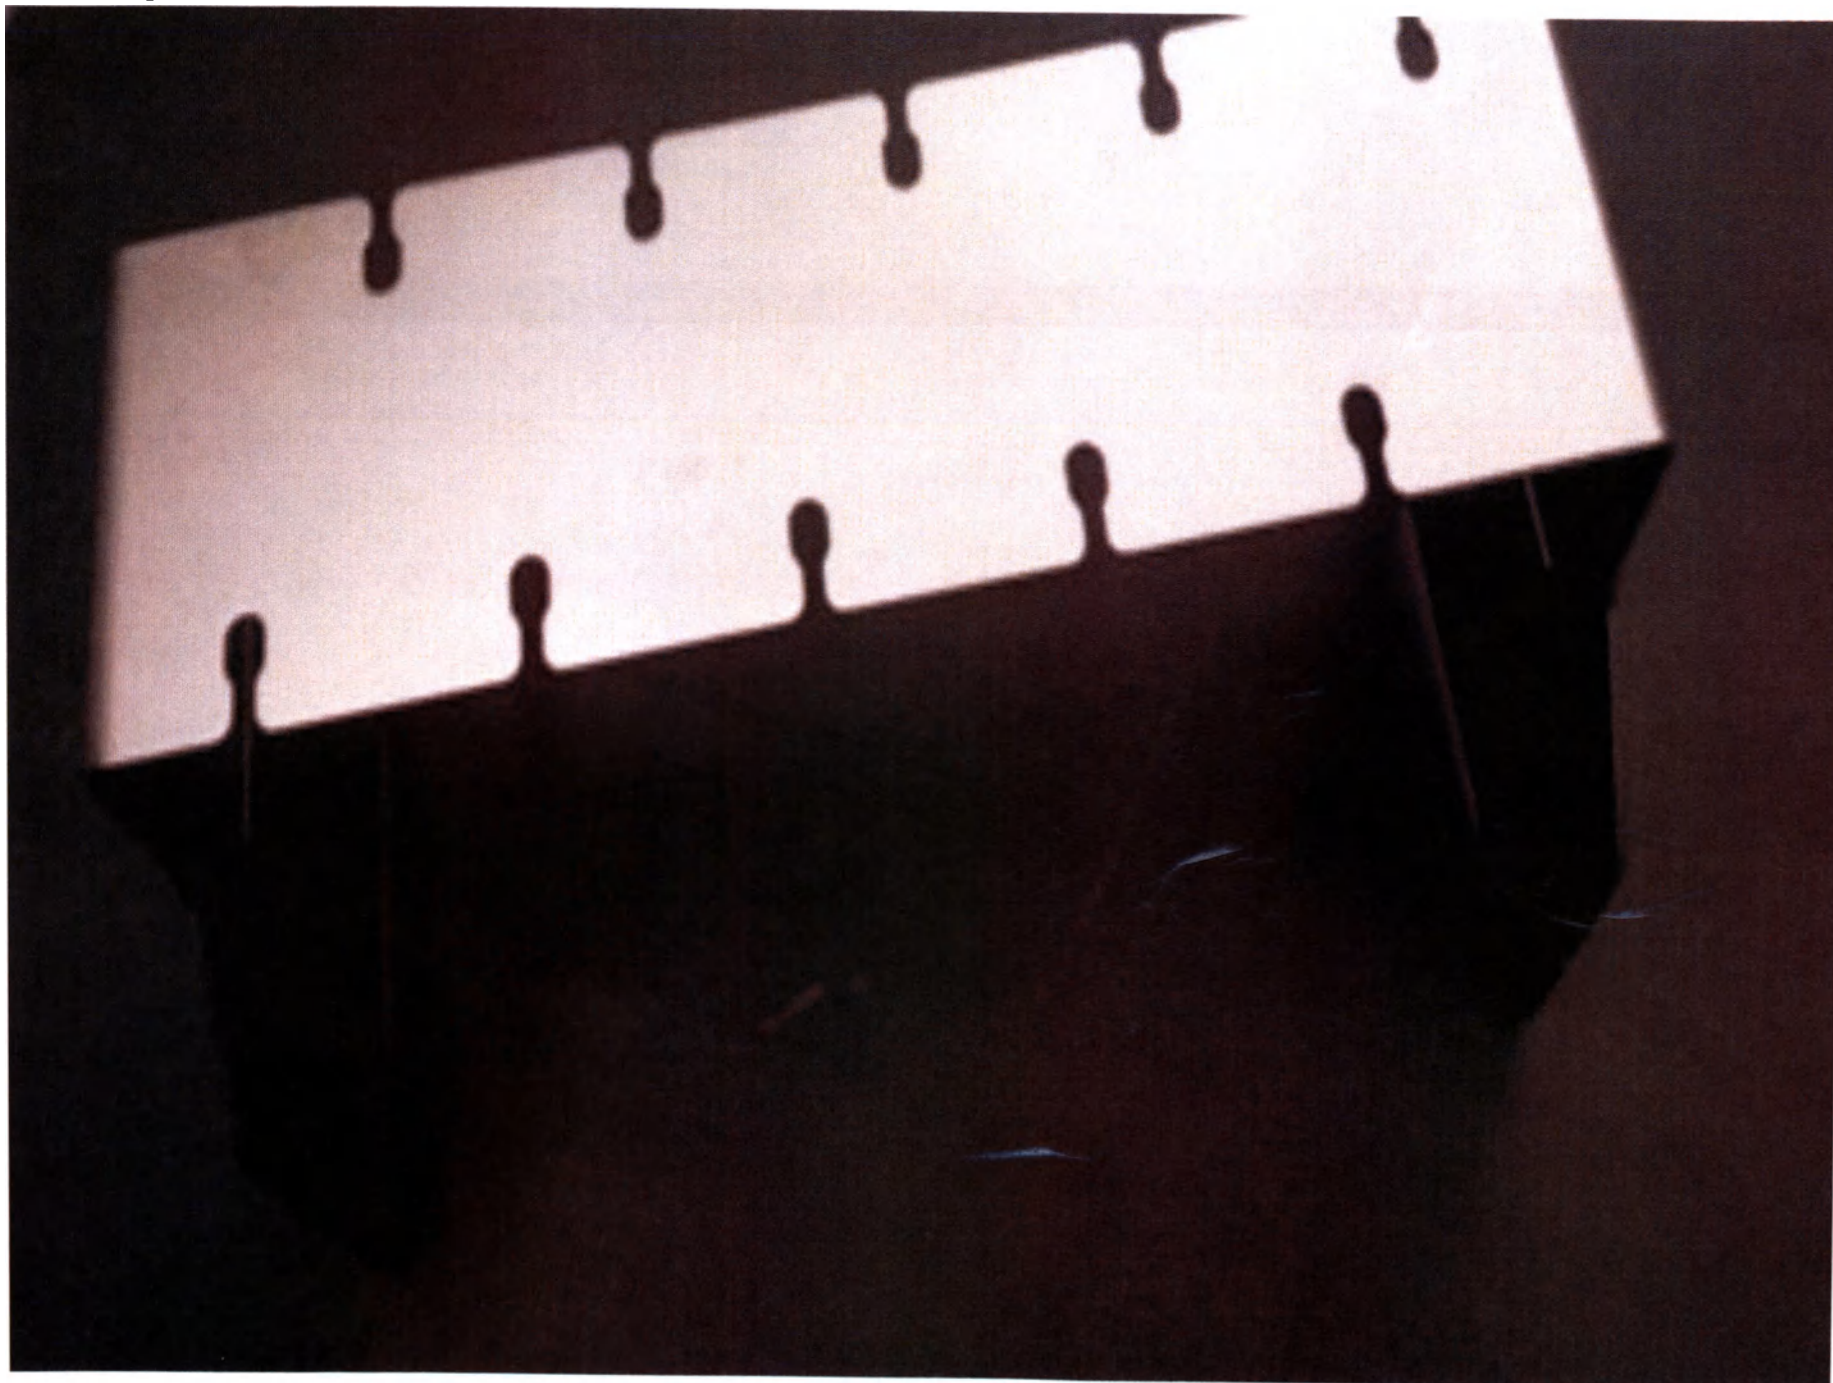




126. Контейнер для чистки датчиков потока пластиковый.






127. Испаритель для севофлюрана Quik-fil.

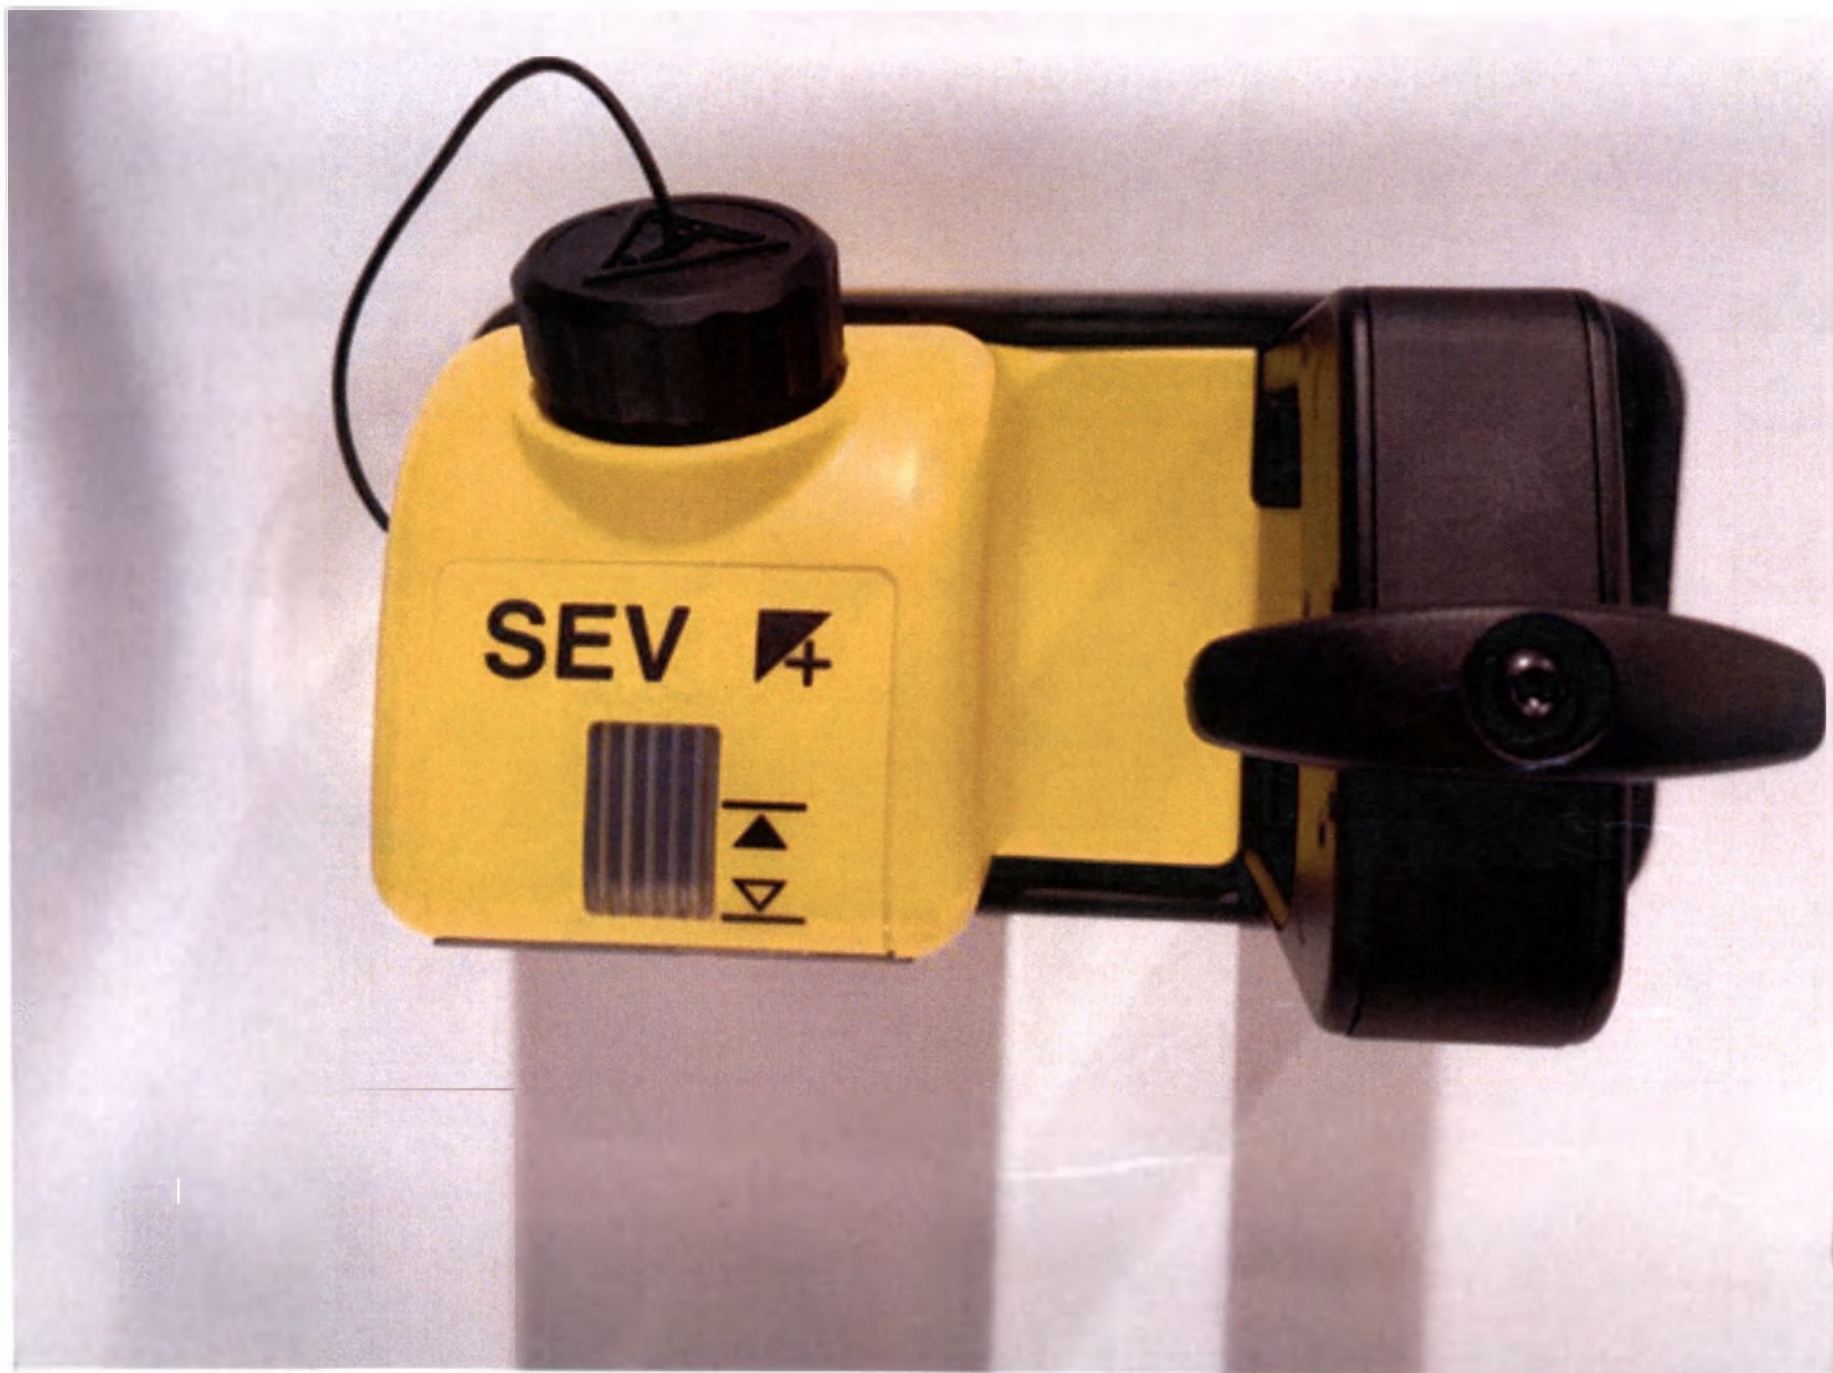



127. Испаритель для севофлюрана Quik-fil.

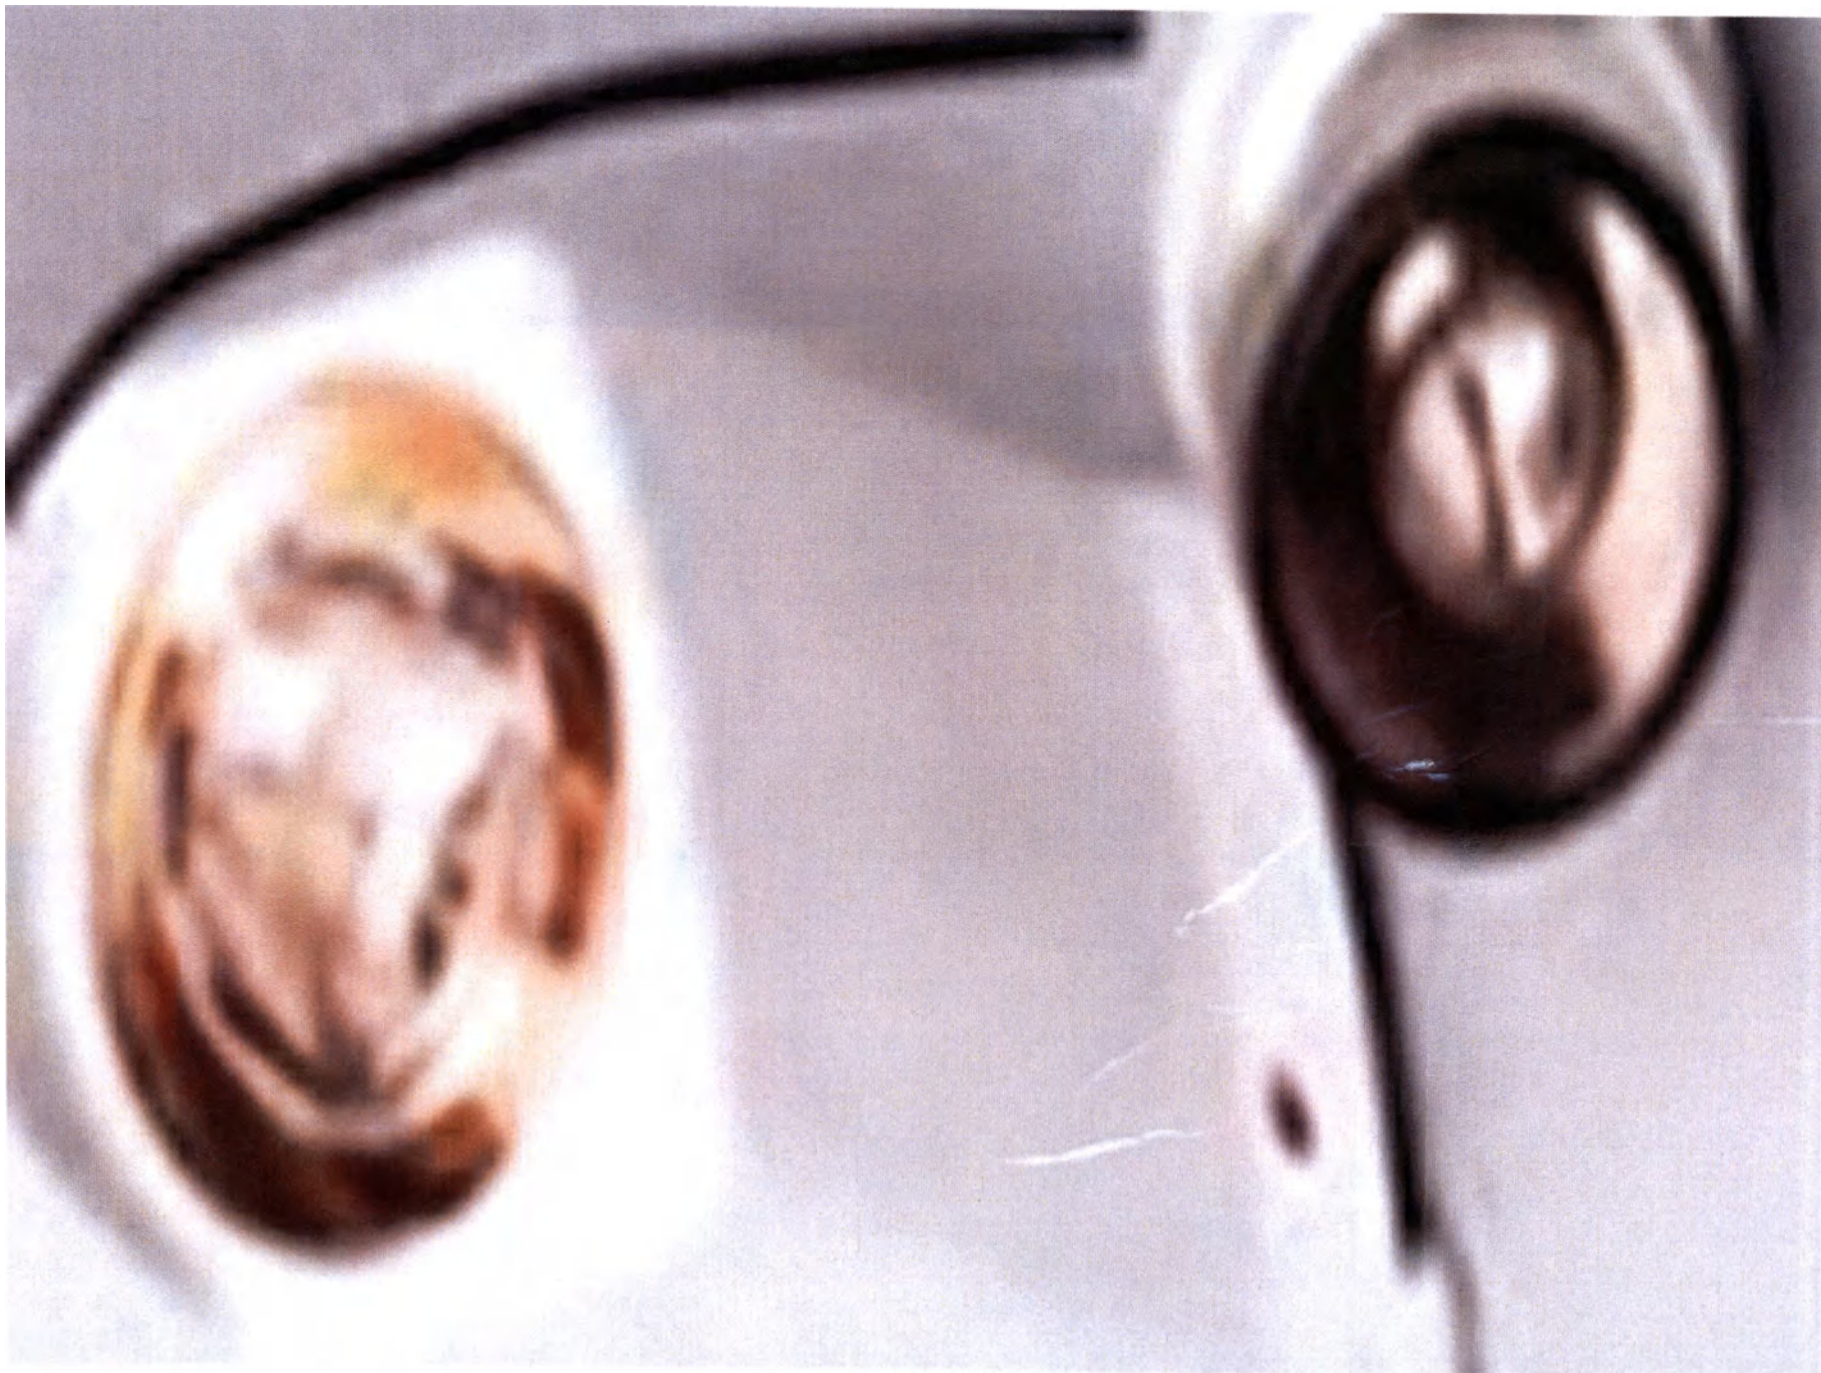



128. Испаритель для десфлюрана.





129. Переходник для энфлюрана (не более 50 шт.).





130. Переходник для галотана (не более 50 шт.).






131. Переходник для изофлюрана (не более 50 шт.).





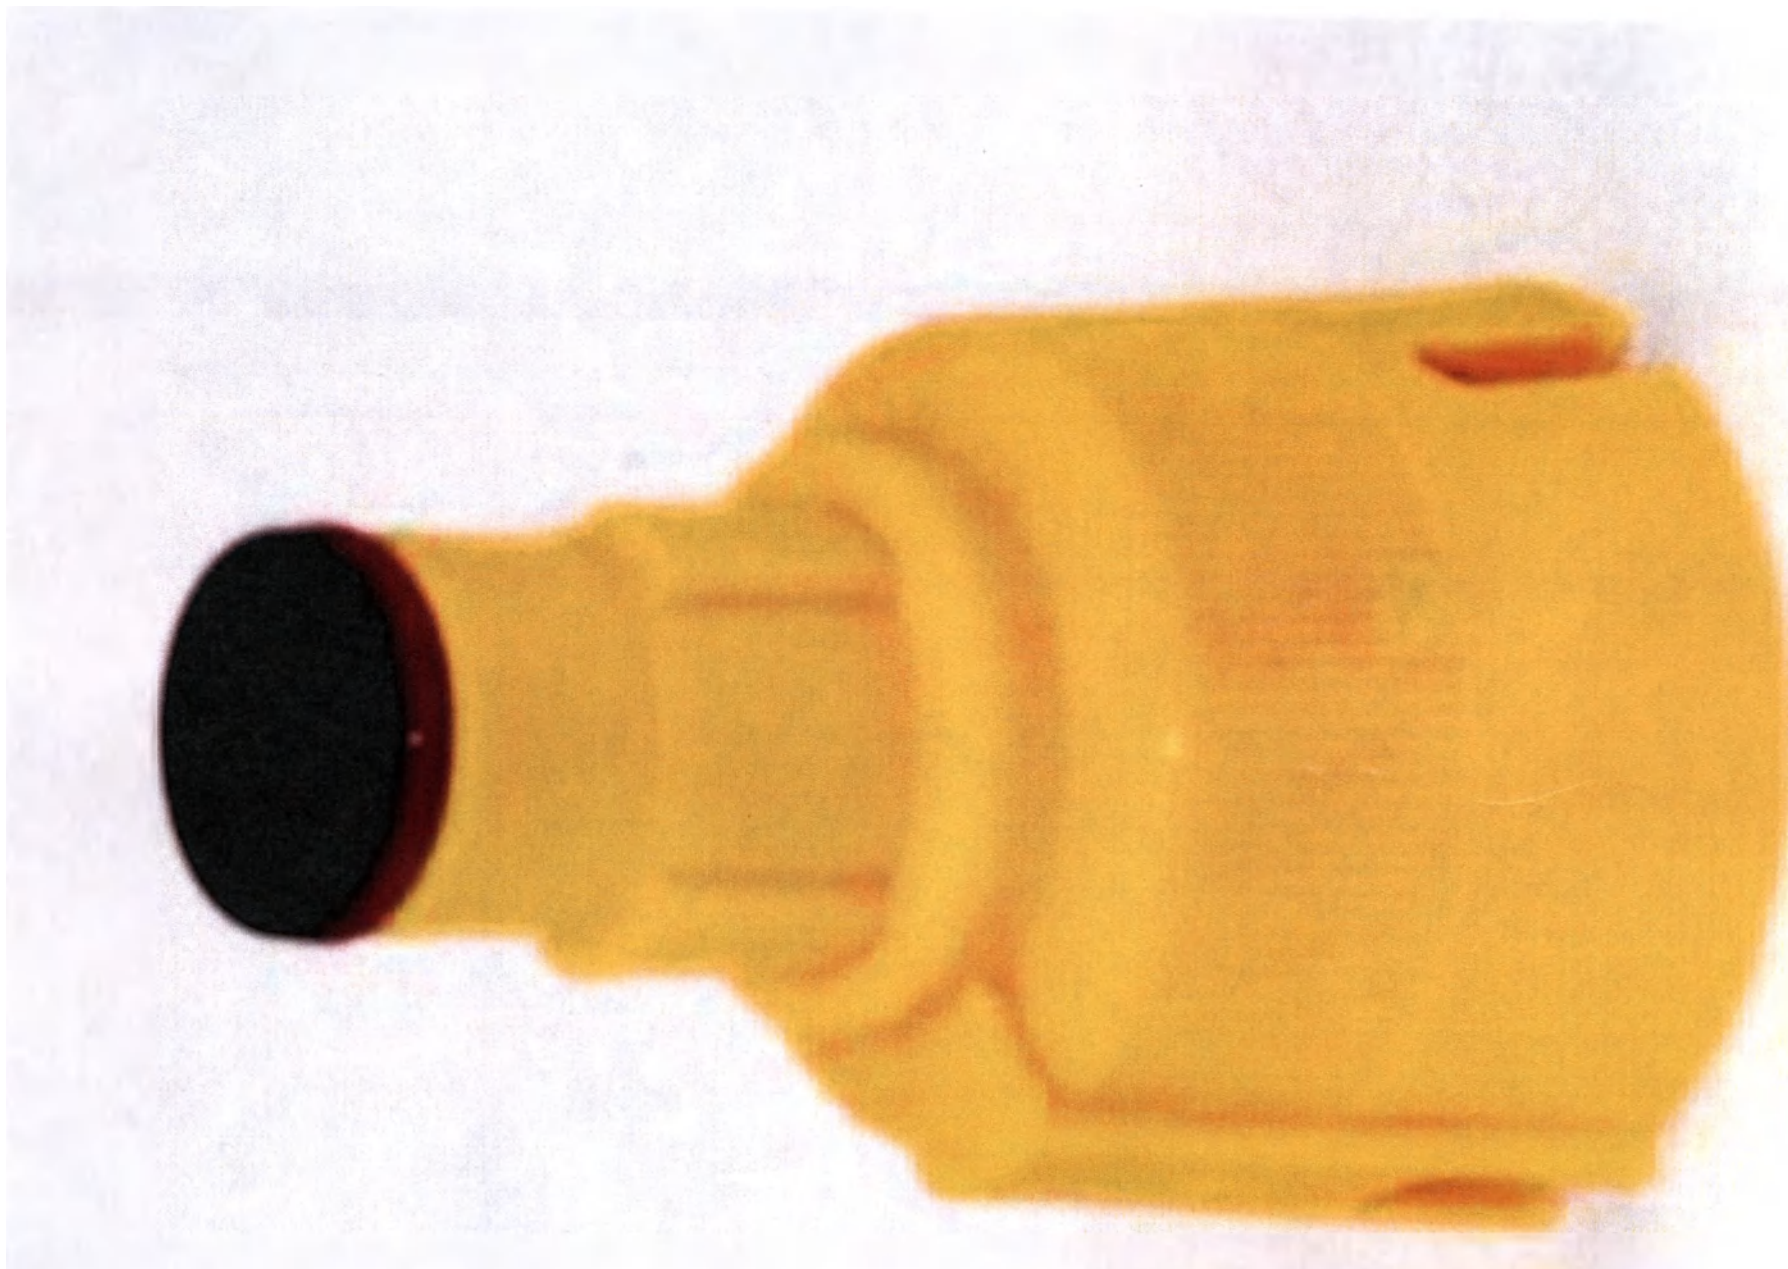




133. Мешок дыхательный (не более 50 шт.).






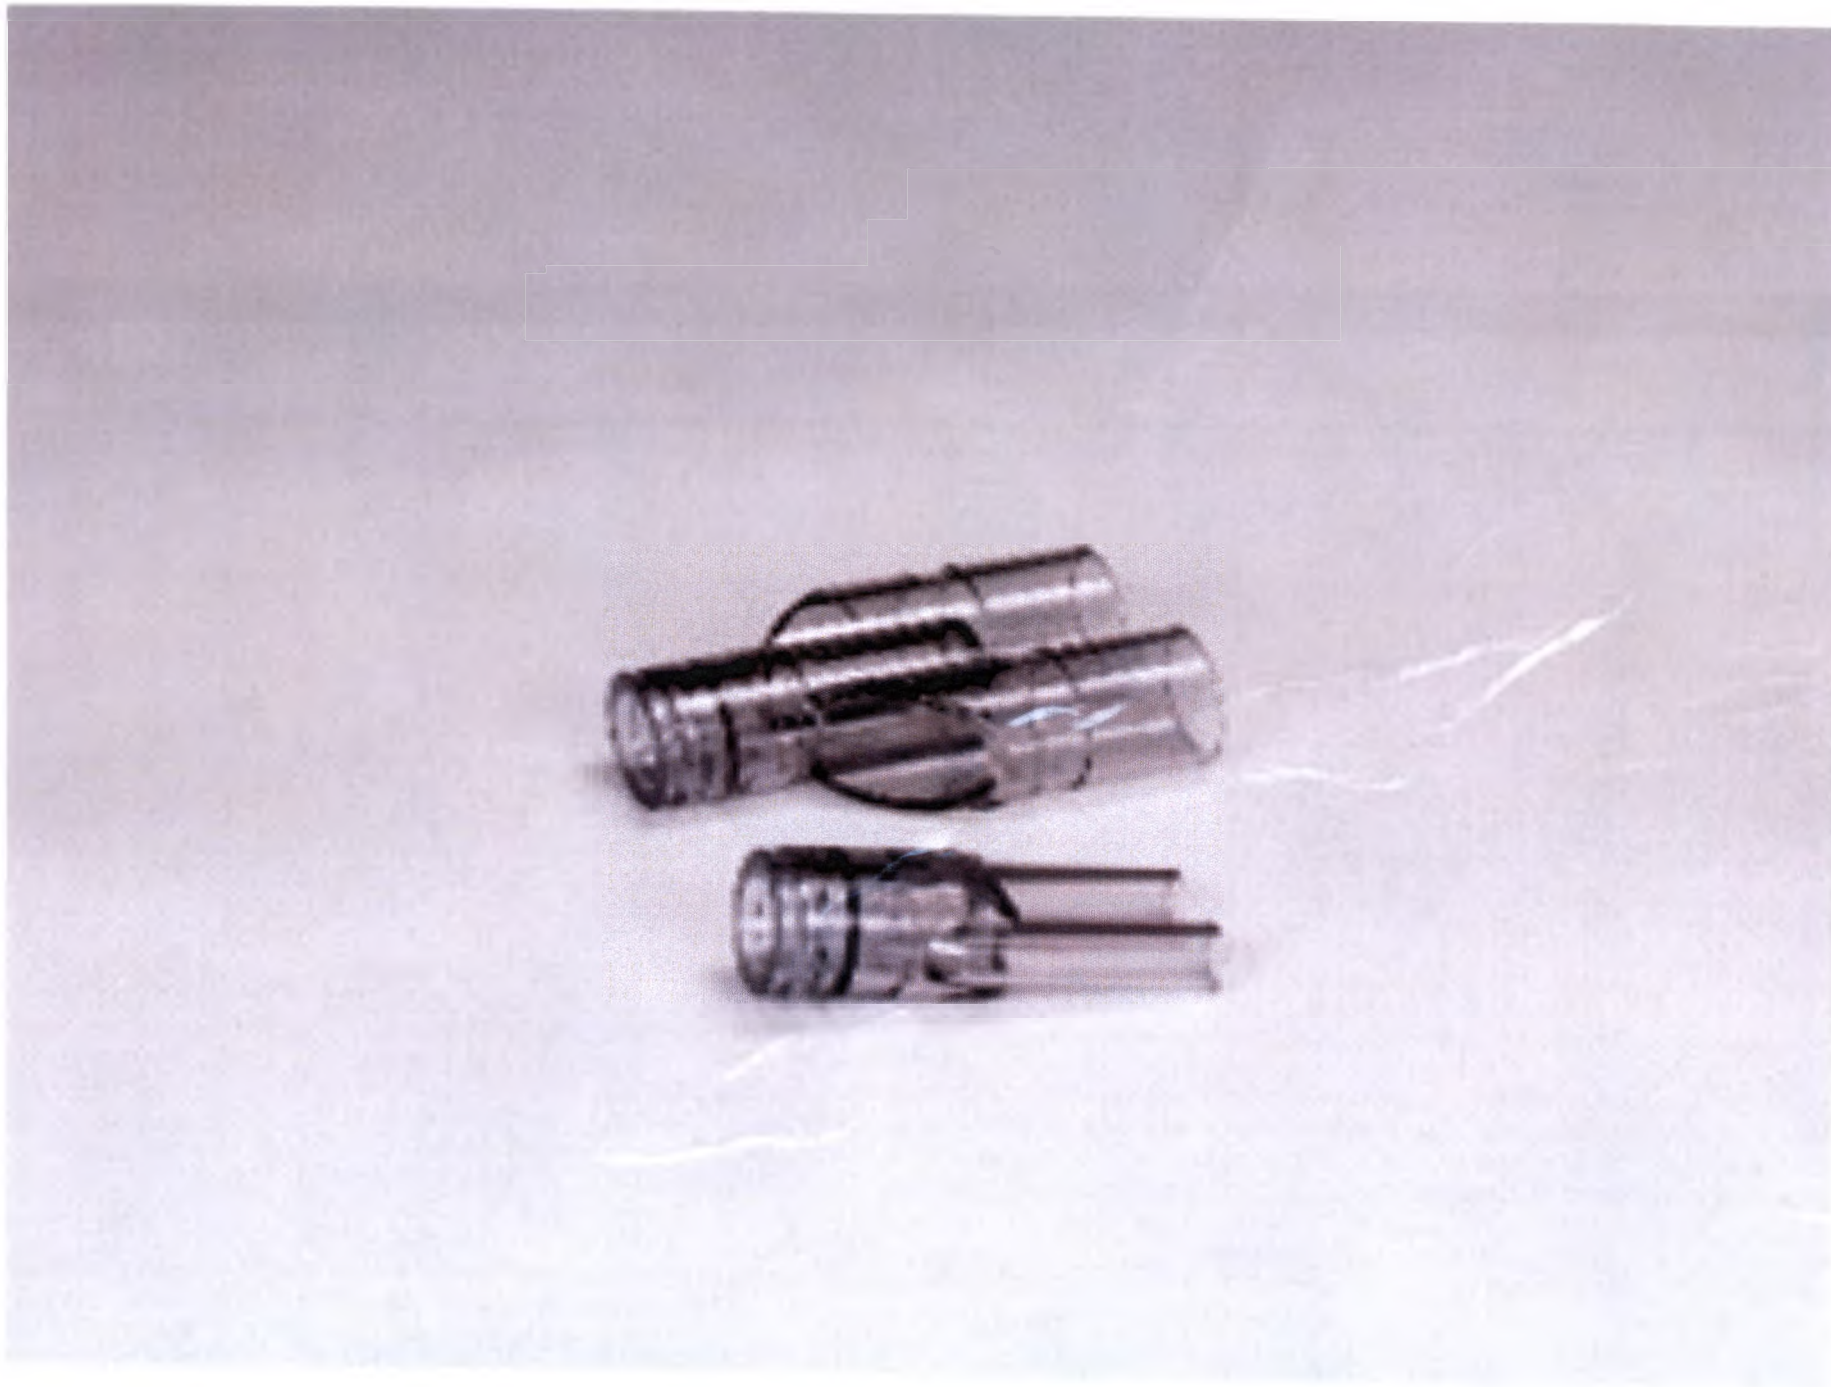



135. Переходник поворотный, многоразовый (не более 50 шт.).

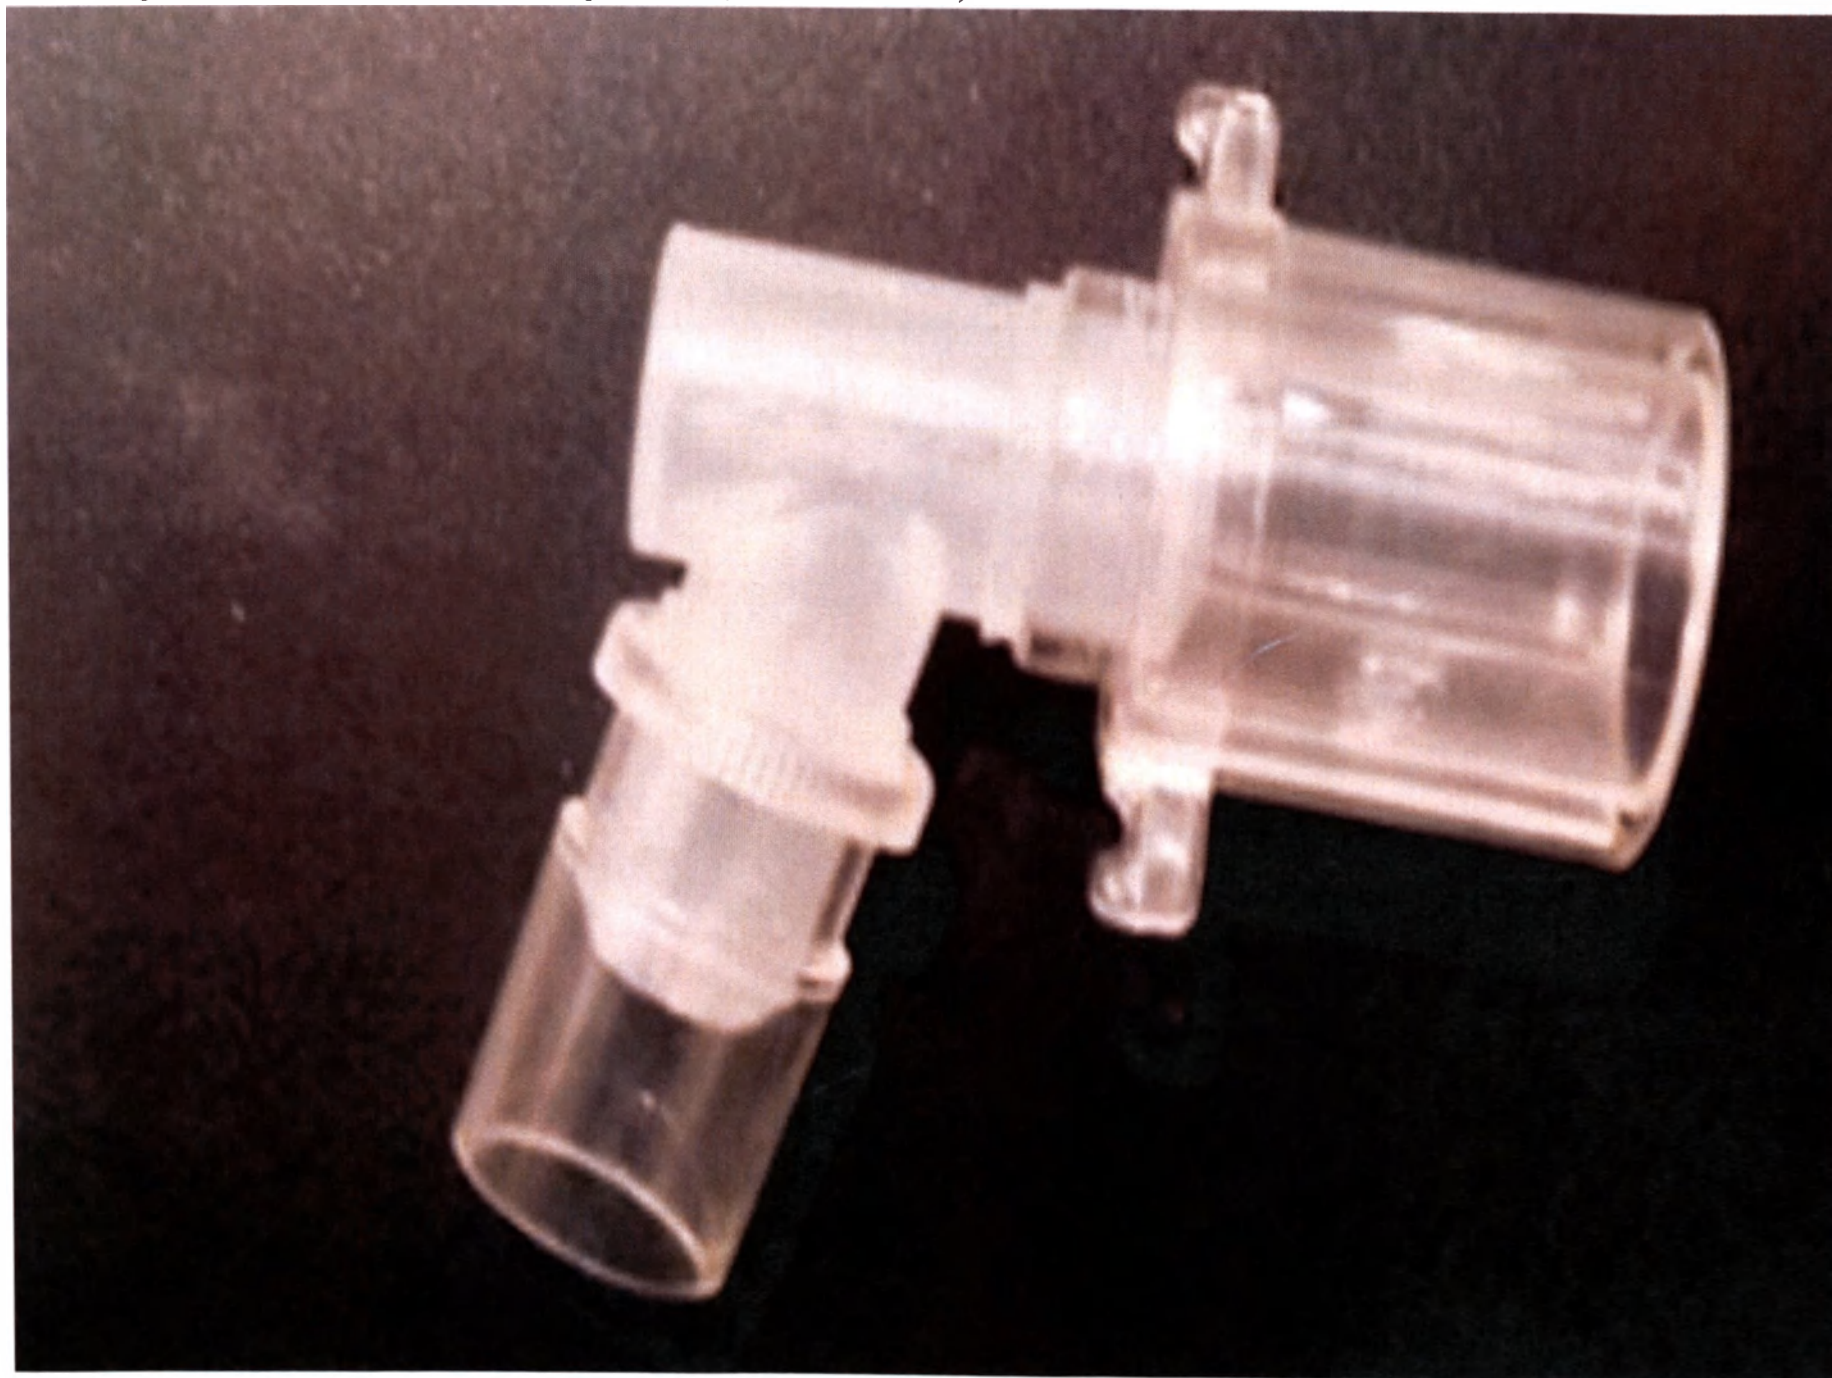









137. Ловушка водяная miniD-Fend (не более 300 шт.).

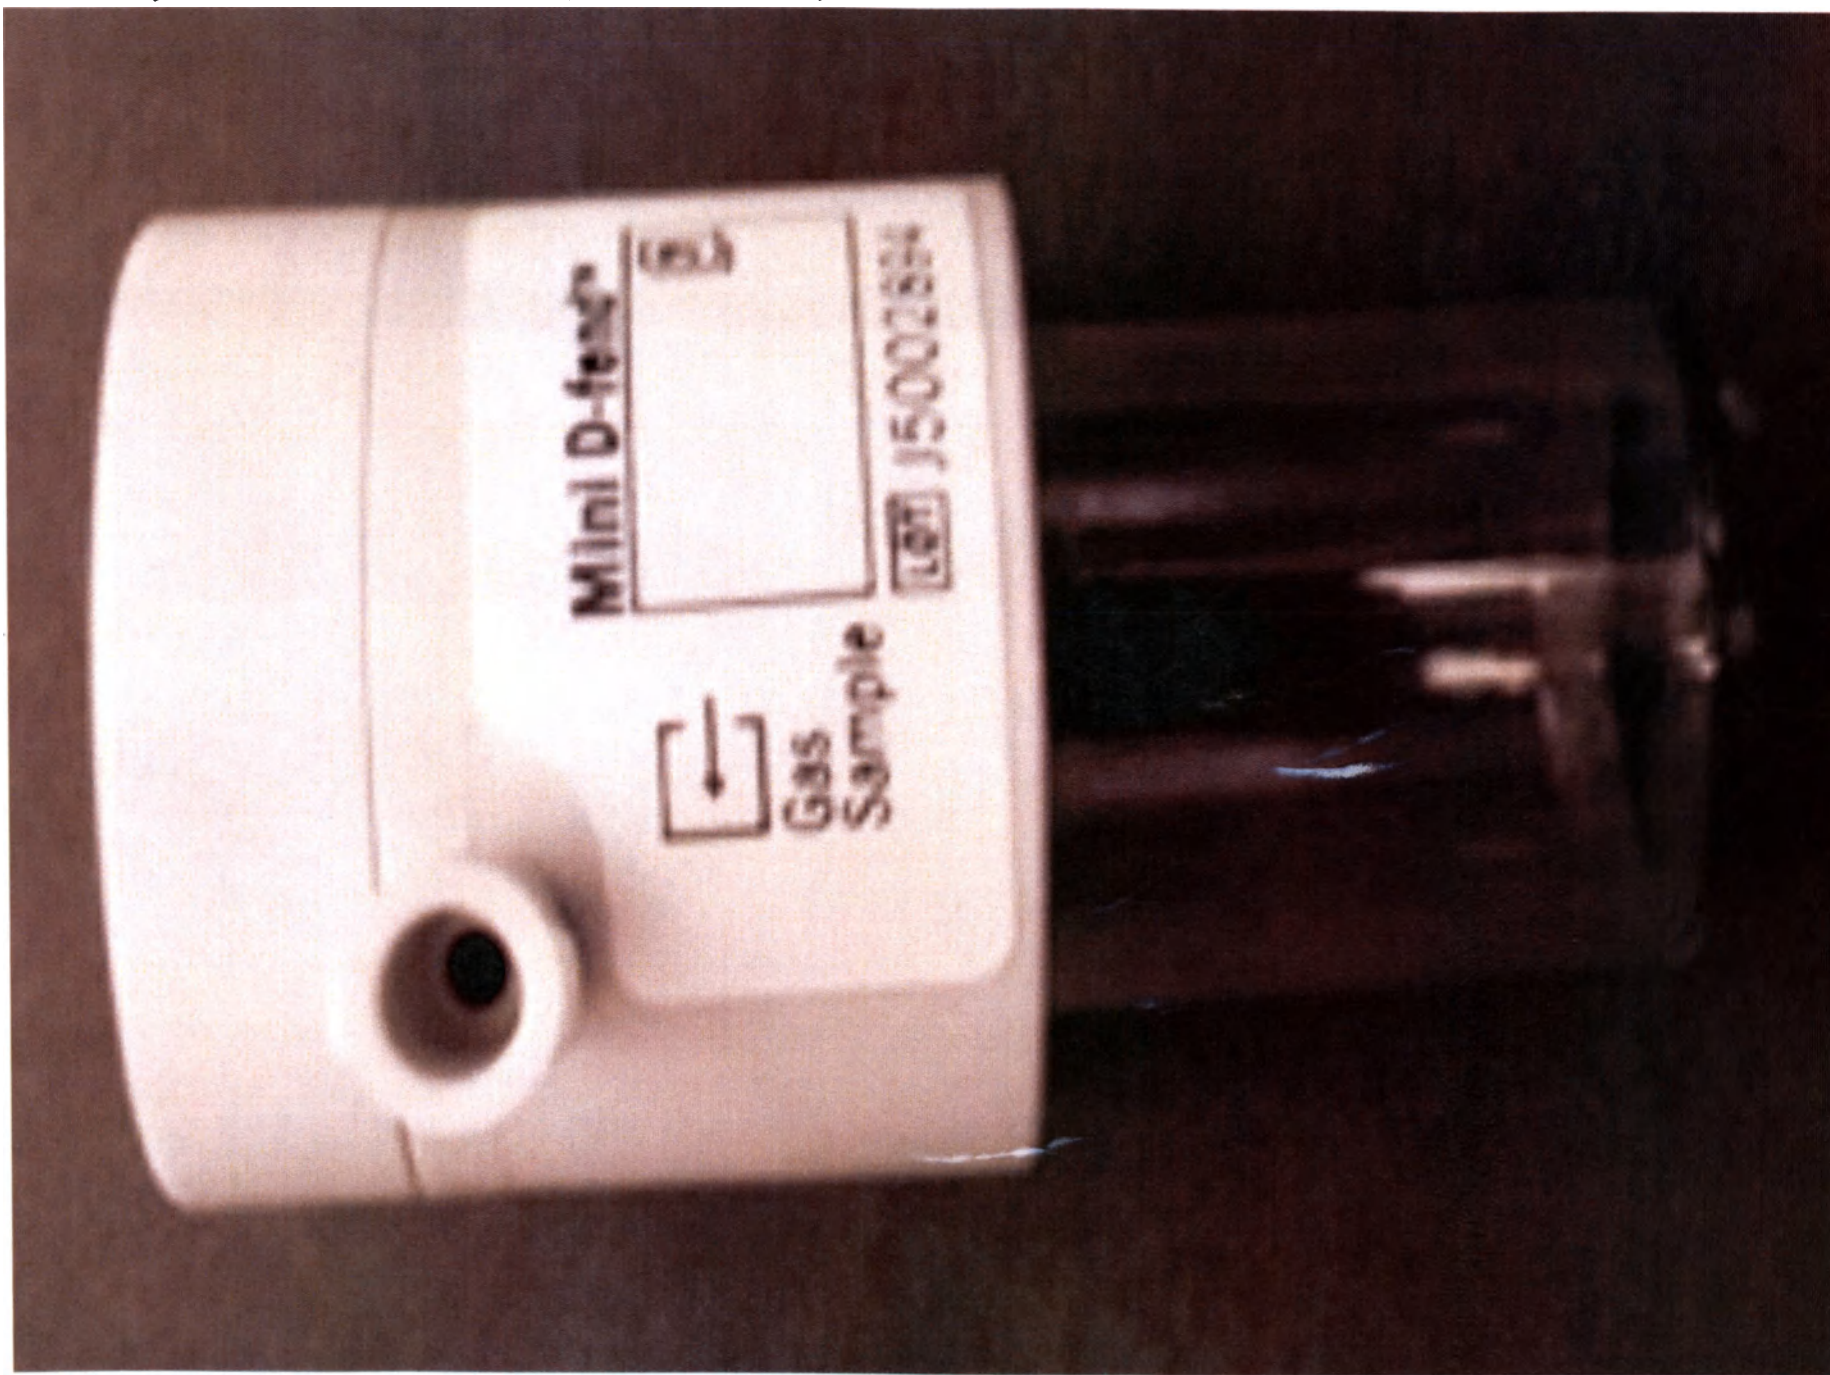



138. Линия отбора проб газов (не более 300 шт.).

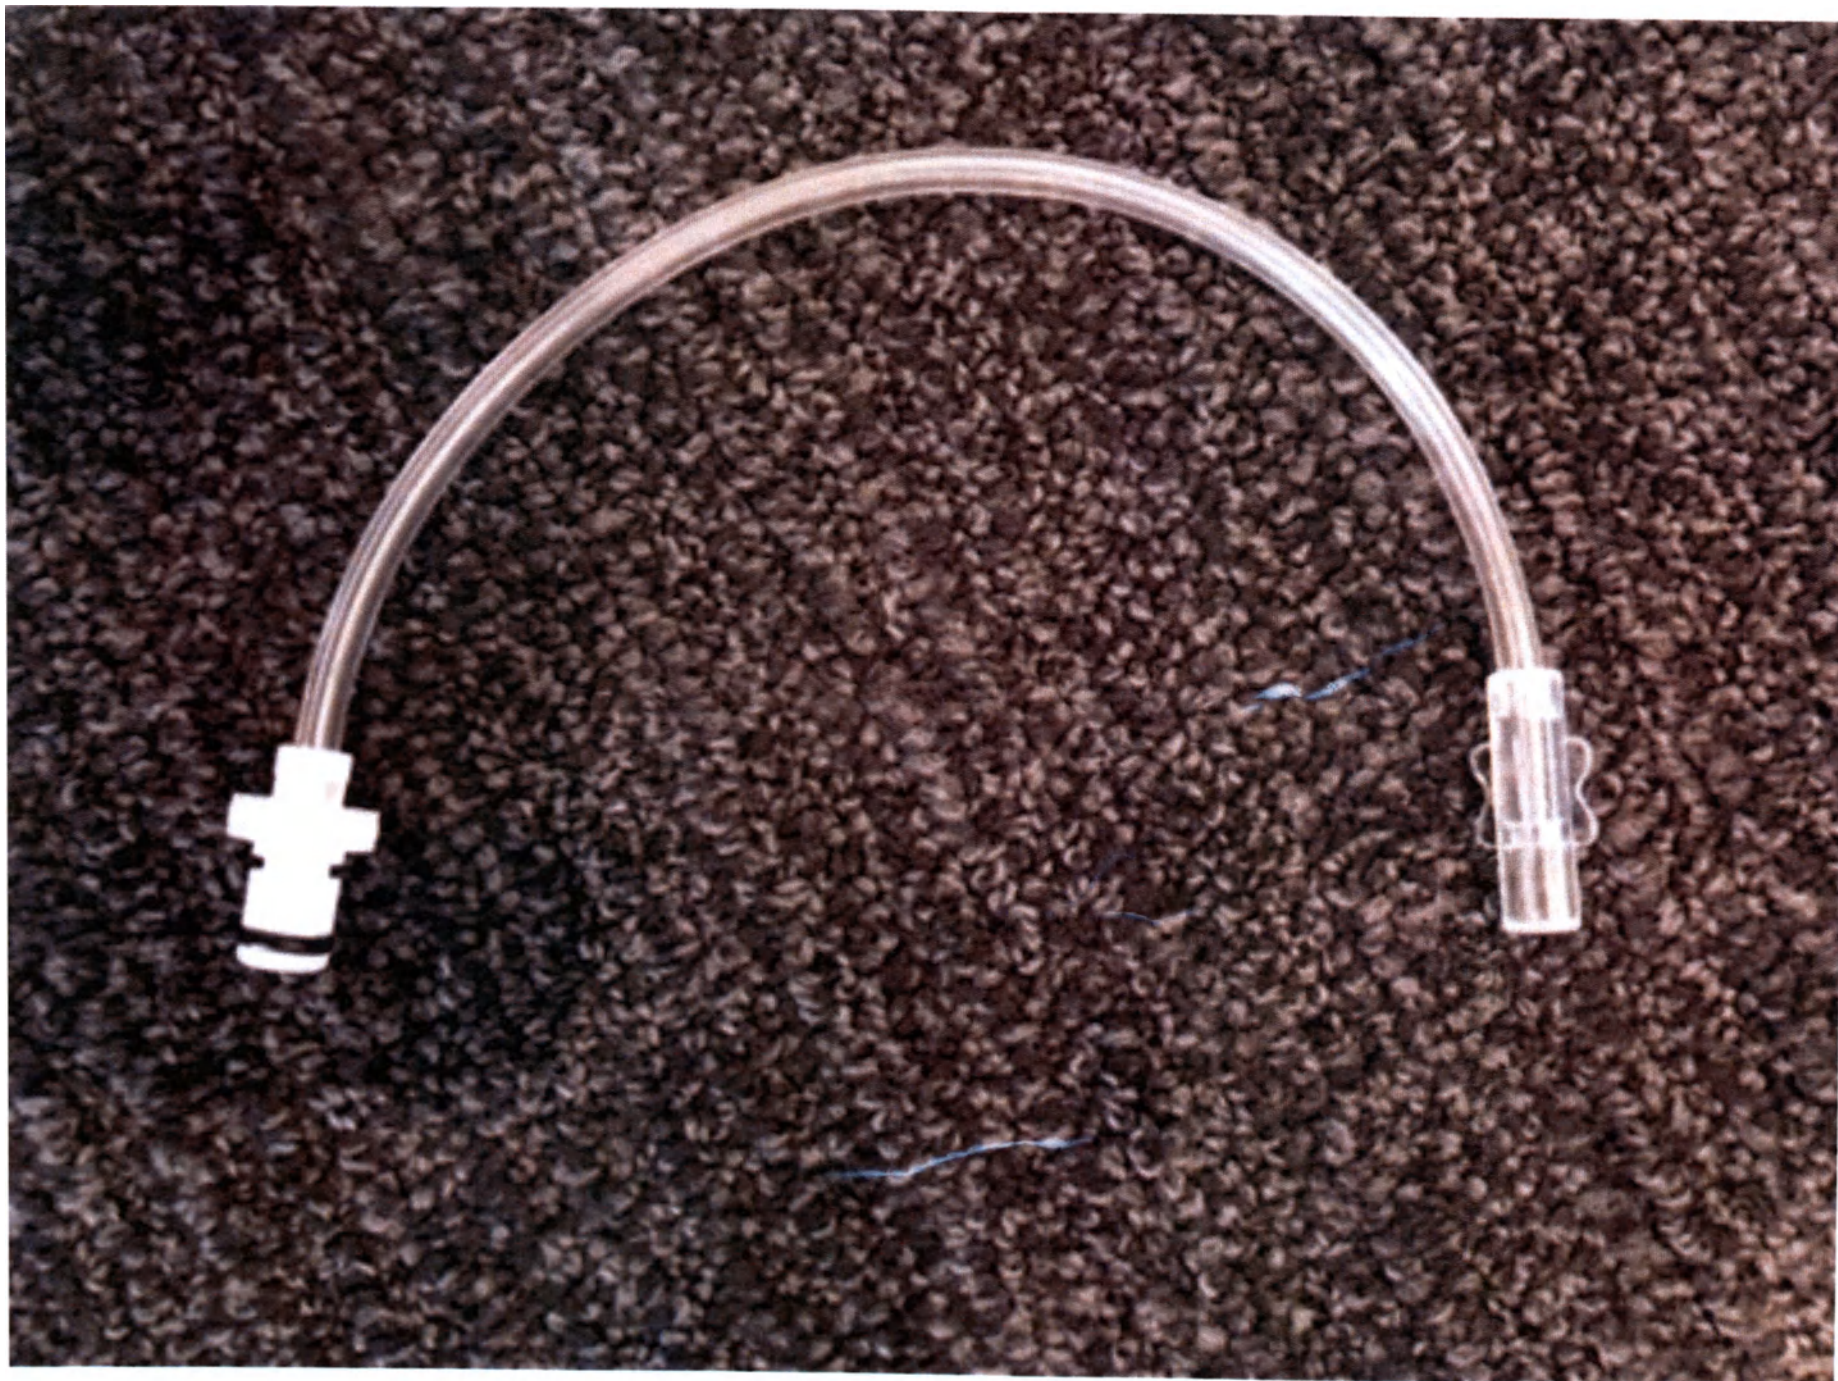




139. Водоотделитель D-FEND (не более 300 шт.).






140. Т-адаптер прямой (не более 300 шт.).

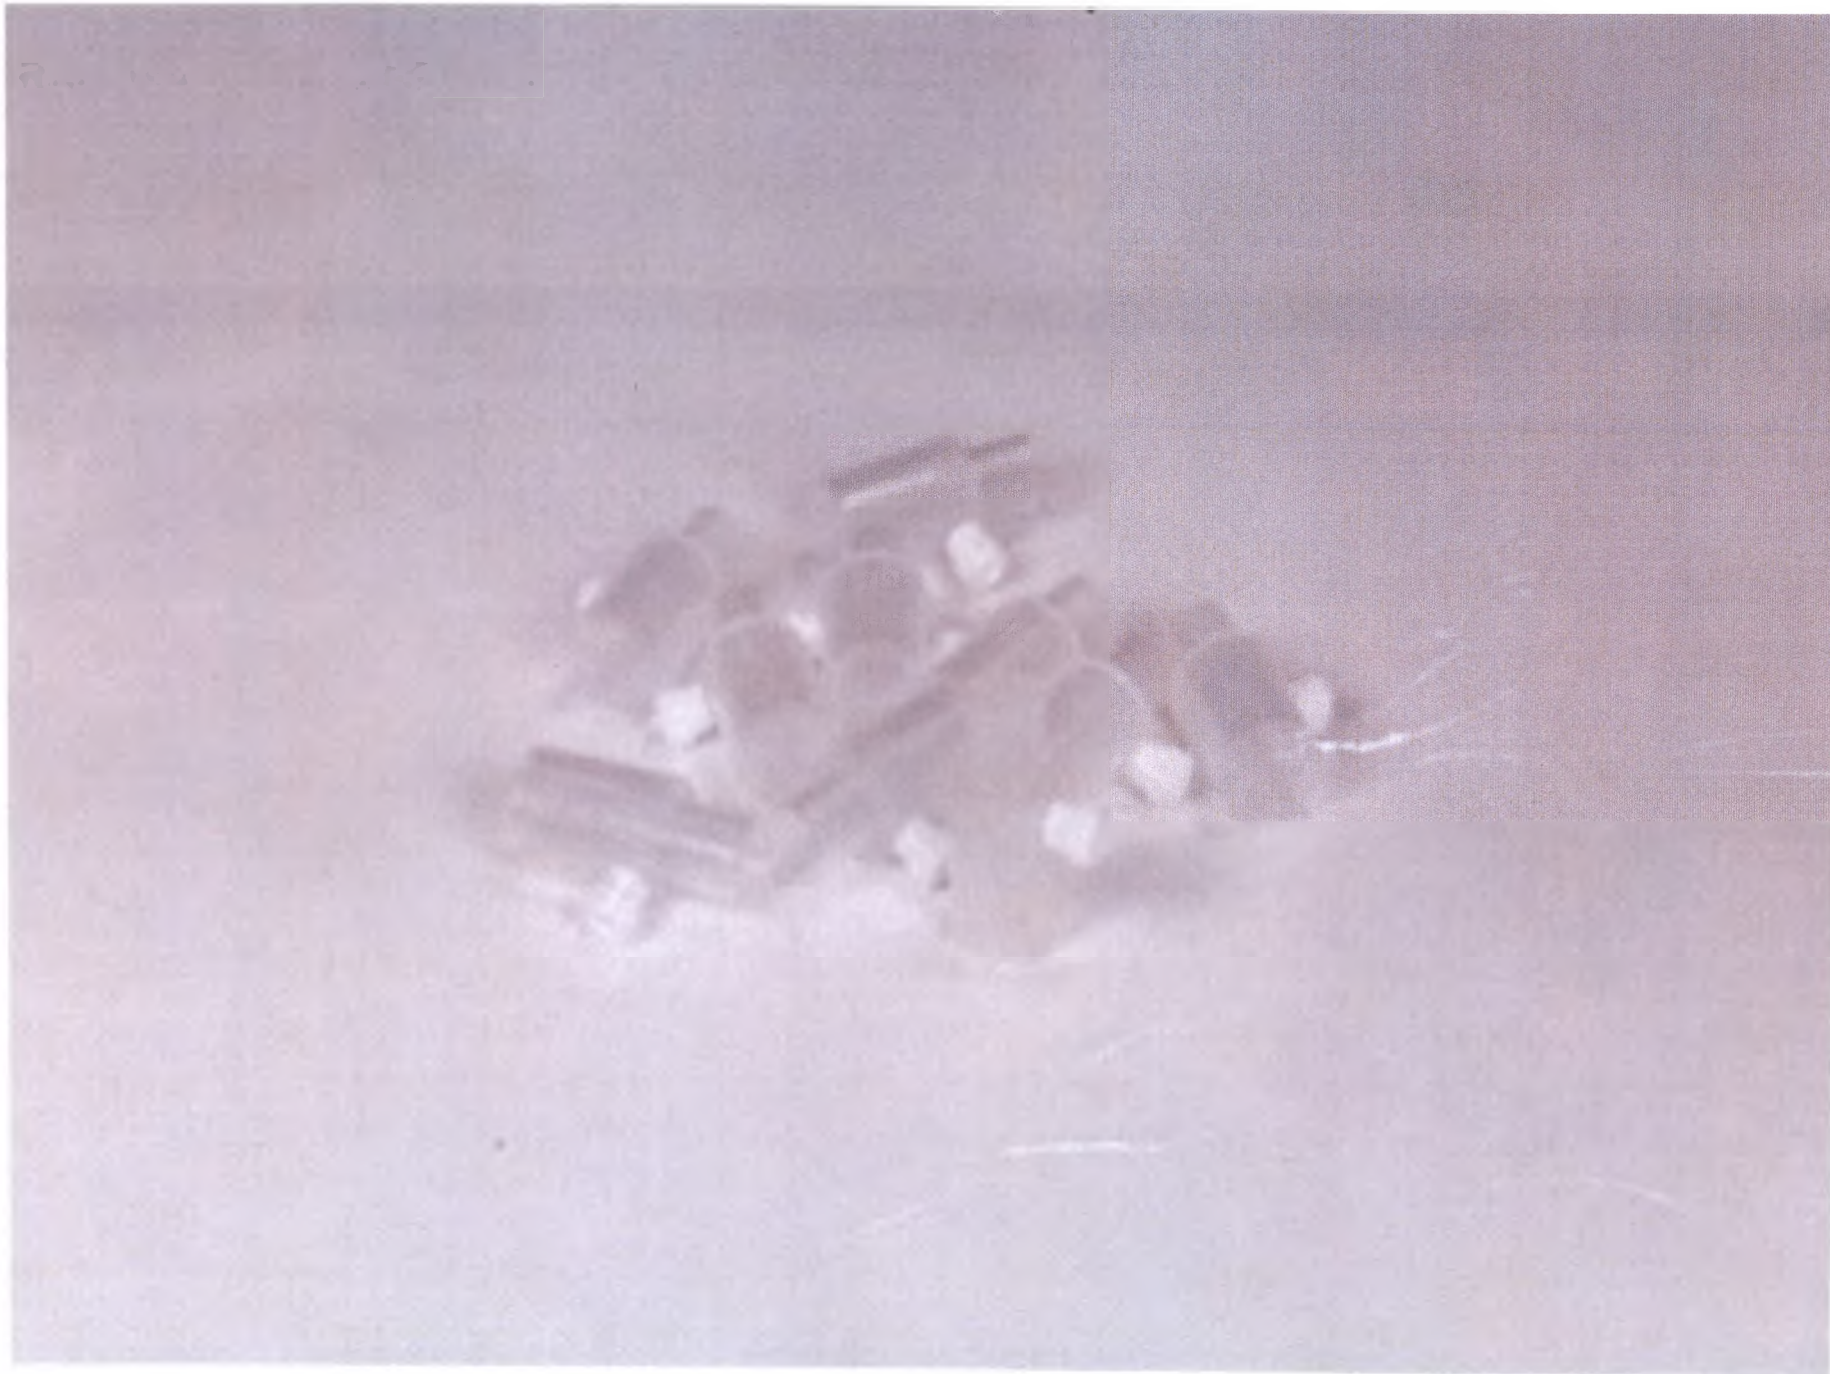




140. Т-адаптер прямой (не более 300 шт.).

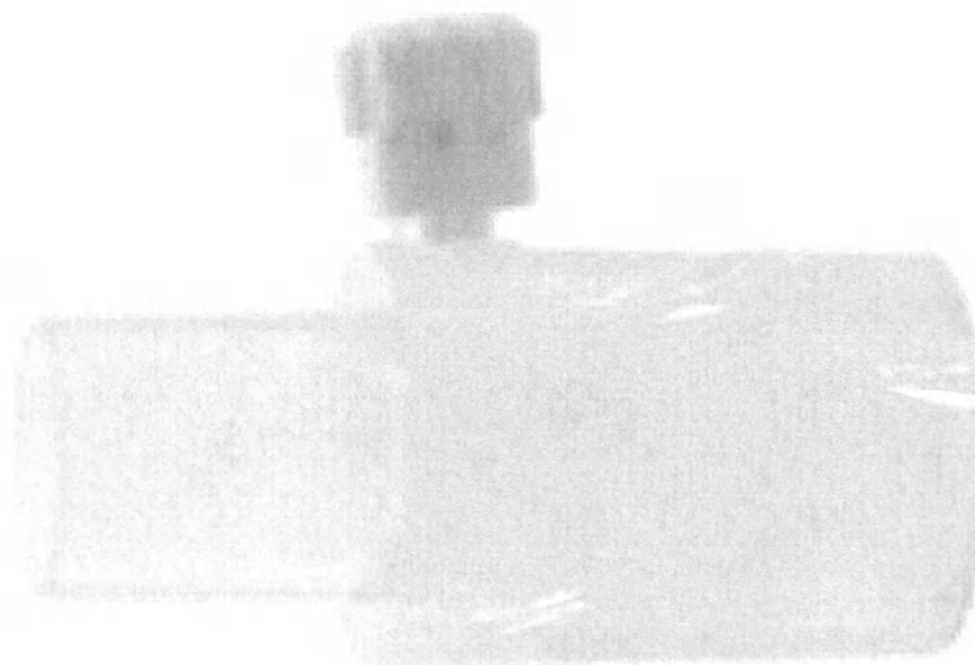



141. Датчик спирометрии и газоанализа одноразовый (не более 300 шт.).

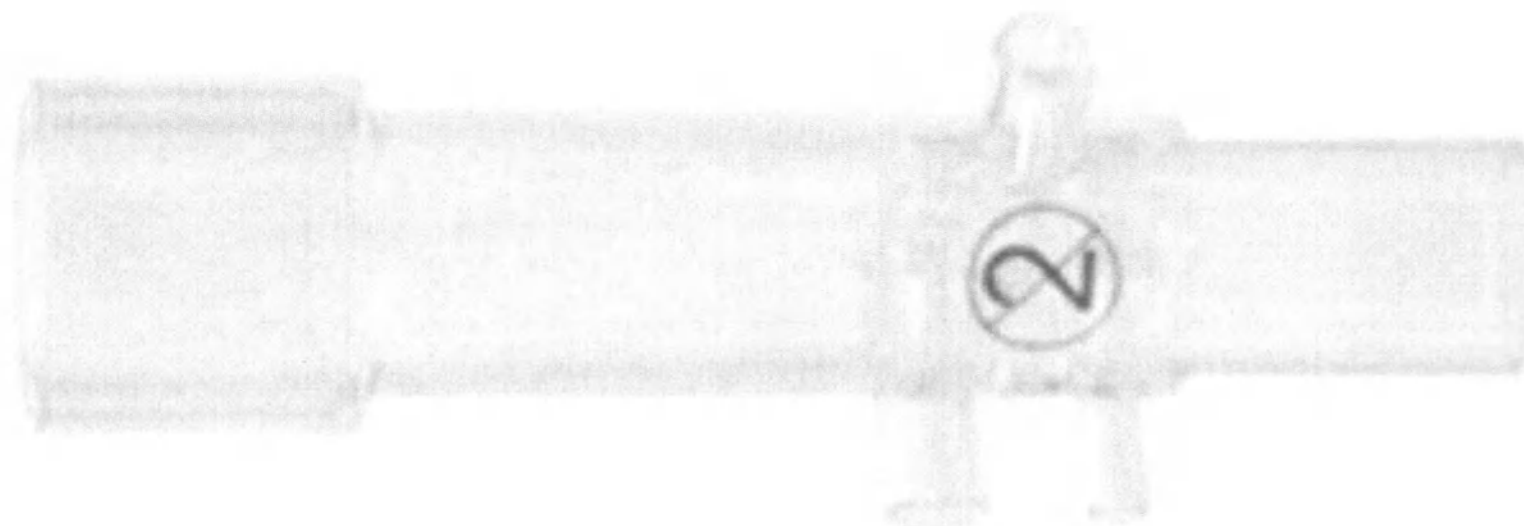



142. Трубки спирометрии (не более 300 шт.).











144. Контуры дыхательные многоразовые взрослые (не более 100 шт.).

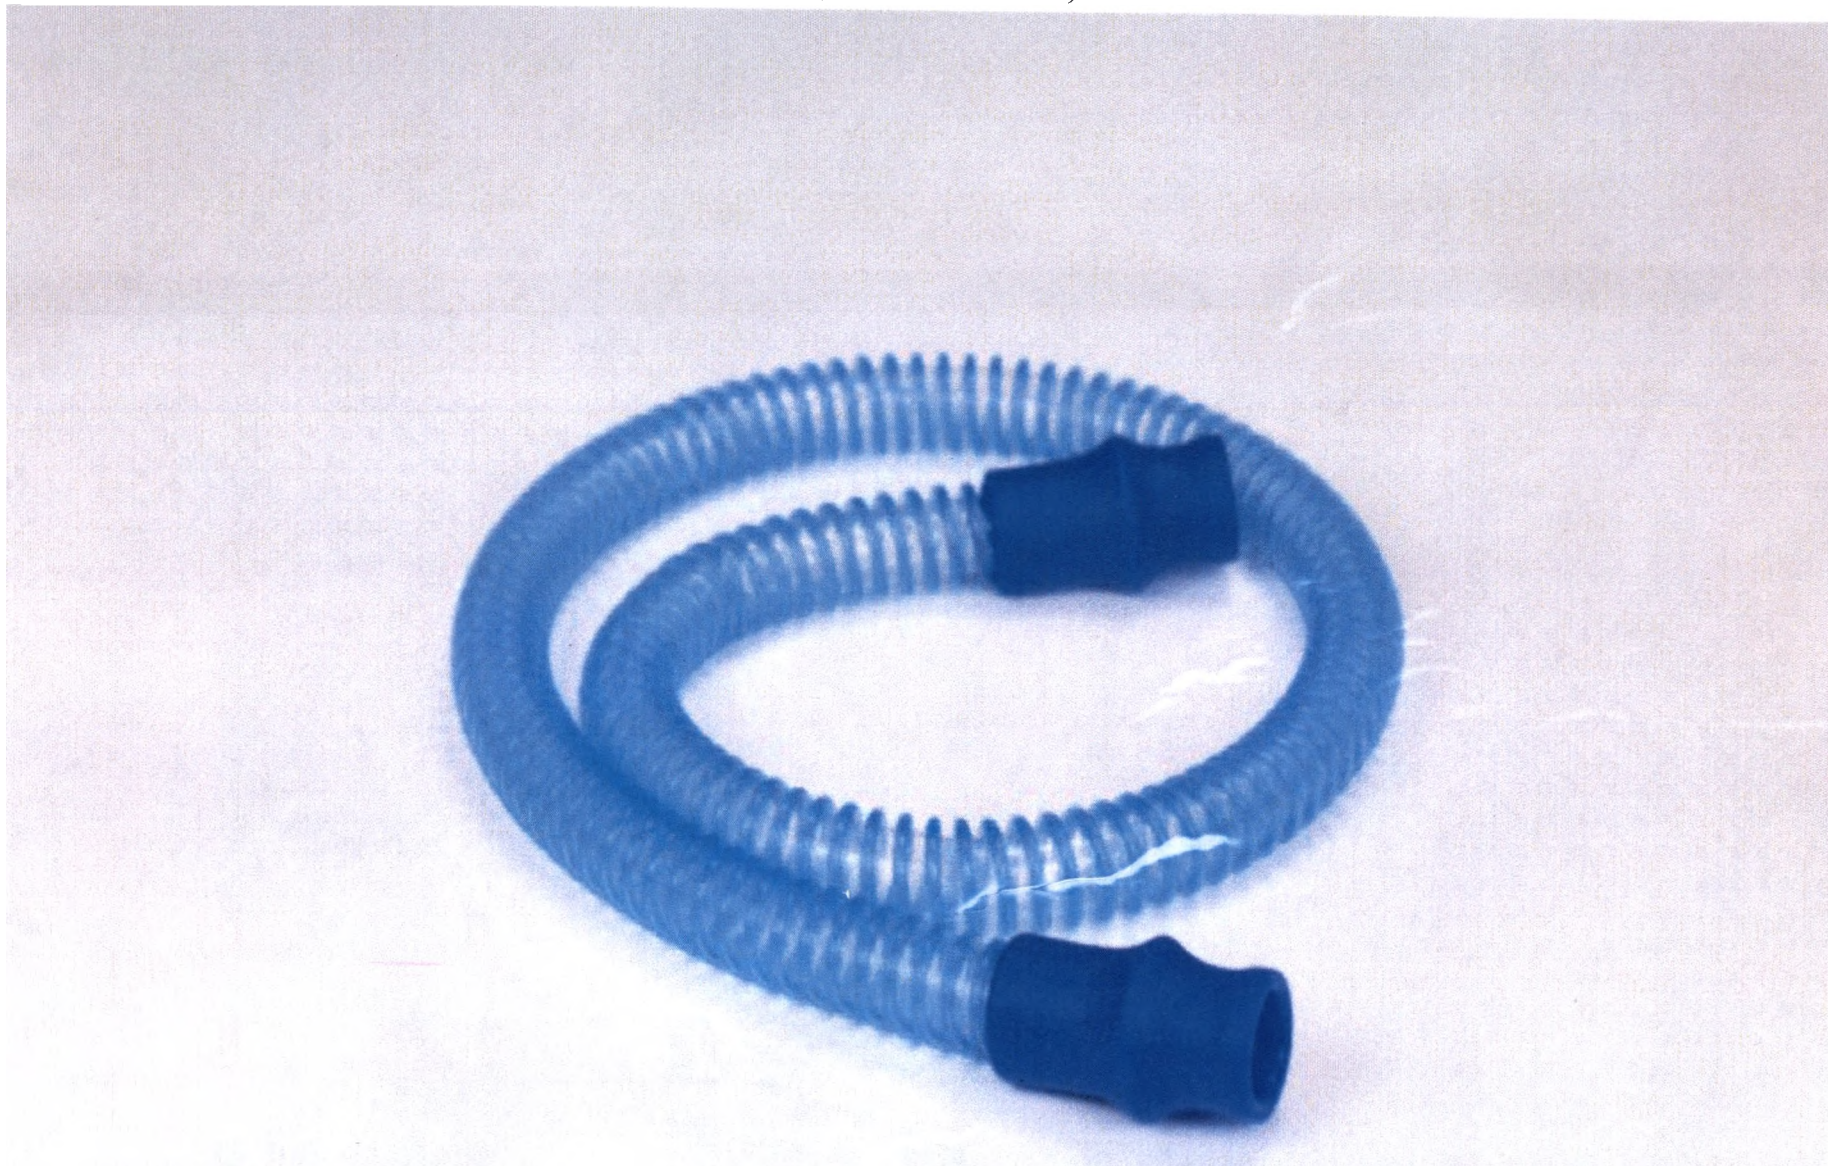




145. Контуры дыхательные многоразовые детские (не более 100 шт.).

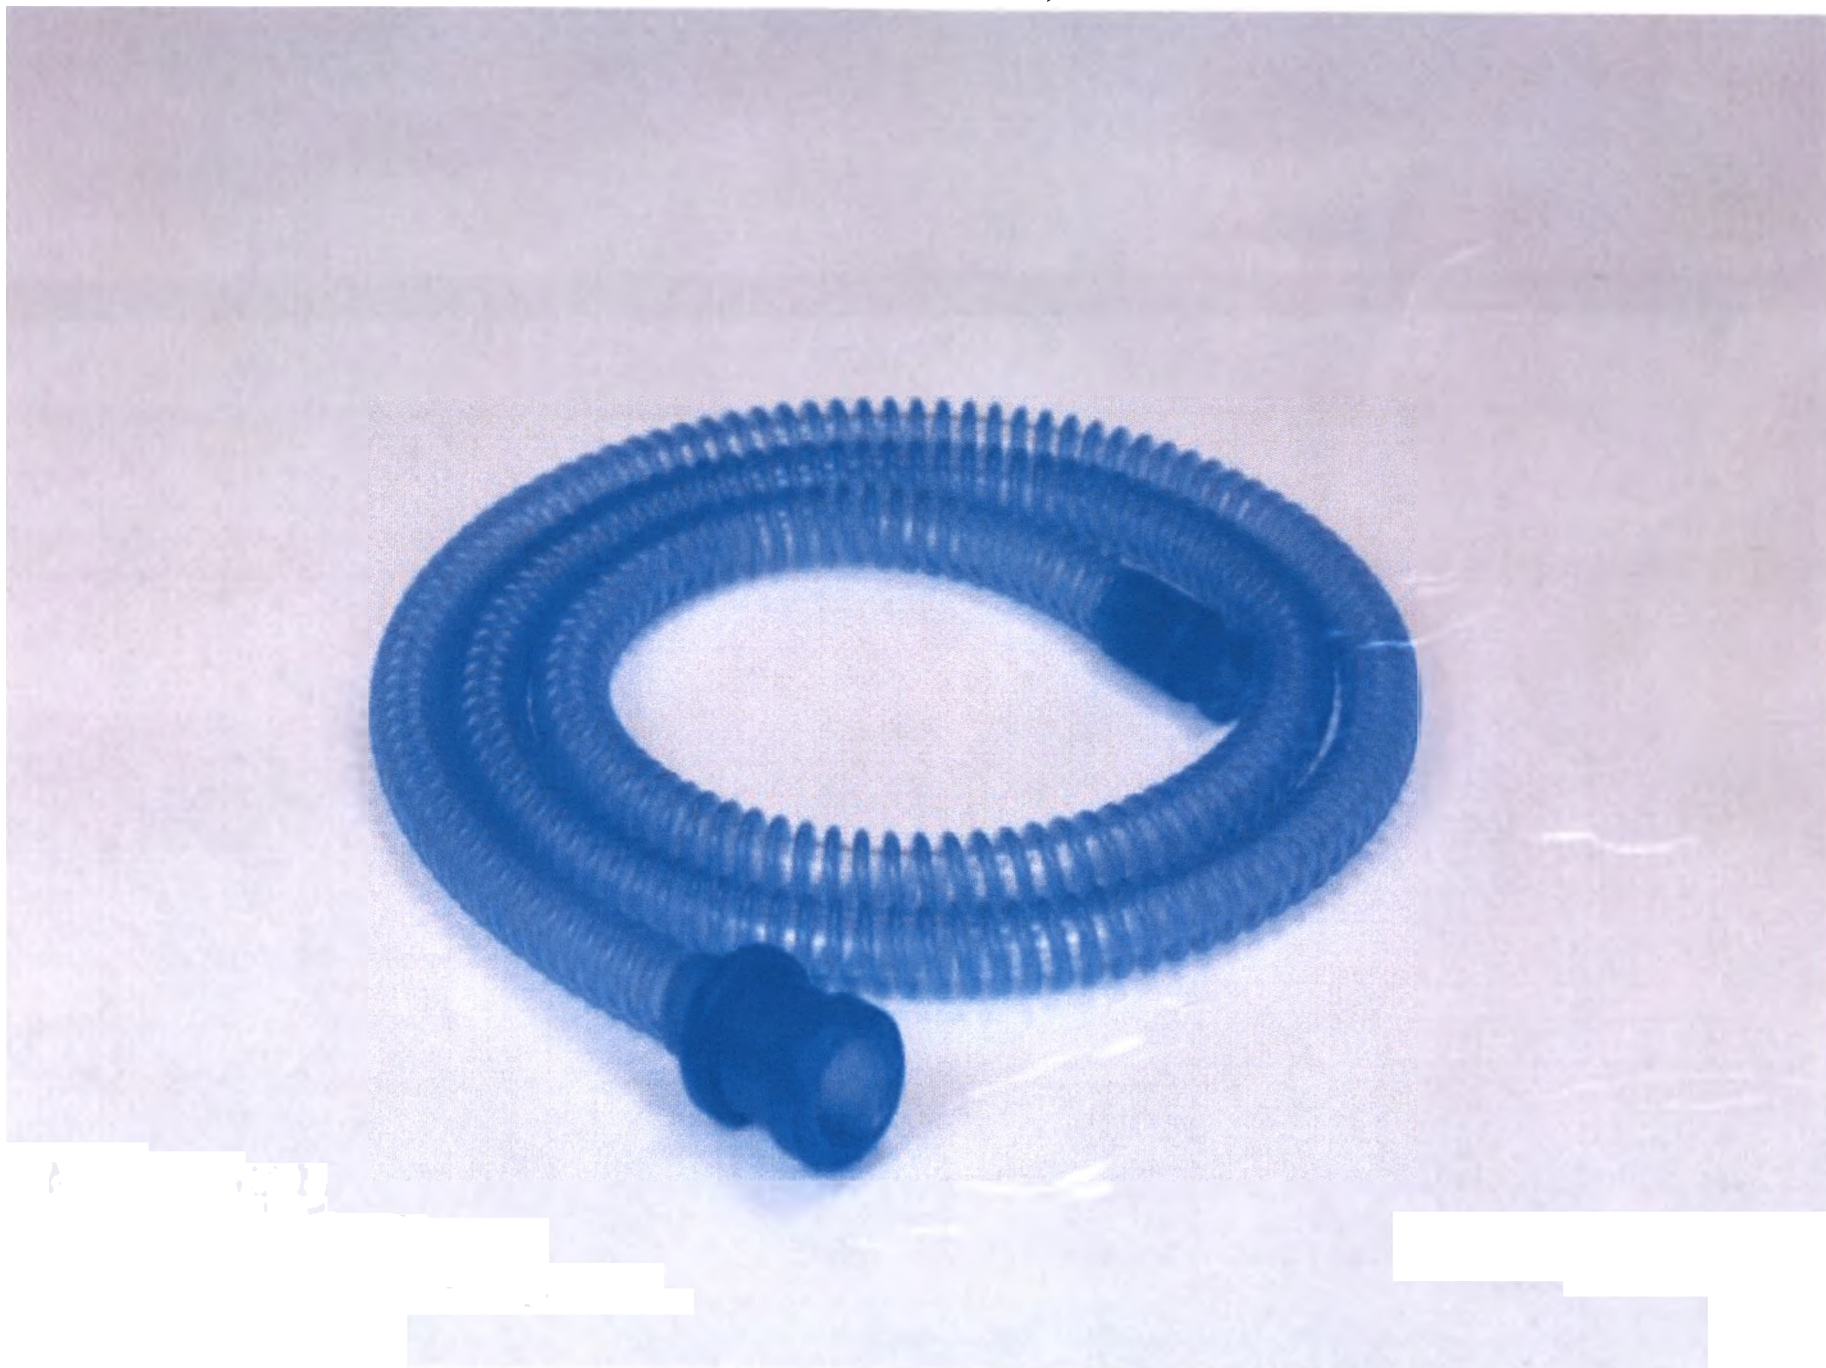




146. Контуры дыхательные многоразовые неонатальные (не более 100 шт.).

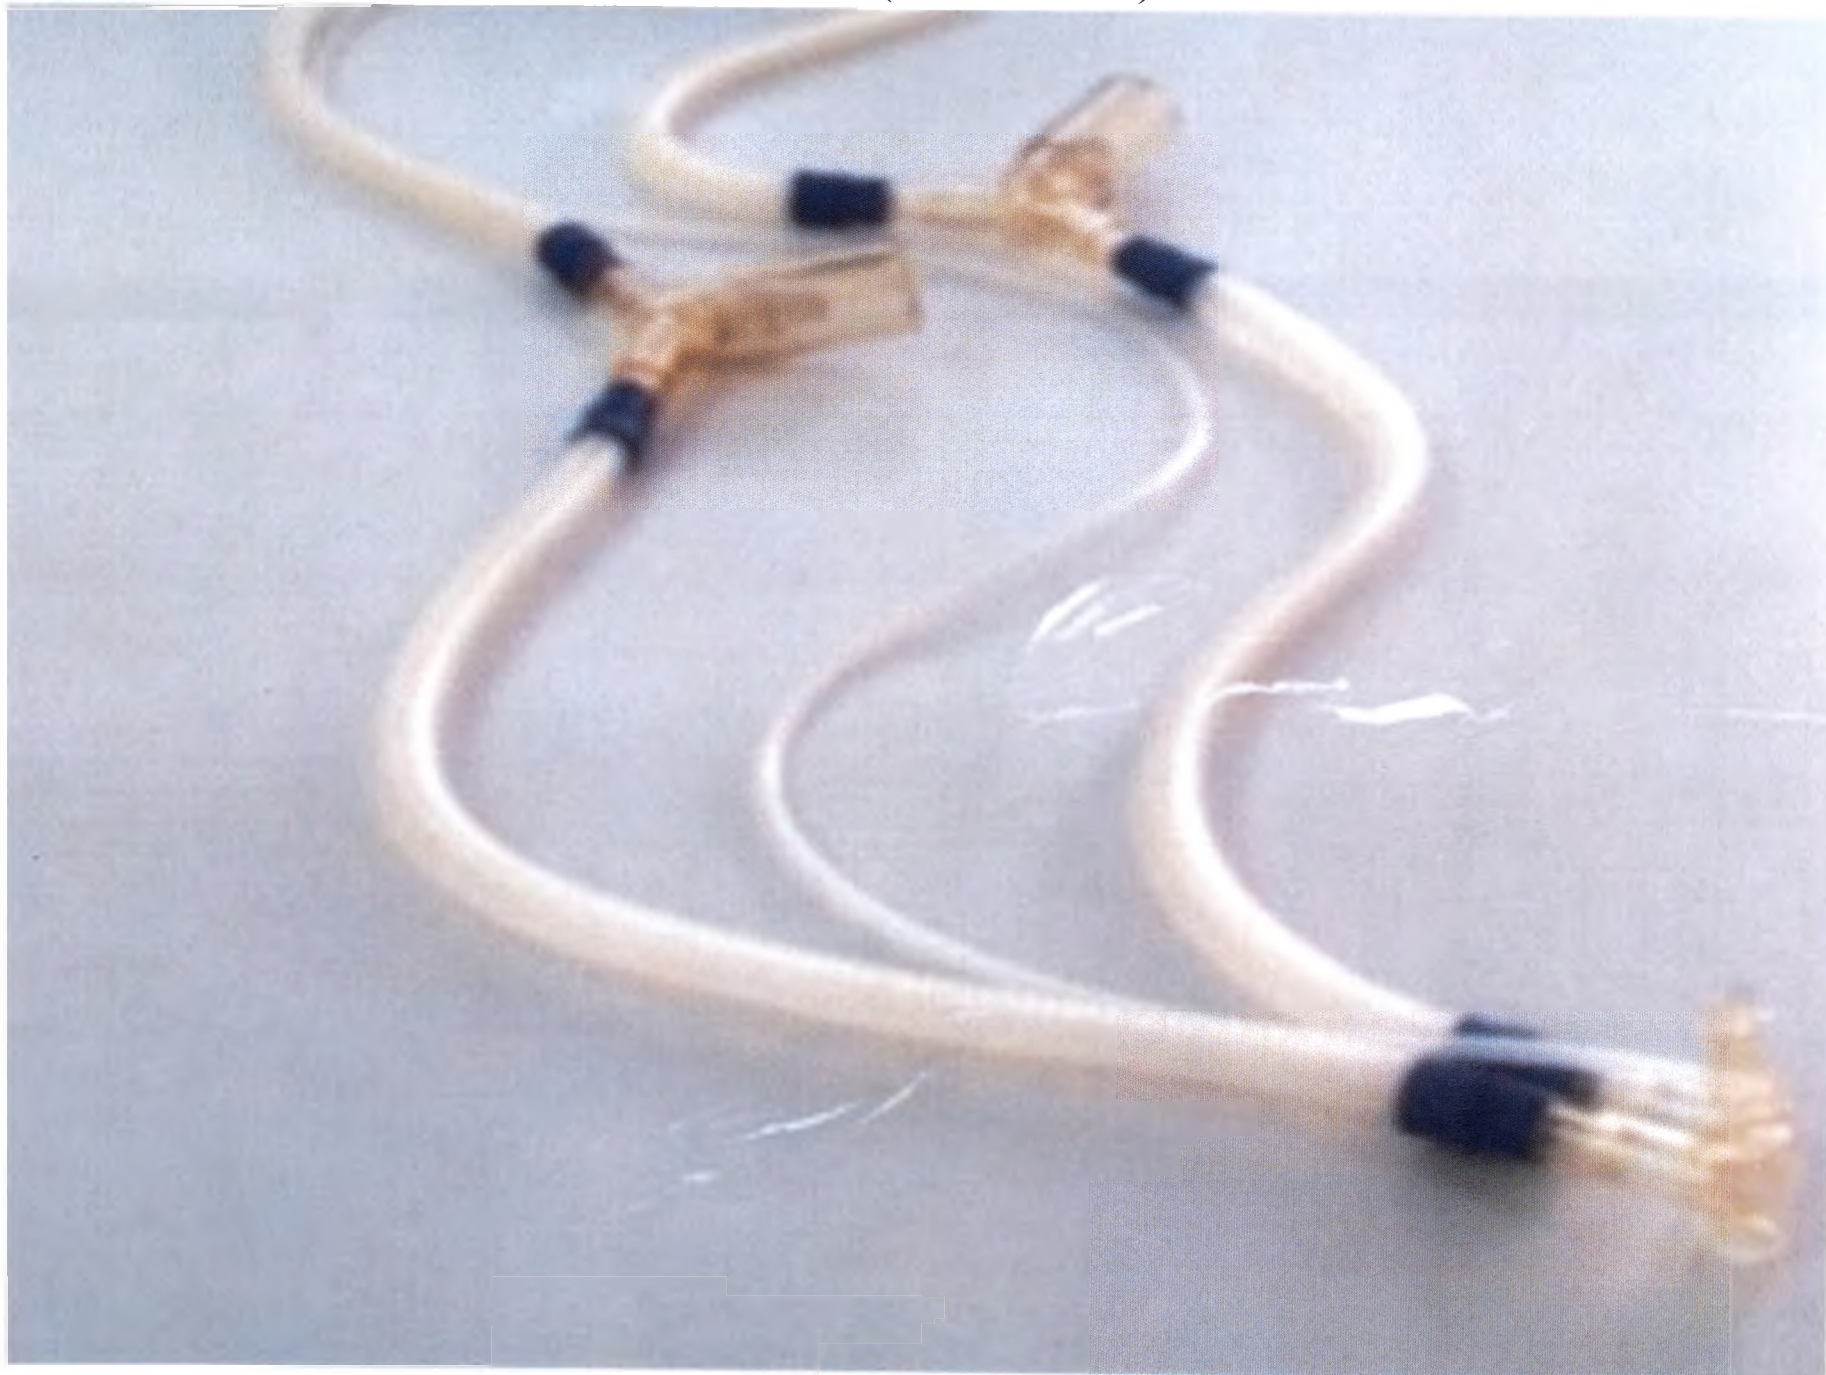




147. Контуры дыхательные одноразовые взрослые (не более 300 шт.).

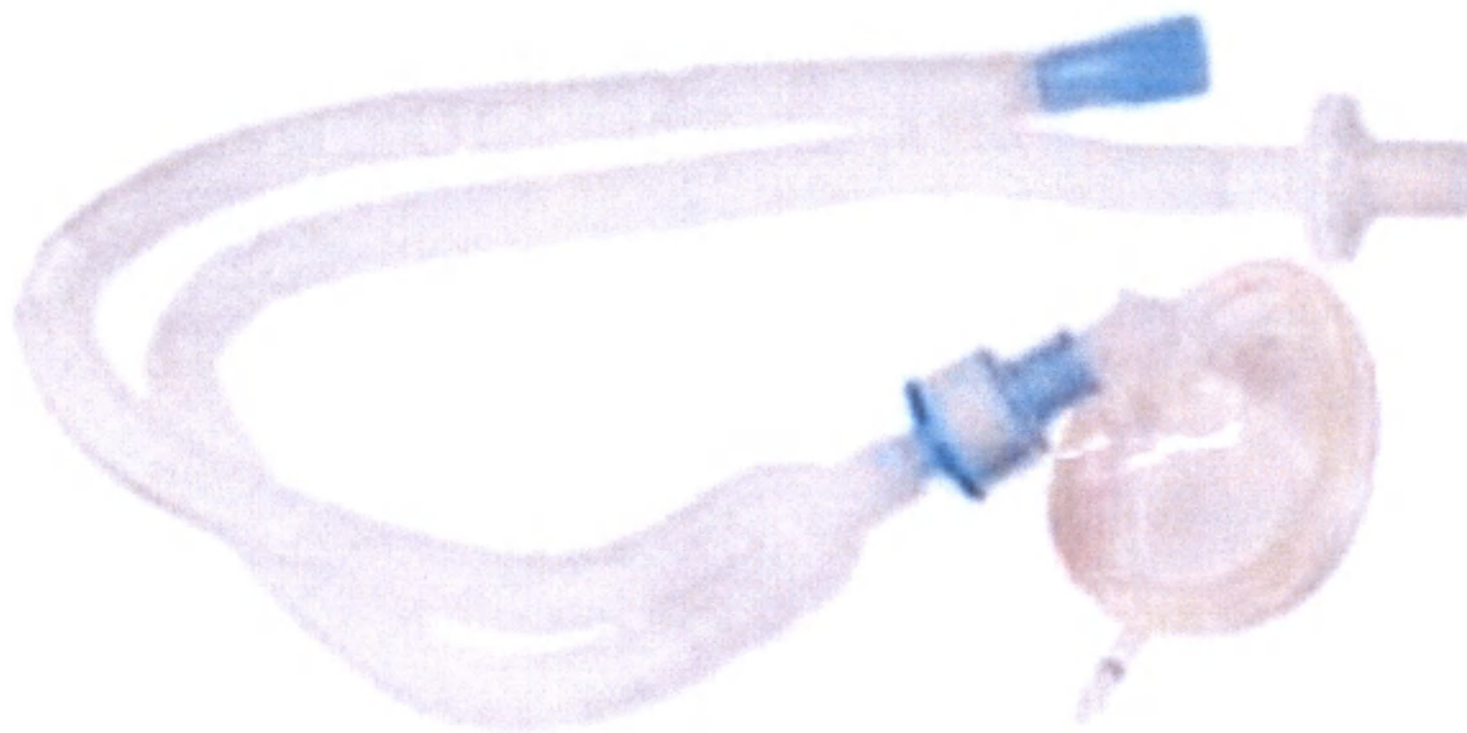




148. Контуры дыхательные одноразовые детские (не более 300 шт.).

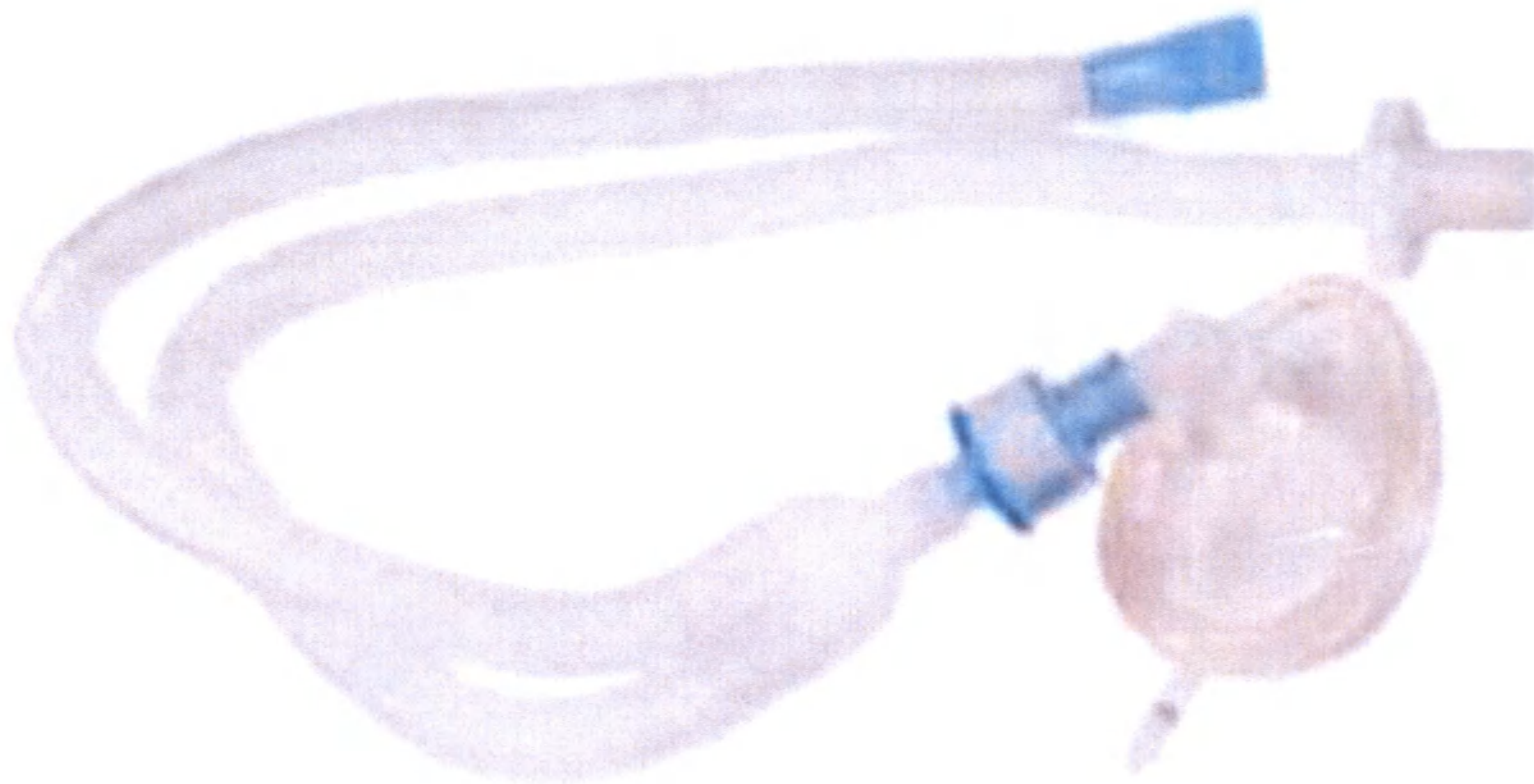



149. Контуры дыхательные одноразовые неонатальные (не более 300 шт.).

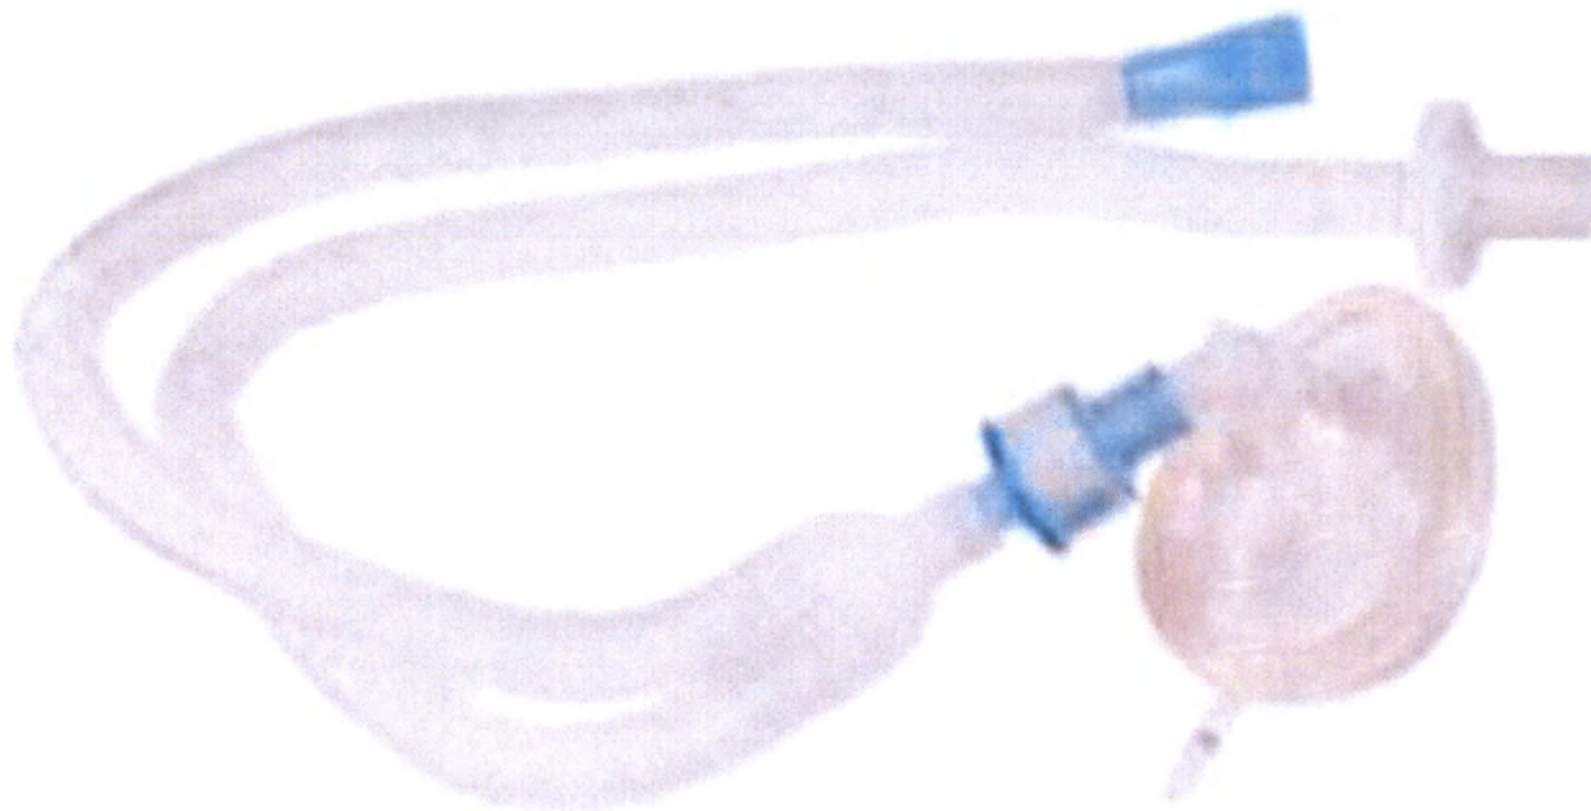



150. Маски наркозные взрослые и детские (не более 300 шт.).






151. Устройство для ручной вентиляции (не более 10 шт.).






## 152. Компрессор.

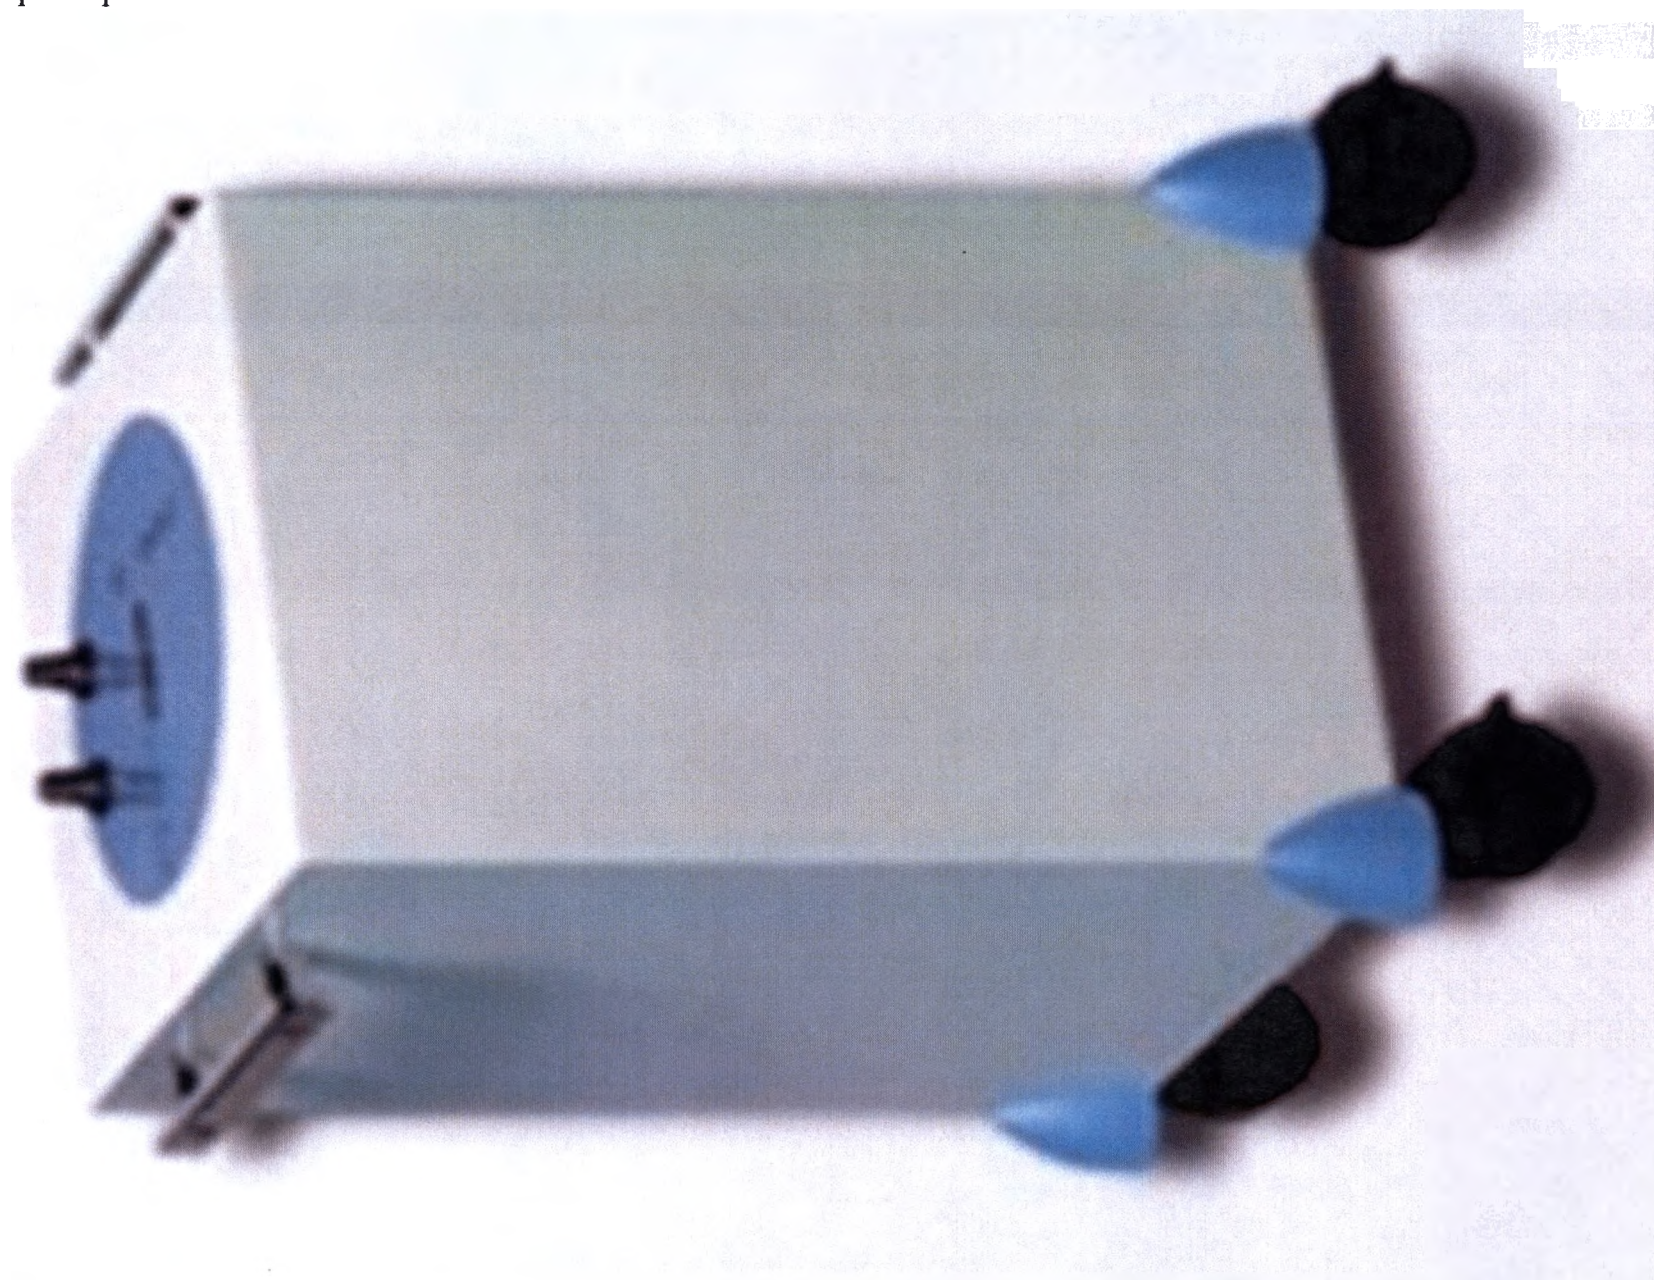



153. Водяная ловушка для компрессора.

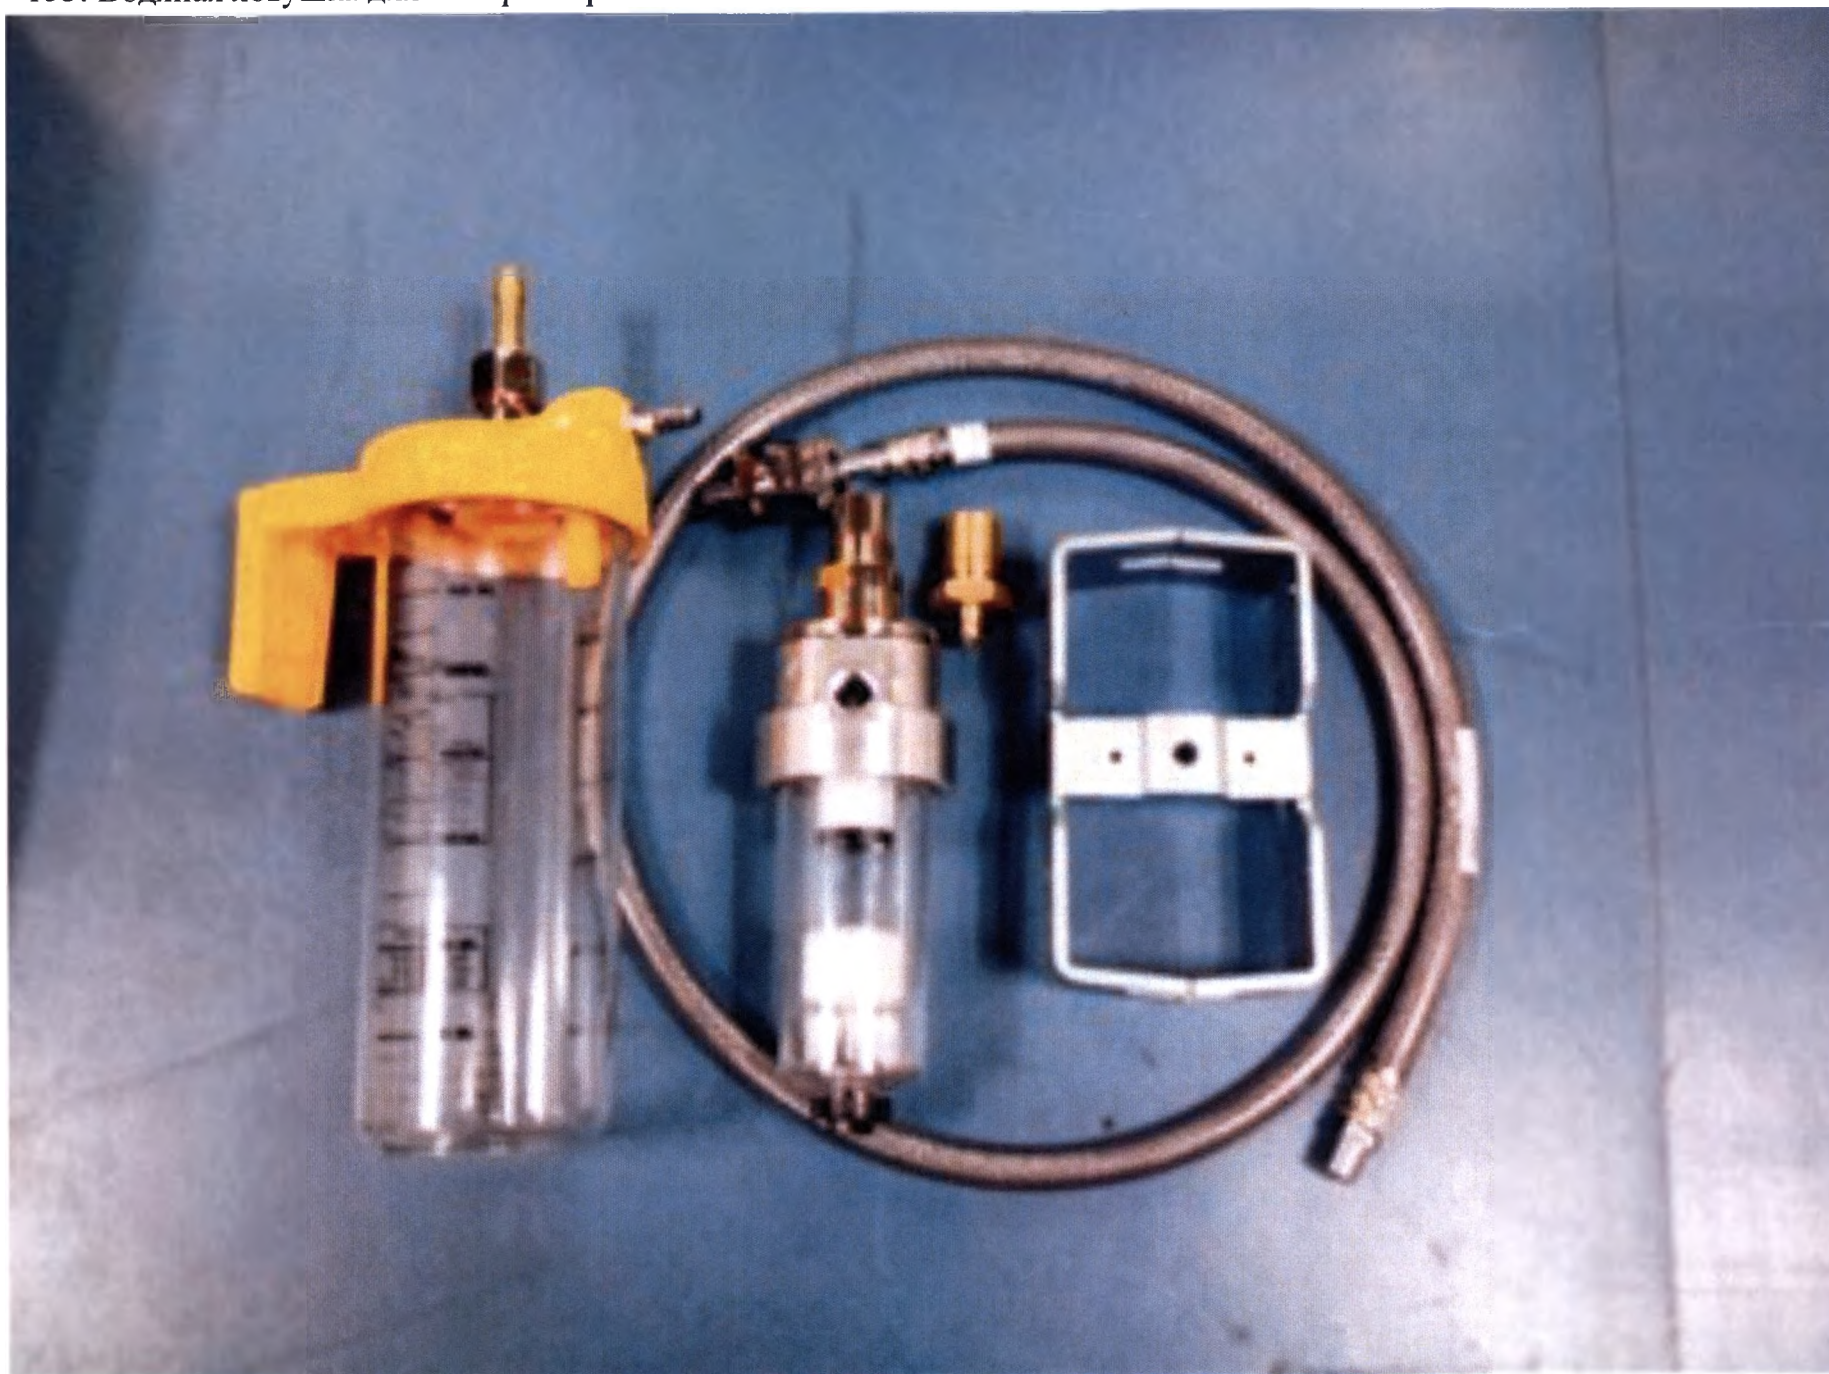




154. Водяная ловушка D-fend Pro (не более 100 шт.).





155. Водяная ловушка D-fend Pro+ (не более 100 шт.).

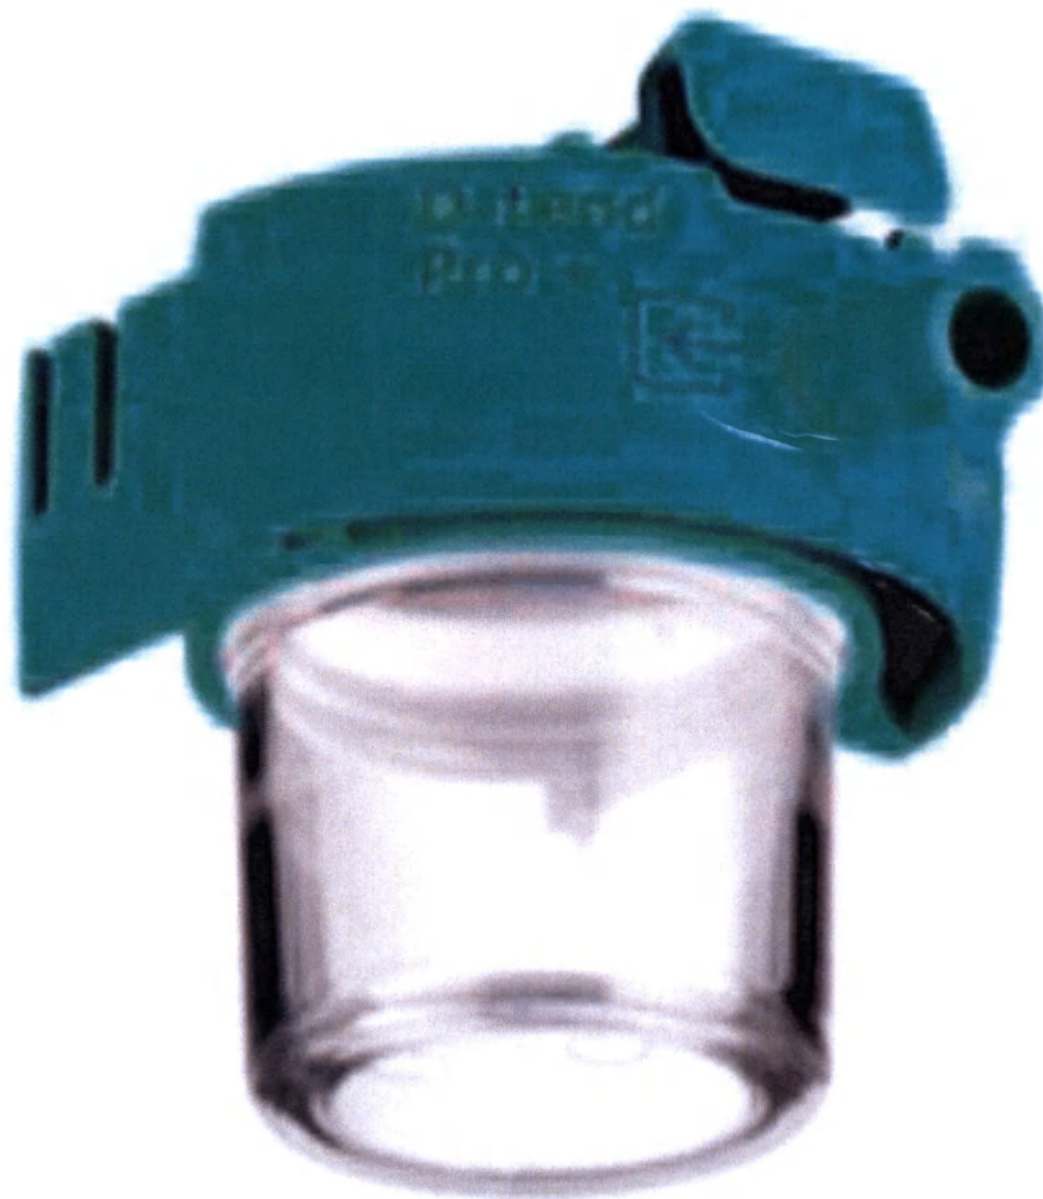



156. Поверхность рабочая с логотипом ДжиИ.





157. Поверхность рабочая без логотипа ДжиИ.






158. Поверхность рабочая для верхней полки.





159. Разъем для подключения дополнительных устройств.

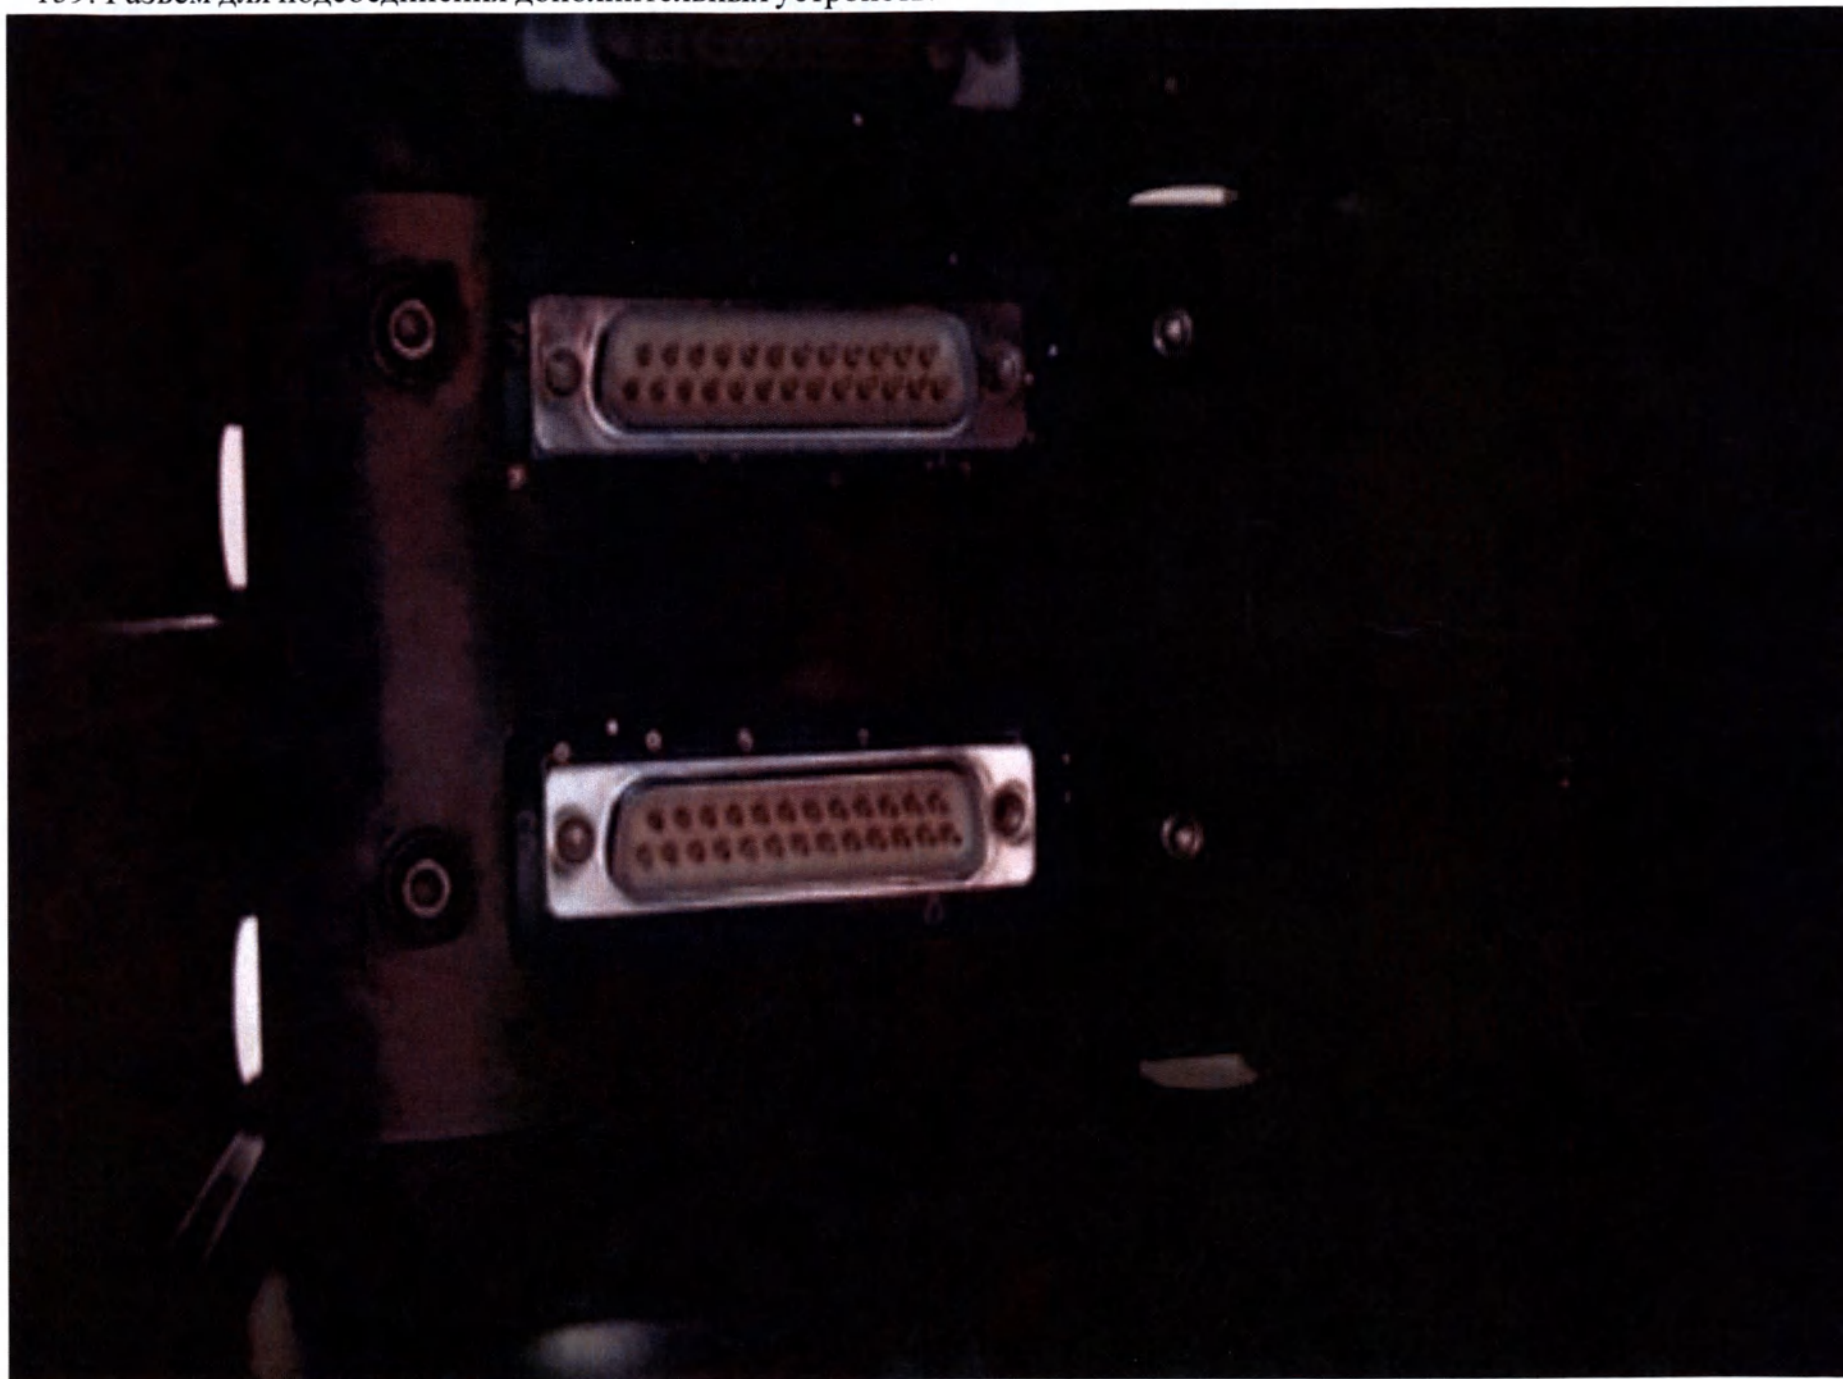



Aislys CS2

### Предоперационное тестирование

1. What is the purpose of the study?

введено перед приливом первого пациента

- [illegible]



Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 173  
(170 листов) листов 4  
Руководитель отдела регистрации и  
сертификации России и СНГ ООО  
«ДжиИ Хэлскеа» Парахина С.Б.

