


Фотографические изображения
медицинского изделия

Наборы операционные марок DURAVIT, IRIS

«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор
ООО "НПК ЛИКОСТОМ"
Бухалов Б.В.

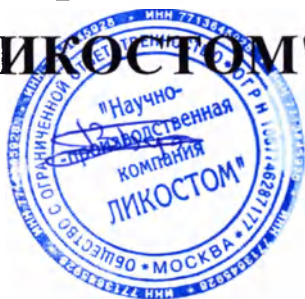


« » _____ 2017 г.





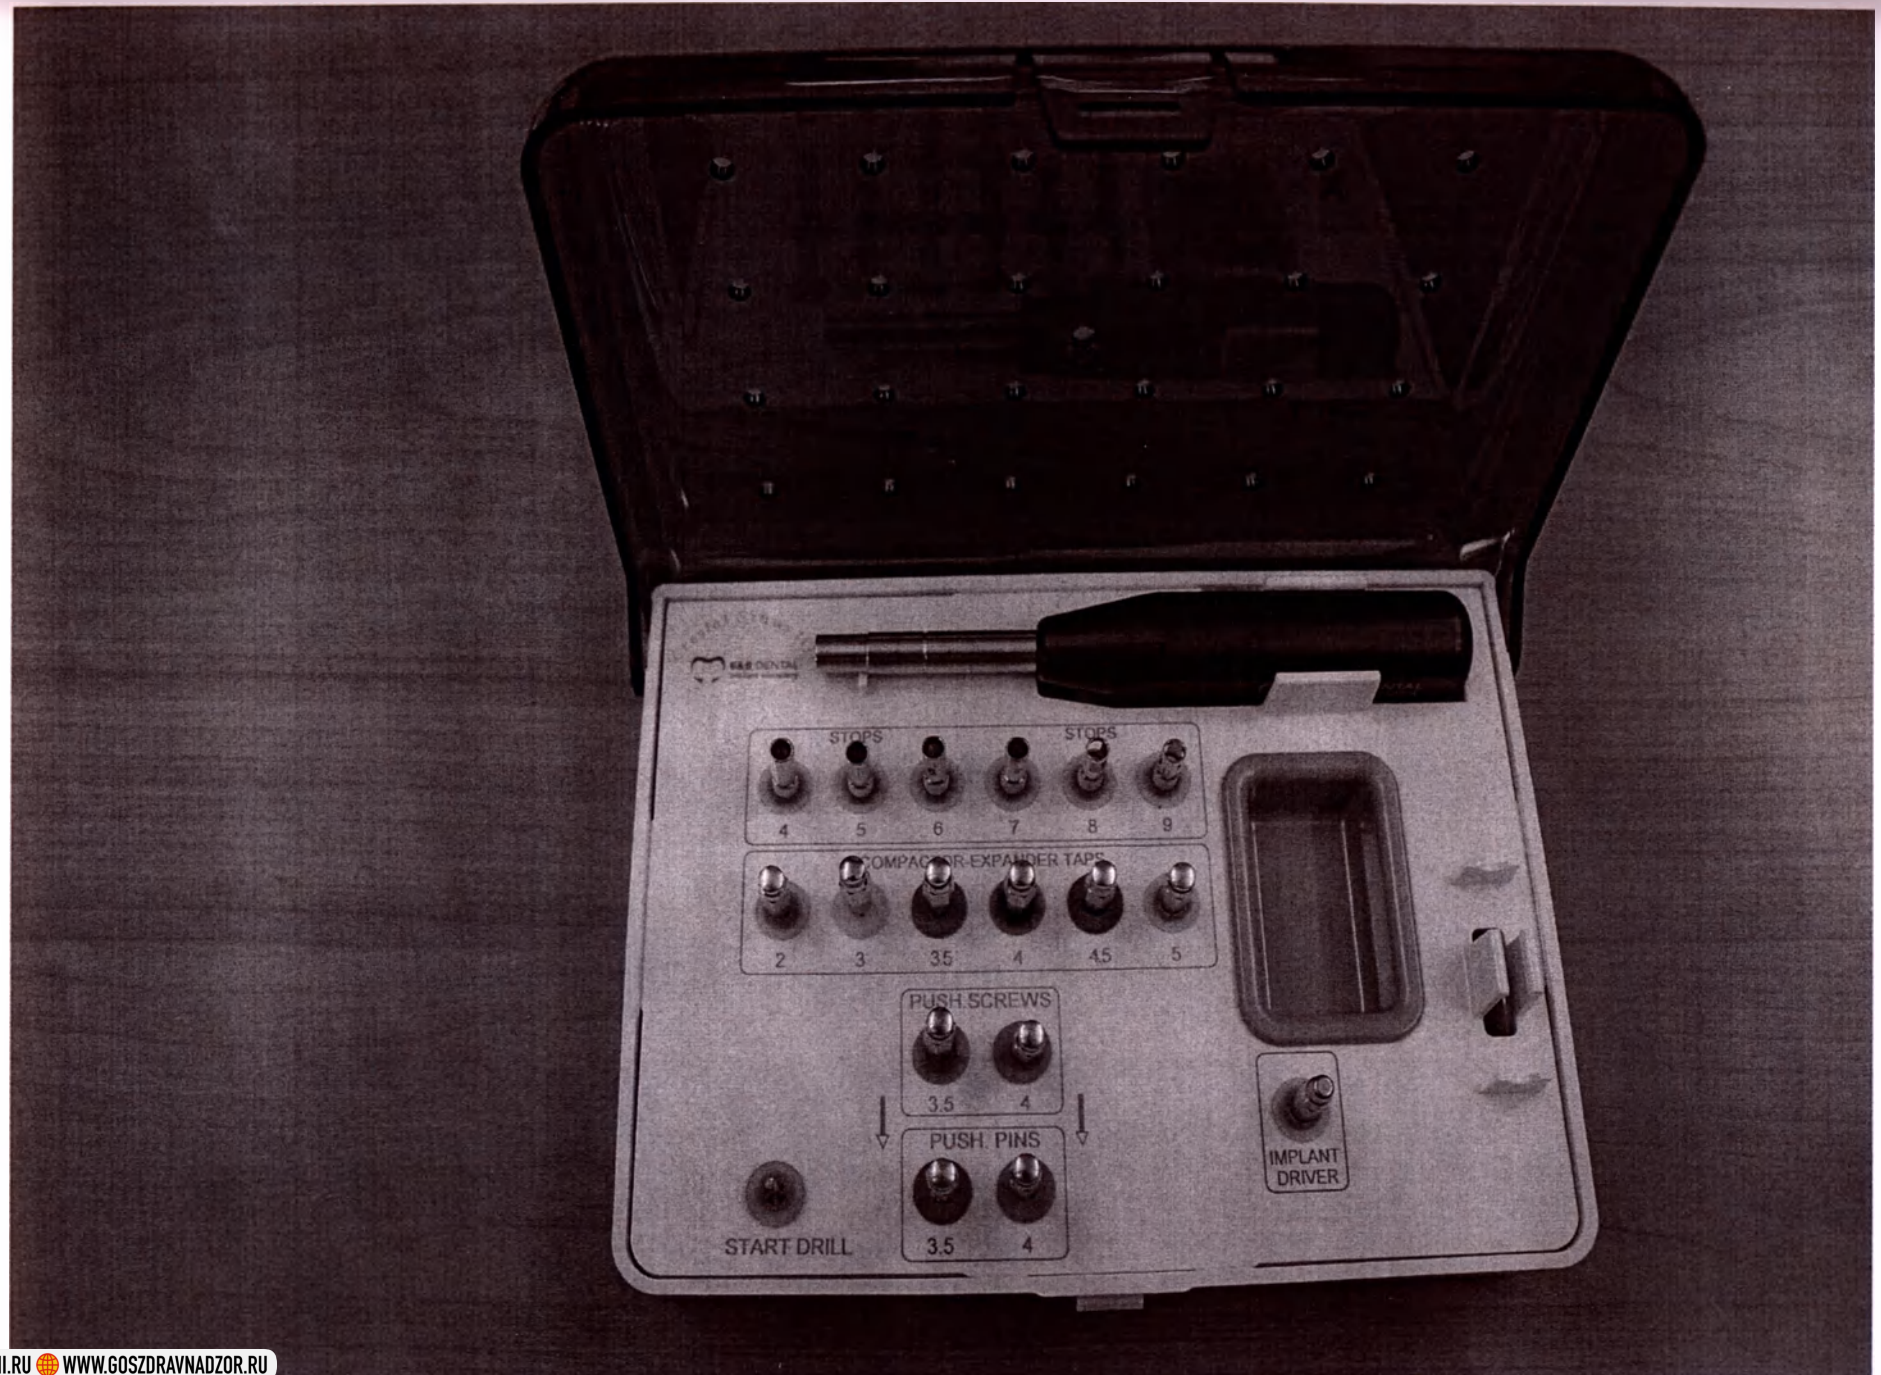



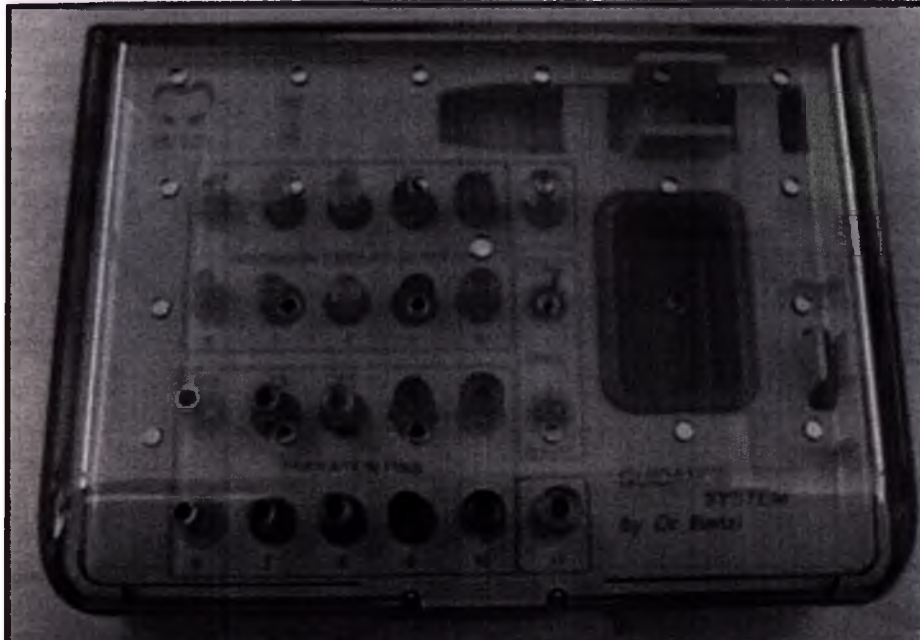

коробка для хирургического инструмента




Штифт для дистанциатора



Дистанциатор



фреза $\varnothing$ 2.1 мм

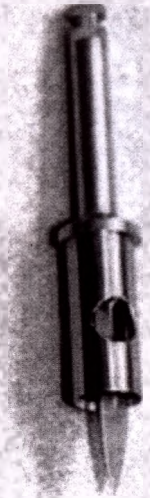

мукотом копьевидный



мукотом стандартный



коробка для хирургического инструмента



пилотный бор навигационный



мукотом навигационный



мукотом копьевидный



мукотом с накаткой



фреза для выравнивания костного гребня



фреза кортикальная навигационная



фреза коническая короткая



основная фреза навигационная



костный экспандер навигационный короткий



костный экспандер навигационный



костный профайлер
навигационный



конвертер



ключ для маунтера навигационный



имплантовод имплантатов $\varnothing 3,0$ мм
для ключа-трещотки навигационный



имплантовод для ключа-трещотки
навигационный



ортопедический ключ короткий



ключ для установки угловых абатментов



ортопедический ключ длинный



насадка для установки прямых универсальных абатментов



динамометрический ключ-трещотка




маунтер навигационный, $\varnothing$ от 3,0 мм до 6,0 мм




пилотный бор для латеральных пинов



крестальный винт $\varnothing$ от 3,0 мм до 7,0 мм,
длиной от 6,0 мм до 12,0 мм

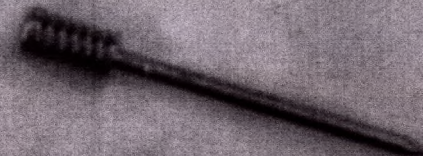


латеральный пин

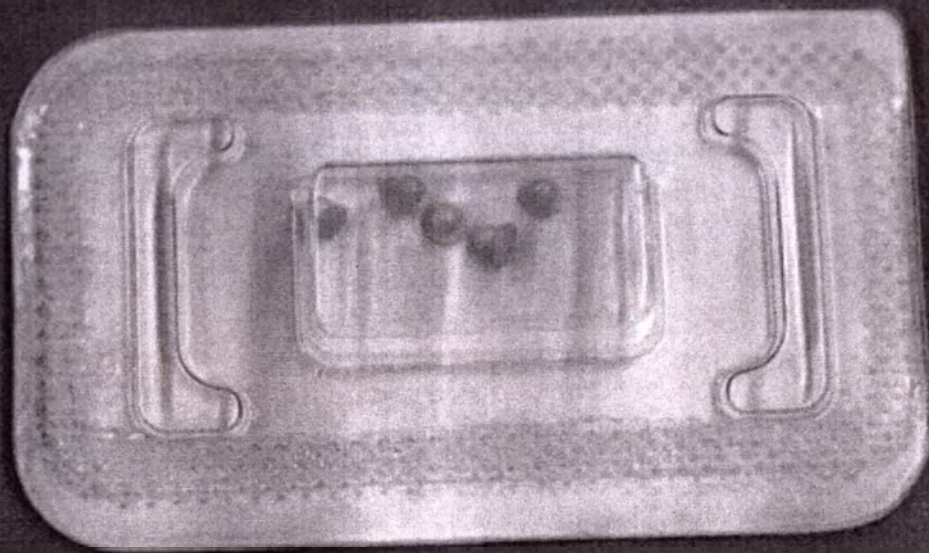

маркеры для изготовления шаблона, 5 штук



навигационная втулка титановая,
от 3,0 мм до 6,0 мм

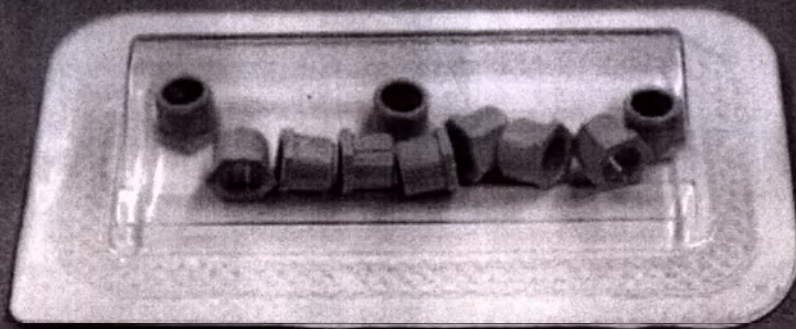

навигационная втулка с шестигранником, $\varnothing$ от 3,0 мм до 6,0 мм



навигационная втулка с латеральным

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

15

лист(а) (ов)

