



Фотографические изображения медицинского изделия

Система рентгеновская Discovery XR656 с принадлежностями



УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
регистрации и сертификации
Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»

С.Б. Парахина

« 12 » февр. 2018г.



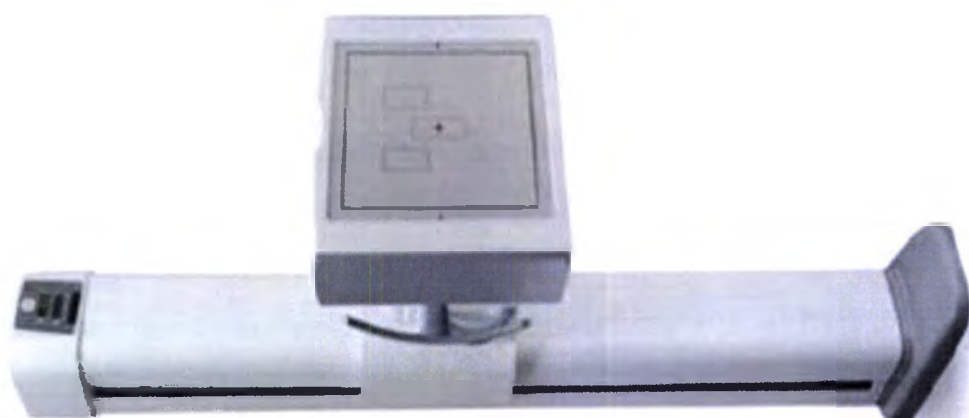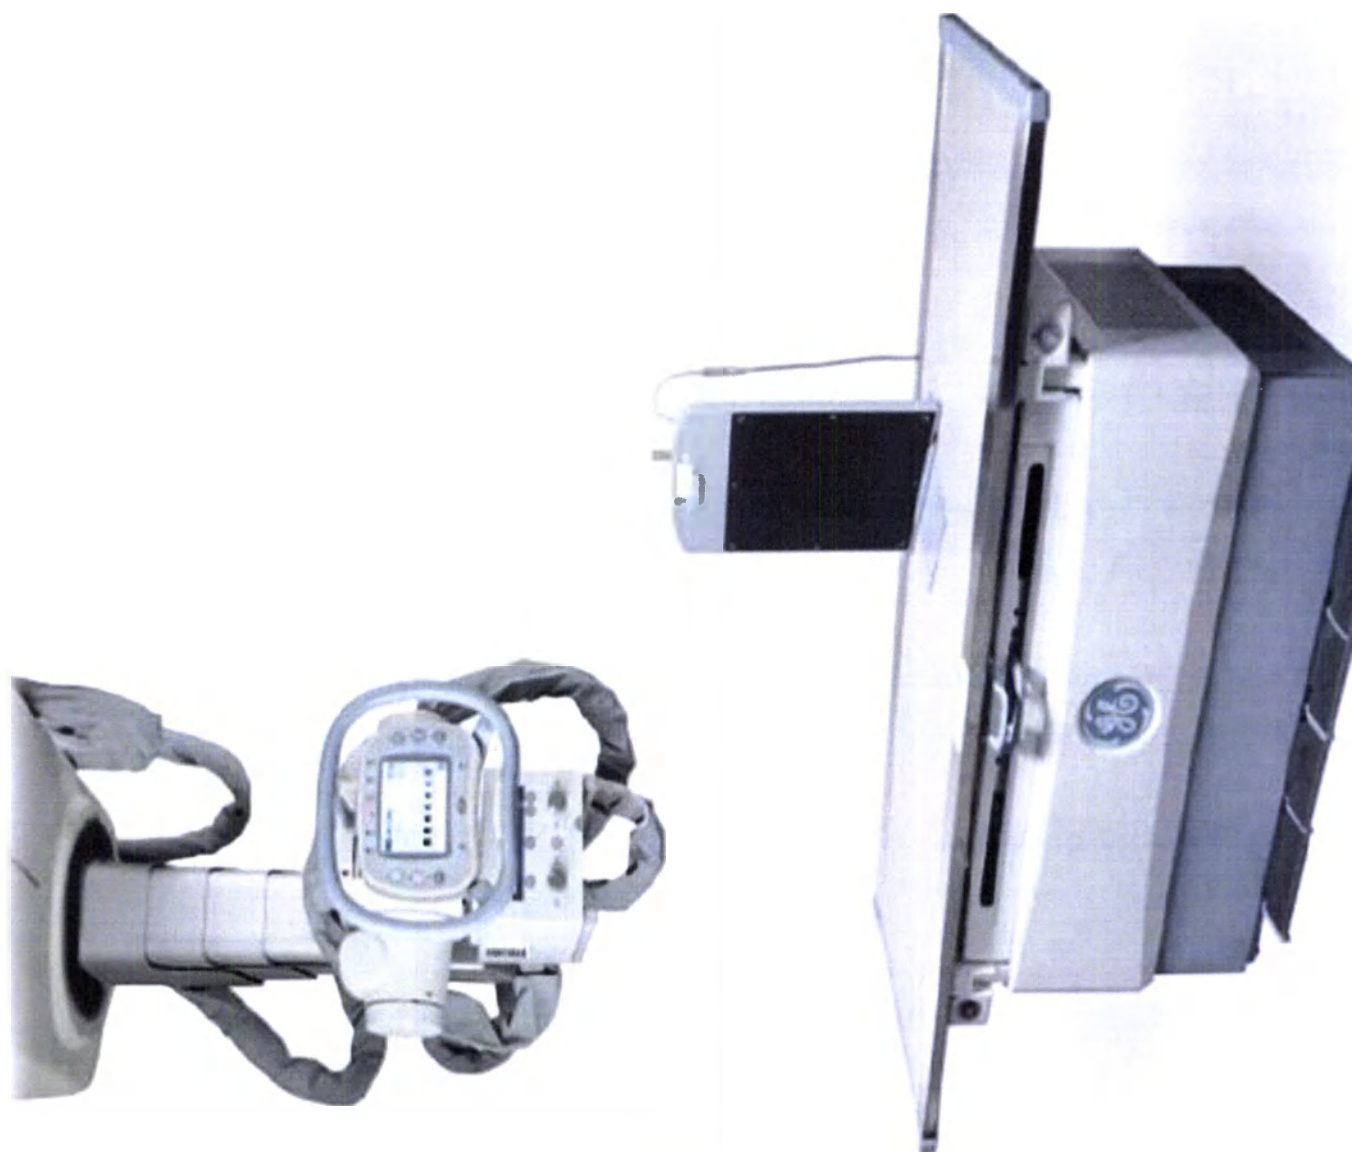

GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS CO. Ltd

N° 1 Yong Chang North Road Beijing Economic Technological
Development Zone BEIJING 100176 CHINA **Сделано в Китае**

Описание: Система рентгеновская

Модель: Discovery XR656

Серийный номер:

Произведено:


Источник: 380/400/420/440/460/480V, 3~, 50/60Hz

Входной ток: 195A (Переменный), 45A (Постоянный)







2. Рентгеновская трубка.

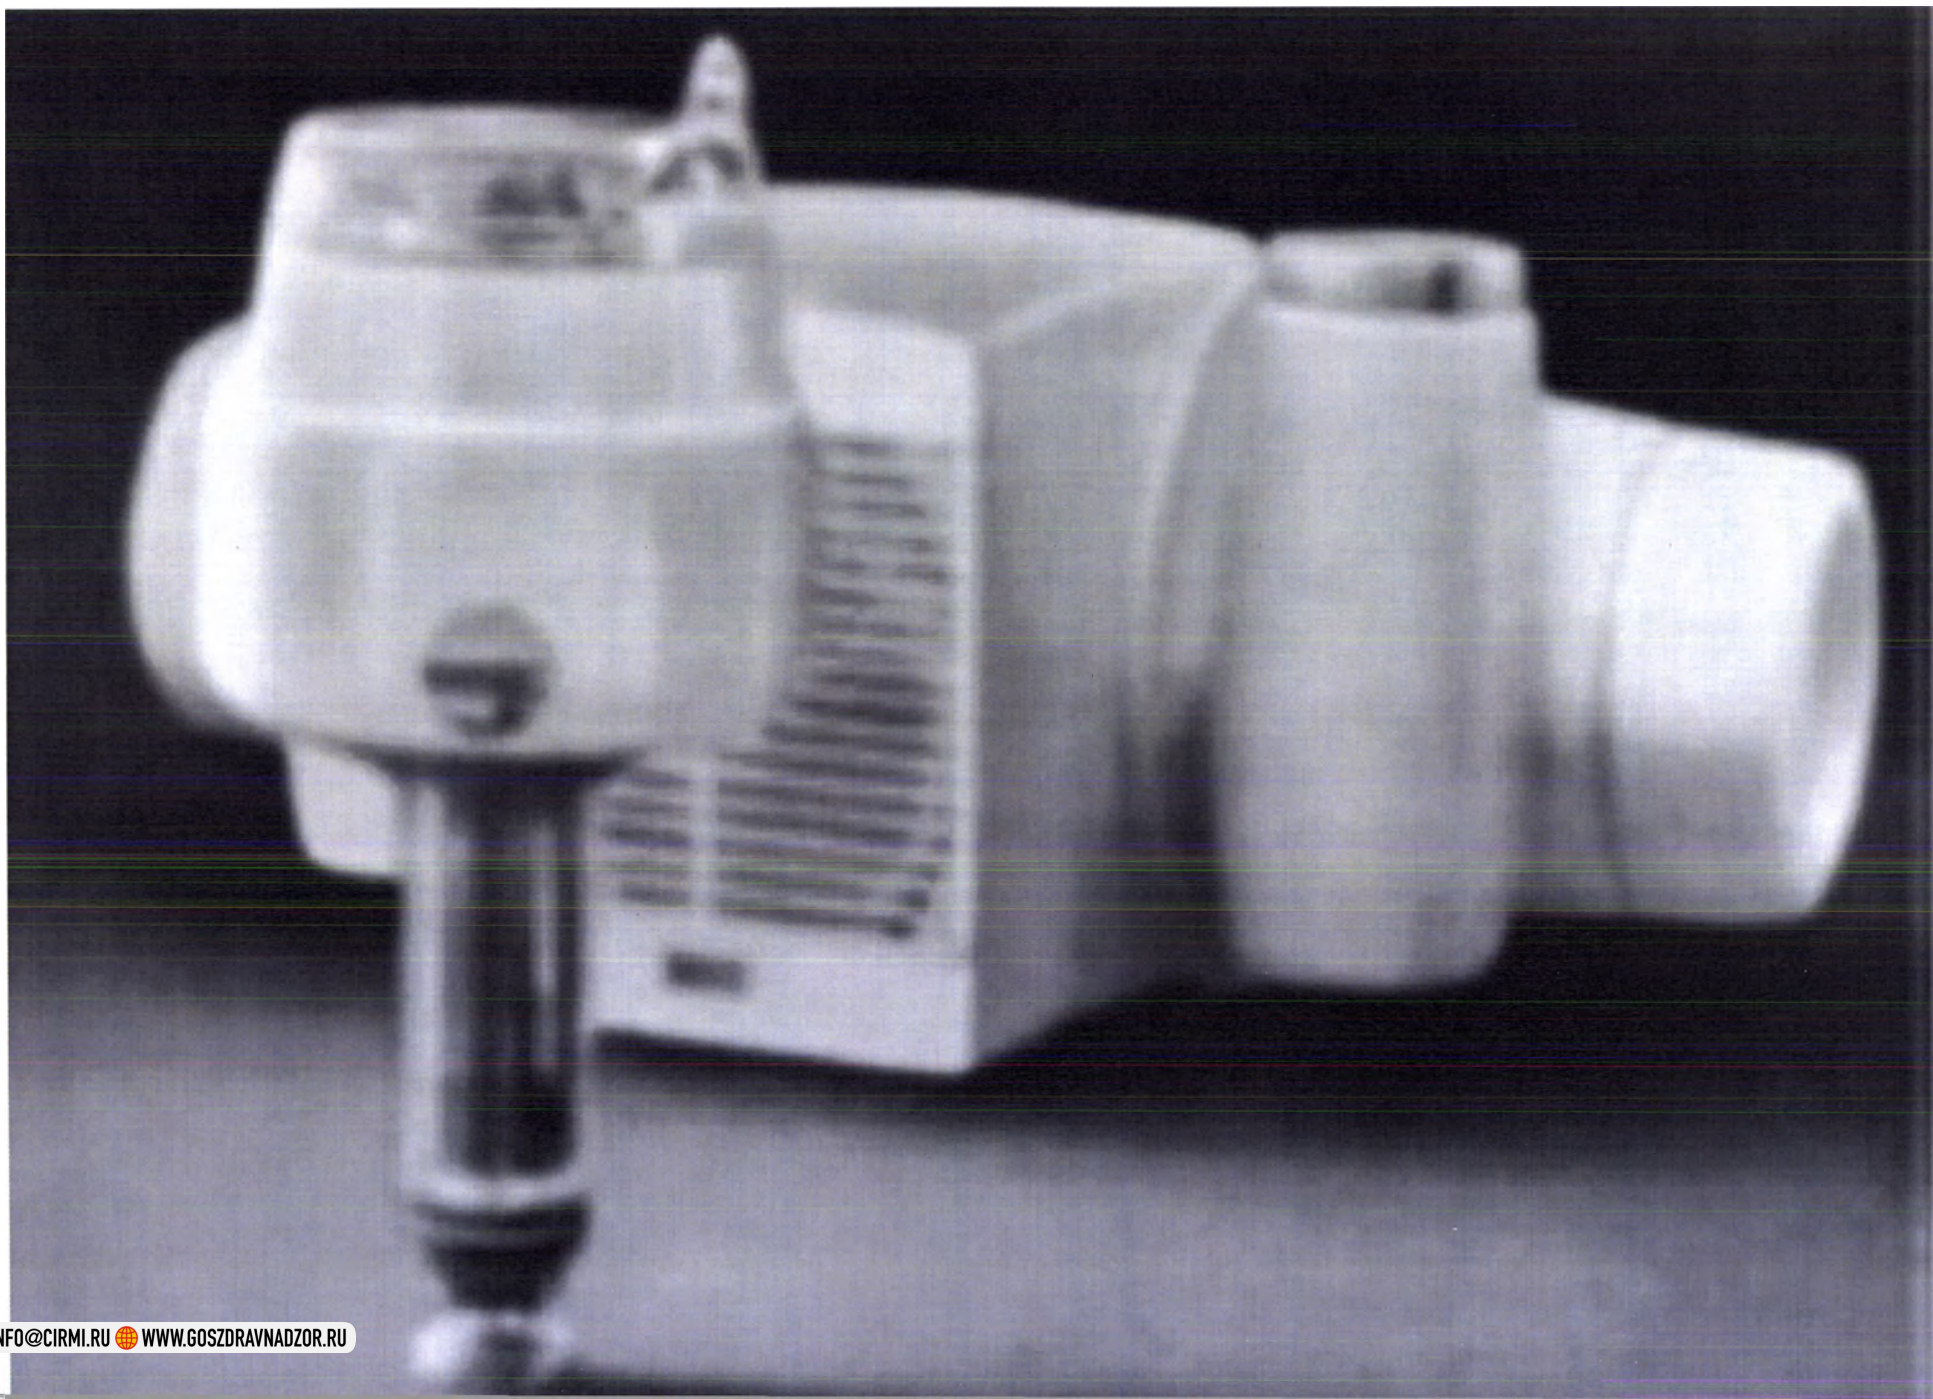

3. Коллиматор.

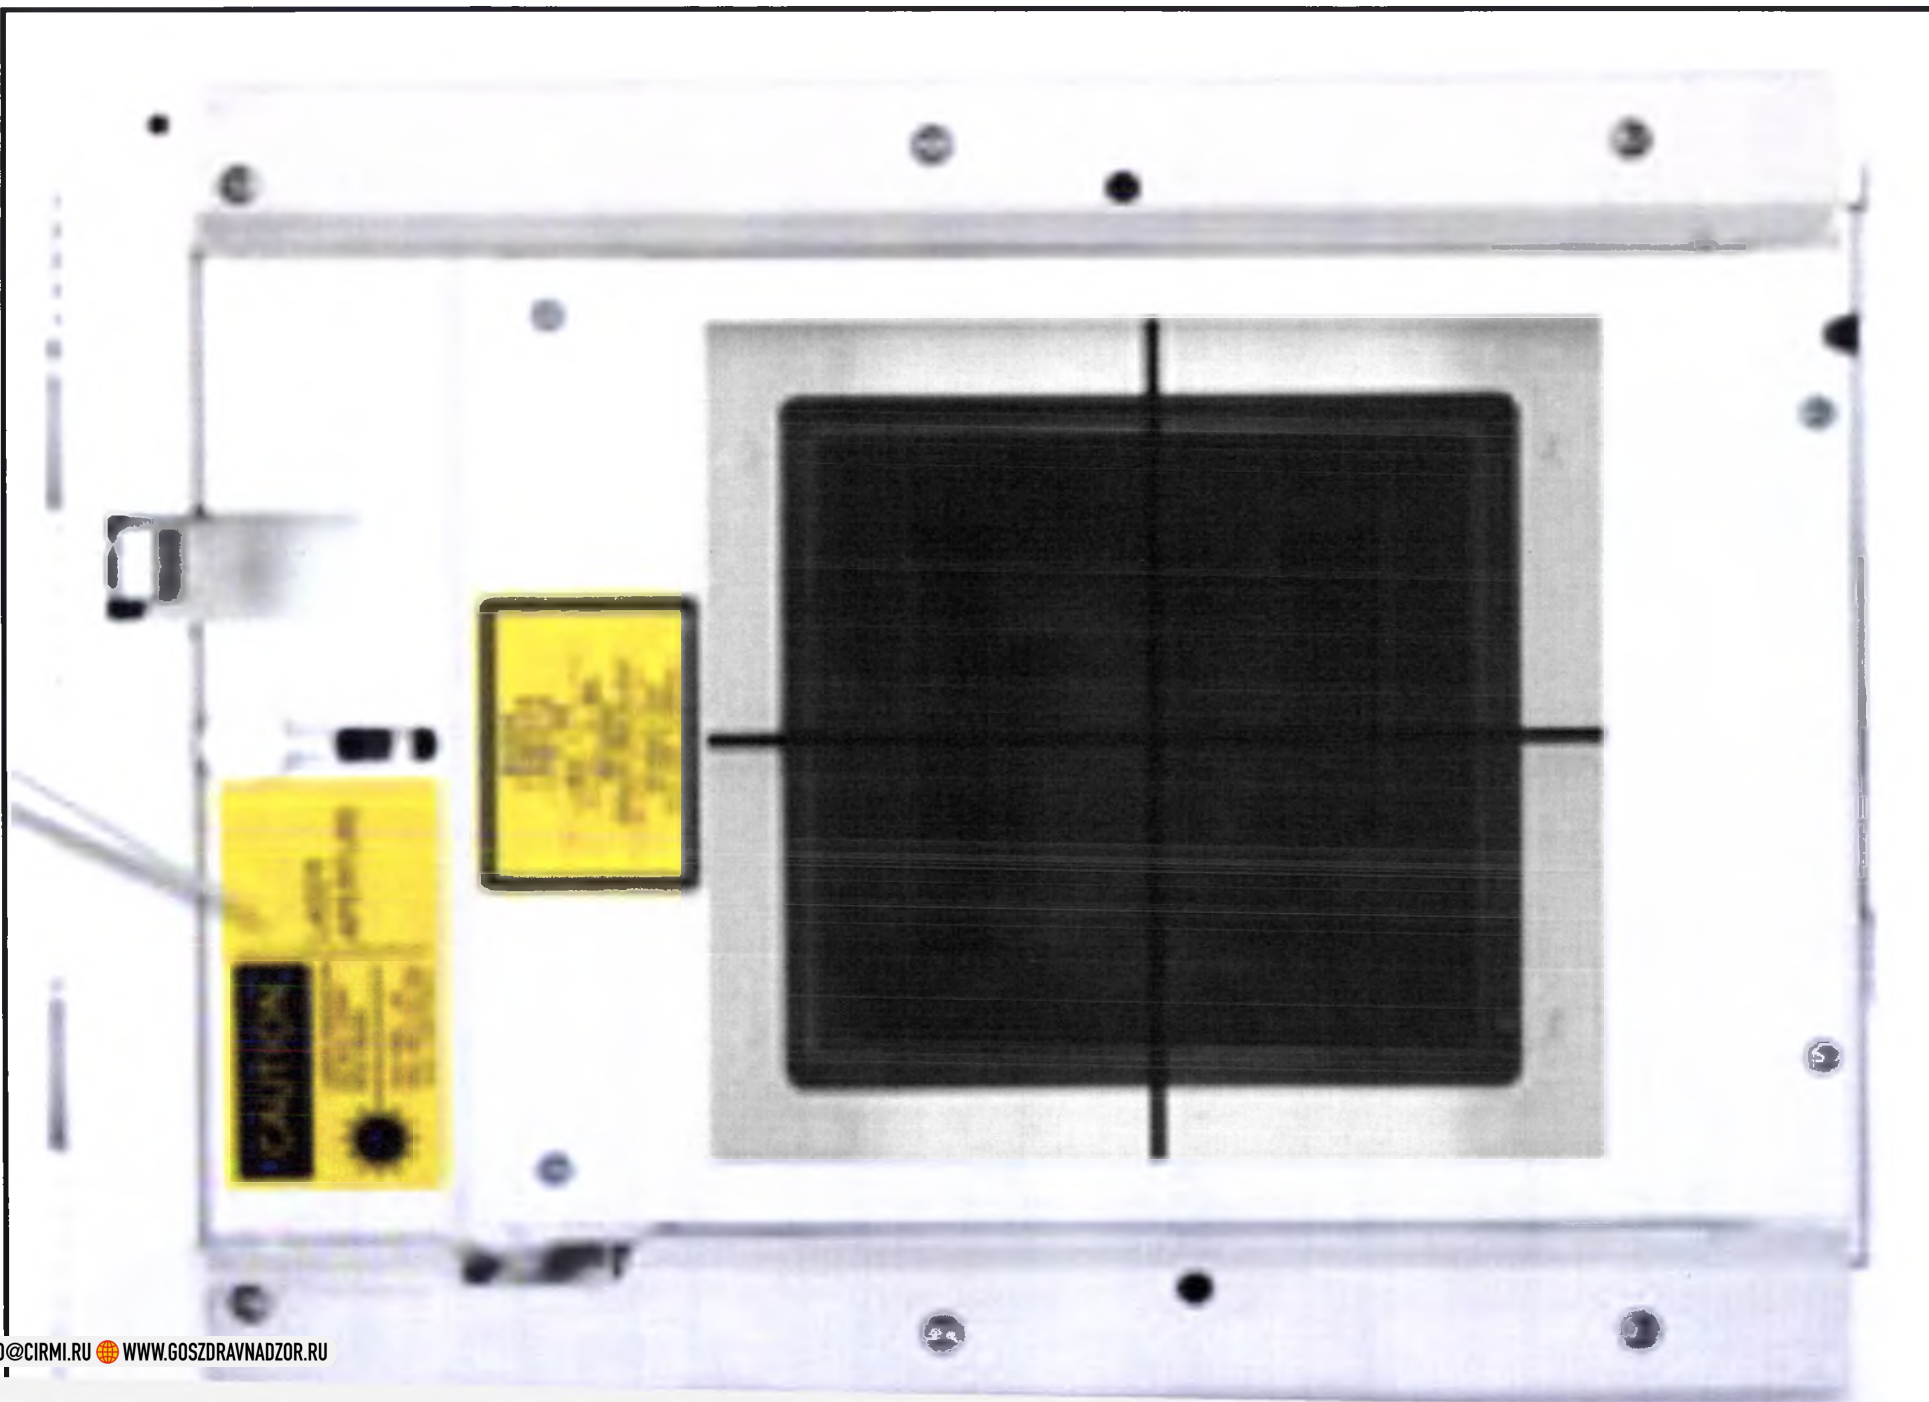

4. Высокочастотный генератор.

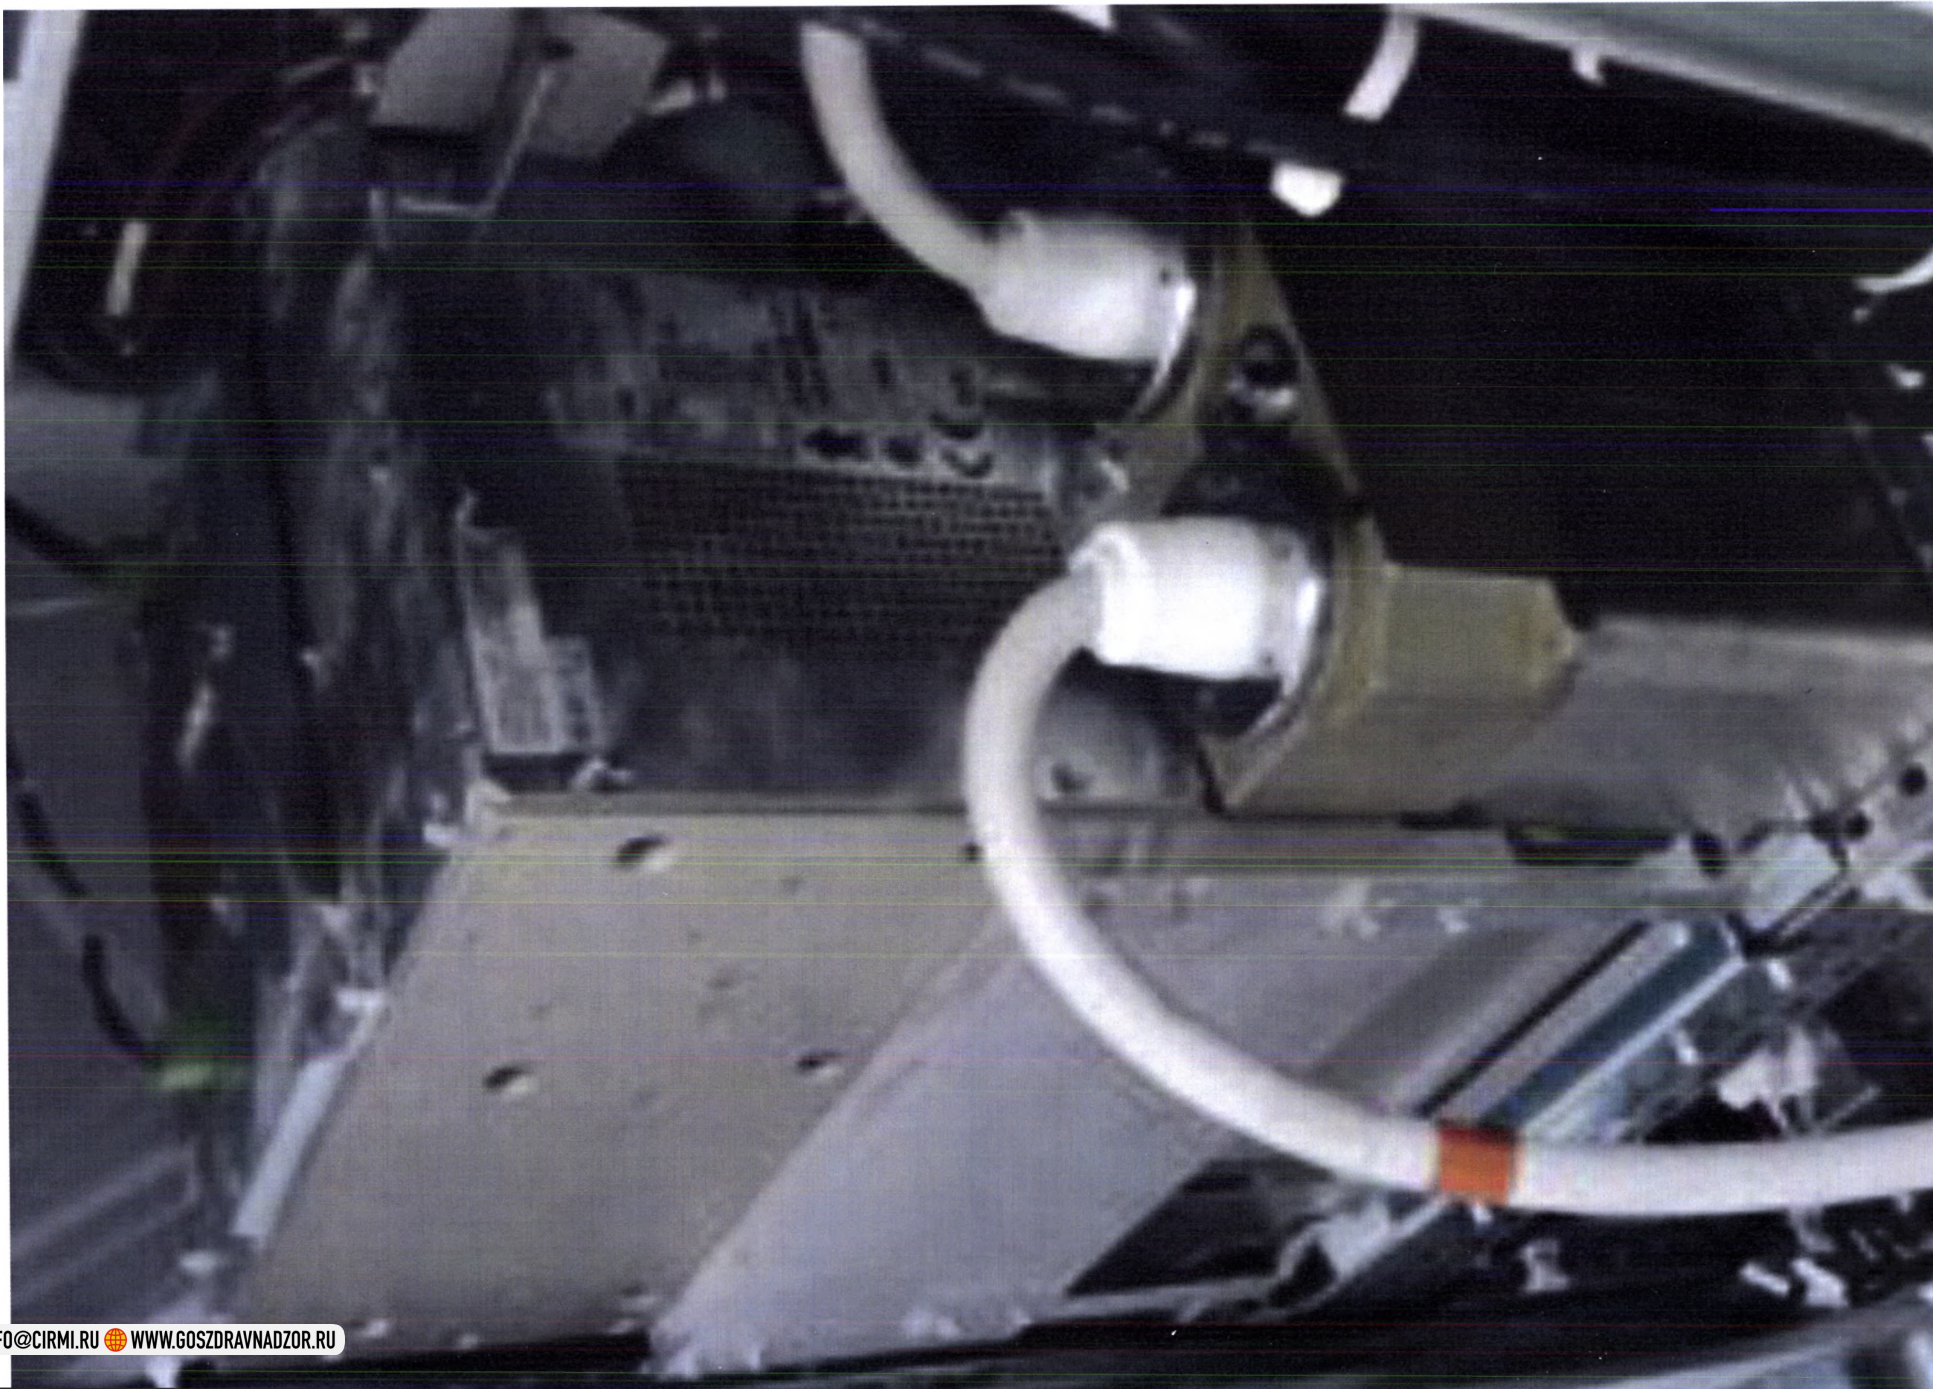

5. Пульт управления системой.



II. Принадлежности: 1. Аккумуляторы для детектора (не более 6 шт.).



2. Антенны для сети Ultrawideband (не более 2 шт.).



3. Беспроводные детекторы FlashPad (не более 3 шт.).



4. Держатели для отсеивающей решётки (не более 2 шт.).




5. Держатели для детектора (не более 2 шт.).



6. Зарядные устройства для детектора (не более 2 шт.).



7. Дозиметрические устройства (не более 2 шт.).

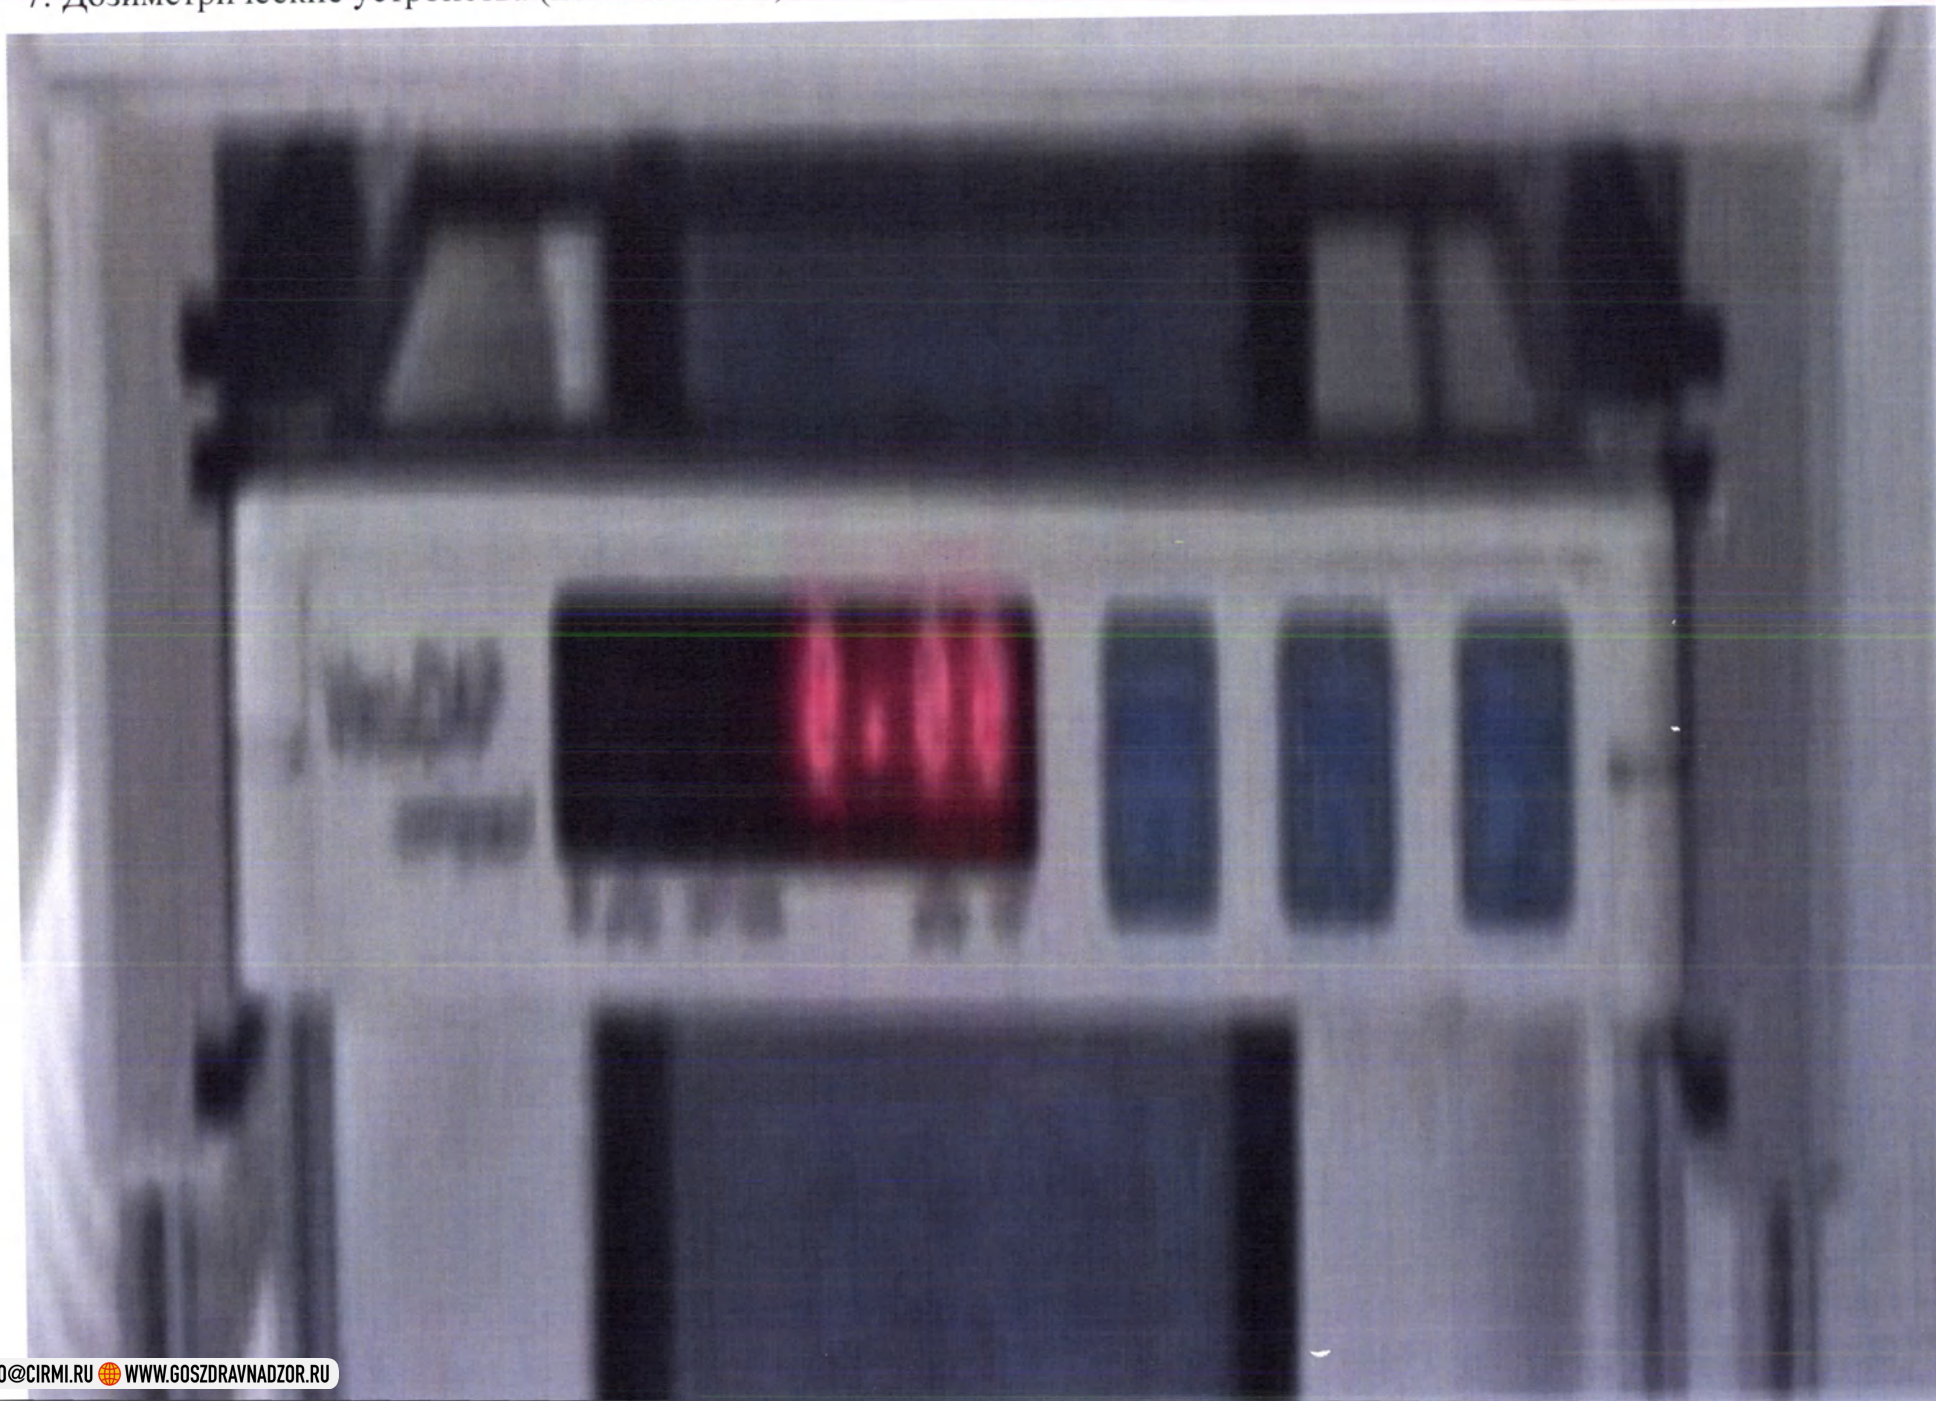

8. Дополнительные расширяющие потолочные мосты (не более 2 шт.).



9. Зарядные устройства для аккумуляторов беспроводного детектора (не более 3 шт.).





Цифровая рентгенографическая система Discovery* XR656

Руководство оператора

5495857-1RU Ред. 2

© General Electric Company, 2014. Все права сохранены.

* Discovery является зарегистрированным товарным знаком компании General Electric.

11. Инфракрасные пульты дистанционного управления (не более 2 шт.).




12. Источники бесперебойного питания (не более 2 шт.).




13. Кабели (не более 20 шт.).



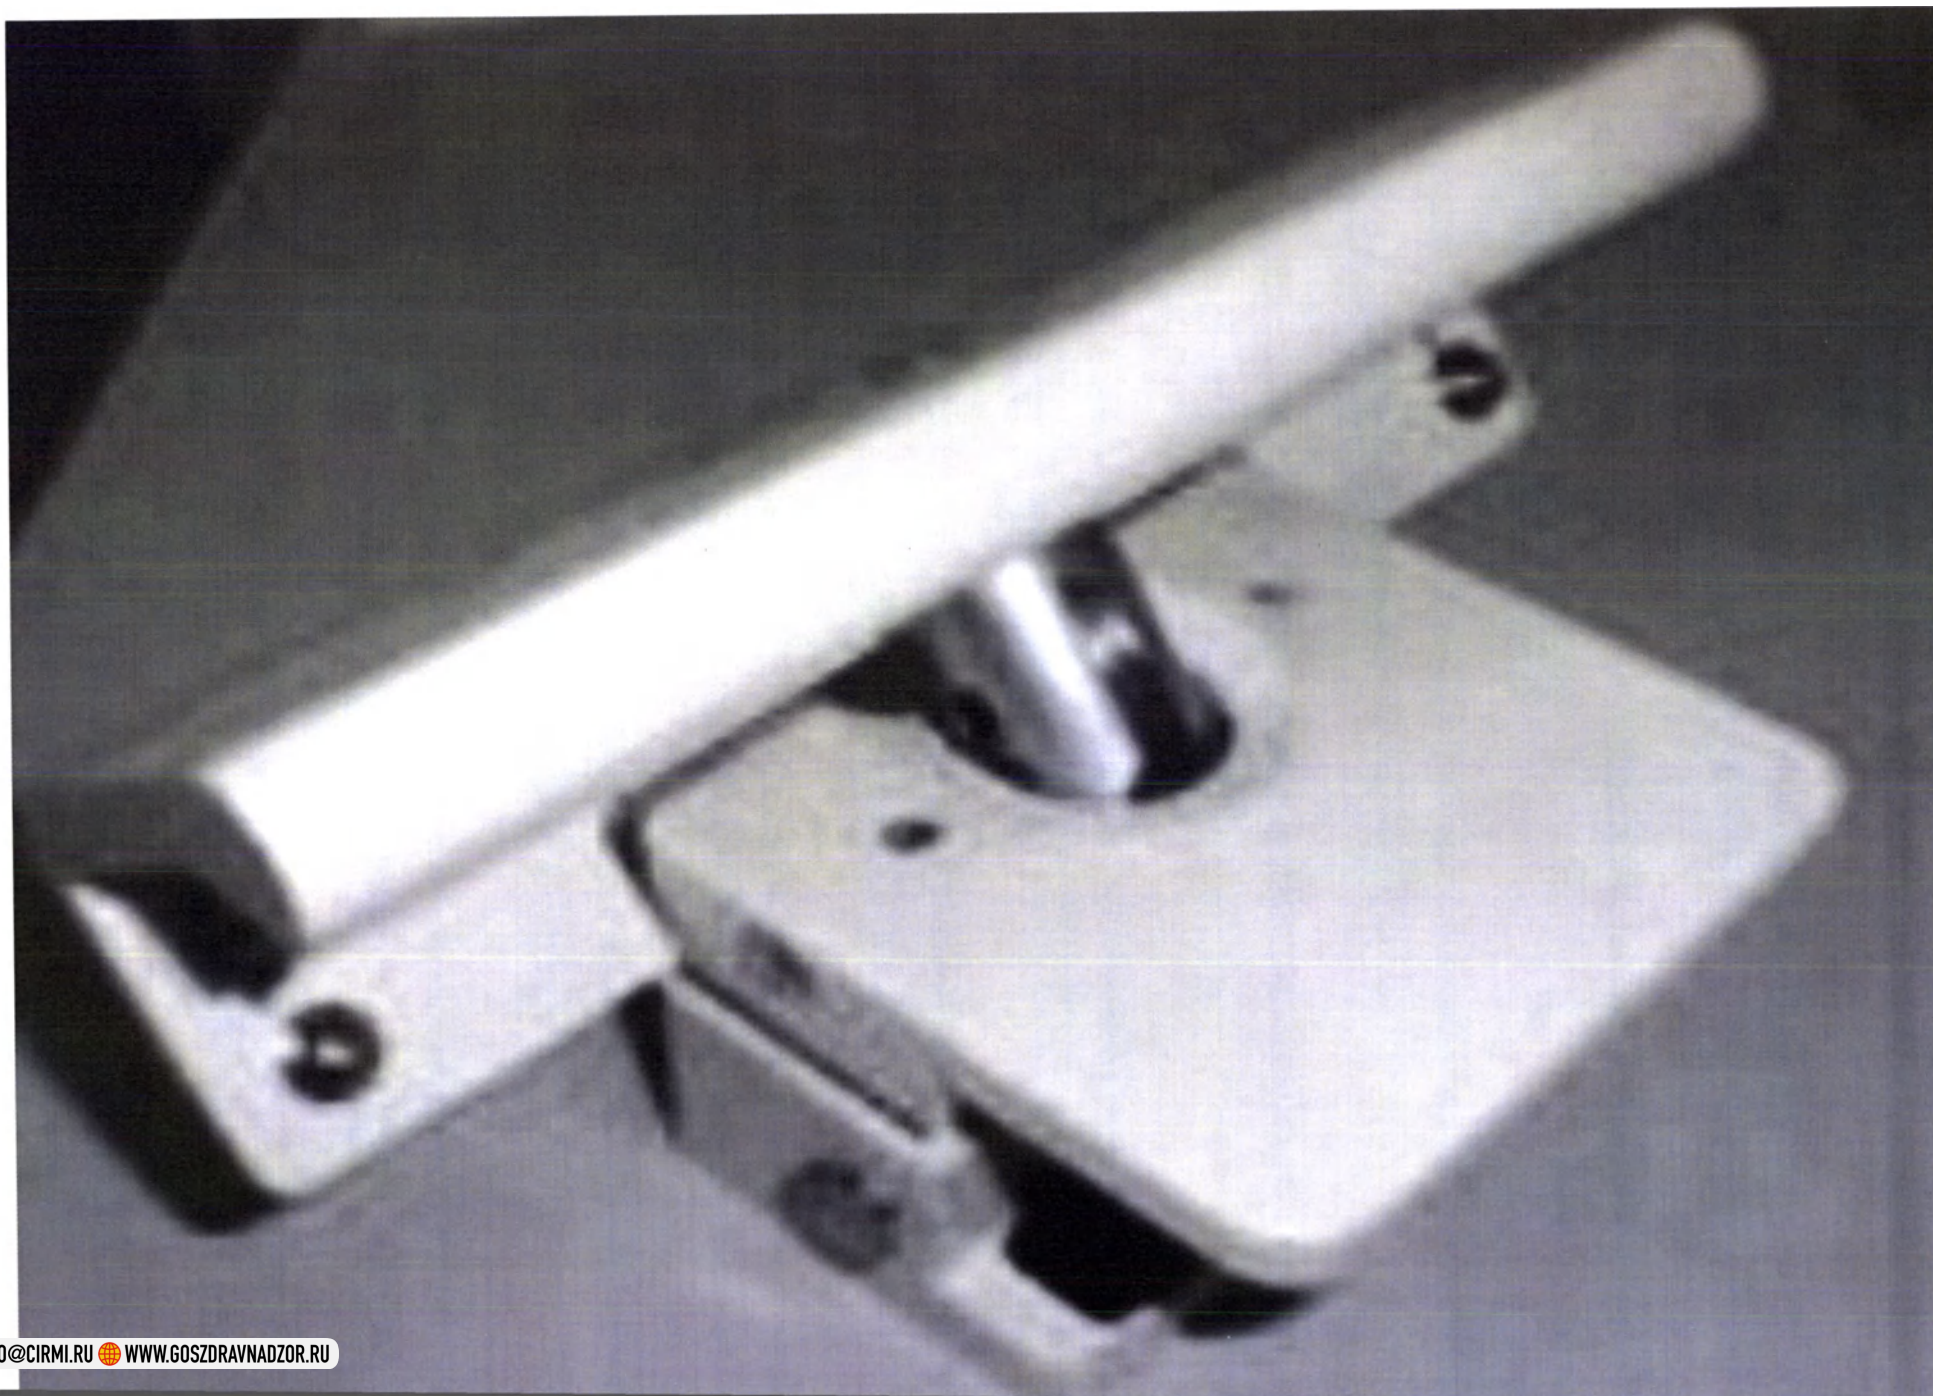

14. Компрессионный ремень.

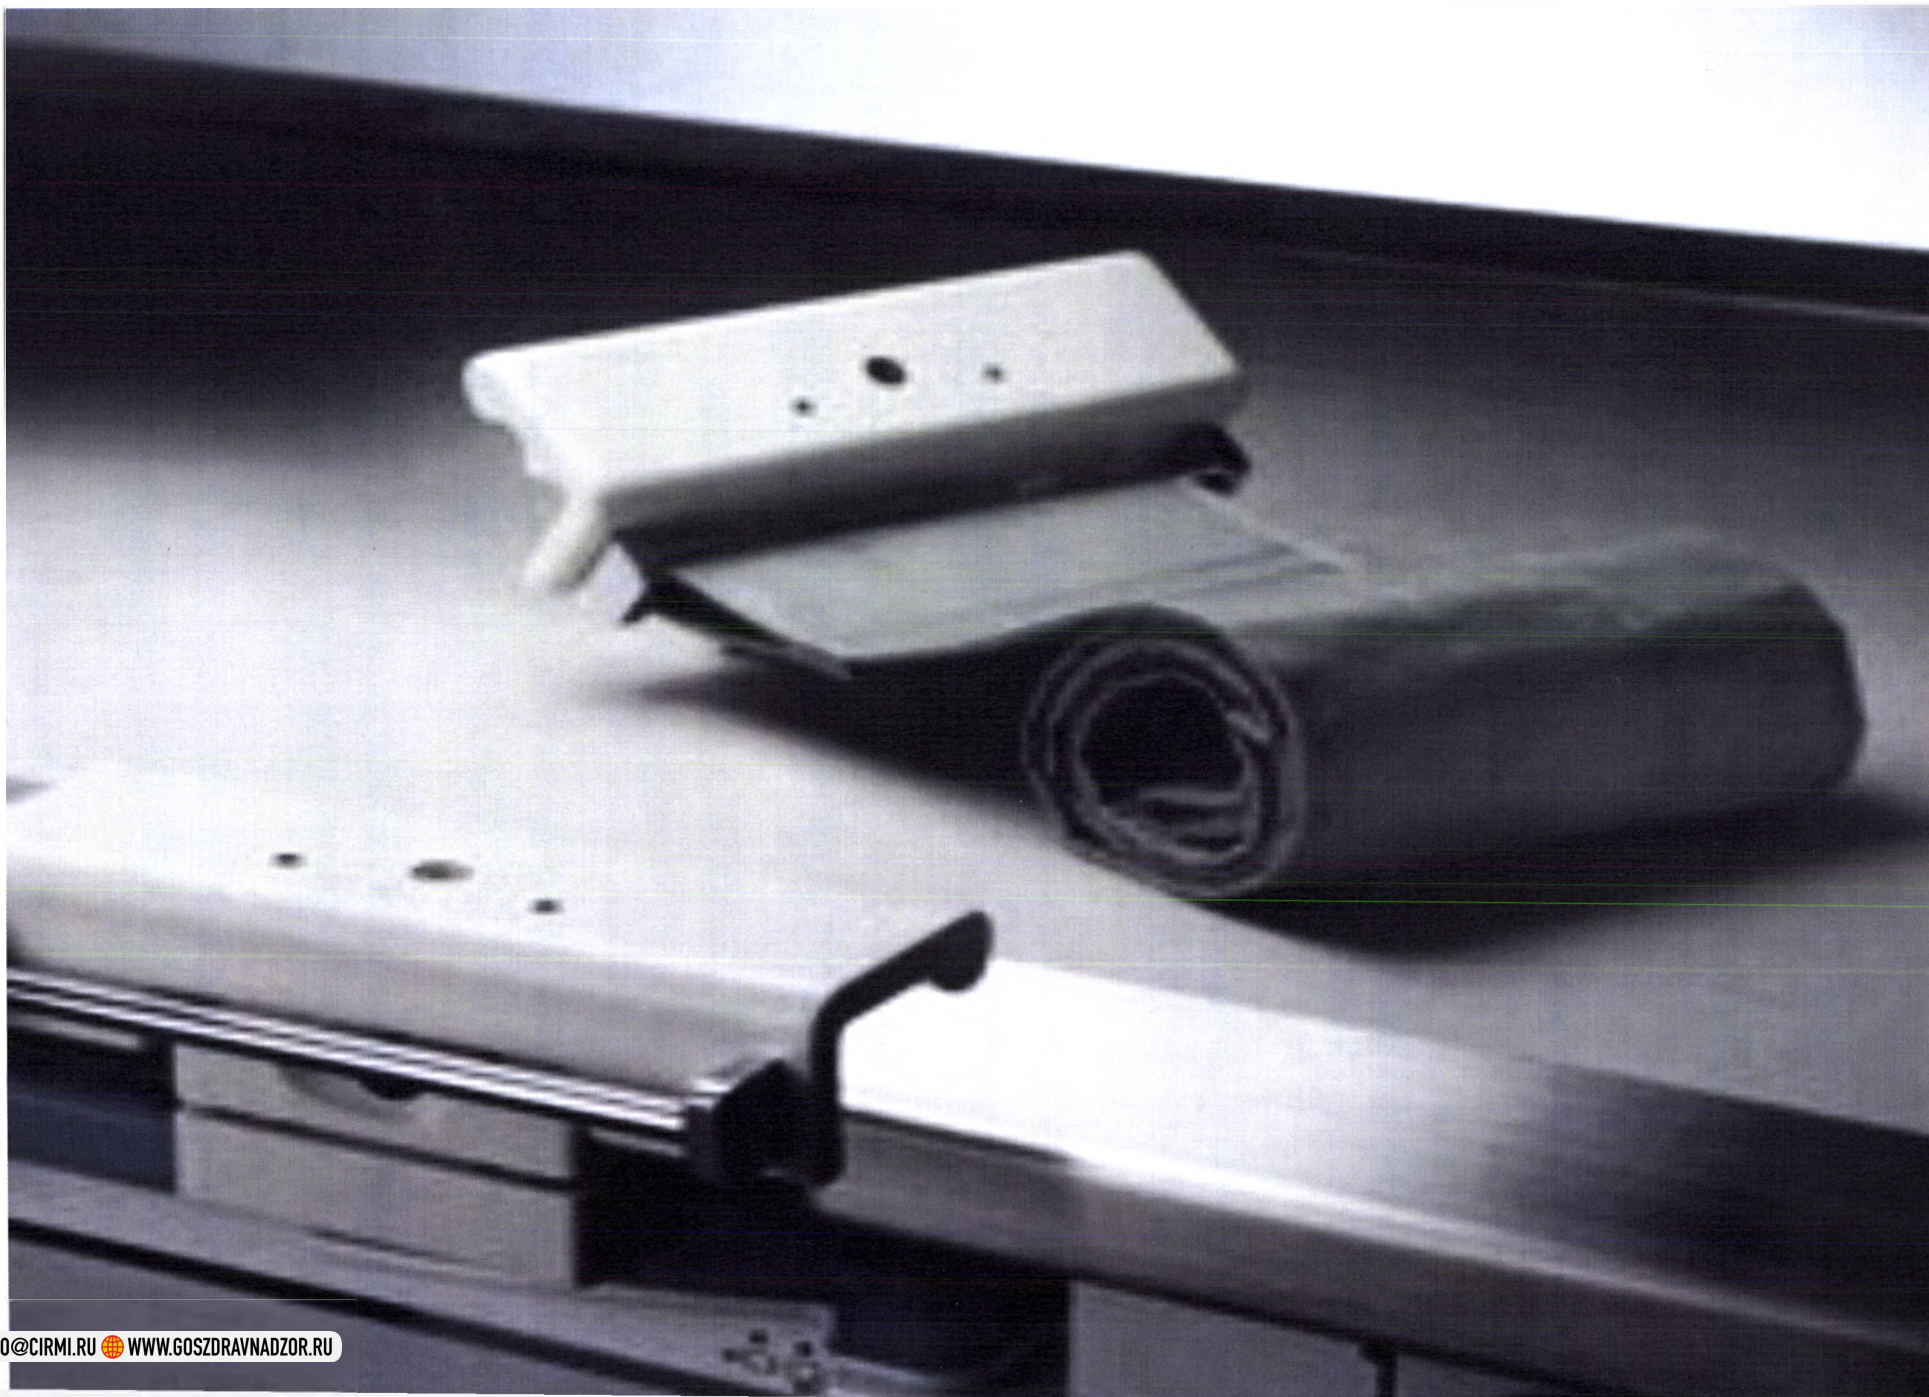


15. Мобильные держатели для беспроводного детектора (не более 2 шт.).



16. Мобильные рентгенографические столы (не более 2 шт.).




16. Мобильные рентгенографические столы (не более 2 шт.).

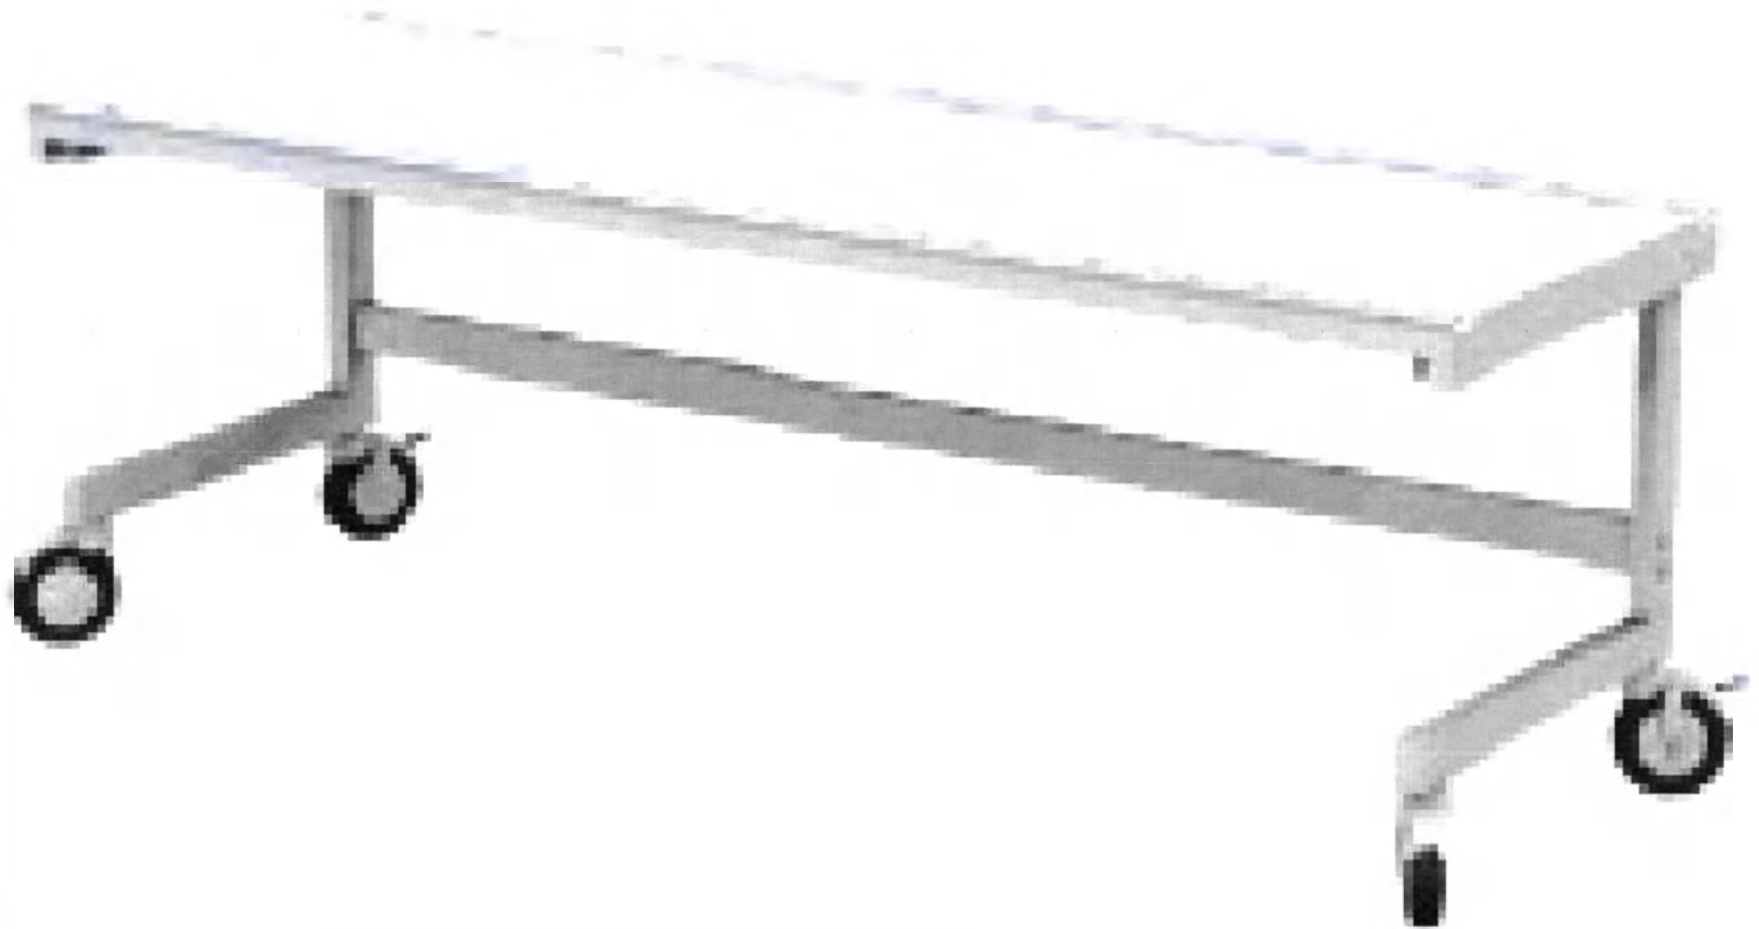




17. Мониторы высокого разрешения (не более 4 шт.).

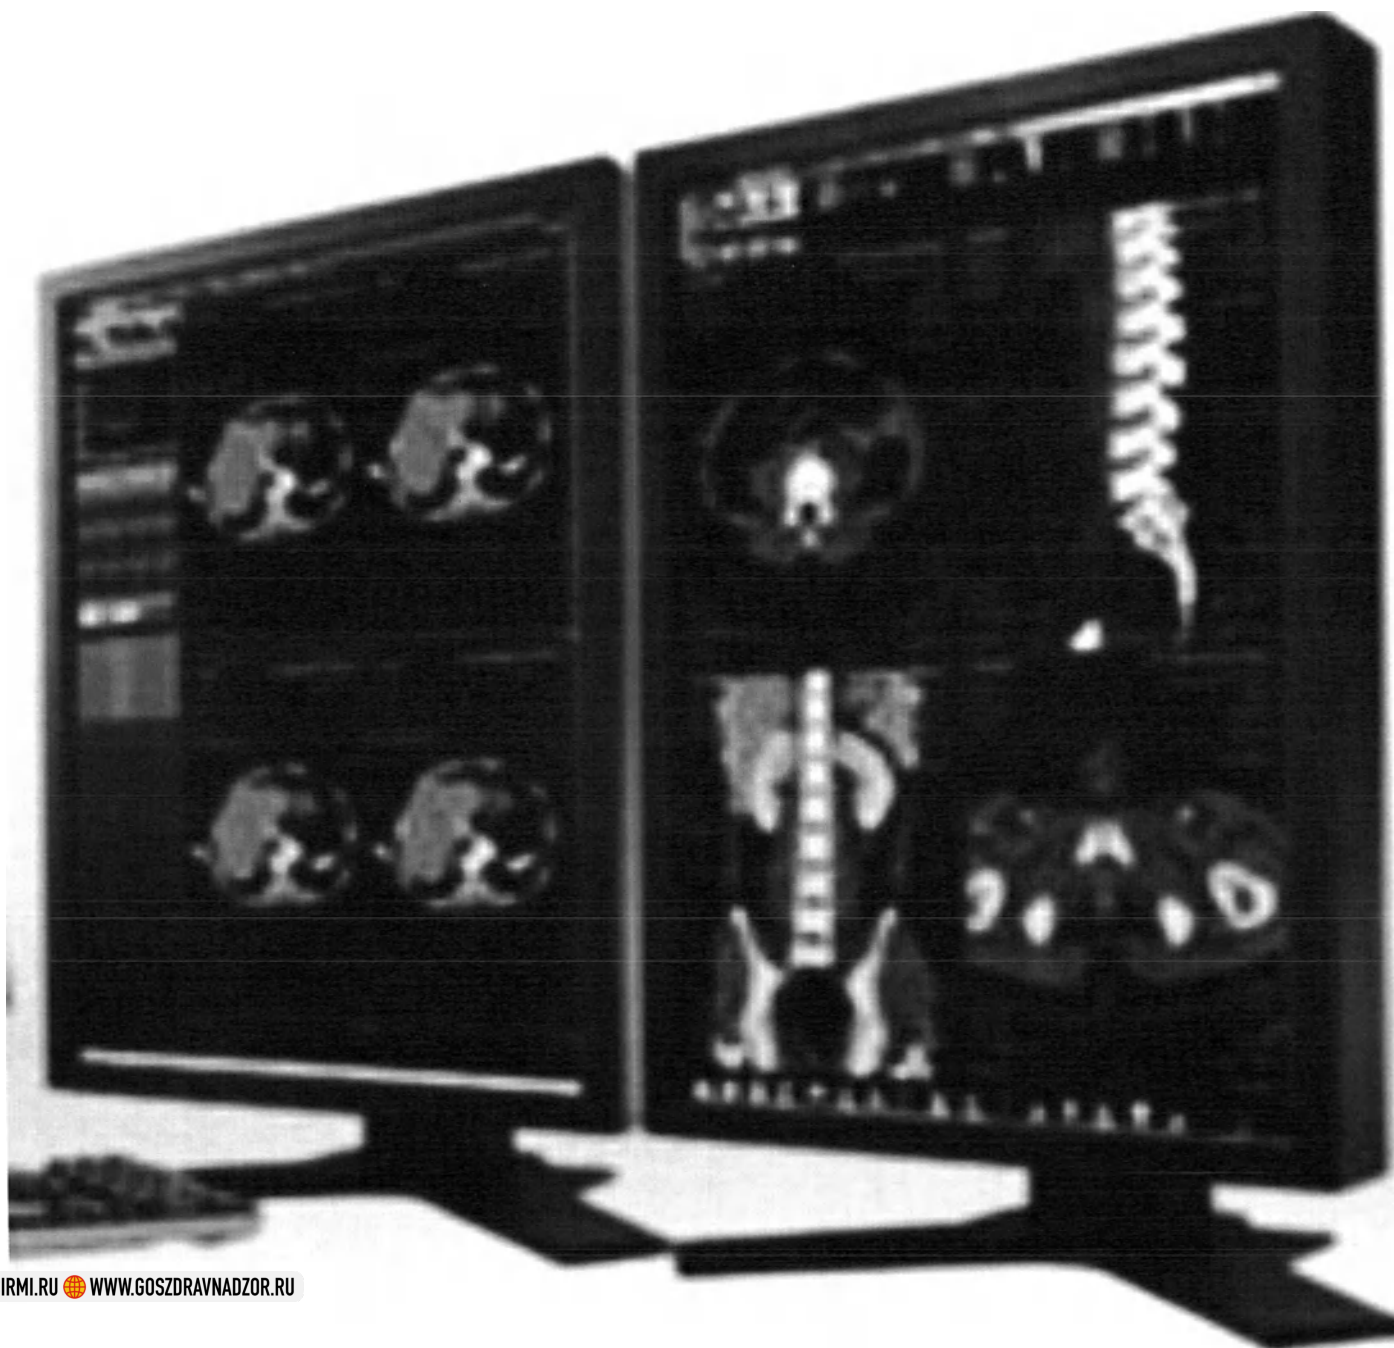

18. Мониторы для станций управления и сбора информации (не более 4 шт.).

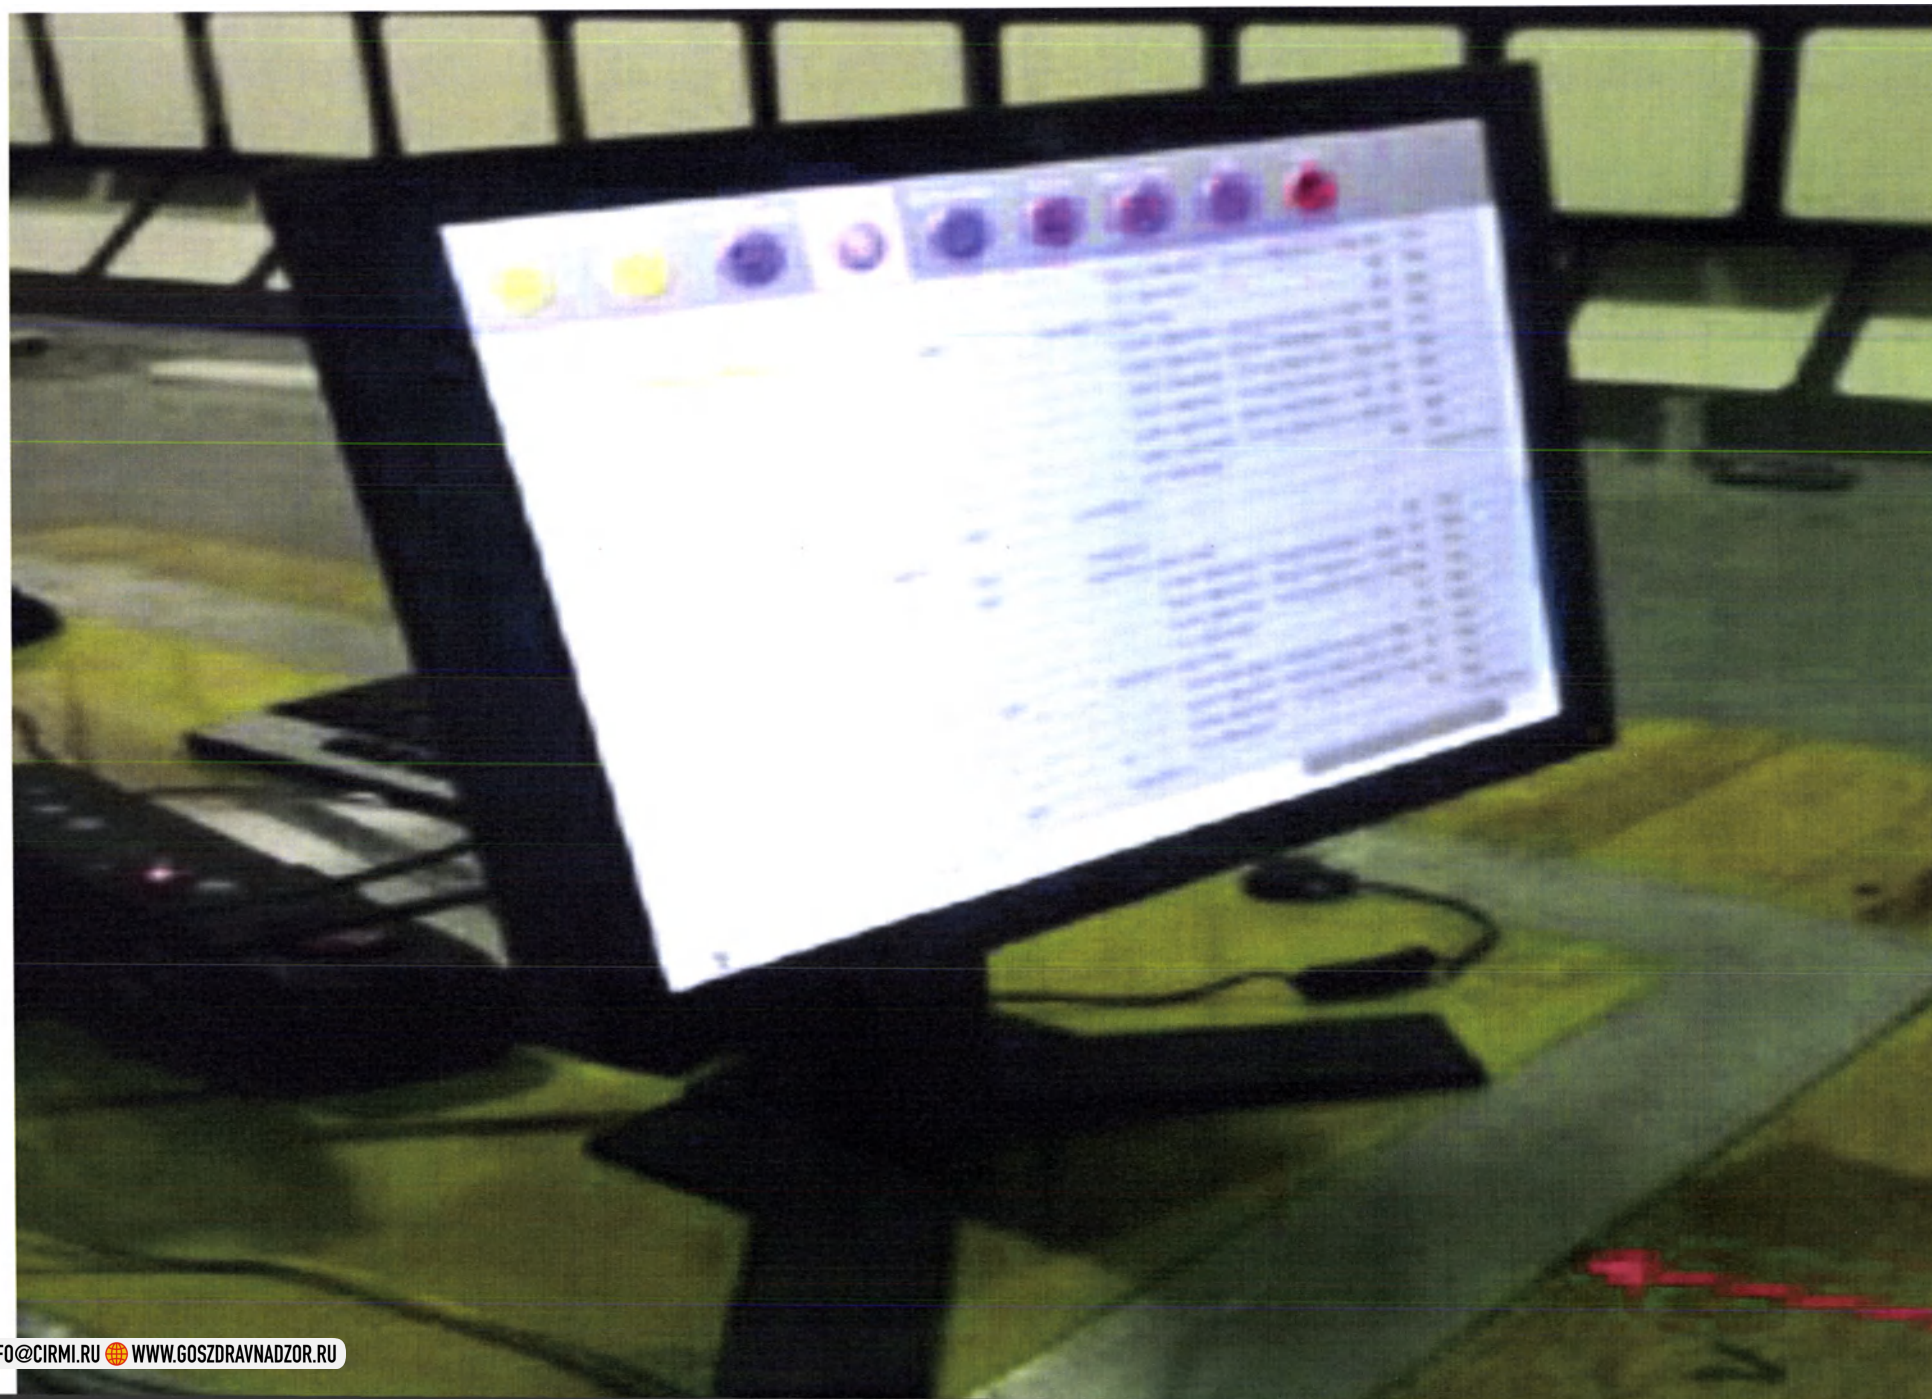

GENC - Am
Product Lo
P.O. Box 41
Mishawaka

Mailing
Address



DESCRIPTION

SHIPMENT

GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS CO. Ltd

N° 1 Yong Chang North Road Beijing Economic Technological
Development Zone BEIJING 100176 CHINA Сделано в Китае

Описание: Система рентгеновская


Модель: Discovery XR656

Серийный номер: M1SS1800003

Произведено: January 2018


Источник: 380/400/420/440/460/480V, 3~, 50/60Hz

Входной ток: 195A (Переменный), 45A (Постоянный)




Class I


20. Опоры для рук пациента при проведении диагностики (не более 2 шт.).

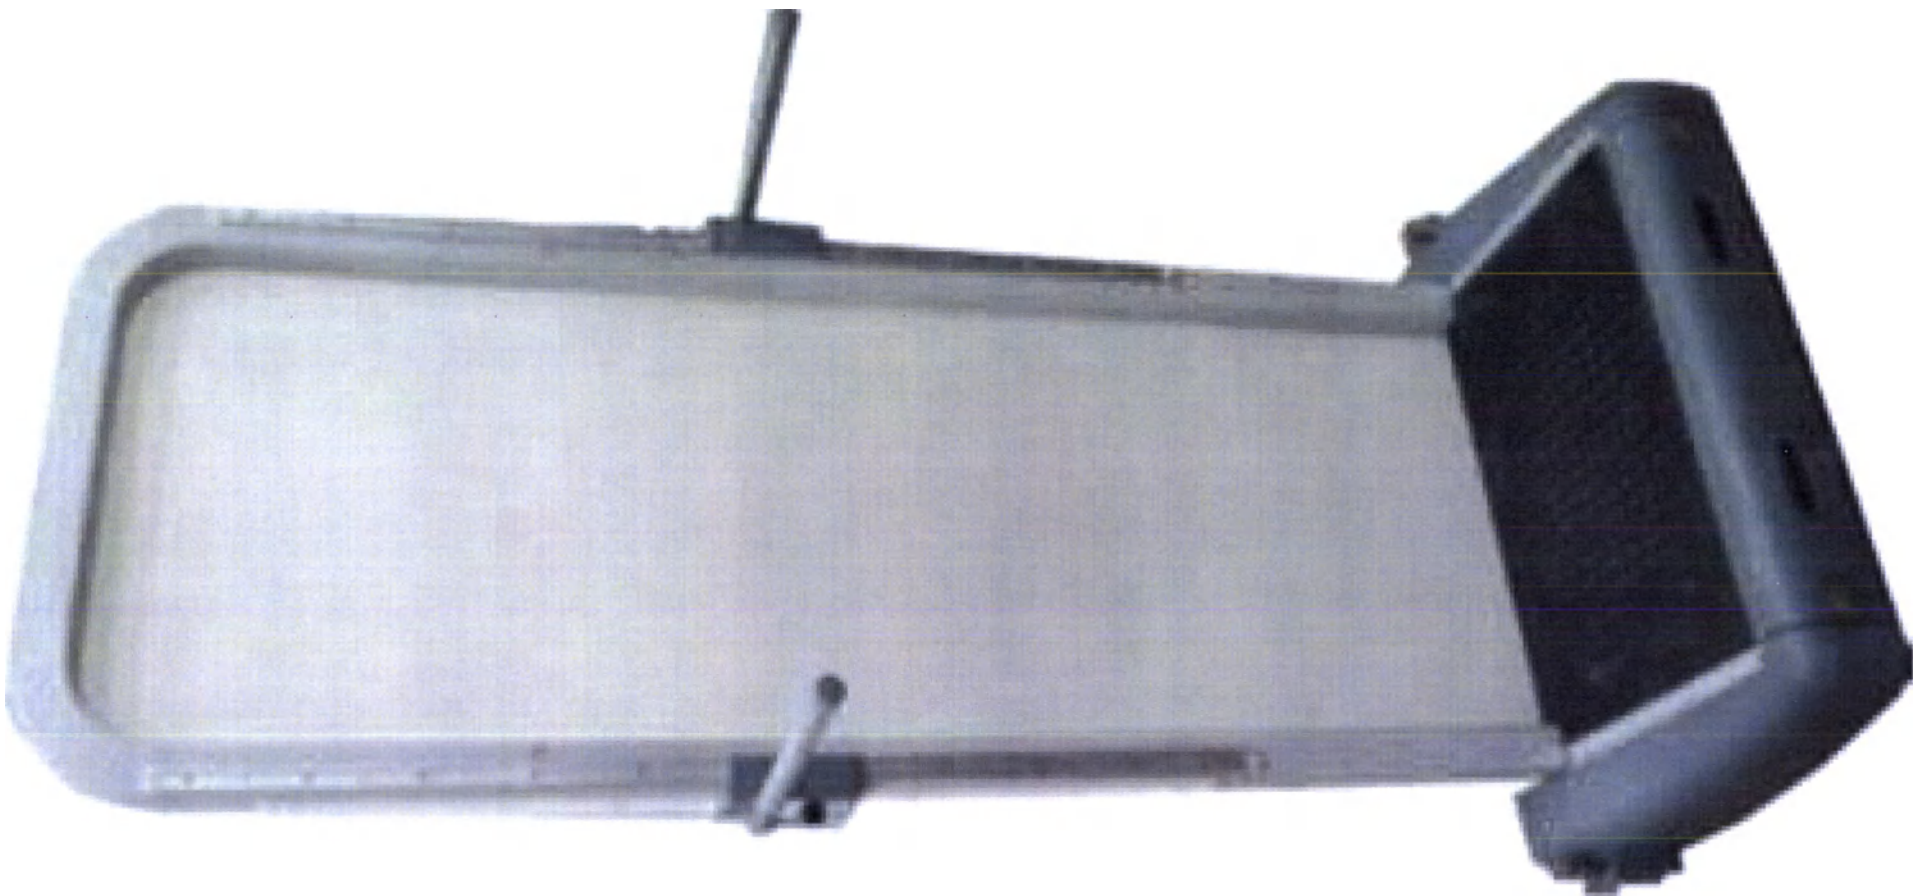


21. Отсеивающие решетки для стойки снимков (не более 2 шт.).

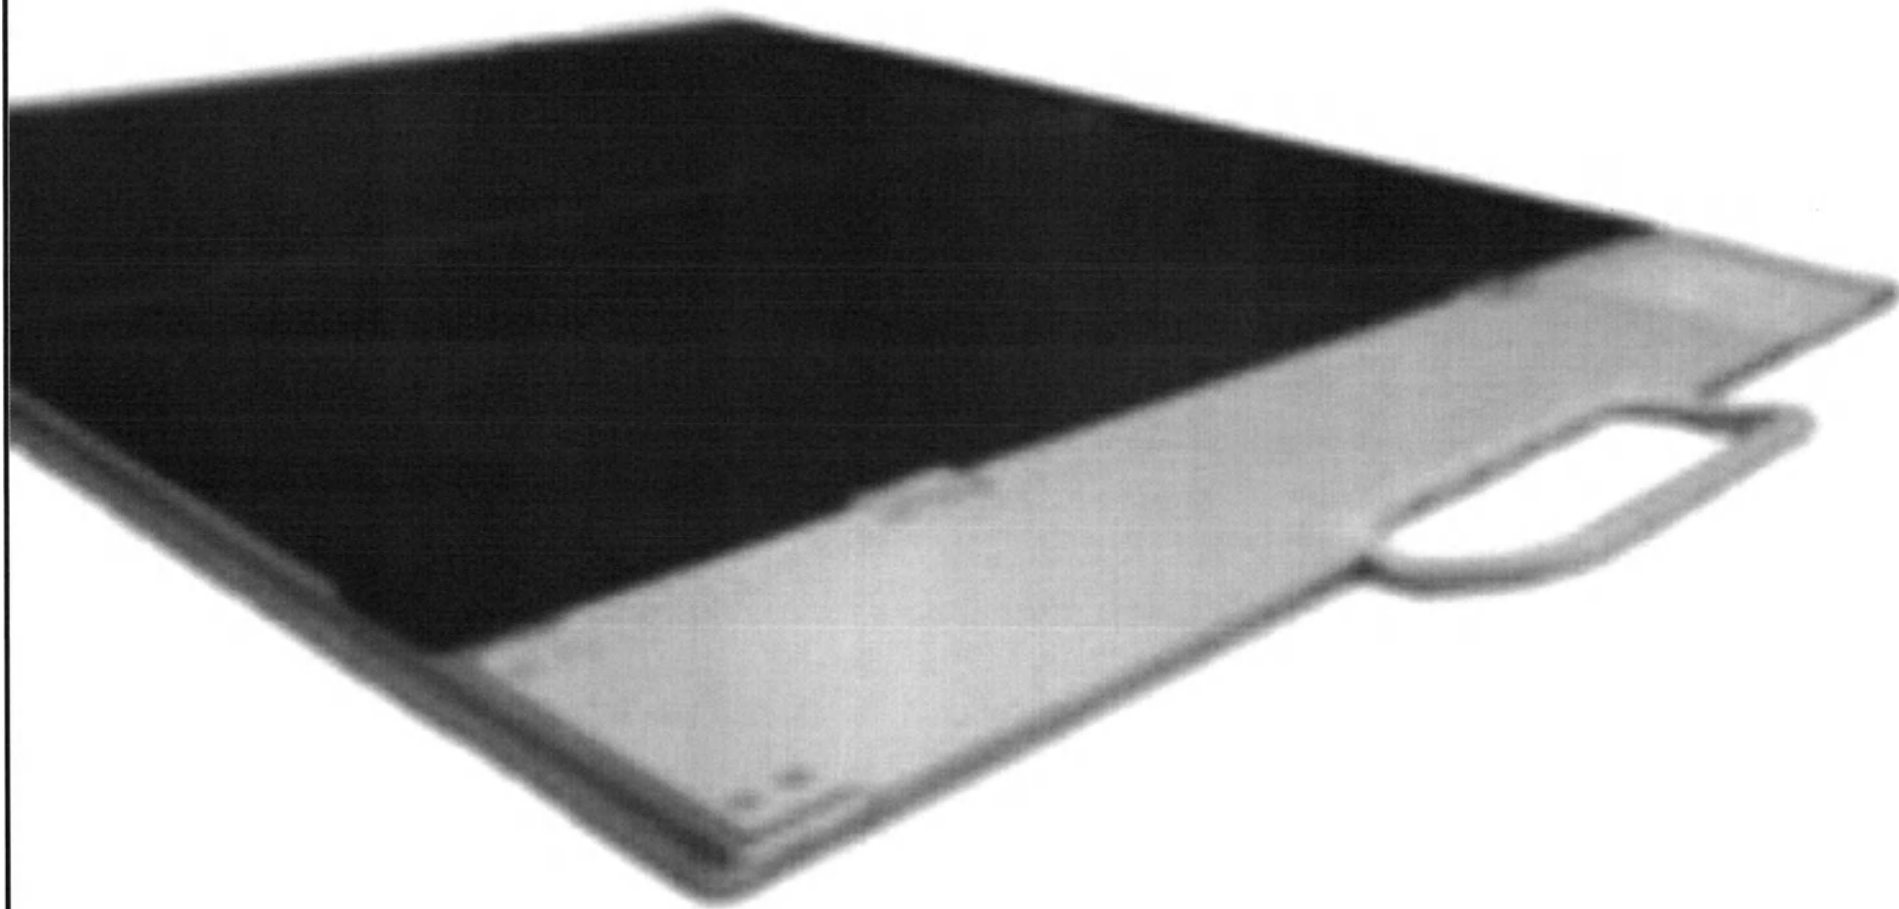

21. Отсеивающие решетки для стойки снимков (не более 2 шт.).

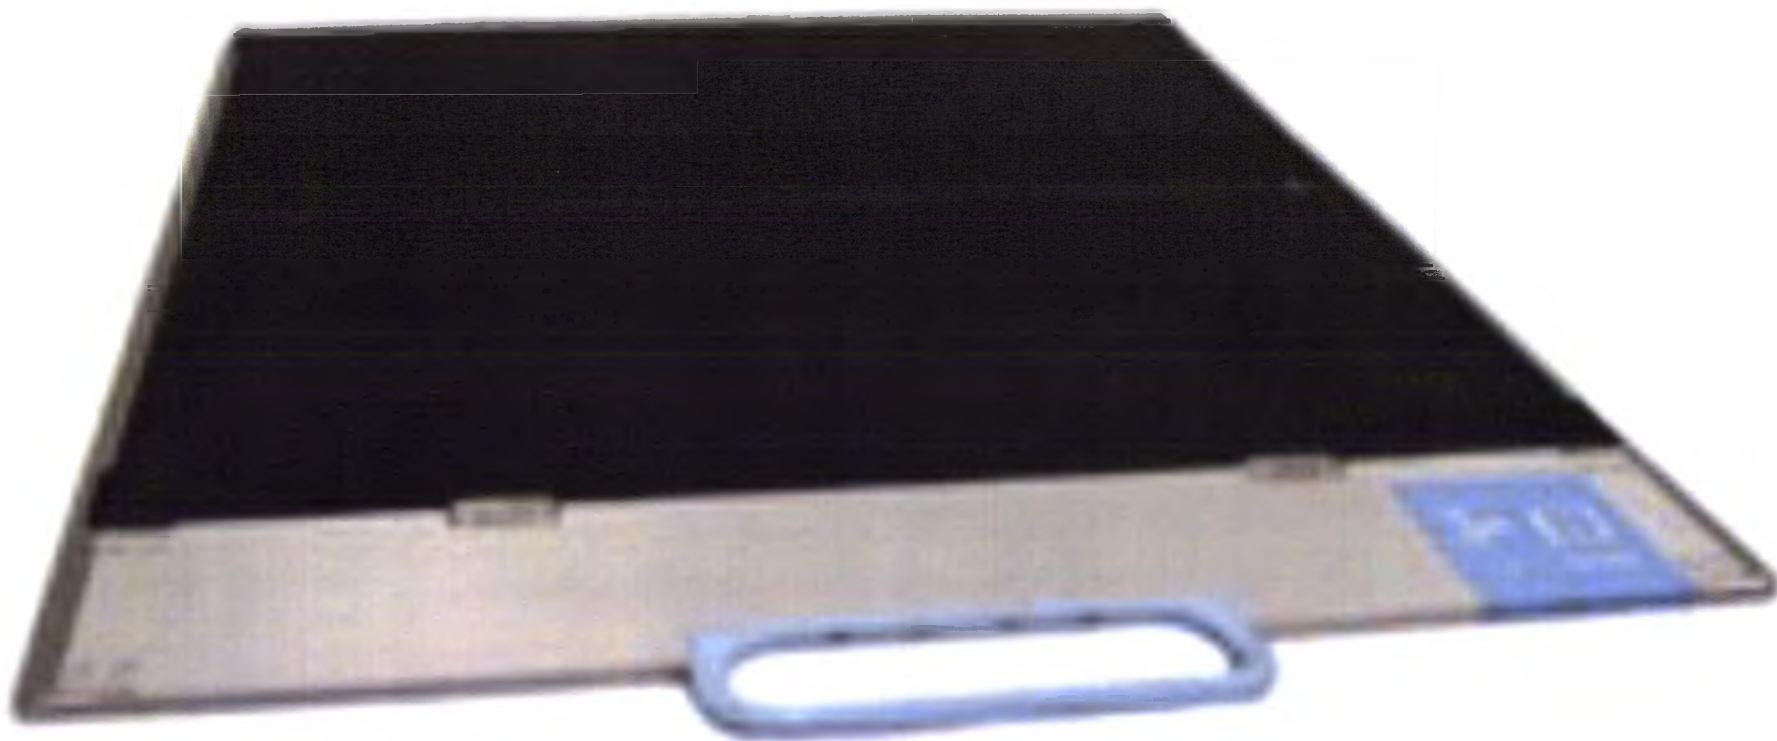

21. Отсеивающие решетки для стойки снимков (не более 2 шт.).

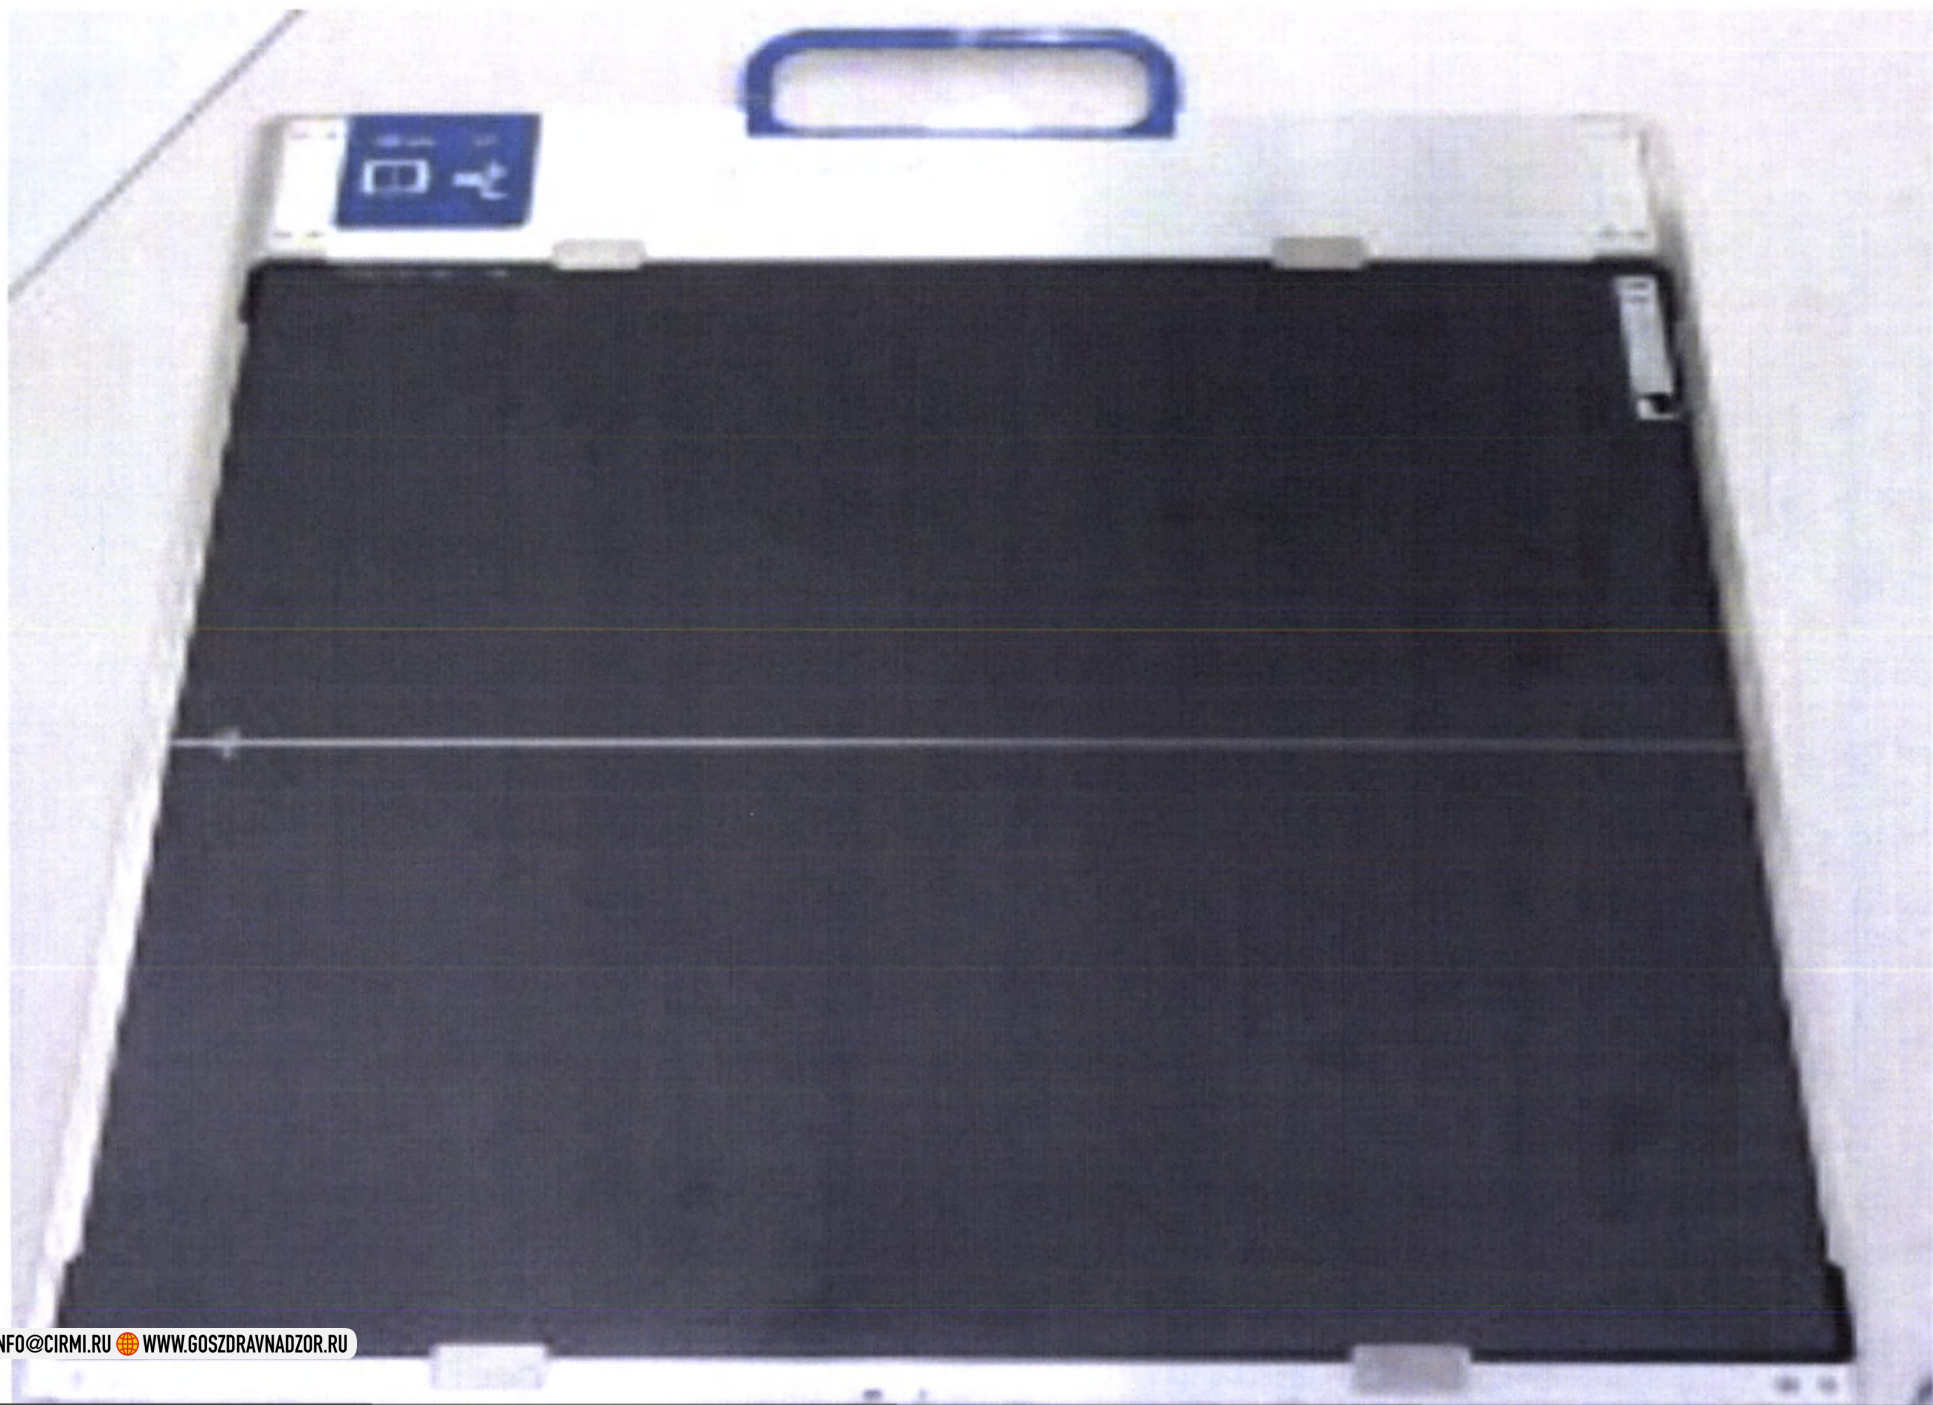


21. Отсеивающие решетки для стойки снимков (не более 2 шт.).





22. Отсасывающие решетки для стола (не более 2 шт.).

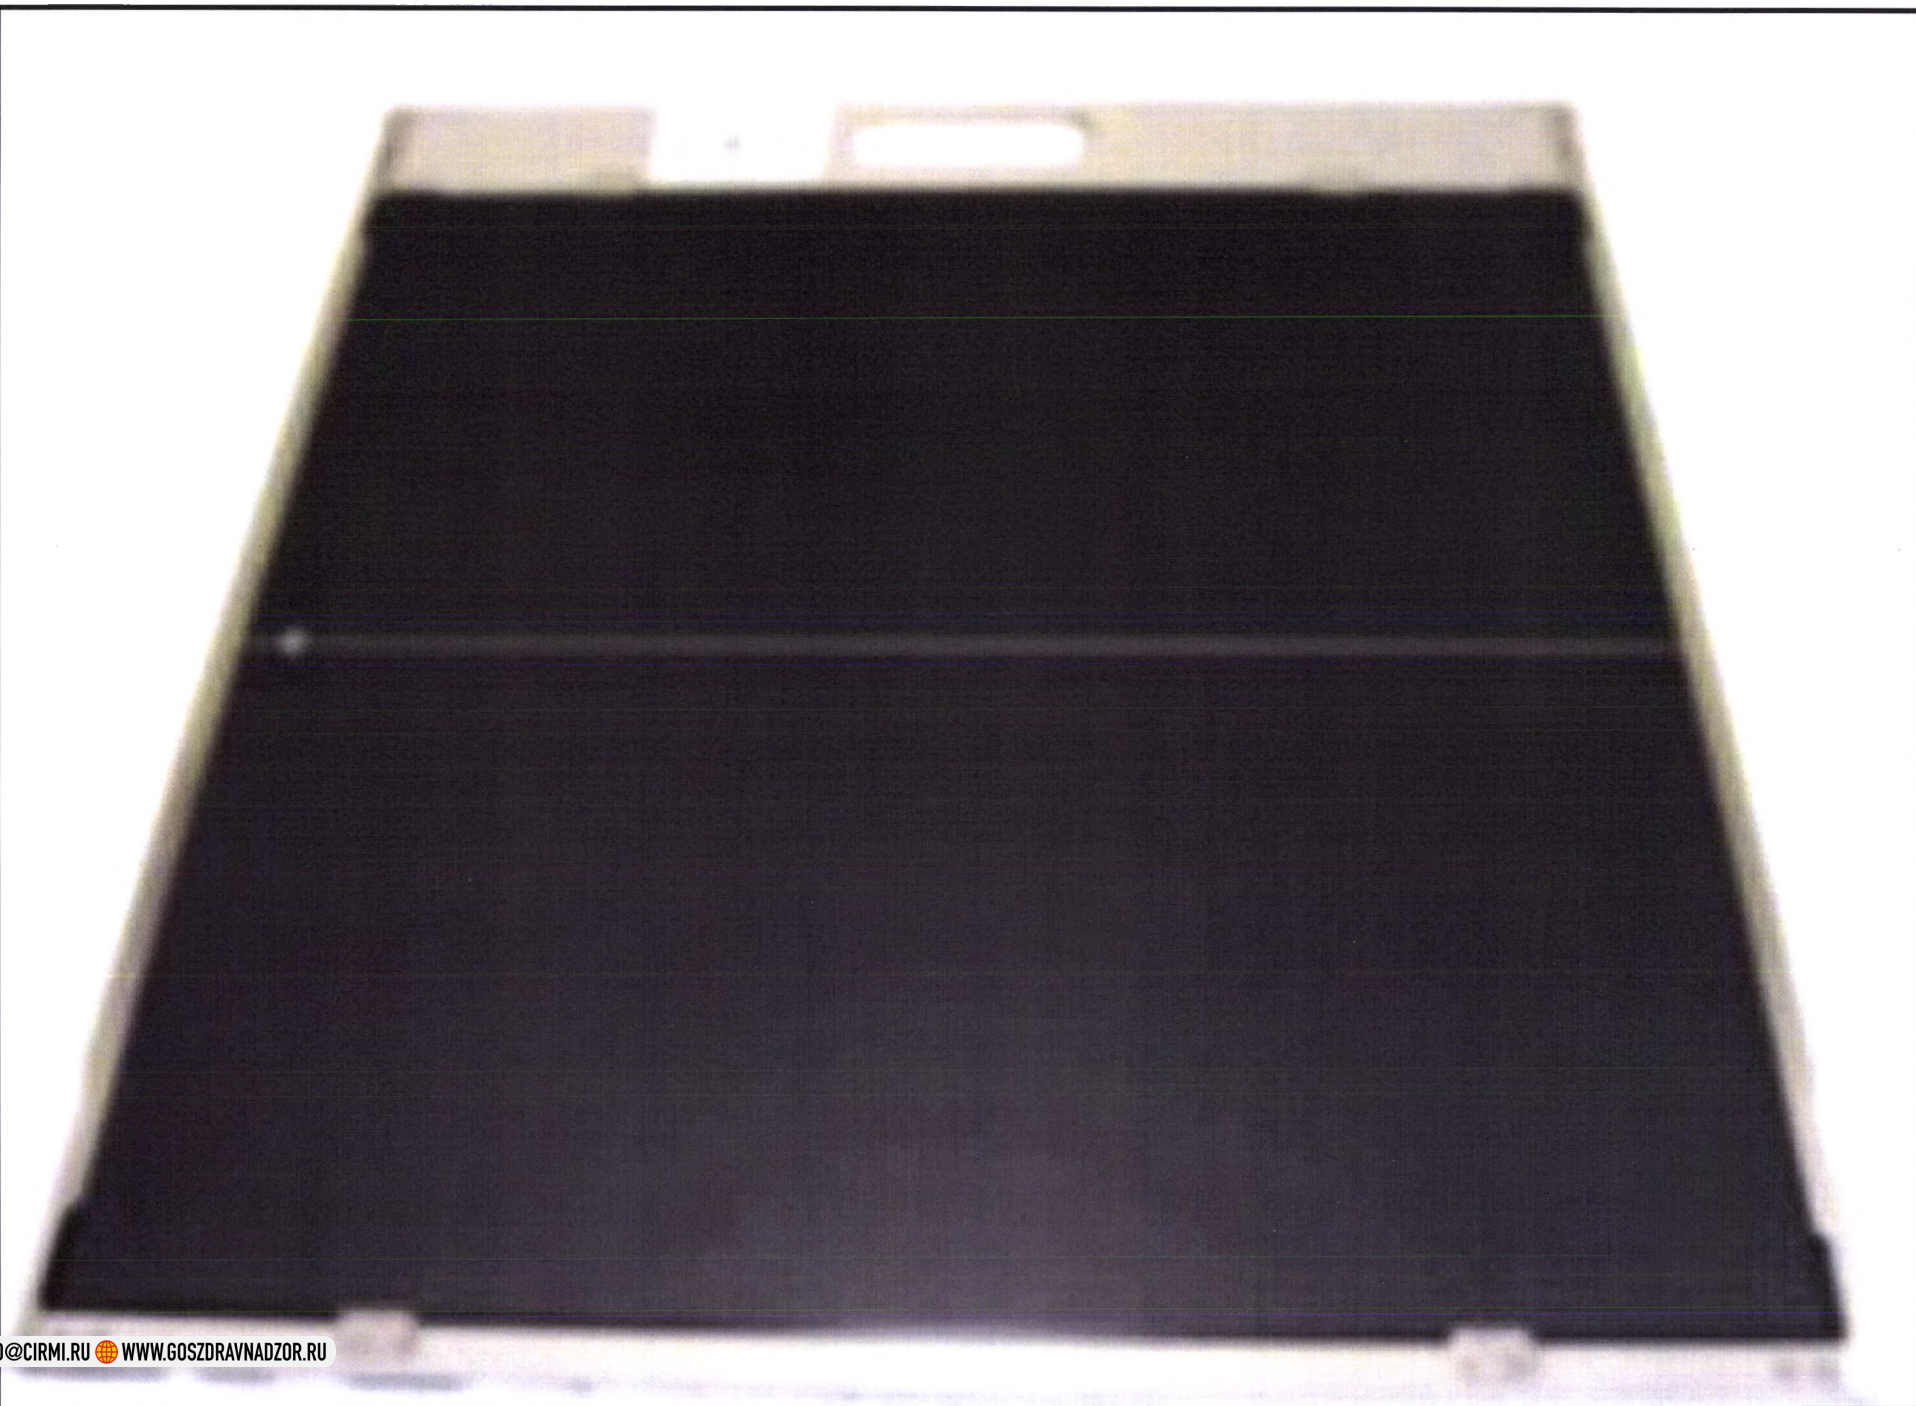


22. Отсеивающие решетки для стола (не более 2 шт.).






2.7. Поручни к столу (не более 4 шт.).

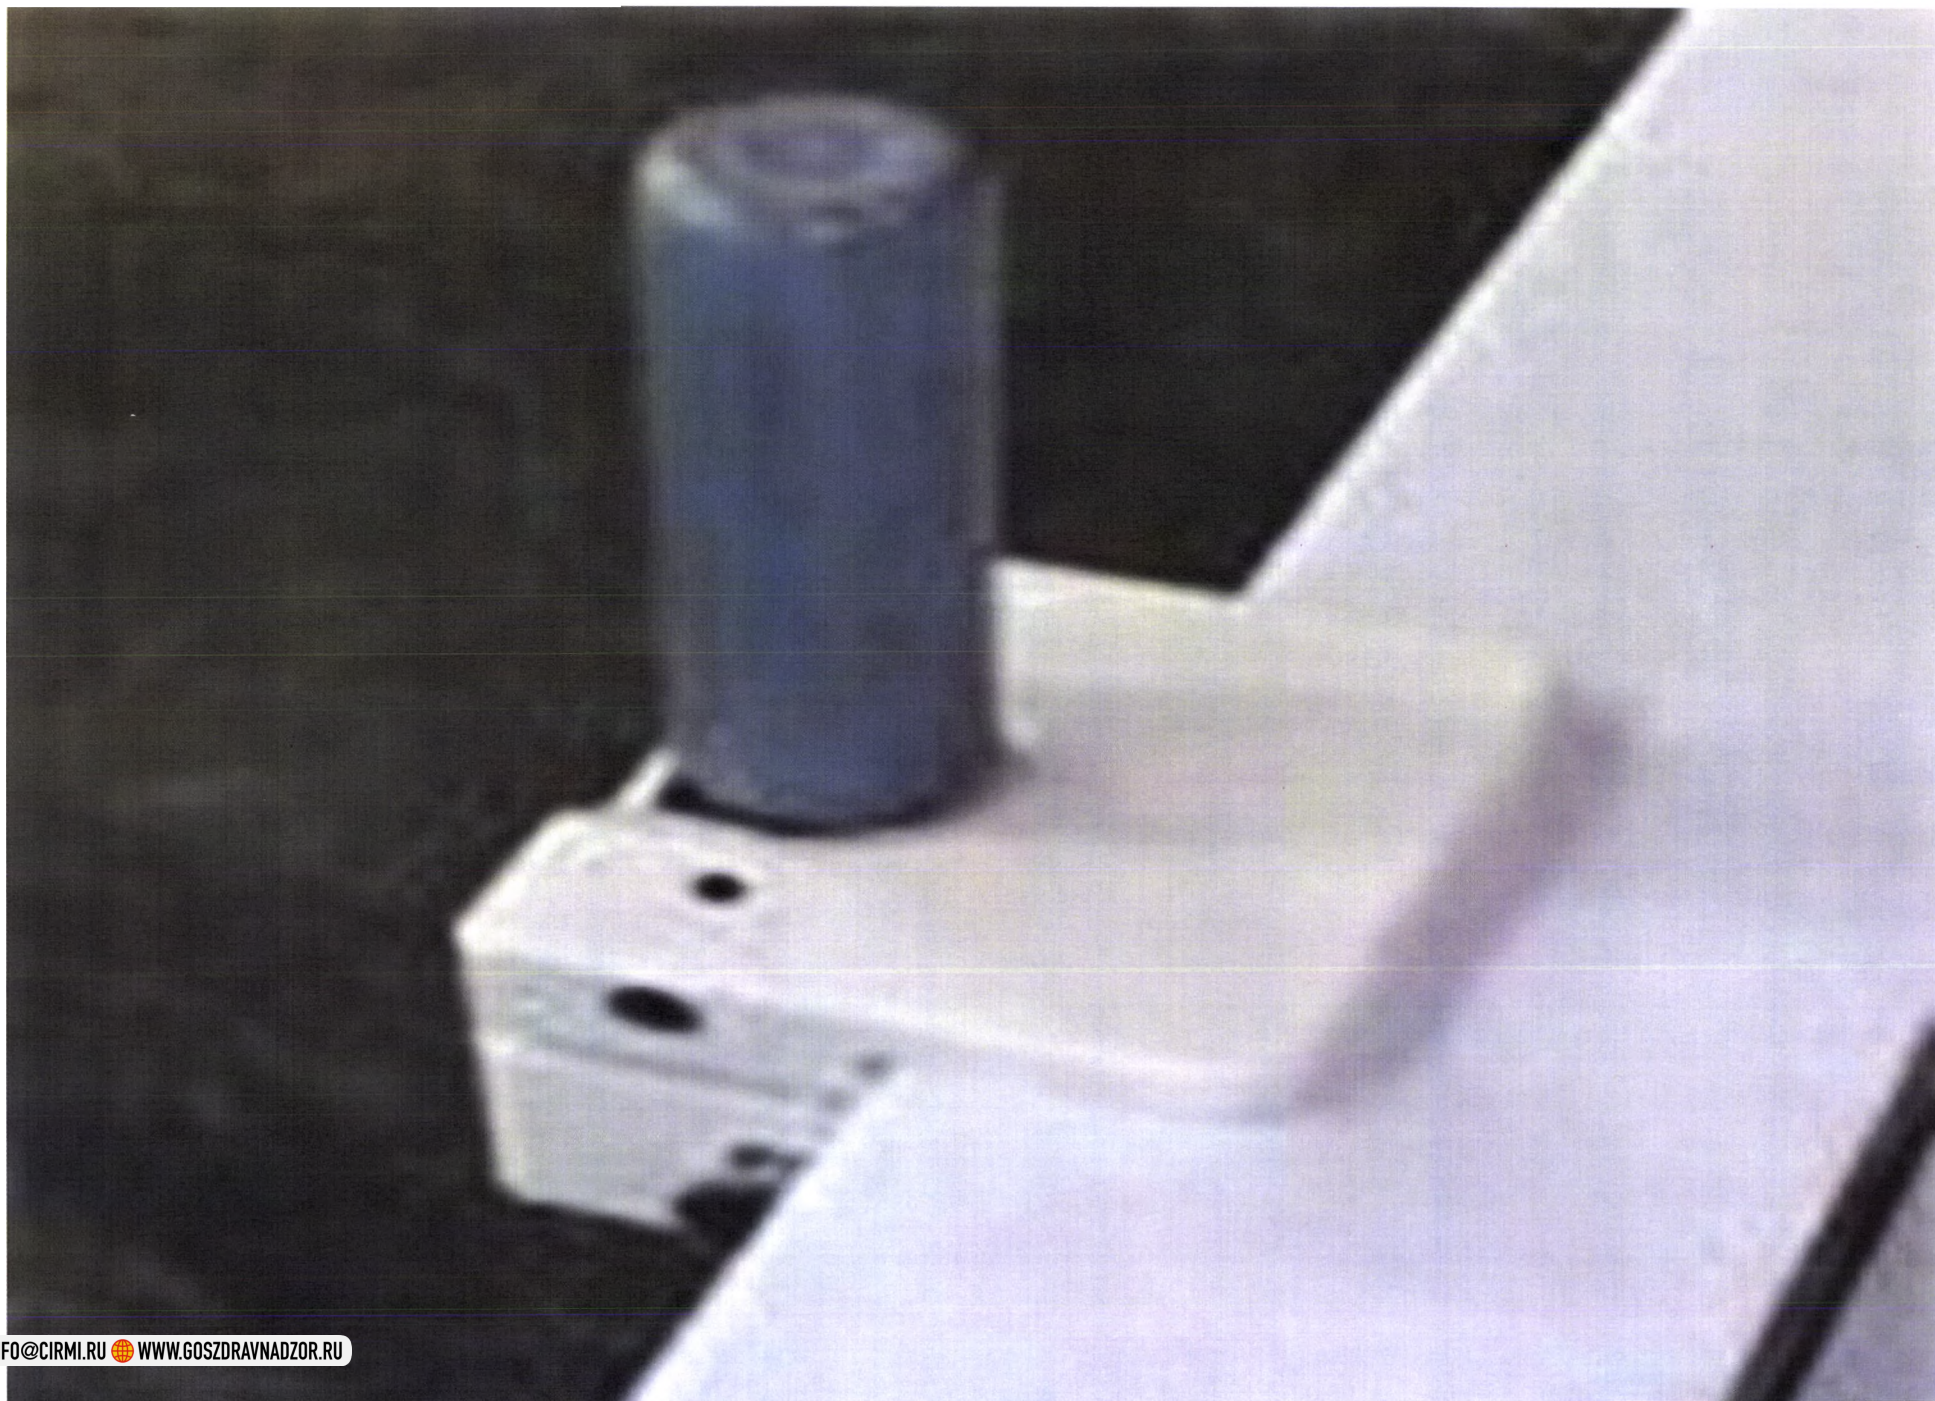



26. Приводные ремни в комплекте (не более 2 шт.).

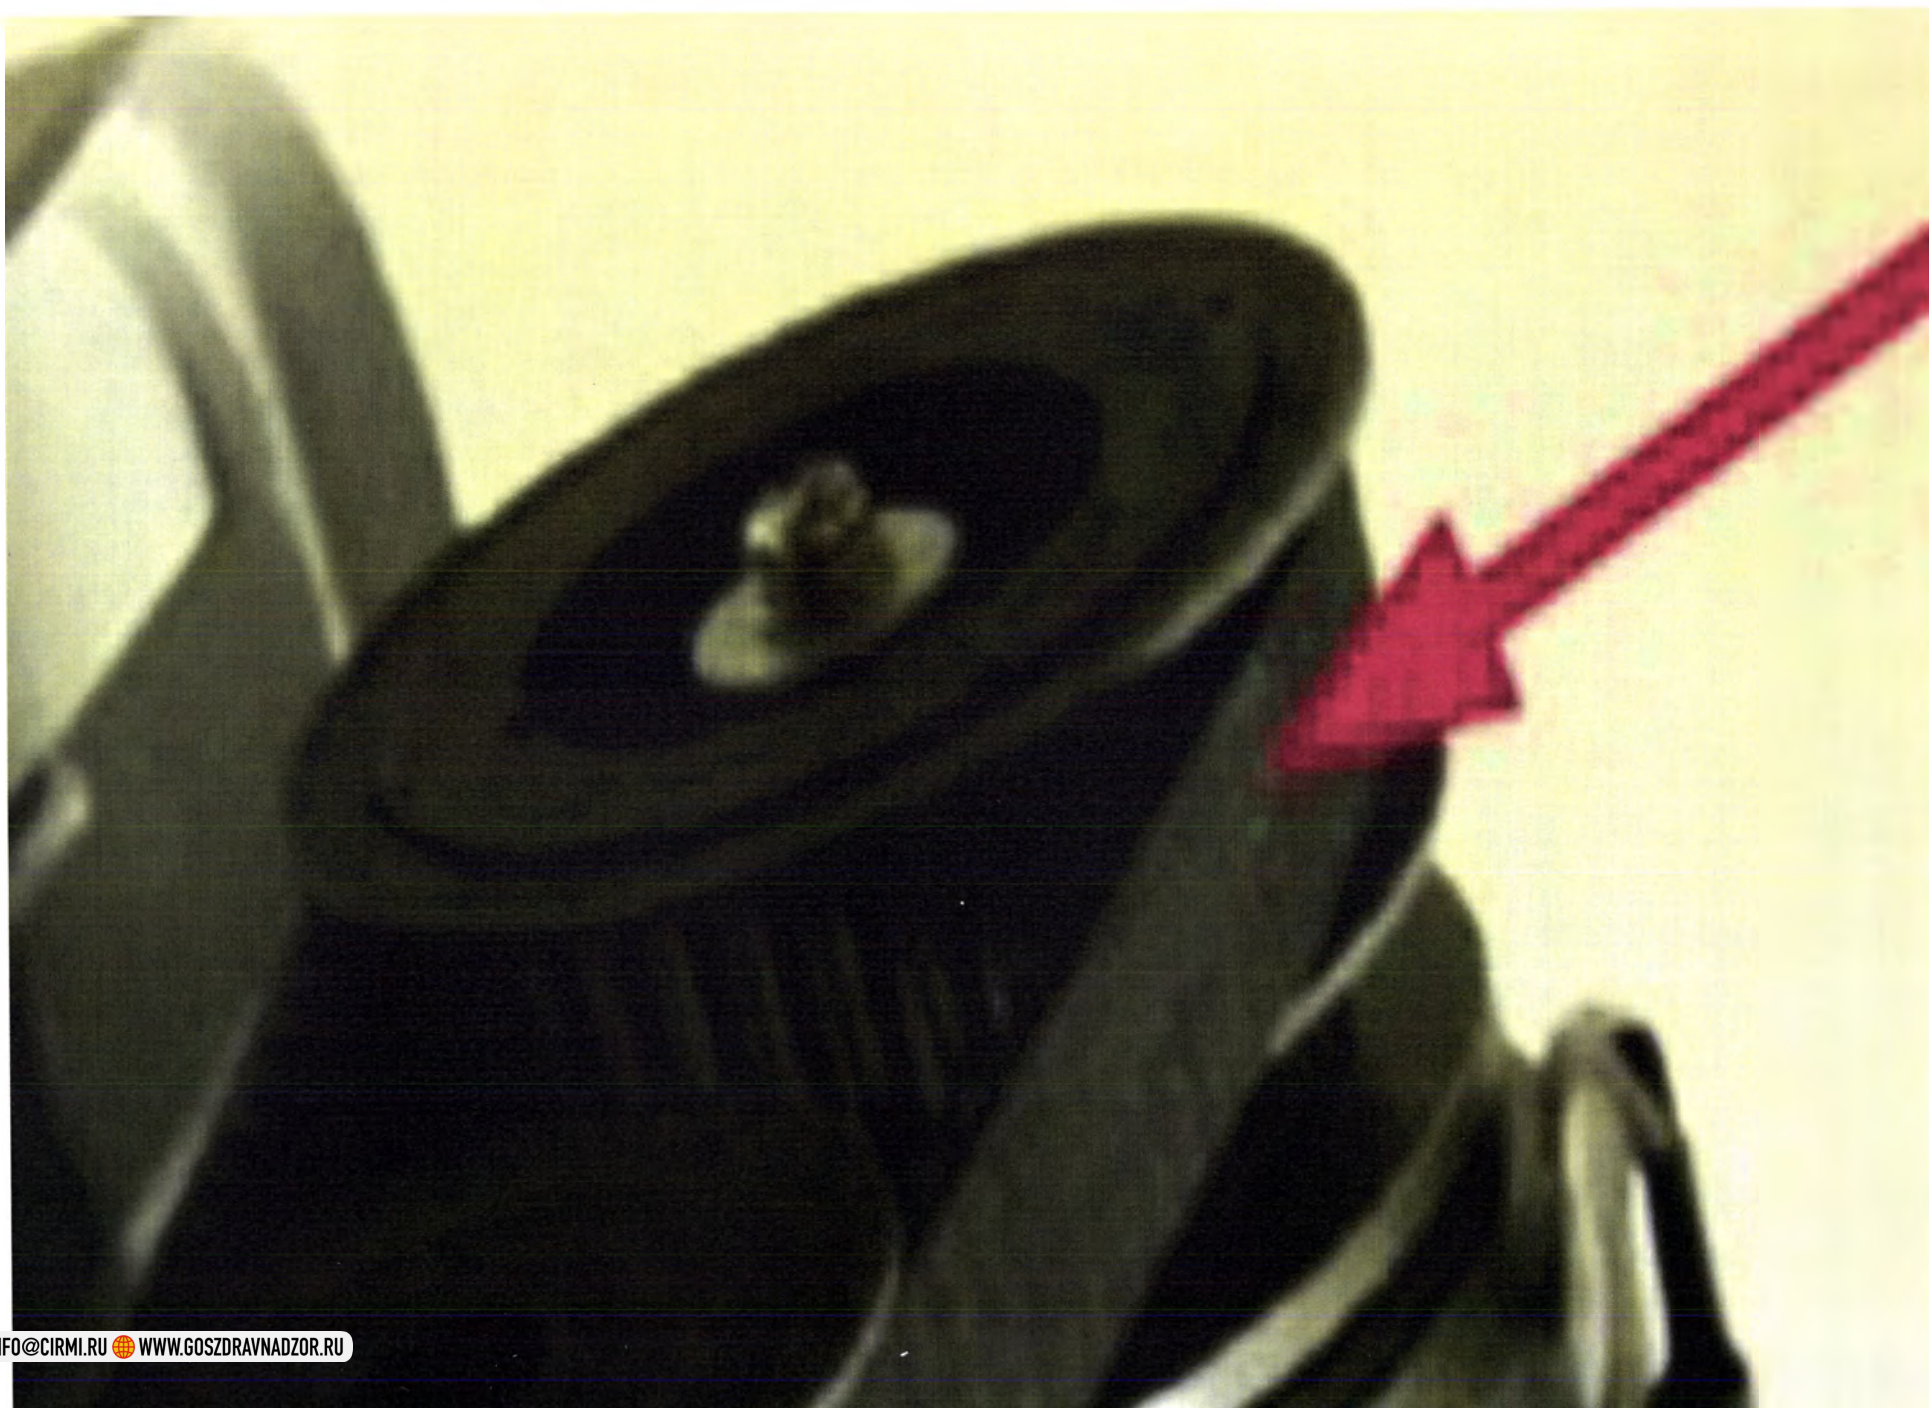














A photograph of a white, rectangular, folded piece of material, possibly a cloth or paper, with a dark, circular mark near the bottom edge. The material is folded in a way that creates a triangular shape at the bottom, with a dark, circular mark visible on the inner surface of the fold. The background is a plain, light-colored surface.


28. Приспособления для укладки пациента (не более 20 шт.).




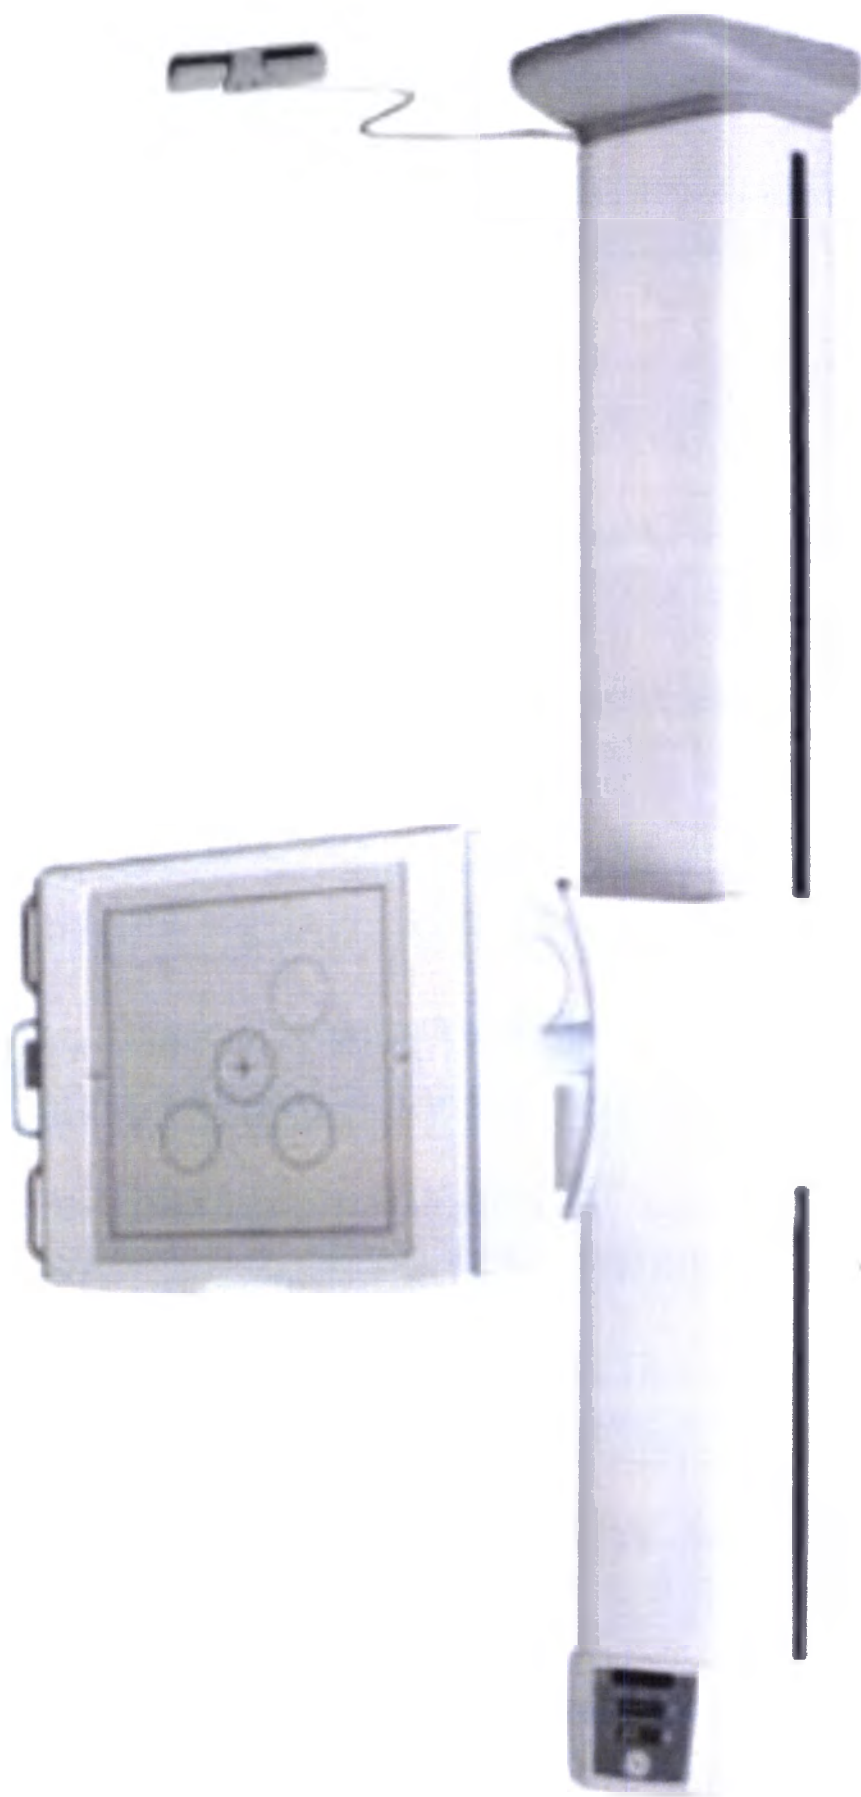

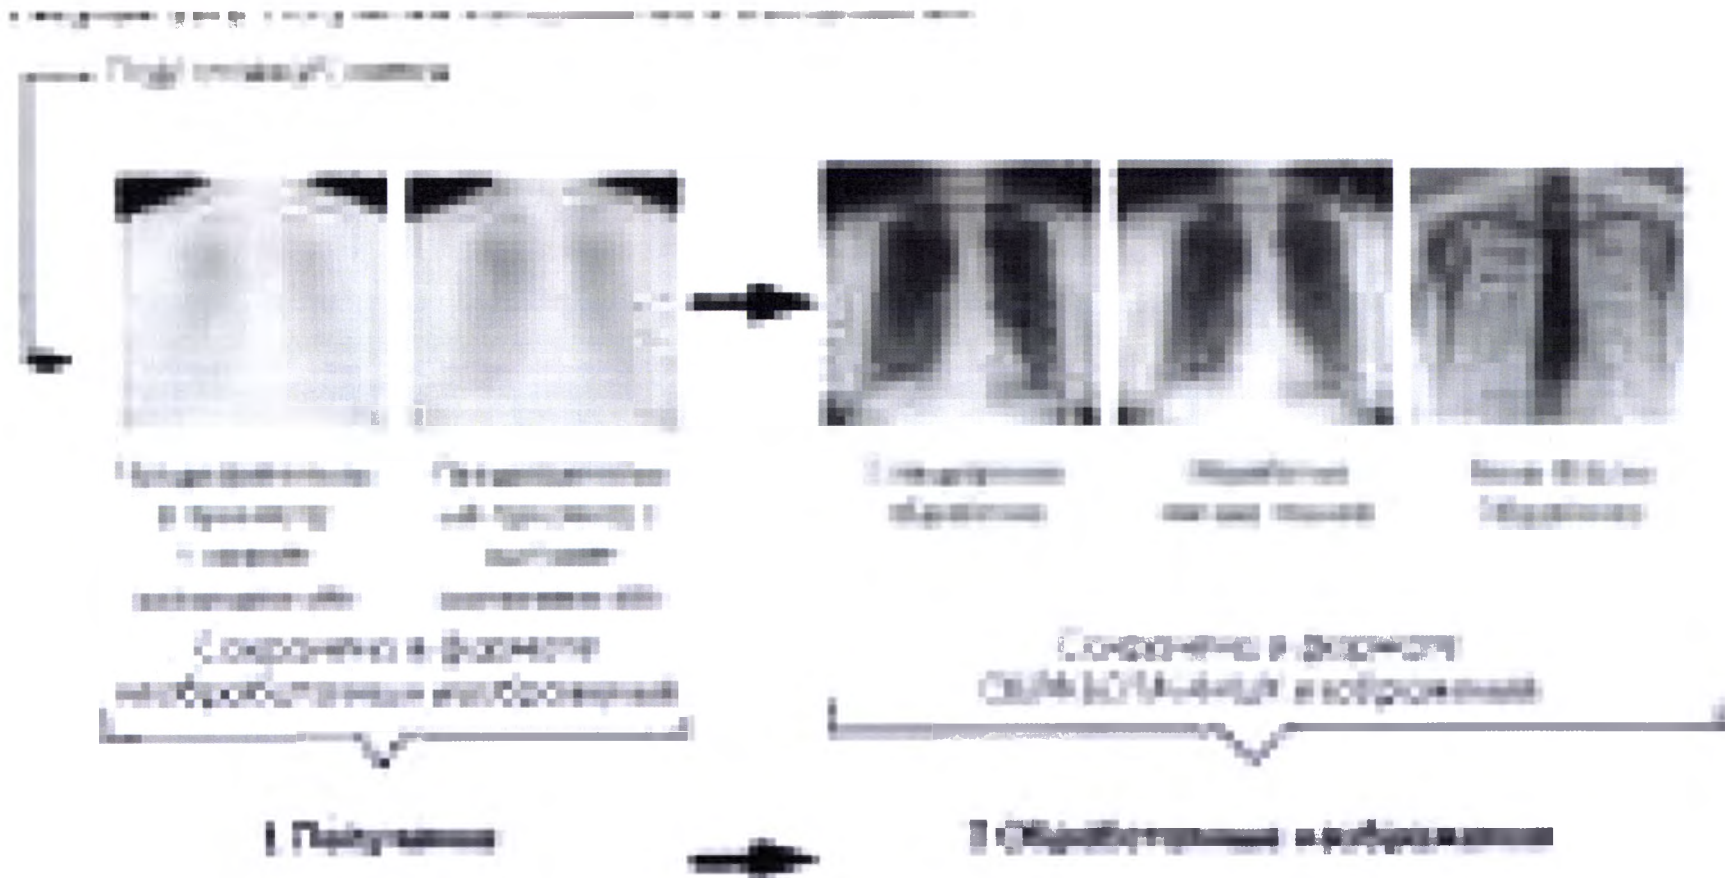

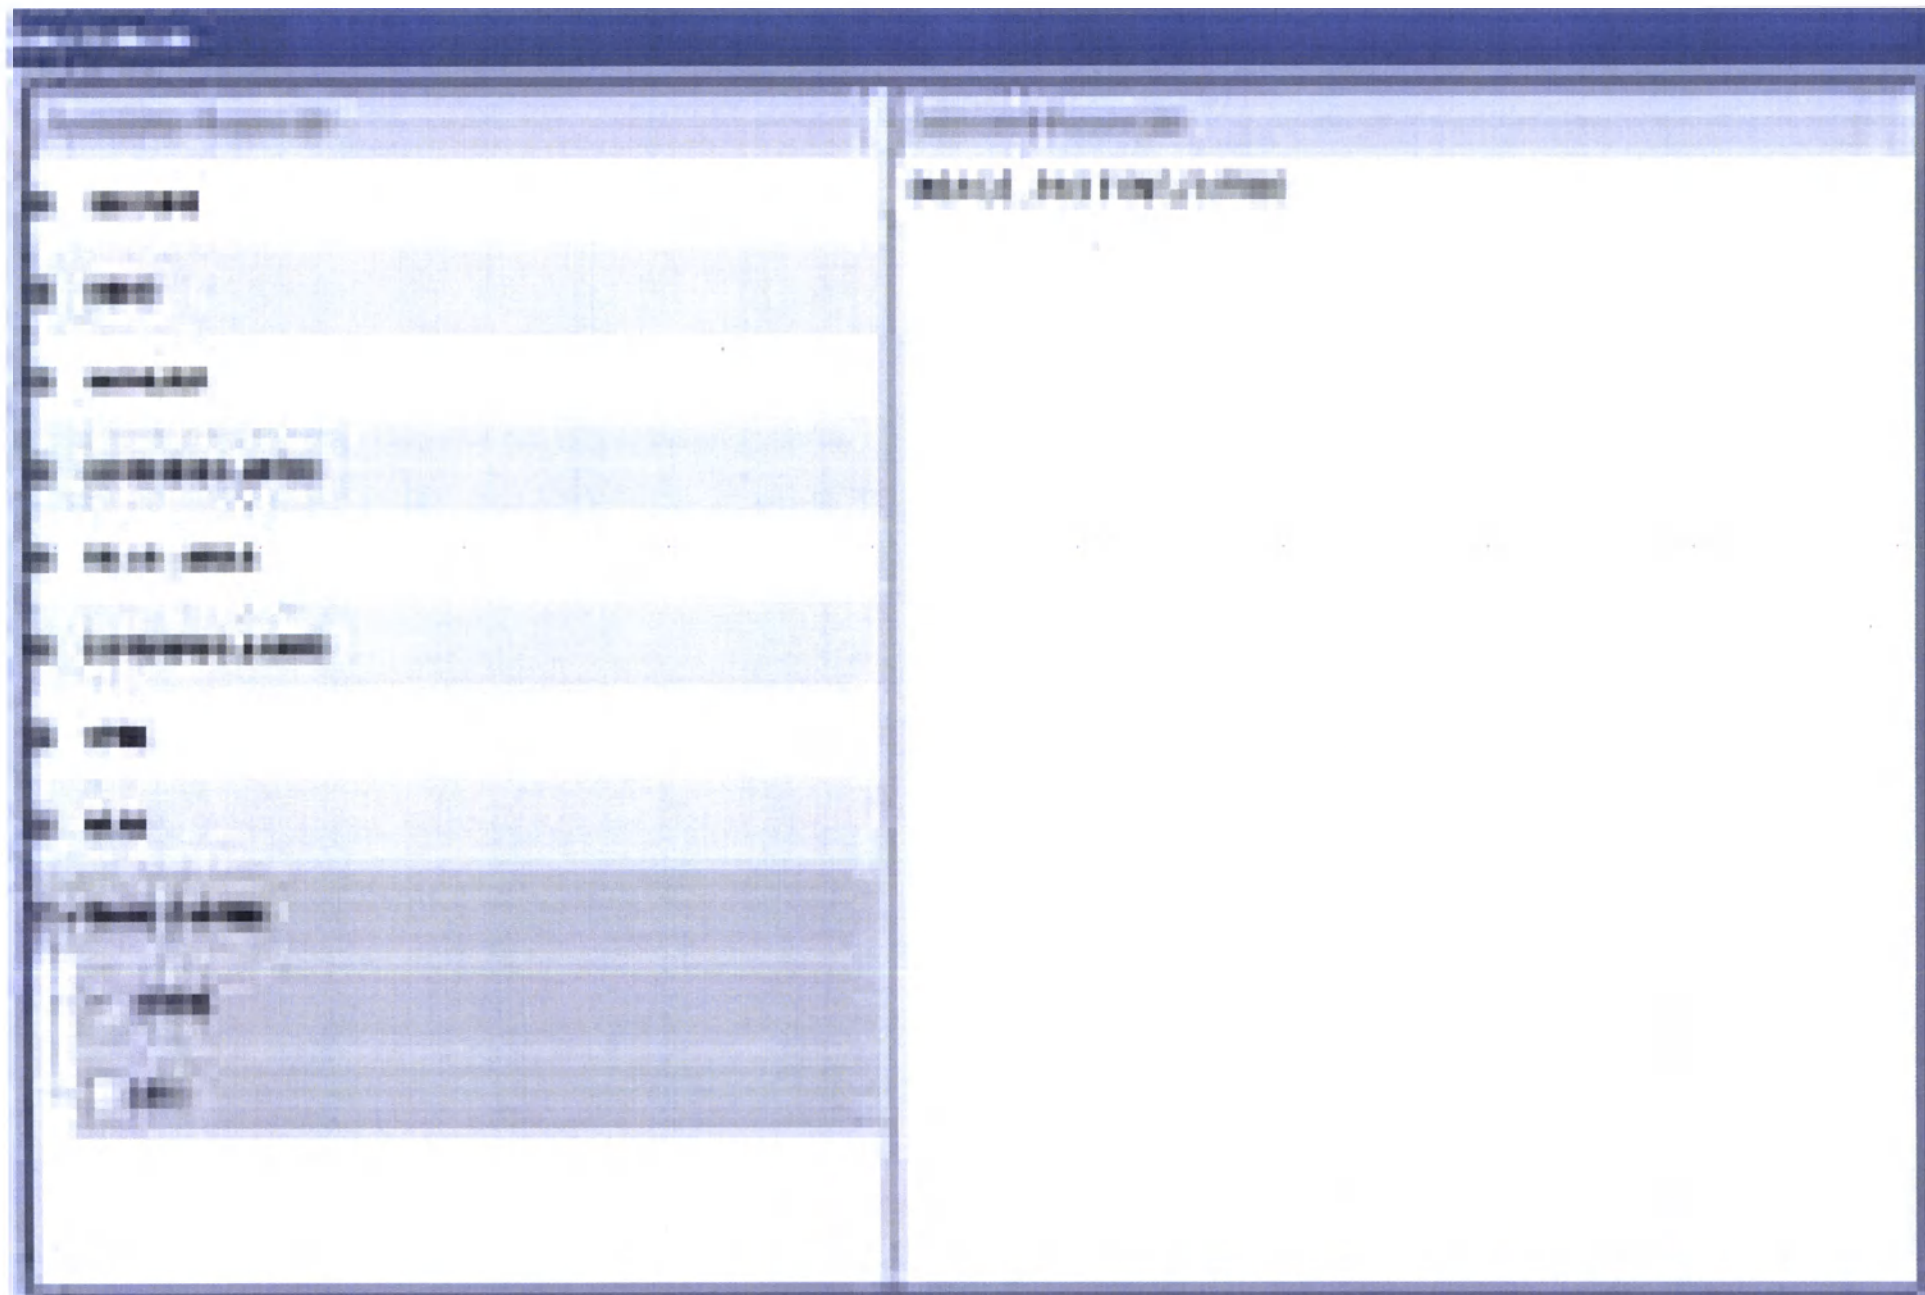

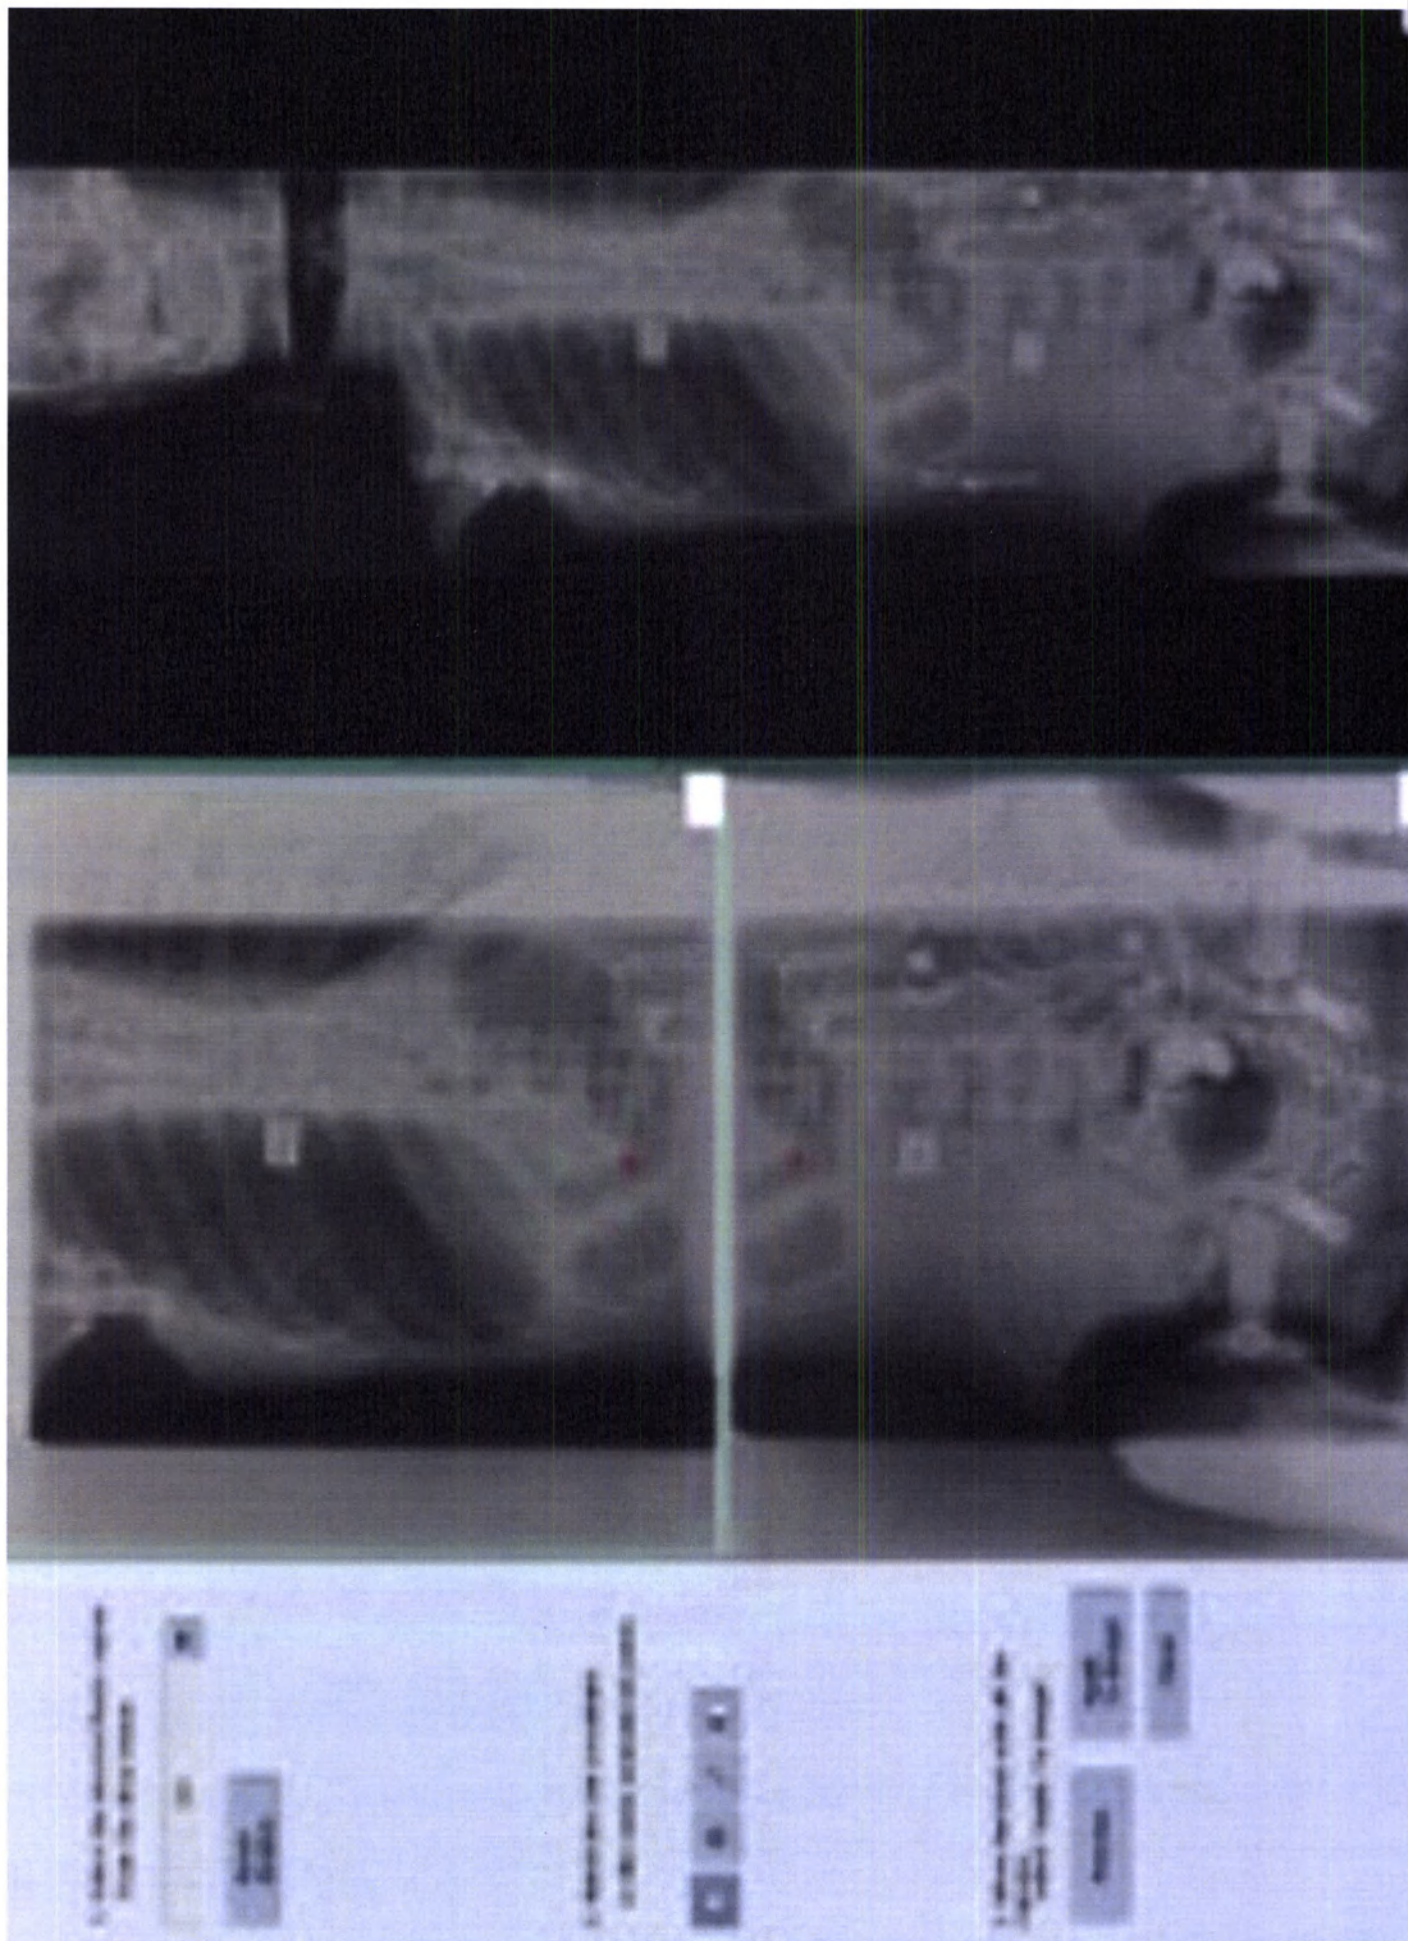


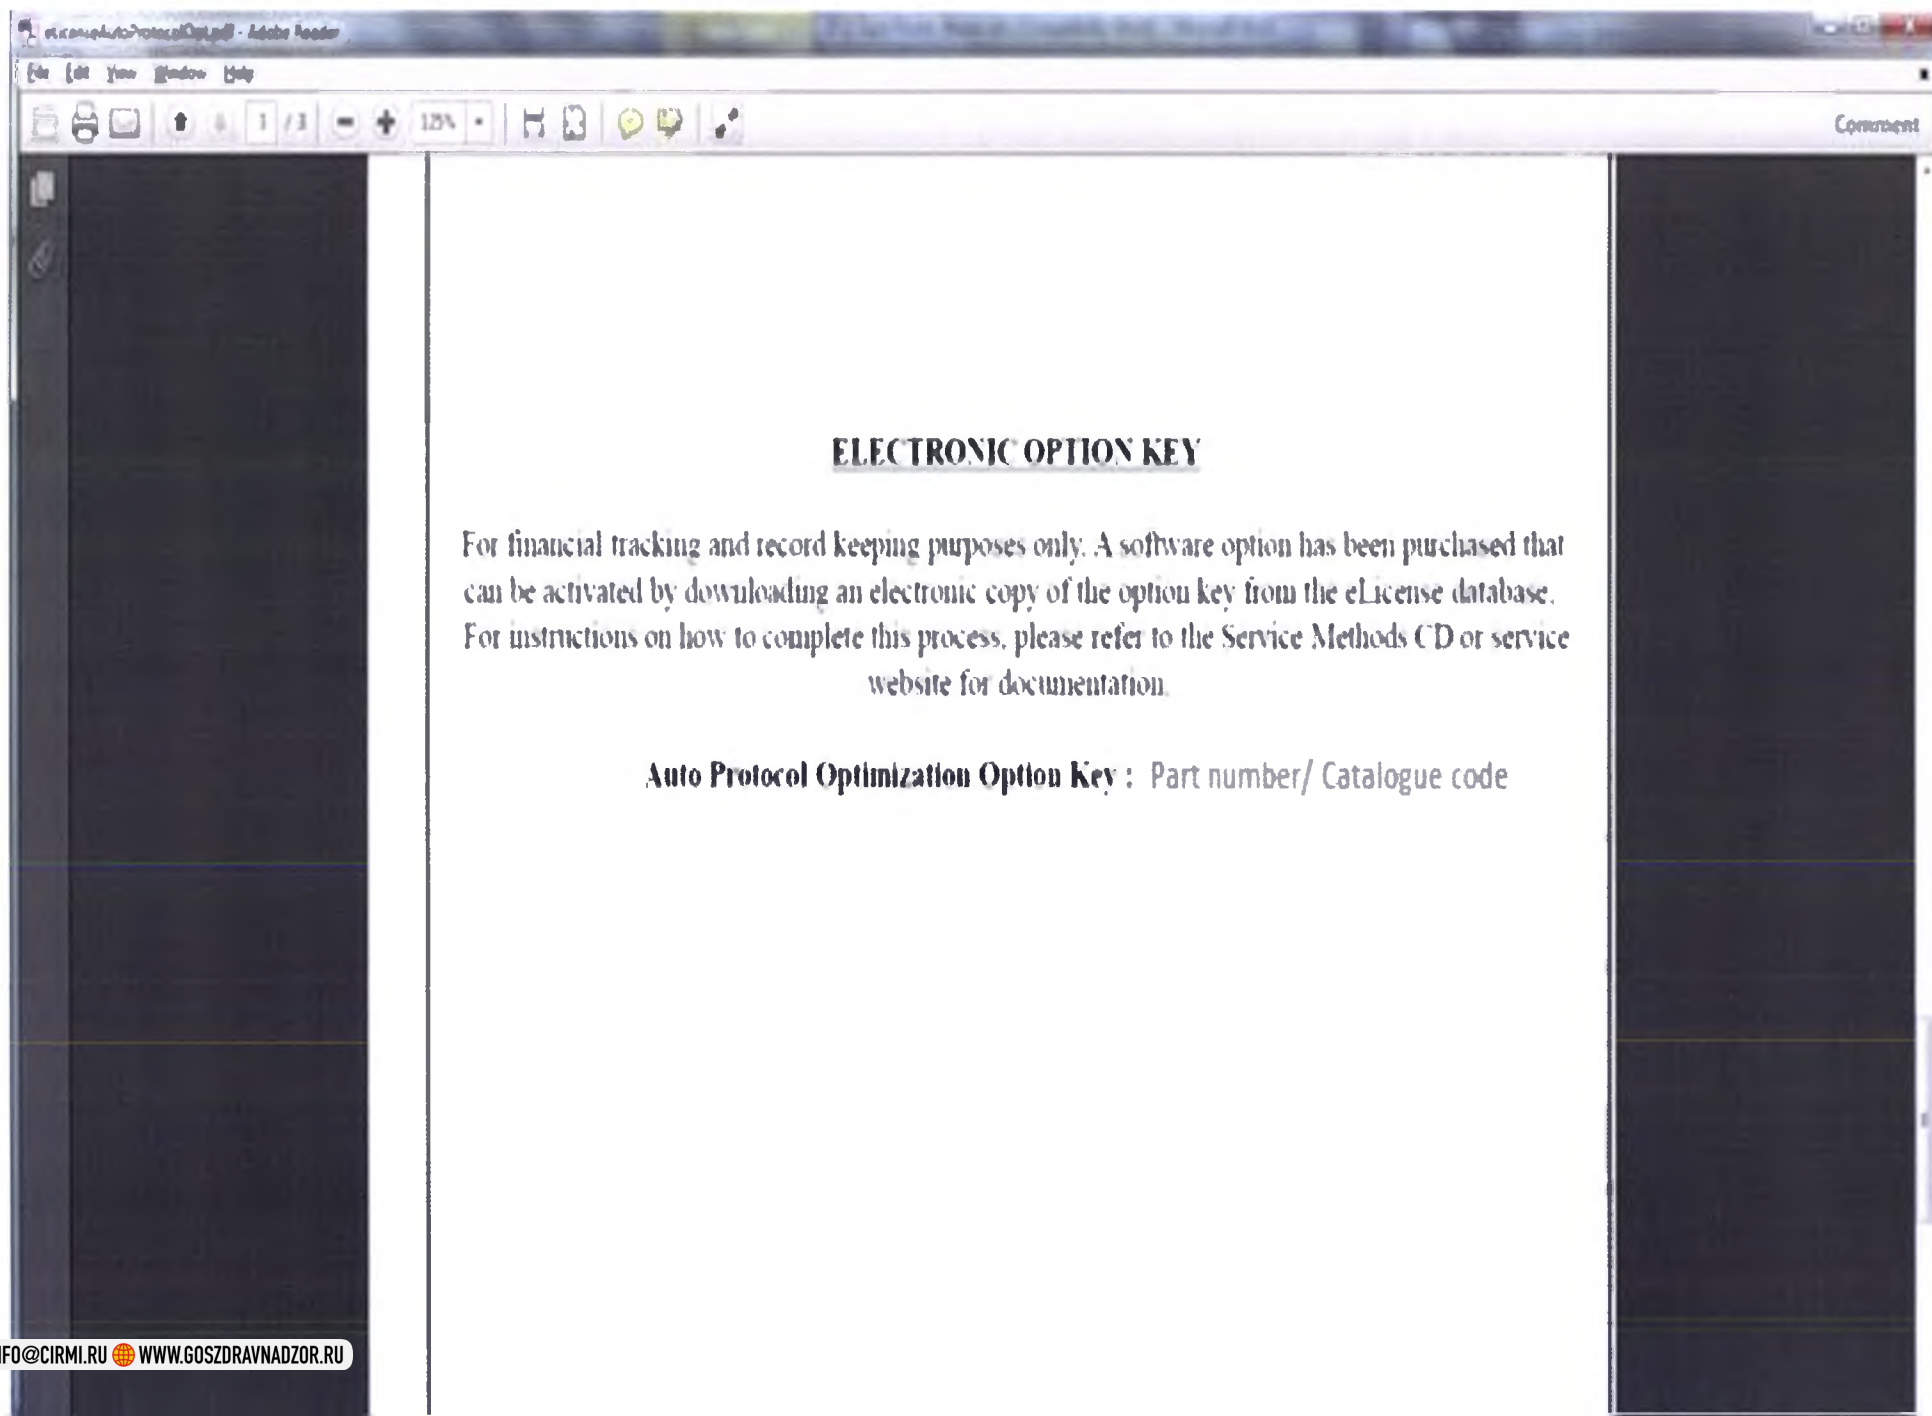


ELECTRONIC OPTION KEY

For financial tracking and record keeping purposes only. A software option has been purchased that can be activated by downloading an electronic copy of the option key from the eLicense database. For instructions on how to complete this process, please refer to the Service Methods CD or service website for documentation.

Auto Protocol Optimization Option Key : Part number/ Catalogue code

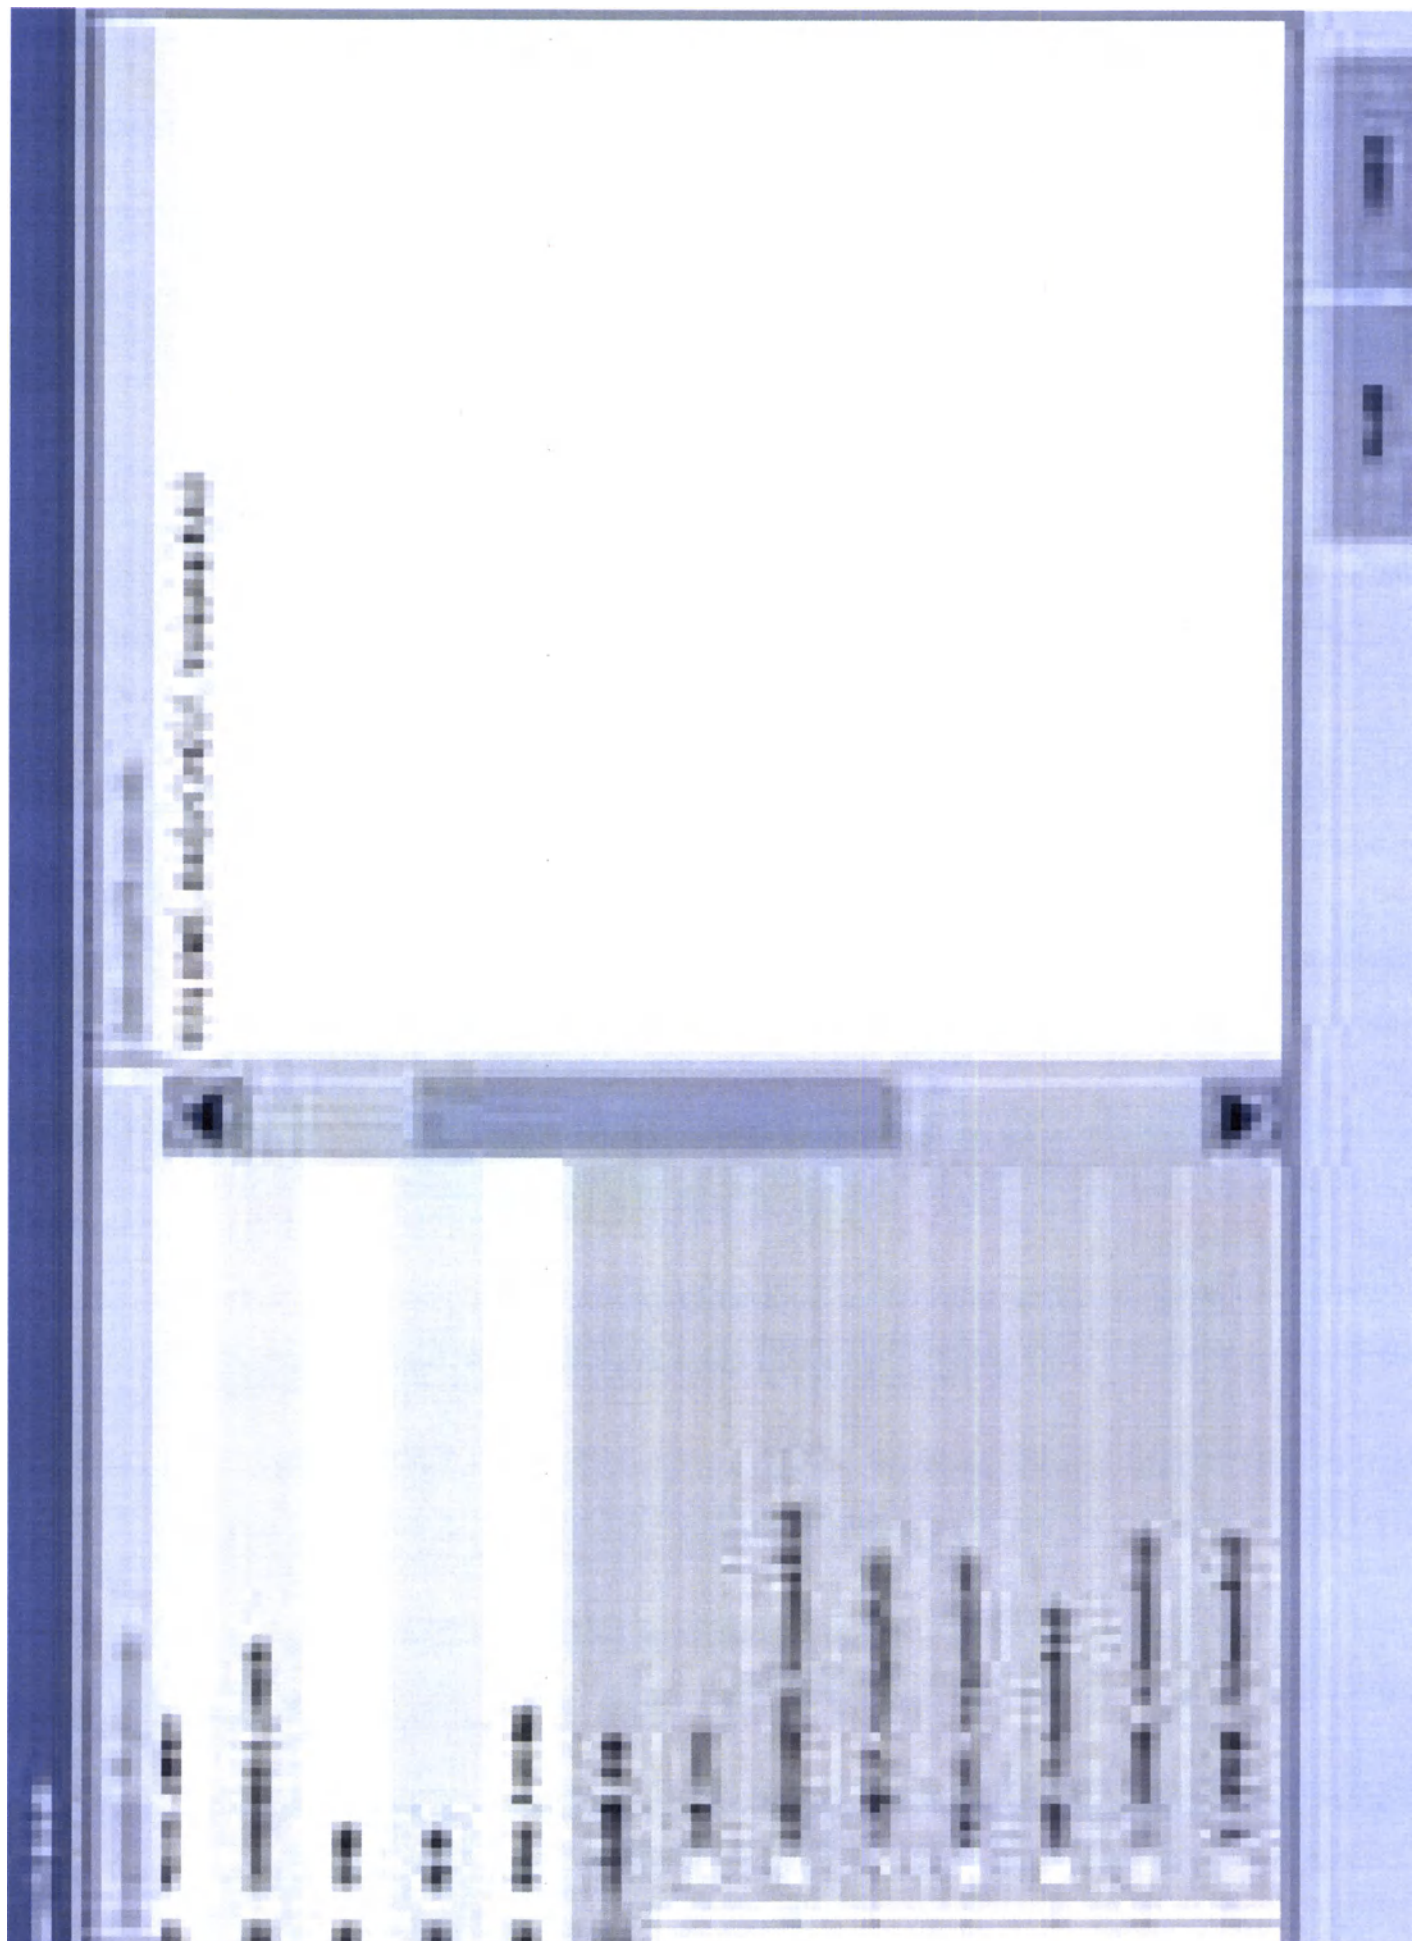

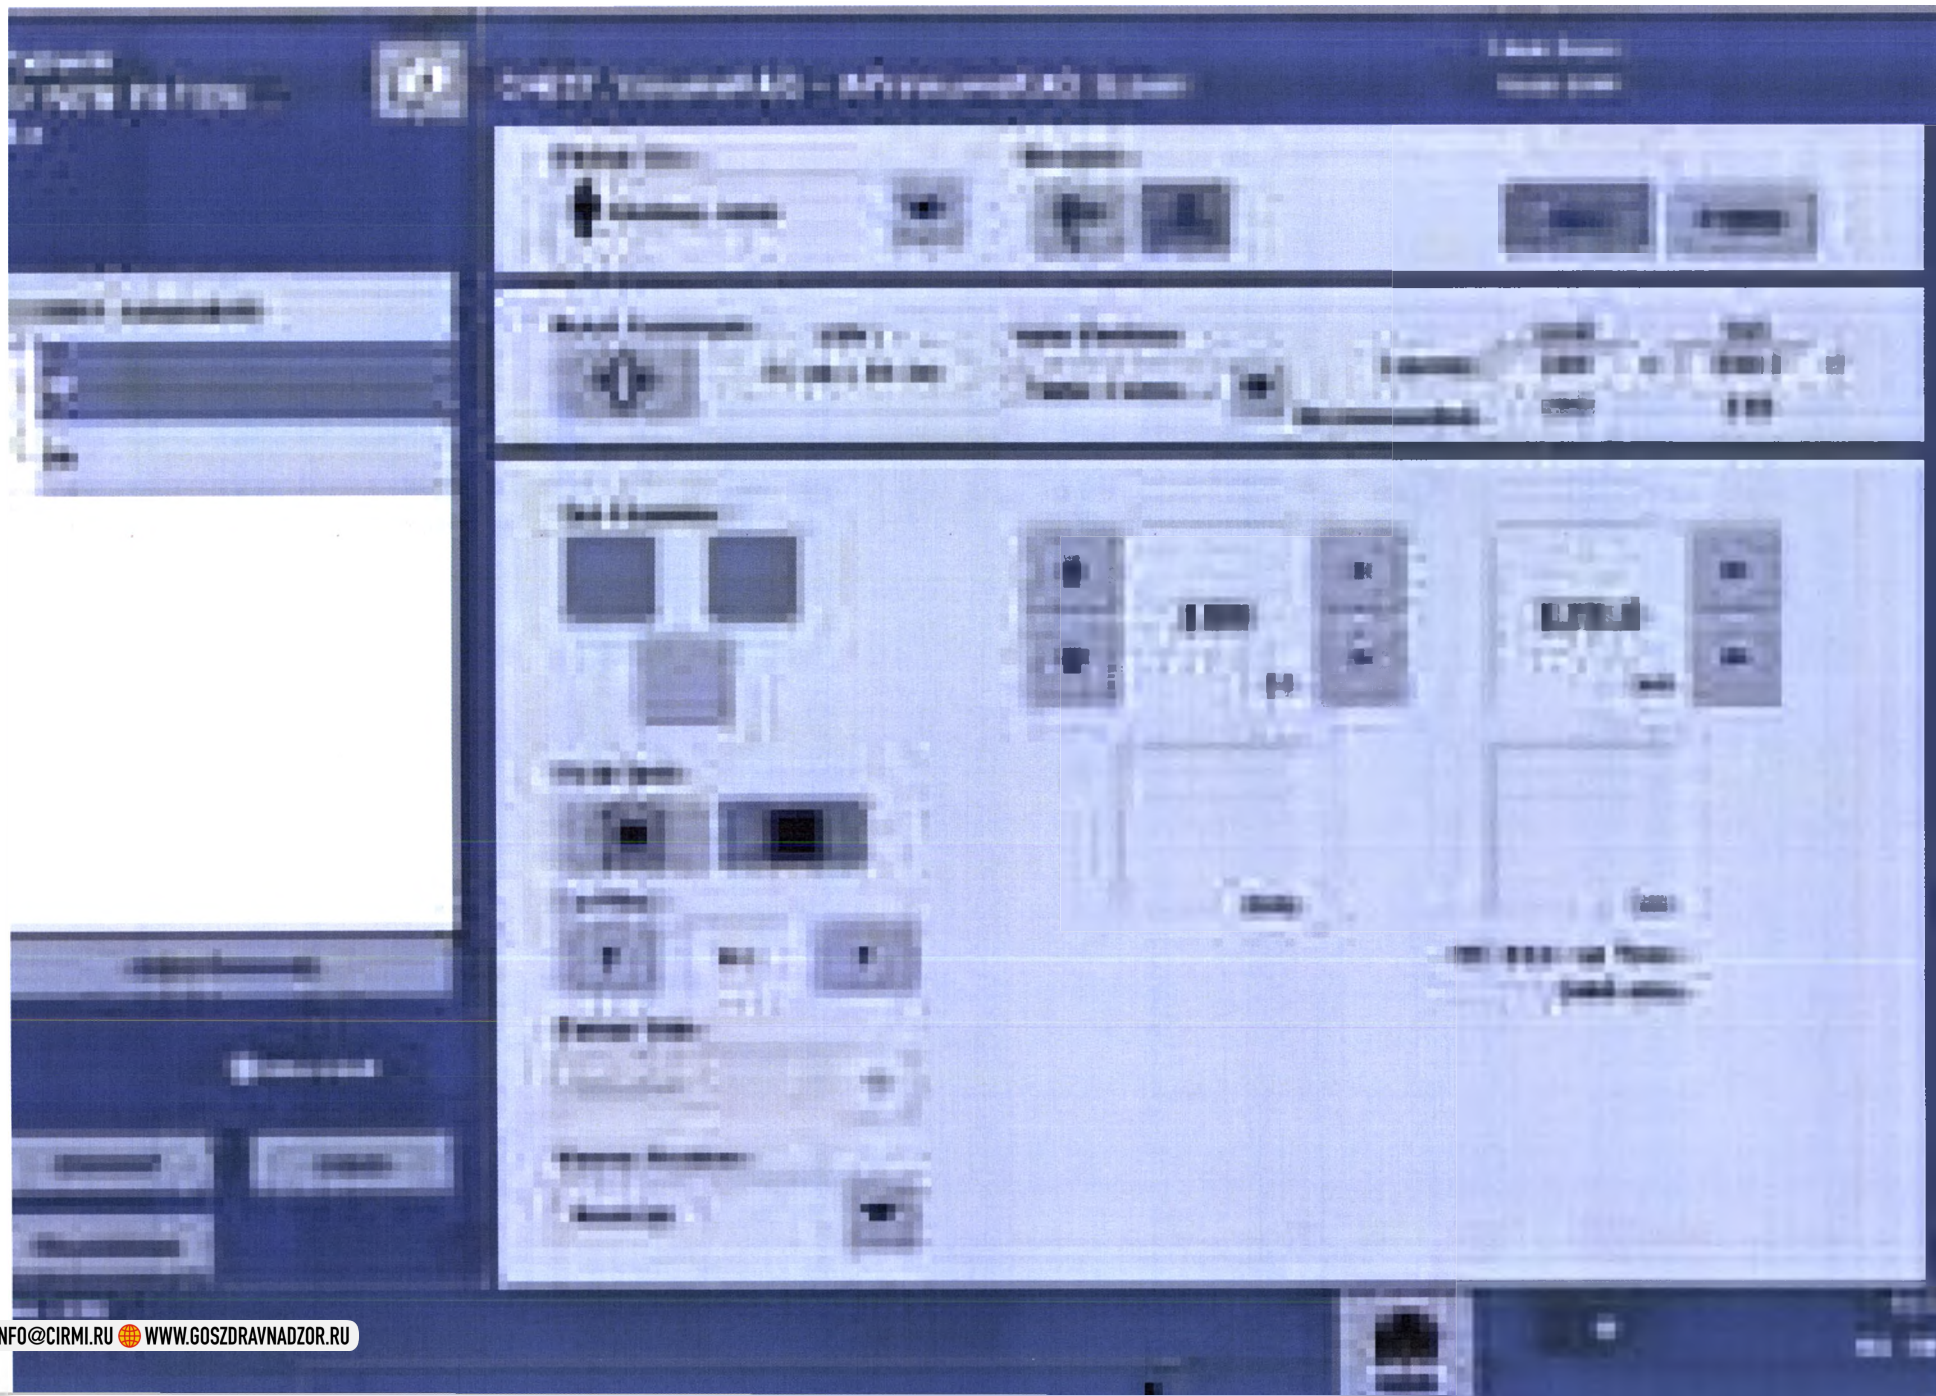

34. Рабочие станции для сбора и анализа полученных изображений (не более 4 шт.).







20. Среда для репродукции (не менее 10 шт.)





GE Healthcare

www.gehealthcare.com

Technical Publication

Direction 5343950-1EN

Revision 11


GE Healthcare


Discovery TM XR656 Installation Manual

Copyright © 2011 by General Electric Company, Inc. All
rights reserved.






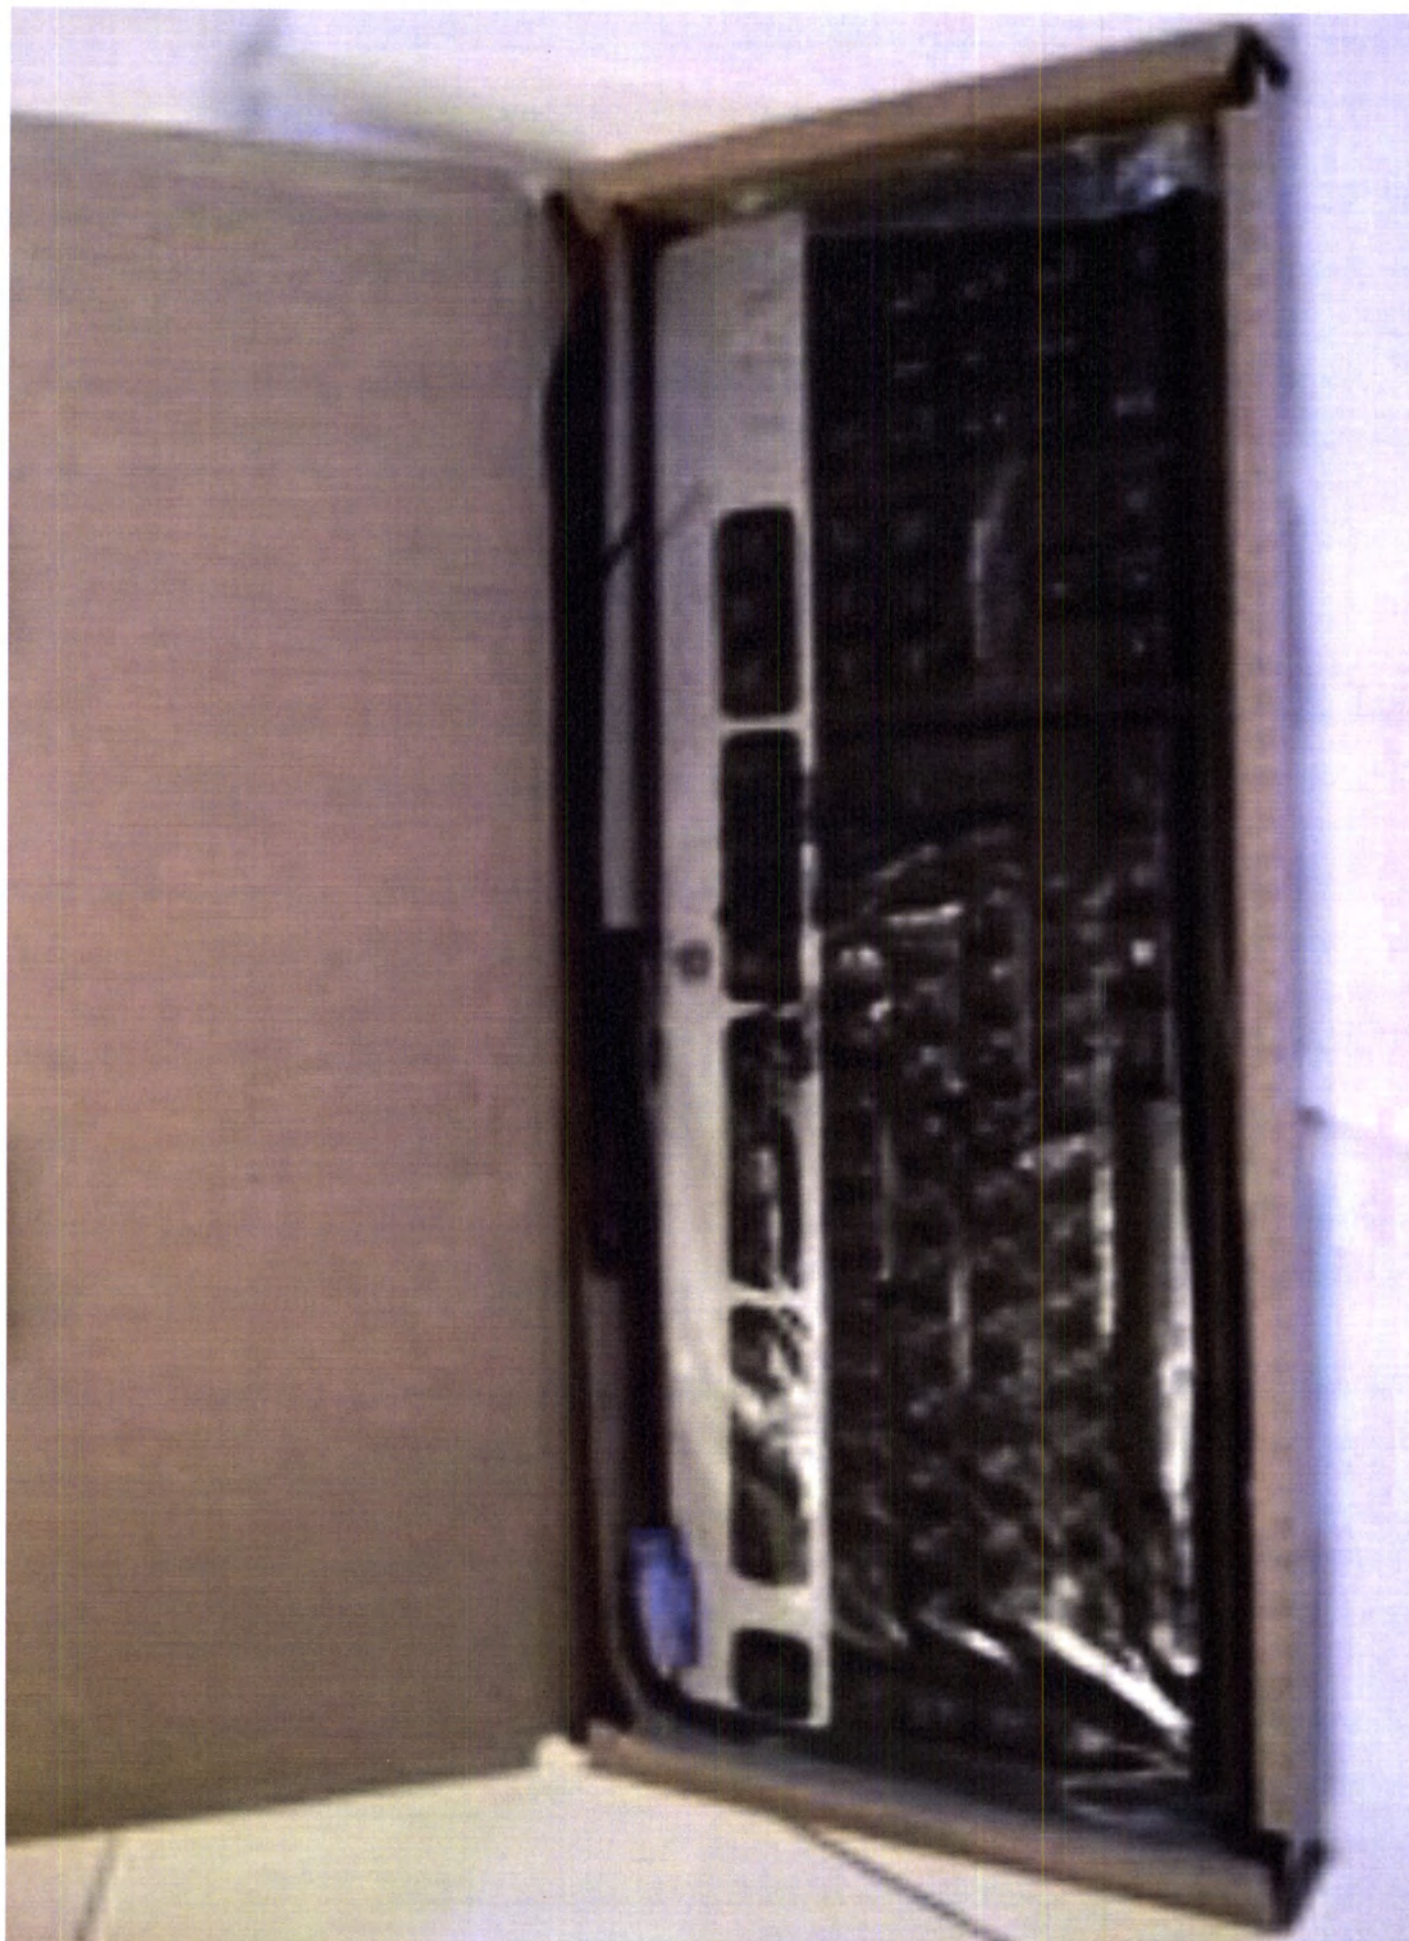

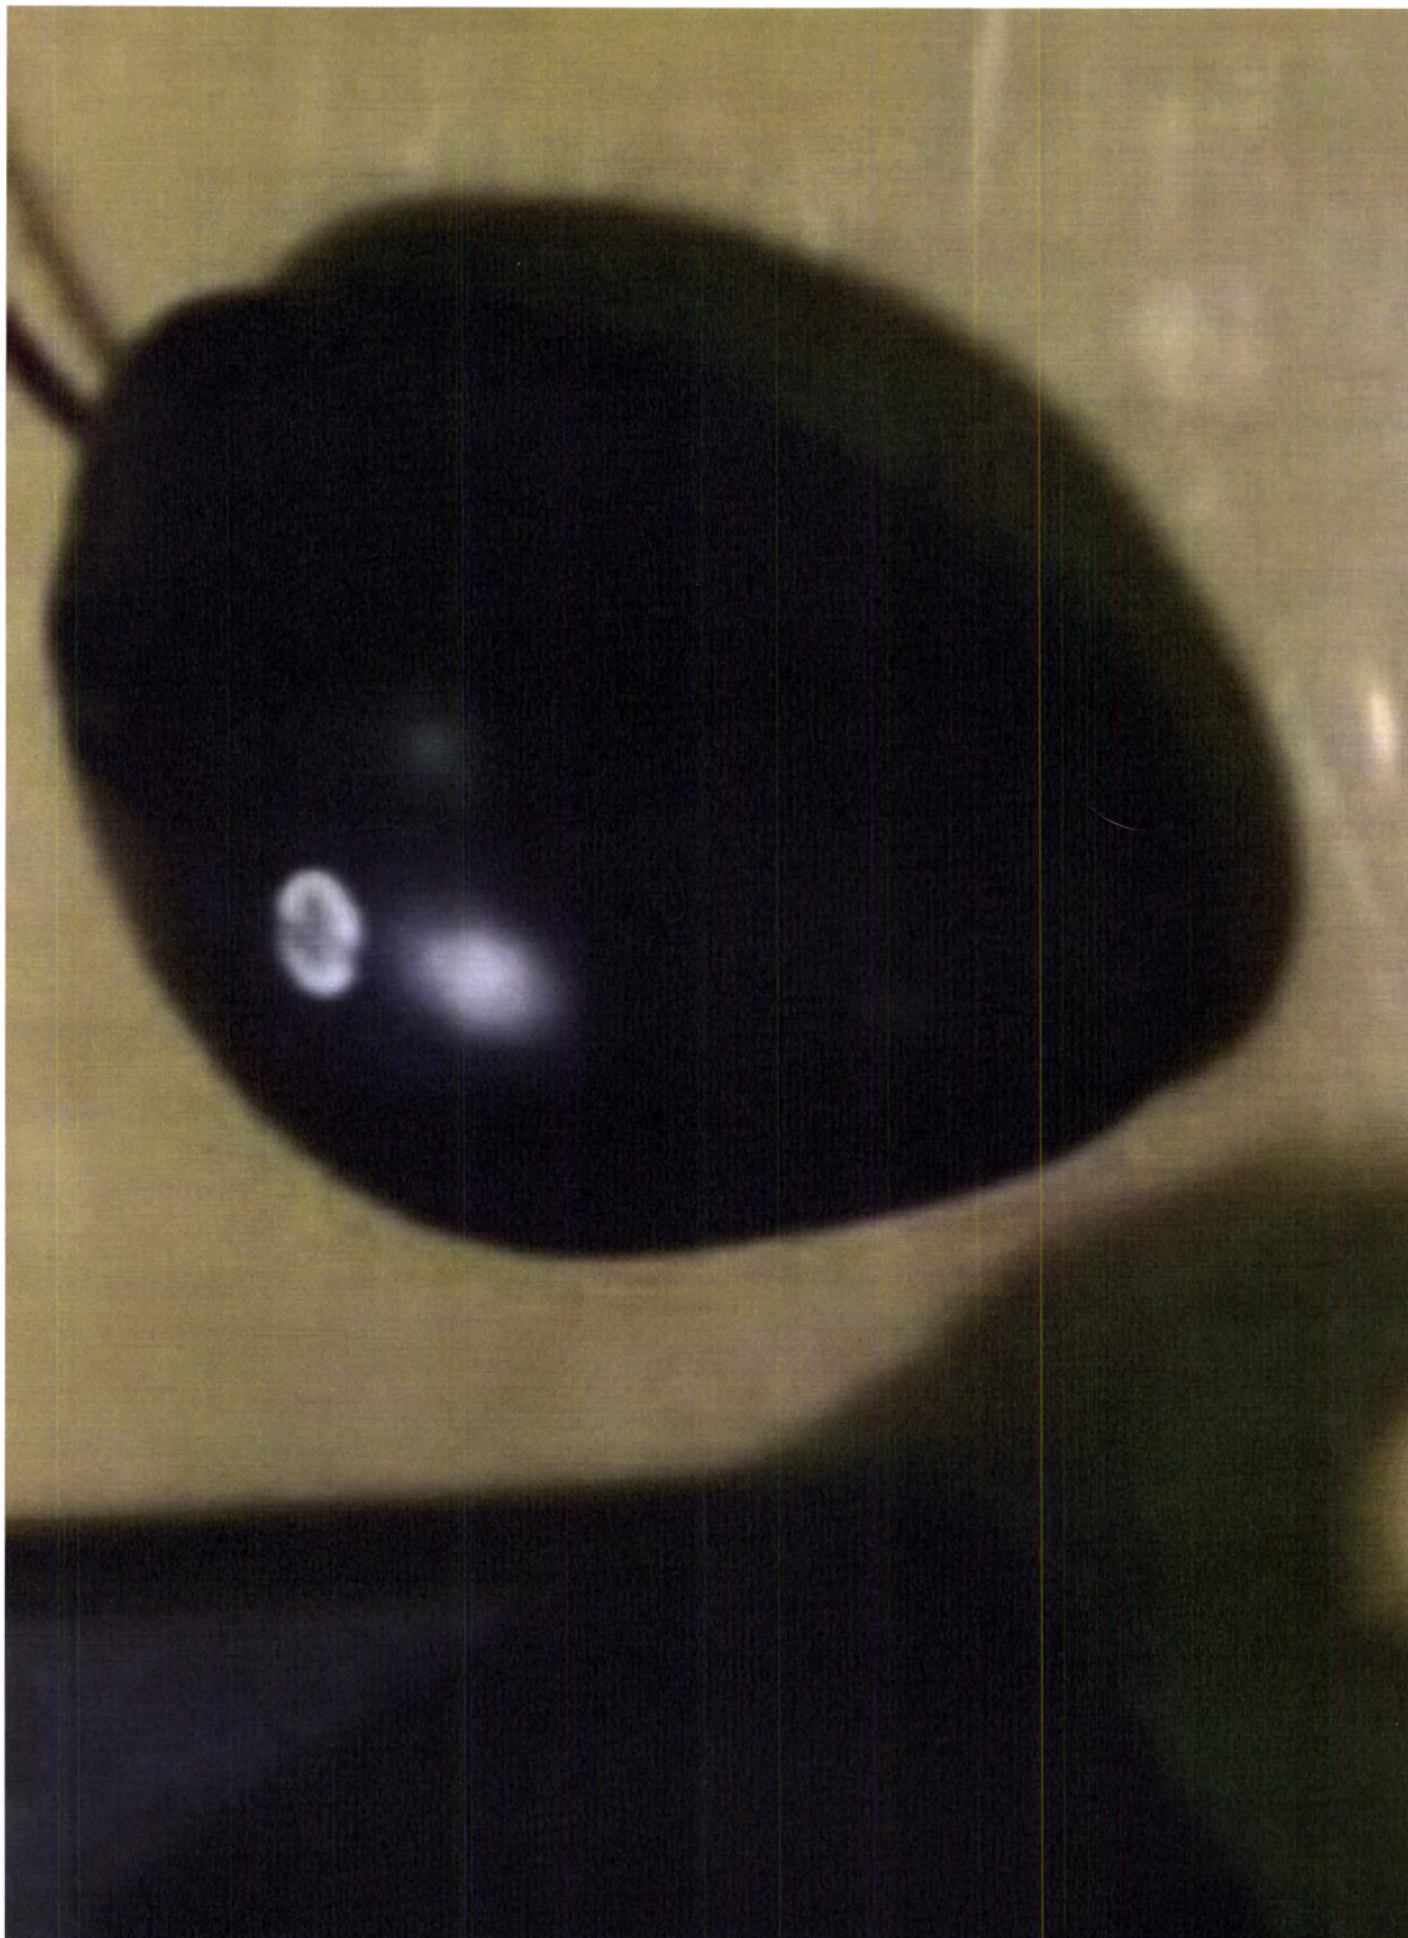




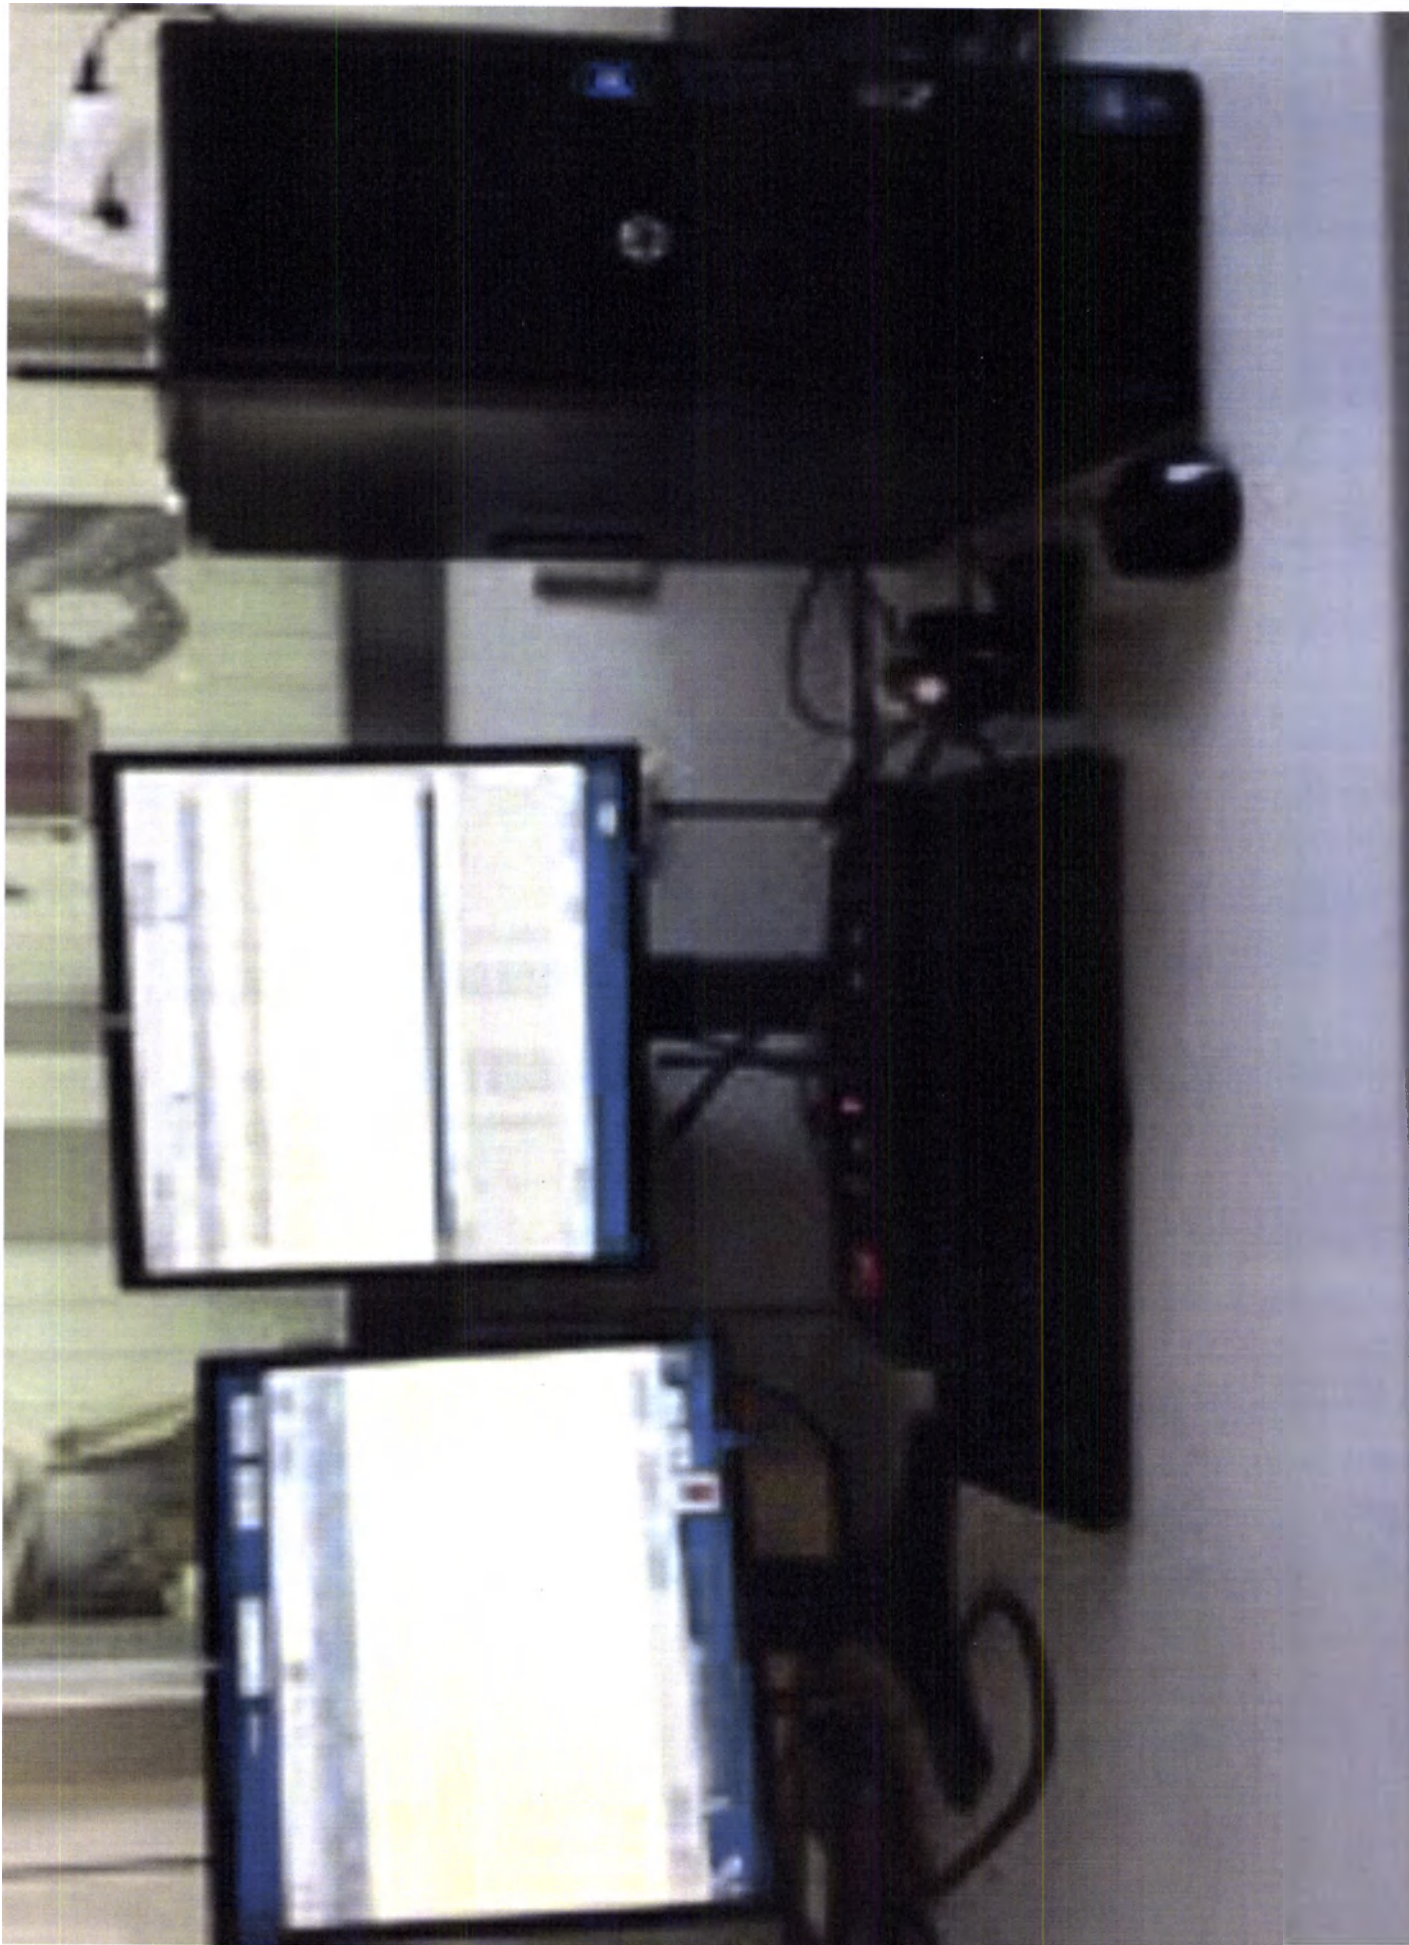




101 страна регистрации в район (не более 2 шт.)

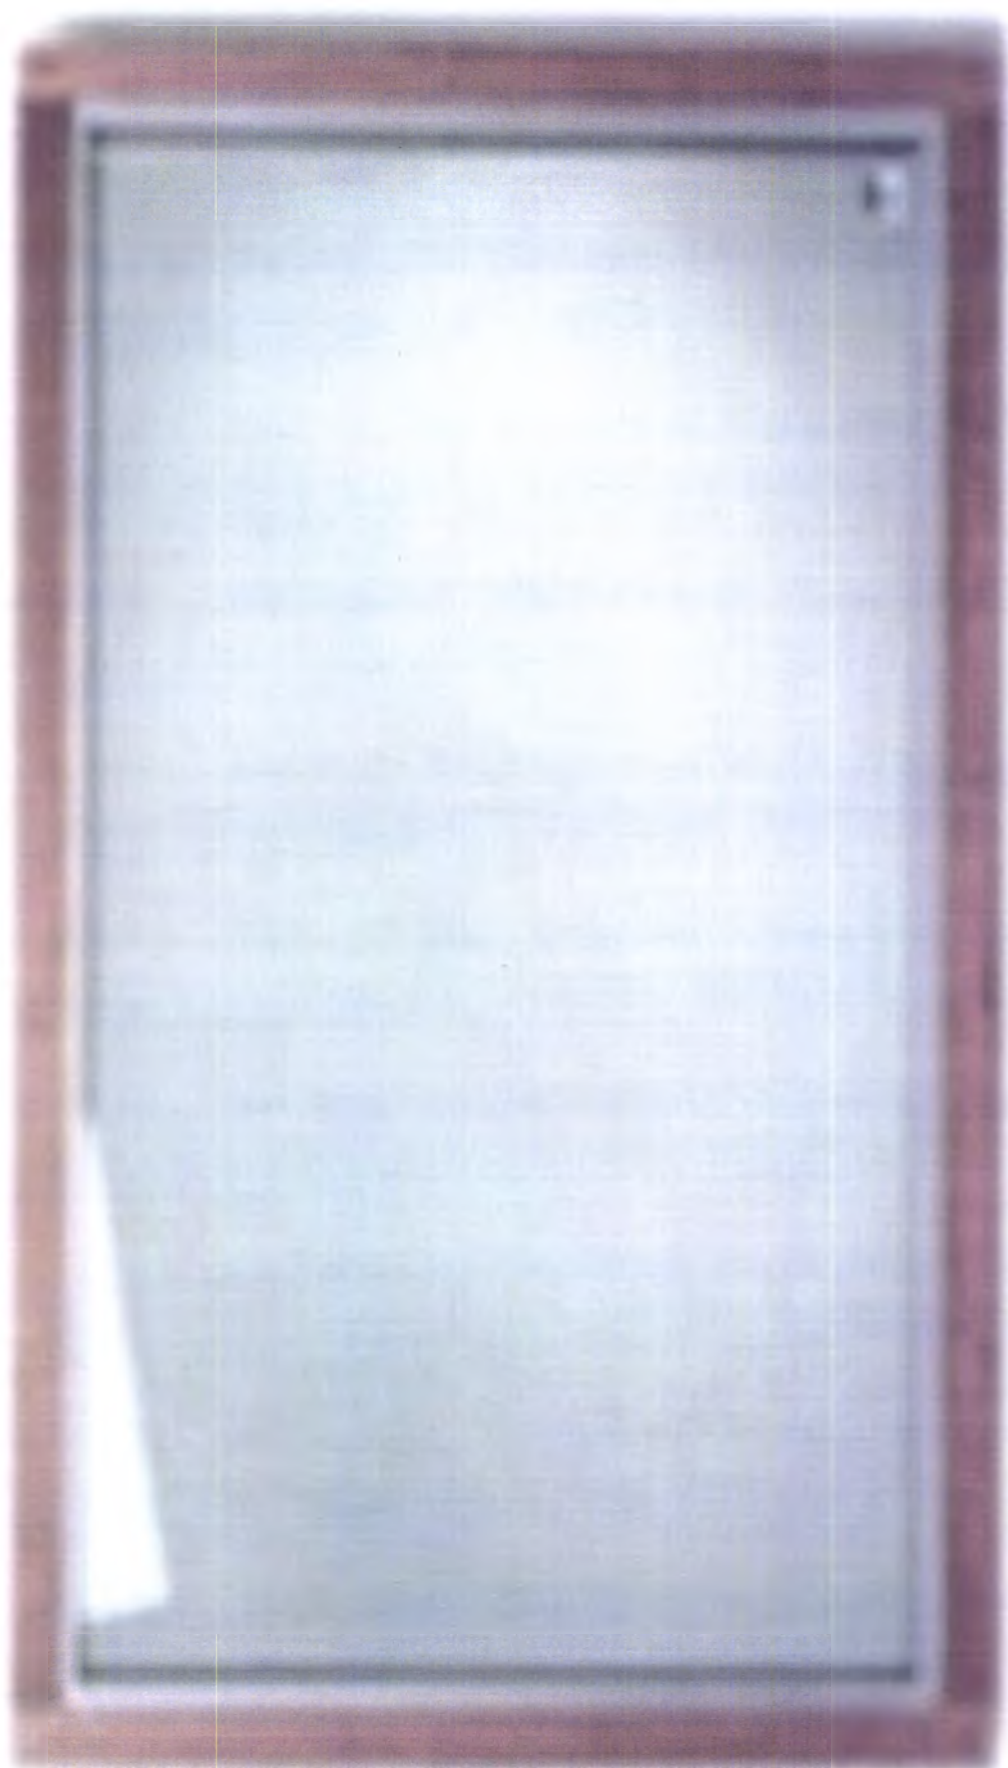



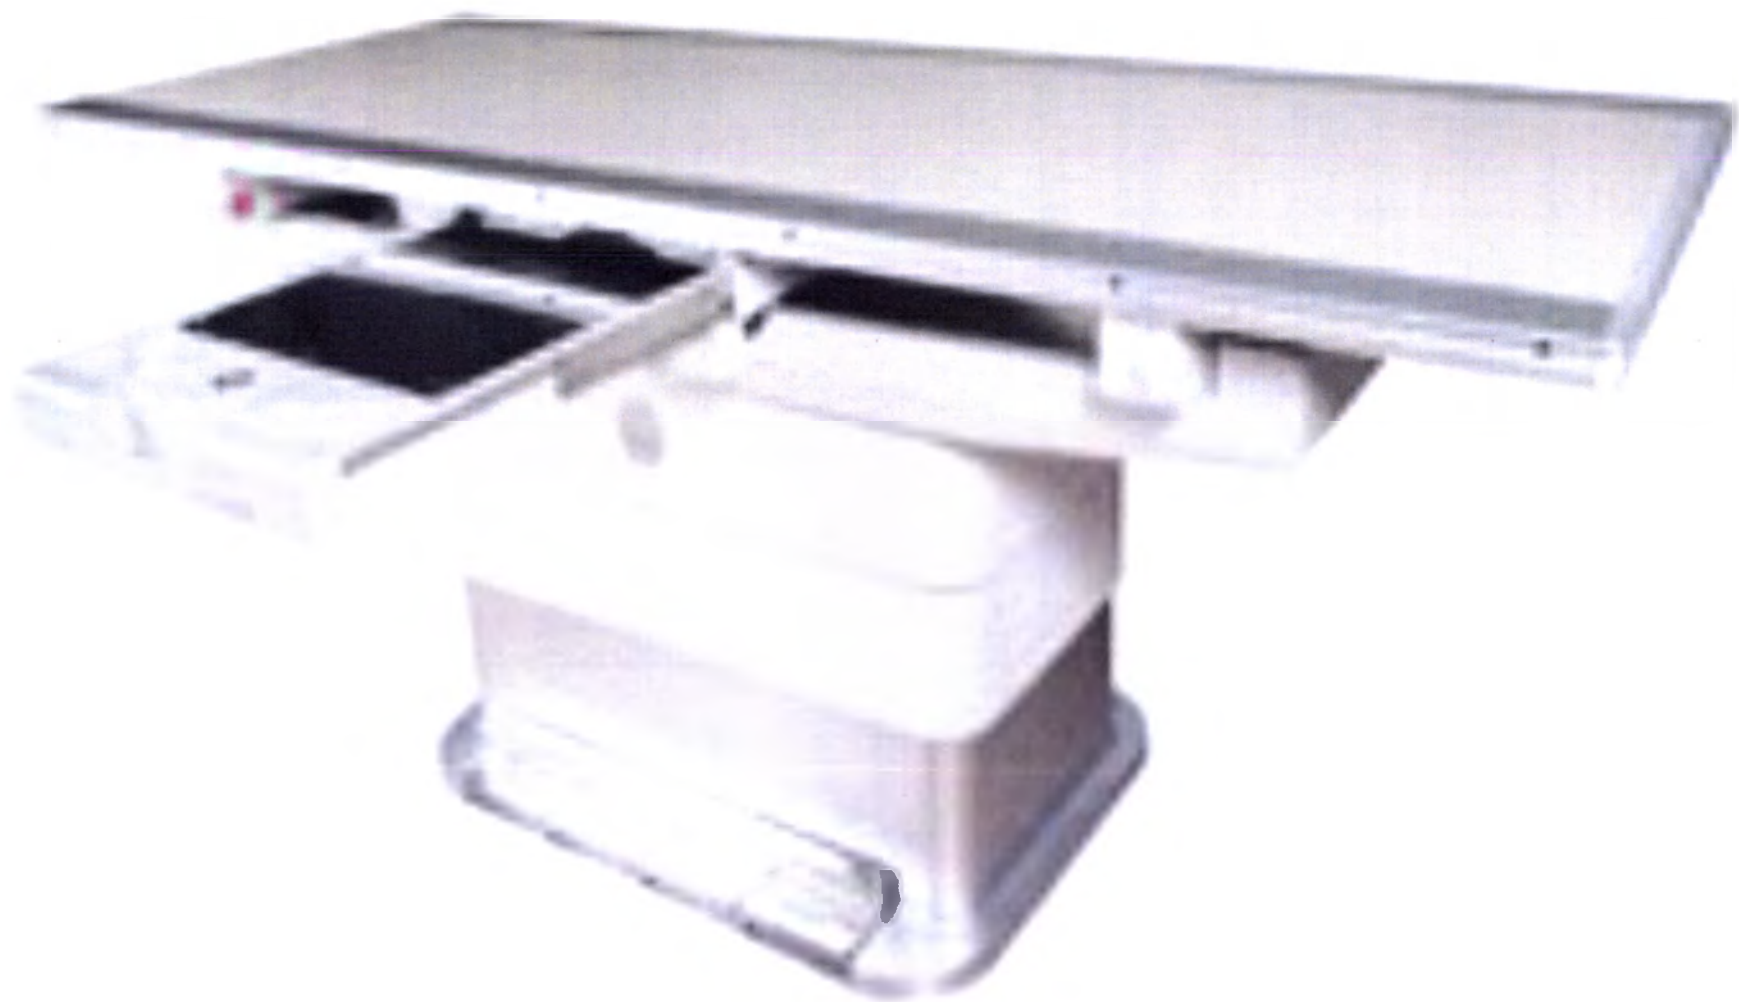





то. Телескопические колонны для трубки (не более 3 шт.).



... (до 10 см)



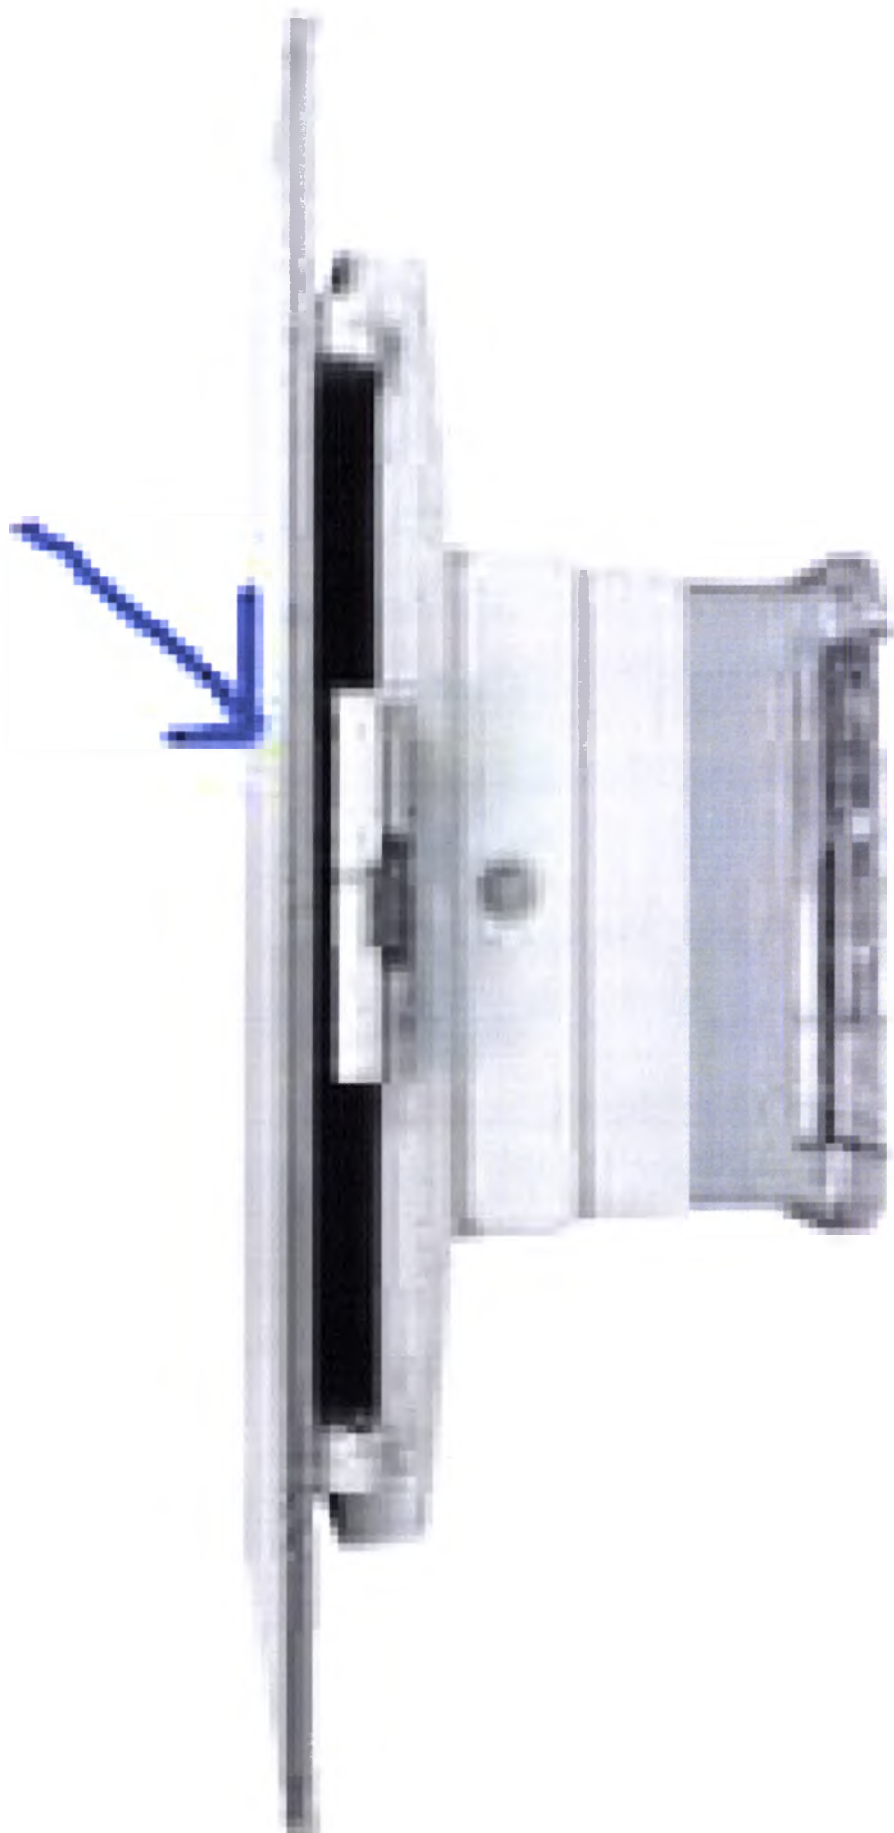

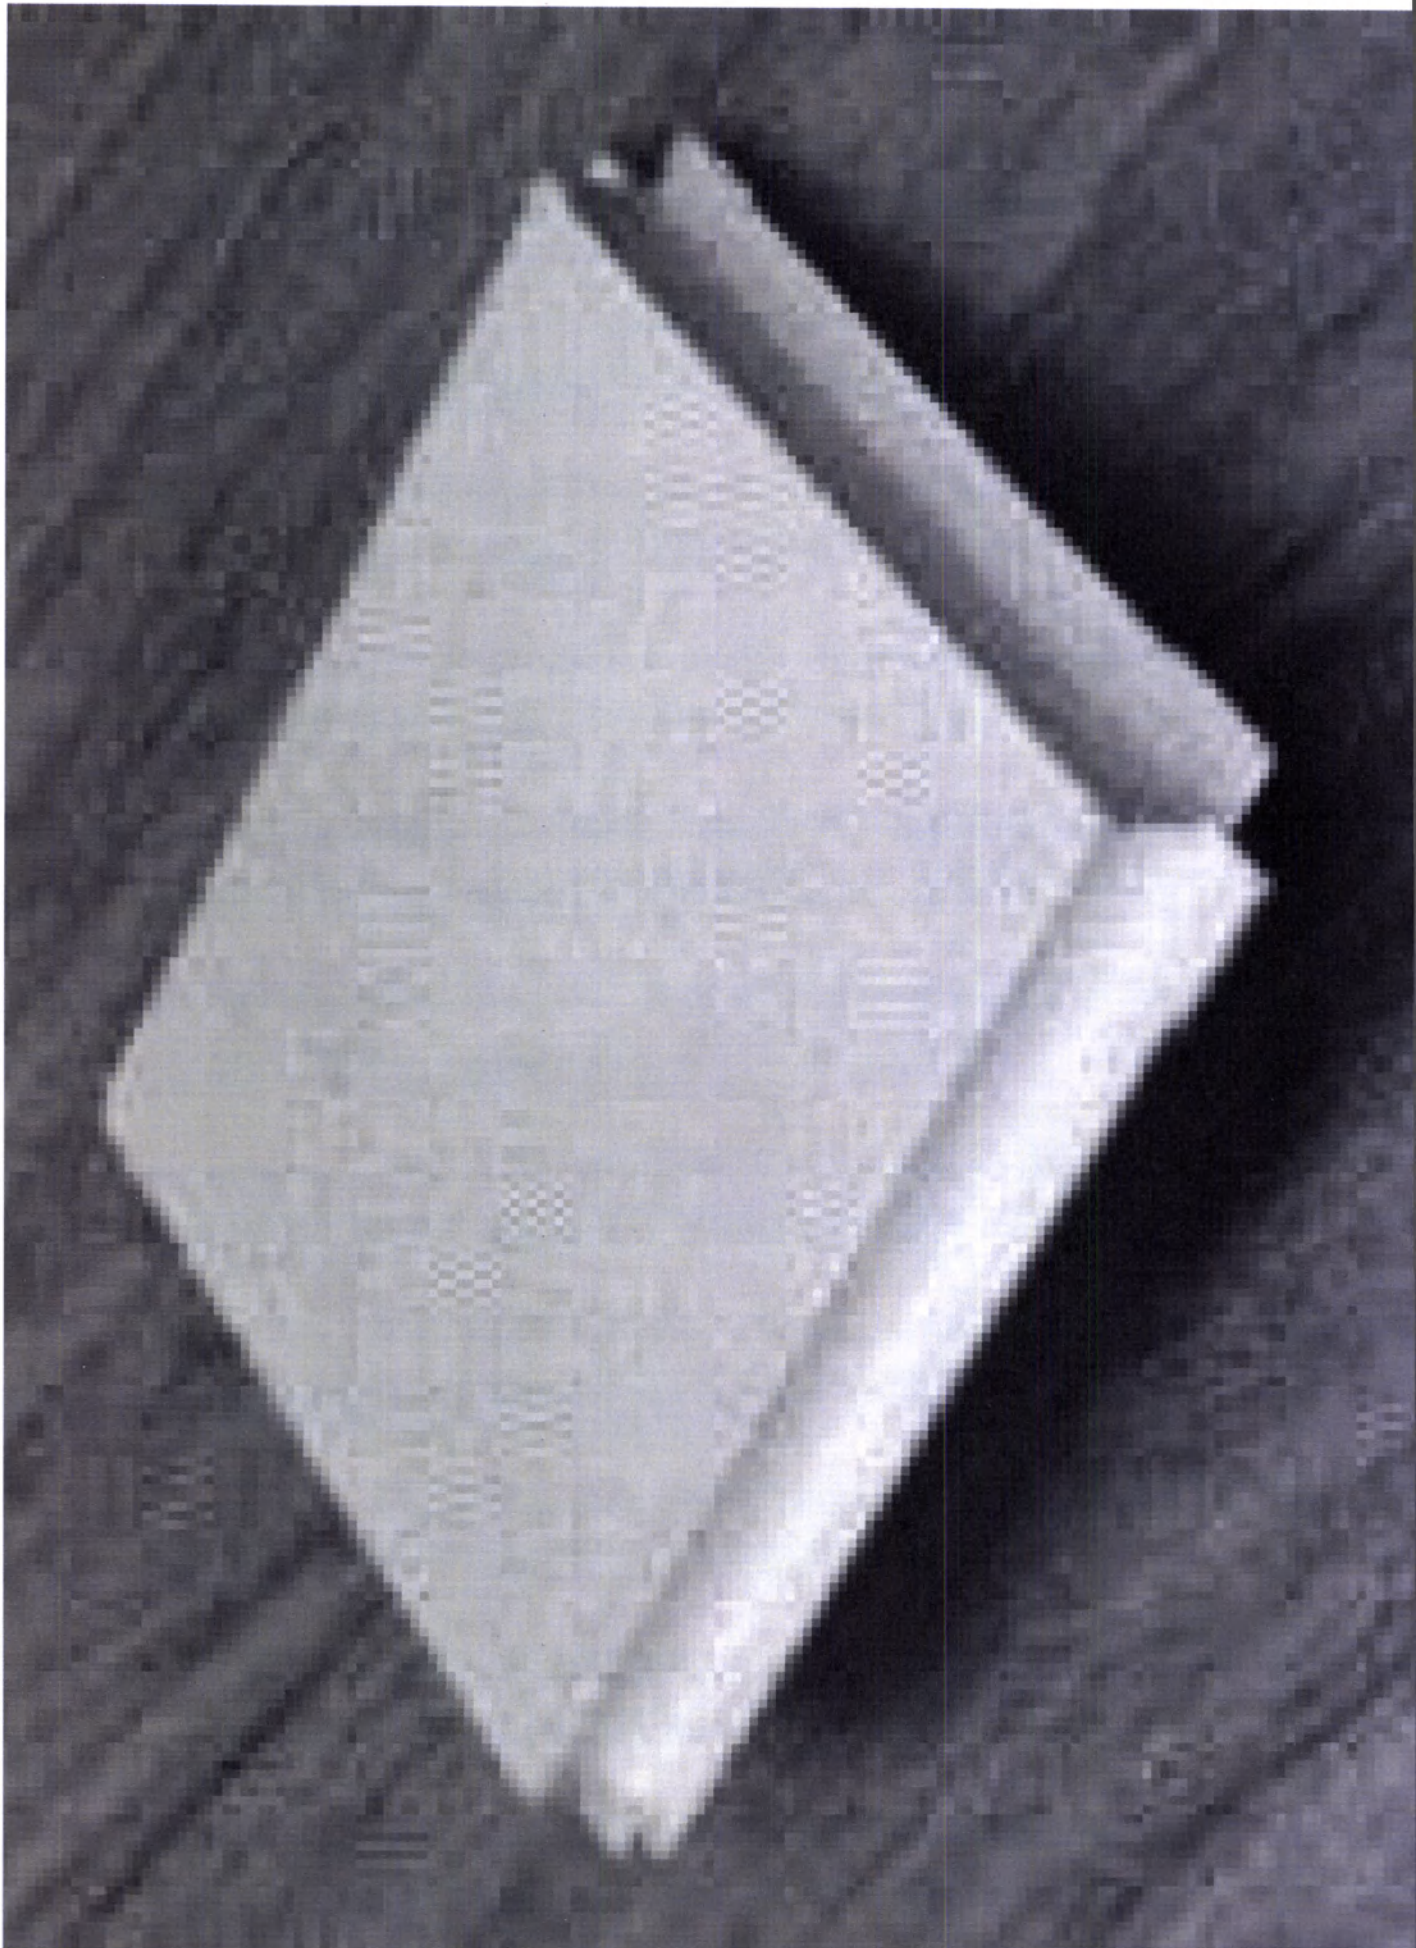




1.1. * пилыры релл еновекоег пелу темм (не еелее 5





51. Щиты электрораспределительные (не более 2 шт.).

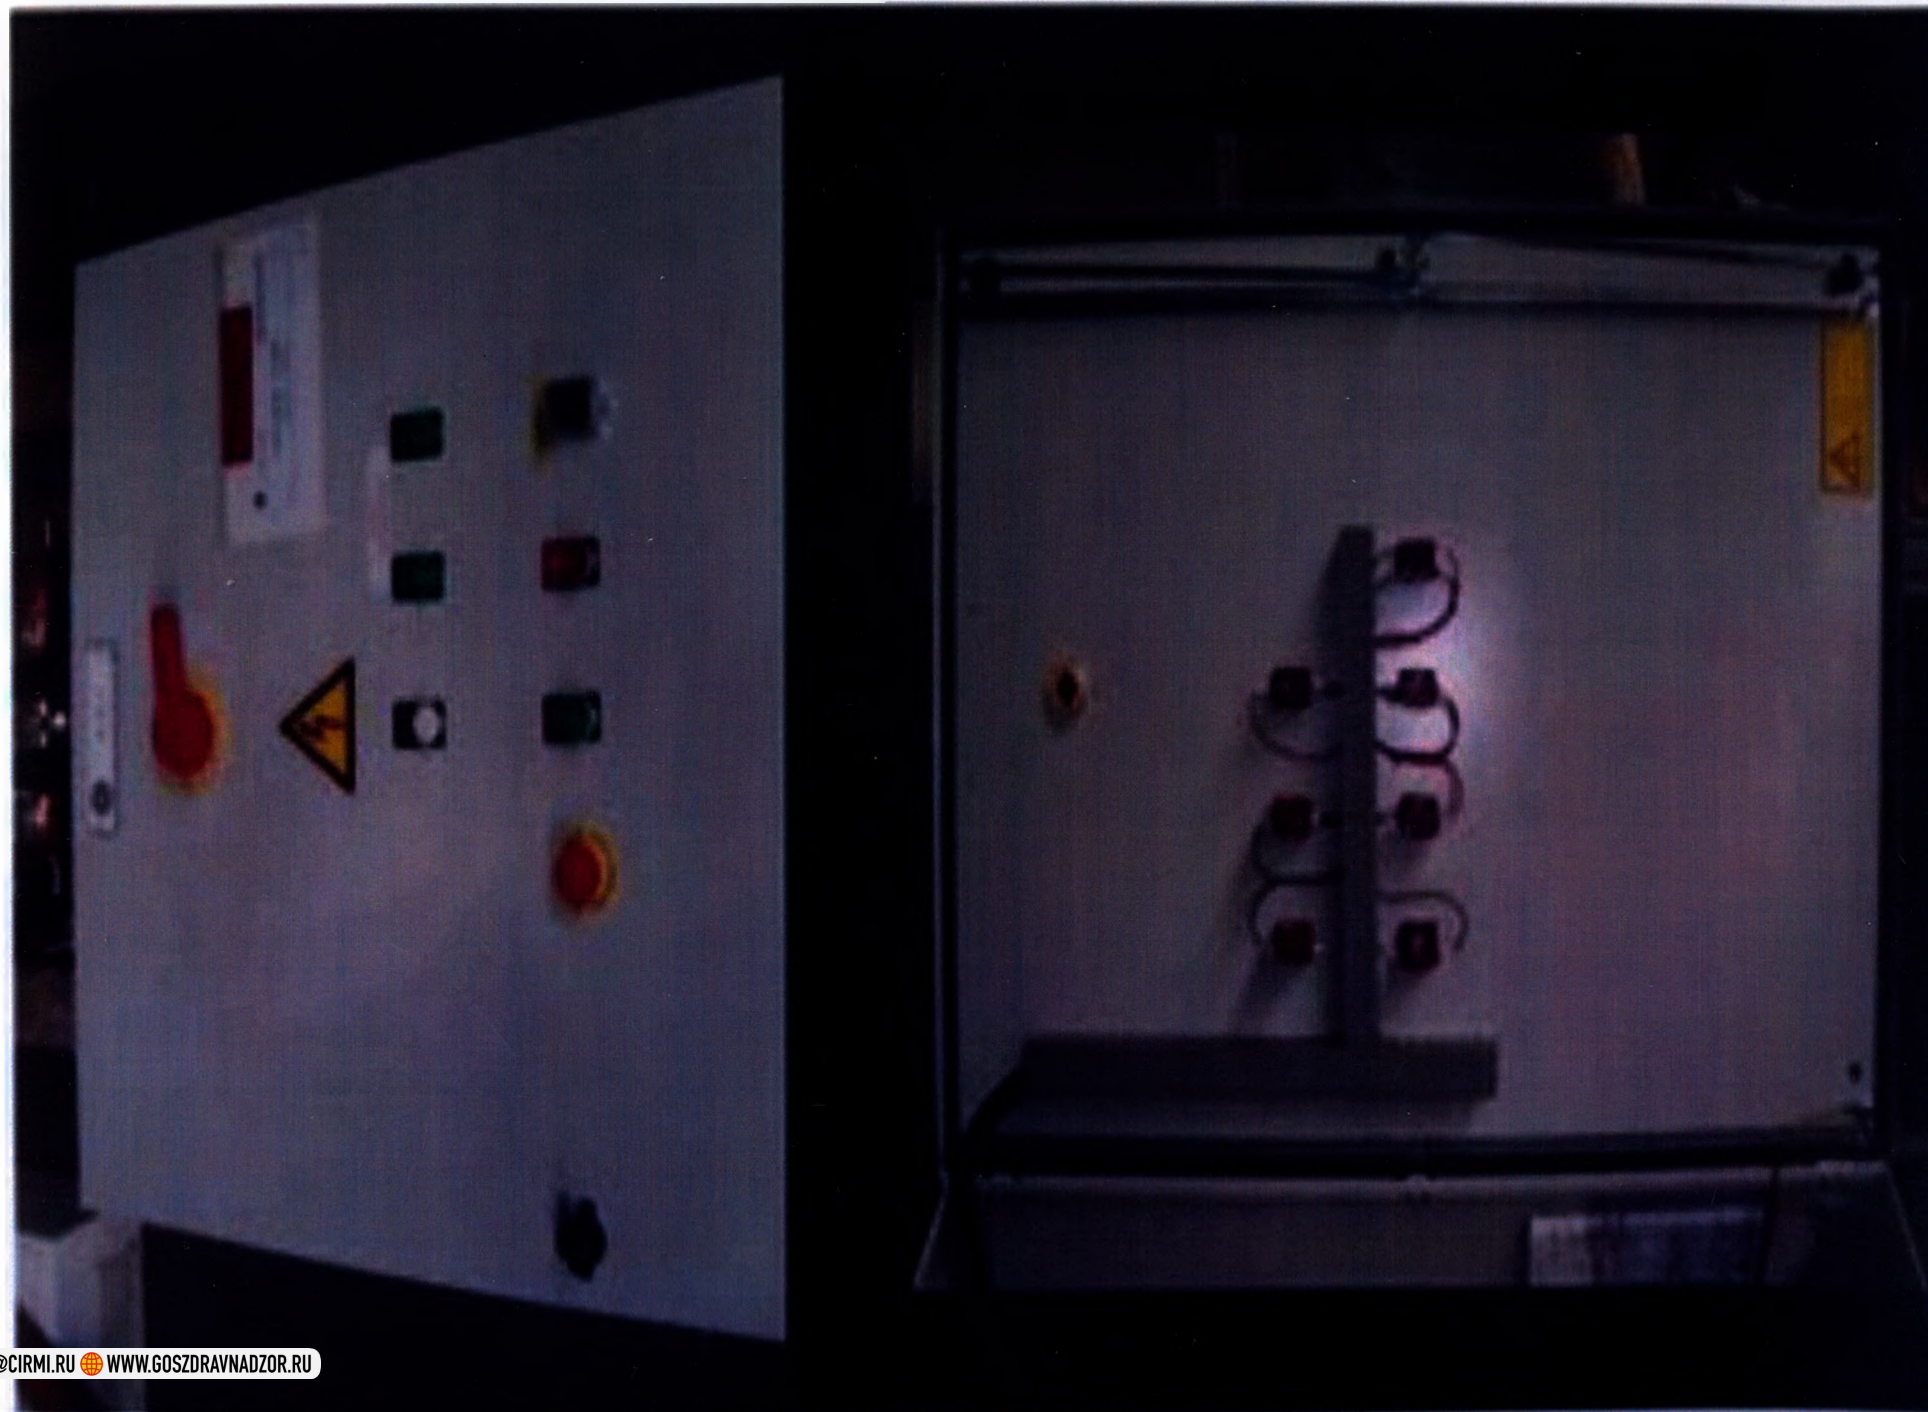

ПРОШТО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 8 ЛИСТА(ОВ)

