

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «НИИ «Полюс»

им. М.Ф. Стельмаха»


Е.В. Кузнецов

2017 г.




**Фотографические изображения
медицинского изделия**


Аппарат ИАГ-лазерный офтальмохирургический АЛОФмх-02 по ТУ-
26.60.13-008-07531870-2017

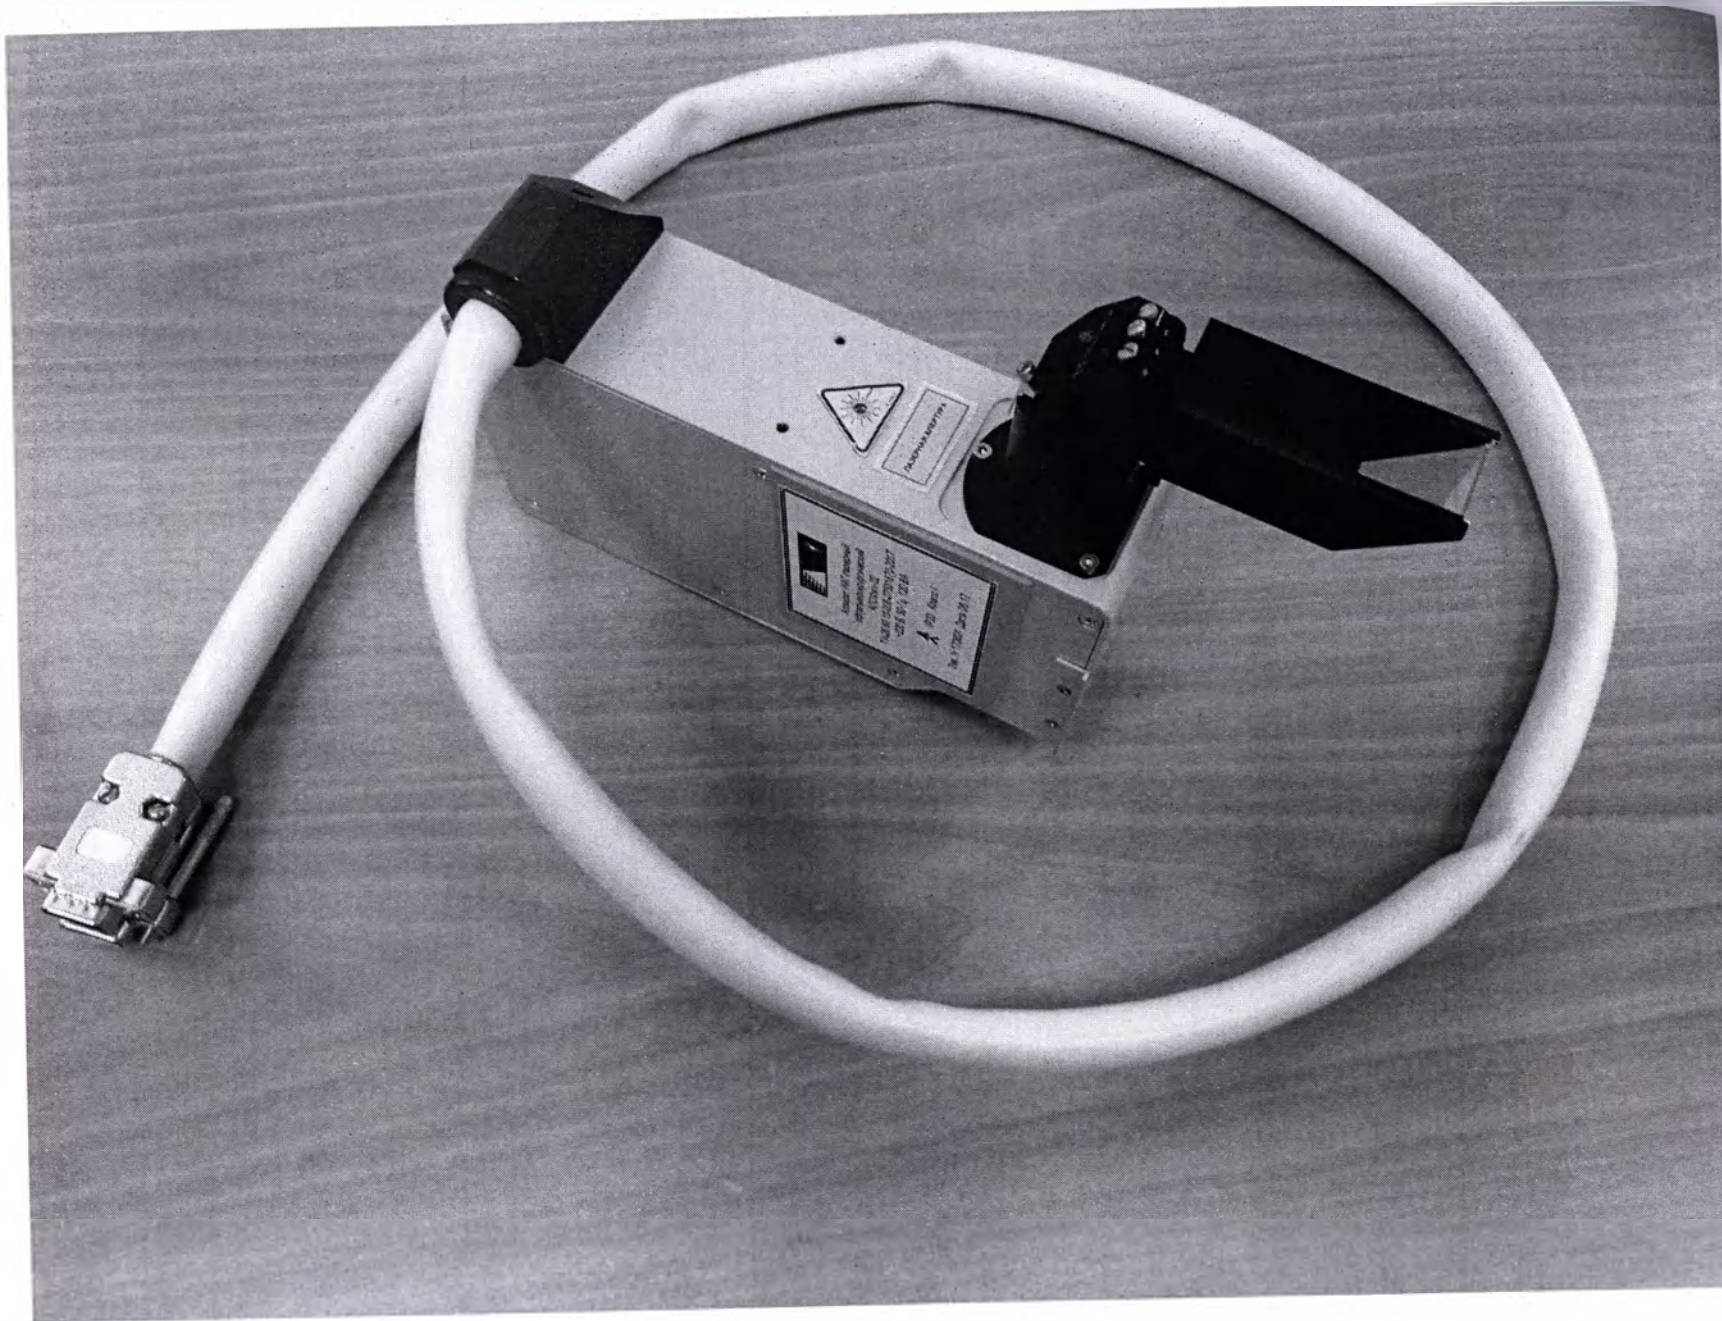

Блок оптический аппарата с соединительным кабелем

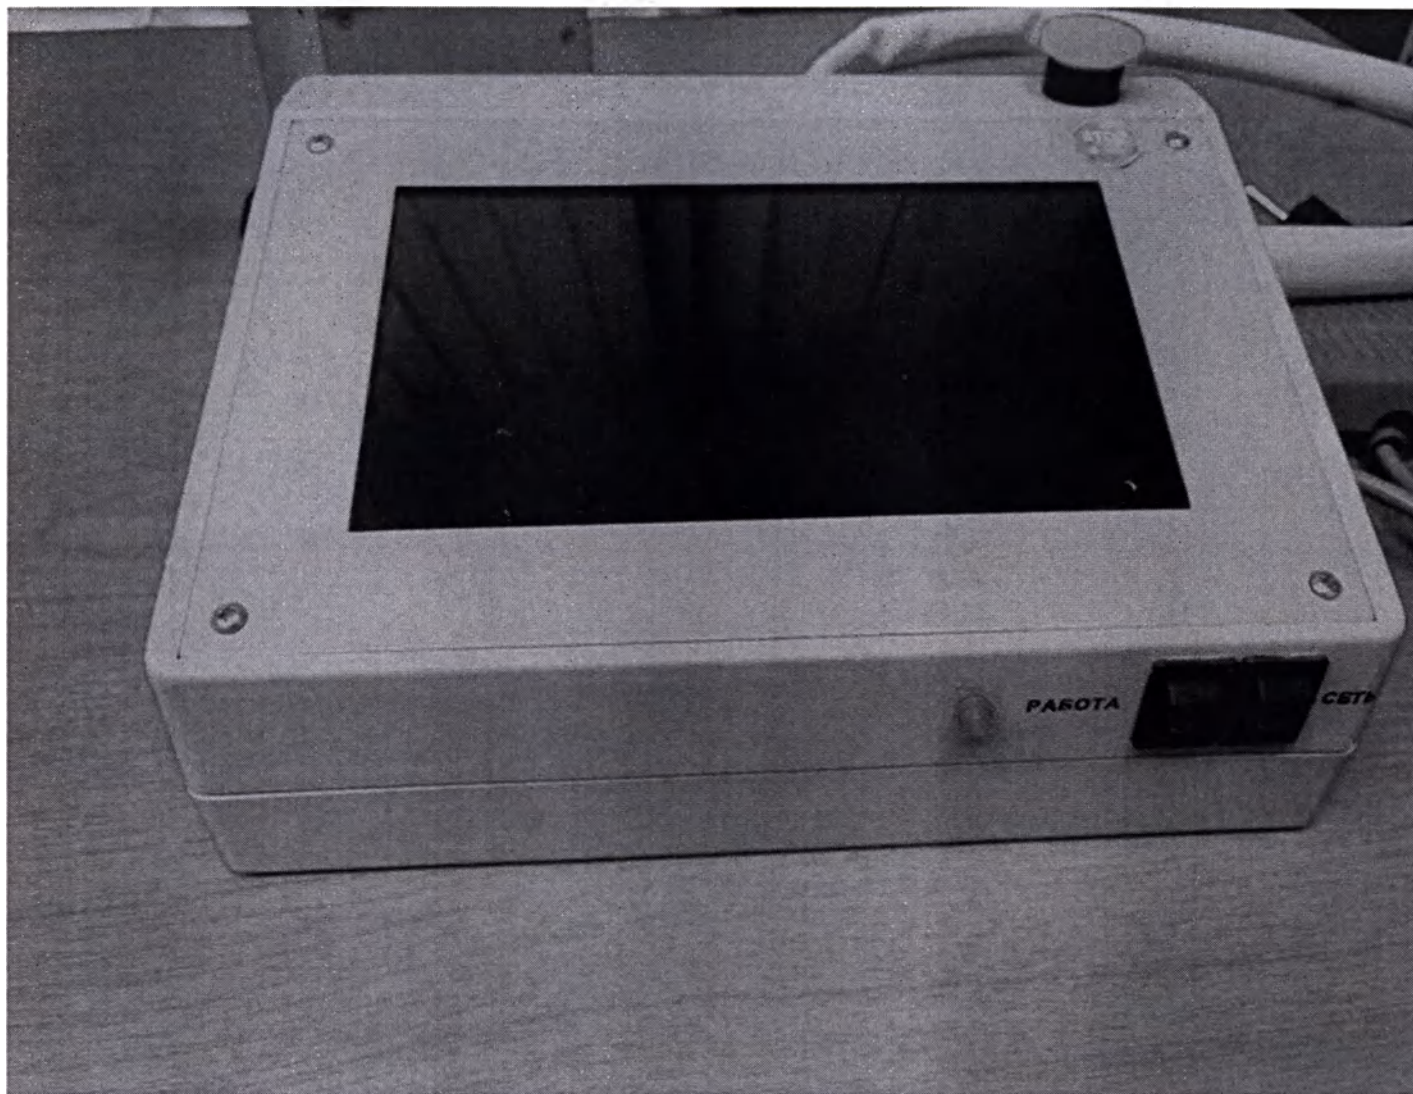

Блок питания и управления аппарата

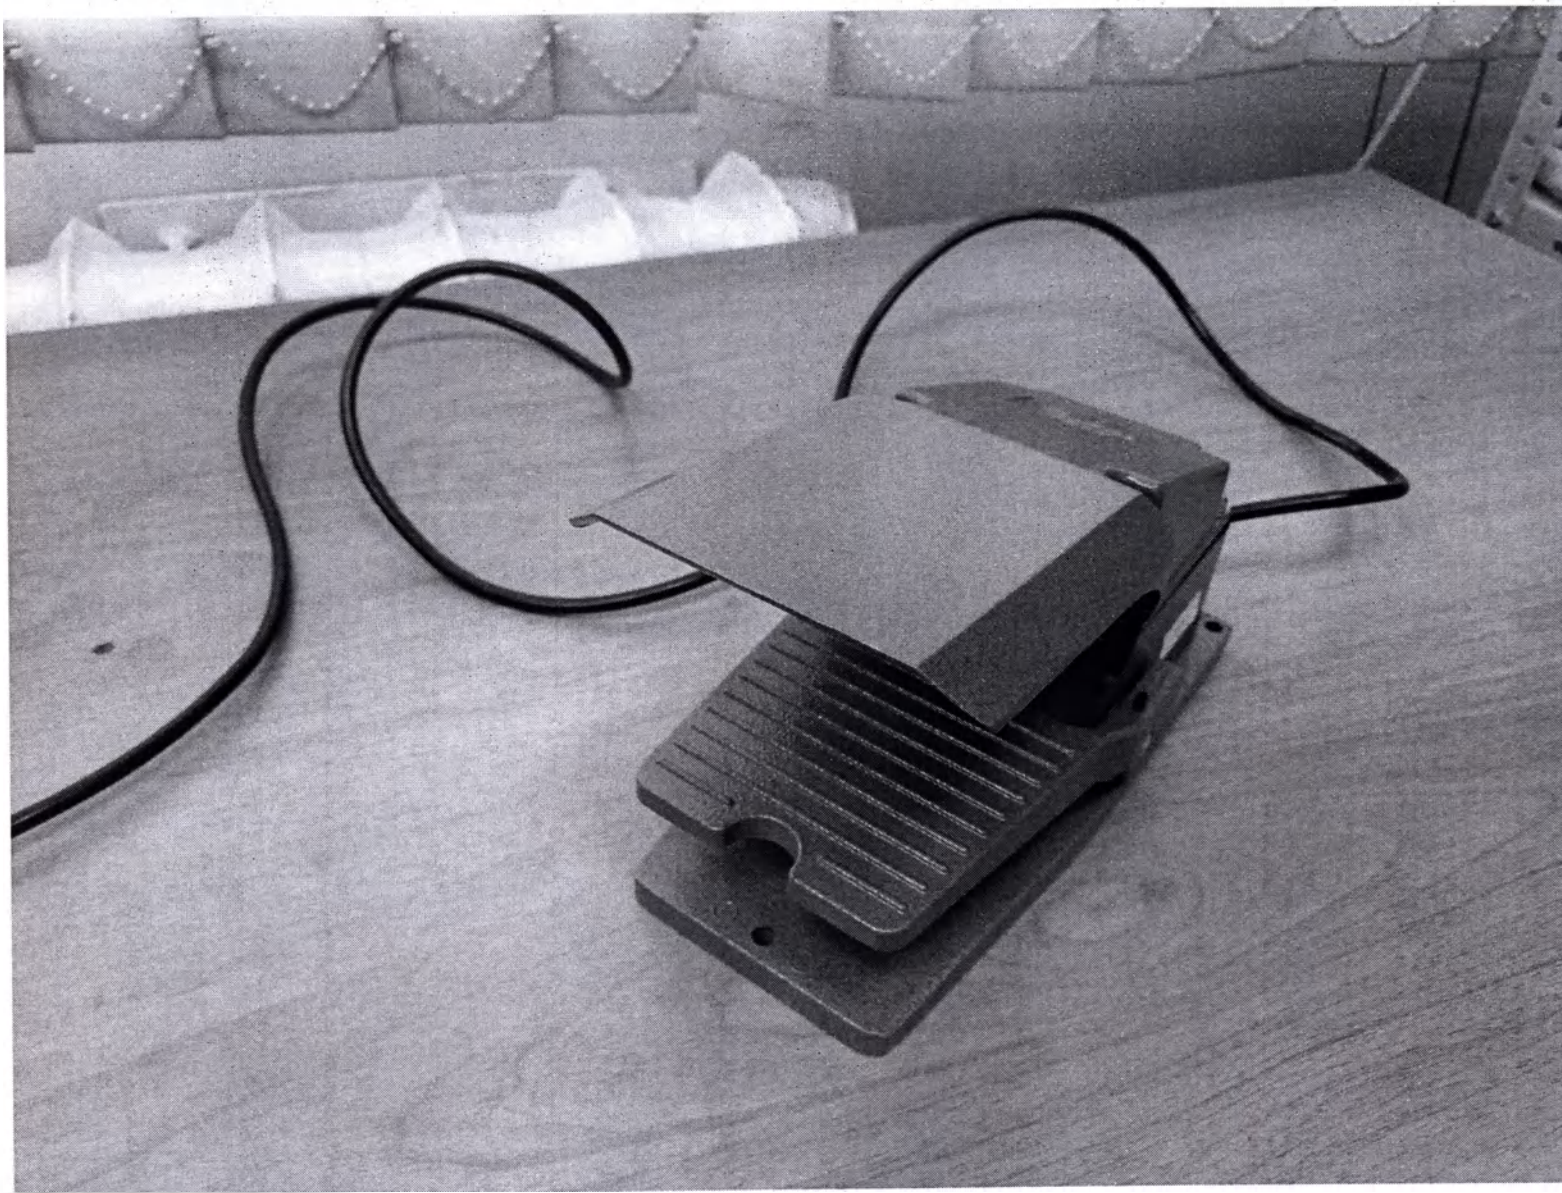


Педаль




Кабель питания

Иванов

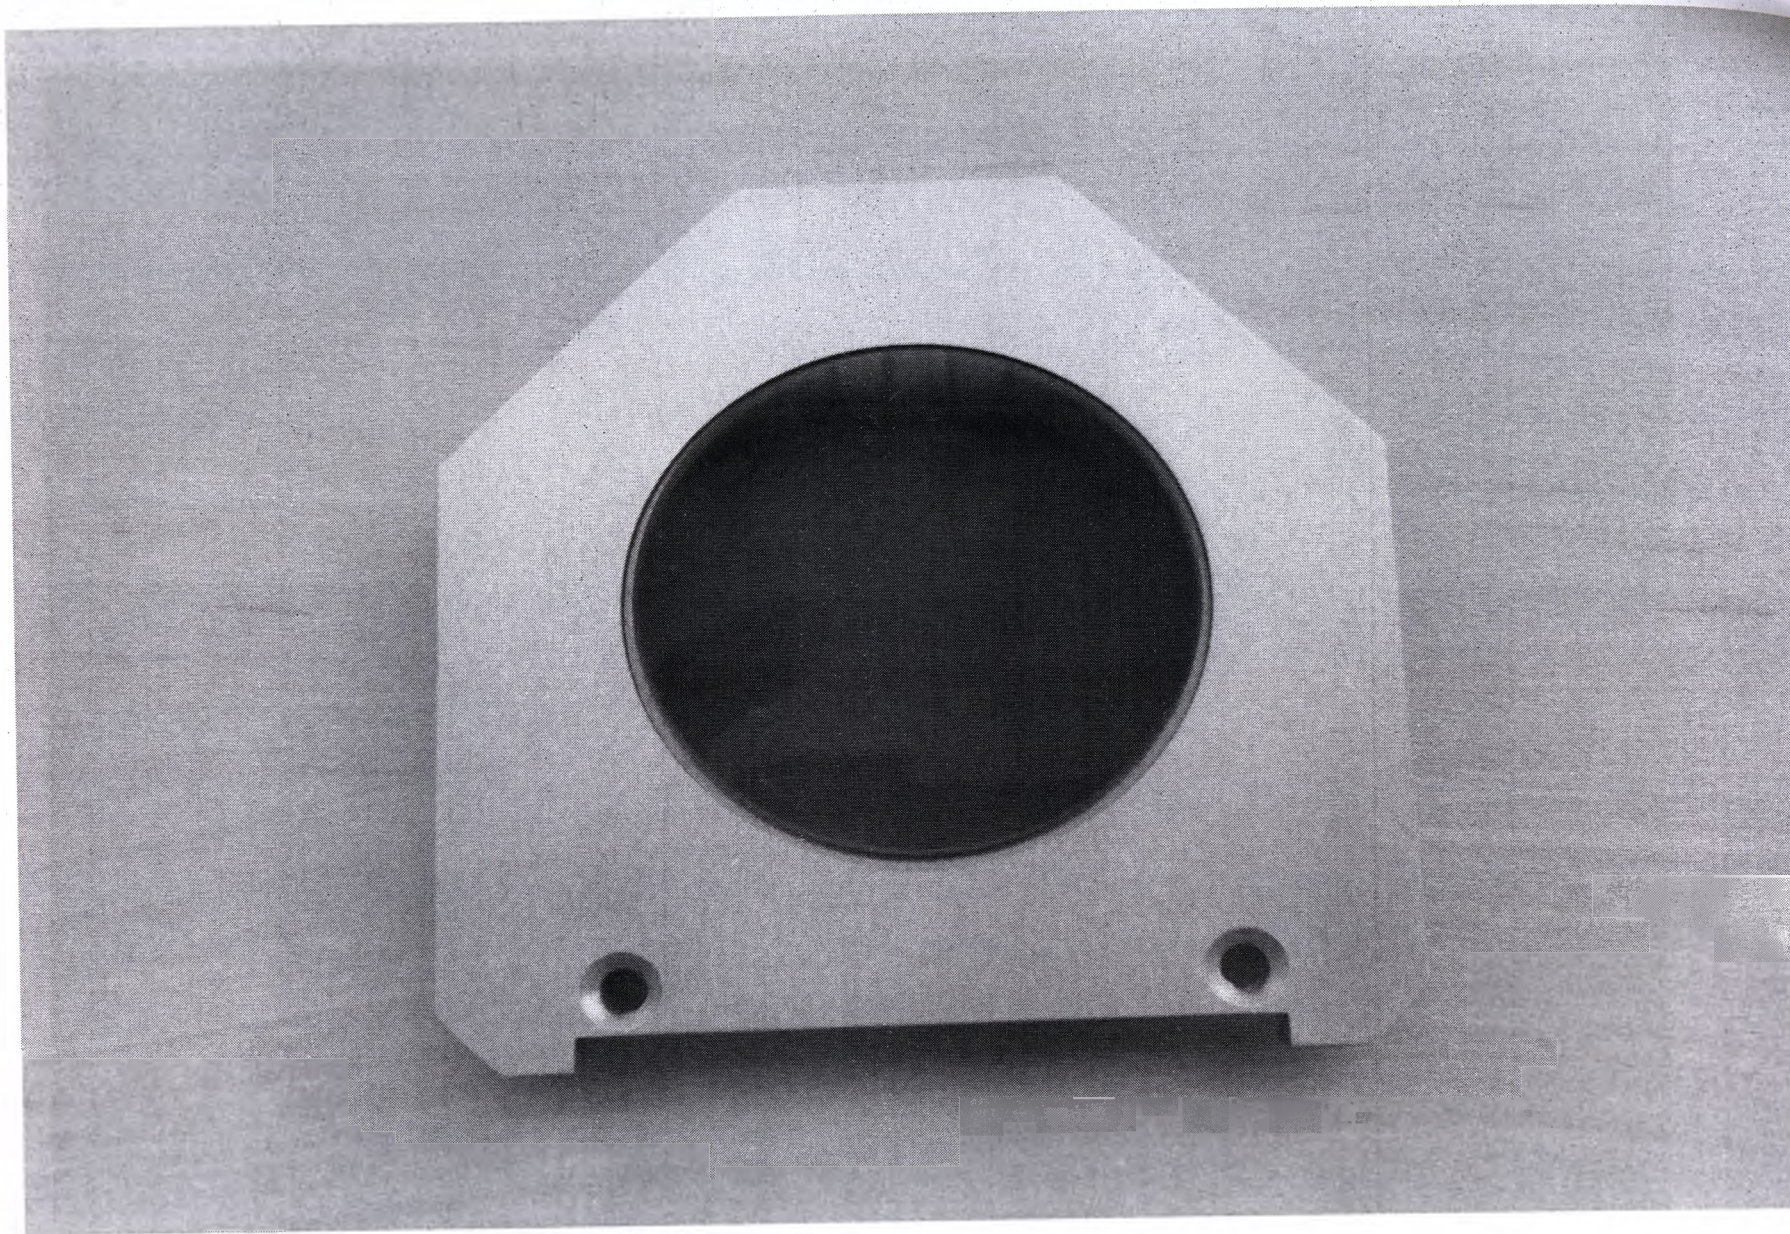


Светофильтр защиты глаз врача в оправе

Мед. 28

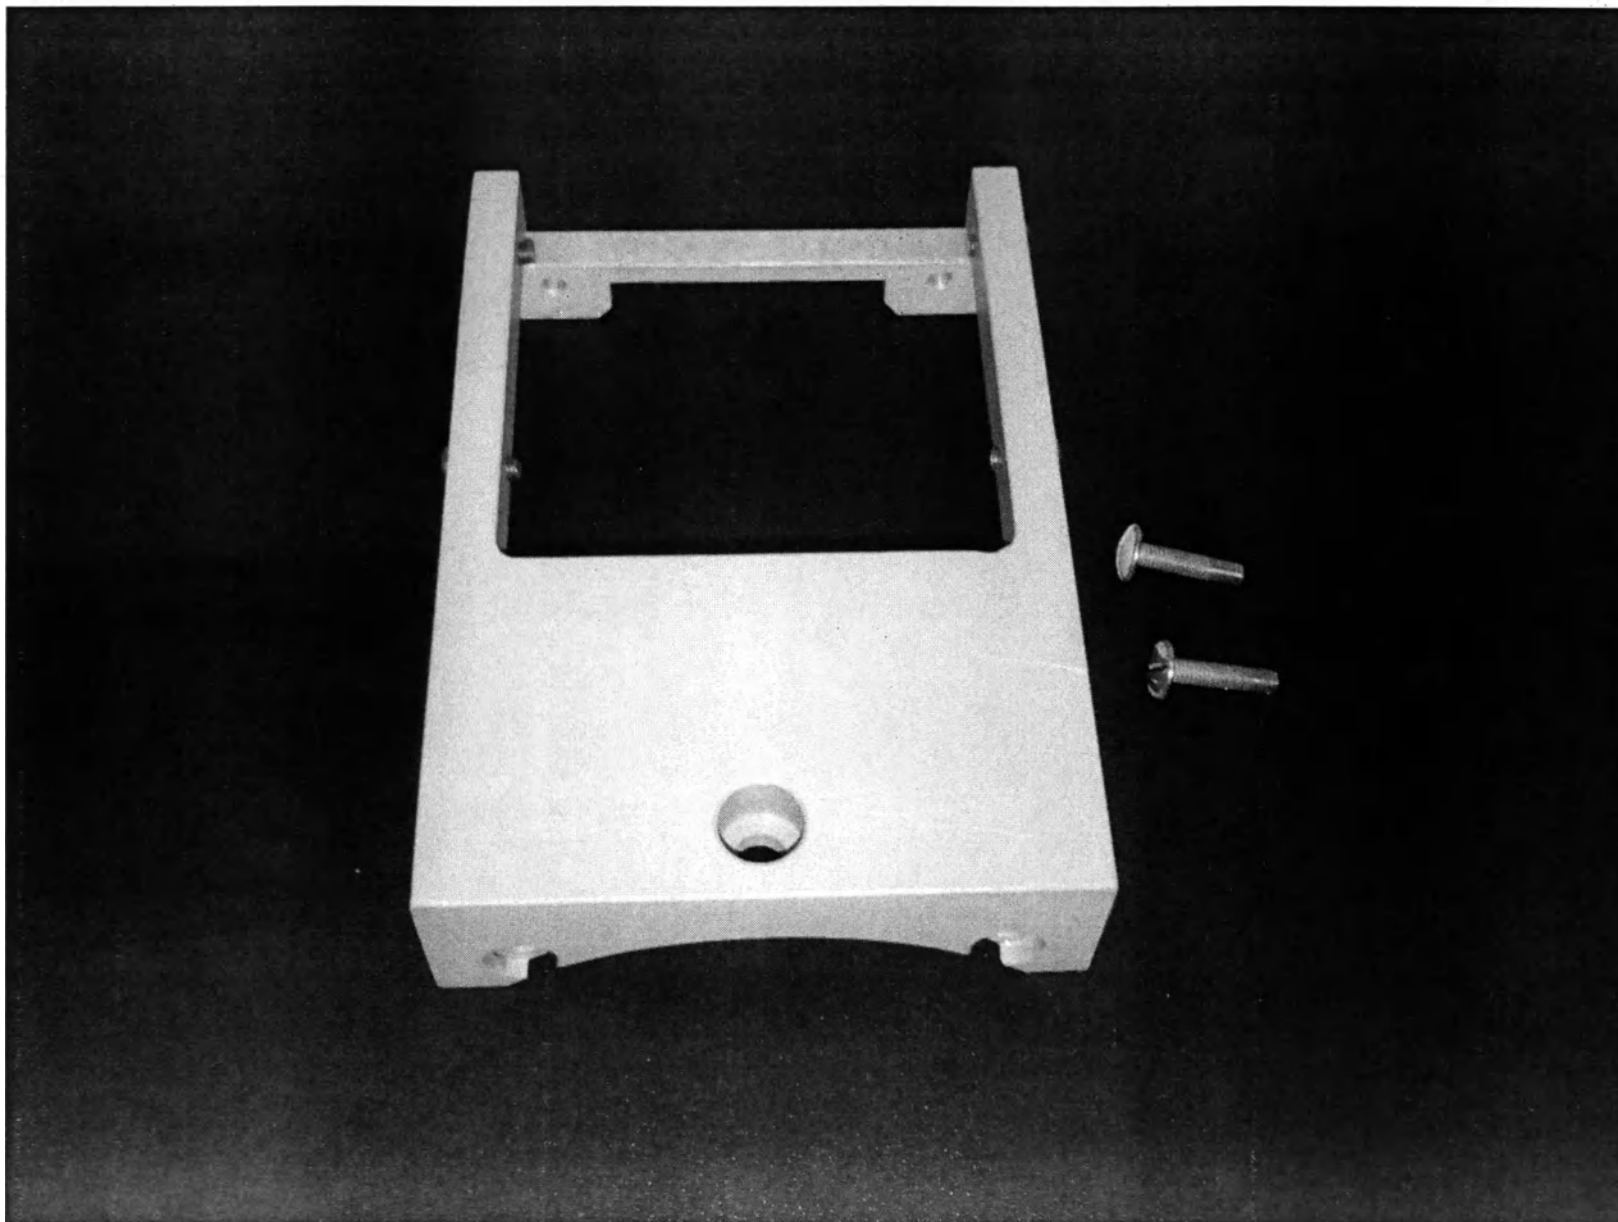


Кронштейн крепления блока оптического к щелевой лампе (с винтами)

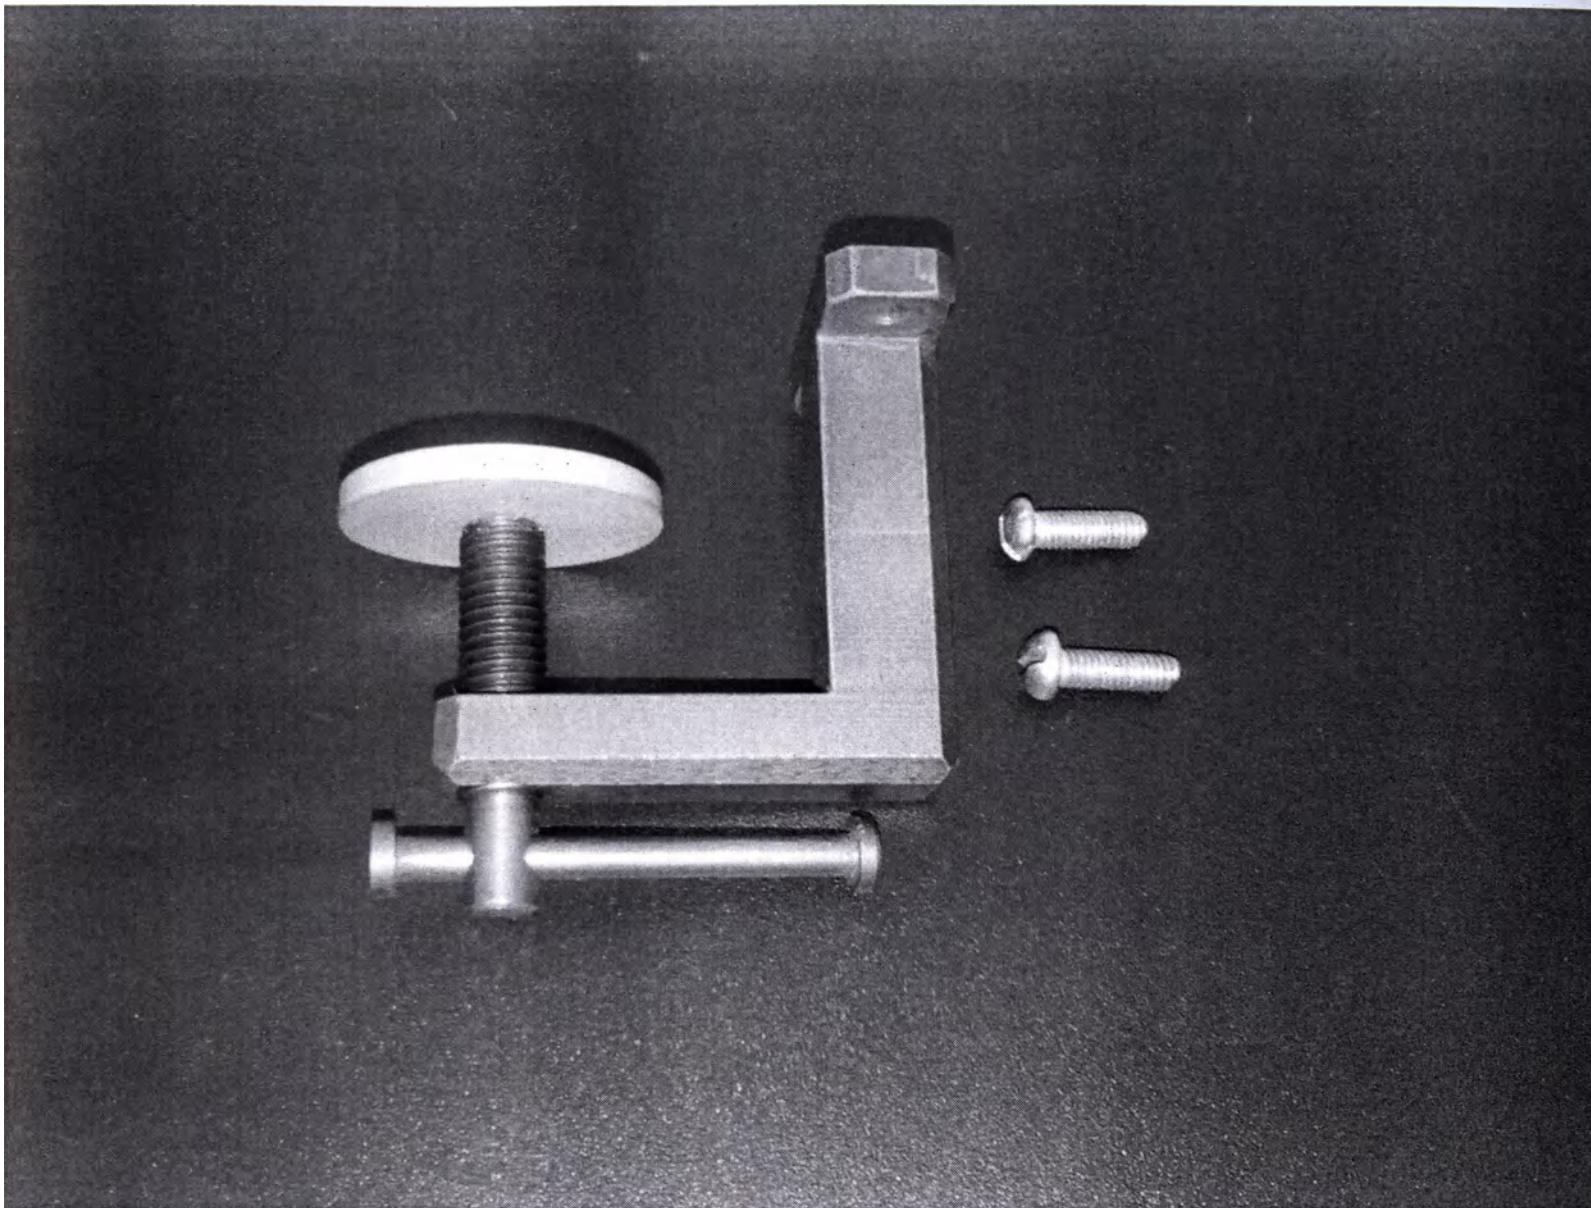

Струбцина крепления к столу блока питания и управления (с винтами)

Метизы

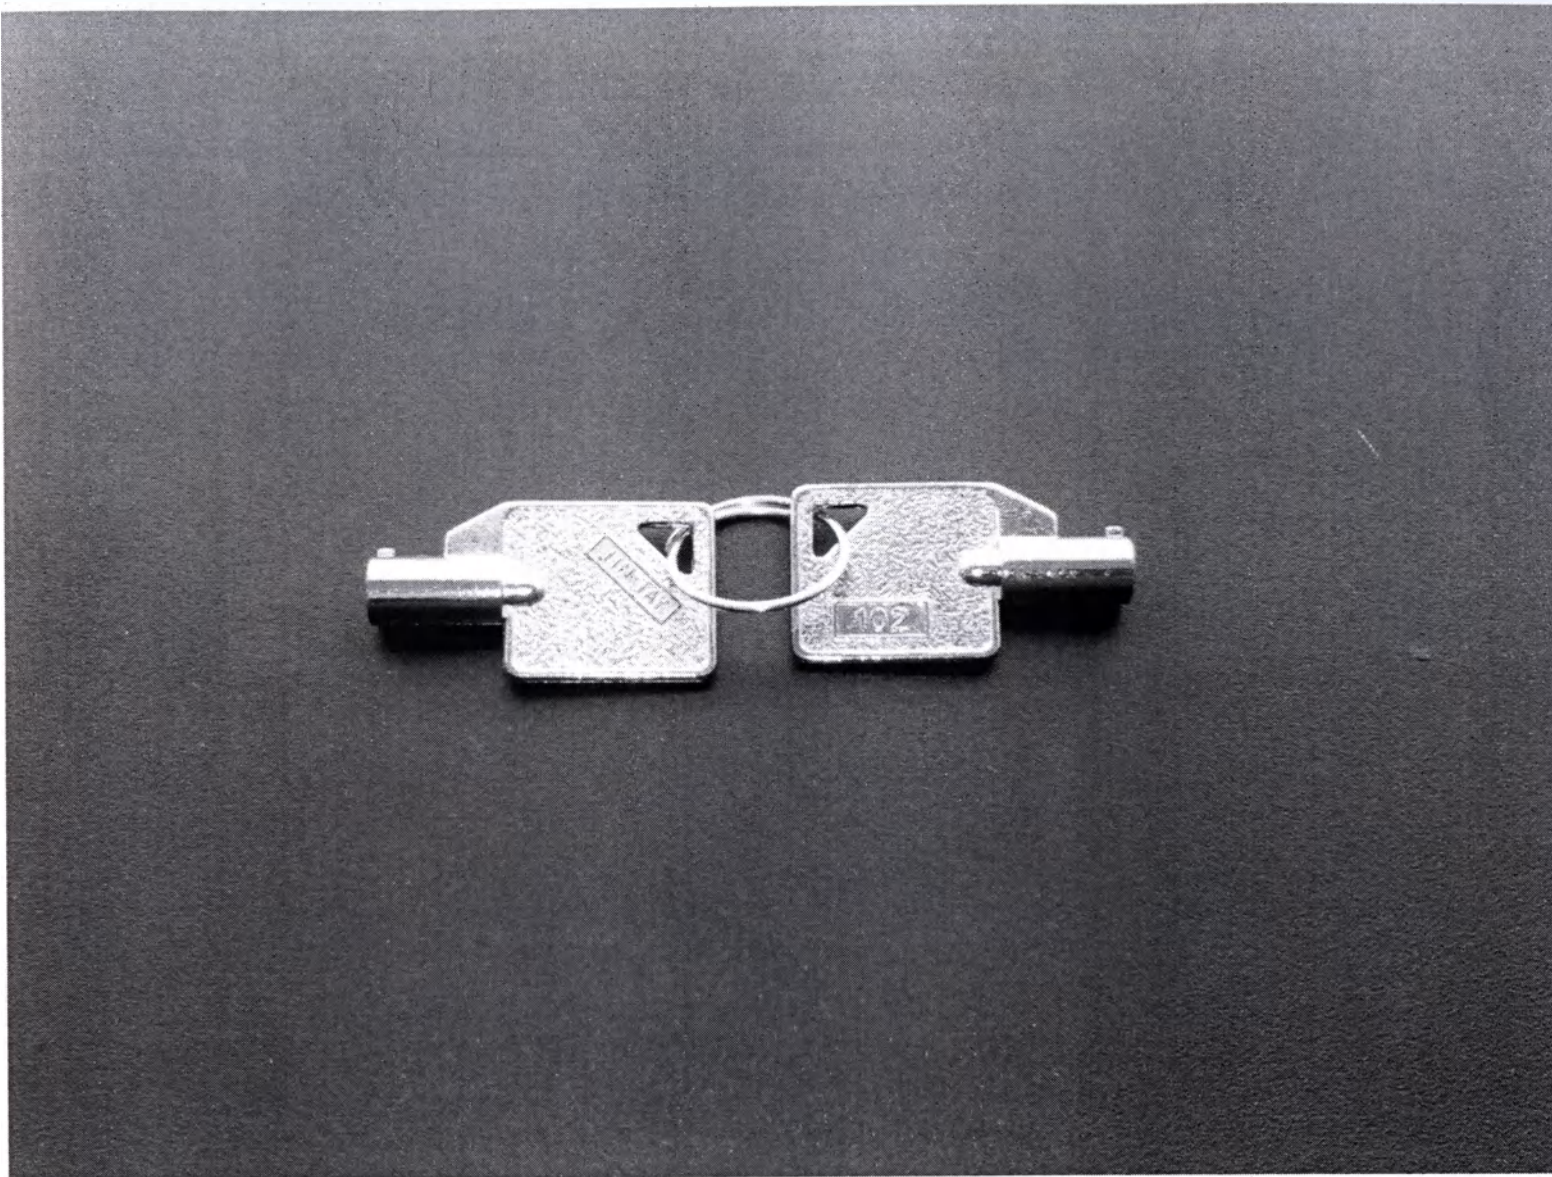

Ключ JIN TAY 102

Прошито и пронумеровано

9 лист 06

Ген.директор

