

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Деркул»**

20 ноября 2017г.



С.Н. Ширшов


**Фотографические изображения медицинского изделия
«Система цифровая стоматологическая интраоральная
визуализации FONA Stellaris»**

Оглавление


I. Датчик цифровой стоматологической визуализации, интраоральный FONA Stellaris	4
1. Датчик FONA Stellaris S1 с кабелем 1,8 м	4
2. Настенный держатель датчика FONA Stellaris, с крепежом	13
3. Комплект для замены кабеля SCHICK	14
3.1. Кабель B1209155	16
3.2. Отвертка 261/PH0x50	22
3.3. Колпачки защитные резьбовые E33	23
3.4. Полоса из эластомера, красная B1209119	25
3.5. Полоса из эластомера, синяя B1207115	28
3.6. Рамка для эластомера (синяя)	30
3.7. Полоса для эластомера с рамкой (белая) B1218115	32
3.8. Гель силиконовый в форме диска B 1218107	34
3.9. Винты с плоской головкой (0-80)	37
4. Система позиционирования датчика	38
4.1. Визирное кольцо	38
4.2. Штанга направляющая	40
4.3. Держатели датчика FONA Stellaris	42
5. Чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчика 100005396, упаковка 100шт	44
6. Руководство пользователя	46
II. Модуль USB	47
1. Блок сопряжения FONA ELITE USB INTERFACE B2272100	47
2. Кабель USB A/B B2250150 – 5м	53
3. Настенное крепление для модуля USB B2270135, с крепежом	56
4. Руководство пользователя	58


III. Программное обеспечение	59
1. Программное обеспечение OrisWin DGSuite. Версия 4.	59
2. Программное обеспечение для калибровки датчика OrisWin DG Suite	60
3. Краткое руководство пользователя	62

I. Датчик цифровой стоматологической визуализации, интраоральный FONA Stellaris. 1. Датчик FONA Stellaris S1 с кабелем 1,8 м.

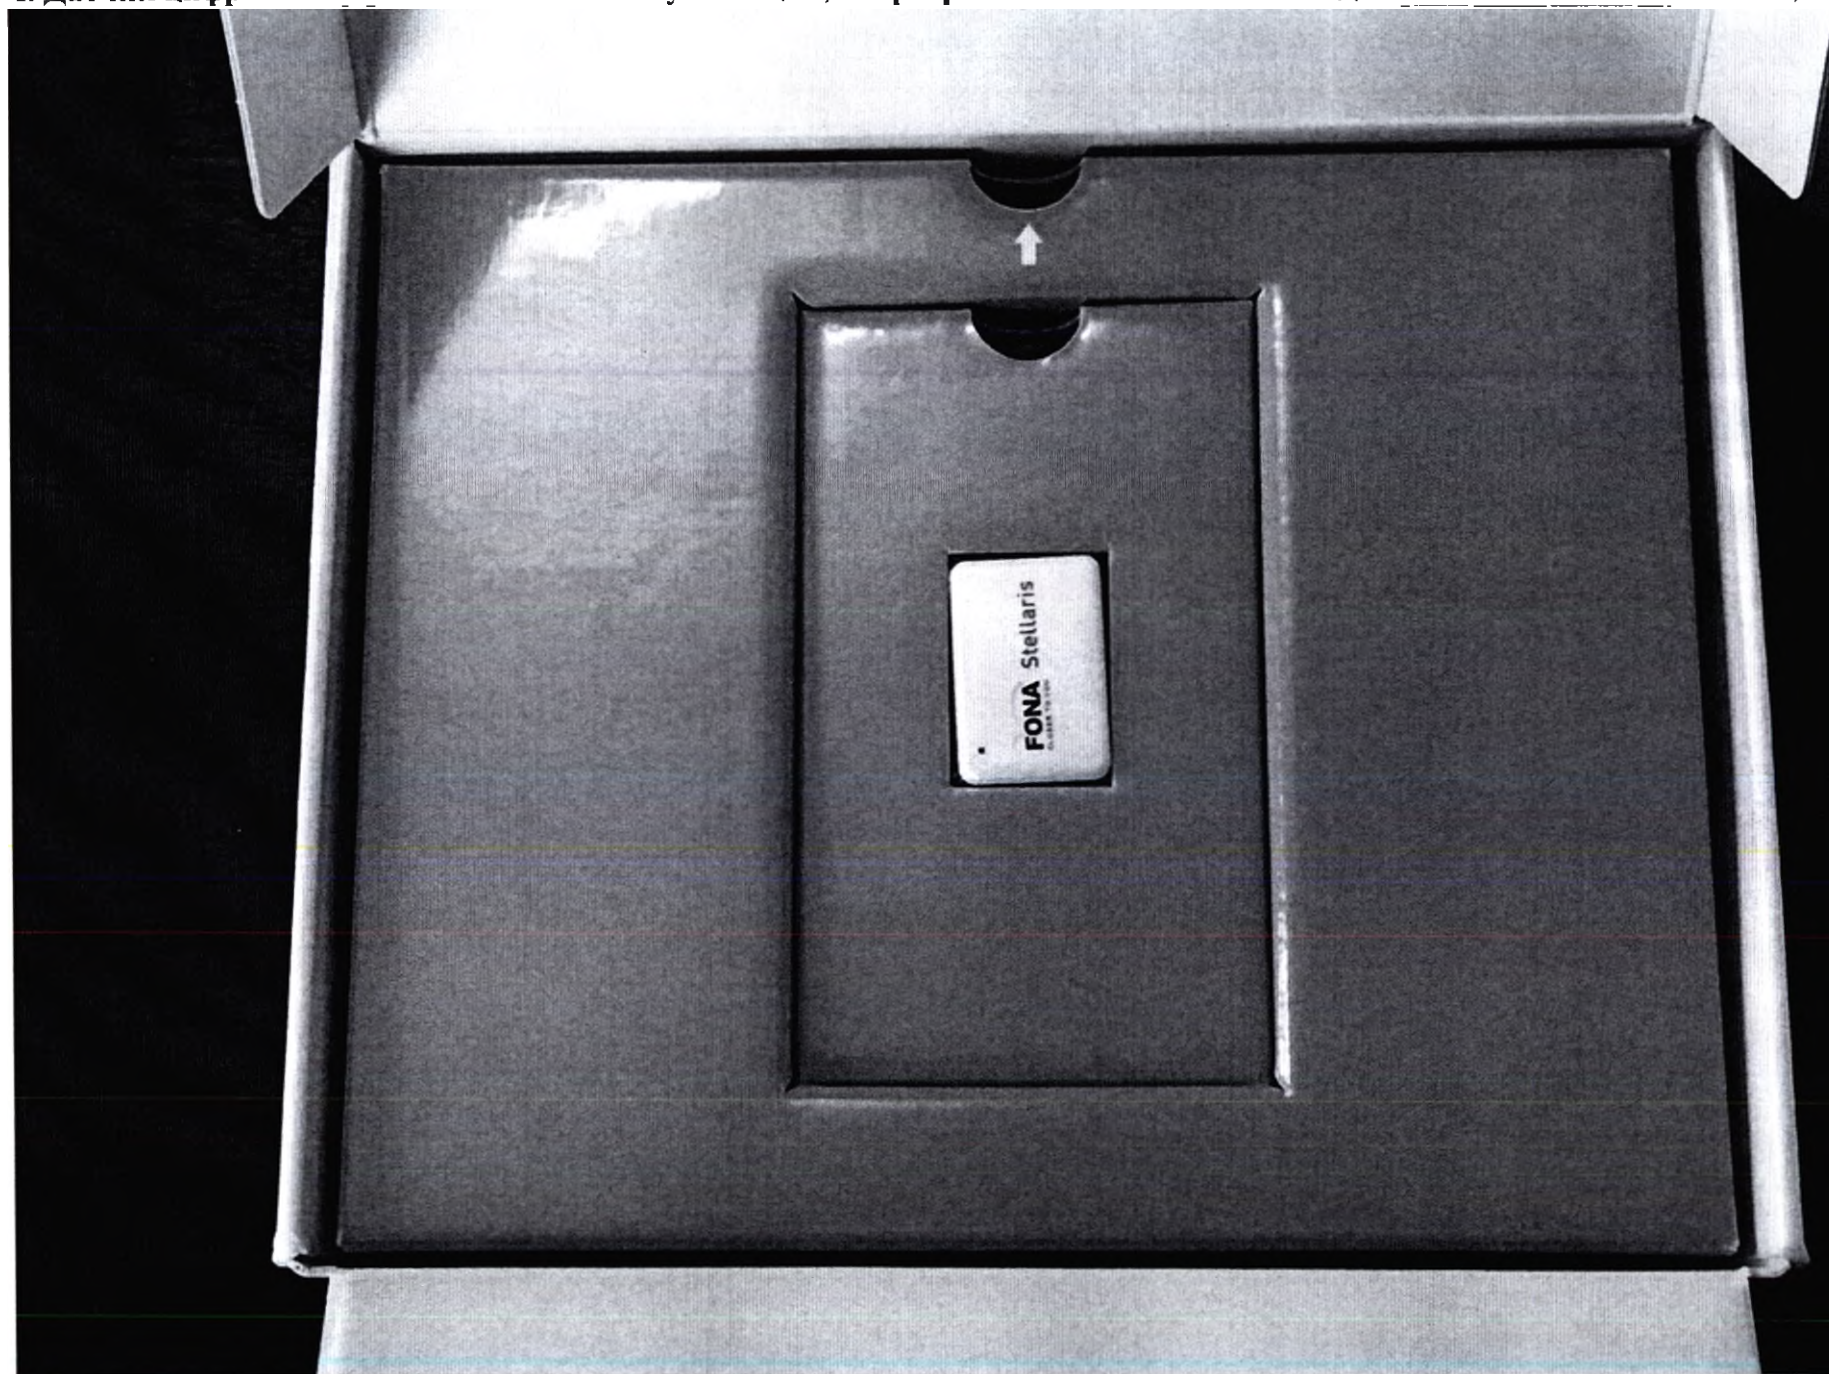



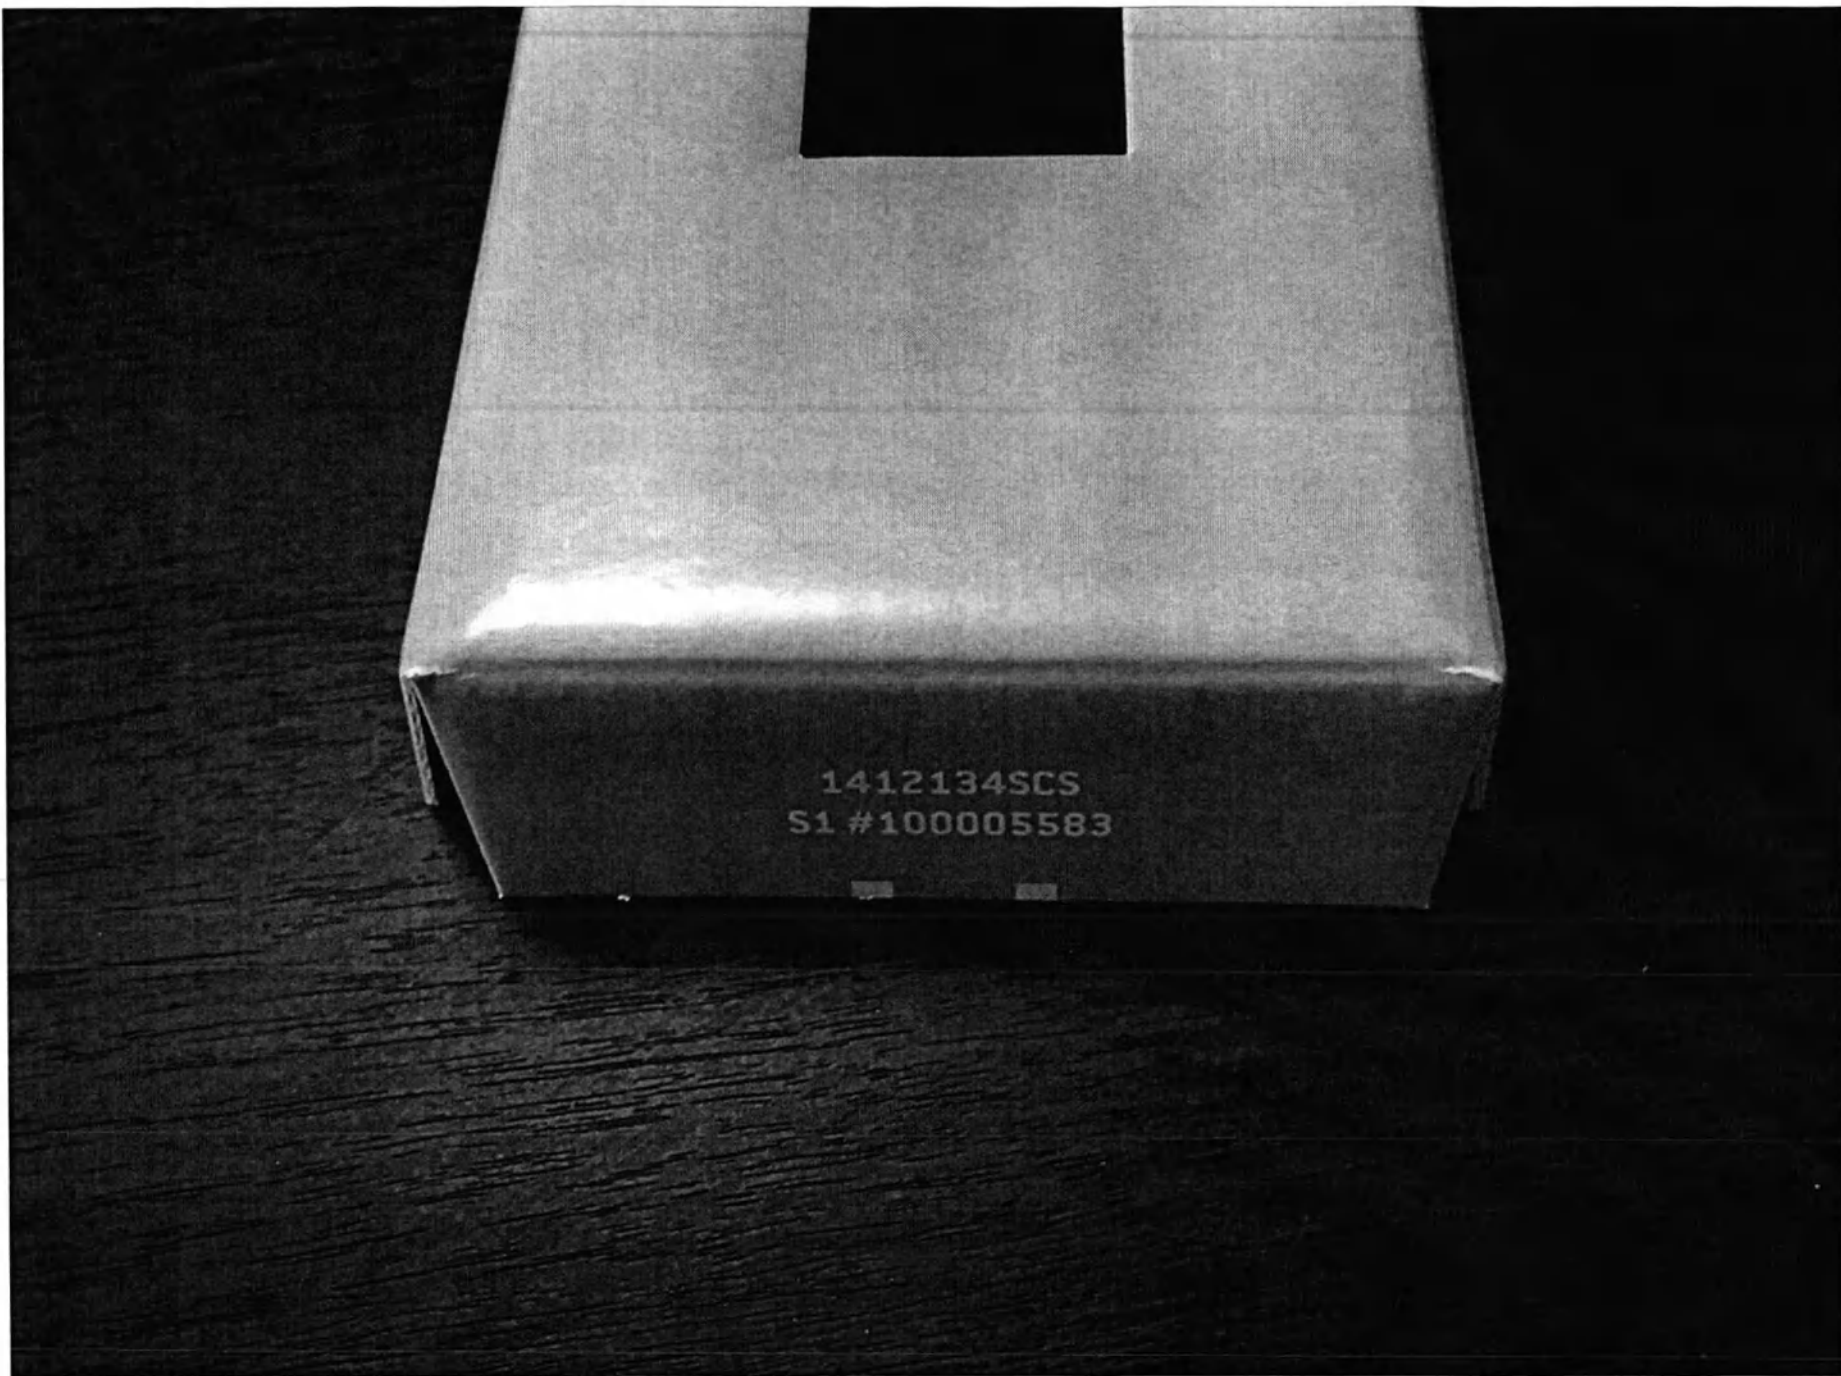

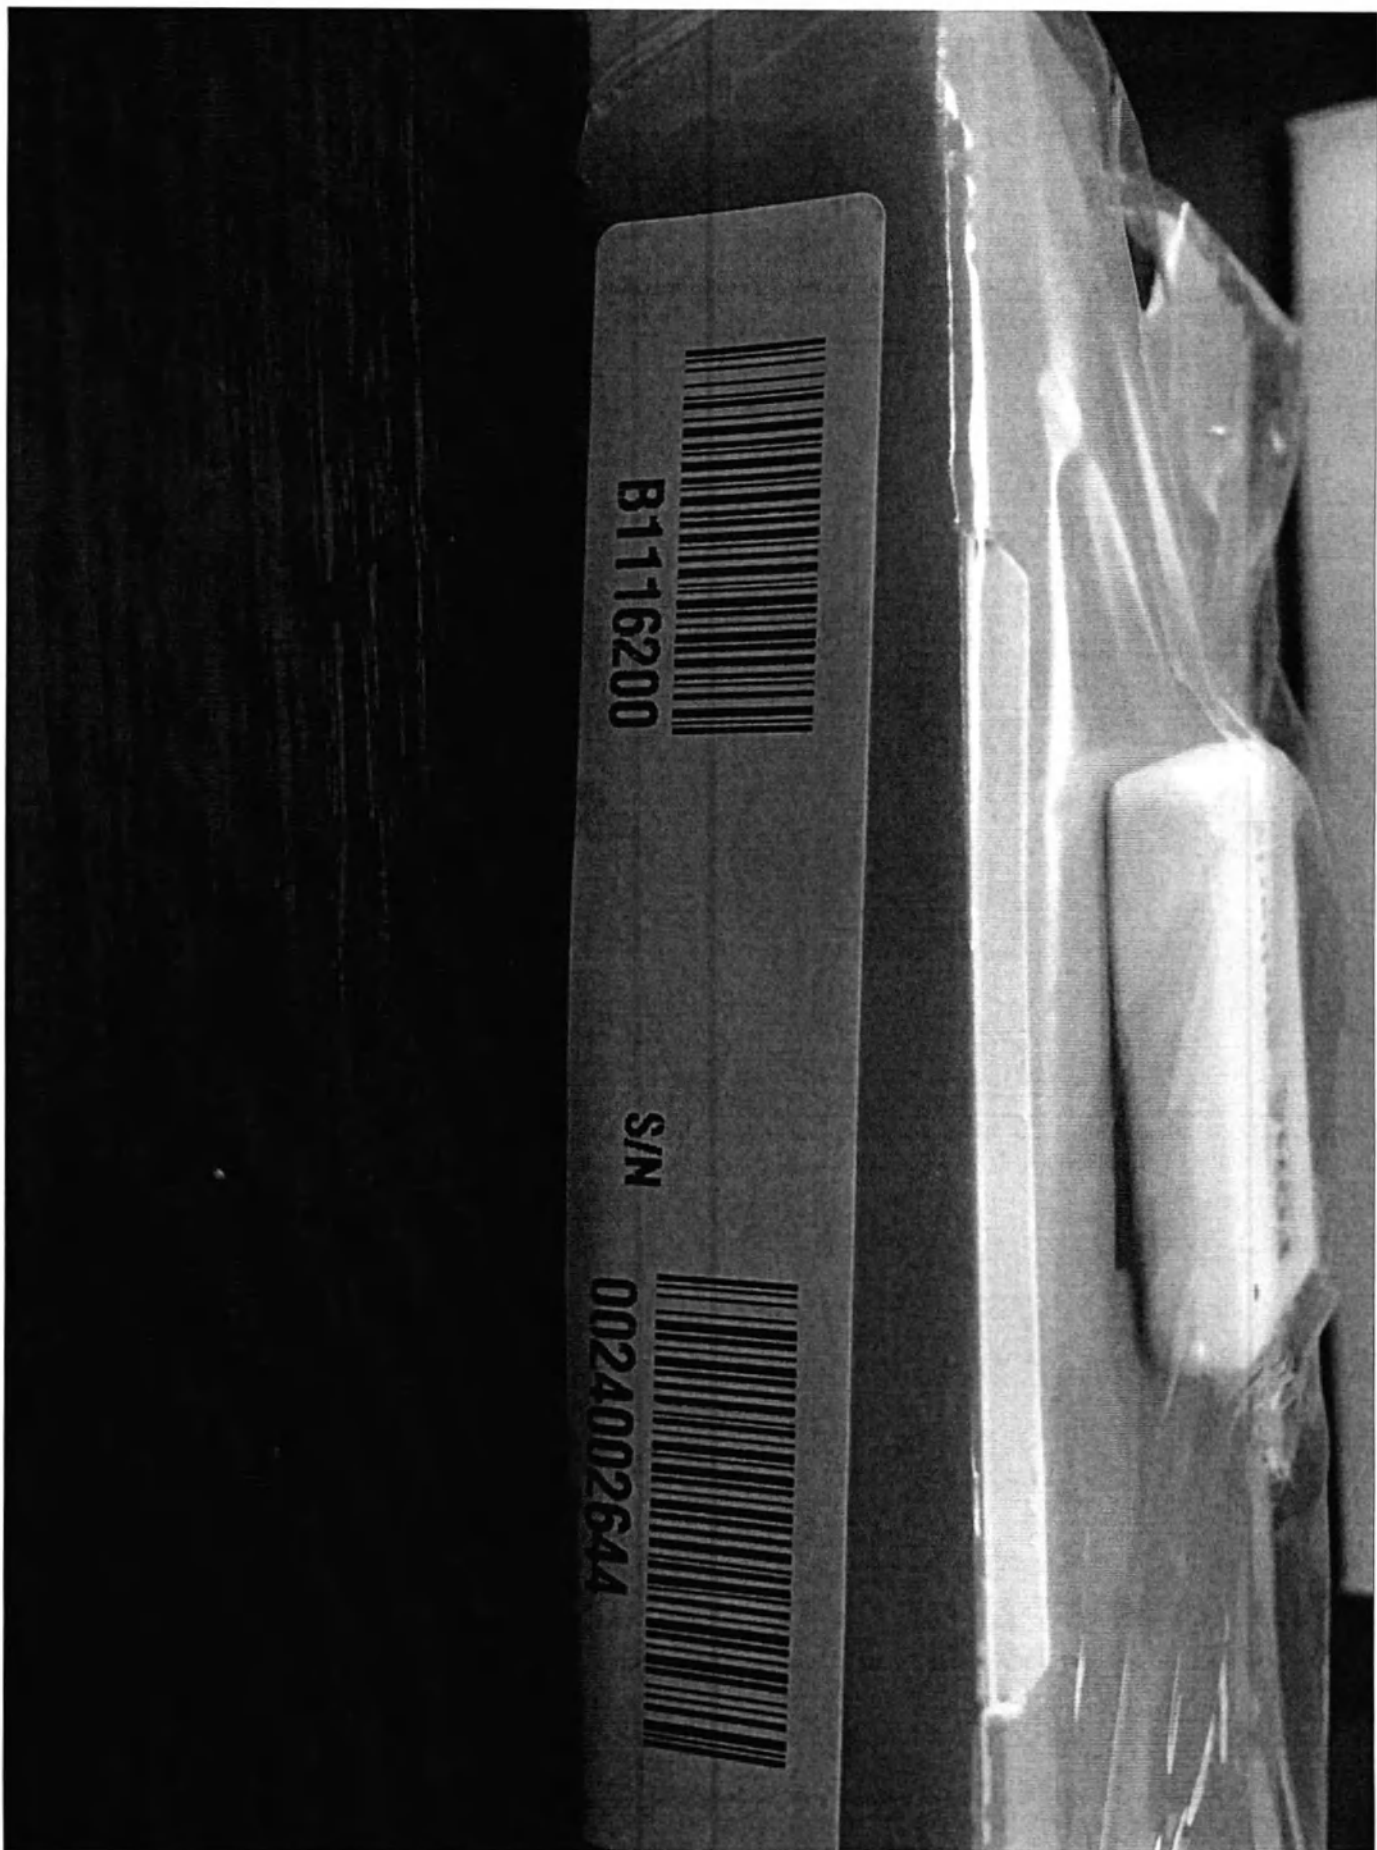

1501031SCS
100005581





P/N B1209155
S/N US115831
MFR: 09/2015



Sirona Dental Inc
30-30 47 Ave L I C NY 11101 USA

0413
24002644



2. Настенный держатель датчика FONA Stellaris, с крепежом







3.1. Кабель В1209155





P/N B1209155

S/N US117616


MFR: 09/2015




Sirona Dental, Inc

30-30 47 Ave L I C NY 11101 USA



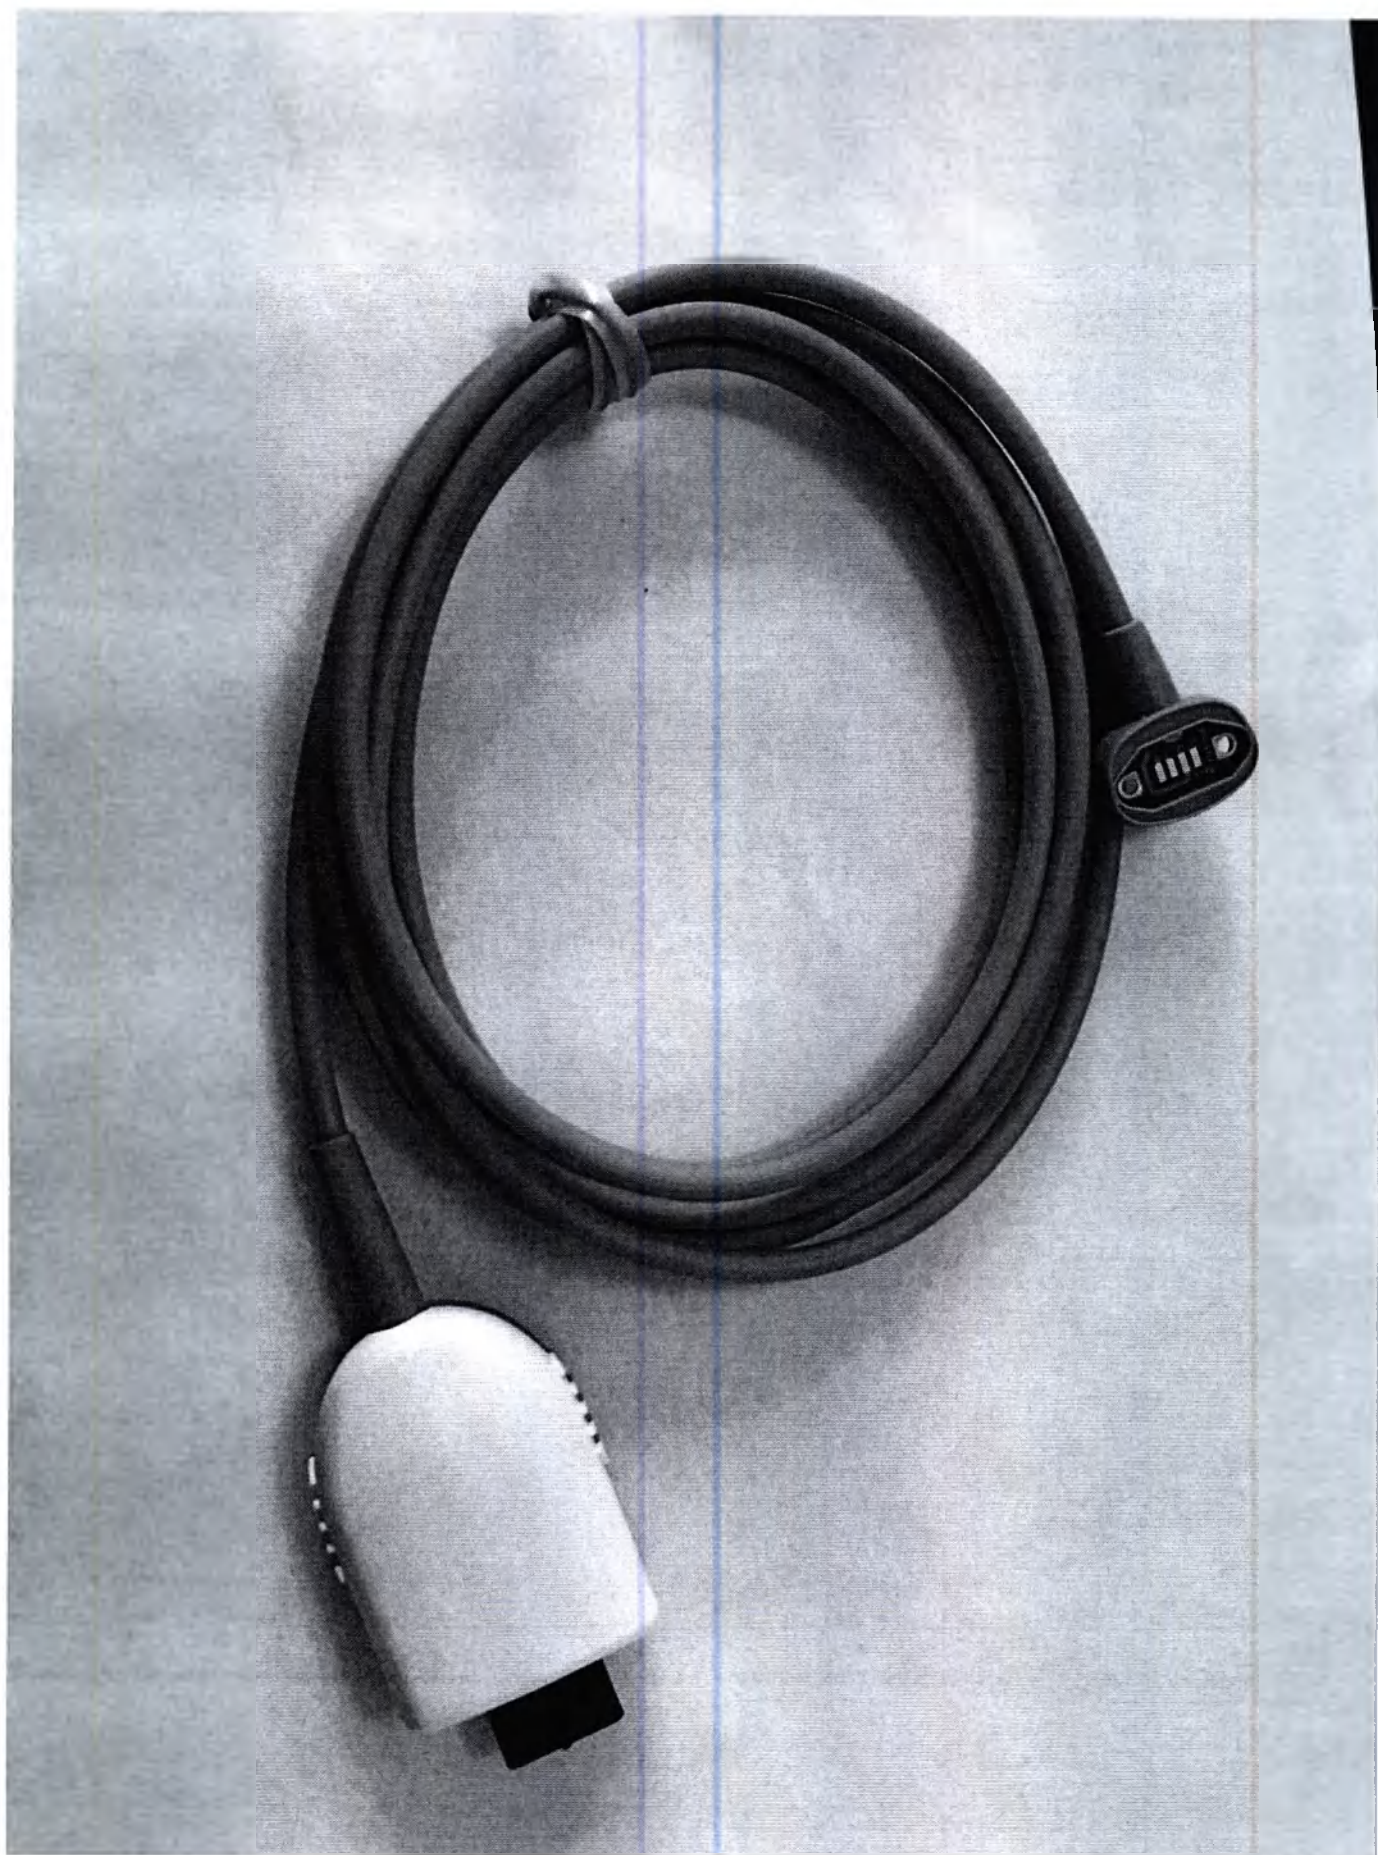




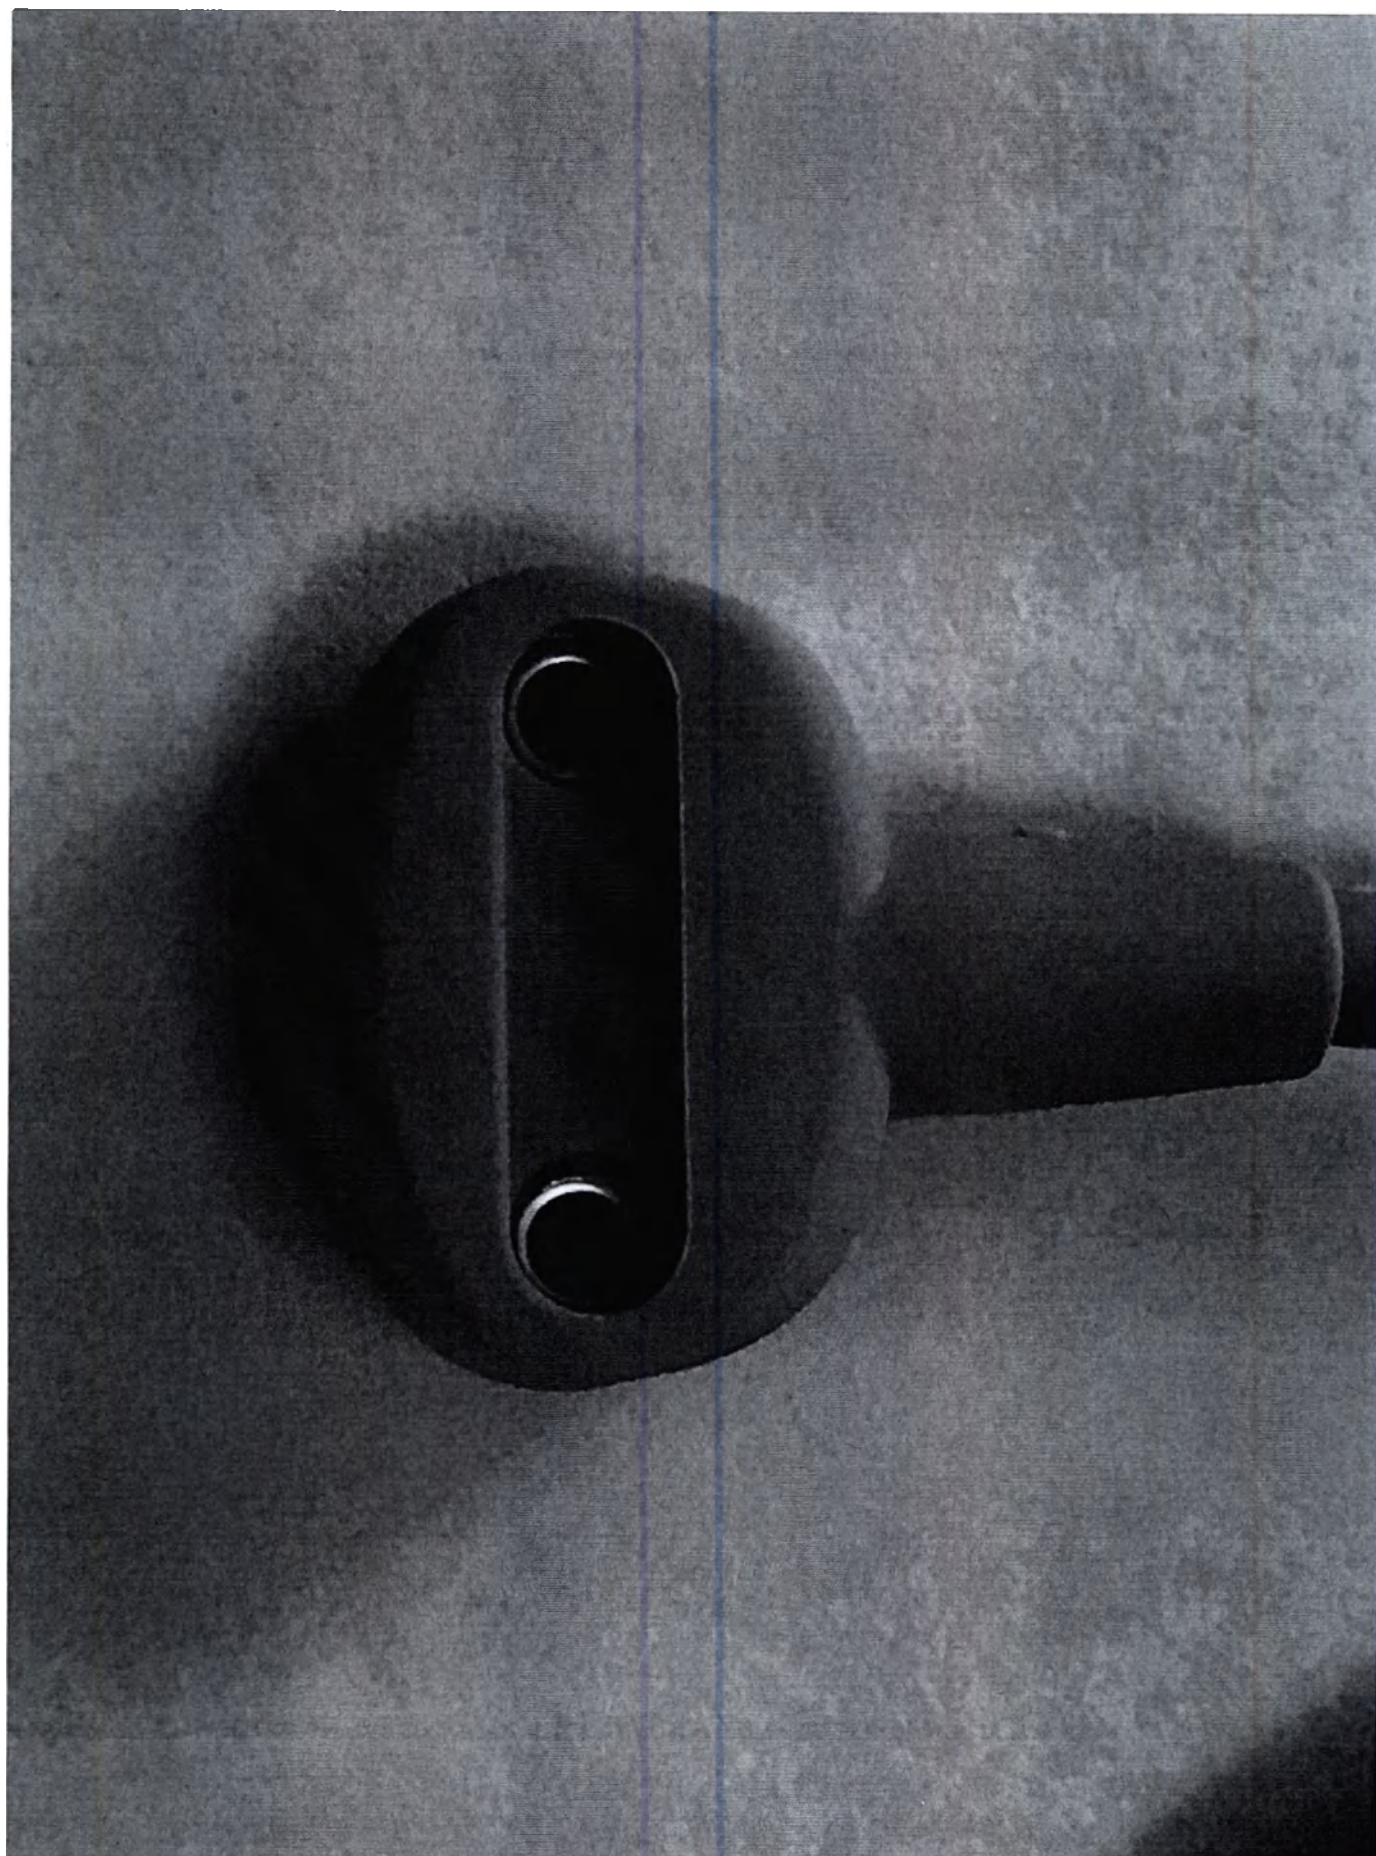



3.2. Отвертка 261/PH0x50





3.3. Колпачки защитные резьбовые E33

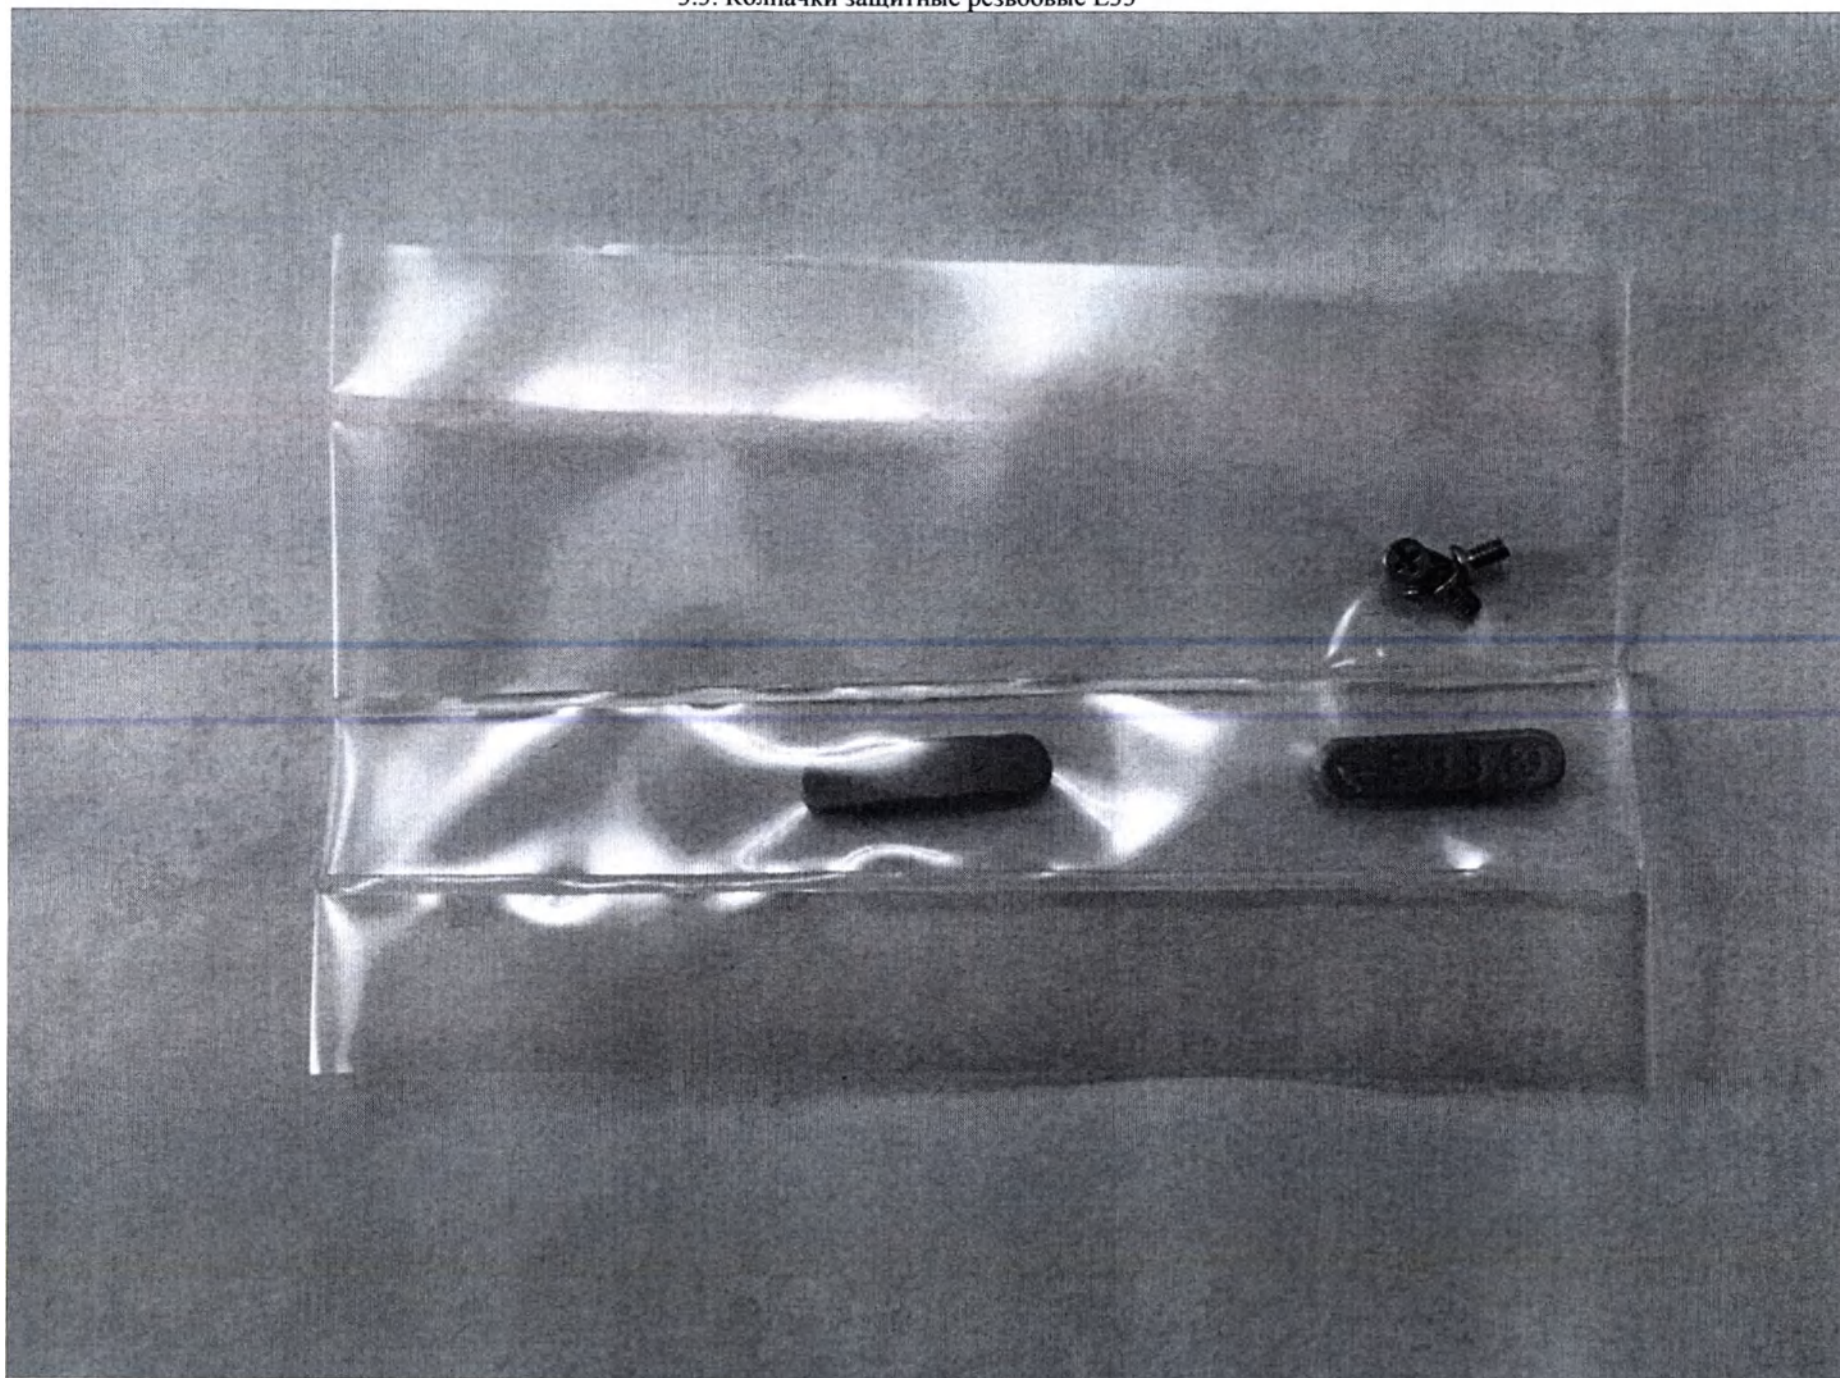

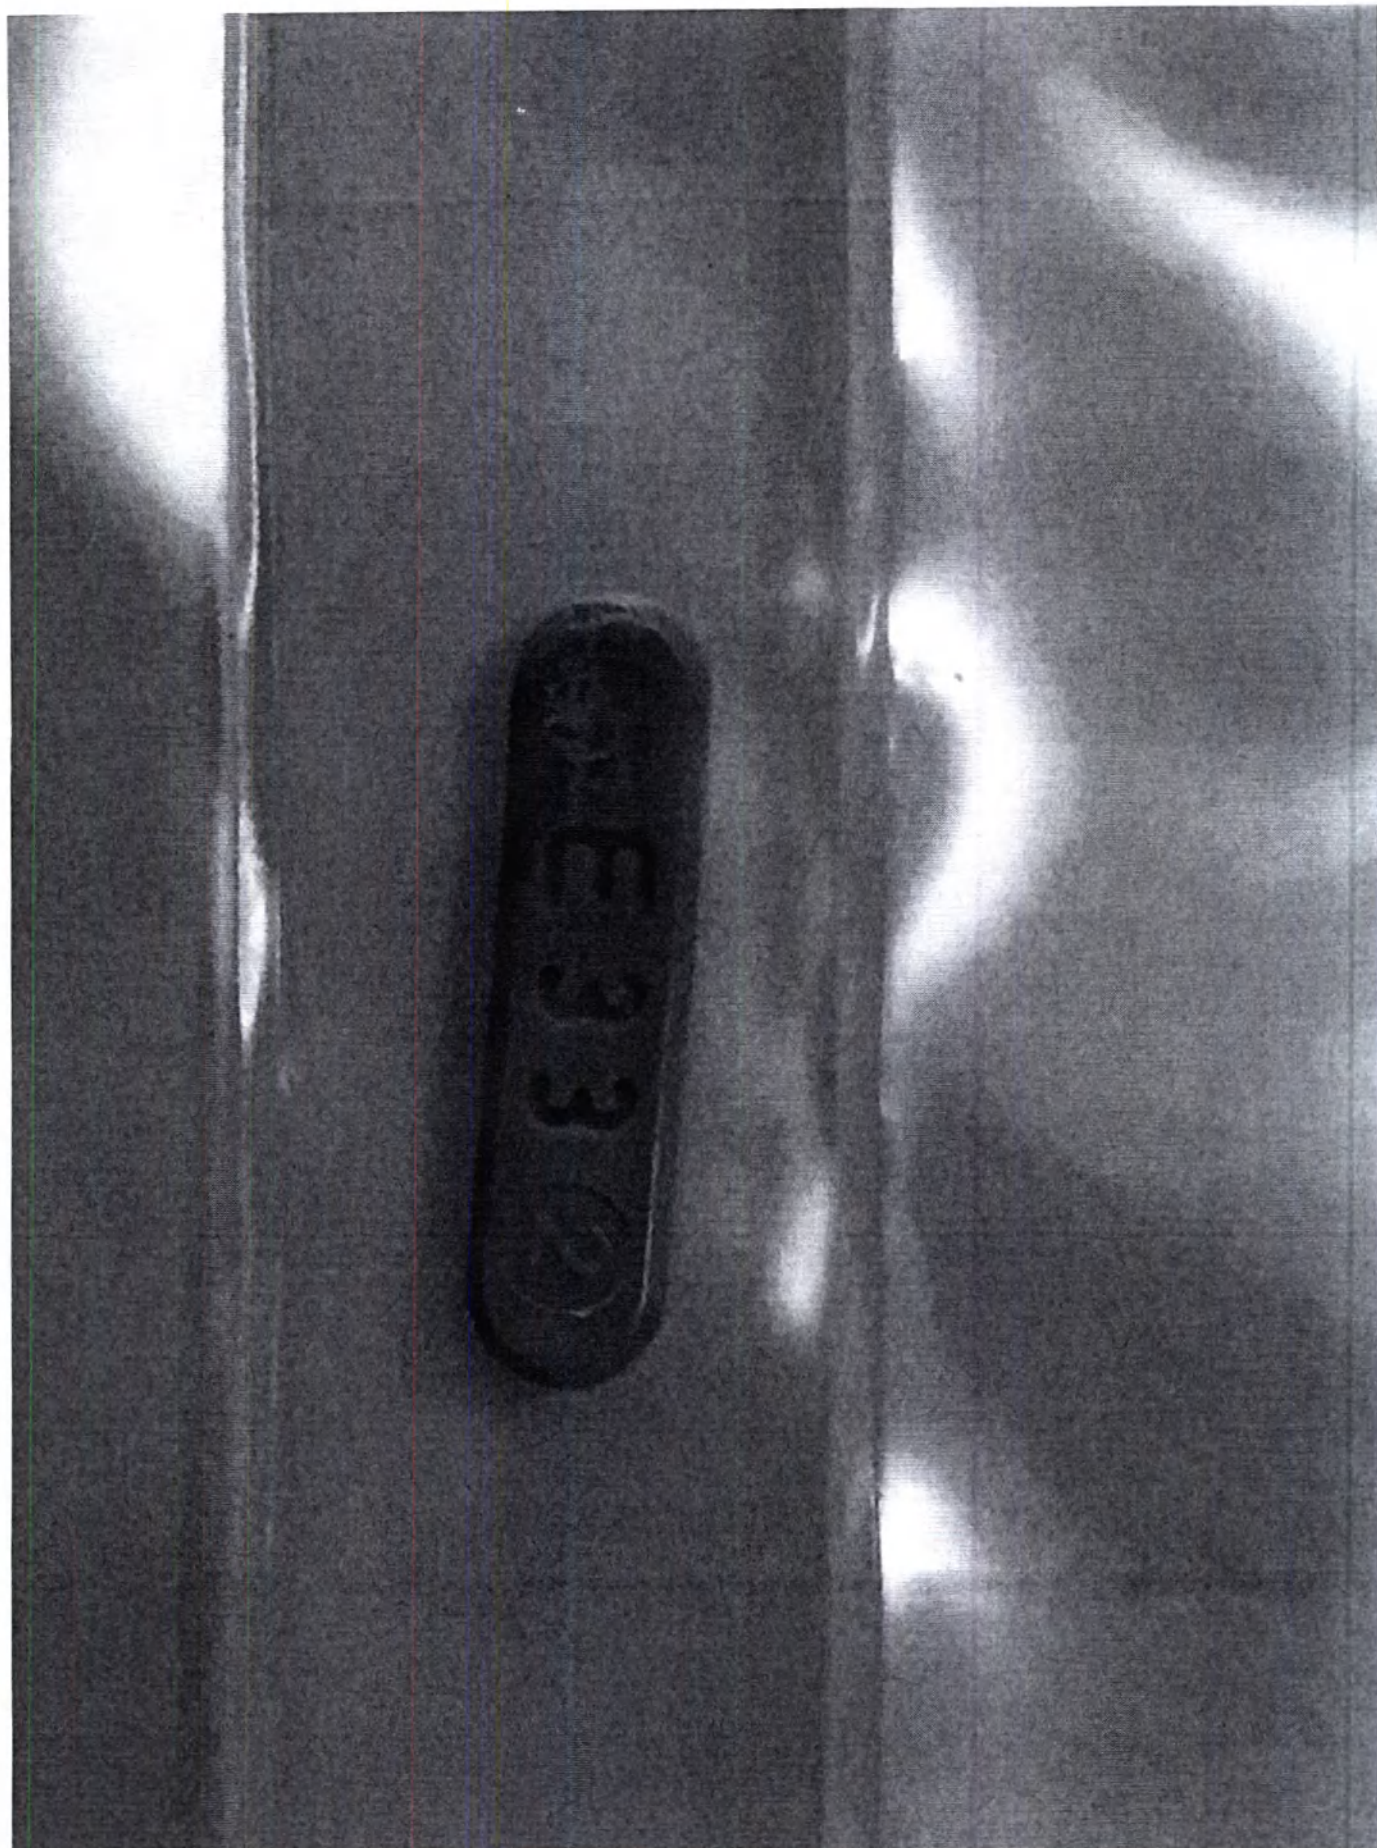


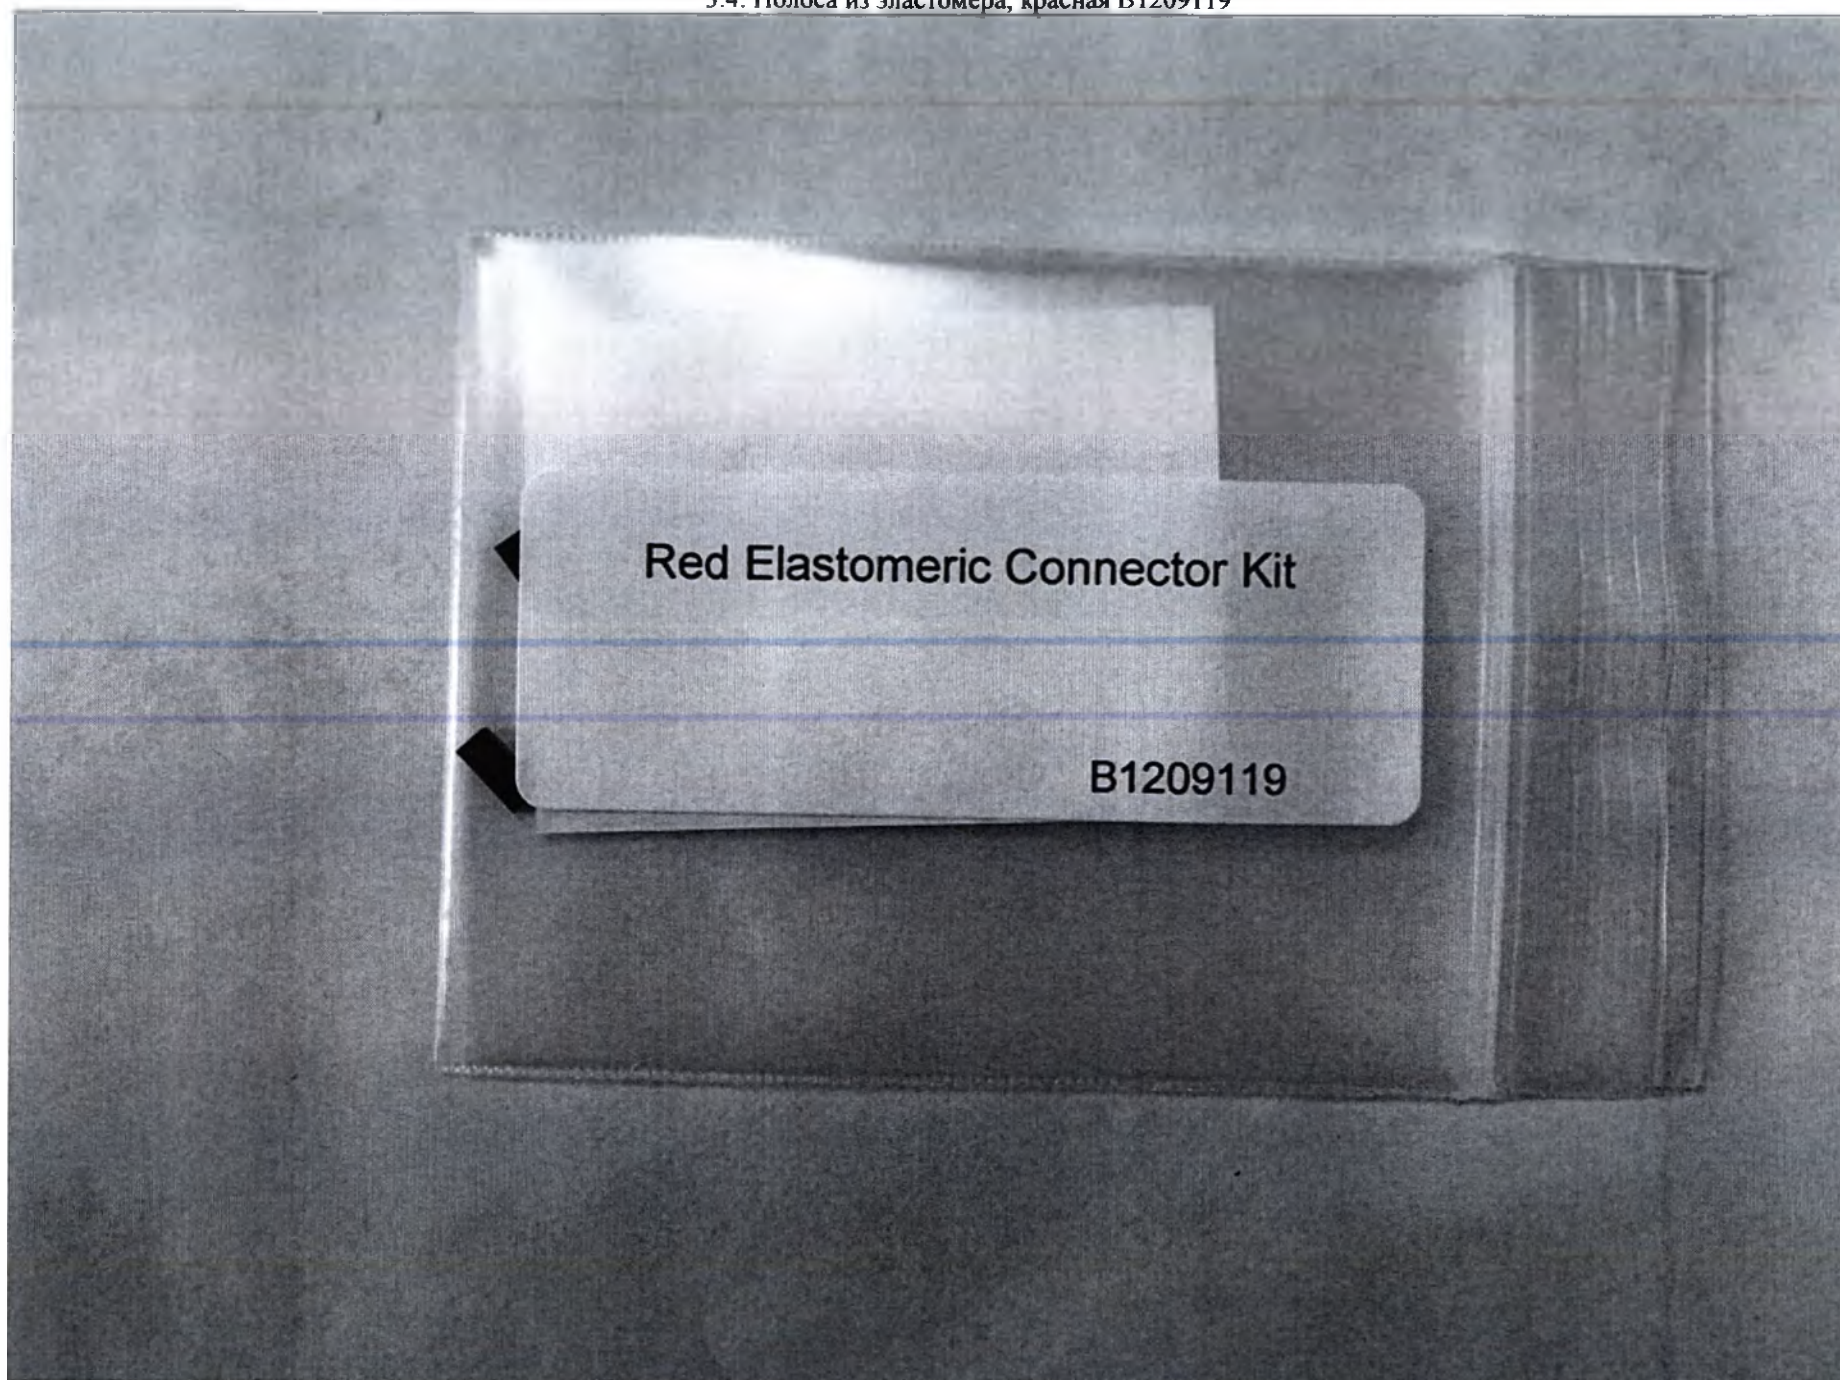

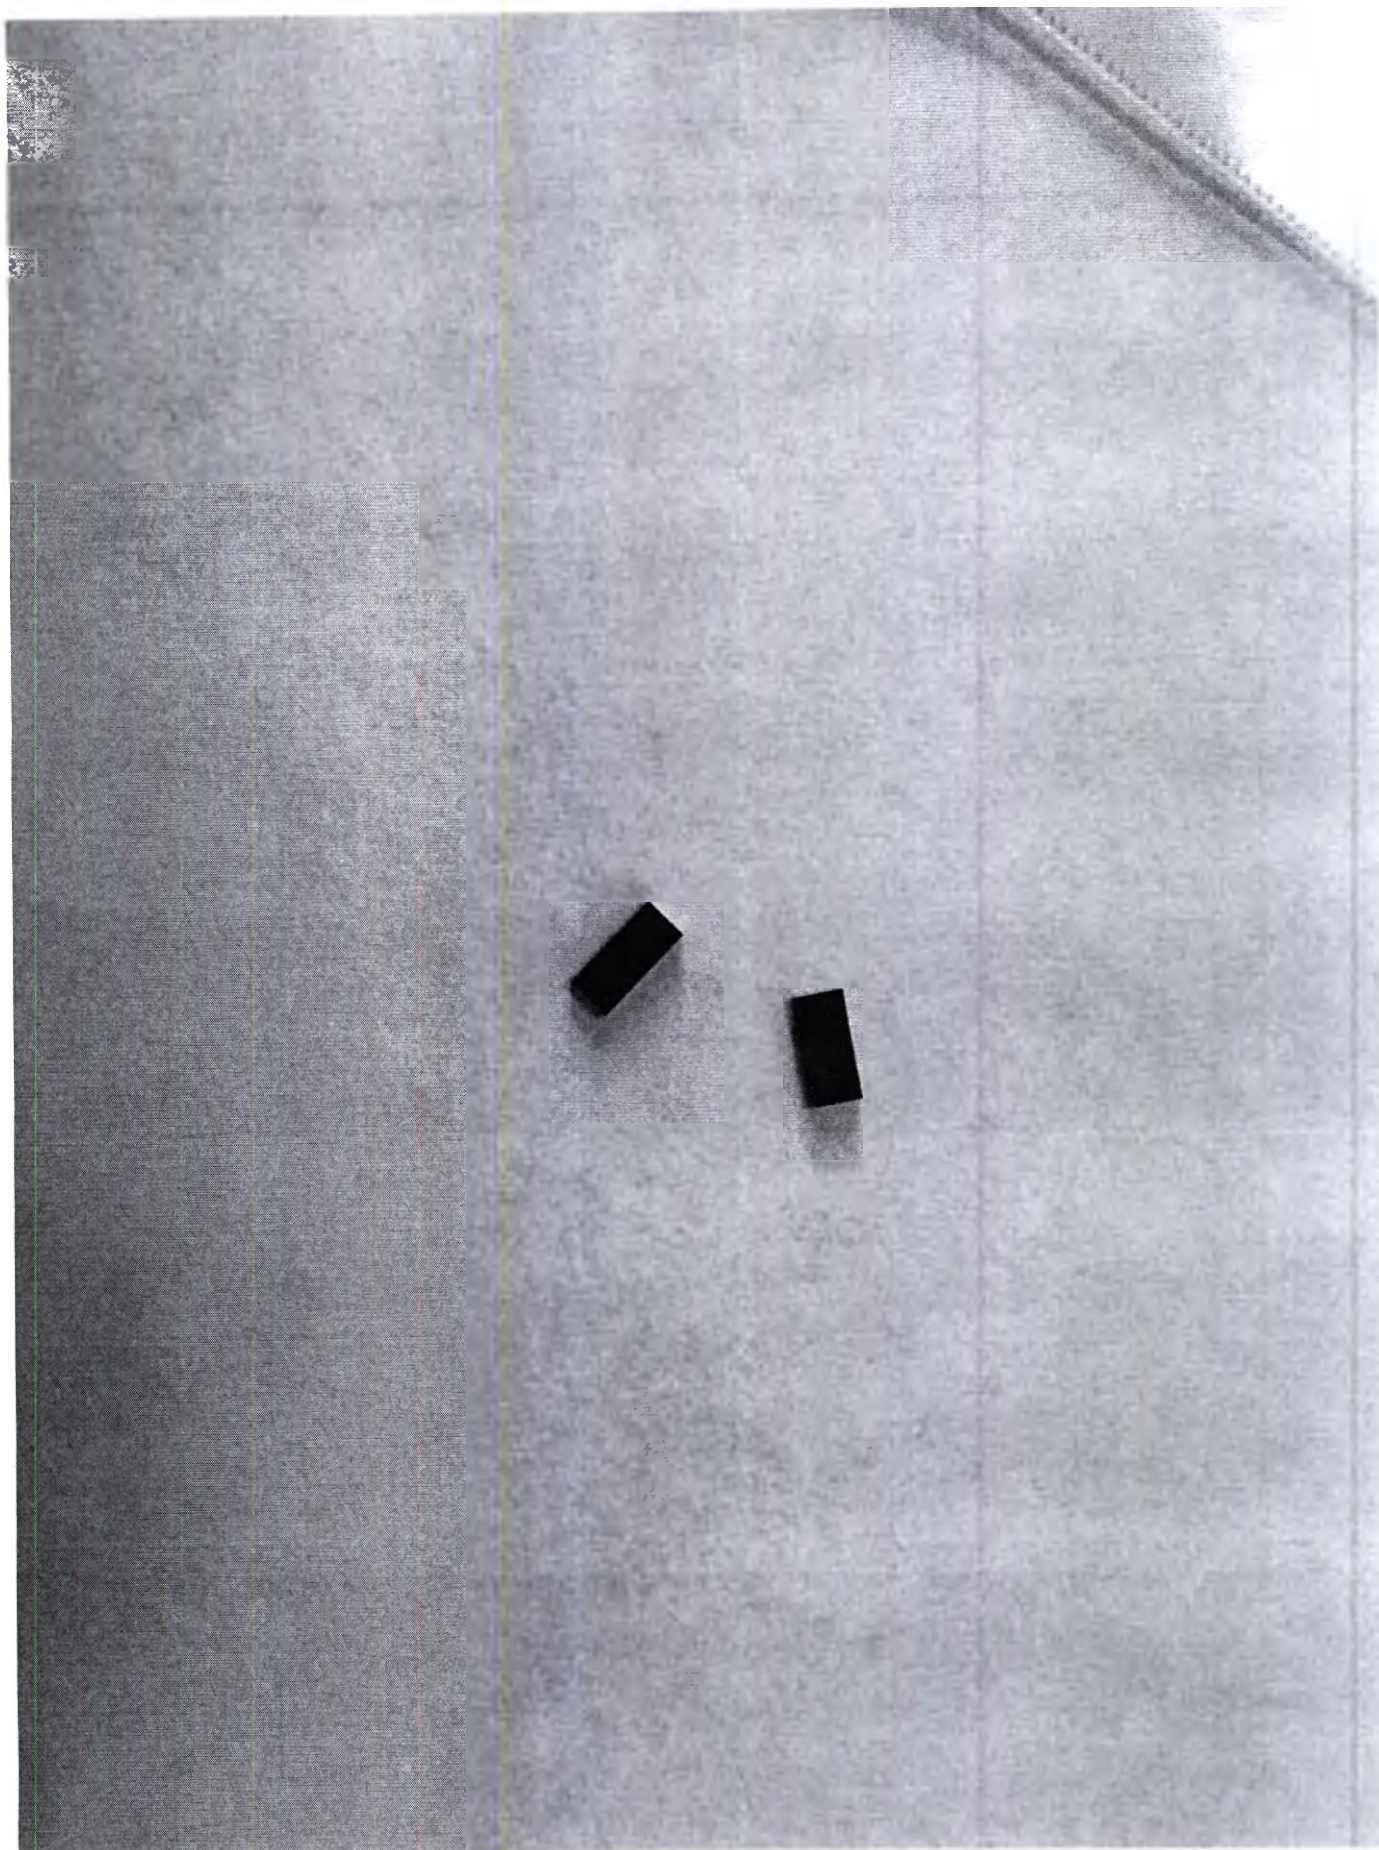


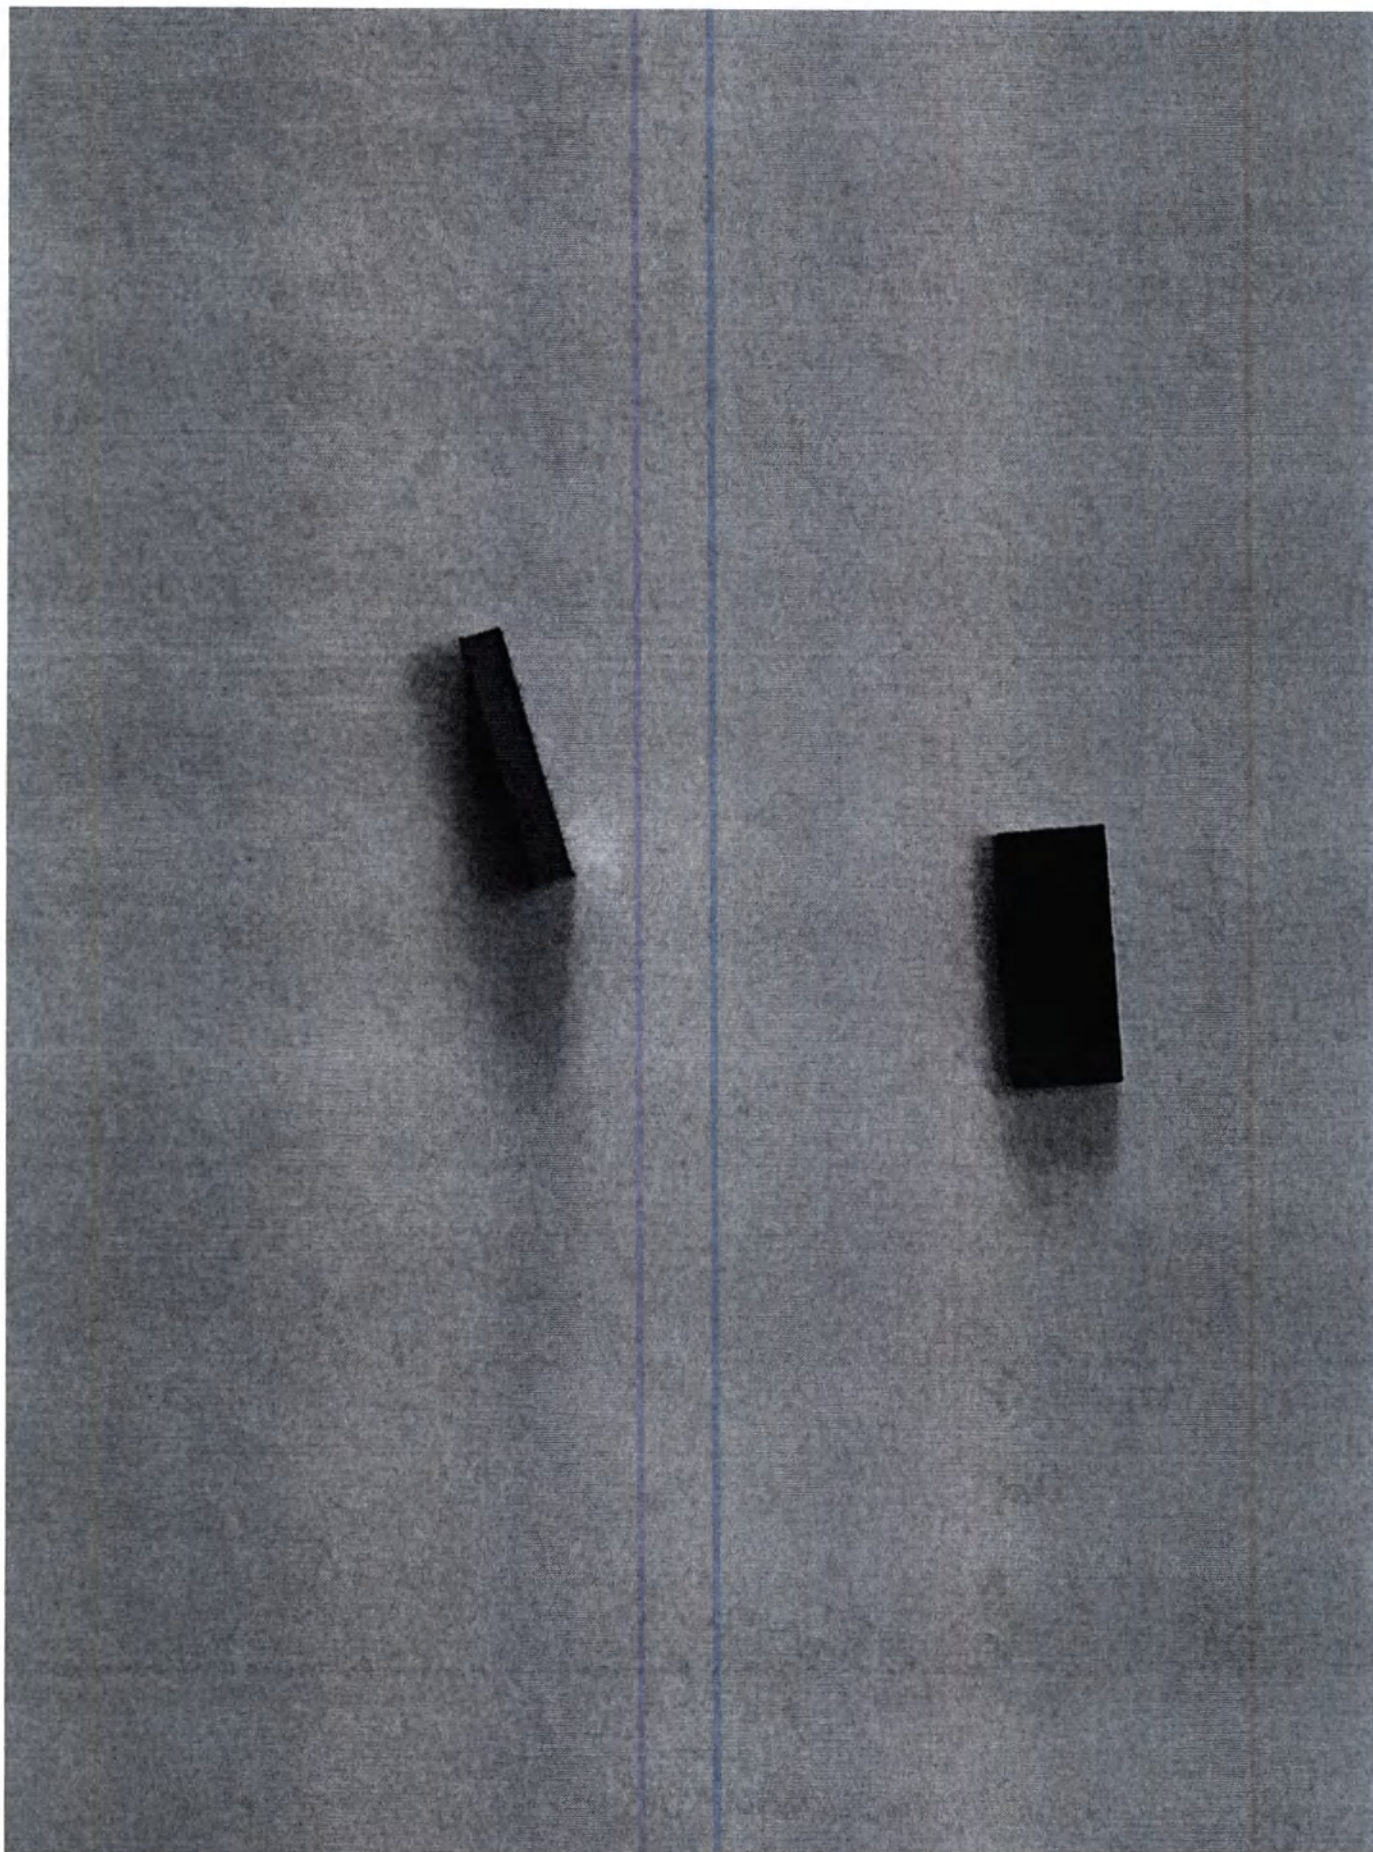




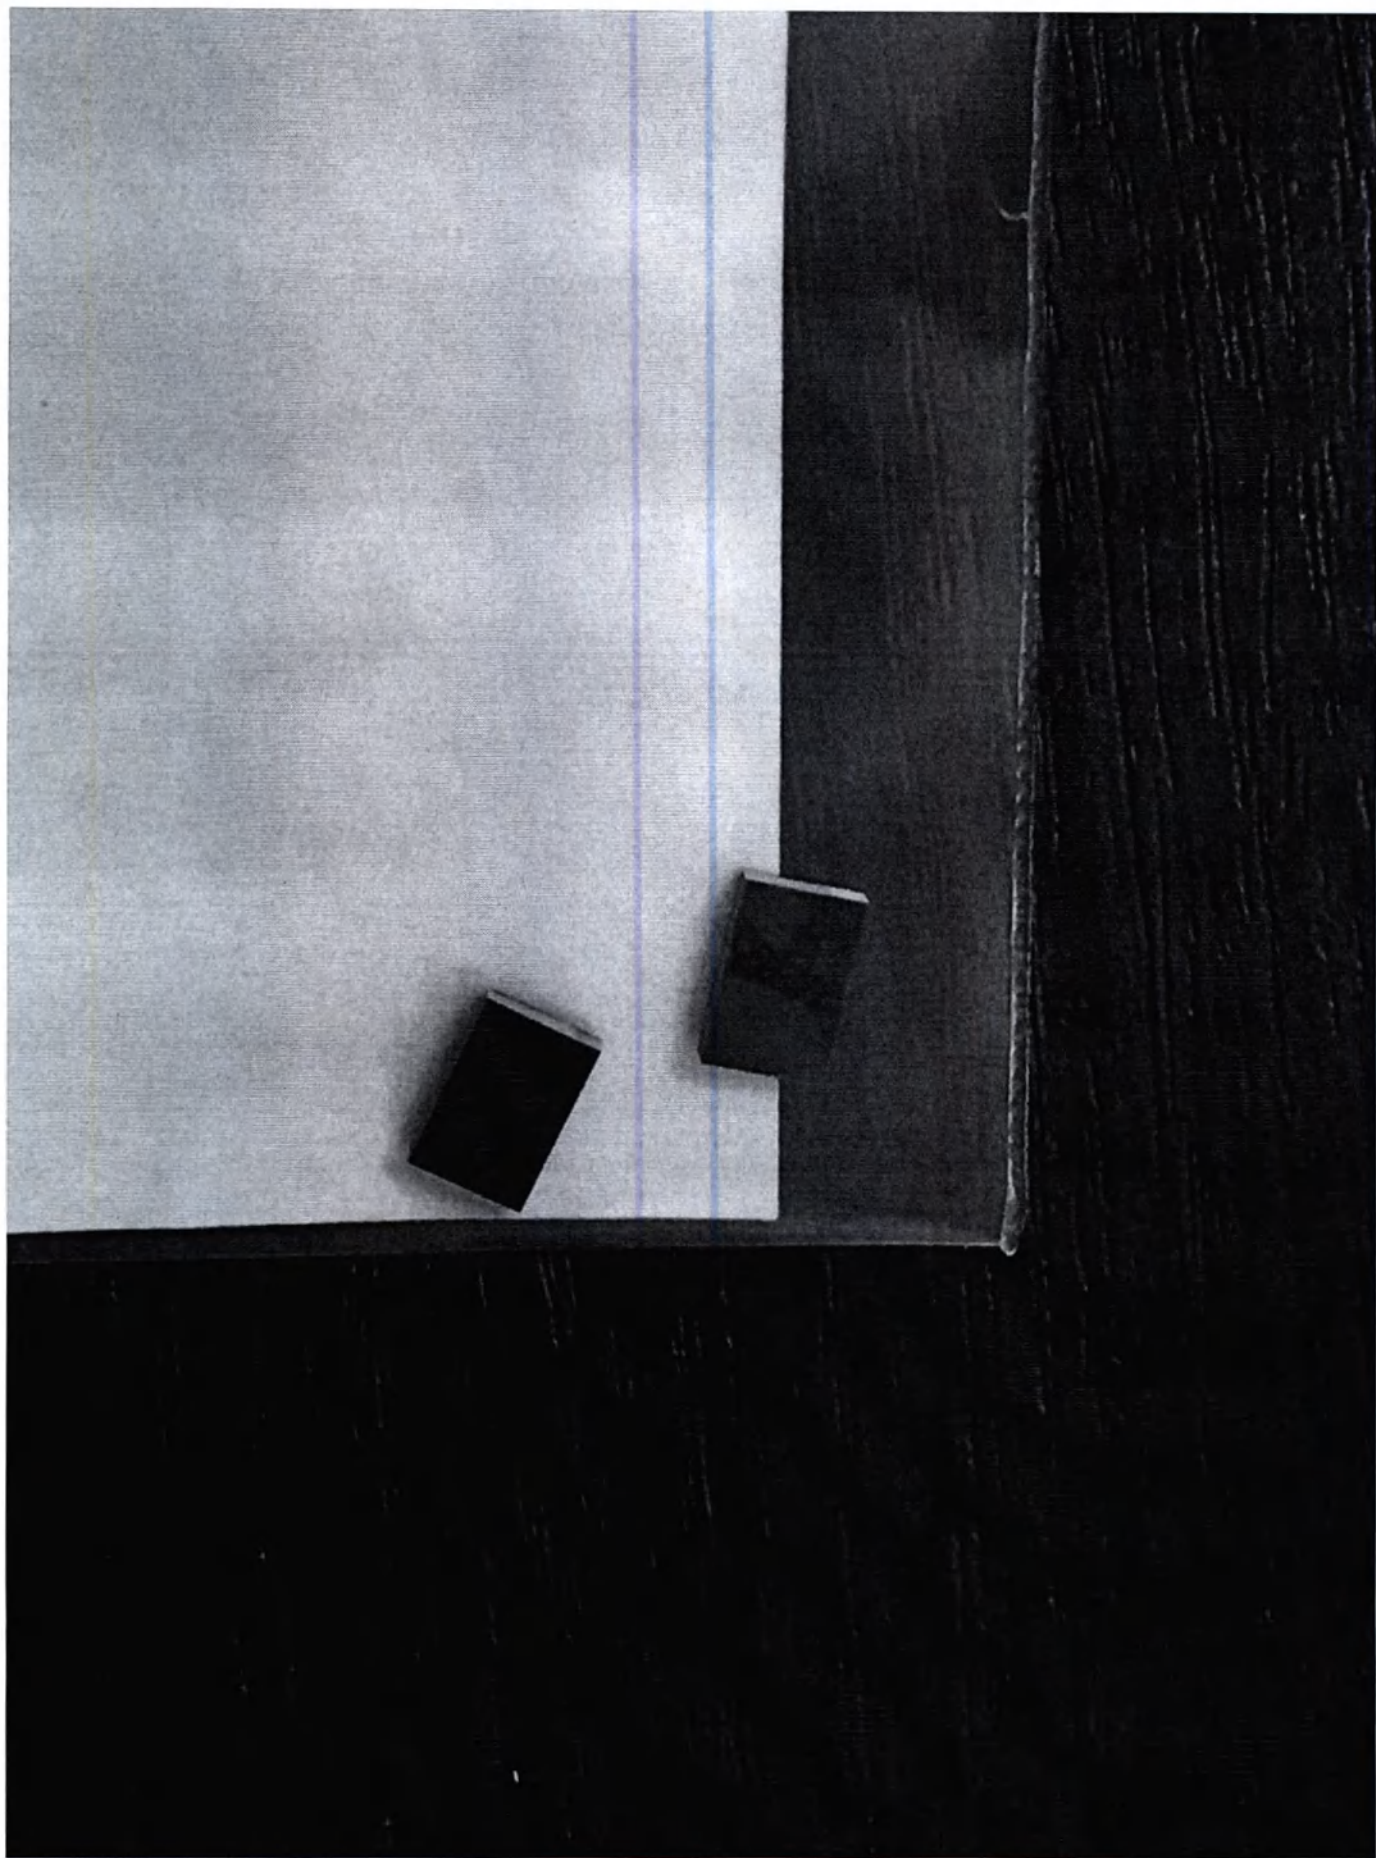


3.6. Рамка для эластомера (синяя)

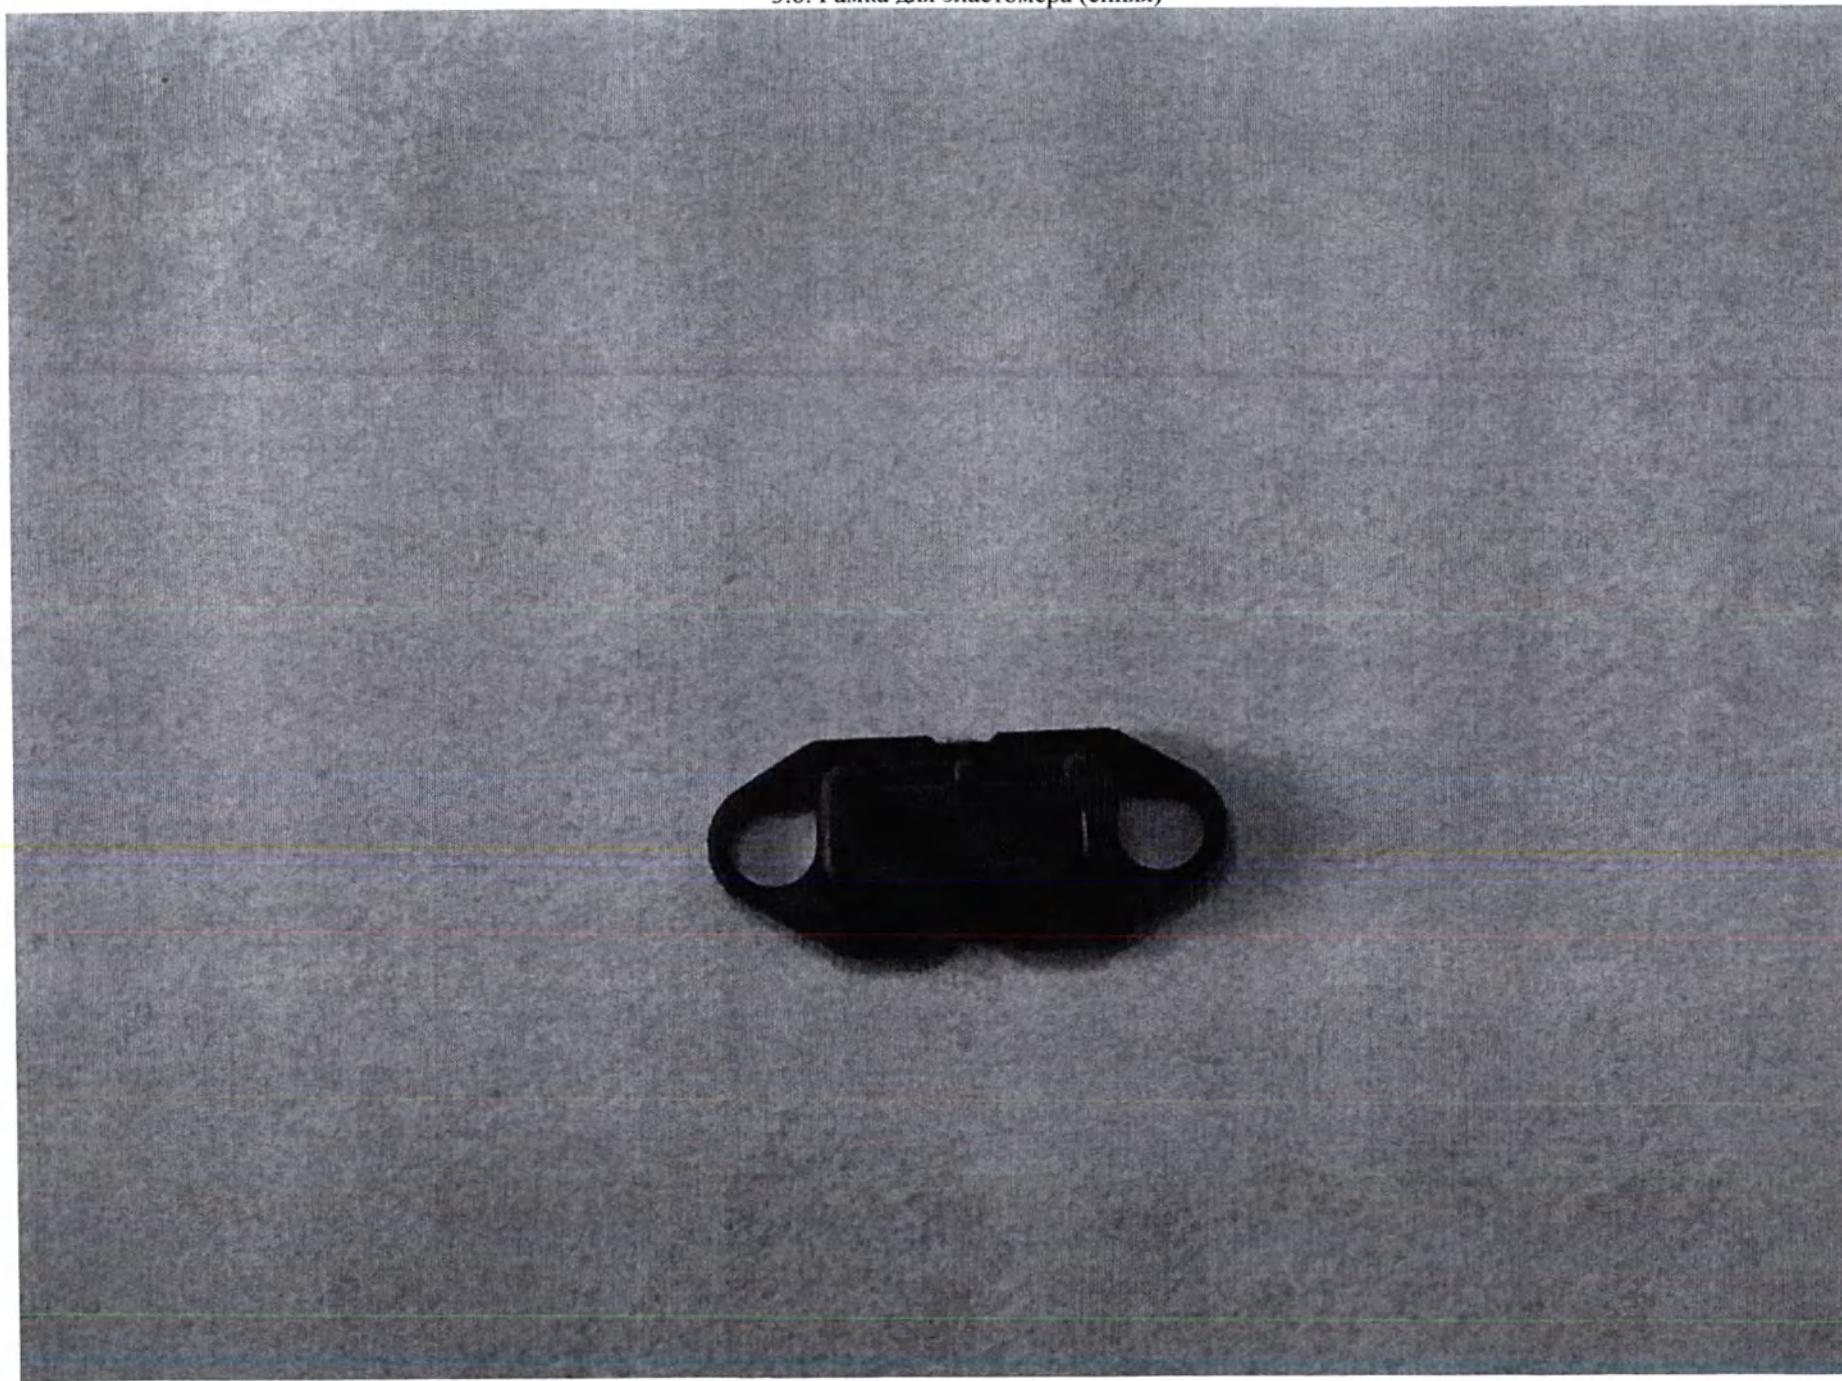


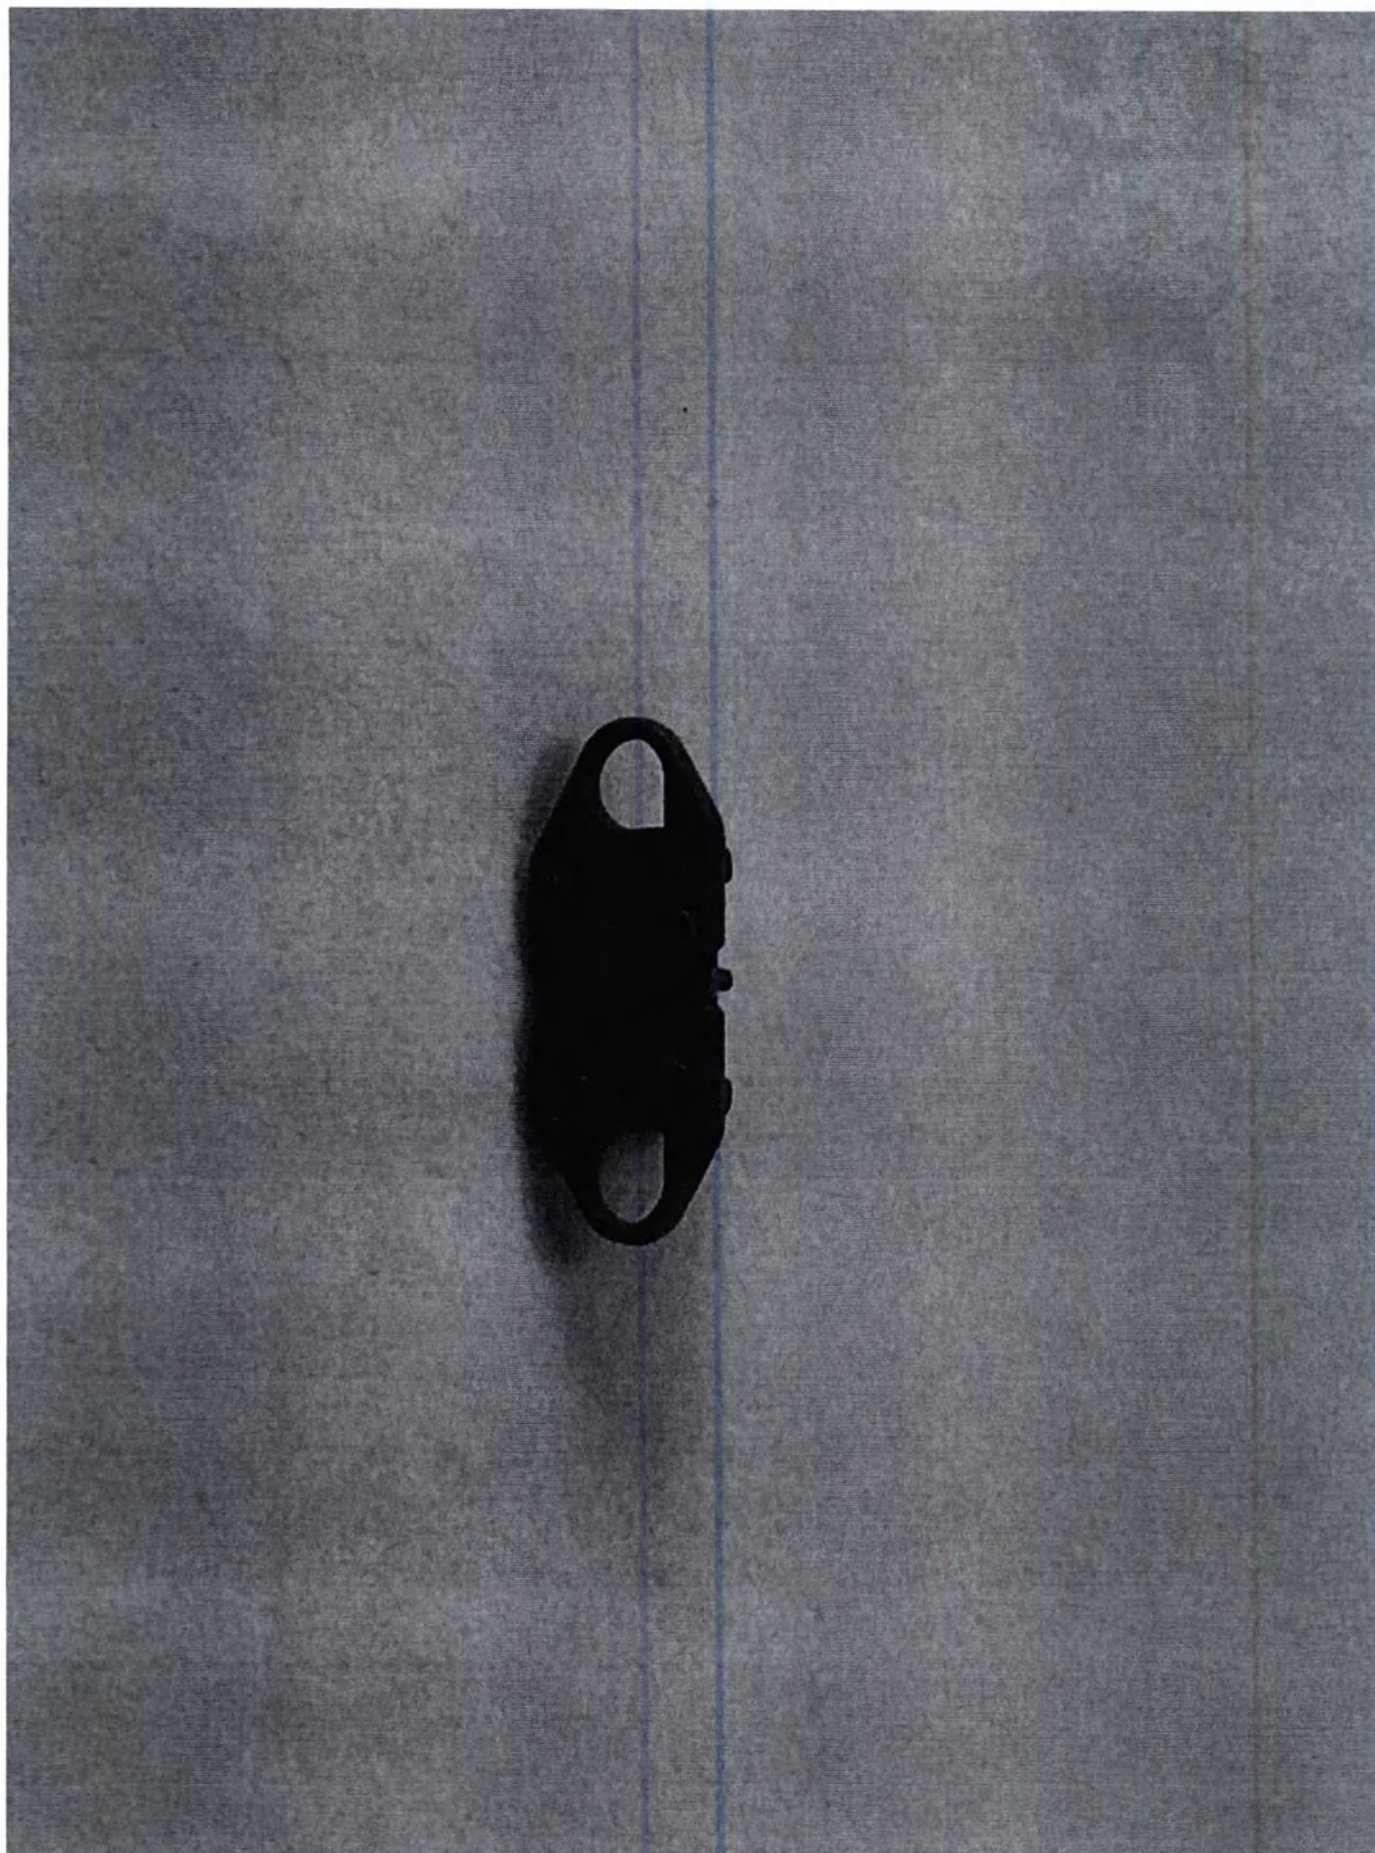







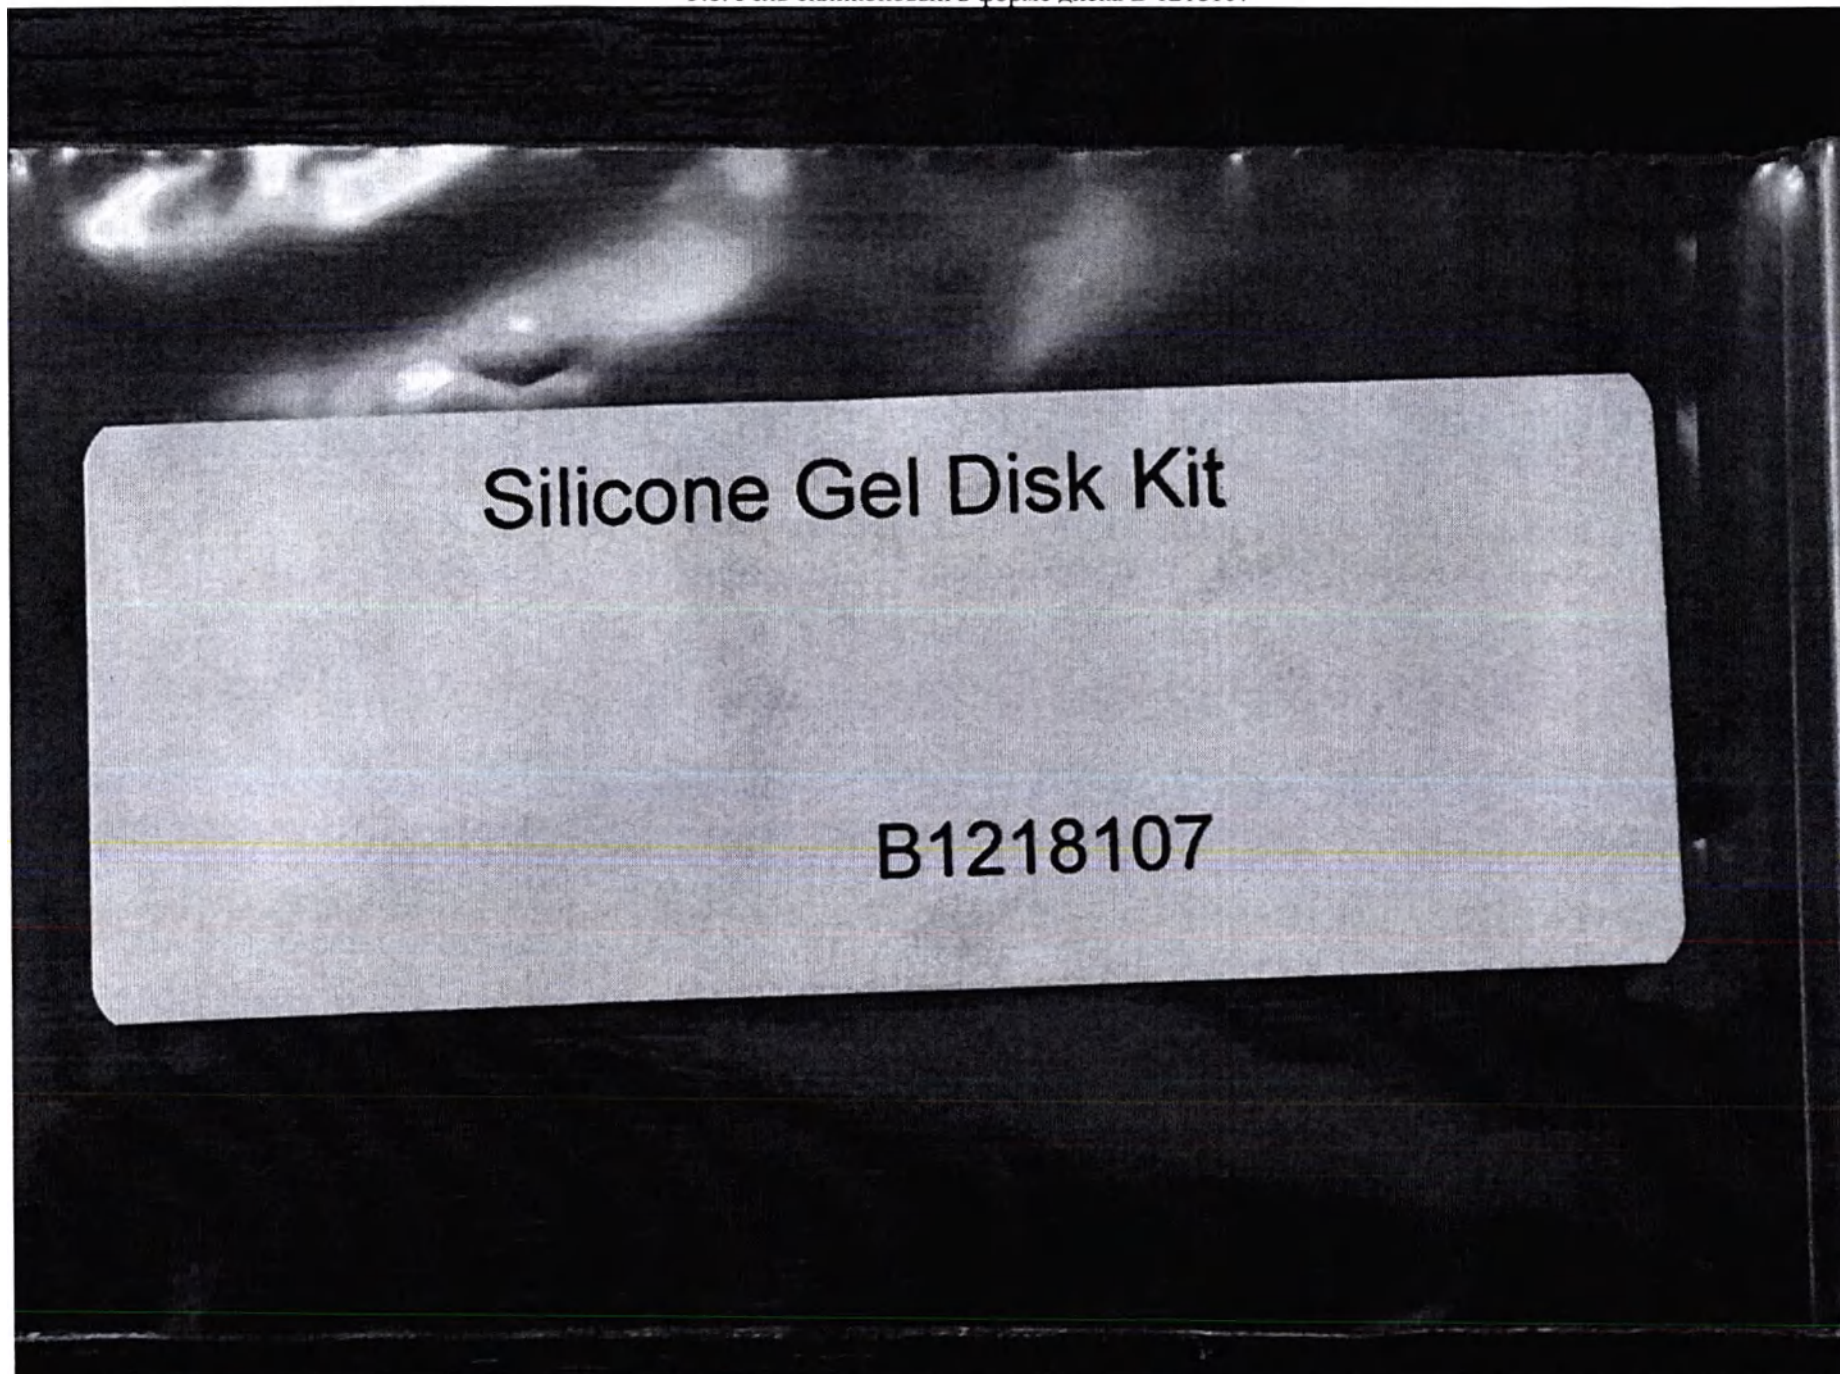

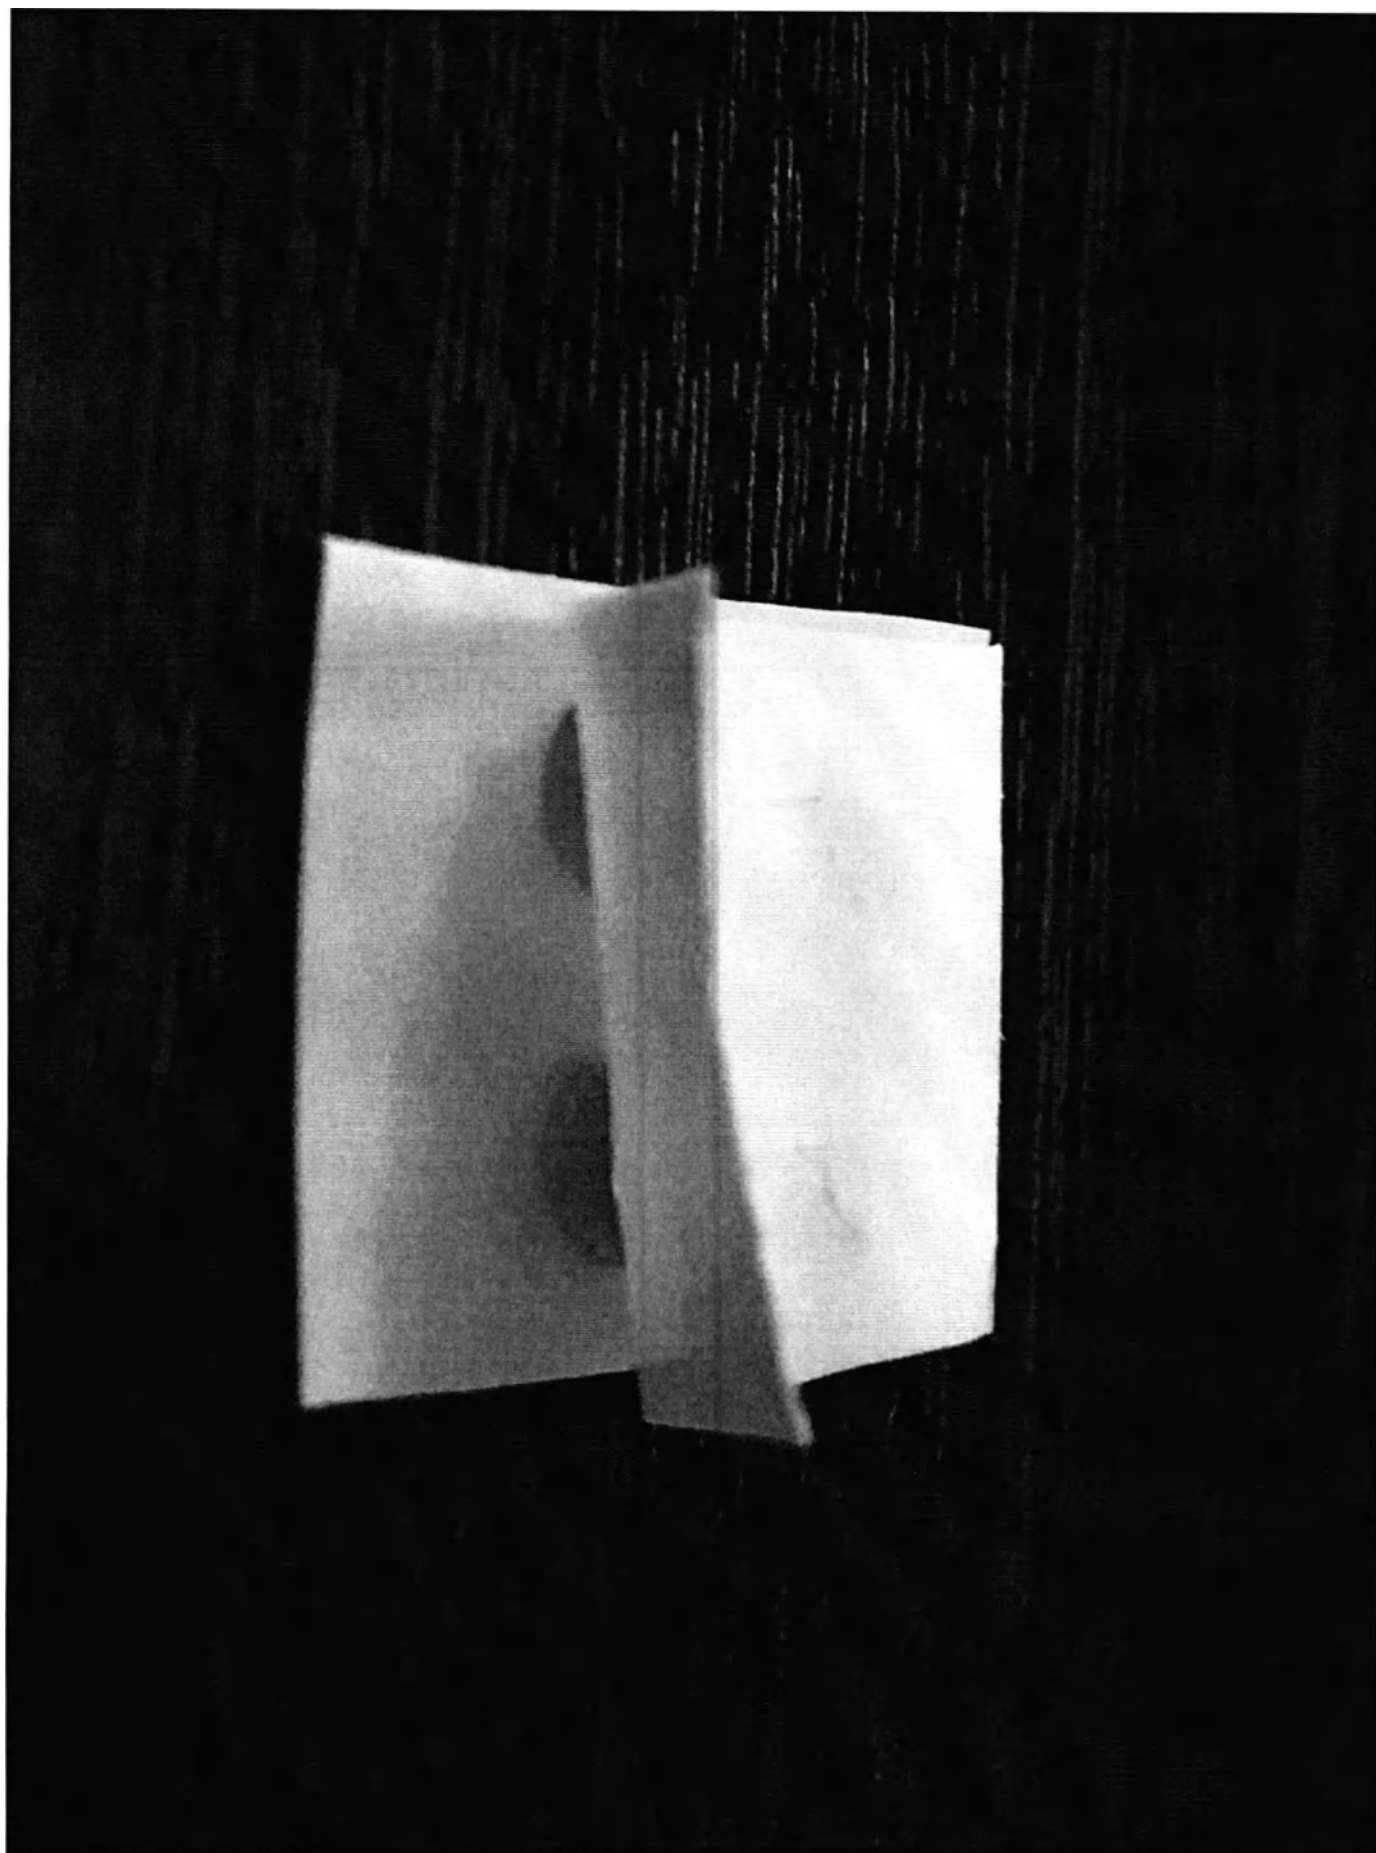


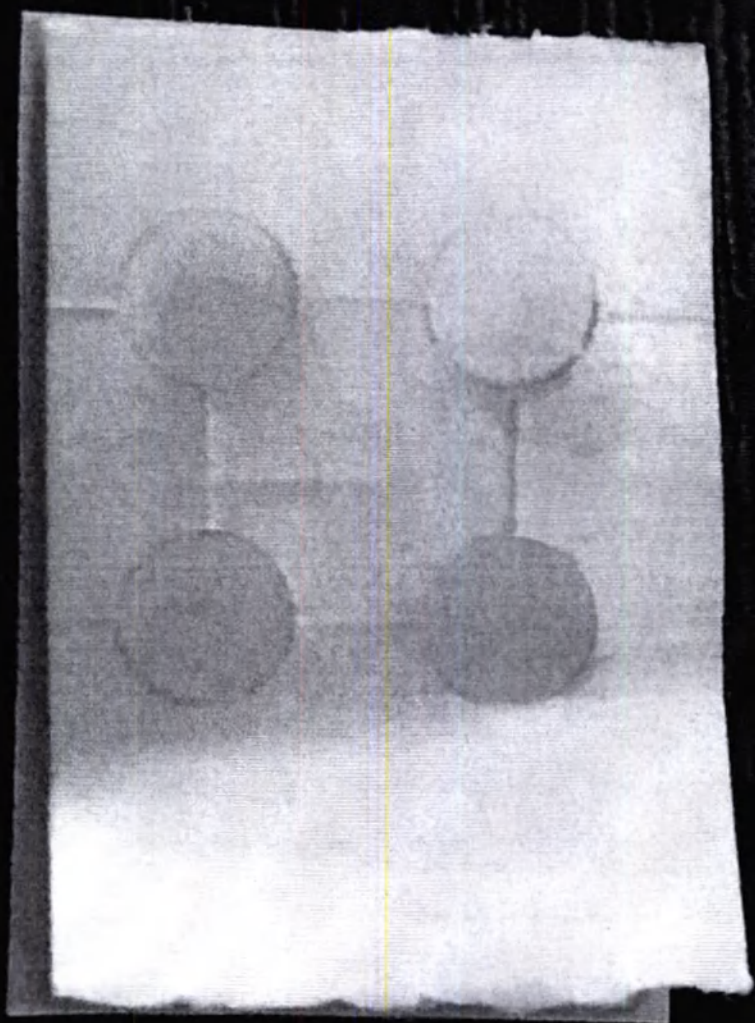

3.9. Винты с плоской головкой (0-80)

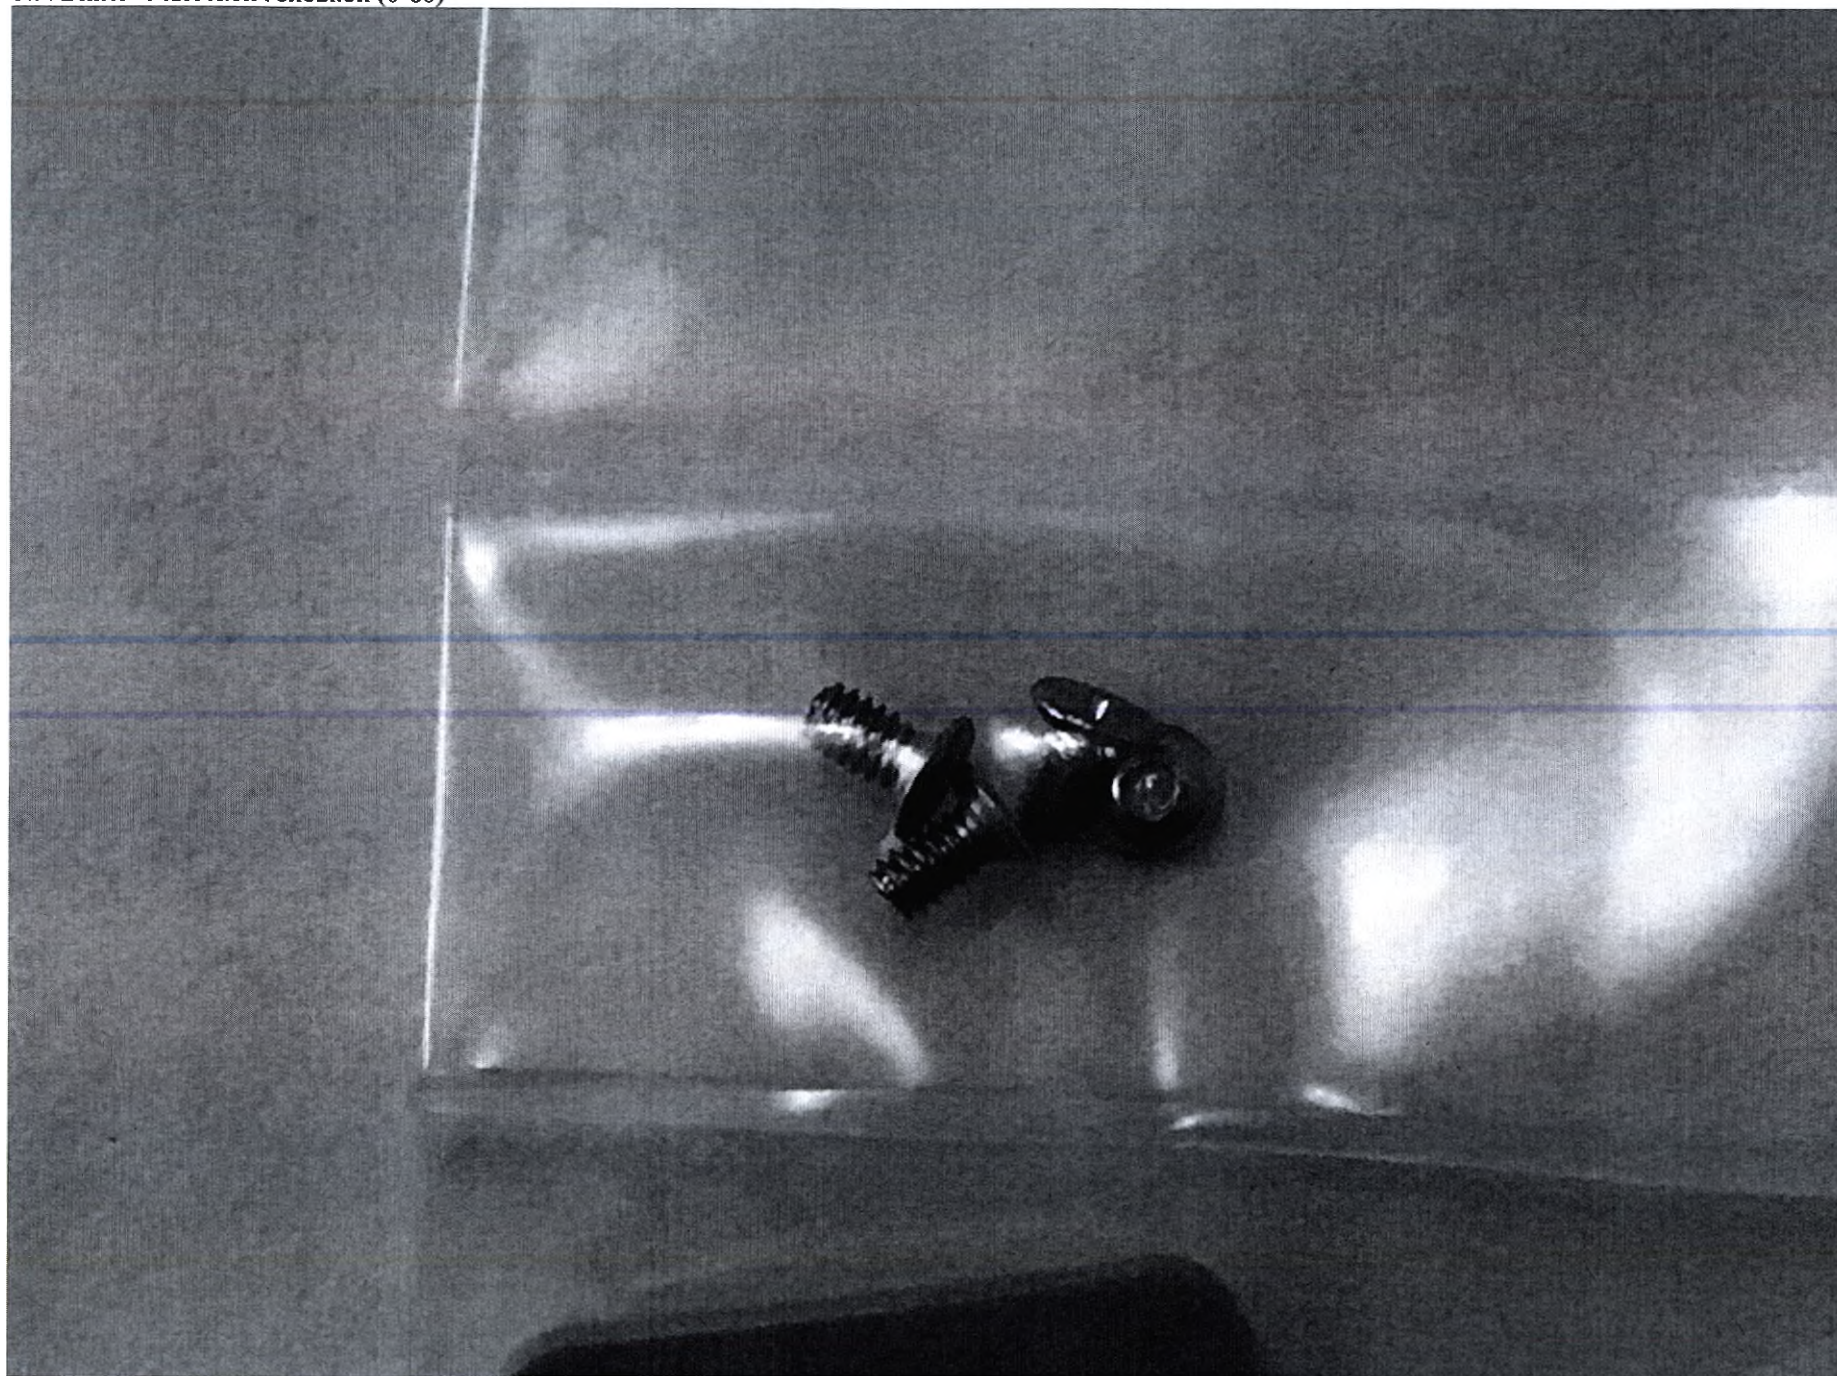




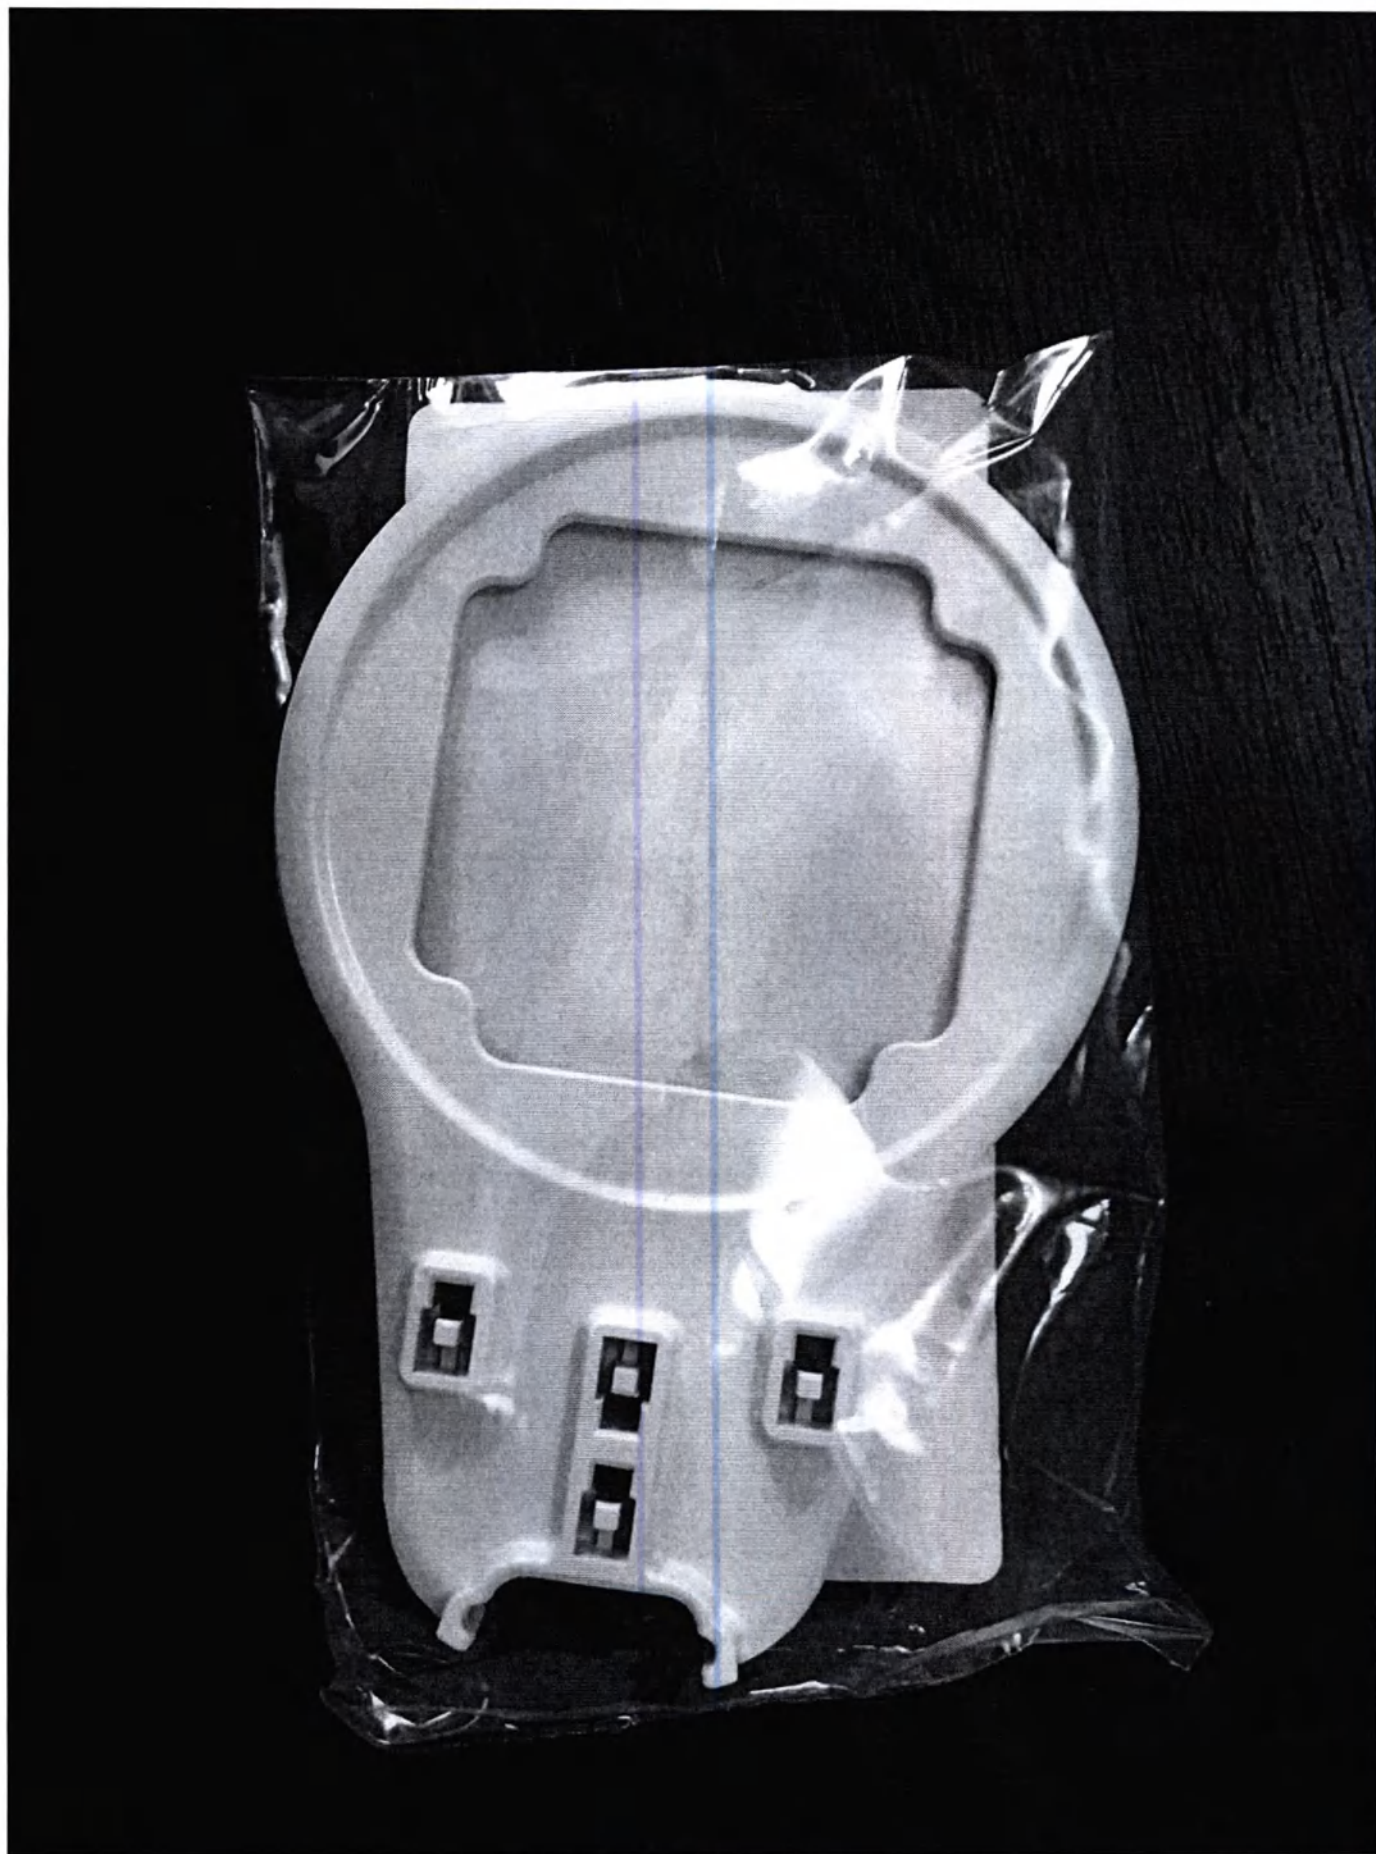








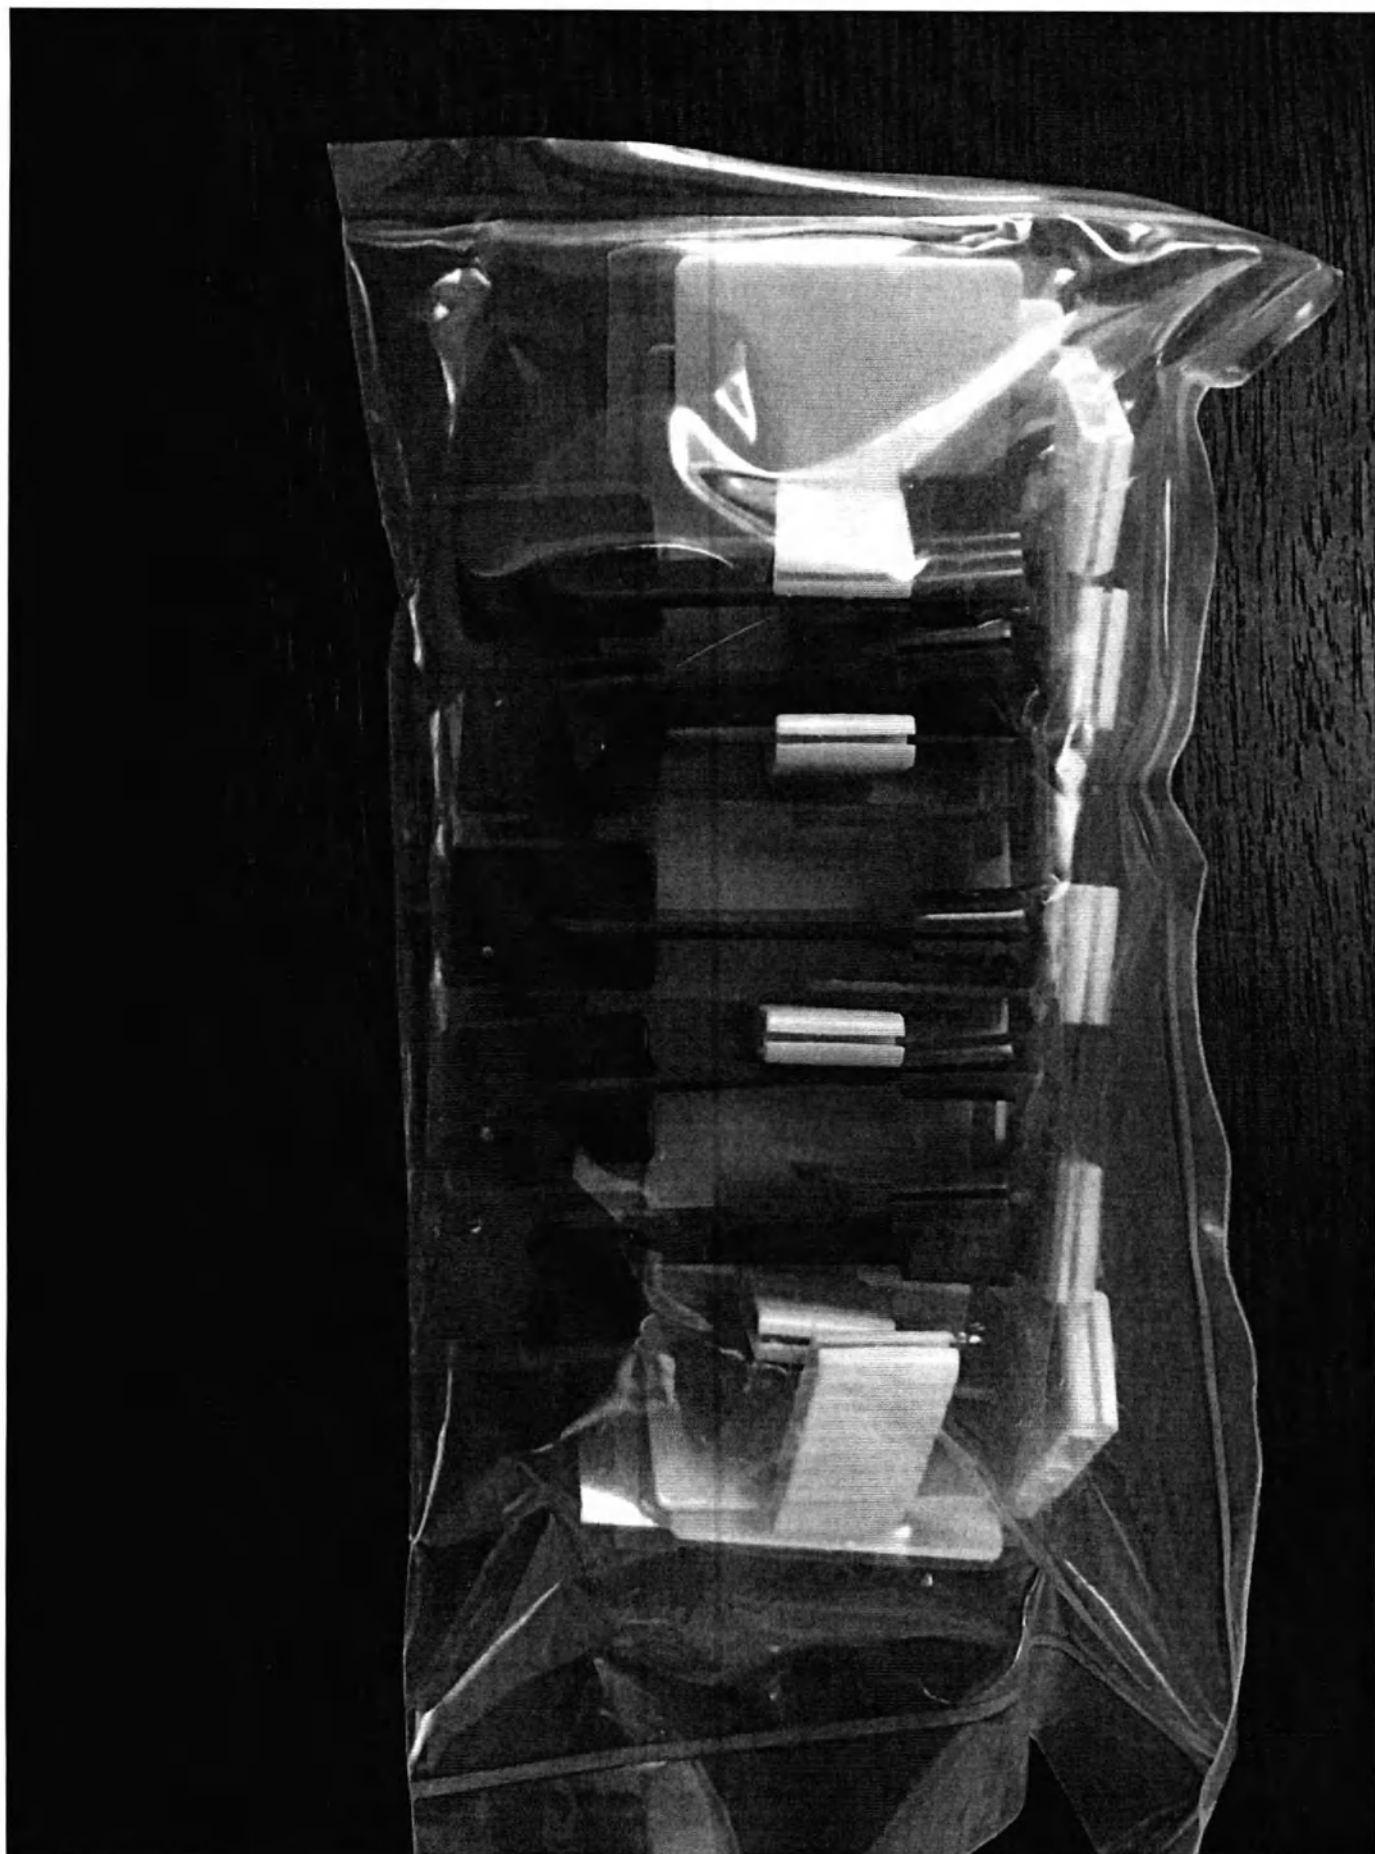

5. Чехлы защитные (гигиенические) одноразовые для датчика 100005396, упаковка 100шт.

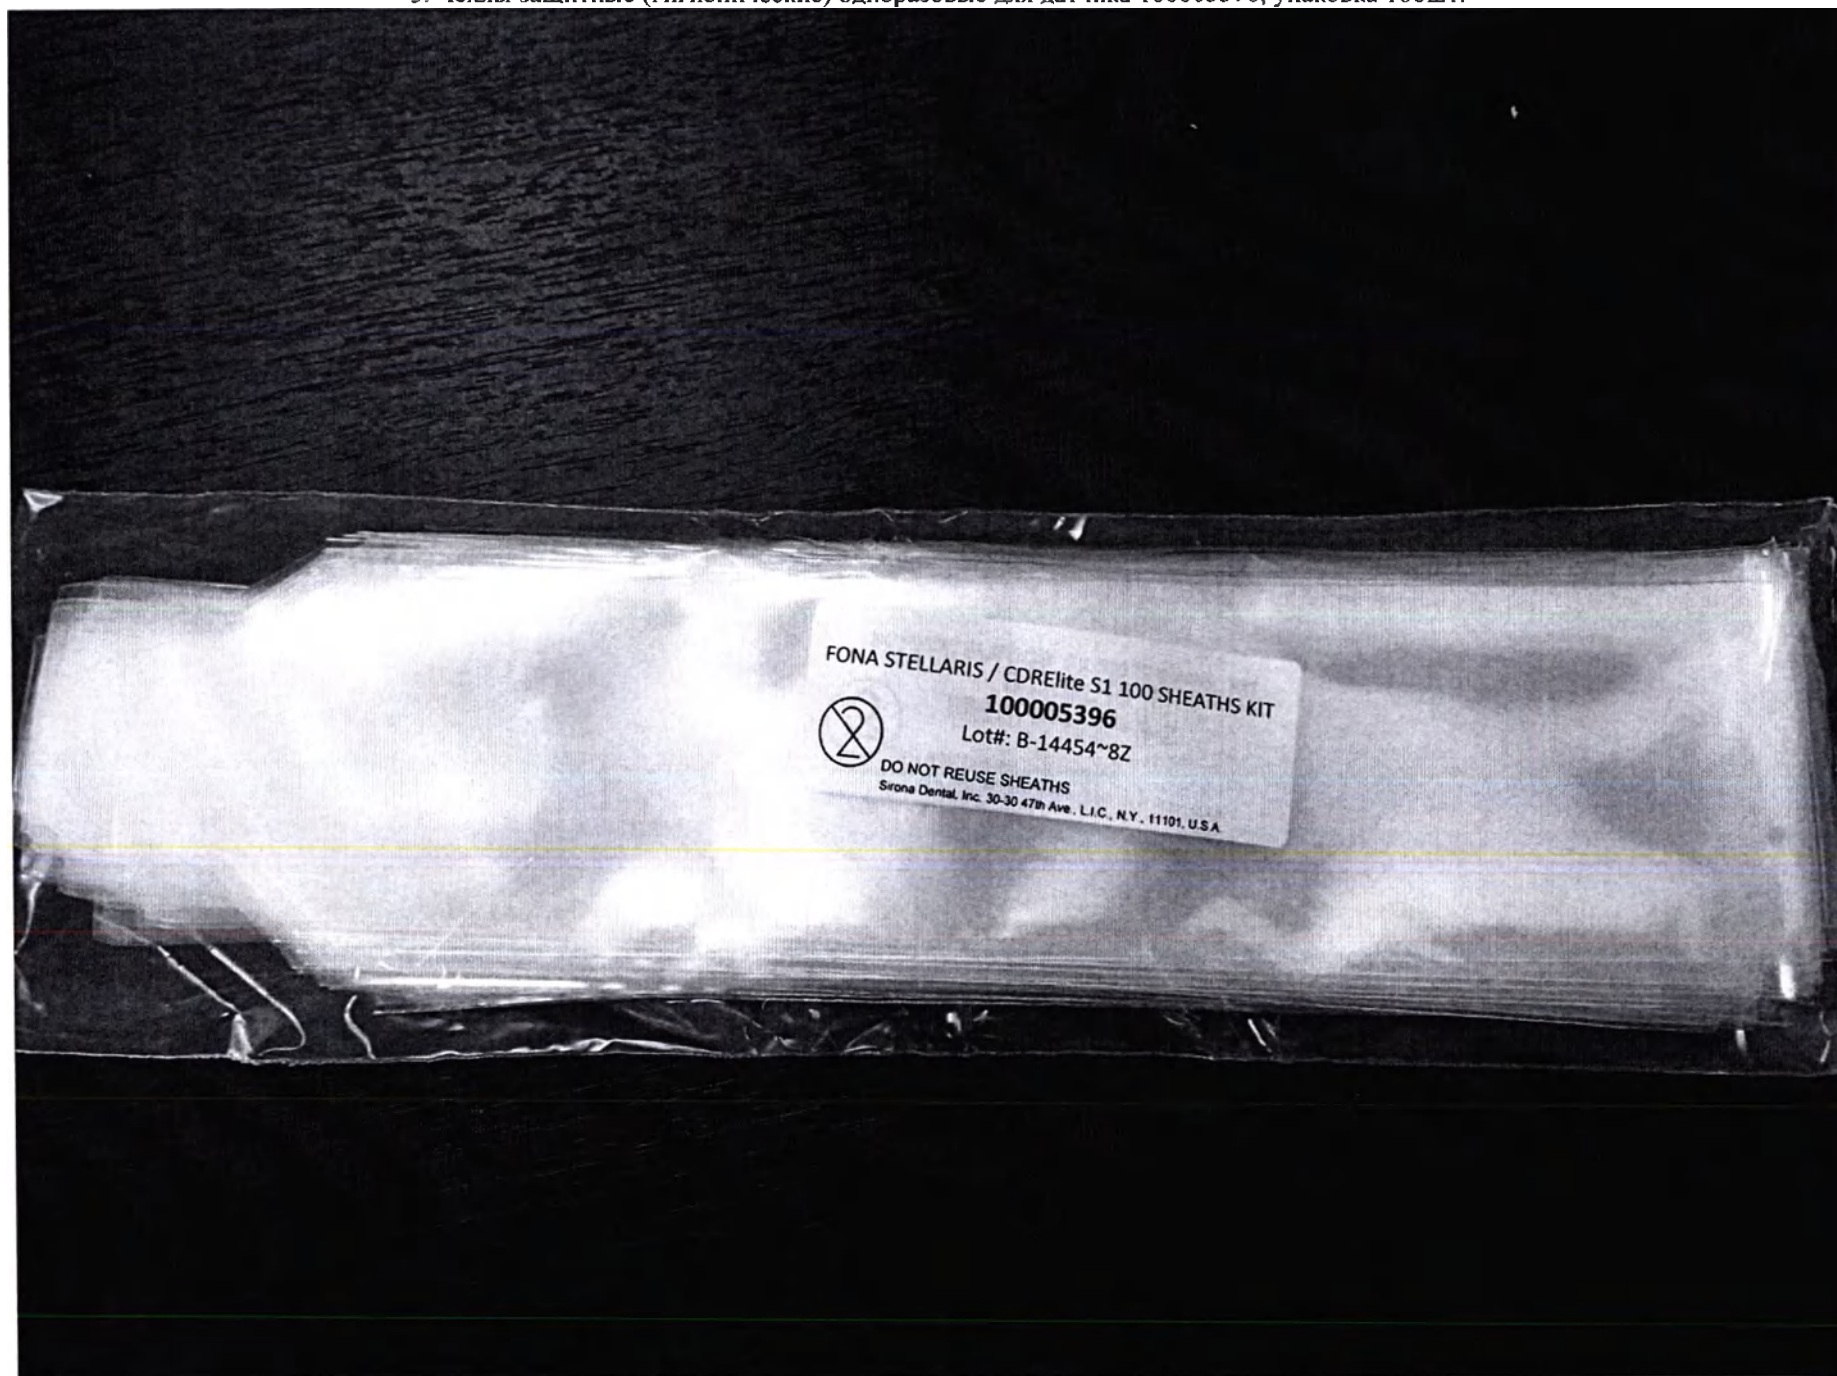


FONA STELLARIS / CDRElite S1 100 SHEATHS KIT
100005396
Lot#: B-14454~8Z
DO NOT REUSE SHEATHS
Sirona Dental, Inc. 30-30 47th Ave. L.I.C., N.Y. 11101, U.S.A.






FONA Stellaris / CDRelite Sensor

Quick User Guide - Please Read This First

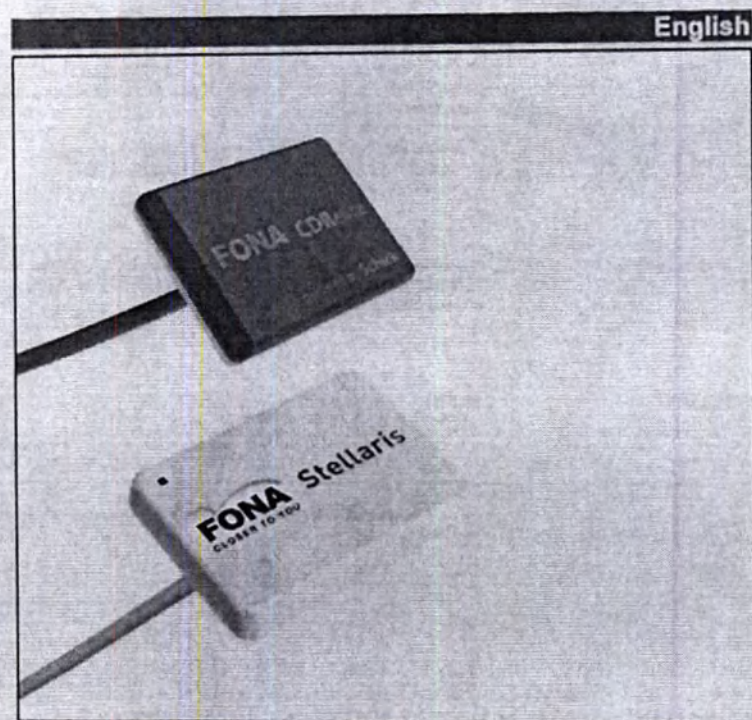

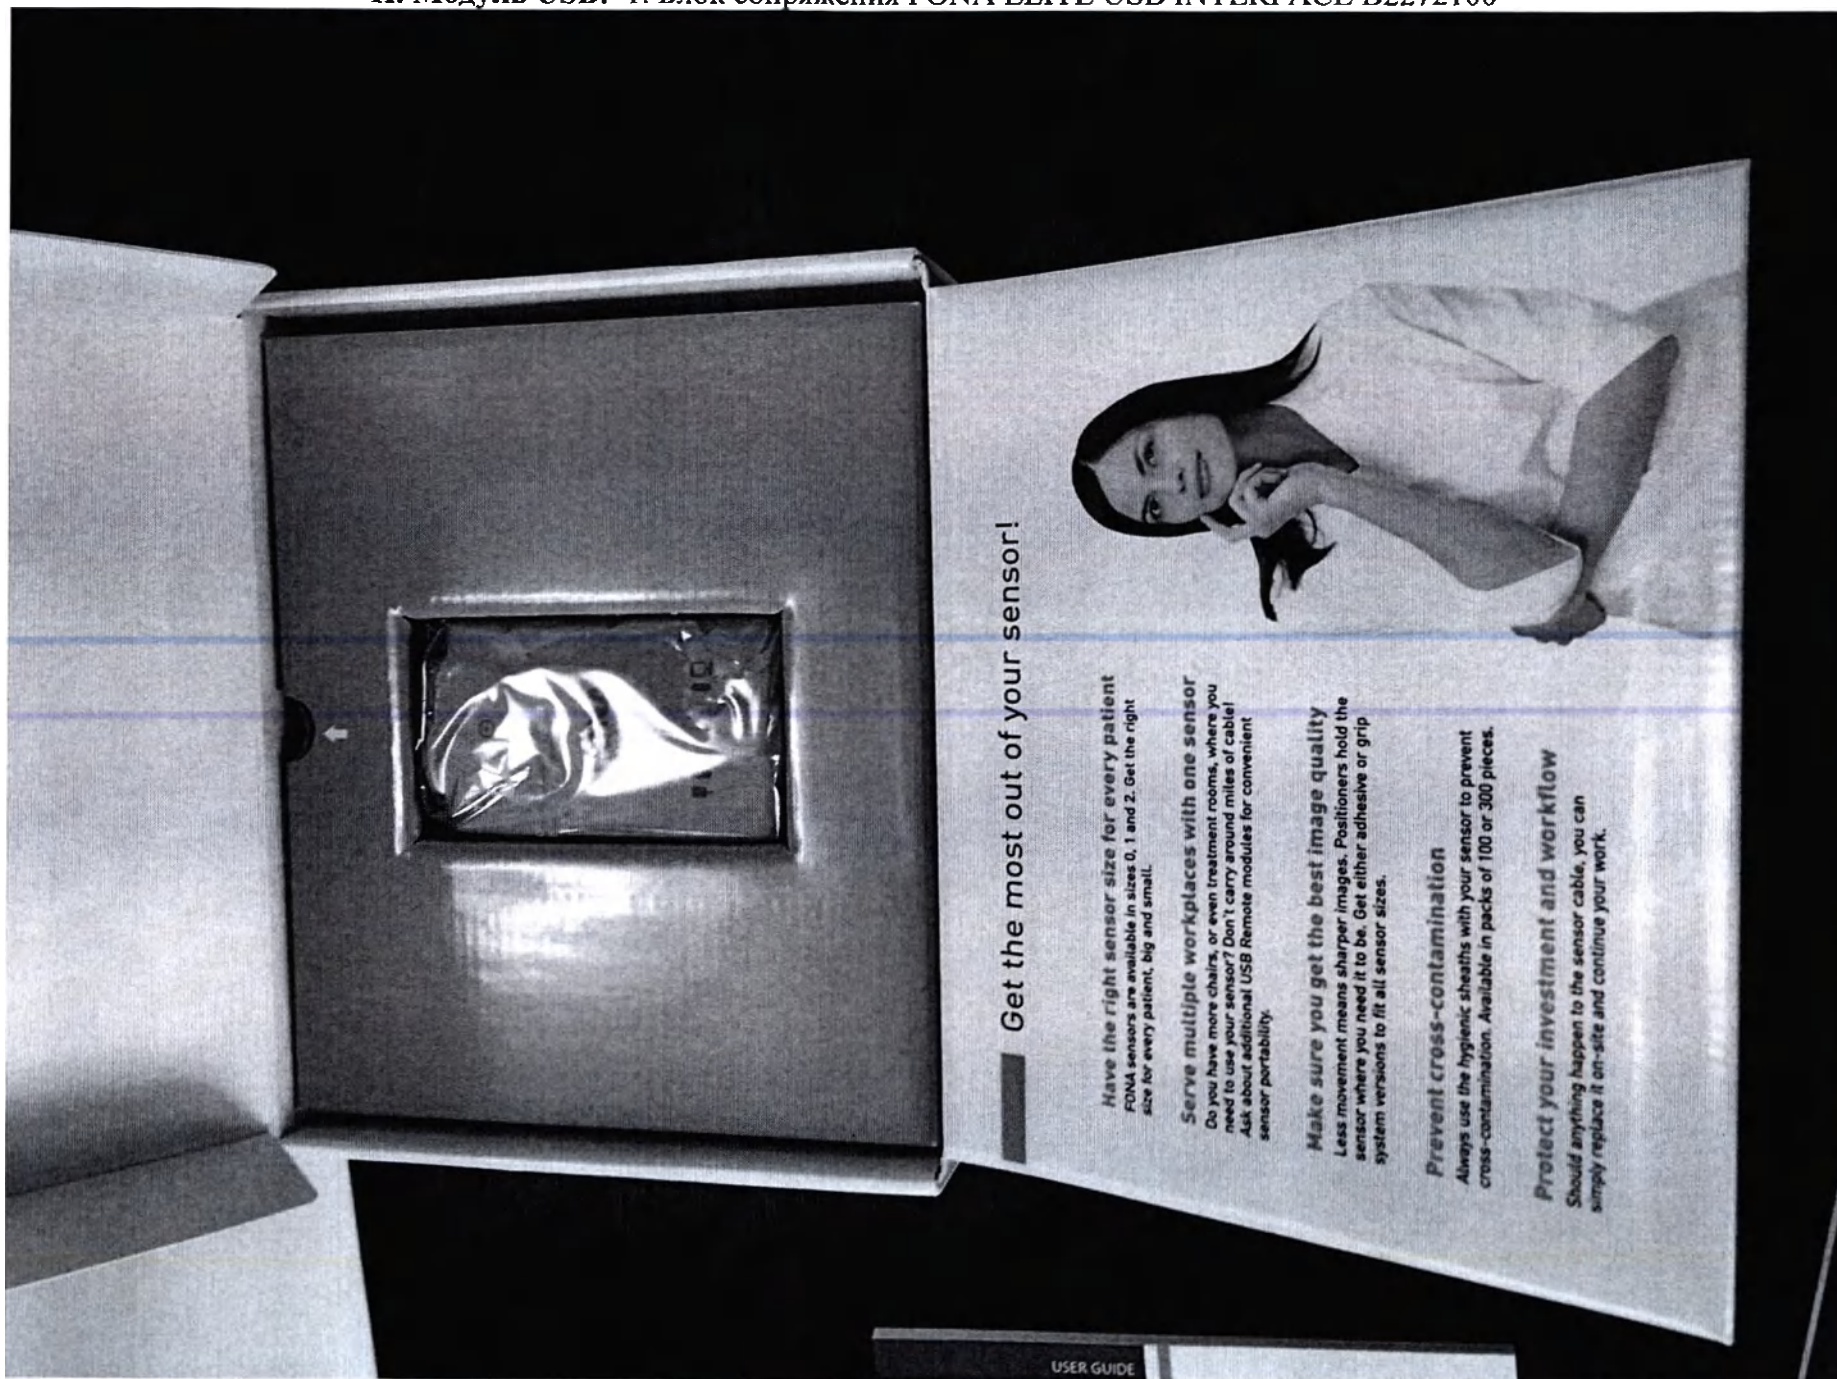

Get the most out of your sensor!

Have the right sensor size for every patient
FONA sensors are available in sizes 0, 1 and 2. Get the right size for every patient, big and small.

Serve multiple workplaces with one sensor
Do you have more chairs, or even treatment rooms, where you need to use your sensor? Don't carry around miles of cable! Ask about additional USB Remote modules for convenient sensor portability.


Make sure you get the best image quality
Less movement means sharper images. Positioners hold the sensor where you need it to be. Get either adhesive or grip system versions to fit all sensor sizes.

Prevent cross-contamination
Always use the hygienic sheaths with your sensor to prevent cross-contamination. Available in packs of 100 or 300 pieces.


Protect your investment and workflow
Should anything happen to the sensor cable, you can simply replace it on-site and continue your work.




USER GUIDE

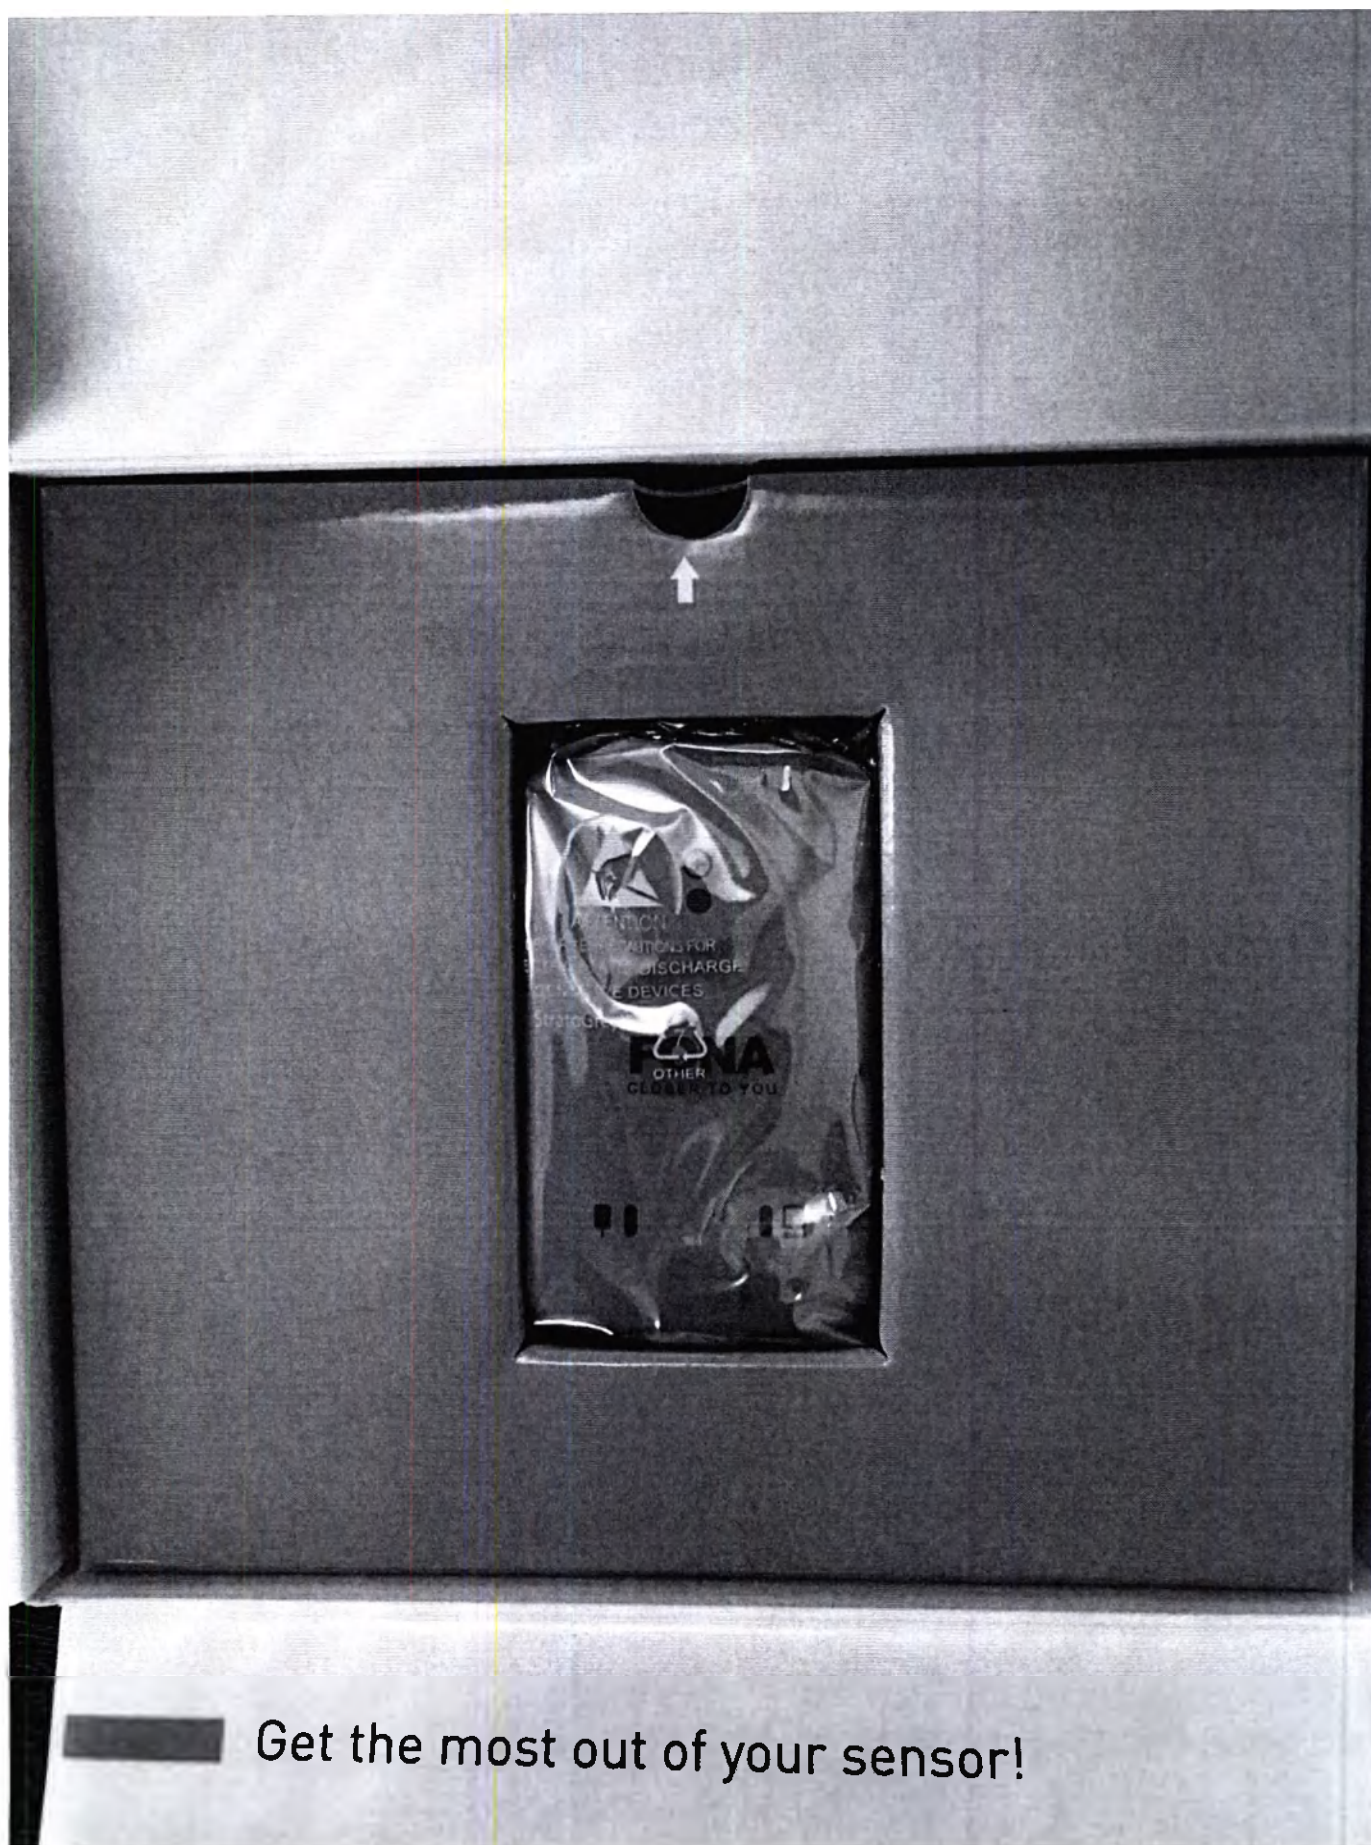

Get the most out of your sensor!

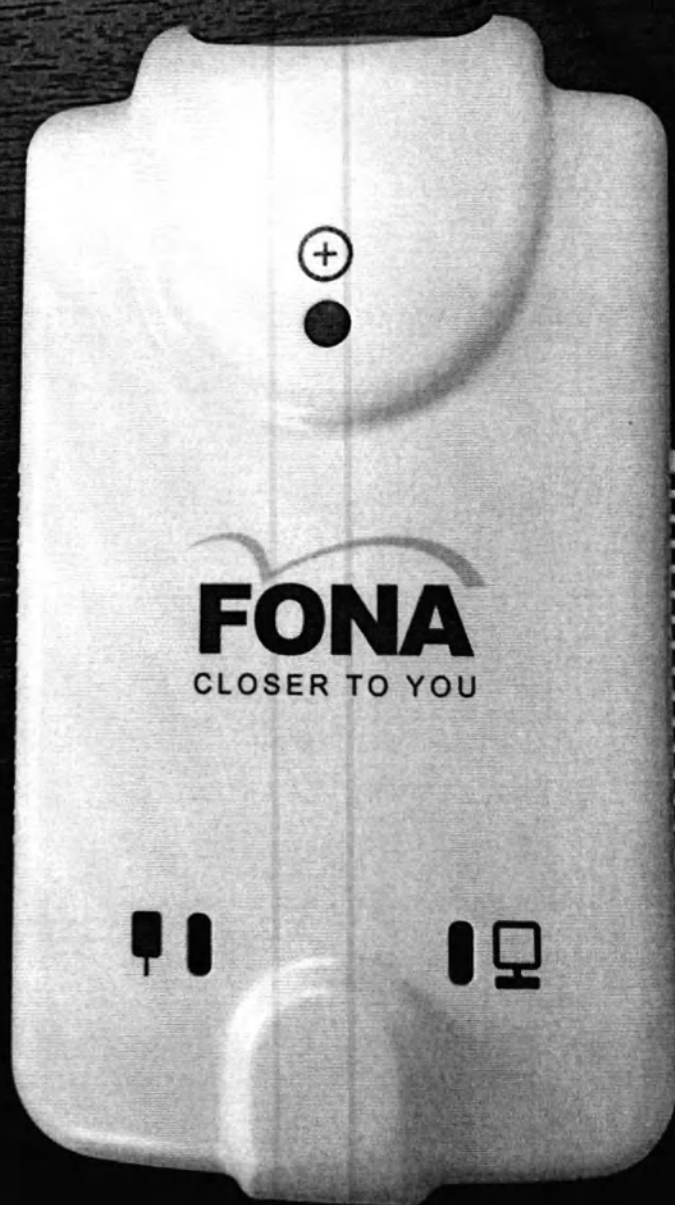



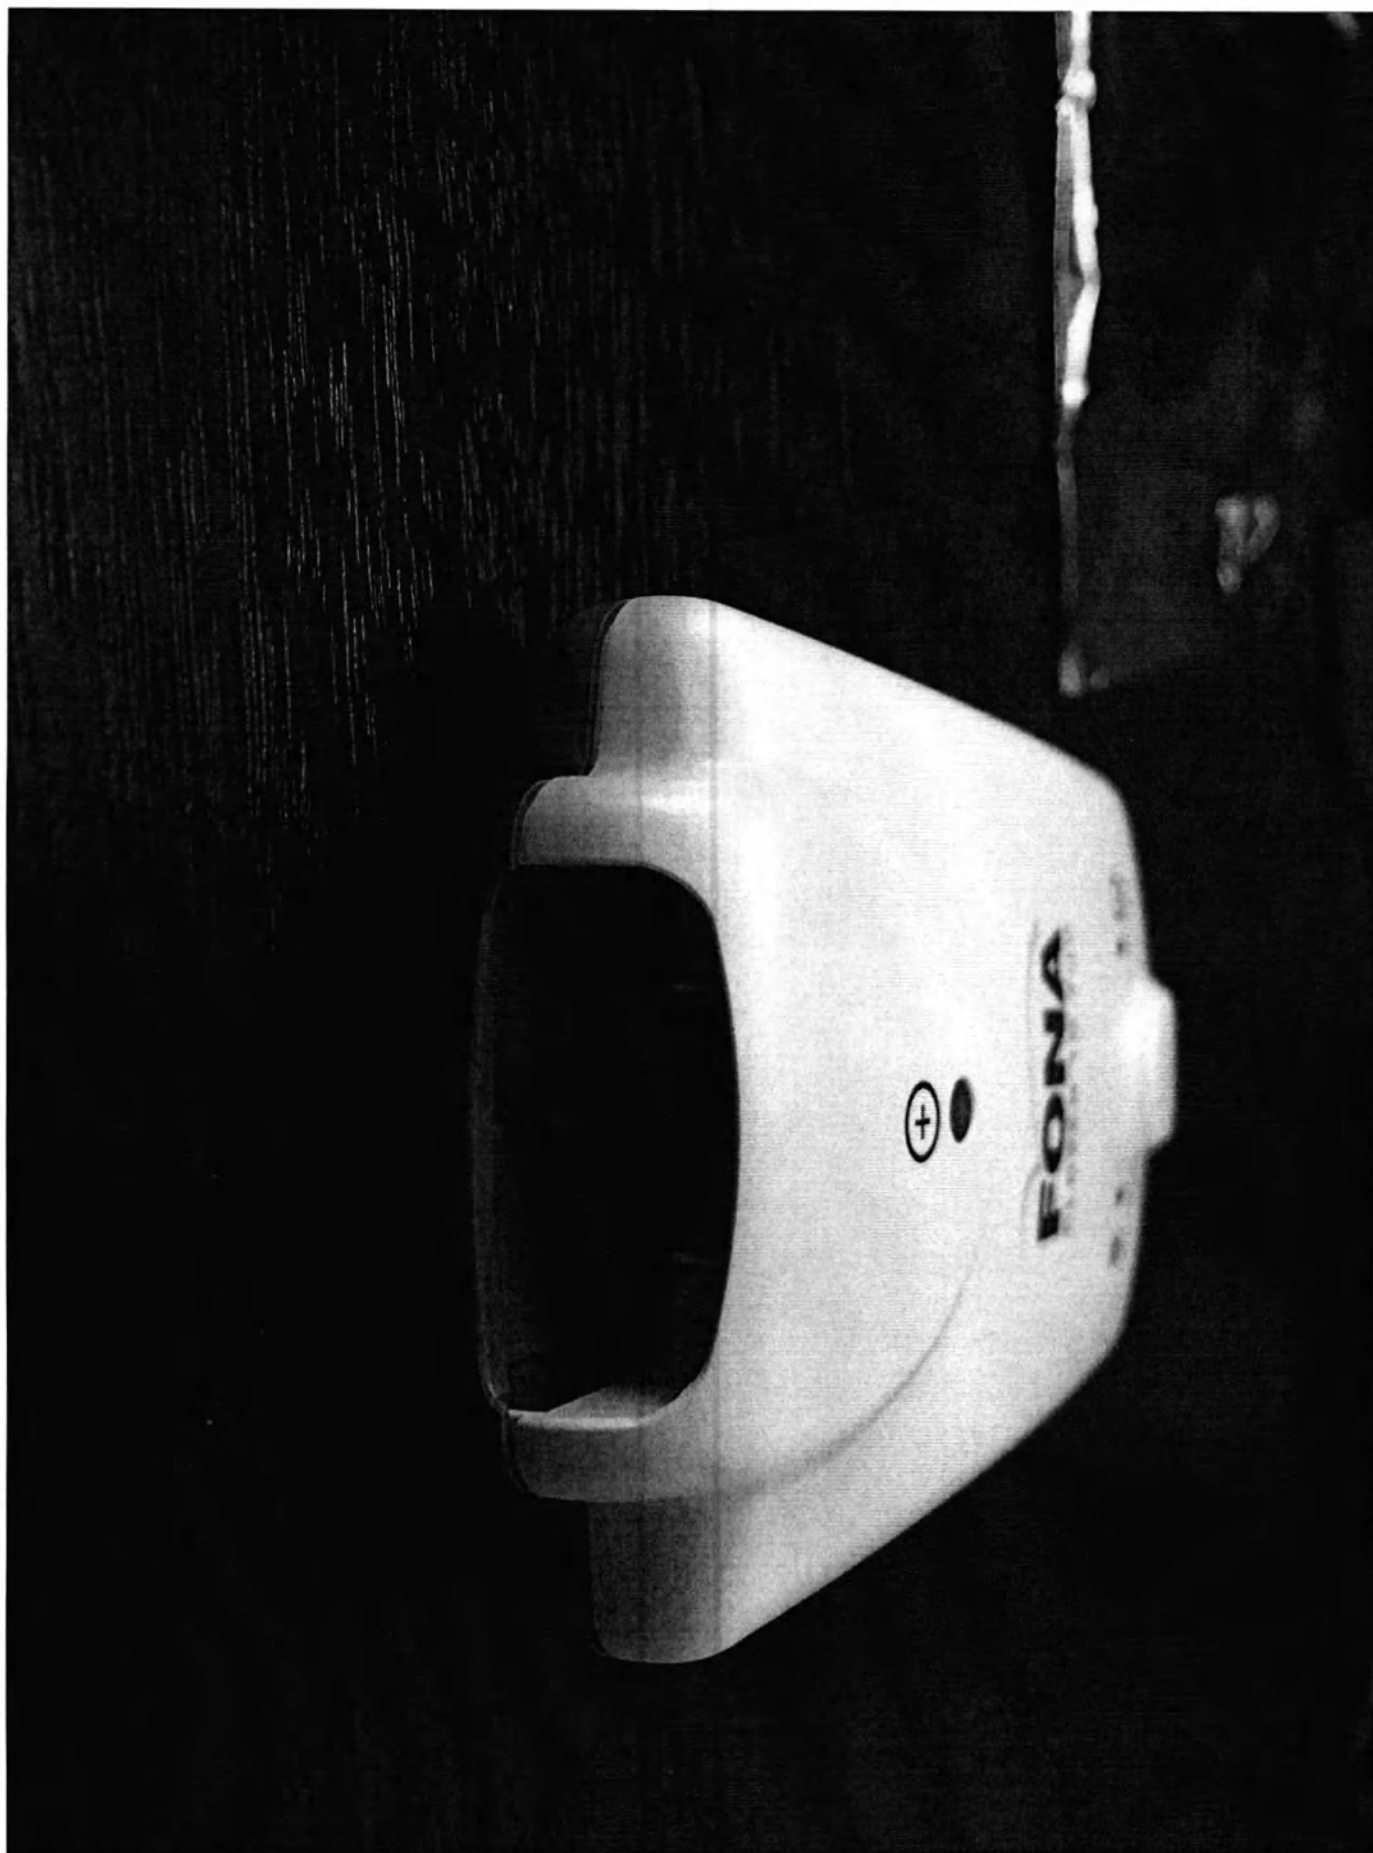



2. Кабель USB A/B B2250150 – 5м.



MFR 2015 LOT#: 20151115

USB A/B CABLE 5M
B2250150

Sirona Dental, Inc.
30-30 47th AVE., L.I.C., N.Y., 11101, U.S.A







ВНИМАНИЕ:
ОБСЛУЖИВАТЬ И
РЕМОНТИРОВАТЬ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
С ПОМОЩЬЮ
СтратоГрей™



3. Настенное крепление для модуля USB B2270135, с крепежом.

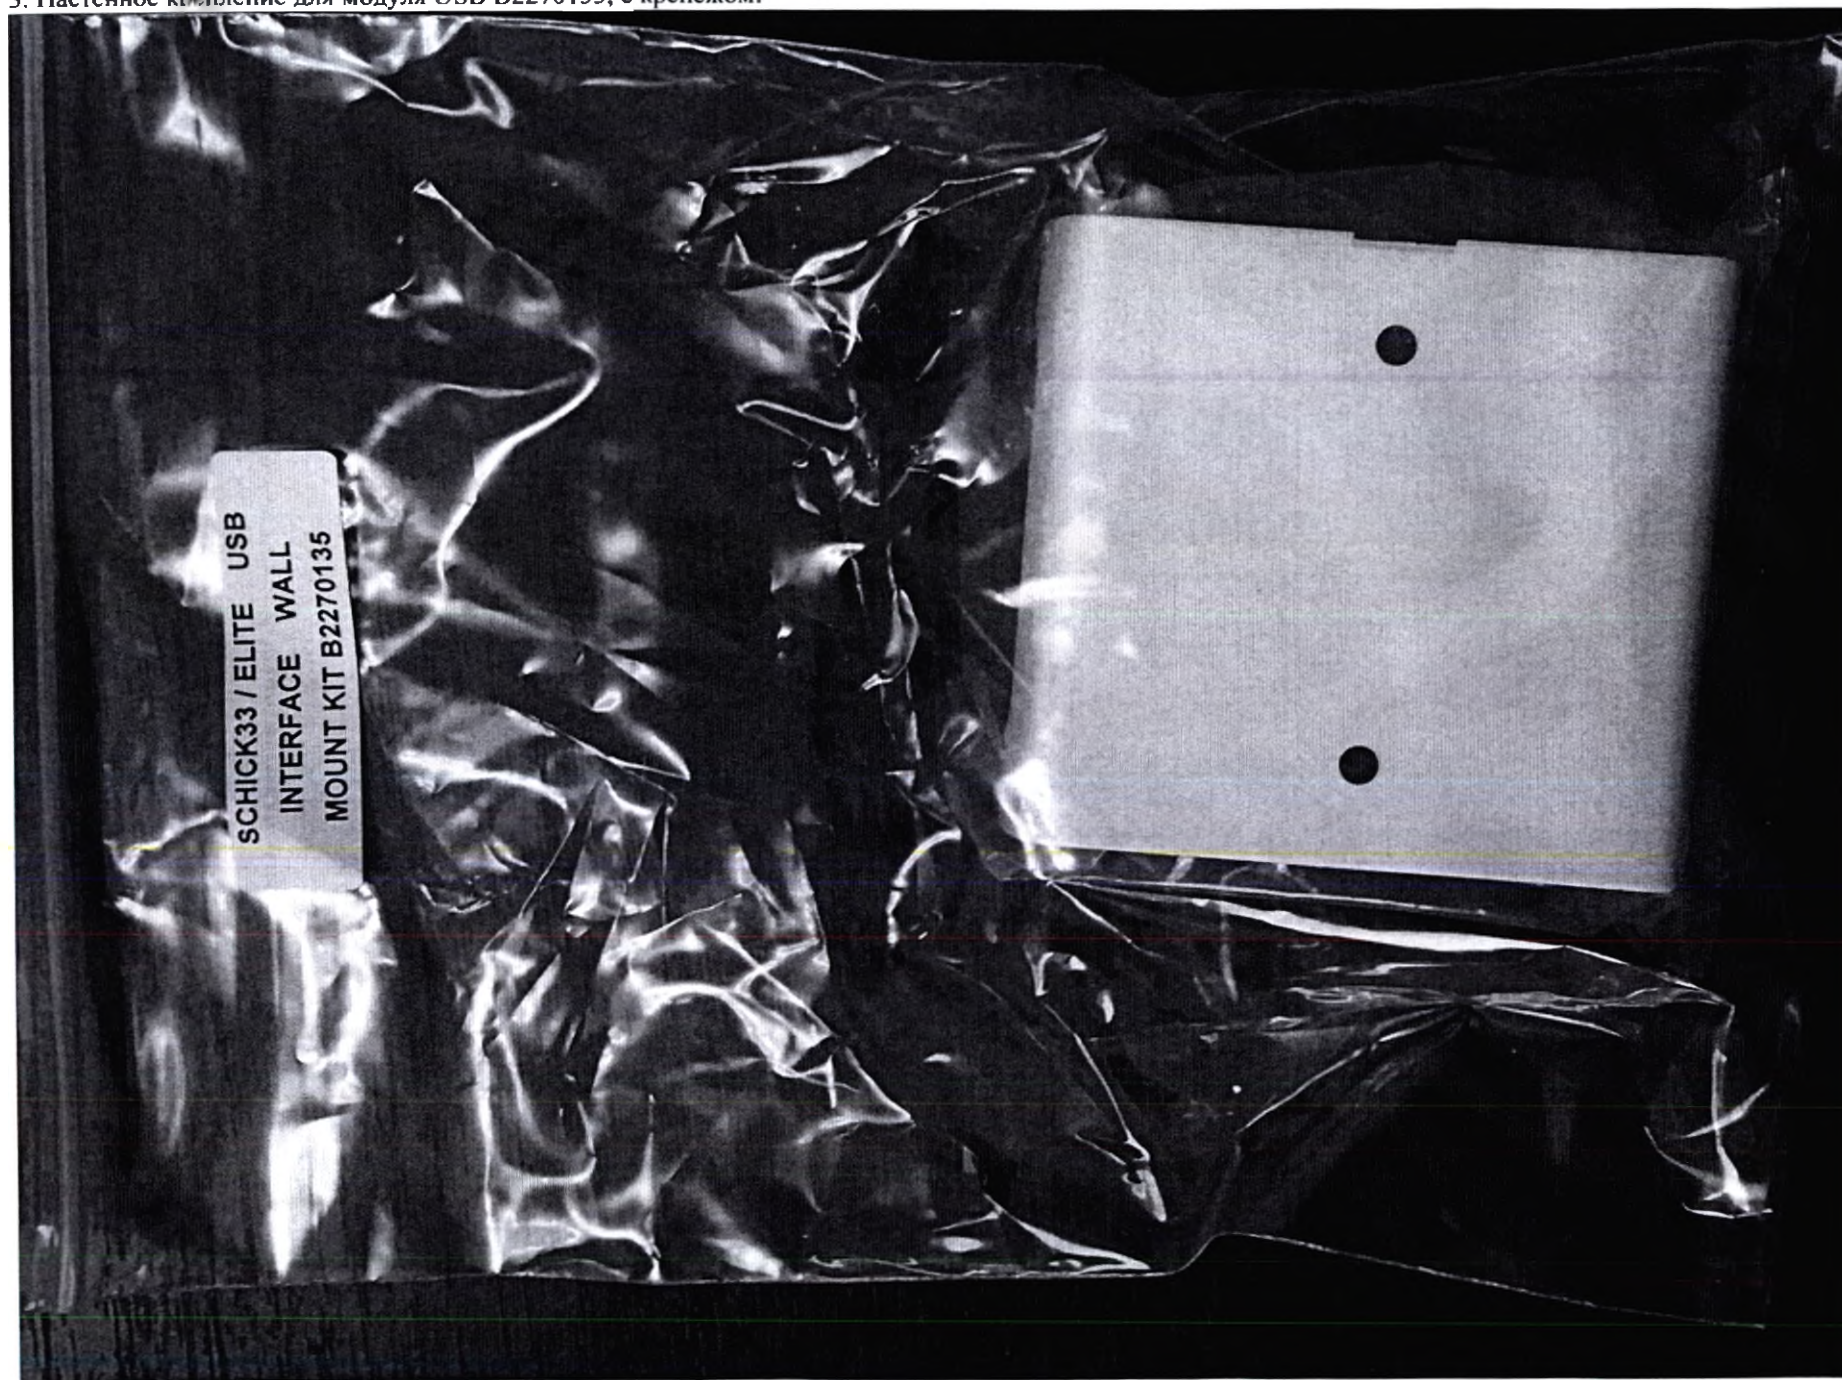







FONA Stellaris / CDRelite Sensor


Quick User Guide - Please Read This First

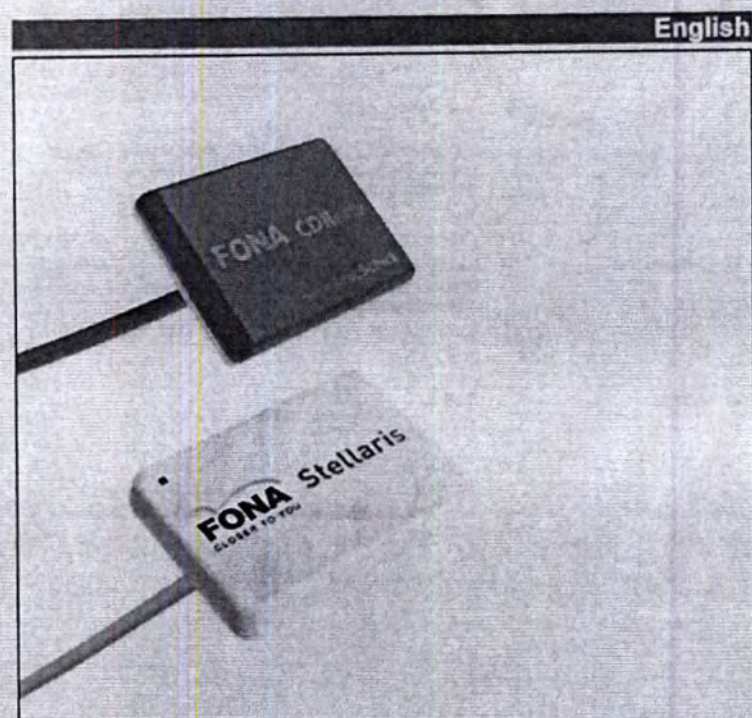


III. Программное обеспечение. 1. Программное обеспечение OrisWin DGSuite, версия 4

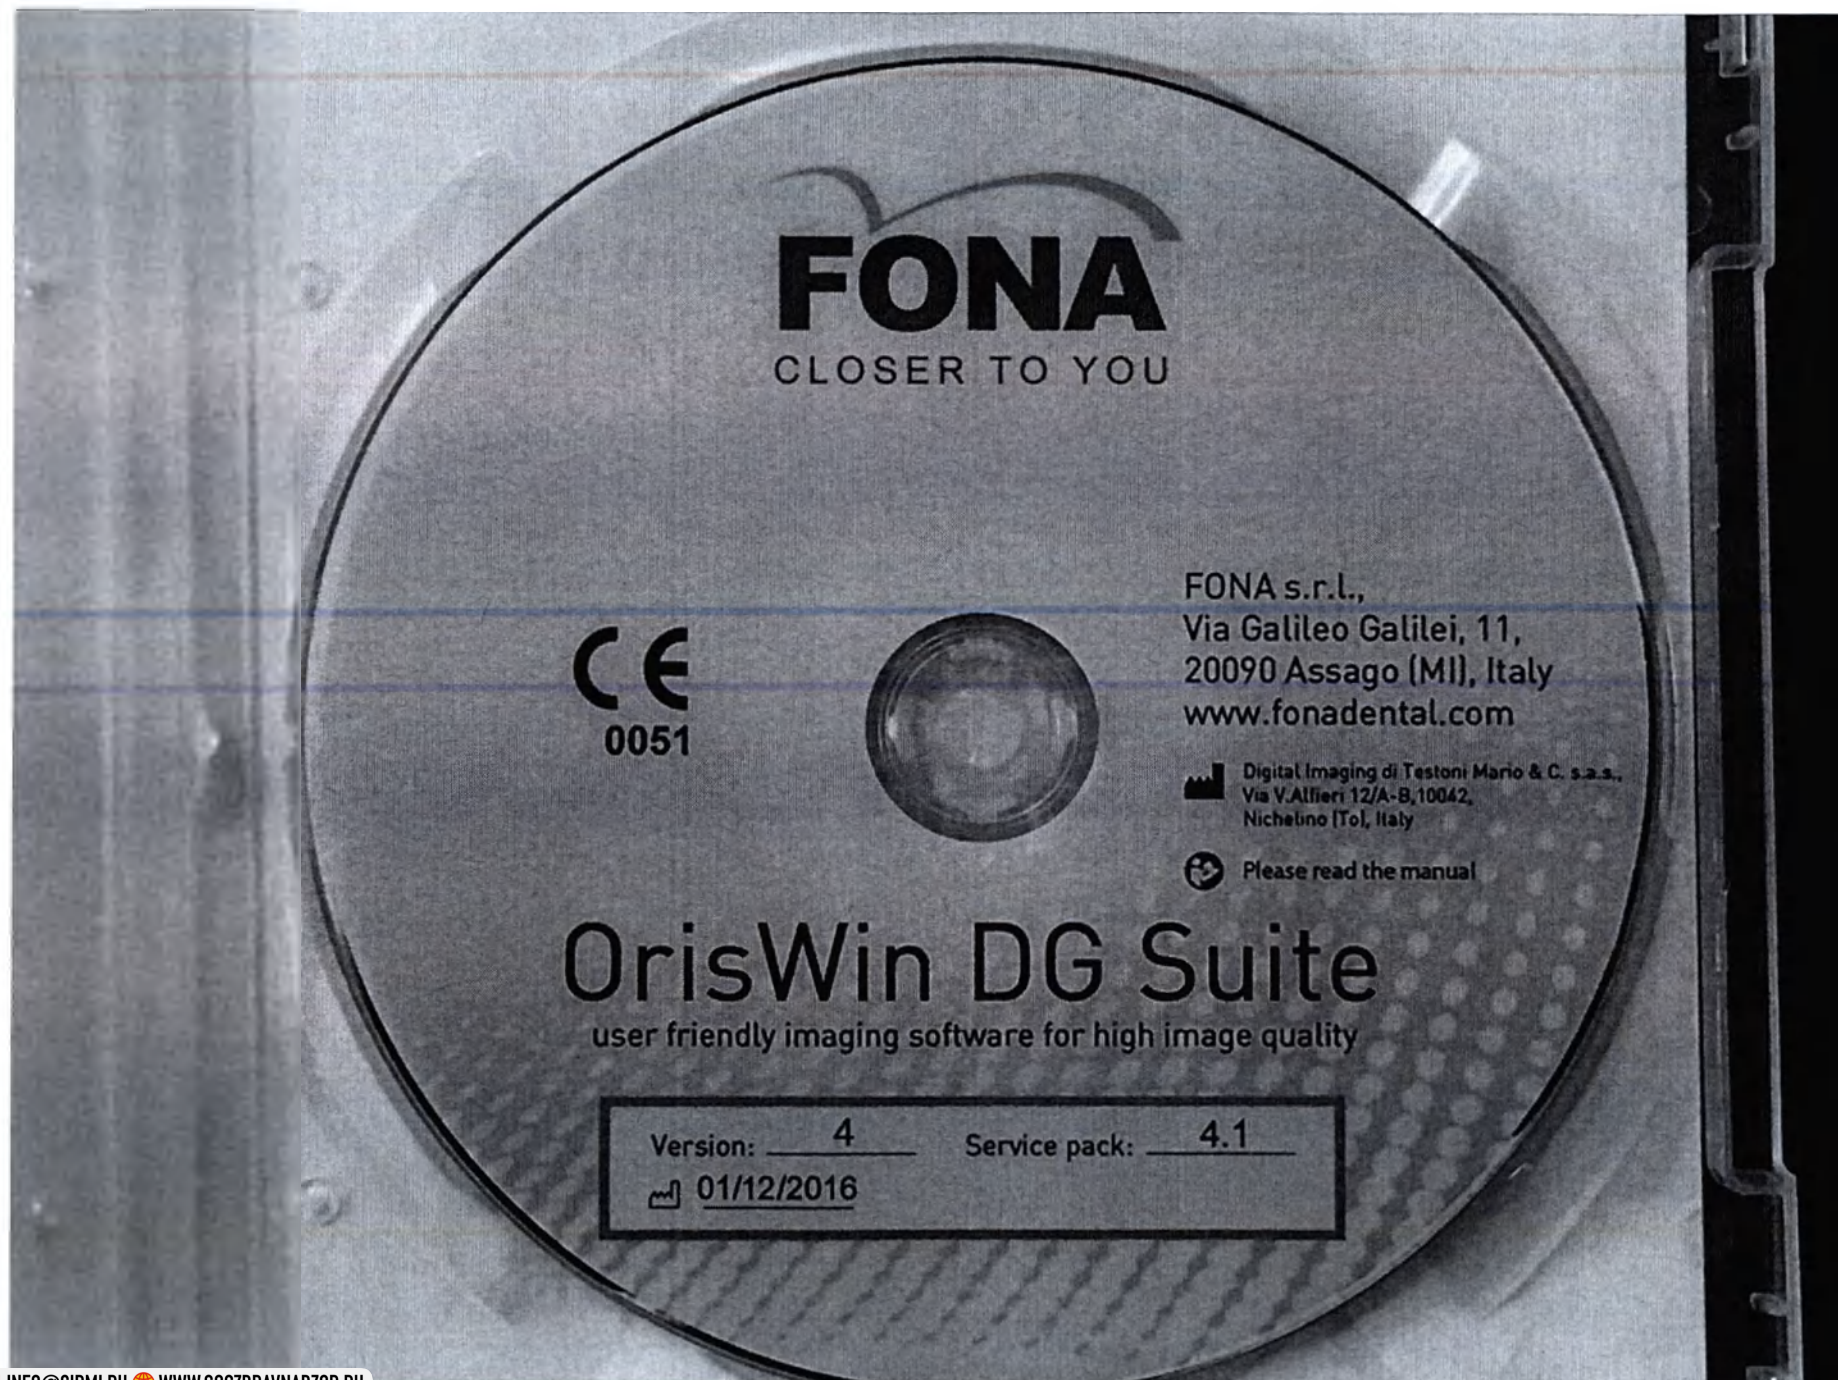



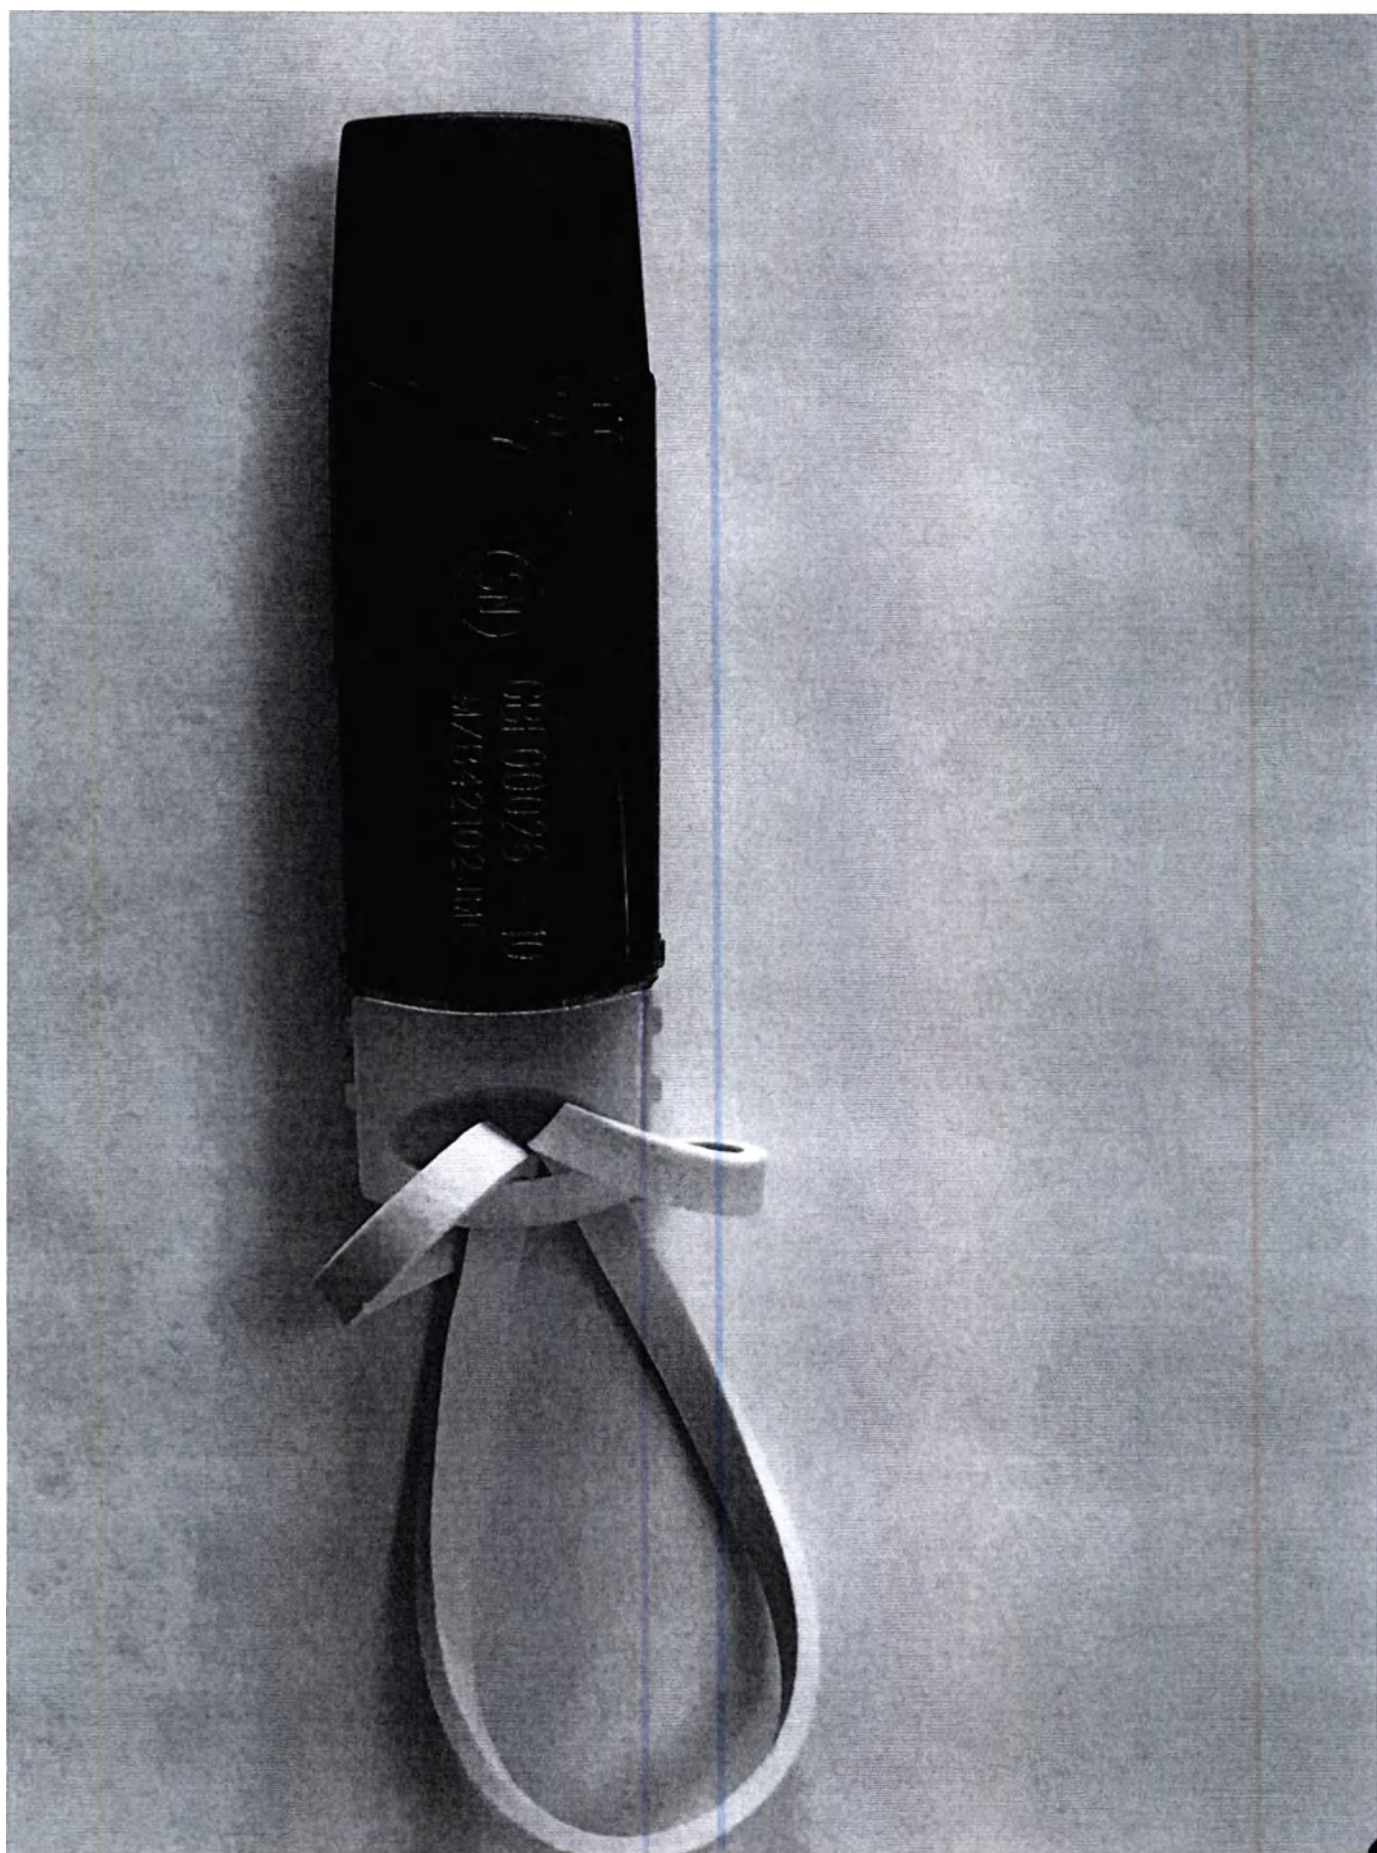



OrisWin DG Suite 4.1

Quick User Guide

English



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
лист (ов)

С.Н. Ширшов