


Фотография медицинского изделия


"Индикатор химический одноразового применения для контроля паровой, воздушной стерилизации ИКПВС-«Медтест» по ТУ 9398-001-53262326-2009"(исполнение Индикатор химический для контроля паровой стерилизации ИКПС-«Медтест»-120/45)



фотография медицинского изделия
"Индикатор химический одноразового применения для контроля паровой, воздушной стерилизации ИКПВС-«Медтест» по ТУ 9398-001-53262326-2009" (исполнение Индикатор химический для контроля паровой стерилизации ИКПС-«Медтест»-132/20)

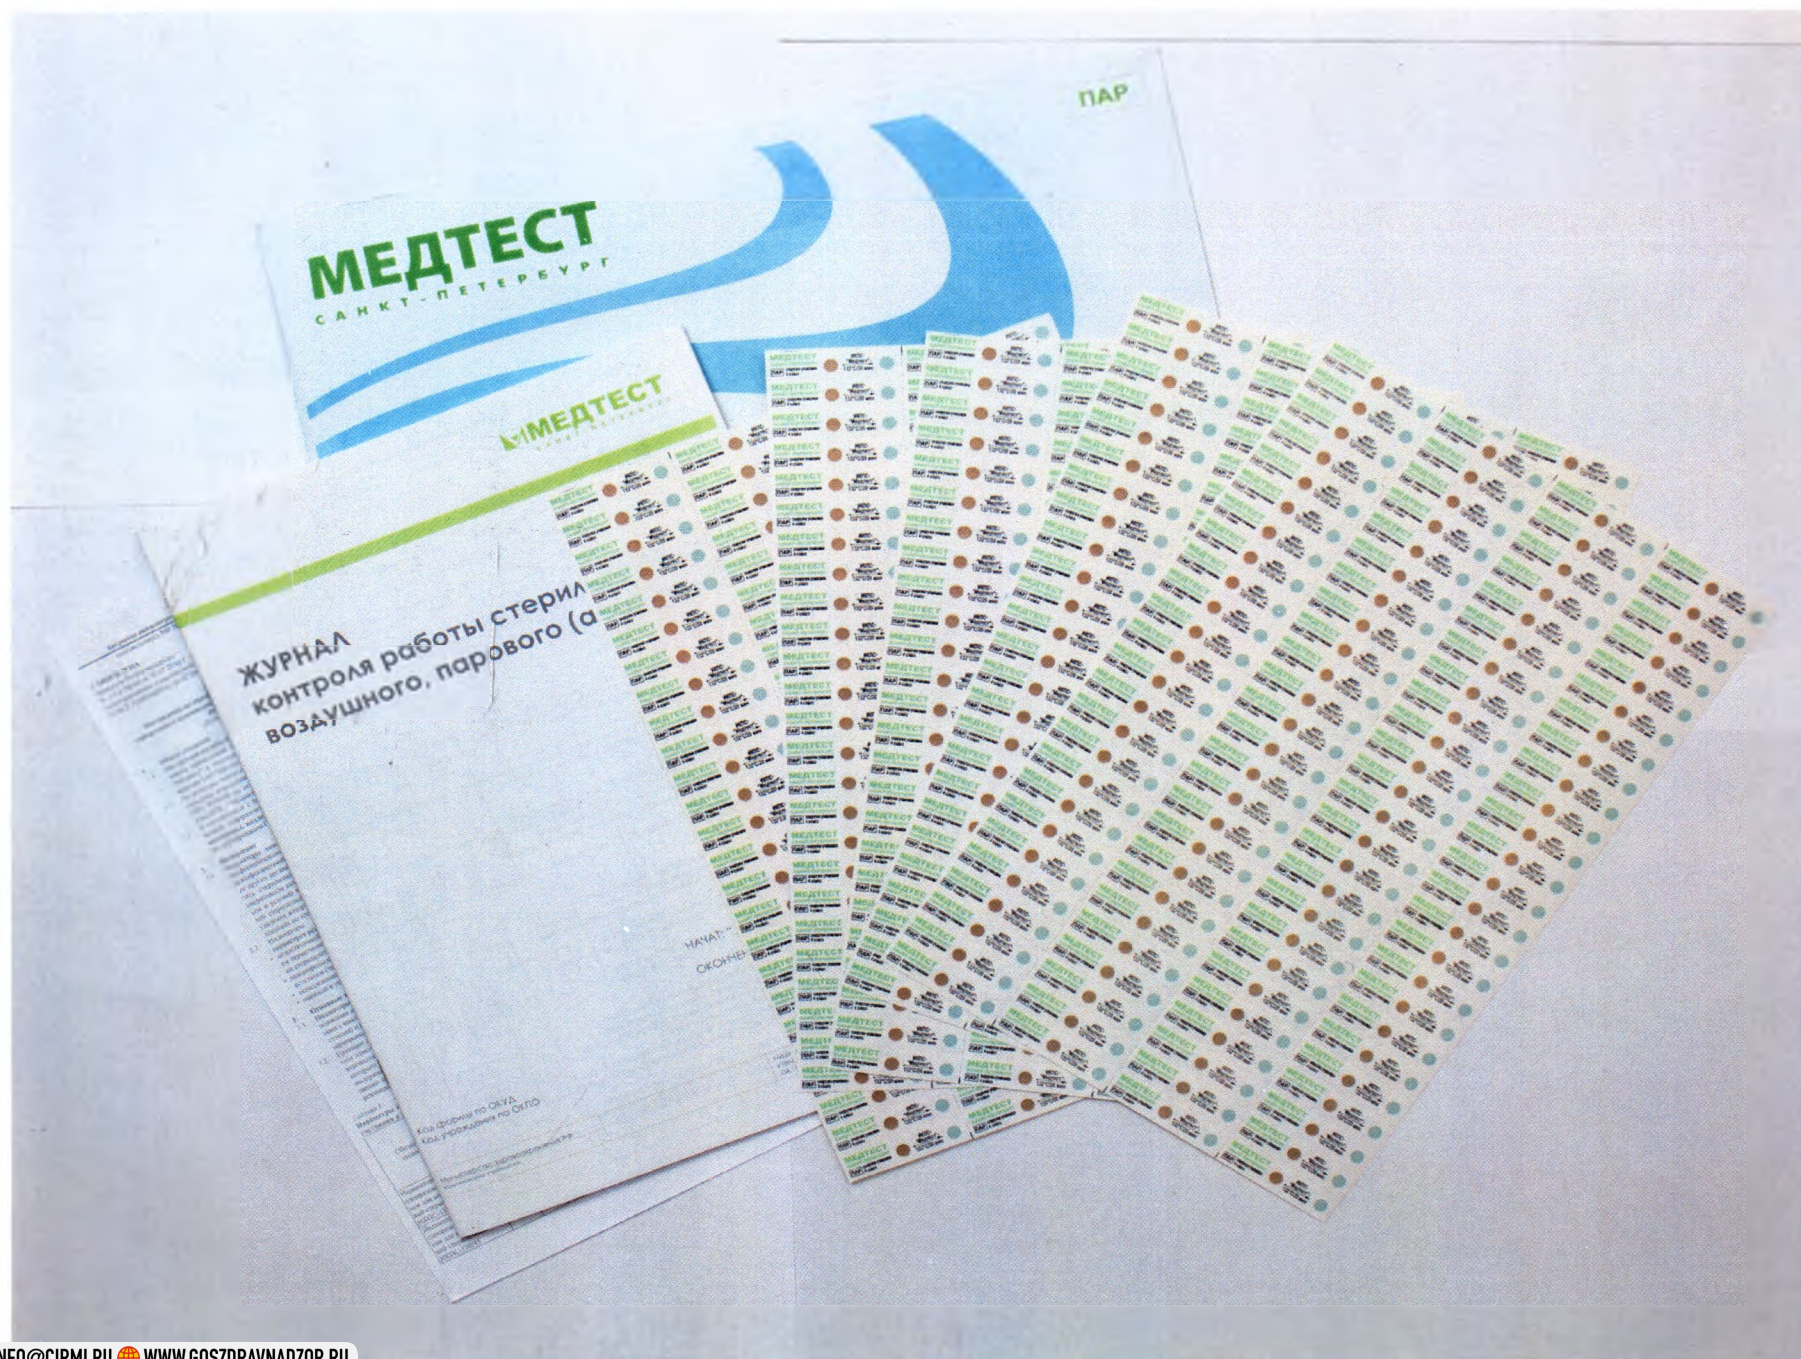

"Индикатор химический одноразового применения для контроля паровой, воздушной стерилизации ИКПВС-«Медтест» по ТУ 9398-001-53262326-2009" (исполнение Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации ИКВС-«Медтест»-180/60)

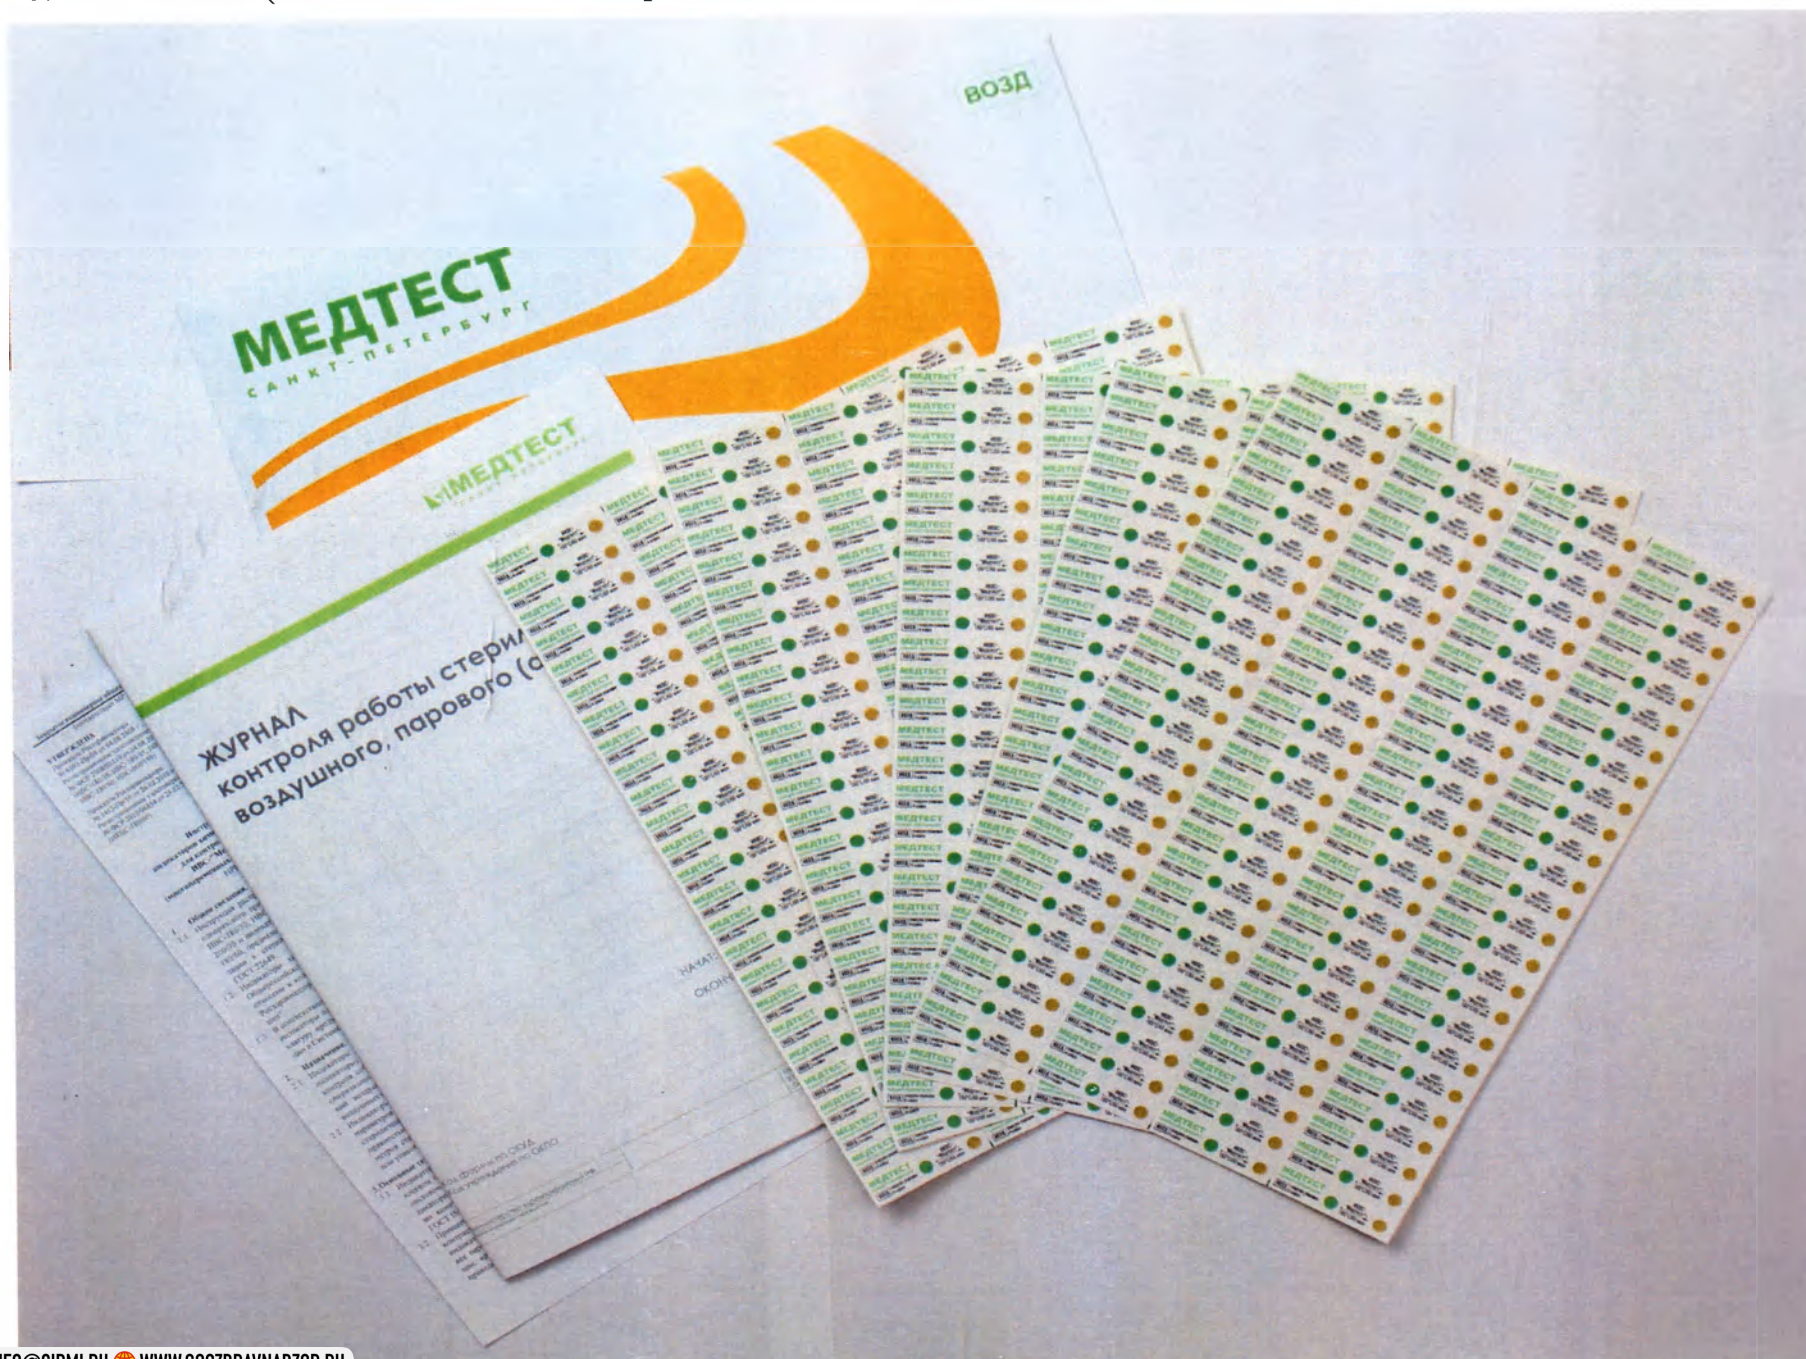

1 пронумеровано и прошнуровано

3 (Три)
Листа/ов

Ген. директор

Р.Г. Котченко

