



Общий вид Укладки санитарной сумки «ФЭСТ» по ТУ 9398-146-10973749-2017



Общий вид Укладки санитарной сумки «ФЭСТ» по ТУ 9398-146-10973749-2017

ПЕРЕЧЕНЬ
вложенной, входящих в «Укладку санитарной сумки «ФЭСТ»
(Приказ Министерства здравоохранения РФ №61н от 08 февраля 2013 г.)

№ п/п	Наименование положений	Кол-во, шт.	№ п/п	Наименование вложений	Кол-во, шт.
1. Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок			5. Прочие медицинские изделия		
1.1	Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см	5 шт.	5.1	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резиновыми или эластичными	5 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см	3 шт.	5.2	Плоскостные для разгрузки повязки по Пастору с абсорбирующим элементом для быстрого разрыва повязки	1 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 5 см	3 шт.	5.3	Сетки или перчатки латексные для ЭКГ	1 шт.
1.4	Жгут кровоостанавливающий материал эластичный	2 шт.	5.4	Покрывало медицинское нестерильное, сложенное не менее 4	20 шт.
1.5	Давильная шарикоподшипник не менее 1 м см х 2 см	5 шт.	5.5	Покрывало стерильное из нетканого материала	1 шт.
1.6	Лейкопластырь рулонный не менее 3 см х 3 м	2 шт.	5.6	Синтетический антисептический материал из нетканого материала	20 шт.
1.7	Пакет перевязочный медицинский стерильный	5 шт.	5.7	Салфетка из нетканого материала с дезинфицирующим	3 шт.
1.8	Салфетка антисептическая из нетканого материала с дезинфицирующим не менее 12,5 см х 11,3 см	5 шт.	6. Прочие средства		
1.9	Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 15 см х 15 см №19	2 шт.	6.1	Антисептик бумажный с спиртом не менее 38 мм	10 шт.
1.10	Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 45 см х 25 см №5	1 шт.	6.2	Бинт бумажный белый не менее 30 см, шириной не менее 47	1 шт.
1.11	Средство перевязочное гемостатическое для остановки кровотечения с антибактериальным и обезболивающим действием не менее 20 см х 24 см	3 шт.	6.3	Карандаш	1 шт.
1.12	Средство перевязочное гемостатическое для остановки кровотечения с антибактериальным и обезболивающим действием не менее 20 см х 24 см	3 шт.	6.4	Маркер перманентный черного цвета	1 шт.
1.13	Средство перевязочное гемостатическое для остановки кровотечения с антибактериальным и обезболивающим действием не менее 20 см х 24 см	3 шт.	6.5	Мешок полиамидный с застежкой не менее 20 см х 25 см	5 шт.
2. Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации			6.6	Резинчатый материал для изготовления перчаток	1 шт.
2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-в-рот» с клапаном	2 шт.	6.7	Санитарная сумка	1 шт.
3. Медицинские изделия для проведения иммобилизации					
3.1	Повязка разгрузочная для верхней конечности	4 шт.			
4. Медицинские изделия для местного охлаждения					
4.1	Пакет гипотермический	3 шт.			

*Большинство изделий ФЭСТ (по результатам маркетинговых исследований от 01.07.2014 г.)

С вопросами обращайтесь по телефонам:

+7(4942) 49-32-99, 49-32-43, 49-32-05

Примечания:

- Укладка санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны (далее - укладчик) проводится в соответствии с требованиями, утвержденными в установленном порядке на территории Российской Федерации.
- Медицинские изделия, входящие в состав, должны соответствовать требованиям, указанным в перечне, на подкладке заменены медицинскими изделиями других производителей.
- По истечении срока годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования учредителю необходимо пополнить.
- Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями.
- Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиамидный с застежкой Б.5.5 в соответствии с требованиями.
- Количество медицинских изделий учтено в соответствии с настоящими требованиями, рассчитано на проведение мероприятий по оказанию первой помощи 20 пострадавшим.

Производитель: ООО "Президент" "ФЭСТ"
Россия, 154025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Телефакс: (4942) 49-32-99, 49-32-43, факс: (4942) 49-32-05
Место производства: Россия, 154019,
г. Кострома, ул. Шереметьева, д. 28




УКЛАДКА
санитарной сумки «ФЭСТ»
ТУ 9398-146-10973749-2017
РУ № Р311 2014/2156




Партия № / ОКК 237/06
Уникальный 20.07.2017
Годен до 06.2019

Общий вид Укладки санитарной сумки «ФЭСТ» по ТУ 9398-146-10973749-2017


«ФЭСТ» по ТУ 9398–146–10973749–2017

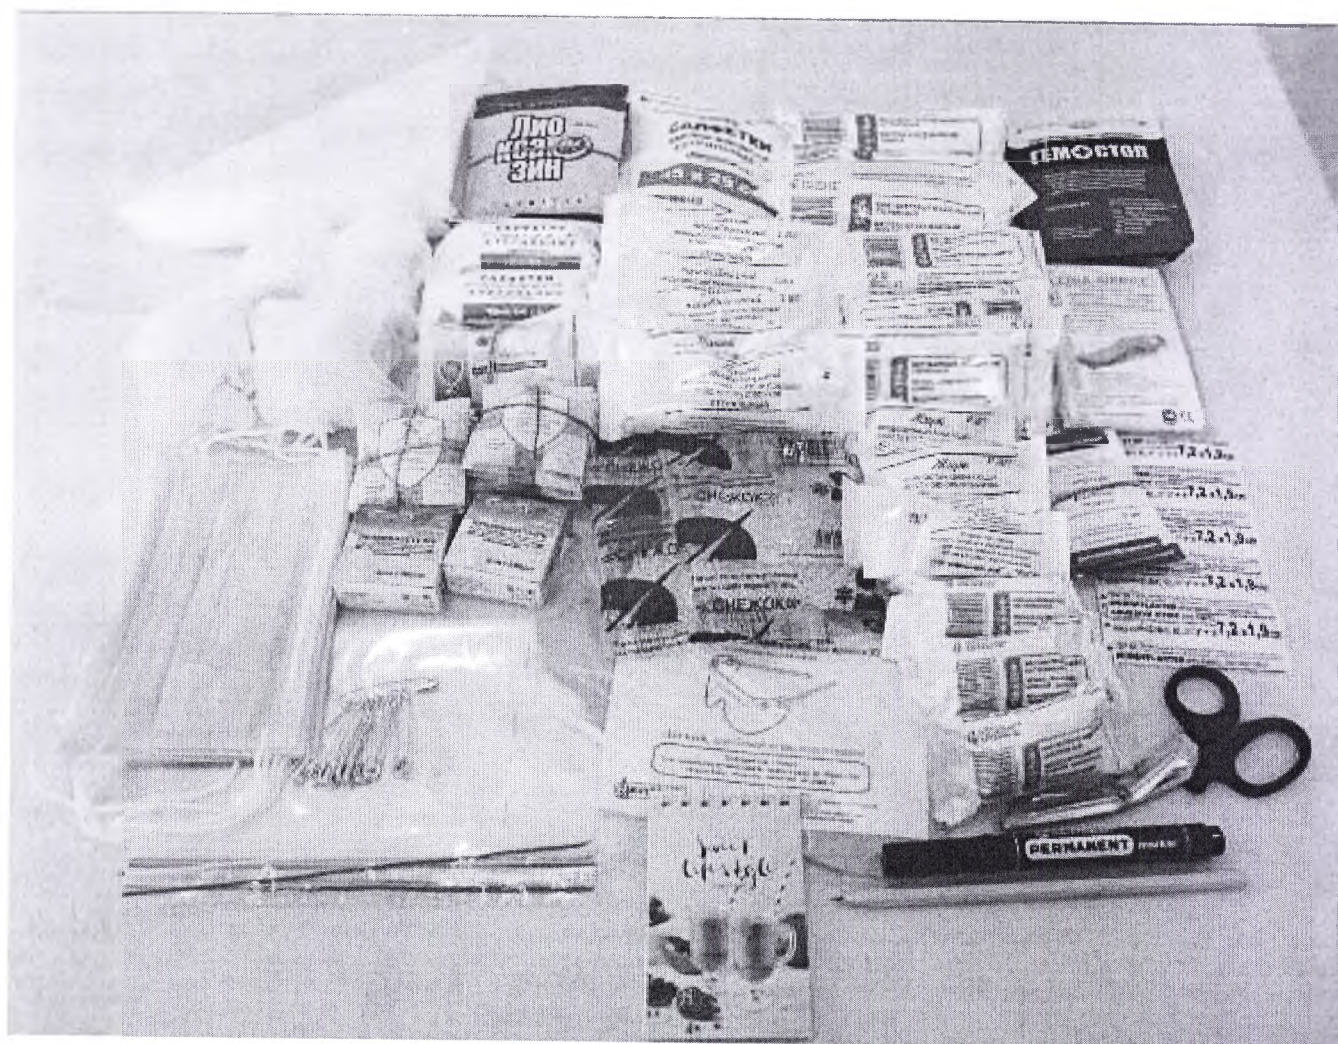


Общий вид вложений, входящих в укладку санитарной сумки «ФЭСТ»

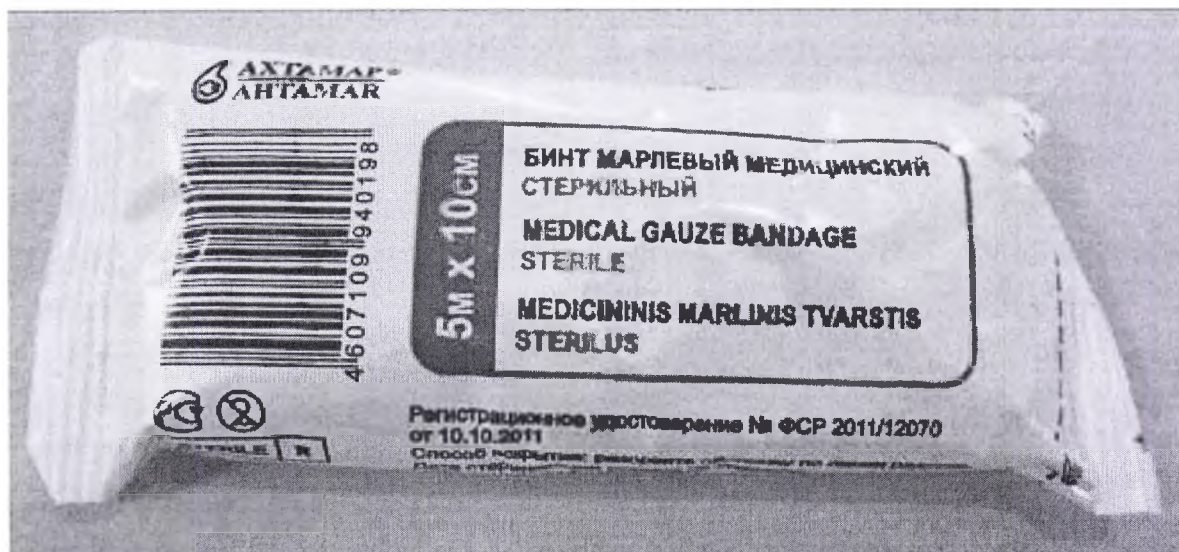

Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

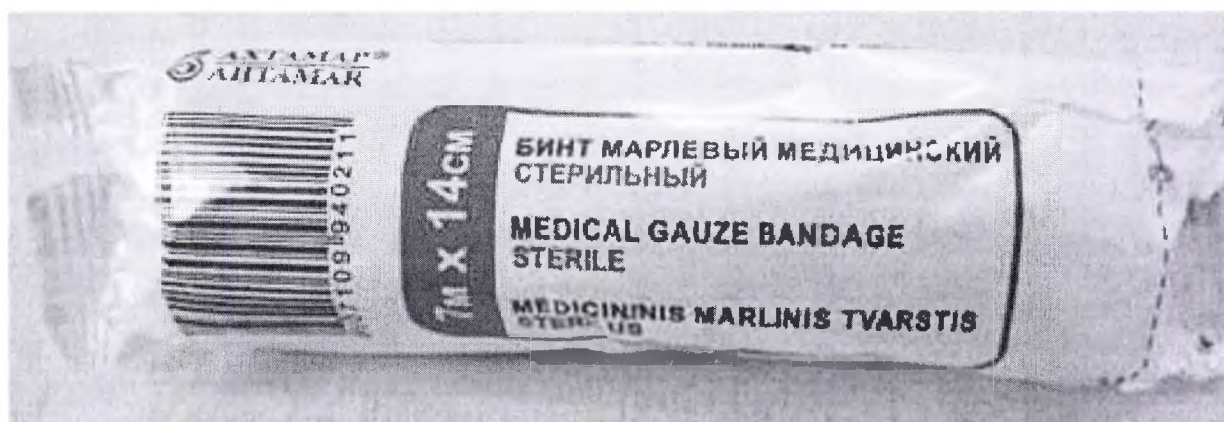

Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

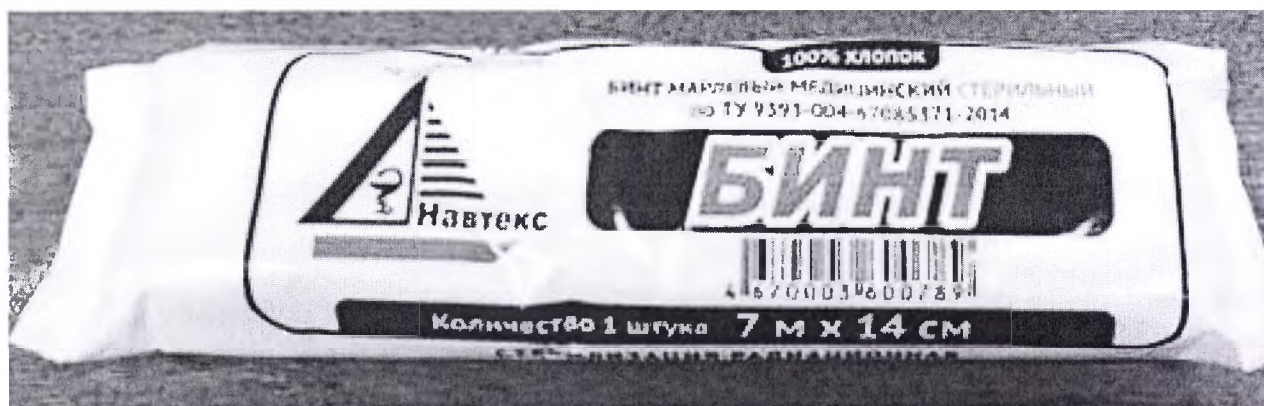

Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
РУ № РЗН 2015/2558, ООО ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
 РУ № РЗН 2015/2558, ООО ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
 РУ № РЗН 2015/2552, ООО ХБК «Навтекс», Россия




Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
 РУ № РЗН 2015/2552, ООО ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
 РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
 РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия

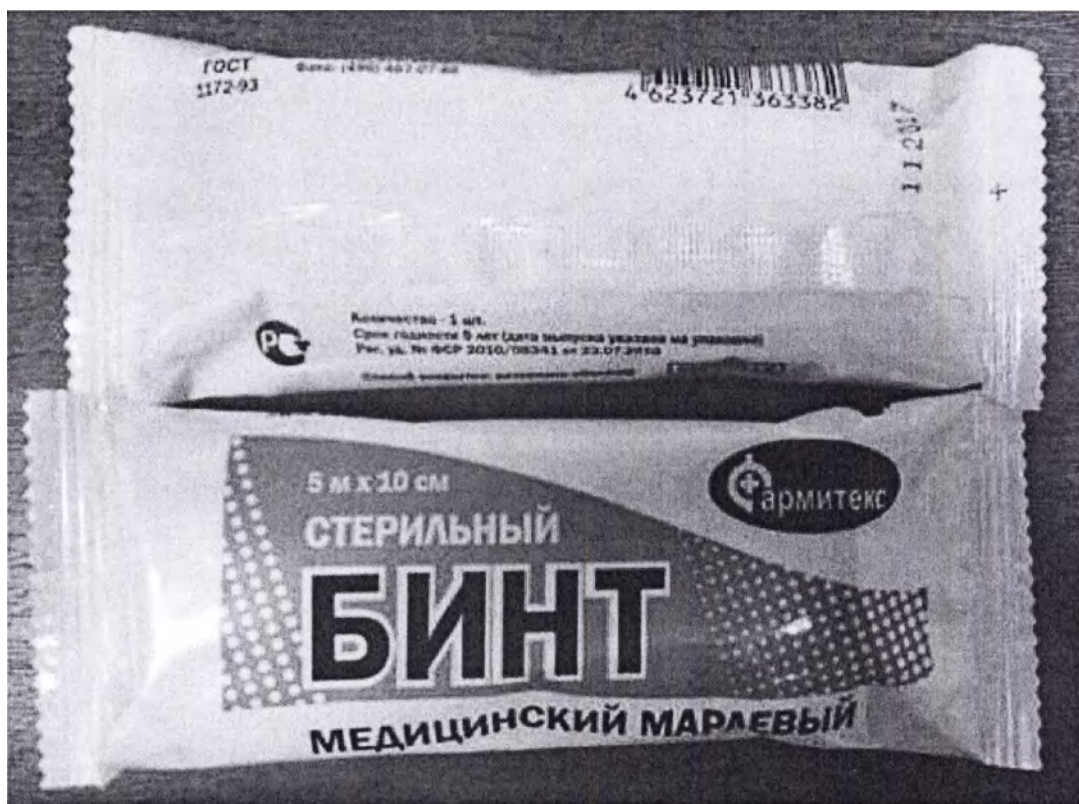

Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см,
 РУ № ФСП 2010/08341, ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия




Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см,
 РУ № ФСП 2010/08341, ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
 РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
 РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия

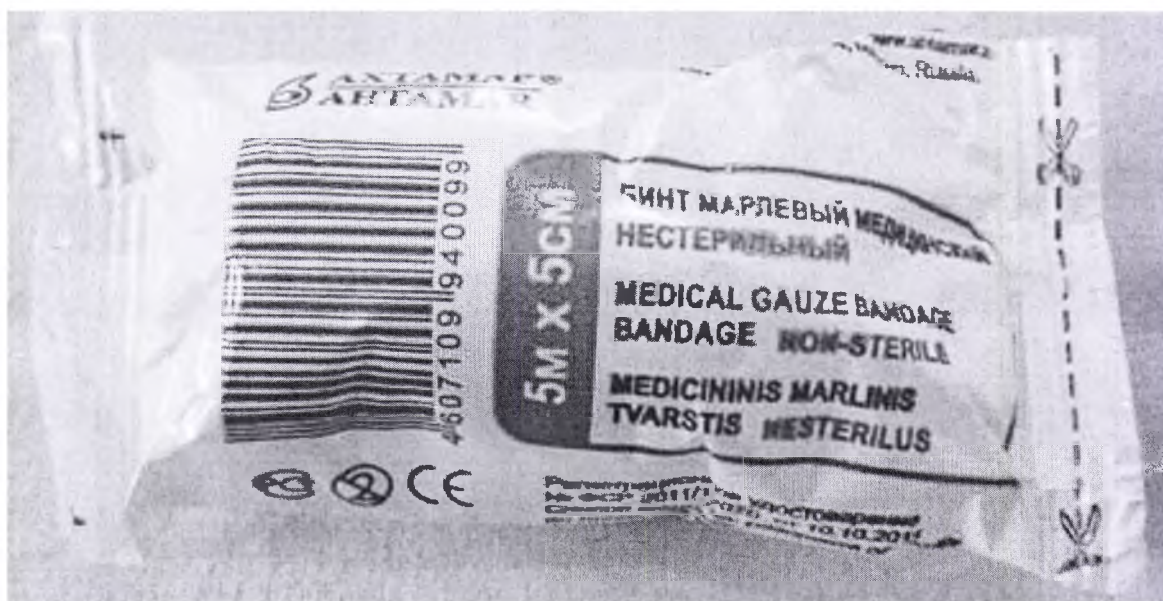

Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
 РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
 РУ № РЗН 2015/2557, ООО «ХБК «Навтекс», Россия






Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
 РУ № РЗН 2015/2555, ООО «ХБК «Навтекс», Россия




Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
 РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия




Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
 РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия

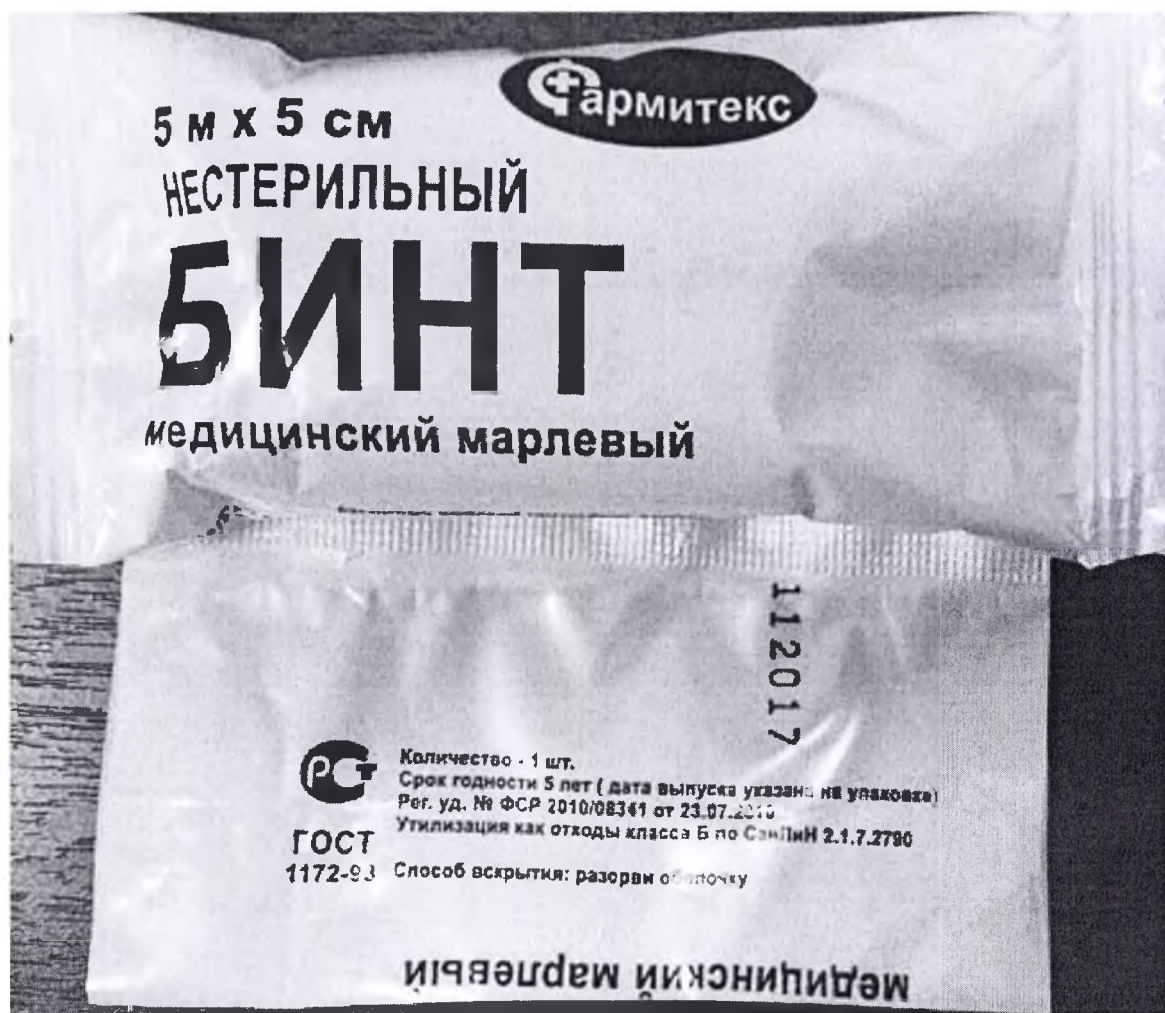

Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
 РУ № ФСР 2010/08341 ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия

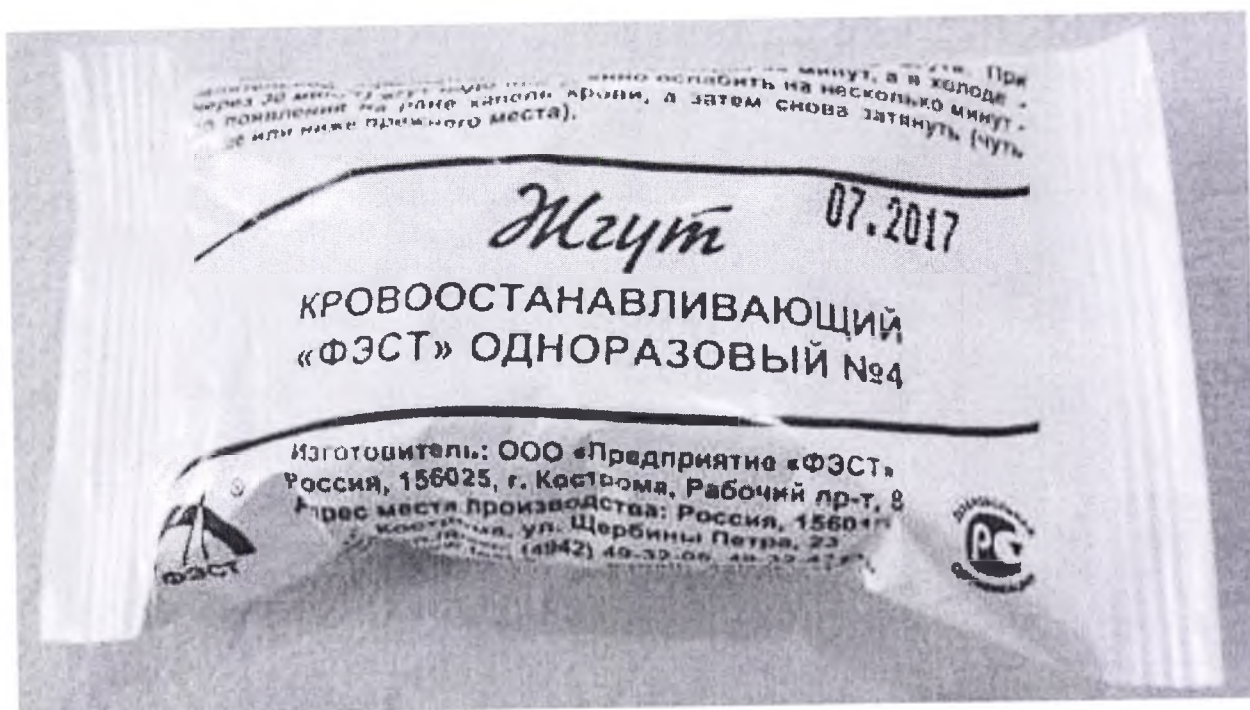

Жгут кровоостанавливающий
РУ № ФСР 2008/03126 ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

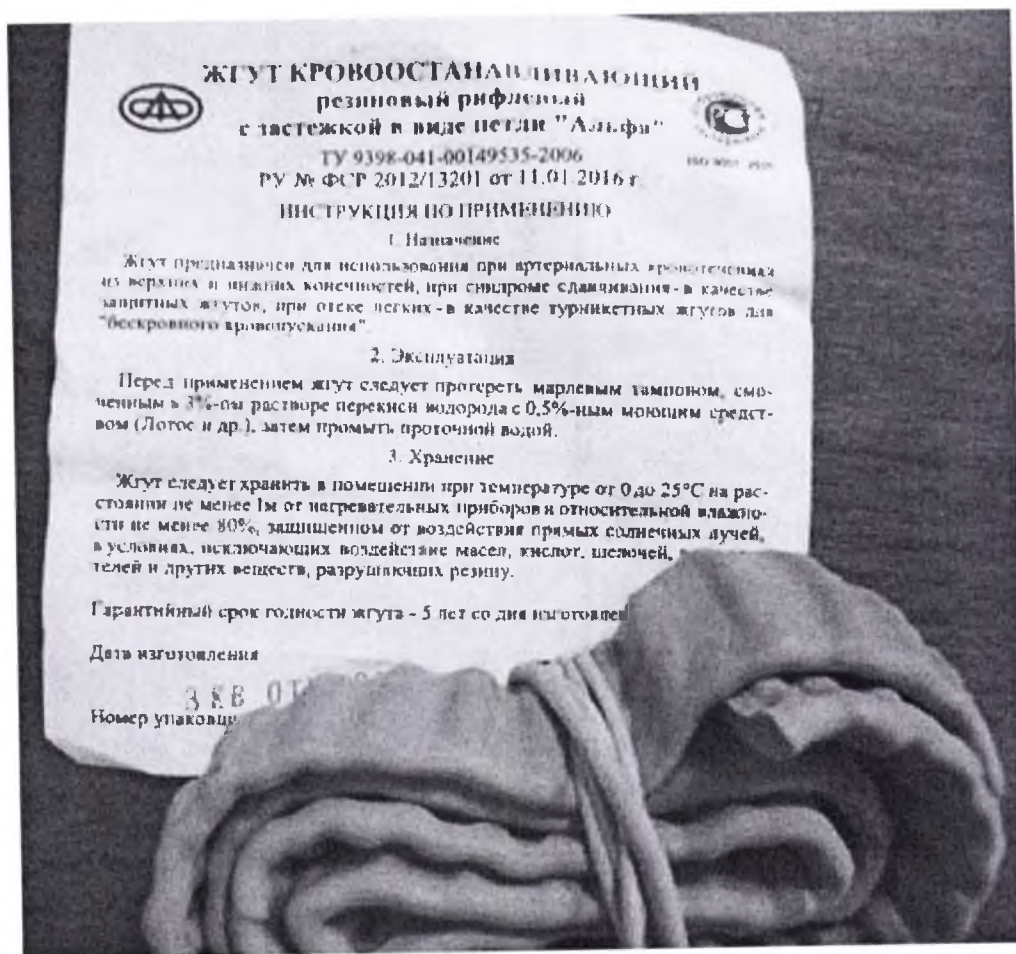



Жгут кровоостанавливающий
РУ № ФСР 2012/13201, ООО «Объединение Альфапластик», Россия




Жгут кровоостанавливающий
 РУ № ФСТ 2007/00032, ООО «Объединение Альфапластик», Россия



Жгут кровоостанавливающий
 РУ № ФСР 2010/07432, ООО НПФ «Мирал», Россия

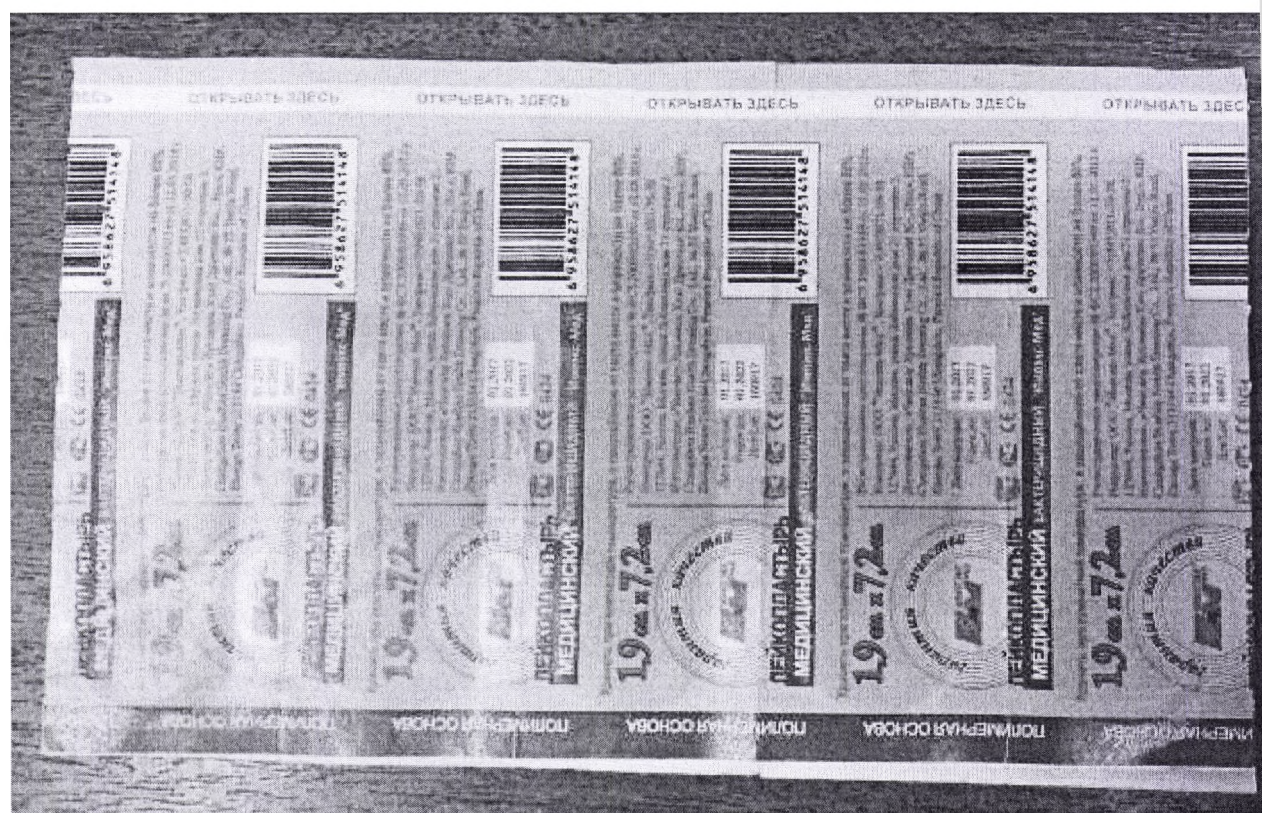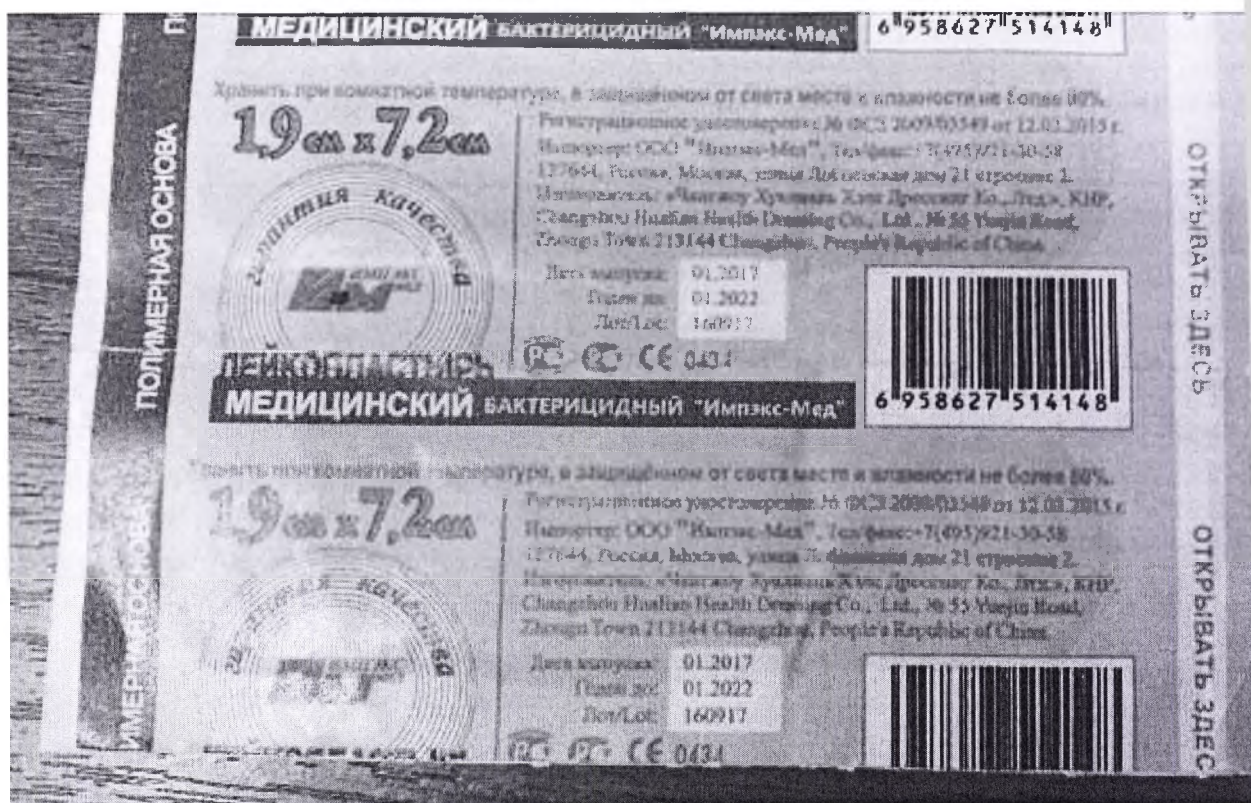

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см
 РУ № ФСЗ 2009/03549, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР

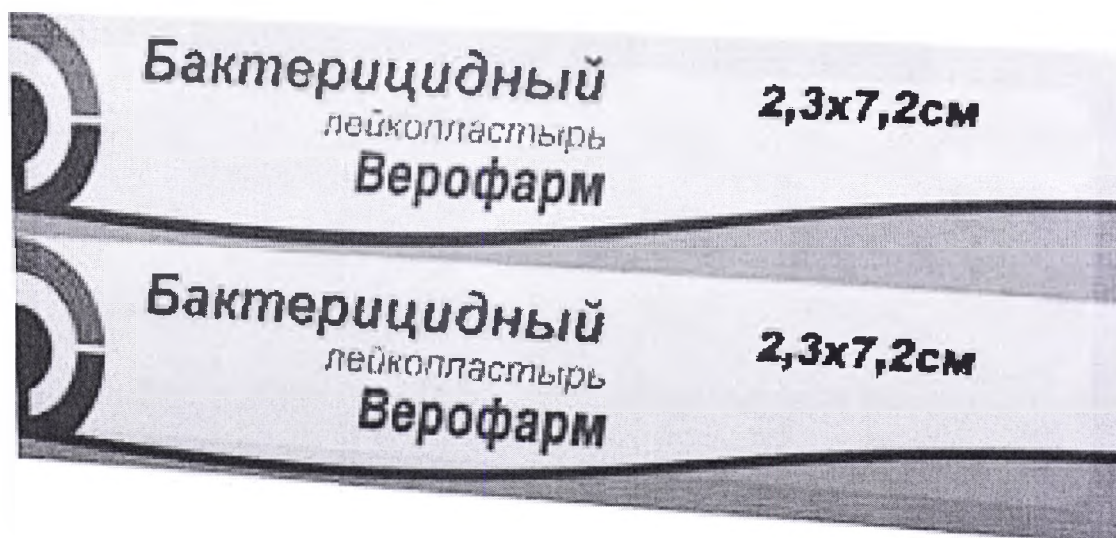

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см х 7,2см

РУ № ФСР 2008/03213, АО «ВЕРОФАРМ», Россия




Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см х 7,2см


РУ № ФСЗ 2010/06666, ООО АУП «САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см

РУ № РЗН 2014/1599, ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь

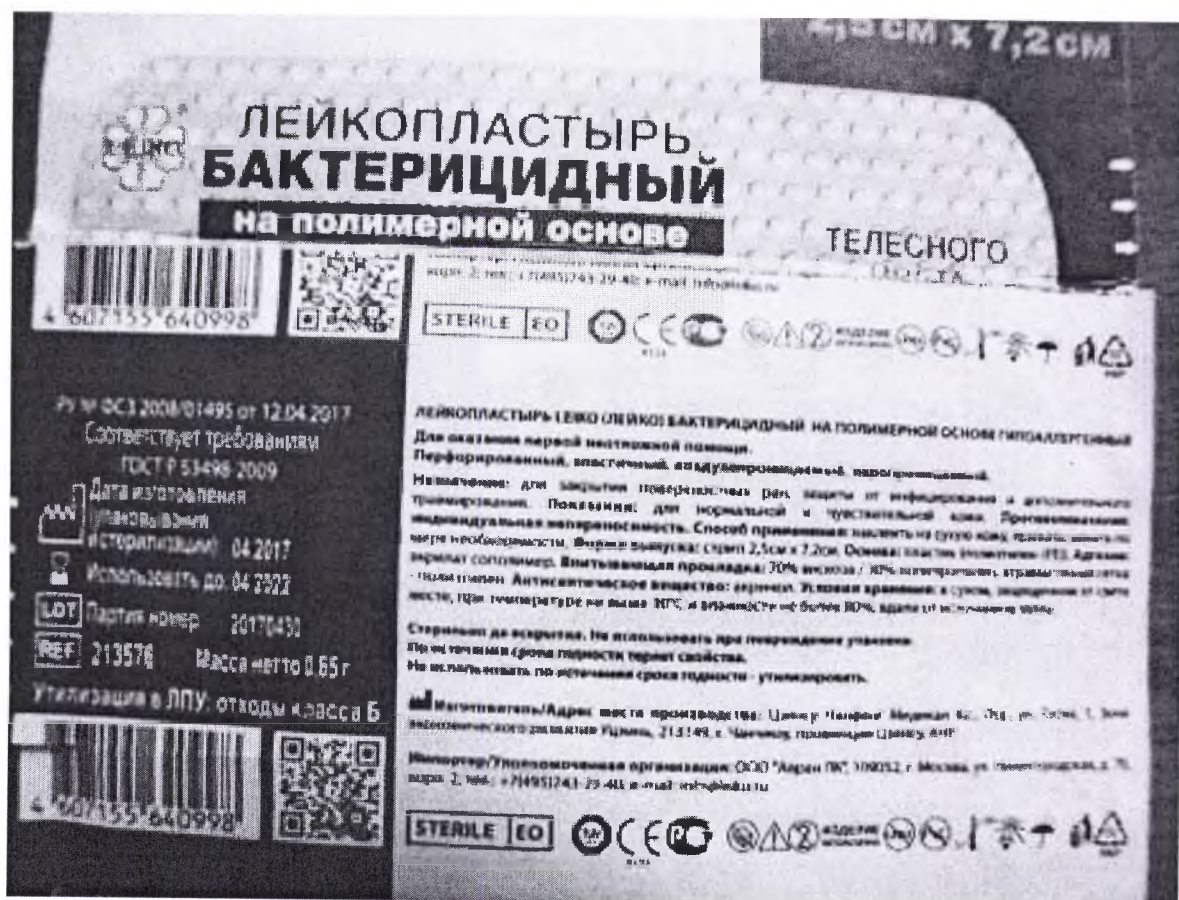

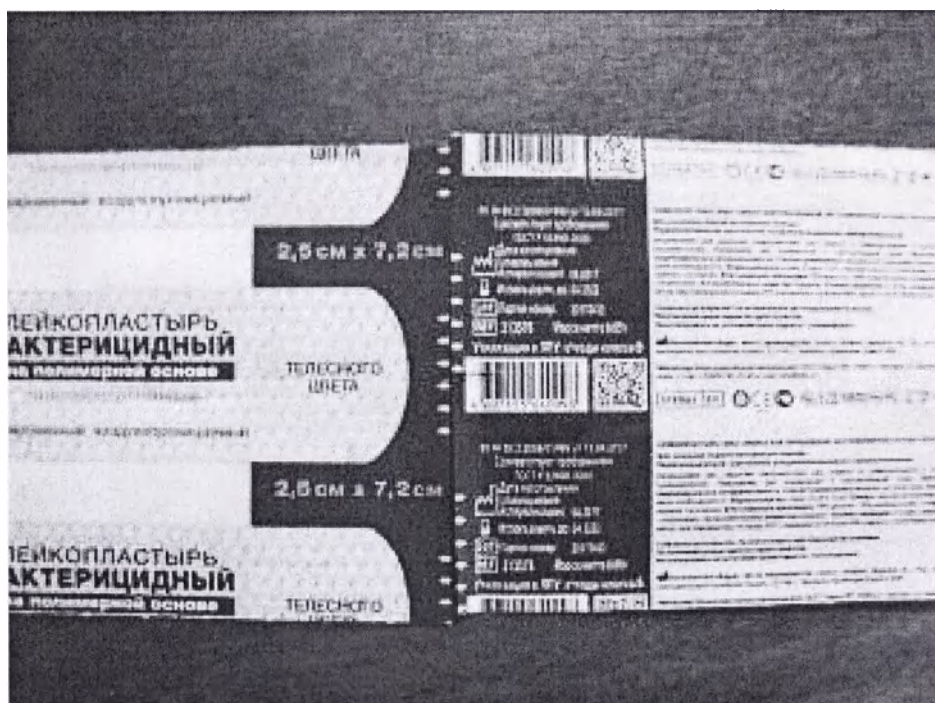

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см
 РУ № ФСЗ 2008/01495, «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко.», Лтд




Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см
 РУ № ФСЗ 2008/01958, «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания



Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см х 5 м

РУ № ФСЗ 2008/01959, «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

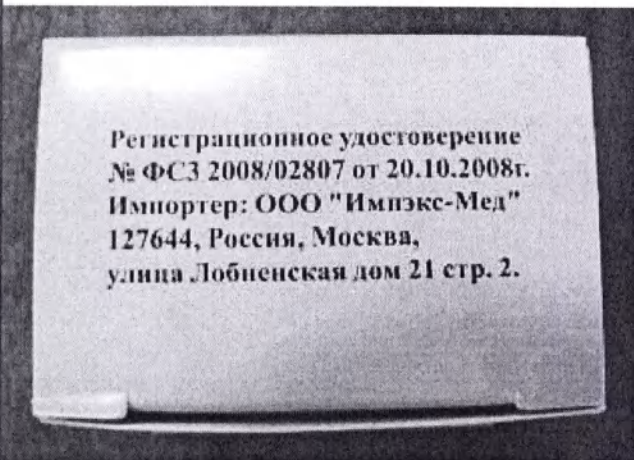

Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см х 5 м

РУ № ФСЗ 2008/02807, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 5 м

РУ № ФСЗ 2008/02807, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 5 м

РУ № ФСЗ 2008/01442, «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко.», Лтд., КНР




Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 5 м

РУ № ФСР 2009/05363, АО «ВЕРОФАРМ», Россия



Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 5 м

РУ № ФСЗ 2010/07988, «ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.», Китай

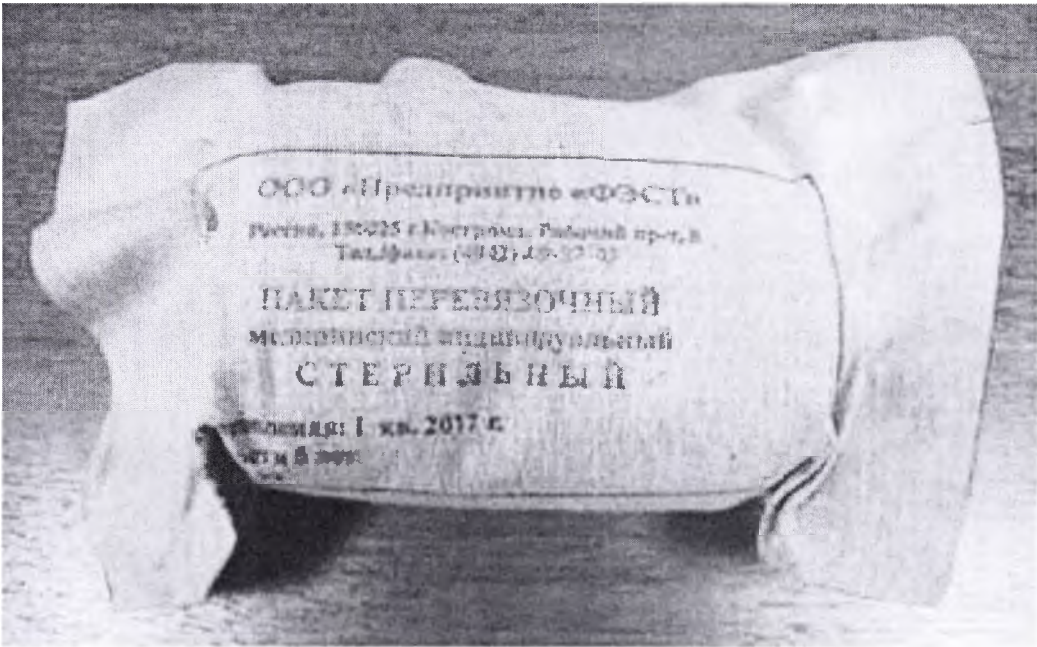

Пакет перевязочный стерильный

РУ № ФСР 2009/05126, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия




Пакет перевязочный стерильный

РУ № ФСР 2008/03791, ООО «ИНГАКАМФ», Россия




Пакет перевязочный стерильный

РУ № ФСР 2010/07445, ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия

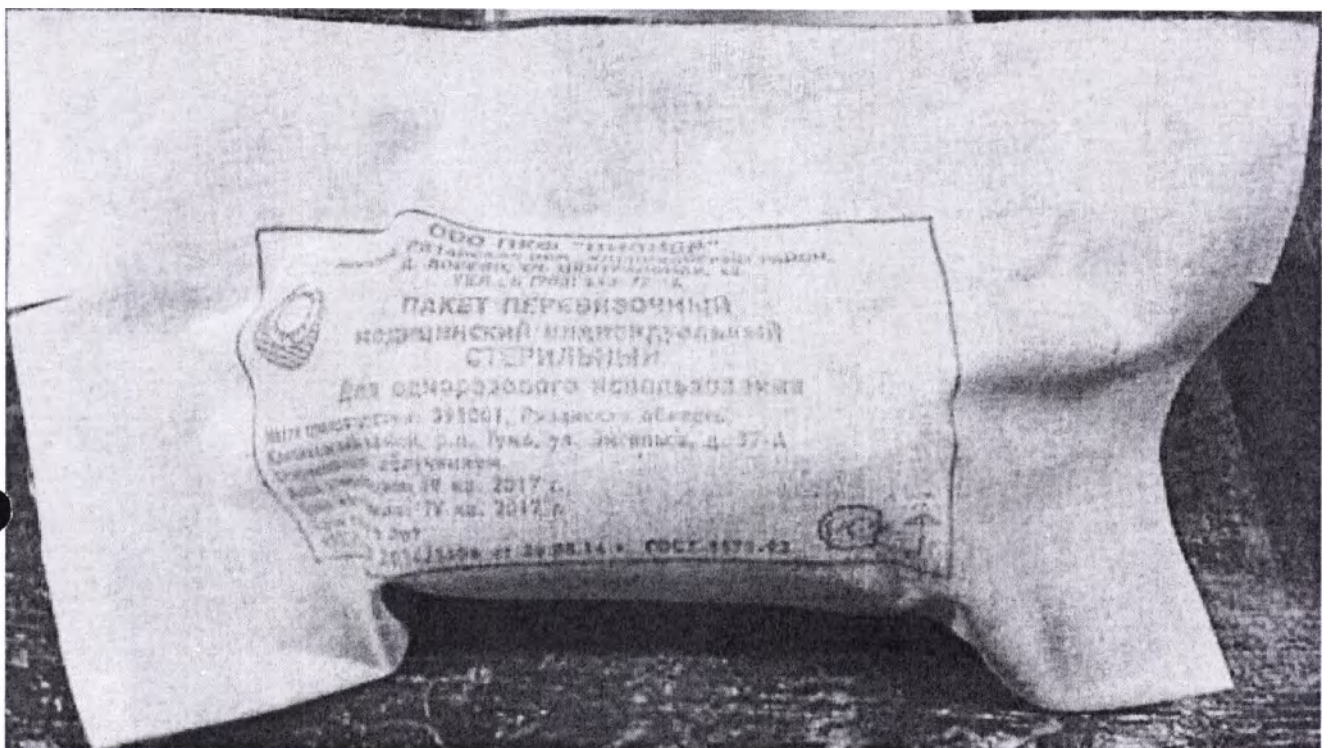

Пакет перевязочный стерильный

РУ № РЗН 2014/1656, ООО ПКФ «Пионер», Россия

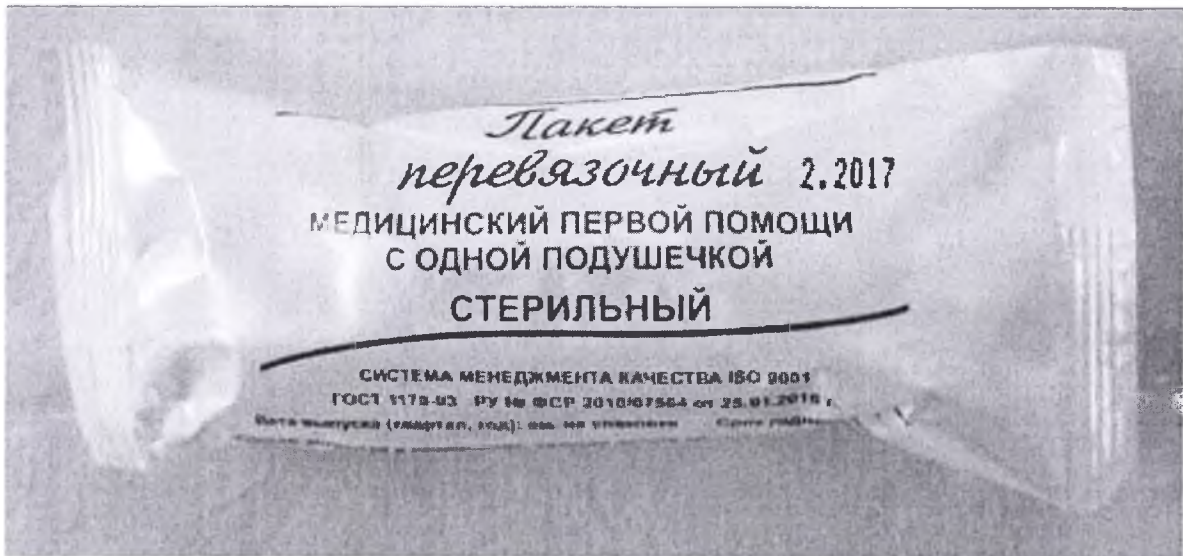

Пакет перевязочный стерильный

РУ № ФСР 2010/07564, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия



САЛФЕТКА
АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ

С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАН

Способ применения: вскройте упаковку, достаньте салфетку, обработайте место повреждения кожи.

Состав: салфетка, пропитанная 3% раствором перекиси водорода.

ТУ 9393-053-42965160-2012

РУ № РЗН 2013/716 от 31.05.2013

(срок действия не ограничен)

Зарег. под названием

«Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода»

СМК соответствует ГОСТ ISO 9001:2011

Условия хранения: при температуре от +5° до +25°.

Дата изготовления: см. на шве.

Срок годности: 3 года.

АППОЛО
МЕДИЦИНСКАЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПАНЬИ

СЕРИЯ САЛФЕТОК АППОЛО:



САЛФЕТКИ
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ДЫХАНИЯ
С НАШАТЫРНЫМ СПИРТОМ



САЛФЕТКИ
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
СПИРТОВЫЕ

Произведено: ООО «ТД «АППОЛО»
111123, Россия, г. Москва,
Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20

Тел./факс: (495) 380-21-47, 215-08-13

e-mail: info@appolo.ru, www.appolo.ru



Салфетка антисептическая из нетканого материала
с перекисью водорода, не менее 12,5 см x 11,0 см
РУ № РЗН 2013/716, ООО «ТД «АППОЛО», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см № 10

РУ № ФСР 2011/12069, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16см x 14см № 10
 РУ № РЗН 2015/2553, ООО «ХБК Навтекс», Россия




Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16см x 14см № 10
 РУ № РЗН 2015/2554, ООО «ХБК Навтекс», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16см x 14см № 10

РУ № ФСР 2010/07469, АО «КПТФ», Россия



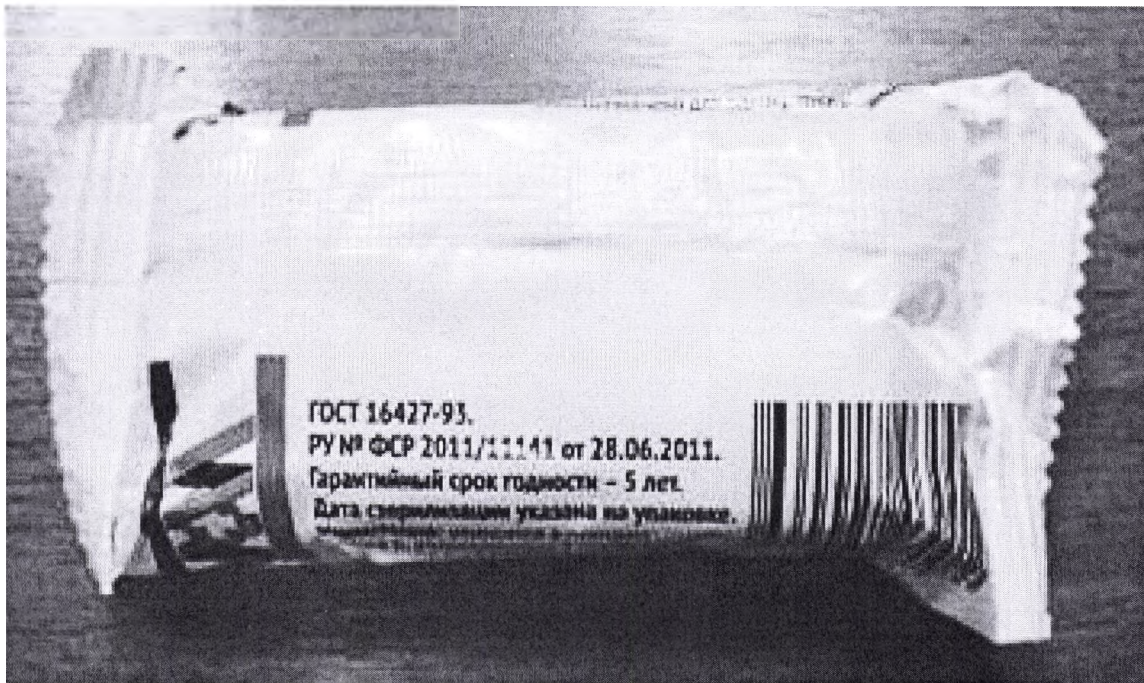

Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16см x 14см № 10

РУ № ФСР 2011/11141, ООО «НЬЮФАРМ», Россия



Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 45 см x 29 см № 5

РУ № ФСР 2011/12069, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

 WISEMAN

САЛФЕТКИ
марлевые медицинские
двухслойные

СТЕРИЛЬНЫЕ

45 см x 29 см

Количество: 5 штук

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ» (ООО «НЬЮФАРМ»)

Место нахождения и почтовый адрес производителя: Россия, 155800, Ивановская обл.,

г. Кинешма, ул. Шуйская, 1. www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru, тел. (49331) 2-00-63

Показания к применению: предназначены для использования в качестве готовых перевязочных средств, для наложения на раны и осушения операционного поля.

Противопоказаний не выявлено. **Способ применения:** вскрыть упаковку по линии отреза и использовать по назначению. Предназначено для однократного применения.

Условия хранения: хранить в сухом месте.

ГОСТ 16427-93.

РУ № ФСР 2011/11141 от 28.06.2011.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Дата стерилизации указана на упаковке.

Утилизация: относятся к отходам класса Б, утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.




STERILE R





Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 45 см x 29 см № 5

РУ № ФСР 2011/11141, ООО «НЬЮФАРМ», Россия

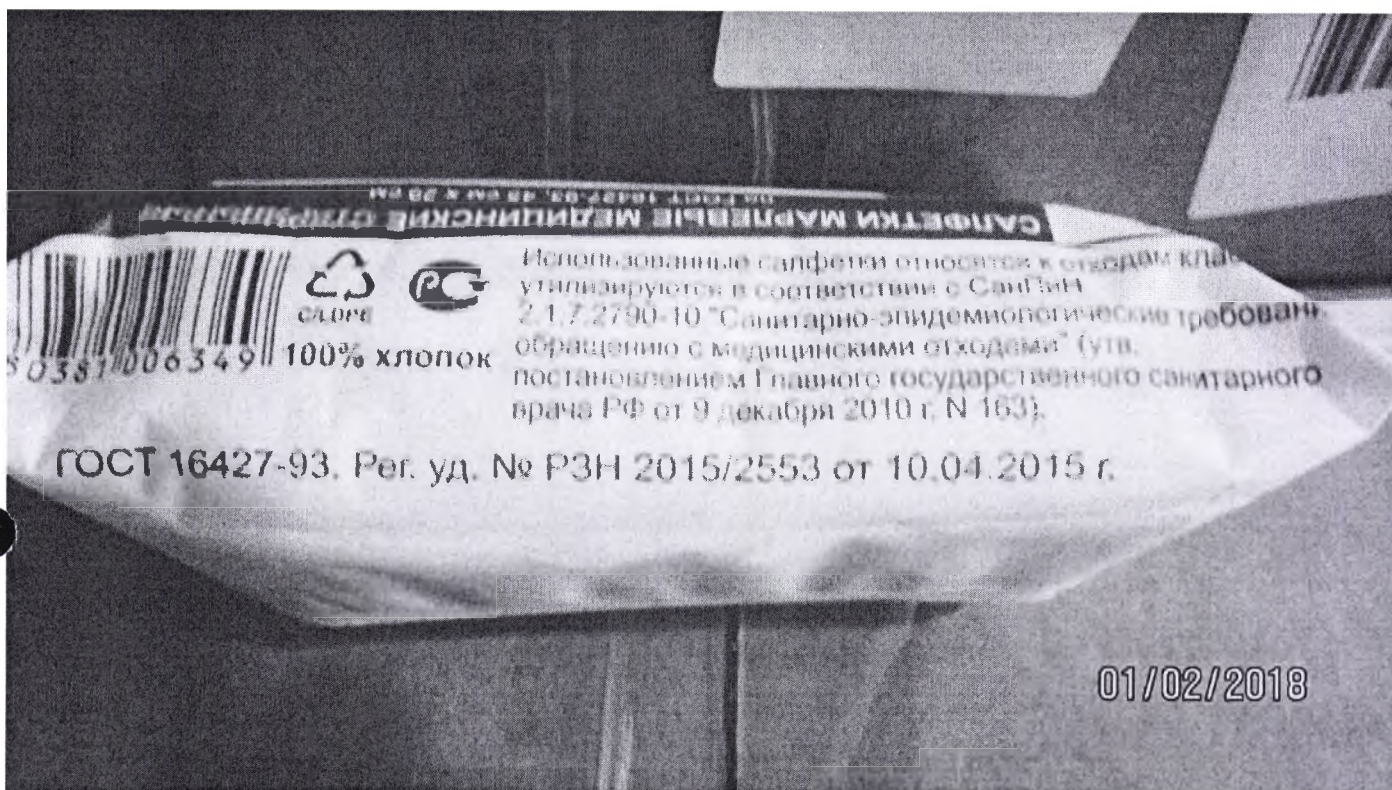

Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 45 см x 29 см № 5

РУ № РЗН 2015/2553, ООО «ХБК Навтекс», Россия

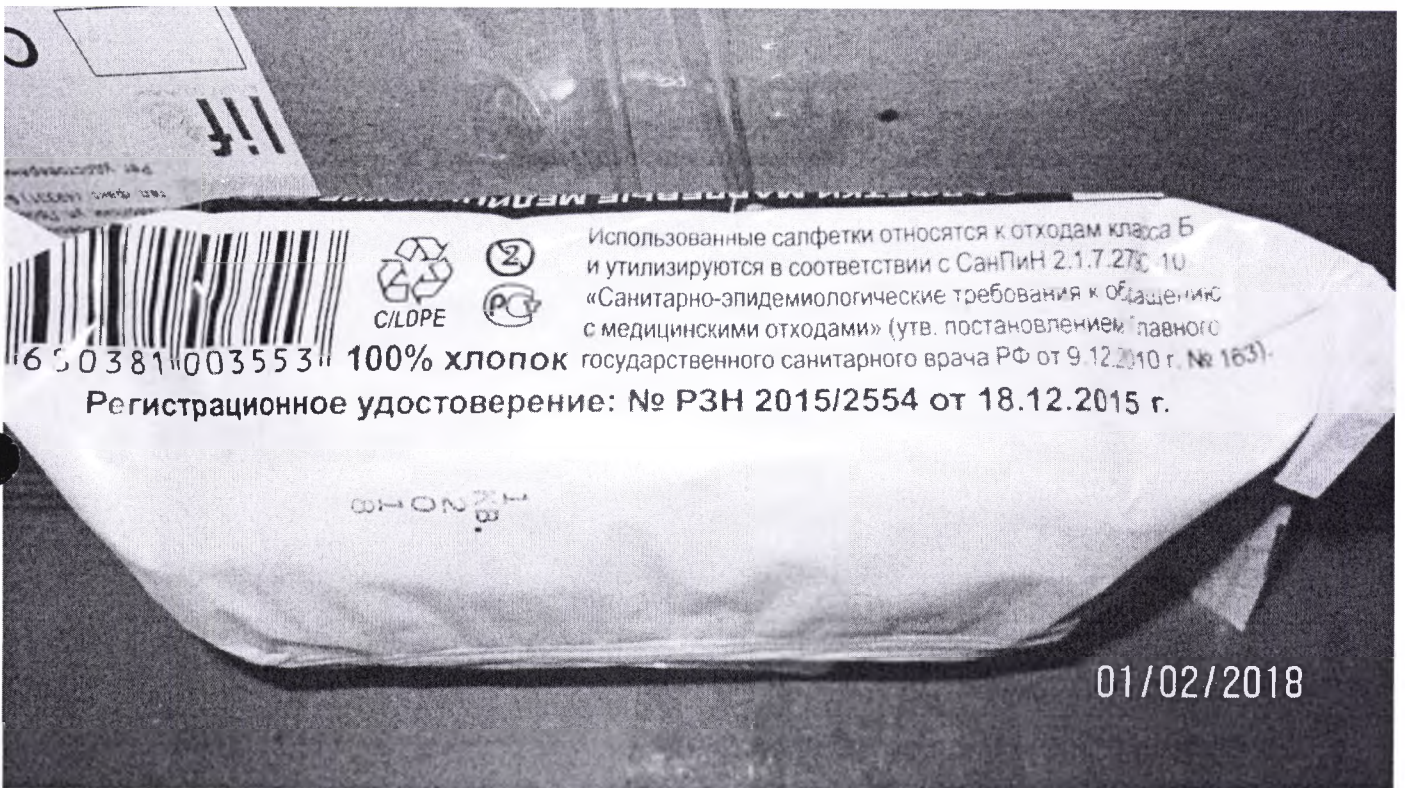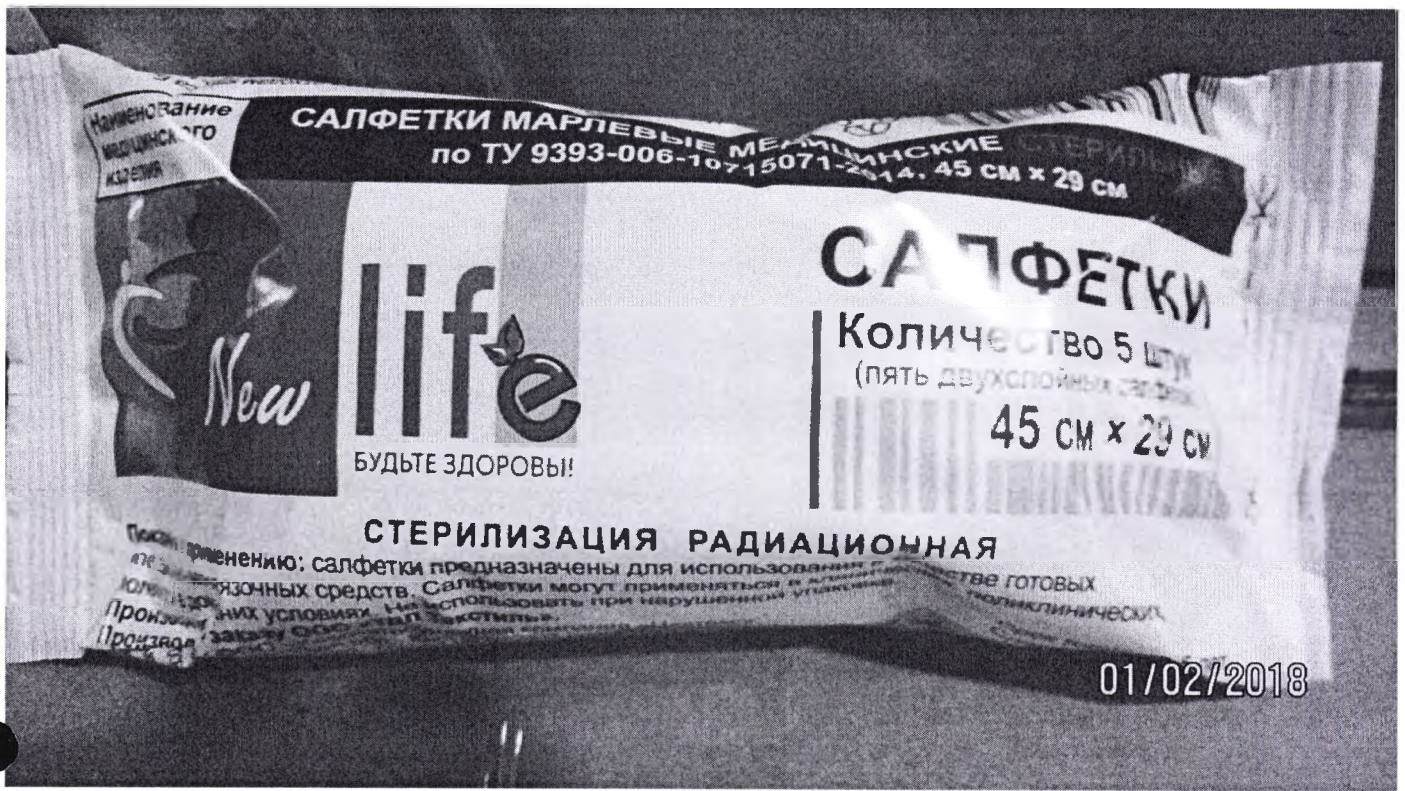

Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 45 см x 29 см № 5

РУ № РЗН 2015/2554, ООО «ХБК Навтекс», Россия



12 2017

Количество 5 штук
5 двухслойных салфеток

ГОСТ 16427-93

стерильные размер 45 см x 29 см

салфетки
марлевые медицинские

Российский
производитель
перевязочных средств

АО «Кинешемская»
прядильно-ткацкая фабрика

Срок годности – 5 лет
дата стерилизации
указана на упаковке.

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2010/07469 от 04.05.2016 г.

STERILE R



Белено без хлора



Хлопок 100%



2195



Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 45 см x 29 см № 5

РУ № ФСР 2010/07469, АО «КТПФ», Россия



ГЕЛЕВАЯ ПОВЯЗКА "АППОЛО" ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ ВЫСОКО-ЭФФЕКТИВНЫМ ПЕРЕВЯЗОЧНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПРОЛЕЖНИ, ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ)

ГЕЛЕВАЯ ПОВЯЗКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

1. Быстрое обезболивающее действие;
2. Равномерное нанесение гидрогеля на раневую поверхность;
3. Создание условий для роста грануляционной ткани;
4. Предотвращение инфицирования раны;
5. Антимикробное действие.

Повязка стерильна, готова к применению, не прилипает к раневой поверхности, безболезненно удаляется при перевязке.

СОСТАВ:

Полимерный гидрогель, мирамистин, анилокаин, текстильная сетчатая салфетка 20х30 см.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Разрезать упаковку с двух смежных сторон;
2. Взять сетчатую салфетку с нанесенным на нее гелем, собрать остатки геля с упаковки и наложить на раневую поверхность;
3. При необходимости наложить марлевую салфетку и зафиксировать повязку бинтом или лейкопластырем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость мирамистина и анилокаина.

ВНИМАНИЕ! Применять после консультации с врачом!
Не применять на мокнущие раны

Производитель: ООО «ТД «АППОЛО»
111123, Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20
Тел./Факс: +7 (495) 380-21-47, +7 (812) 337-66-73
e-mail: info@apolo.ru www.apolo.ru

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008

ТУ 9393-002-42065180-2009
РУ №ФСР 2009/05055 от 10.08.2009 г
Срок годности 3 года
с даты стерилизации.
Дату стерилизации см. на упаковке.
Хранить при температуре от +5 до +25 С



Зарег. под названием «Повязка гелевая на текстильной основе для лечения ожогов и инфицированных ран, стерильная, «АППОЛО-ПГ-ПАК-АИ» на основе полиакрилатного гидрогеля с включением мирамистина и анилокаина»

Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран
стерильное с антимикробным и обезболивающим действием,
салфетка, не менее 20см х 24см
РУ № ФСР 2009/05055, ООО «ТД «Апполо», Россия

ООО "КОЛТЕКС"

Средство перевязочное
гидрогелевое противоожоговое



КОЛТЕКС-АДЛ

с альгинатом натрия
диоксидином и лидокаином

НАЗНАЧЕНИЕ :

для местного
обезболивания
и охлаждения
при лечении ожогов

ООО "КОЛТЕКС"

Средство перевязочное
гидрогелевое противоожоговое



КОЛТЕКС-АДЛ

с альгинатом натрия
диоксидином и лидокаином

для лечения гнойных ран,
ожогов, трофических язв

ПРИМЕНЕНИЕ :

- Салфетку, смоченную водой или физраствором, положить на пораженную область.
- Зафиксировать салфетку бинтом или пластырем.
- Салфетку на ране желательно поддерживать во влажном состоянии.
- Салфетку можно не менять до 3-х суток.

Марка: Колетекс-АДЛ
Состав: альгинат натрия,
диоксидин - 0,5 мг/см²,
лидокаин - 1,5 мг/см².

Противопоказания: аллергическая
реакция на препараты.

ТУ 9393-013-26943035-2003.


Регистрационное удостоверение ФСР 2007/01068

Производитель/поставщик: ООО «Колетекс»

РФ, 115093, Москва, ул. Павловская, д. 21.

Тел./факс. (495) 730-56-45 (многоканальный);

Web site: coletex.ru



Хранить в сухом, защищенном от света
месте при температуре от +5 до +40°C.




STERILE R

Количество: 1 штука
Срок годности: 3 года
Дату изготовления и номер
партии см. на шве упаковки
Дата стерилизации

Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран
стерильное с антимикробным и обезболивающим действием,


салфетка, не менее 20см x 24см

РУ № ФСР 2007/01068, ООО «Колетекс», Россия

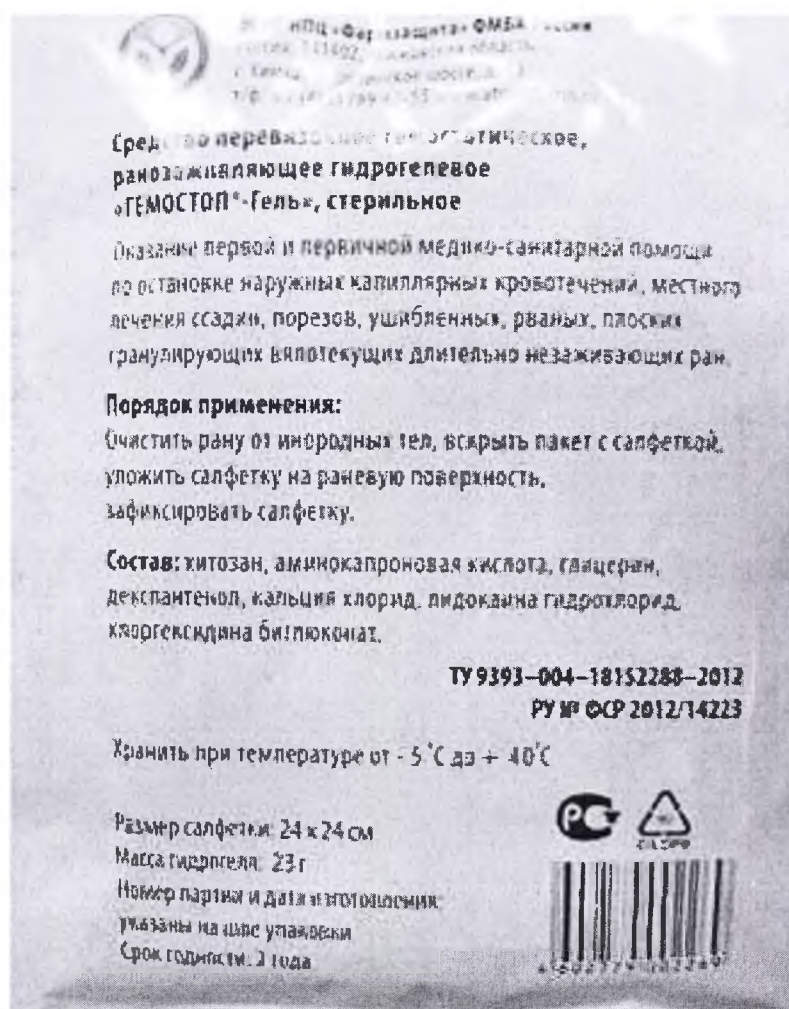

Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран
стерильное с антимикробным и обезболивающим действием,
салфетка, не менее 20см x 24см

РУ № ФСР 2012/14223, ООО ФГУП НПЦ «Фармзащита»ФМБА, Россия

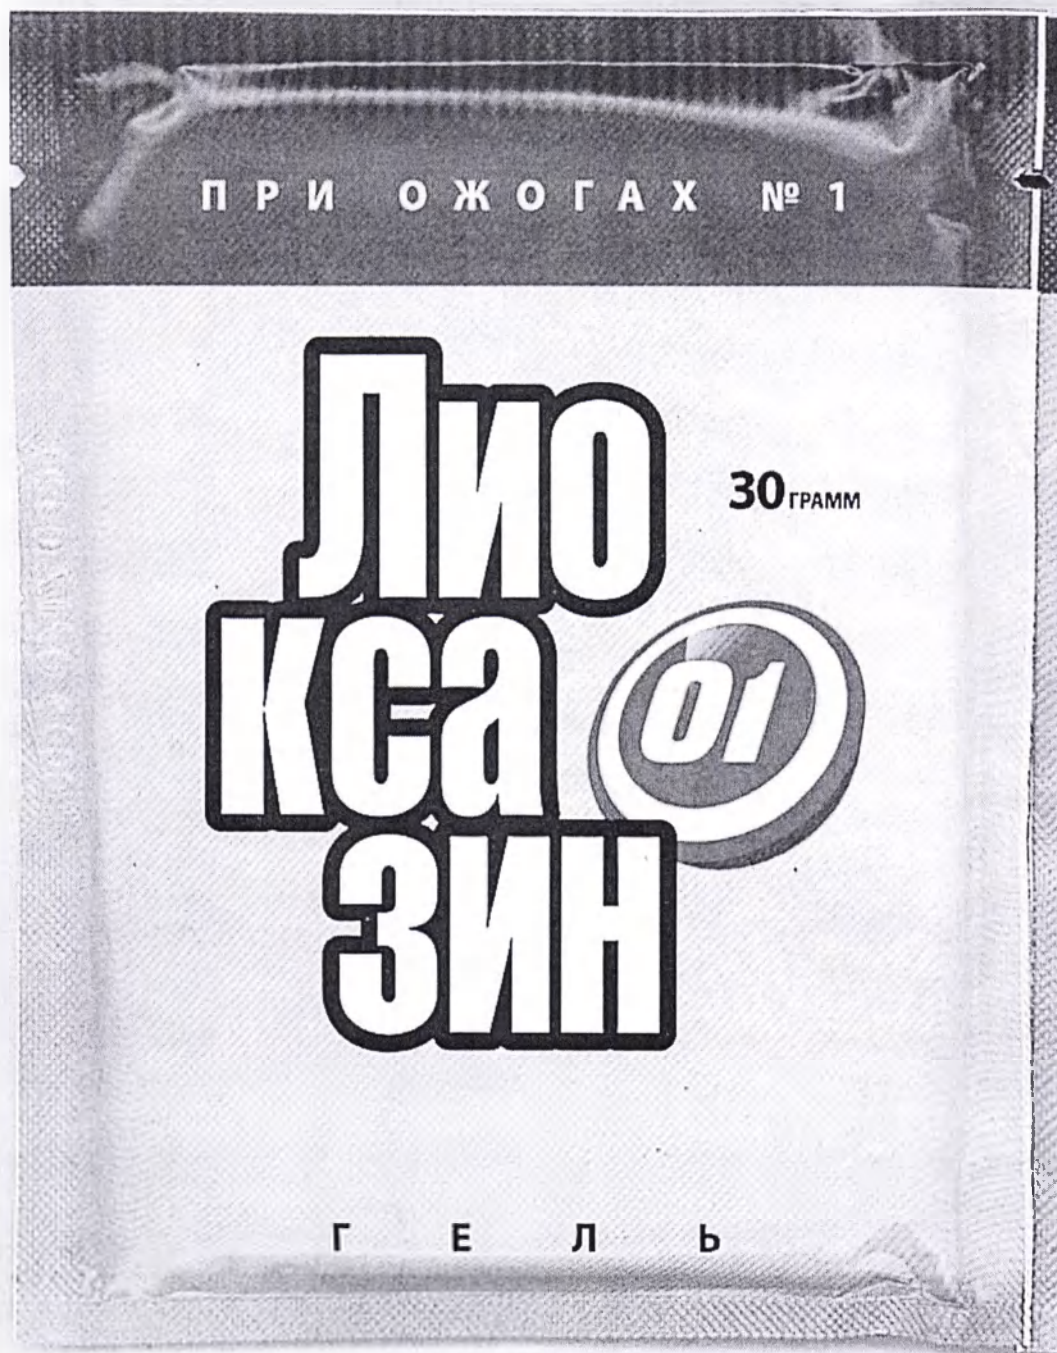

Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран
стерильное с антимикробным и обезболивающим действием,
салфетка, не менее 20см x 24см
РУ № ФСР 2010/08888, ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия

С Т Е Р И Л Ь Н О

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГИДРОГЕЛЕВОЕ, ПРОТИВООЖОГОВОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ «ЛИОКСАЗИН-ГЕЛЬ».

Обладает охлаждающим, обезболивающим, бактериостатическим действием.

Состав:

Биологически активная гидрогелевая композиция на основе гидроксипропилцеллюлозы с иммобилизованными 2-аллилоксиэтанолом и лидокаином в индивидуальной упаковке.

Назначение:

Для оказания первой помощи и лечения ожогов I-IIIa степени, в том числе солнечных и радиационных, для снятия воспаления при кожных заболеваниях, а также для обработки мест укуса насекомых.

Способ применения:

При ожогах сразу после возникновения - нанести гель на пораженный участок; через 6 часов повторить обработку пораженного участка, затем ежедневно 1 раз в день до заживления раны.

При укусах насекомых обработать место укуса.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам.

Побочные действия:

Аллергические реакции.

ТУ 9393-002-18152288-2010

РУ № ФСР 2010/08888 от 22.09.14

Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С.

Утилизация: образующиеся отходы и отработанное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Сведения о производителе:

ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России

141402, Московская область,

г. Химки, Вашутинское шоссе, 11

тел/факс: +7 (495) 789-6555

e-mail: info@atompharm.ru



WWW.LIOXAZIN.RU

Номер партии, дата изготовления
и срок годности указаны
на шпе упаковки

**ПРОТИВООЖОГОВОЕ
СРЕДСТВО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ**

Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран
стерильное с антимикробным и обезболивающим действием,
салфетка, не менее 20см x 24см

РУ № ФСР 2010/08888, ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Россия

Средство перевязочное гемостатическое

ГЕМ+СПАС М

Остановка наружных артериовенозных
и капиллярных кровотечений.
В условиях стационара – остановка
кровотечения из паренхиматозных органов.

Масса нетто: 50 г

ТУ 9393-002-40086098-2015
РУ № РЗН 2017/6201 от 07.09.17

Номер партии:

Дата изготовления:

Годен до:


указаны на шве упаковки

ООО «МДК Медика»

РФ, 115035, г.Москва,
ул. Садовническая, д.25
тел./факс: 8(495) 151-82-91
info@mdk-medica.ru
www.mdk-medica.ru


Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов и
алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция, не менее 50 г

РУ № РЗН 2017/6201, ООО «МДК Медика», Россия

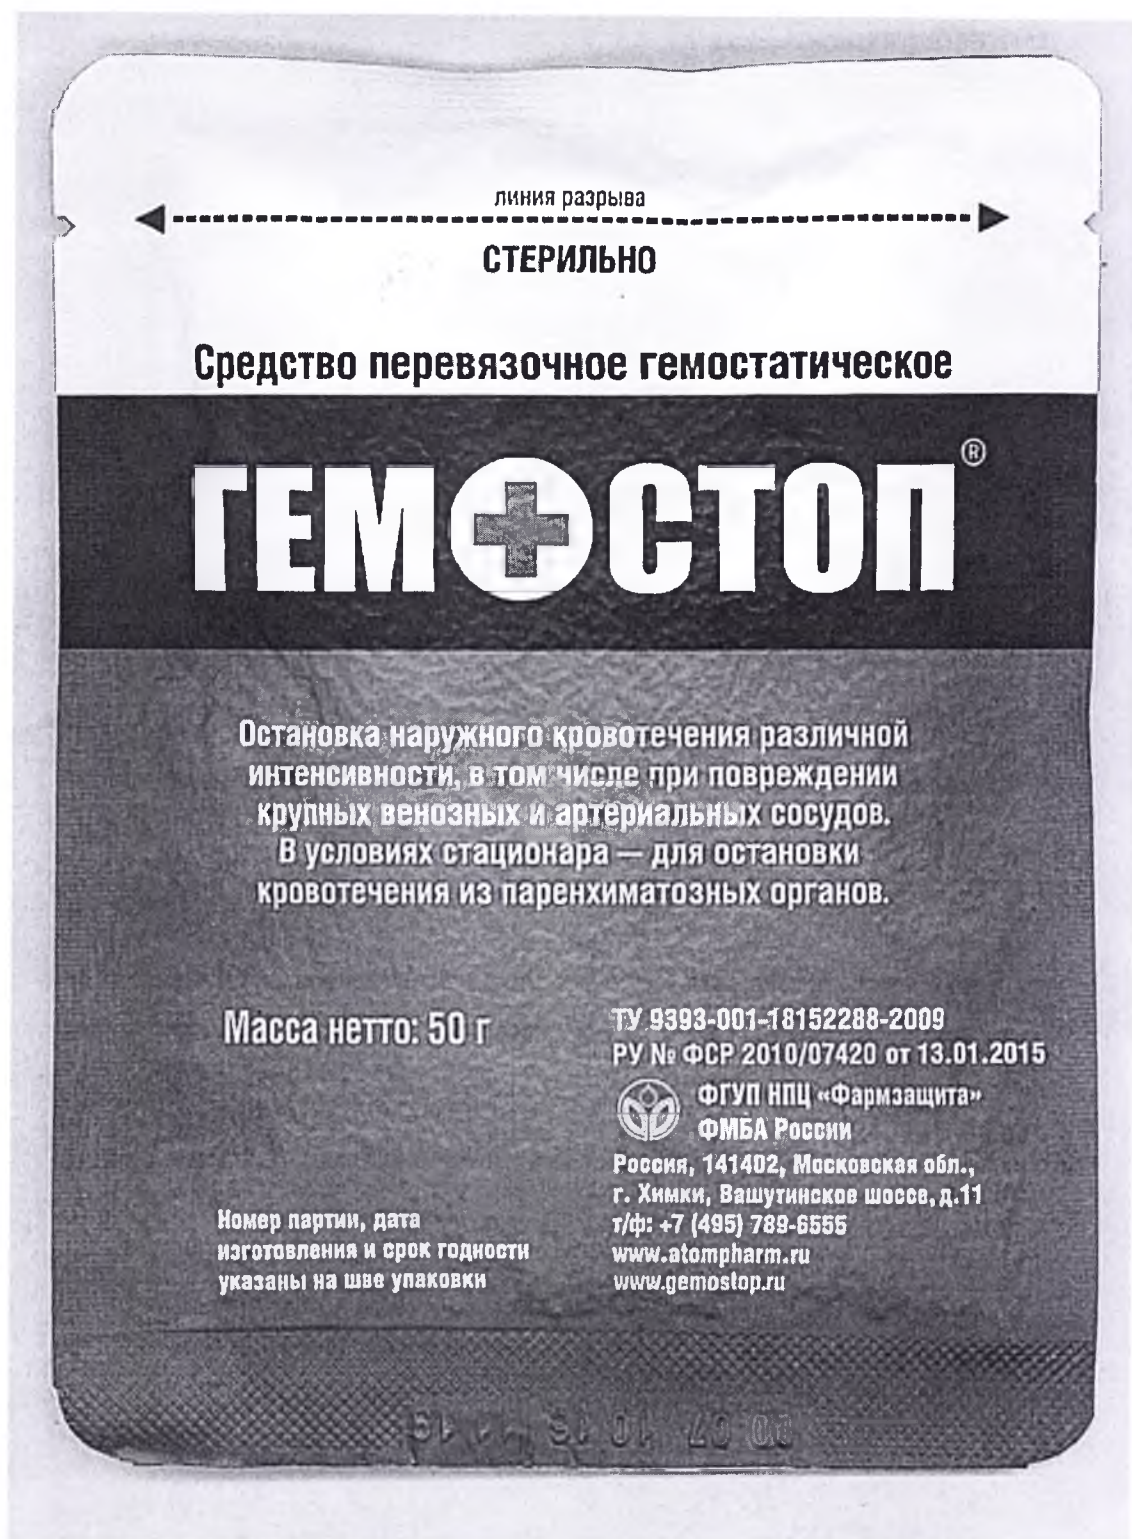


Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов и алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция, не менее 50 г

РУ № ФСР 2010/07420, ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА, Россия

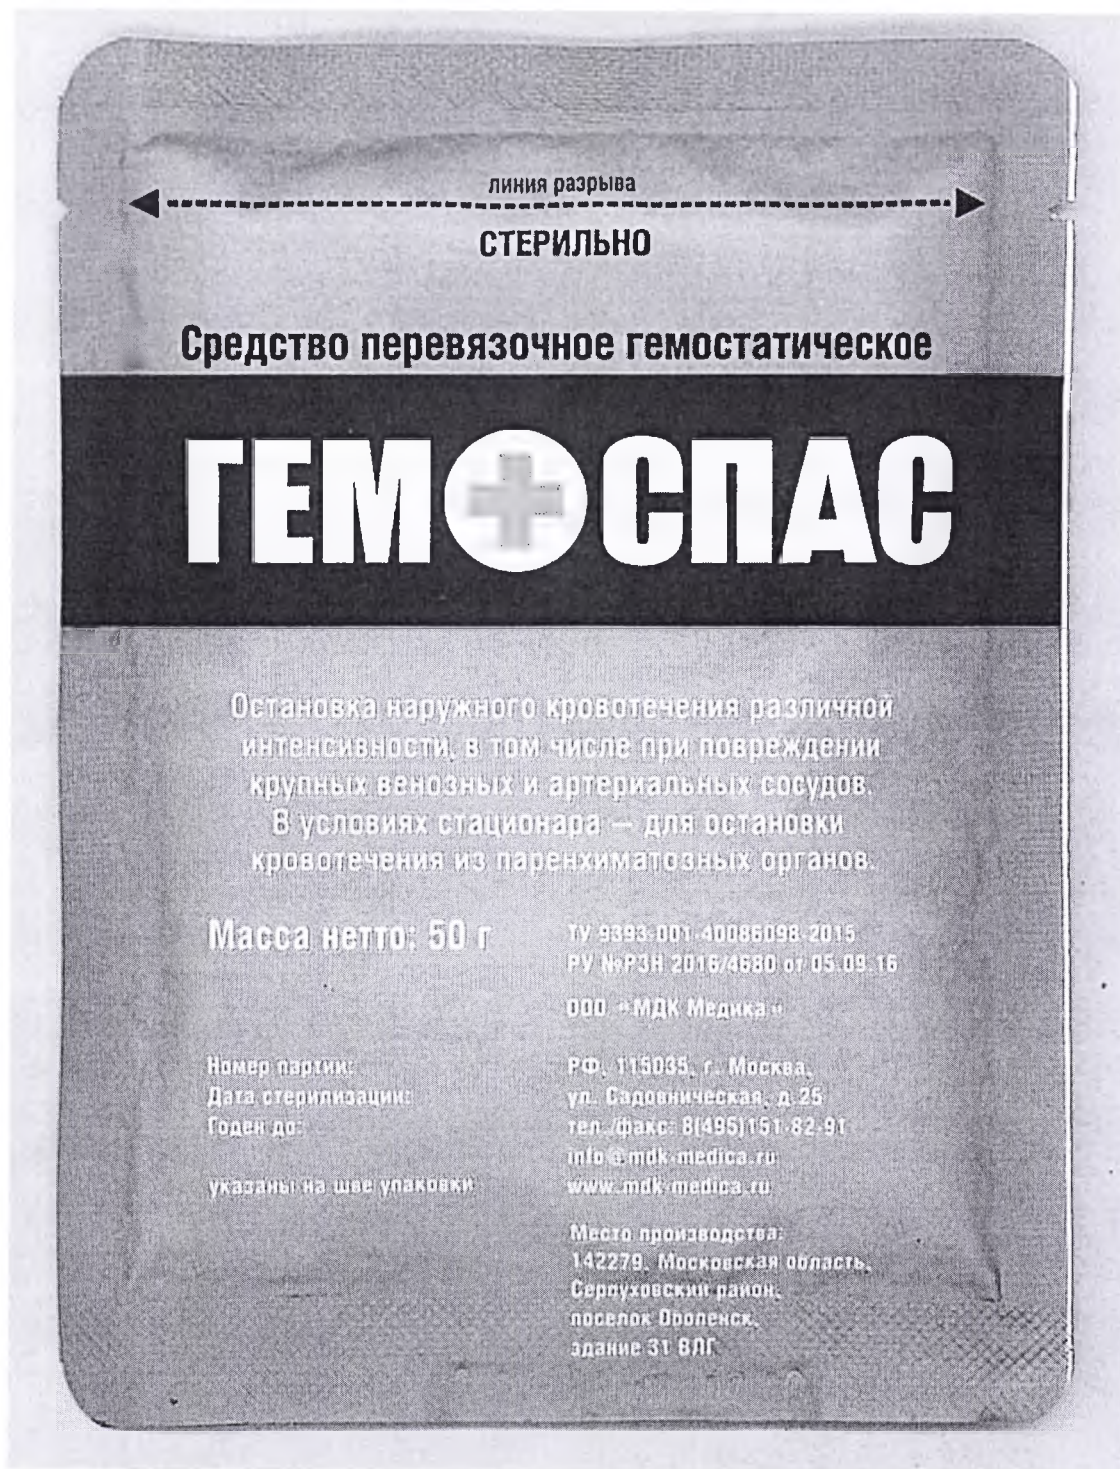

Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов и алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция, не менее 50 г

РУ № РЗН 2016/4680, ООО «МДК Медика», Россия

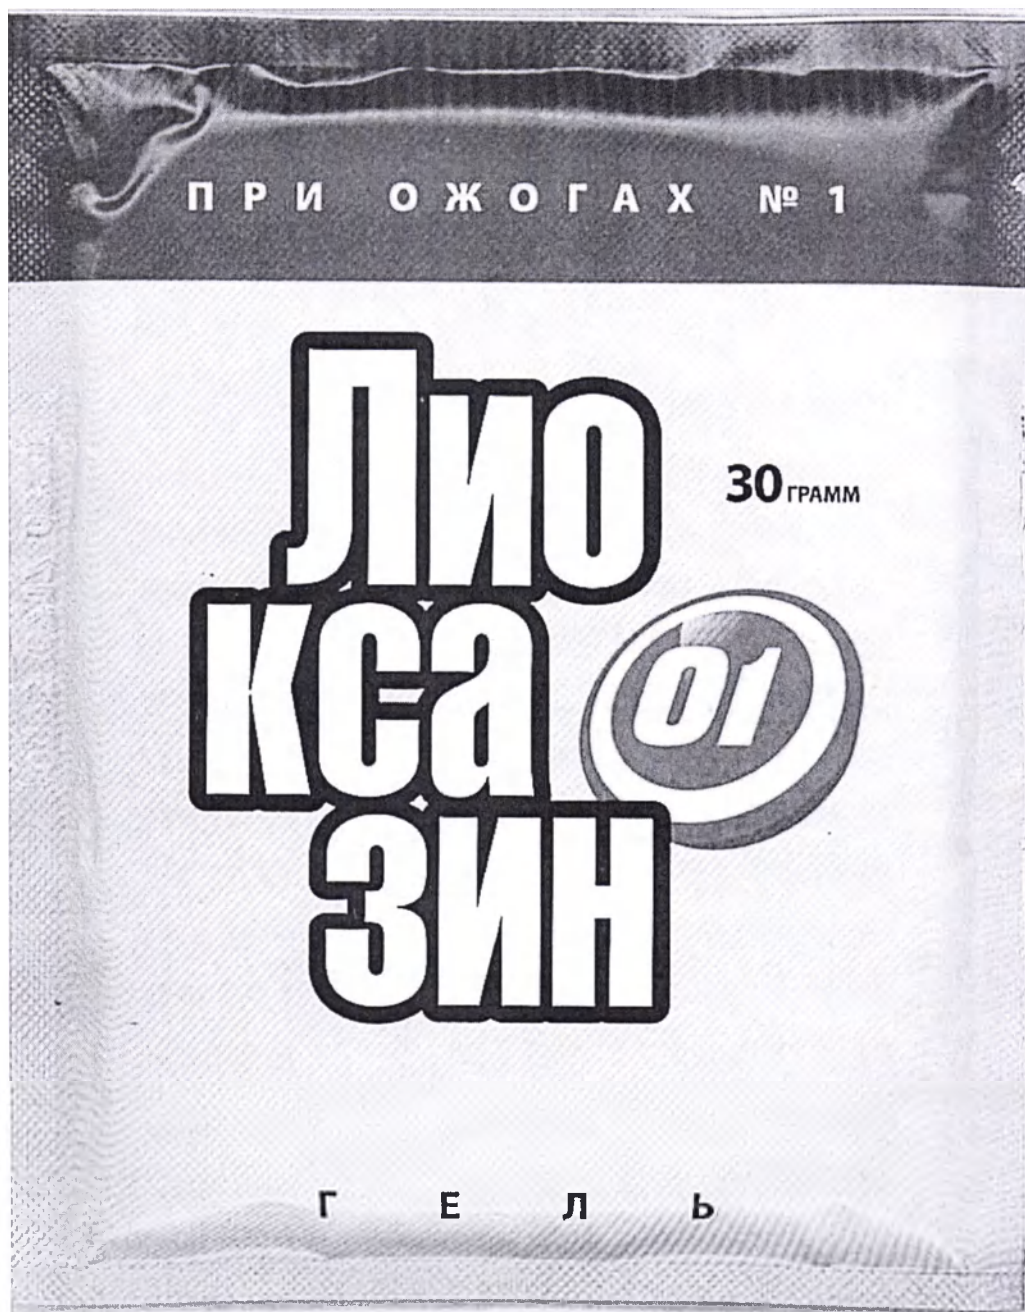

Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное
с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка,
не менее 20 см x 24 см

РУ № ФСР 2010/08888, ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России

СТЕРИЛЬНО

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГИДРОГЕЛЕВОЕ, ПРОТИВООЖОГОВОЕ СТЕРИЛЬНОЕ «ЛИОКСАЗИН-СП»

Обладает охлаждающим, обезболивающим, бактериостатическим действием.

Состав:

Биологически активная гидрогелевая композиция на основе гидроксипропилцеллюлозы с иммобилизованным 2-аллилксиэтанолом и лидокаином на салфетке 24 x 24 см в индивидуальной упаковке.

Назначение:

Для оказания первой помощи и лечения ожогов I-II степени, в том числе радиационных и солнечных, для снятия воспаления при кожных заболеваниях, а также для обработки мест укуса насекомых.

Способ применения:

При ожогах сразу после возникновения - обработать пораженный участок; через 6 часов повторить обработку, затем ежедневно 1 раз в день до эпителизации.

При укусах насекомых обработать место укуса.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам.

Побочные действия:

Аллергические реакции.

ТУ 9393-002-18152288-2010

РУ № ФСР 2010/08888 от 22.09.14

Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С.

Утилизация: образующиеся отходы и отработанное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Сведения о производителе:

ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России

141402, Московская область,

г. Химки, Вашутинское шоссе, 11

тел/факс: +7 (495) 789-6555

e-mail: info@atompharm.ru

WWW.LIOXAZIN.RU



Номер партии, дата изготовления
и срок годности указаны
на шве упаковки

ПРОТИВООЖОГОВОЕ СРЕДСТВО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Средство перевязочное гидрогелевое противожоговое стерильное
с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка,
не менее 20 см x 24 см

РУ № ФСР 2010/08888, ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России



Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное
с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка,
не менее 20 см х 24 см

РУ № ФСР 2009/05056, ООО «ТД «Апполо», Россия

**СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГИДРОГЕЛЕВОЕ ПРОТИВООЖОГОВОЕ
СТЕРИЛЬНОЕ С ОХЛАЖДАЮЩИМ И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ**

ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

1. Мгновенное охлаждение обожженного участка;
2. Обезболивание обожженного участка;
3. Предотвращение образования пузырей (при поверхностных ожогах);
4. Мягкое удаление ожогового струпа (при глубоких ожогах);
5. Предотвращение инфицирования раны;
6. Антимикробное действие.

Перевязочное средство стерильно, готово к применению, не прилипает к обожженной поверхности, безболезненно удаляется при перевязке.

СОСТАВ:

Полимерный гидрогель, йодовидон, анилокаин, текстильная сетчатая салфетка 20х24 см.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Разрезать упаковку с двух смежных сторон;
2. Взять сетчатую салфетку с нанесенным на нее гелем, собрать остатки геля с упаковки и наложить на обожженную поверхность;
3. При необходимости наложить марлевую салфетку и зафиксировать повязку бинтом или лейкопластырем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость йодовидона и анилокаина.

ВНИМАНИЕ! Применять после консультации с врачом!

Производитель: ООО «ТД «АППОЛО»

111123, Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 58, стр. 20

Тел./Факс: +7 (495) 215-08-13, +7 (495) 380-21-47, +7 (812) 748-25-39

e-mail: info@appolo.ru www.appolo.ru

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ ISO 9001-2011

ТУ 9393-002-42965160-2009

РУ №ФСР 2009/05056 от 10.06.2009 г

Срок годности 3 года

с даты стерилизации.

Дату стерилизации см. на упаковке.

Хранить при температуре от +5 до +25 С



Зарег. под названием «Повязка гелевая на текстильной основе для лечения ожогов и инфицированных ран, стерильная, «АППОЛО-ПГ-ПАК-АИ» на основе полиакрилатного гидрогеля с включением анилокаина и йодовидона»

Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное
с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка,
не менее 20 см х 24 см

РУ № ФСР 2009/05056, ООО «ТД «Апполо», Россия

Салфетка гидрогелевая противожоговая стерильная

КОЛТЕКС · САФТ · ГЕМ
с альгинатом натрия
и фурагином

Останавливает кровотечение

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Салфетку наложить на рану стороной с лекарственным средством и прижать на 30-40 сек.
- После полной остановки кровотечения салфетку удалить.

Марка: САФТ-ГЕМ

Состоит из альгината натрия,

фурагина.

Противопоказания: аллергическая

реакция на препараты.

ТУ 0393-0018-58213785-2005


РУ ФСР 2010/08240

Производитель: ООО «Колтекс»

15001, Москва, ул. Павловская, д. 21, пп 4-6.

Тел./факс: +7 (495) 730-56-45 (многоканальный);

Web site: www.kolelex.ru



Количество: 1 штука

Срок годности: 3 года


Дата изготовления и номер

партии см. на этикетке упаковки

Дата стерилизации


Средство перевязочное гидрогелевое противожоговое стерильное
с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка,
не менее 20 см x 24 см

РУ № ФСР 2010/08240, ООО «КОЛТЕКС», Россия

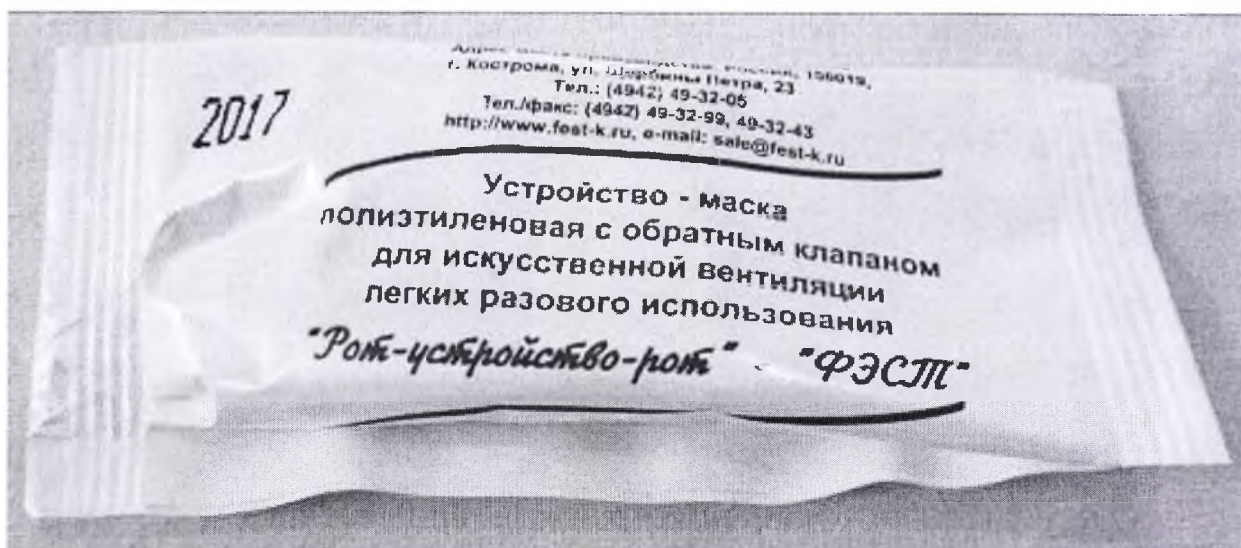



Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

РУ № ФСР 2007/00679, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

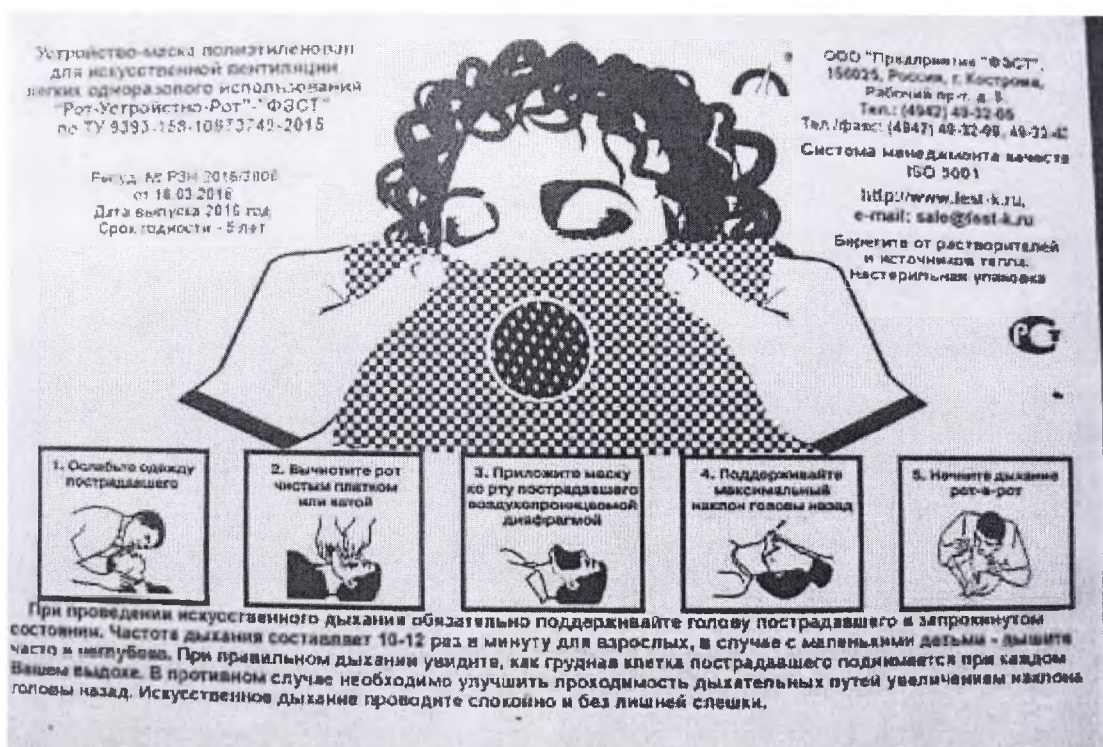


Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

РУ № РЗН 2016/3806, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

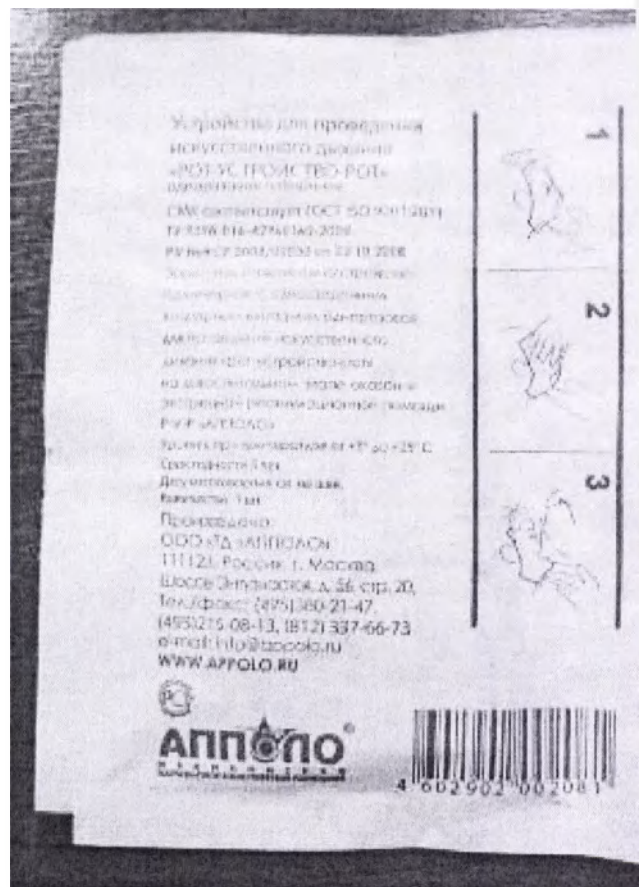
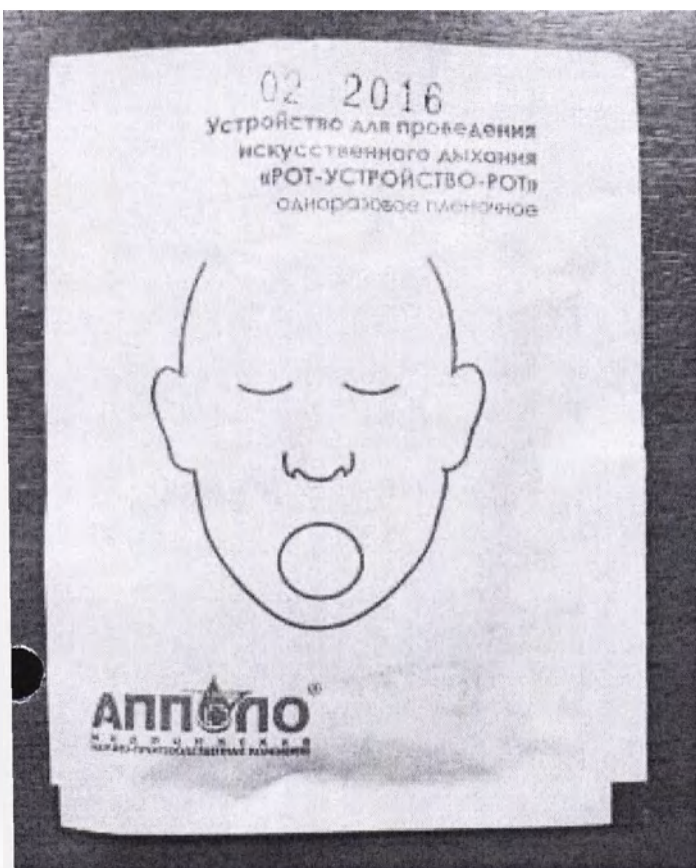


Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

РУ № ФСР 2008/03530, ООО ТД «Апполо», Россия

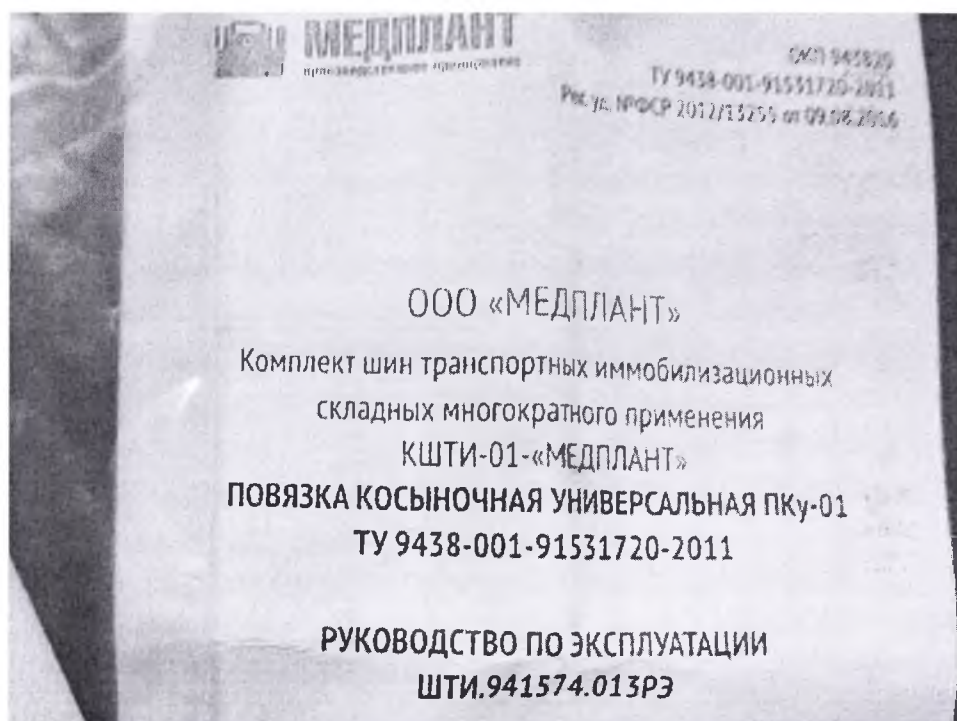

Повязка разгружающая для верхней конечности
РУ № ФСР 2012/13255, ООО «МЕДПЛАНТ», Россия

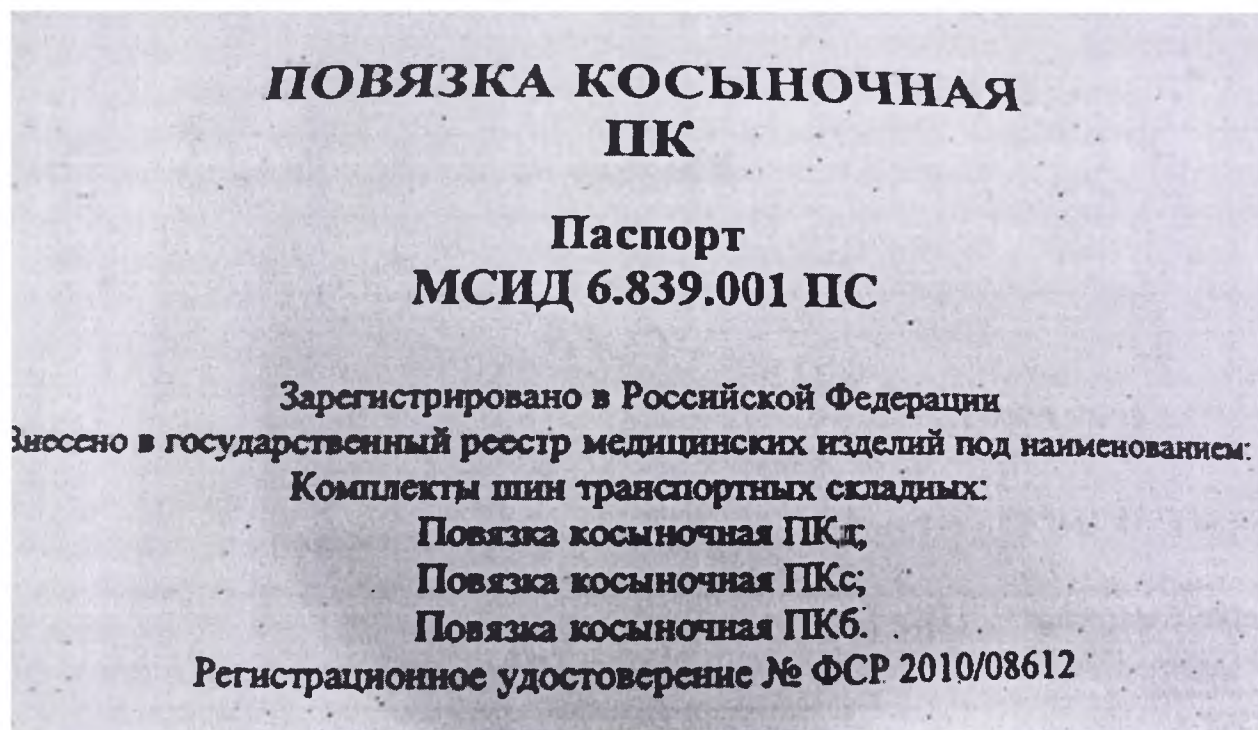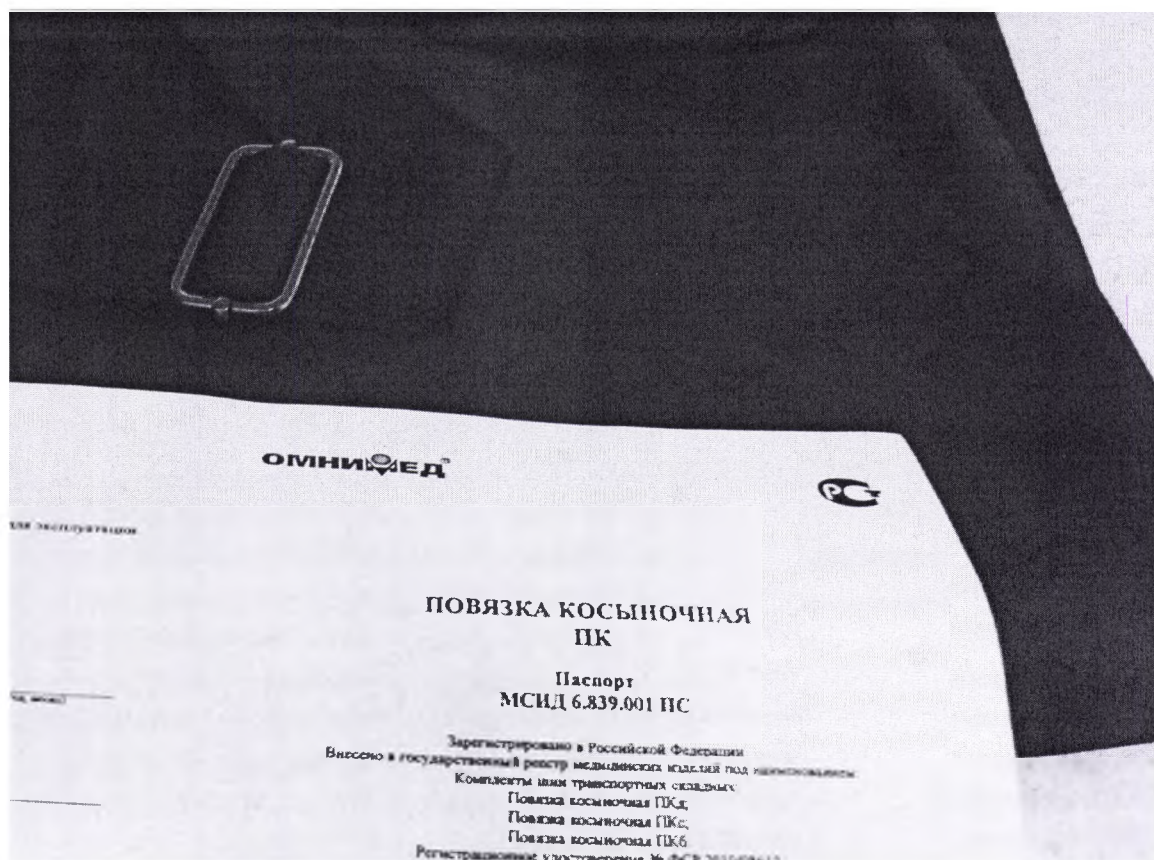

Повязка разгружающая для верхней конечности
РУ № ФСР 2010/08612, ООО ППИЦ «Омнимед», Россия



Пакет гипотермический


РУ № ФСР 2007/01584, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия



Пакет гипотермический

РУ № ФСР 2011/12263,
ООО «ТД «АППОЛО», Россия



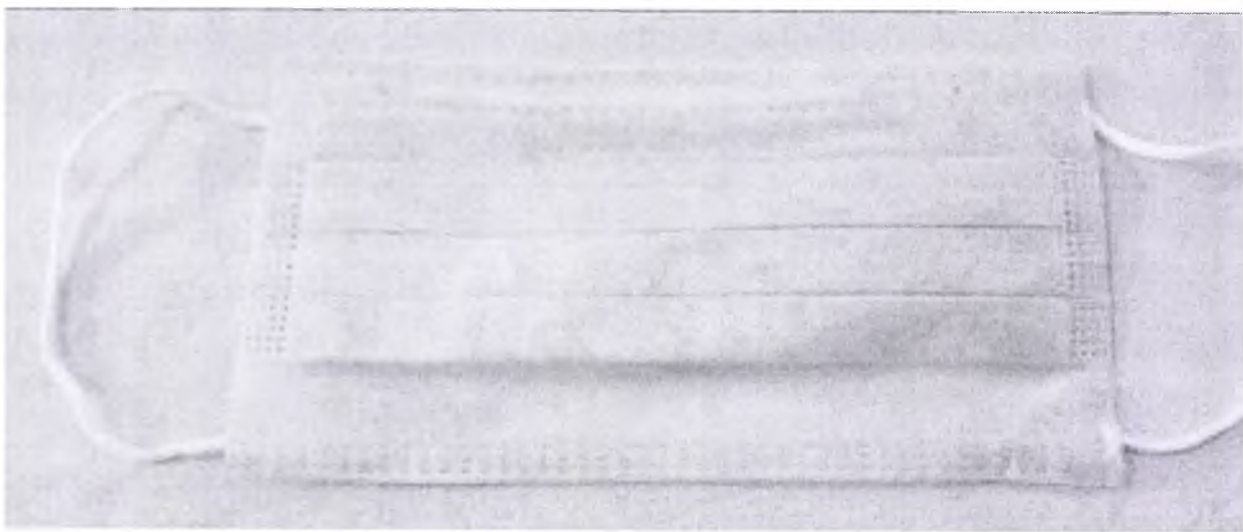

Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСР 2010/07908, ООО «Казанская фабрика «СмекМедЗащита», Россия




Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСЗ 2008/02100, «Вухан Лифарма Кемикалз Ко.,Лтд.», Китай



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСР 2010/08512, ООО «Маска», Россия



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСР 2010/09673, ООО «КИТ», Россия

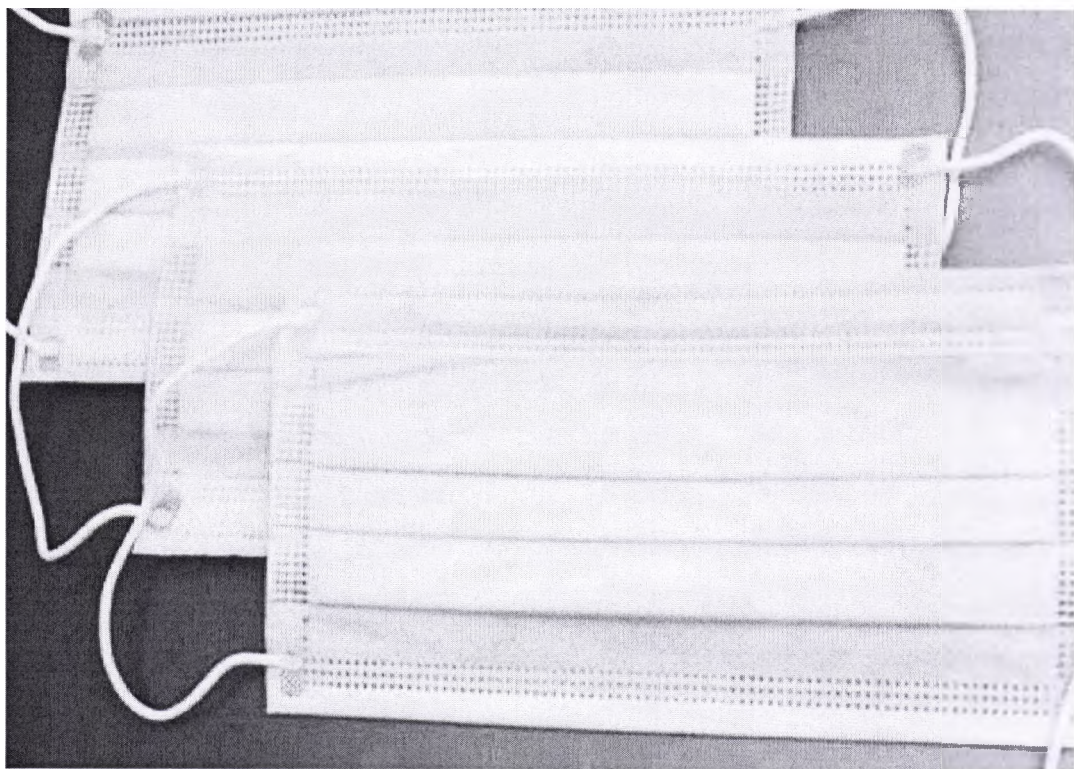

Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСЗ 2010/08588, «АС ФОРАНС ЭЭСТИ», Эстонская республика



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № РЗН 2013/823, ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-П», Россия



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСЗ 2009/03795, «Сяньтао Фуюань Иляо Баозяньпинь Юсянь
Гунсы», КНР



Ножницы разрезания повязок по Листеру
РУ № ФСР 2010/07370, ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия




Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСЗ 2008/02888, «СУРДЖИВЕЛЛ», Пакистан



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ РЗН 2015/3121, «Сурджикон ЛТД», Пакистан

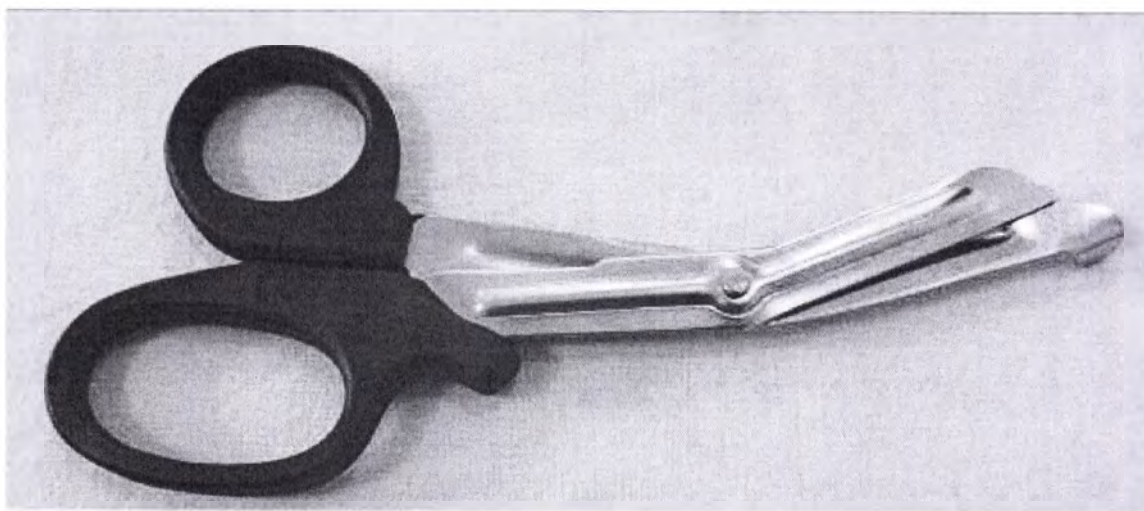

Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСЗ 2010/07112, «Орто Селект ГмбХ»(«Орто Селект, Имплант Технолоджи ГмбХ»), Германия

РУ РЗН 2015/3121, «Сурджикон ЛТД», Пакистан




Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСЗ 2010/07104, «Линватек Корпорэйши», США

РУ № ФСЗ 2012/12352, «Эс-Джи-ЭС Экспорт Интернешил», Пакистан

Руководство по эксплуатации
Экран пластмассовый для предохранения глаз
медицинского персонала ЭПГ-«ЕЛАТ»
по ТУ 9398-022-24320270-2008

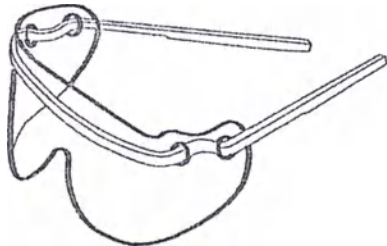

Лёгкий, удобный в эксплуатации

**Защита глаз
от механических частиц и брызг
(крови, гноя, мочи и др.)**




Изготовитель: АО «Елагомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, р.п. Елапыма, ул. Янина, 25
Тел./факс (49131) 2-04-57
E-mail: admin@elamed.com INTERNET: www.elamed.com

Очки или экран защитный для глаз
РУ № ФСР 2008/03716, РАО «ЕПЗ», Россия



Очки или экран защитный для глаз
РУ № РЗН 2013/823, ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-П», Россия

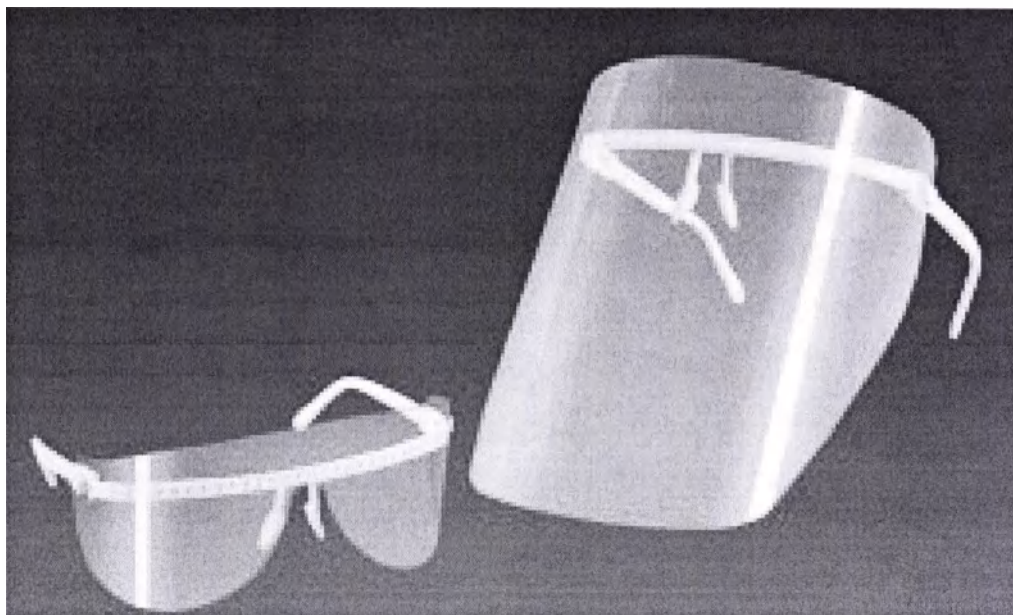


Очки или экран защитный для глаз

РУ № ФСР 2007/01323, ЗАО НПКФ «МЕТОМ, Россия

Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, не менее М



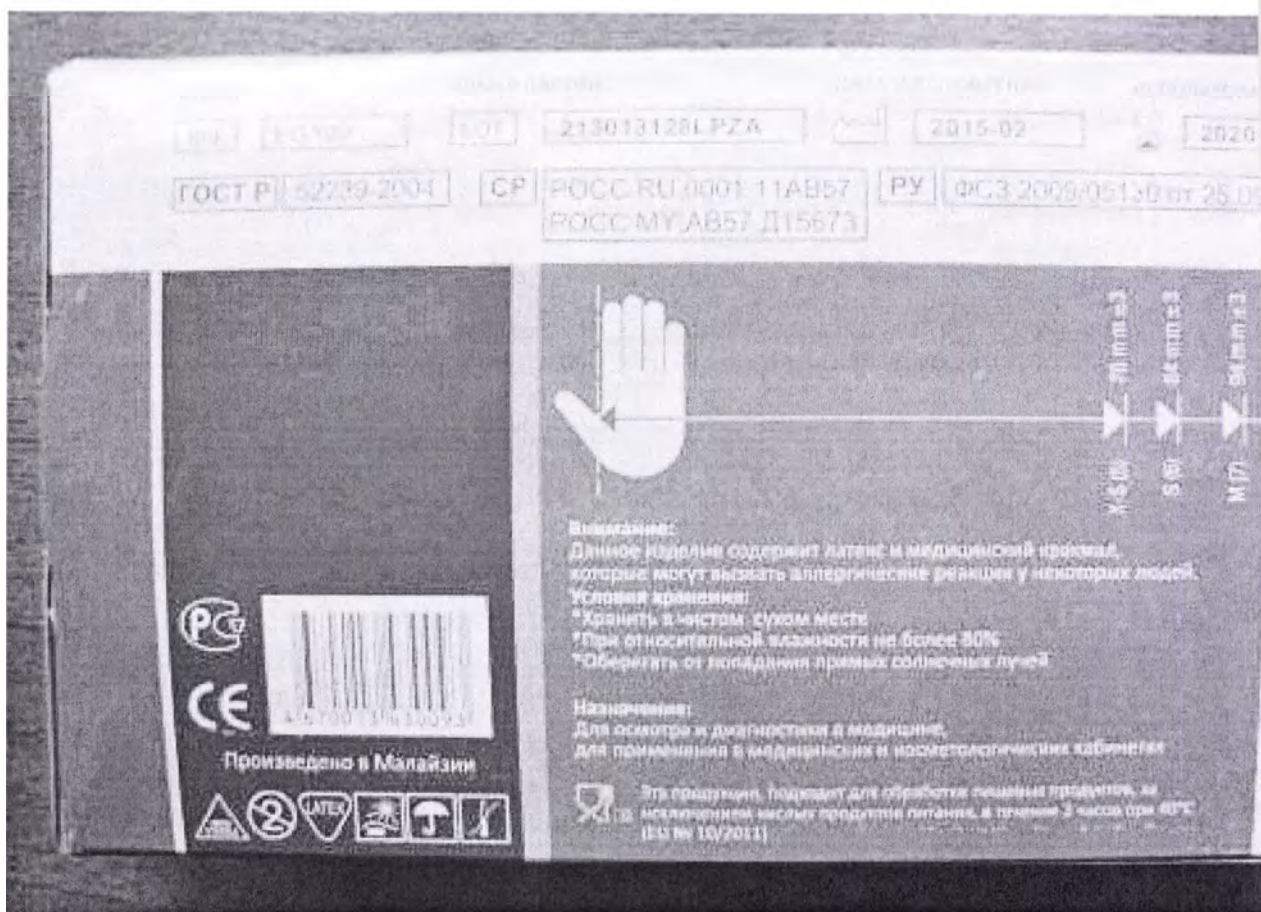

Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, не менее М
 РУ № ФПСЗ 2009/05130, «Топ Глав Сдн Бхд», Малайзия

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ



По заказу

ООО «Фарм-Глобал»

AQL 1.5

100 шт. по весу

Powdered – Smooth

Опудренные – Гладкие

Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные

Powdered – Smooth

Опудренные – Гладкие

Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные

Хранить в сухом месте, подальше от источников тепла (температура не должна превышать 30°C) и прямых солнечных лучей, флуоресцентного освещения, рентгеновских лучей и озона.

Предупреждение: продукты, сделанные из натурального каучукового латекса могут вызвать аллергическую реакцию. Не предназначены для использования в качестве основной химической защиты.


РУ и РФ № ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009
ГОСТ Р 52239-2004

Импортёр/эксклюзивный представитель:
ООО «ГЛОБЛ БИО» Россия, Москва, 111524,
ул. Андреева, дом 1, стрелочка 20
Тел. +7 (495) 3663491

www.pharm-global.com pharm-global@mail.ru

Производитель:

Top Glove Sdn Bhd, Малайзия
10P-610V1 SDN BHD, Lot 4969, Jalan Teratai,
Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor D E., Malaysia



AQL 1.5

ISO 9001
ISO 13485



4 612747 430062



2016-12





2021-11

Lot No.


210033951LPZ

Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, не менее М

РУ № ФСЗ 2009/05130, «Топ Глав Сдн Бхд», Малайзия

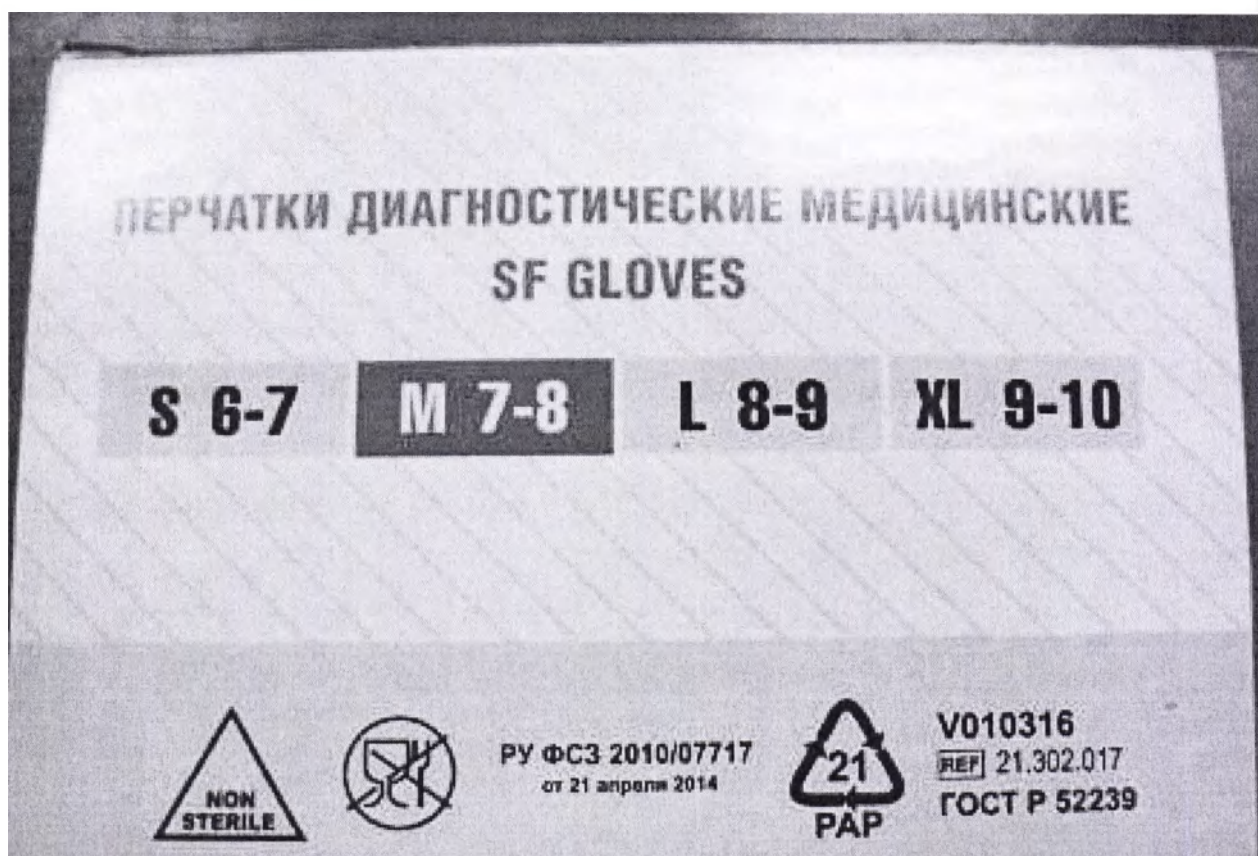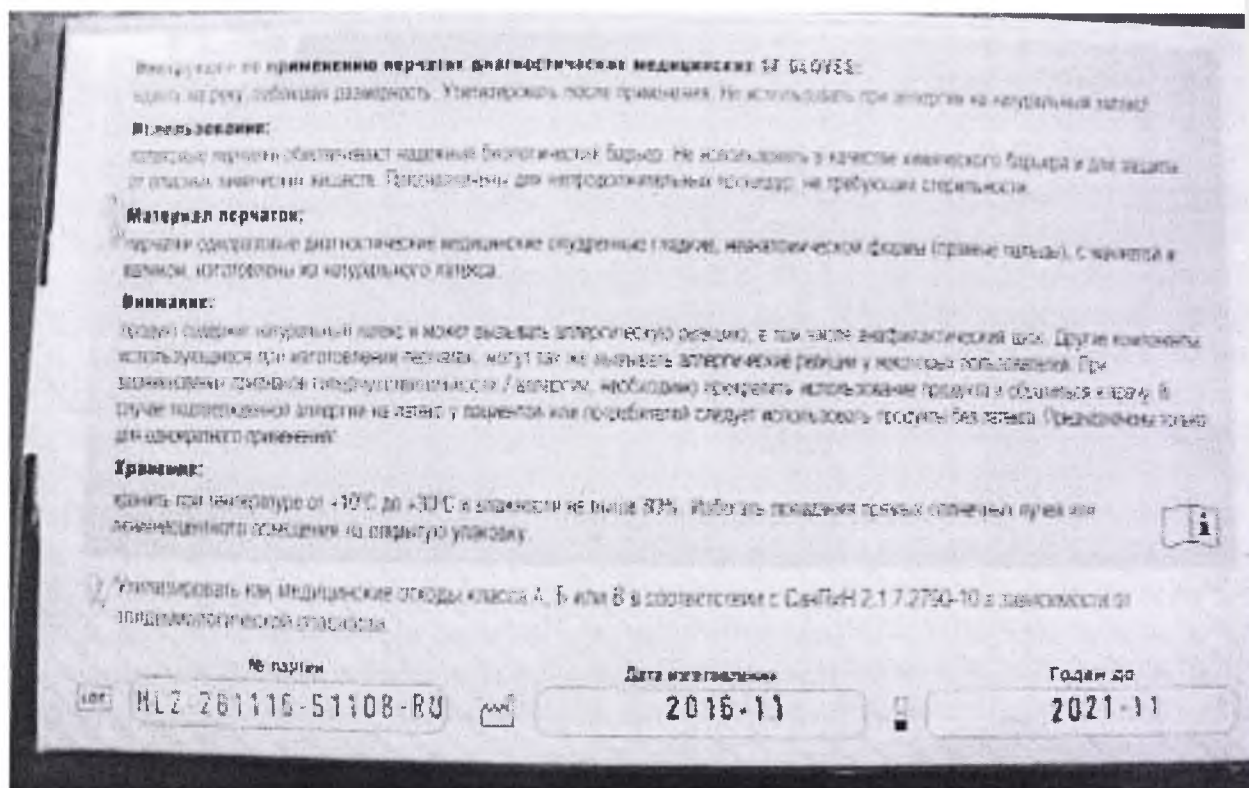

Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, не менее M
 РУ № ФСЗ 2010/07717, «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия

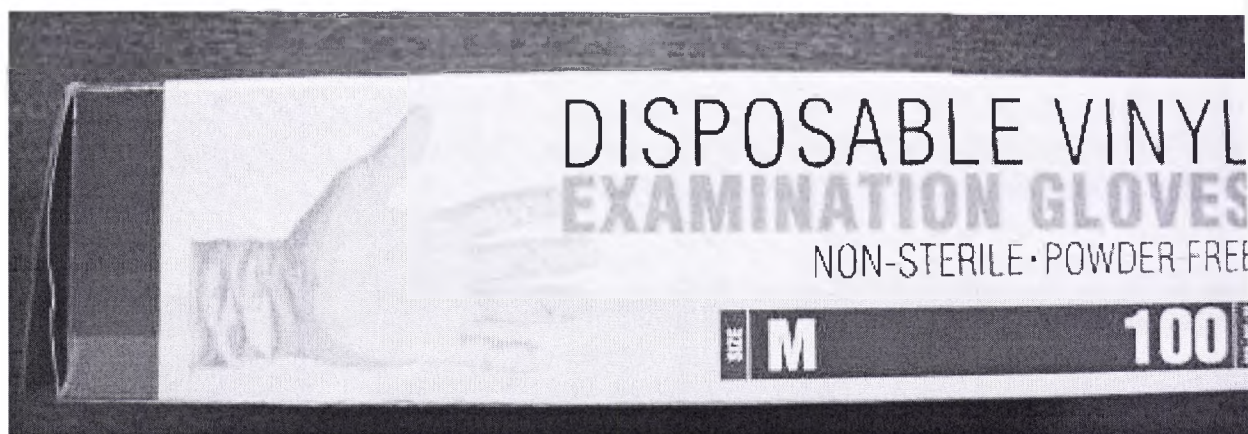

Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, не менее М
РУ № ФСЗ 2010/07717, «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия

ПЕРЧАТКИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВИНИЛОВЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ • OPEN HERE • HIER ÖFFNEN

ПАЗМЕР

VINYL

EXAMINATION GLOVES

NON-STERILE • POWDER-FREE

M

SIZE



ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
SF GLOVES

S 6-7 M 7-8 L 8-9 XL 9-10

RU 1 Не содержит латекса, гипоаллергенно

EN 1 Gledke no natural rubber latex protein, hypoallergenic

DE 1 Frei von Latexproteinen, die Allergien auslösen können



ГОСТ Р 52239
РУ ФСЗ 2010/07717
от 21 апреля 2014



V010316
REF 60.100.003





Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, не менее М

РУ № ФСЗ 2010/07717, «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия



Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, не менее М
РУ ФСЗ 2012/12488, «ТГ МЕДИКАЛ Сдн.Бхд», Малайзия

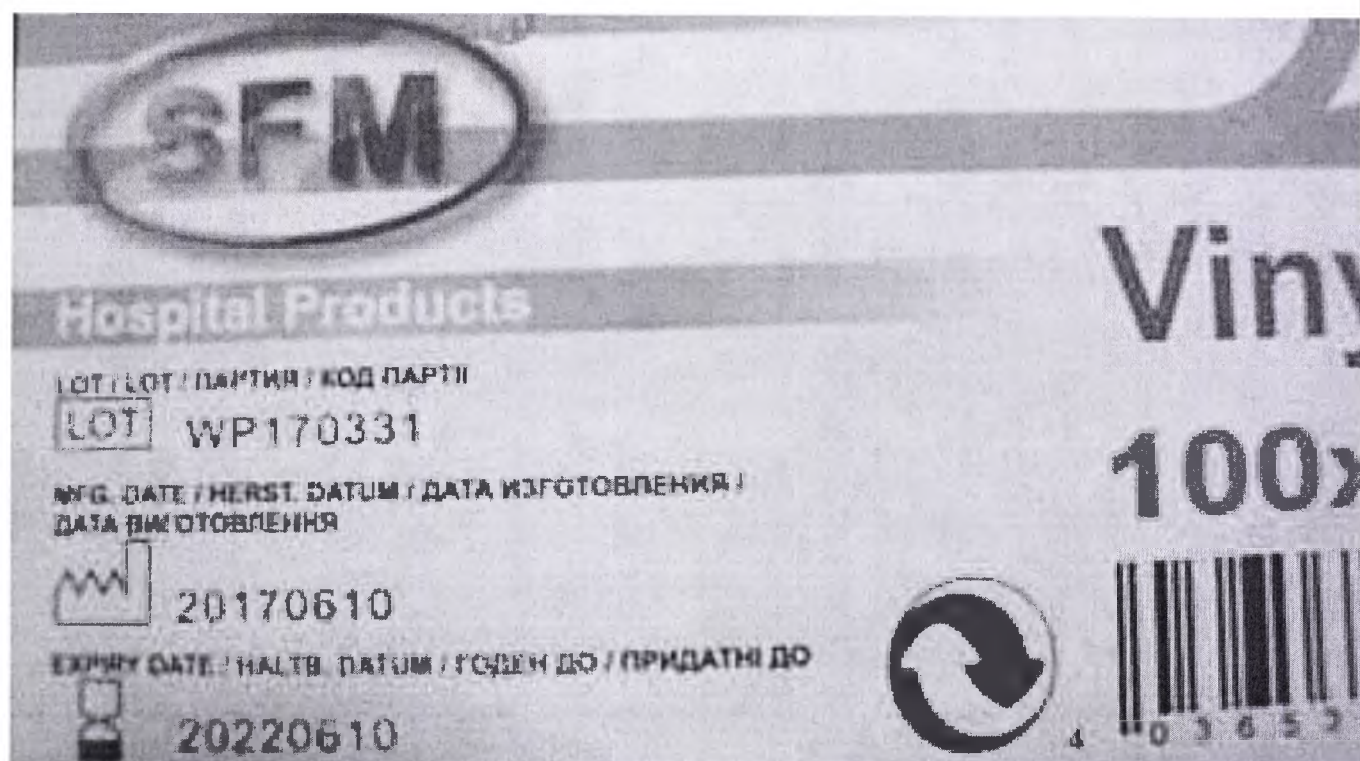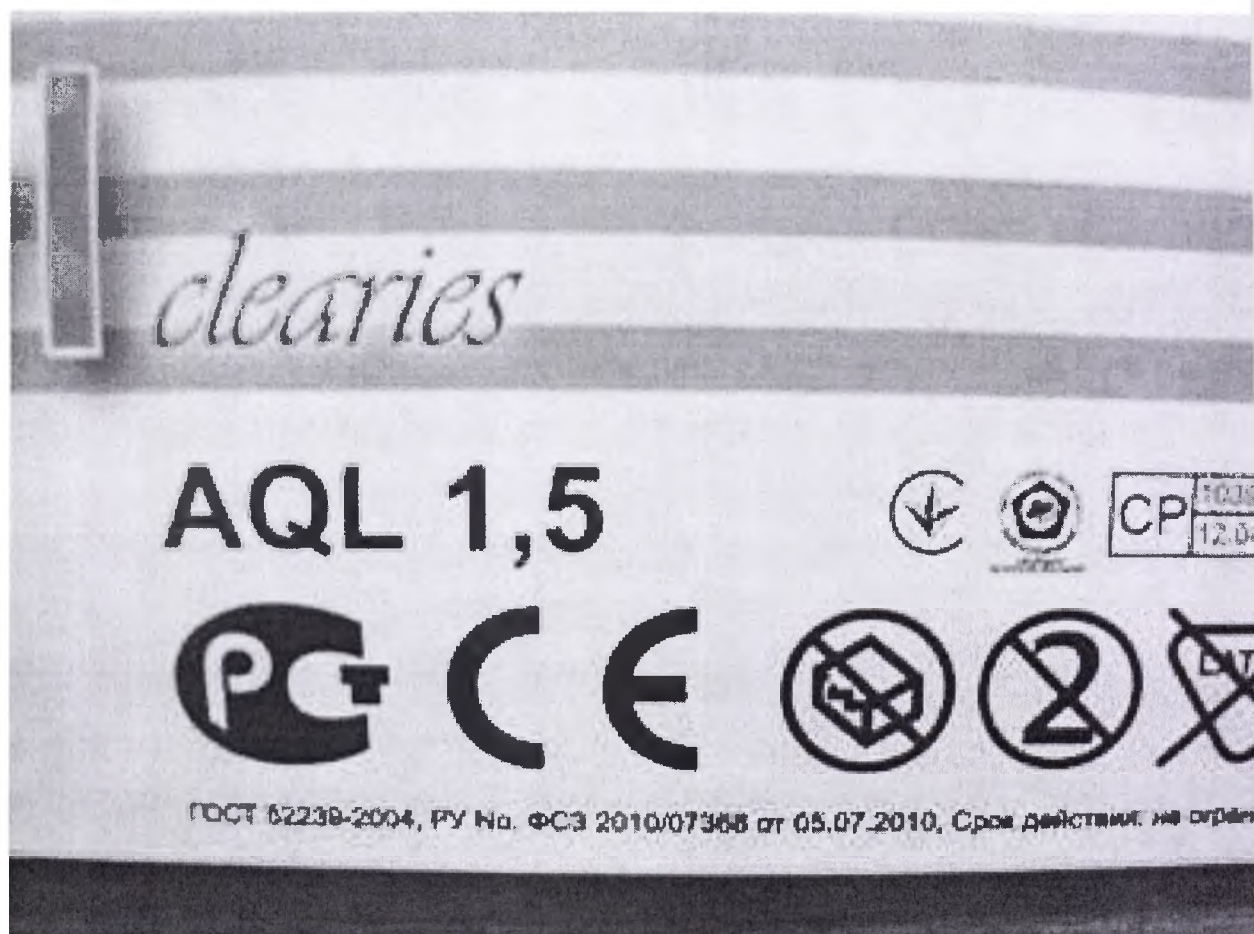

Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2010/07368, «СФМ Госпитал Продактс Гмбх», Германия



(19) *Chen et al.* (2005) and *Chen et al.* (2007) report that the low quantity of *Chen et al.* (2005) and *Chen et al.* (2007) is not a significant predictor of the low quantity of *Chen et al.* (2005) and *Chen et al.* (2007).

114. $\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}^+ \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$ (в кислой среде)
 $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{O}_2$ (разложение перекиси водорода)
 $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + e^-$ (окисление железа)
 $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (восстановление перекиси водорода)
 $\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}^+ \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$ (полное уравнение)
 $2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ (окончательное уравнение)



vinylex® PF

MERCATOR MEDICAL

- 120 beşridiğme şavlıve wıñıwme
 121 powder-free vinyl flowers
 122 pudretke: Vıññıñkashlıve
 123 vıññıñov: şavlıve Beş tıñk
 124 beşridiğme: wıñıwme pudretke
 125 yıtıñk: şavlıve atıñov: ve wıñıwıñ
 126 pıñkemeñte: vıññ keshıñı
 127 pıñkemeñte: vıññ keshıñı
 128 neşırdetke: vıñıñk: şıñıñı
 129 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 130 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 131 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 132 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 133 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 134 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 135 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 136 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 137 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 138 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 139 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 140 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 141 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 142 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 143 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 144 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 145 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 146 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 147 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 148 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 149 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ
 150 şıñıñıñ: vıñıñk: şıñıñıñıñ

last rev. 06/2014

100
by weight

XSD: 2011-01-27 | M7: 10 | 10: 91 | 30: 910

AQL 1.5



85



ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

MERCATORMEDICAL



vinylex®

MERCATORMEDICAL



Перчатки диагностические MERCATOR MEDICAL из натурального латекса и синтетических каучуков (нитрил, акрил, полихлоропрен, полиизопрен) нестерильные. Перчатки диагностические Vinylex PF виниловые неопудренные. Производители: «Меркатор Медикал Лтд.», Таиланд (38/8 Moo 12 Tambon Kongsiraphet, Amphur Rattaphum, Songkhla, Thailand 90180). Неподходящий материал: раствор термоэластопласта поливинилхлорида, внутренний слой – полиуретан. Перчатки диагностические, нестерильные, одноразовые. Структурированные, неопудренные. Приемлемый уровень качества (AQL): 1,5. Соответствие ГОСТ Р 57239-2004. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13339 от 25.11.2012г.

- duży | large
- groß | rolym
- velký | velký
- nagy | didelis
- lles | grande
- mari | velika
- большой | velika
- velký | velký
- великий


L

8-9

vinylex® PF

Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/13339, «Меркатор Медикал Лтд.», Таиланд

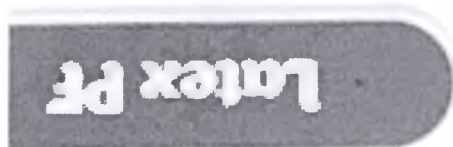

BASIC MEDICAL
total solutions for health care

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ) НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
«BASIC» EXAM PF ЛАТЕКСНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ

Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1071 от 21.08.2013

Производитель: TERANG NUSA SDN. BHD., Млн. Селанг-Б. Пондасан-Ната 1
Регистрарный Центр: 10100 Кинг-Банду, Кантон-Бенгел-Мане, Малайзия
Уполномоченное представительство: ООО «Синтез Фармацевтика»
Россия, 115243, г. Москва, ул. Басманная-Средняя д. 44, к. 10

Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № РЗН 2013/1071, «Теранг Нуса СДН., БХД.», Малайзия

Нитриловые перчатки обеспечивают надежный биологический барьер, но не являются химической защитой. Не предназначены для людей, имеющих аллергическую реакцию на латекс. Обеспечивают комфортную защиту кожи рук. Очень пластичные, плотно облегают руку. Сохраняют высокие тактильные ощущения при любых манипуляциях.

Хранить в сухом месте, вдали от солнечных лучей.



Raysen (Tianjin) Healthcare Products Co., Ltd. (China)
Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс Ко., Лтд. (Китай)

Регистрационное Удостоверение: № ФСЗ 2012/13220
от 02.11.2012

Номер партии:

Дата производства:

Срок годности: 5 лет



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/13220, «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс Ко.Лтд.», Китай

М

Размер:

100 шт.

Перчатки смотровые нитриловые
нестерильные неопудренные
текстурированные

Размер: **М**

Нитриловые перчатки,
текстурированные на пальцах

L39/SH-9
(1) - R1

Перчатки смотровые нитриловые нестерильные
неопудренные текстурированные

Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/13220, «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфка Продактс Ко.Лтд.», Кита



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: относительная влажность до 85%, температура 0 - 35С.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием следует удалить пудру стерильным тампоном.

Срок годности: 5 лет

ВНИМАНИЕ: Продукт содержит натуральные латексы, который может вызвать аллергическую реакцию.

ПЕРЧАТКИ ГЛОБАЛ

100 штук

AQL 1.5

СМОТРОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ГЛАДКИЕ ОПУДРЕННЫЕ
для одноразового использования

- XS (5-6) ☐
S (6-7) ☐
M (7-8) ☒
L (8-9) ☐
XL (9-10) ☐

СМОТРОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ

По заказу ООО "Фарм-Глобал" (495) 786-34-91
Россия, г.Москва, ул.Мясницкая, 30/1/2-стр.2
www.pharmglobal.ru pharm-global@mail.ru
Изготовлено "Tan Sin Lian Industries SDN. BHD." (Малайзия)
Р.У. ФСЗ 2010/06671 от 28.09.2012


ISO 13485
ISO 9001



ГОДЕН ДО: DECEMBER 2017

Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2010/06671, «Тан Син Лиан Индастриз Сдн. Бдх.», Малайзия

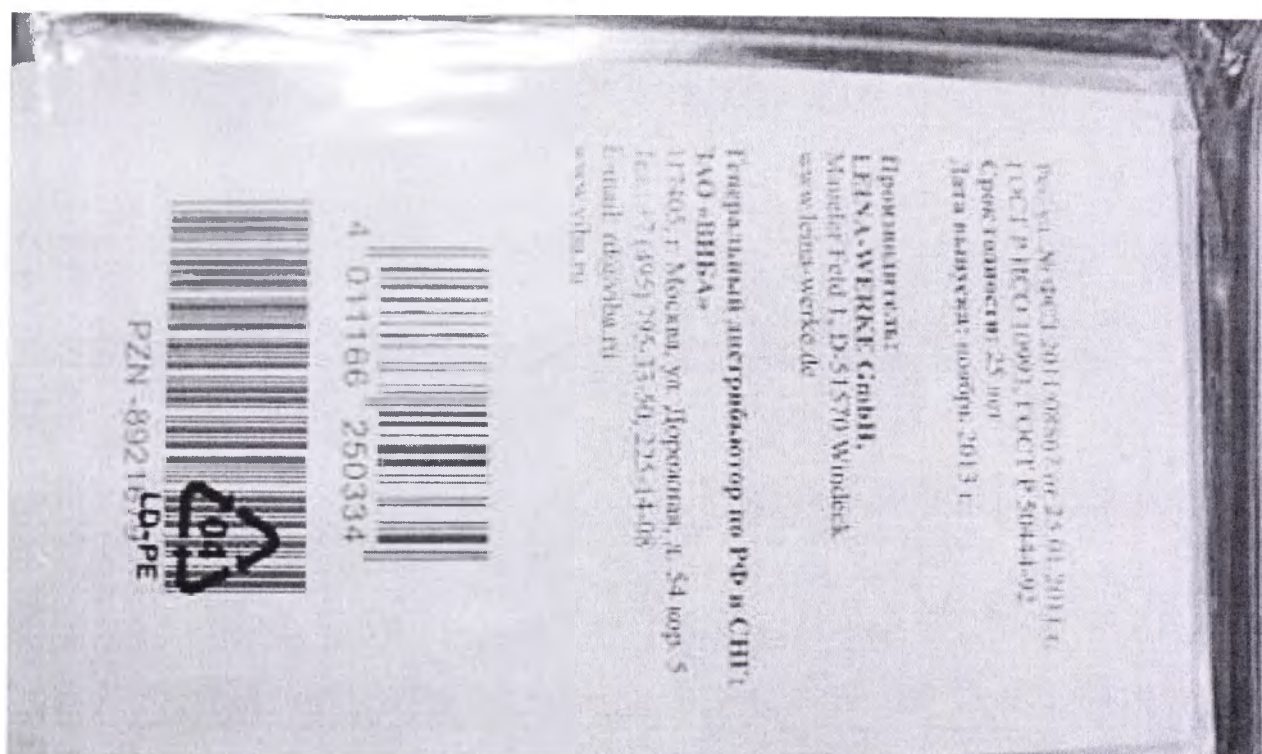

Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ № ФСЗ 2011/08867, Лайна-Верке ГмбХ, Германия

Рег. уд. № РЗН 2015/3146 от 07.10.2015 г.
ТУ 9398-001-27955879-2014
ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92
Срок годности: 15 лет
Дата изготовления: декабрь 2016 г.
Хранить при температуре: от -50 °С до +40 °С
(условия хранения 2 по ГОСТ 15150)
Утилизировать в соответствии с СанПин
2.1.7.1386-03 и СанПин 2.1.7.2790-10

Производитель:
ЗАО «ВИБА»
Россия,
117405, г. Москва,
ул. Дорожная, д. 54 корп. 5
Тел.: (495) 795-3350, (495) 225-1408
E-mail: viba@viba.ru
www.viba.ru



LD-PE


ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

для предохранения
от переохлаждения или перегрева

160x210 см серебристый/золотой

Защита от переохлаждения,
серебристой стороной к телу:

1. Расстелить спасательное покрывало;
2. Уложить пострадавшего поверх покрывала;
3. Обернуть покрывалом, оставив лицо открытым;
4. Зафиксировать край покрывала липкой лентой;
5. Вызвать «Скорую помощь».

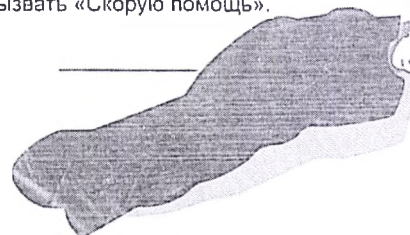

Защита от перегрева,
золотистой стороной к телу:


1. Накрыть пострадавшего покрывалом, обеспечив свободный доступ воздуха к телу;
2. Вызвать «Скорую помощь».

Экстренная транспортировка:

Удерживать покрывало с пострадавшим за 4 угла.
Избегайте повреждения покрывала острыми предметами!

Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

ТУ РЗН 2015/3146, ЗАО ВИБА, Россия

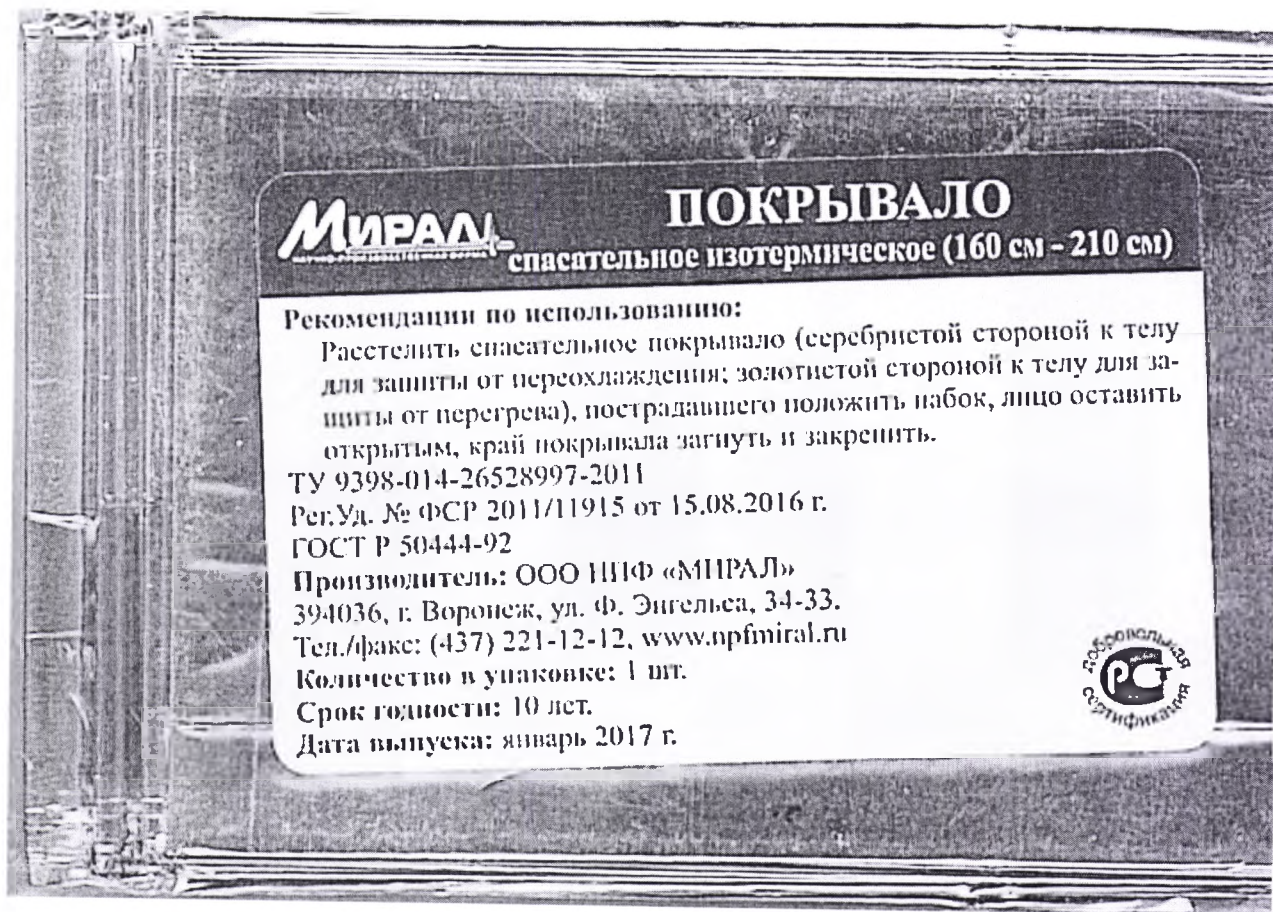

Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ № ФСР 2011/11915, ООО «Мирал», Россия

ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ

от перегрева или переохлаждения пострадавших:


(LIFECOVER/RETTUNGSDECKE)

160 x 210 см золотистый/серебристый

Защита от перегрева:

Золотистой стороной к телу.

Путем светоотражения солнечных
лучей тело предохраняется от нагрева.

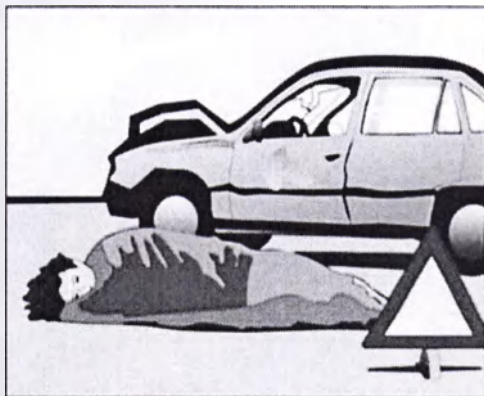

Защита от переохлаждения:

Серебристой стороной к телу.

Путем рефлектирования сохраняется
тепло тела. Опасность переохлаждения
уменьшается.

Правило пользования:


1. Расстелить спасательное покрывало
2. Пострадавшего положить набок.
Лицо оставить открытым
3. Конец покрывала загнуть и закрепить
4. Обеспечить вызов скорой помощи



Произведено в России

ООО «Шанс», 125047, г. Москва
пл. Тверская Застава, д. 3, оф. 8
Тел.: +7(909) 656-9867

ГОСТ: Р ИСО 10993.1-99.



4 606735 669015 >

ТУ 9398-001-74050508-2005

Рег. уд. Мин. Здрав. РФ № ФСР 2010/06812 от 12.02.2010 г.

Характеристика и область применения:

- масса — 60 г.
- толщина 12 мк
- размер 210x160 см
- высокая прочность позволяет
переносить пострадавшего
весом до 80 кг, взявшись
за четыре угла покрывала (рис. 1)
- сохраняет тепло до 20 часов при низких
температурах (см. Правило пользования)
- Является незаменимым средством для людей,
попавших в сложные или чрезвычайные
ситуации, в которых могут оказаться водители
автомобилей и пассажиры, шахтеры, рыбаки,
альпинисты, охотники, военнослужащие и рабочие
на объектах Сибири и севера.



(Рис. 1)

Примечание:

- а) недопустимо переносить пострадавших, имеющих иммобилизацию
конечностей жесткими шинами.
- б) при массе тела более 80 кг перенос пострадавшего осуществлять на двух
сплошных покрывалах.

Дата выпуска: январь 2018г


Срок годности: 15 лет

Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см


РУ № ФСР 2010/06812, ООО «ШАНС», Россия



Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного
материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 x 11,0 см
РУ № ФСР 2009/05438, ООО «М.К. Асептика», Россия

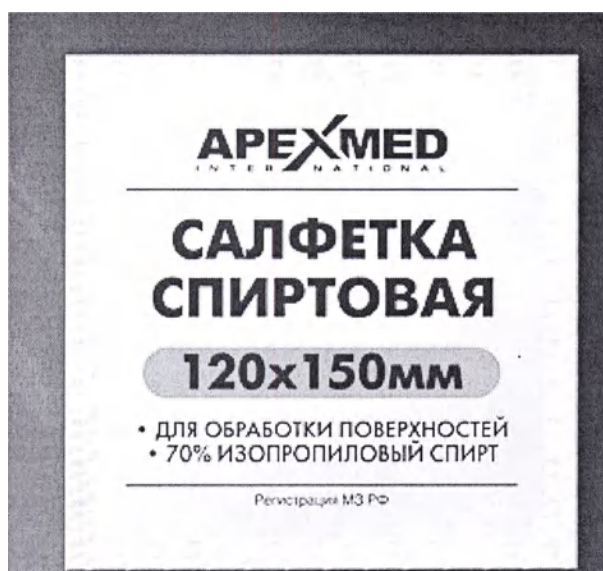

Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного
материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 x 11,0 см
РУ № ФСЗ 2009/05782, «Тайчжоу Канлин Хеалс Протекши Продактс Ко.,Лтд.», Китай

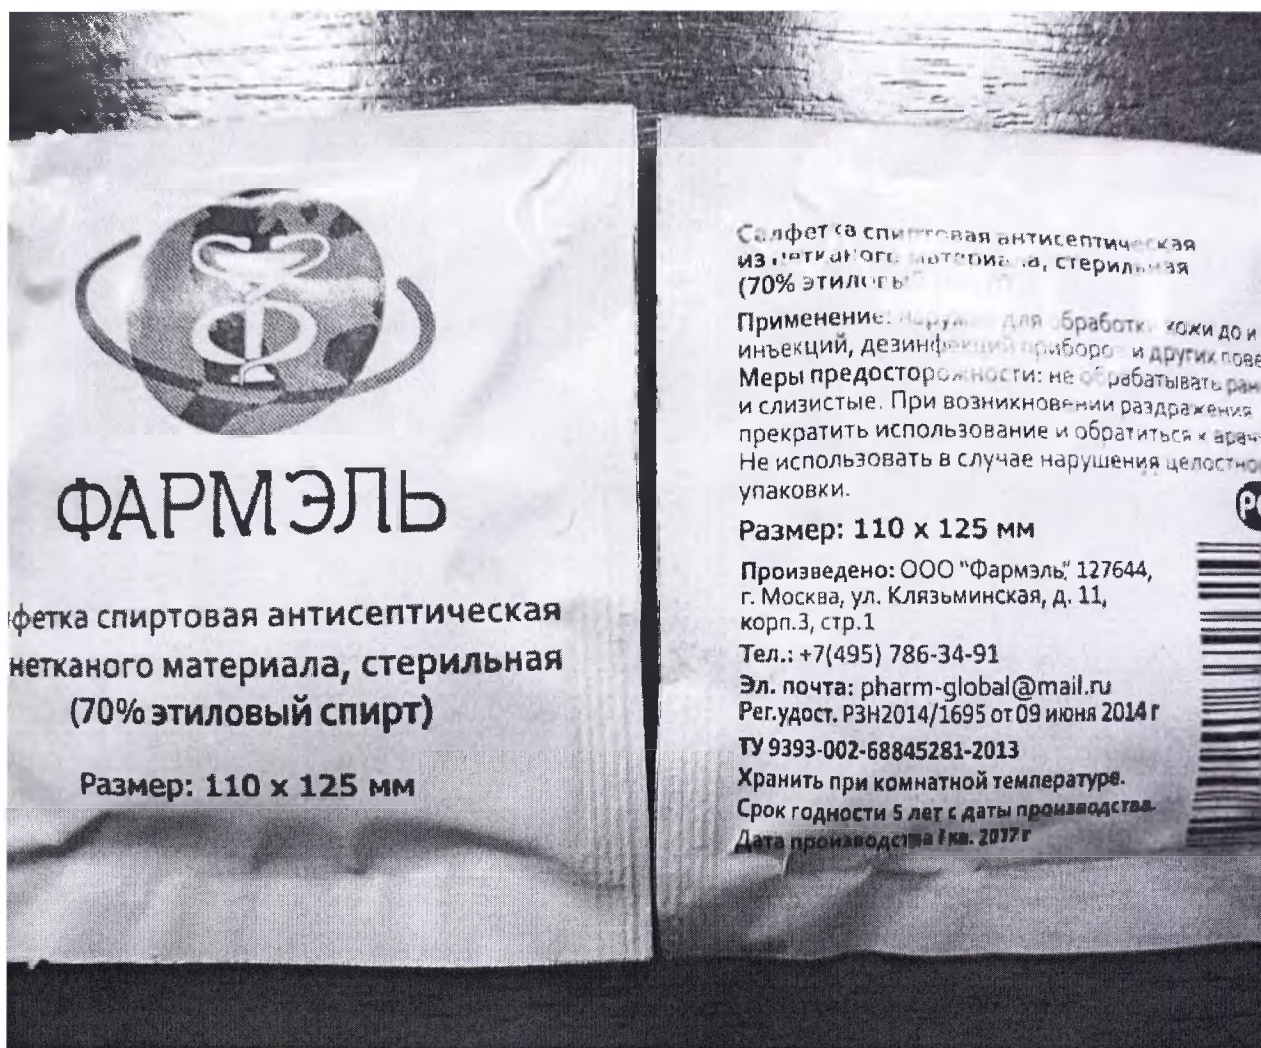

Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного
материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 x 11,0 см
РУ № РЗН 2014/1695, ООО «Фармель», Россия



**СРЕДСТВО
ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА
С РАСТВОРОМ АММИАКА**



Назначение: для стимуляции дыхания при обморочном состоянии.

Способ применения: вскрыйте упаковку, осторожно поднесите к носу на 0,5-1 секунду.

Состав: нетканая основа размер 130 мм x 180 мм, пропитанная 2% раствором аммиака.

Меры предосторожности: использовать только по назначению.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

ТУ 9393-052-12965160-2015

РУ № РЗН 2013/715 от 04.12.2015 г.

(срок действия не ограничен)

СМК соответствует ГОСТ ISO 9001-2011

Условия хранения: при температуре от +5° до +25°.

Дата изготовления: см. на шве.

Срок годности: 3 года.

СЕРИЯ САЛФЕТОК АППОЛО:



**САЛФЕТКИ
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
СПИРТОВЫЕ**



**САЛФЕТКИ
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА**

Произведено: ООО «ТД «АППОЛО»

Россия, 111123, г. Москва,

Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20

Тел./факс: (495) 380-21-47, 215-08-13

e-mail: info@appolo.ru, www.appolo.ru



С/РАР



Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака, не менее 12,5x11,0 см

РУ № РЗН 2013/715, ООО «ТД «АППОЛО», Россия


противообморочная

Способ применения при обморочном состоянии:

сразу после вскрытия пакета
салфетку осторожно поднести к
носовым отверстиям (на 0,5 - 1 с).
Предназначена для однократного
применения.

Условия хранения 5 (ОЖ4)
по ГОСТ 15150 (От -50°C до +50°C)

Срок годности 5 лет.

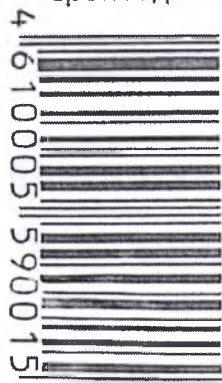

Номер
партии:

Дата
изготовления:

противообморочная

противообморочная

ООО «РАДИАН МЕД», Россия, 300004, г. Тула,
Торховский пр-д, д. 10.
тел.: (499) 685-17-73

Адрес производства: ООО «Тульская
фармацевтическая фабрика», Россия, 300004,
г. Тула, ул. Торховский пр-д, д. 10.

Медицинское изделие

Салфетка для стимуляции дыхания "РАДИАН"

с 2% раствором аммиака водного

1 шт

ТУ 9398-001-86566053-2009
РУ № ФСР 2009/06146 от 30 октября 2014 г.

Типоразмер изделия - большой

противообморочная

Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака, не менее 12,5x11,0 см

РУ № ФСР 2009/06146, ООО «Радан-МЕД», Россия




Блок бумажных бланков, не менее 30 листов, размер не менее А7



Маркер перманентный черного цвета



Карандаш

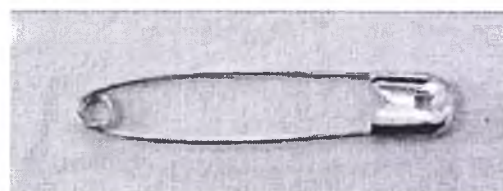

Английская булавка стальная со спиралью, не менее 38 мм



Мешок полиэтиленовый с зажимом, не менее 20 см х 25 см



**Общий вид Укладки санитарной сумки «ФЭСТ» в транспортной таре
с маркировкой (ящик из картона)**

Прошито, пронумеровано,
опечатано

81/Васильев от 07.07.18 листов

Директор Михайлов В.В.

