


Внешний вид индикатора биологического одноразового для контроля паровой стерилизации
«iPACK BIO-STEAM» (АЙПАК БИО-СТИМ)



Внешний вид флакона со стерильной цветной питательной средой
для индикатора биологического одноразового для контроля паровой стерилизации
«РАСК BIO-STEAM» (АЙПАК БИО-СТИМ)

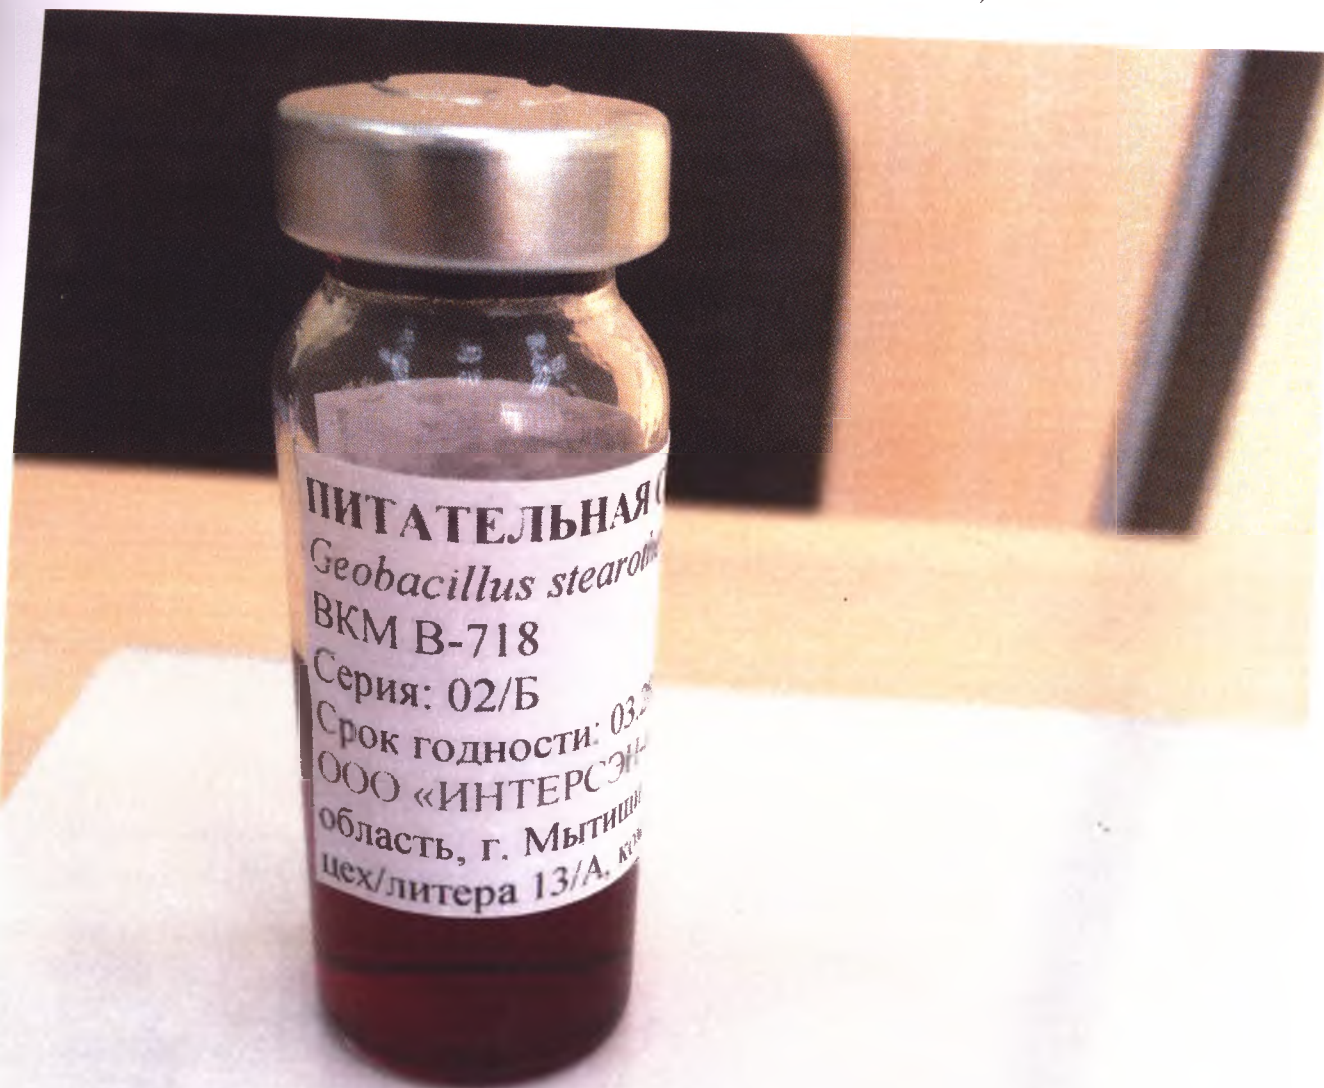

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА для
Geobacillus stearothermophilus
ВКМ В-718
Серия: 02/Б
Срок годности: 03.2020 г.
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», 141004, Московская
область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комн. 9-13

Внешний вид пакета со стерильной пробиркой Эппендорфа для контроля питательной среды для индикатора биологического одноразового для контроля паровой стерилизации «iPACK BIO-STEAM» (АЙПАК БИО-СТИМ)




«iPACK BIO-STEAM» (АЙПАК БИО-СТИМ)



Внешний вид индикатора биологического одноразового для контроля воздушной стерилизации
«iPACK BIO-DRY» (АЙПАК БИО-ДРАЙ)



Внешний вид флакона со стерильной цветной питательной средой
для индикатора биологического одноразового для контроля воздушной стерилизации
«iPACK BIO-DRY» (АЙПАК БИО-ДРАЙ)

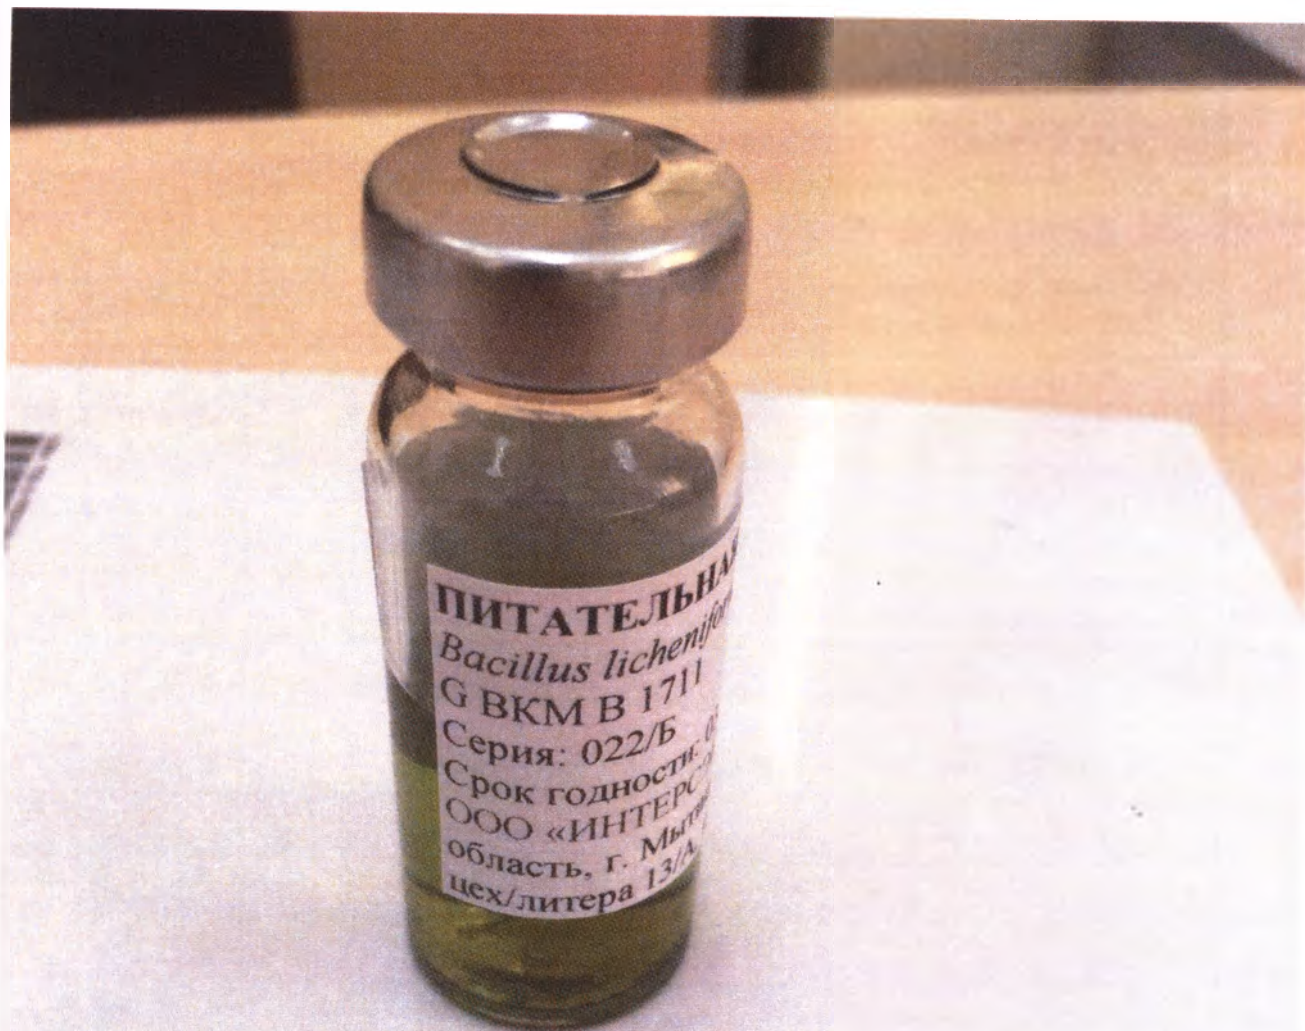

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА для
Bacillus licheniformis
G VKM B 1711
Серия: 022/Б
Срок годности: 03.2020 г.
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», 141004, Московская
область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комн. 9-13

Внешний вид пакета со стерильным флаконом для контроля питательной среды и резиновыми пробками для индикатора биологического одноразового для контроля воздушной стерилизации «iPACK BIO-DRY» (АЙПАК БИО-ДРАЙ)



Внешний вид шприца (с иглой) однократного применения для розлива питательной среды для индикатора биологического одноразового для контроля воздушной стерилизации «iPACK BIO-DRY» (АЙПАК БИО-ДРАЙ)



Внешний вид индикатора биологического однократного для контроля стерилизации оксидом этилена «iPACK BIO-EO» (АЙПАК БИО-ЭО)



Внешний вид флакона со стерильной цветной питательной средой для индикатора биологического одноразового для контроля стерилизации оксидом этилена «iPACK BIO-EO» (АЙПАК БИО-ЭО)



ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА для
Bacillus subtilis
В 168 ВКПМ В 10020
Серия: 025/Б
Срок годности: 01.2020 г.
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», 141004, Московская
область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комн. 9-13


Внешний вид шприца (с иглой) однократного применения для контроля питательной среды для индикатора биологического одноразового для контроля стерилизации оксидом этилена «iPACK BIO-EO» (АЙПАК БИО-ЭО)



Внешний вид индикатора биологического одноразового для контроля газовой (пароформальдегидной) стерилизации «iPACK BIO-FORM» (АЙПАК БИО-ФОРМ)




Внешний вид флакона со стерильной цветной питательной средой
для индикатора биологического одноразового для контроля
газовой (пароформальдегидной) стерилизации «IPACK BIO-FORM» (АЙПАК БИО-ФОРМ)

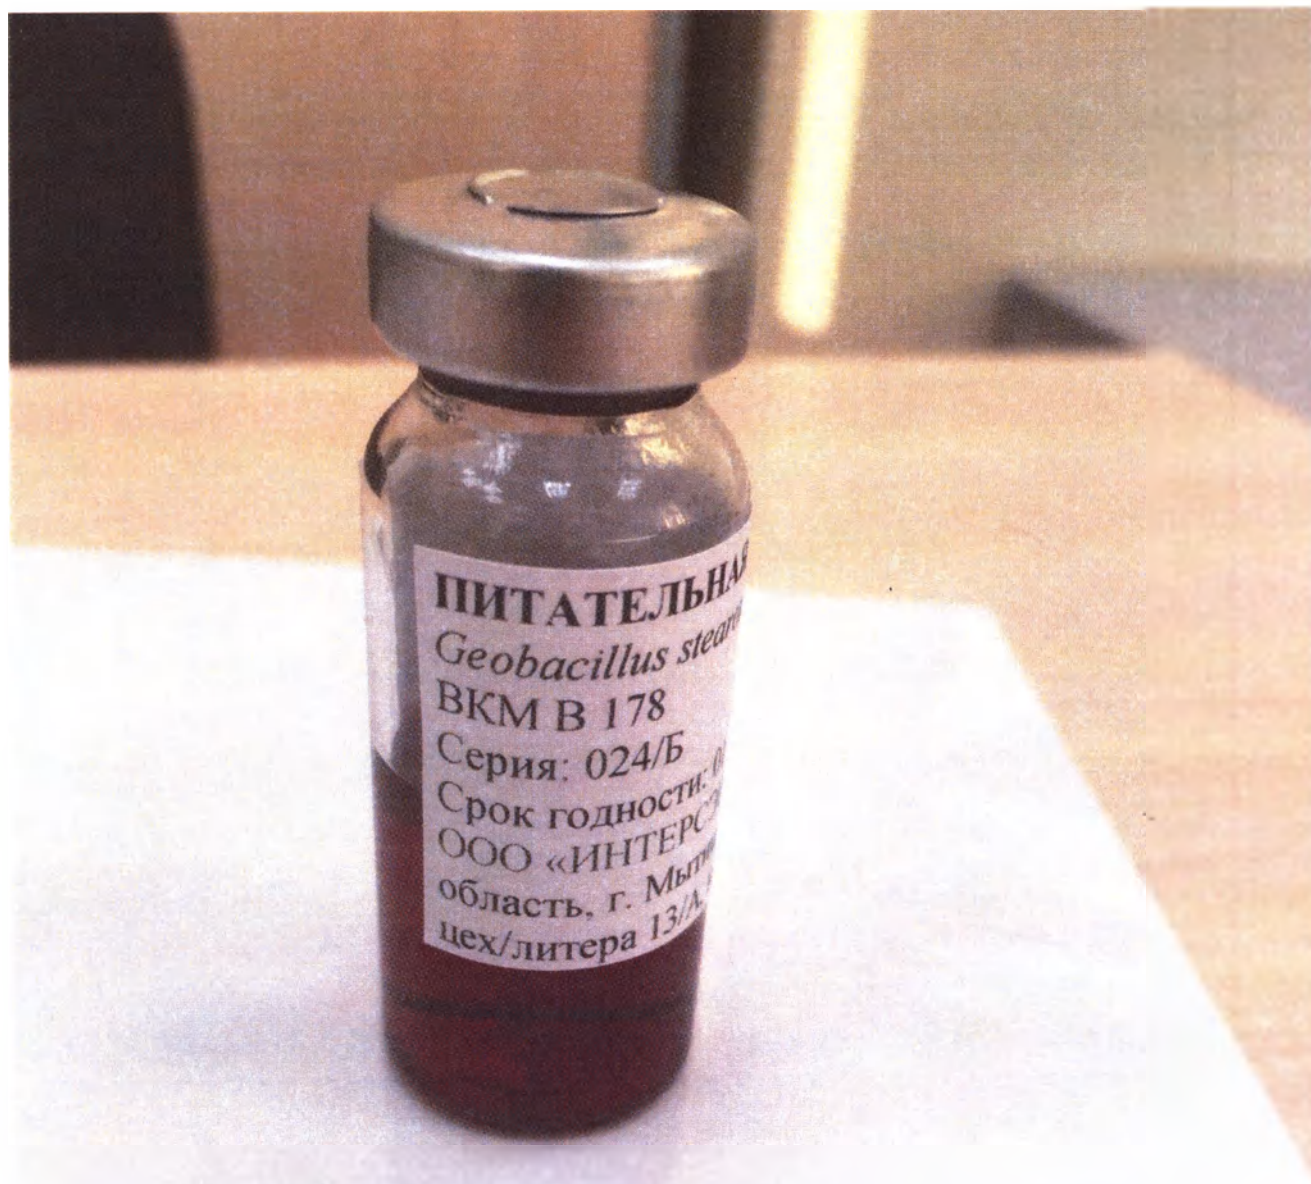

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА для
Geobacillus stearothermophilus
ВКМ В 178
Серия: 024/Б
Срок годности: 01.2020 г.
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», 141004, Московская
область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19,
цех/литера 13/А, комн. 9-13

Внешний вид шприца (с иглой) однократного применения для контроля питательной среды для индикатора биологического одноразового для контроля газовой (пароформальдегидной) стерилизации «iPACK BIO-FORM» (АЙПАК БИО-ФОРМ)

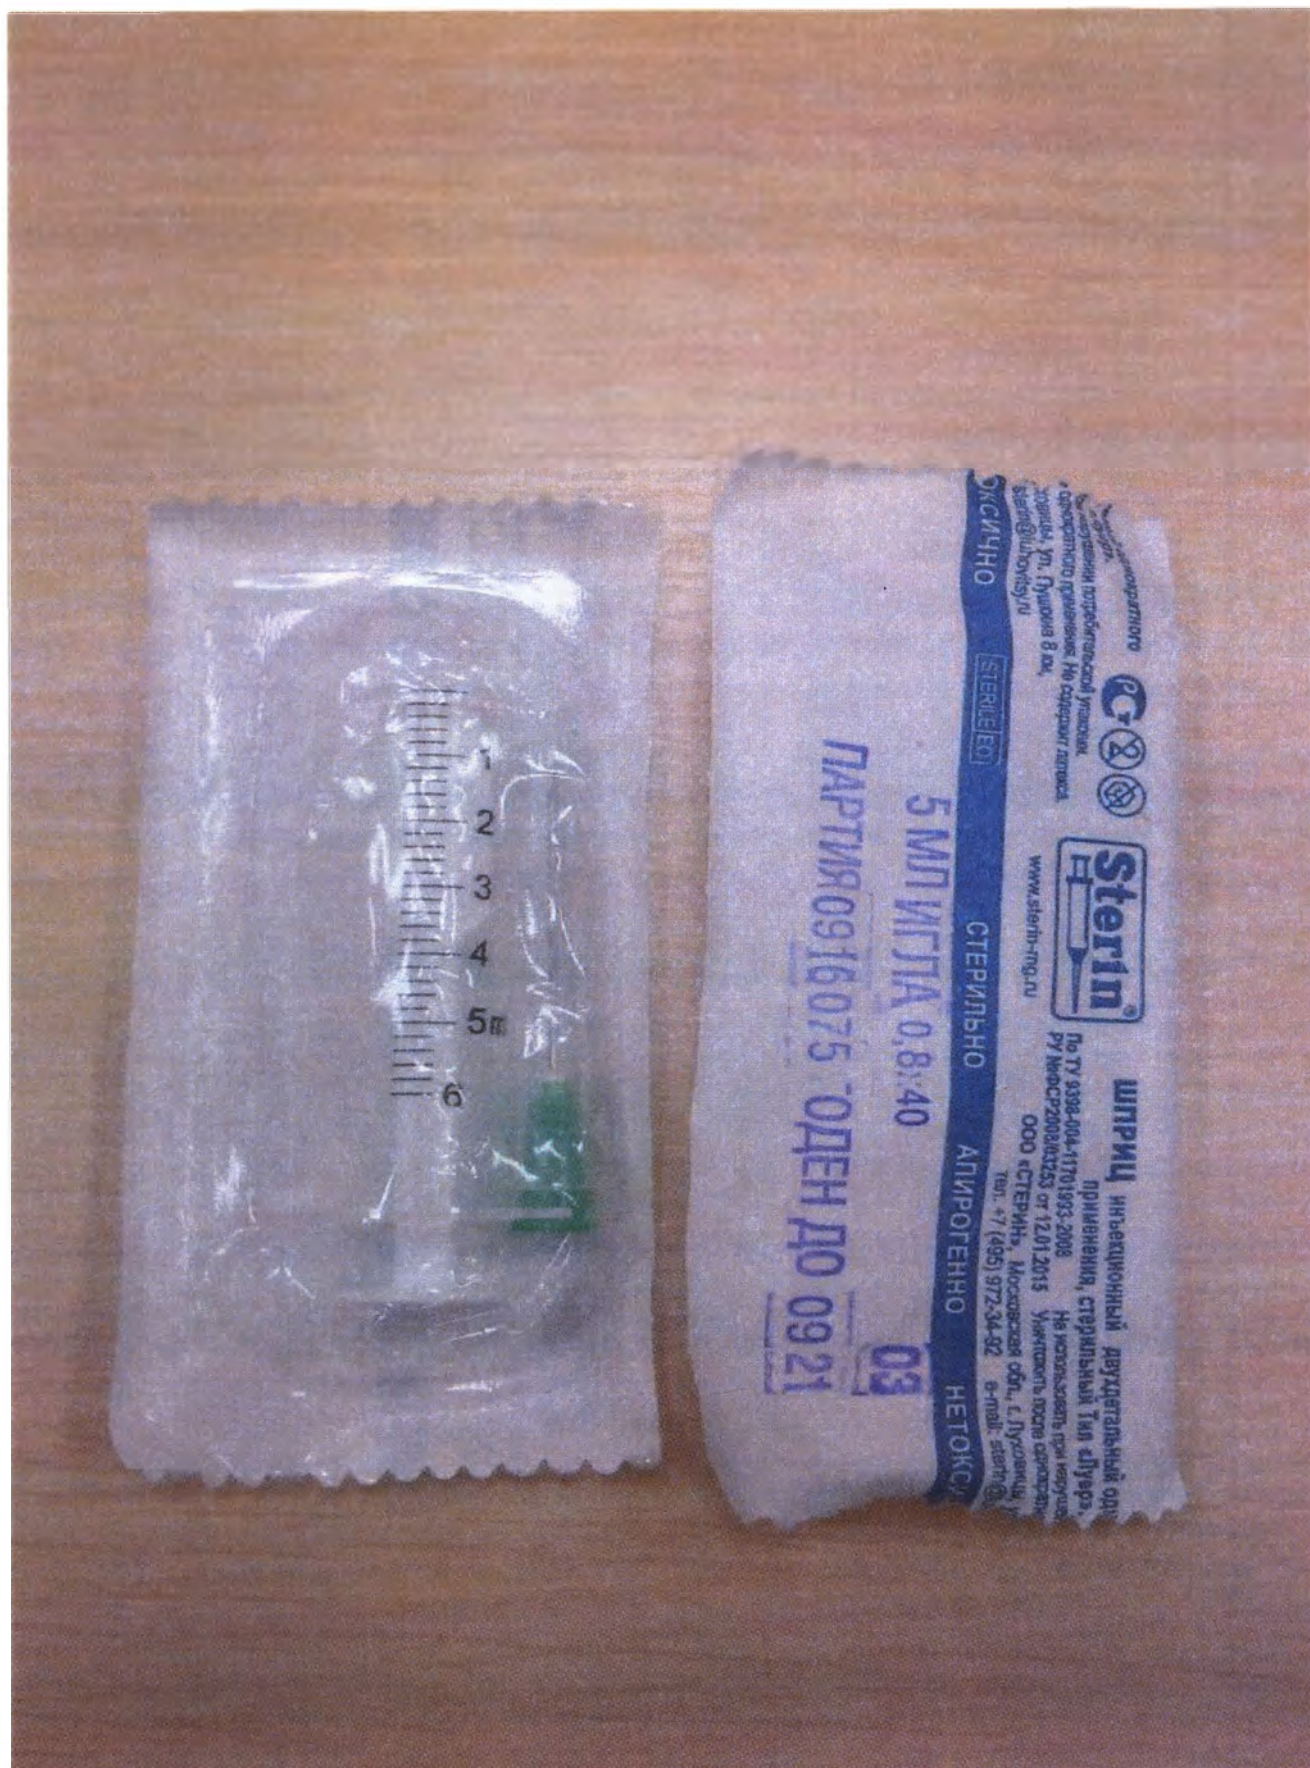


Внешний вид индикатора биологического автономного одноразового
для контроля паровой стерилизации «iPACK BIO-AUTO S» (АЙПАК БИО-АУТО С)



ПАР «iPACK BIO-AUTO S»
Geobacillus
stearothermophilus
ВКМ В 718
Серия: 029/Б
Срок годности: 02.2020 г.
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»,
141004, Московская область, г. Мытищи,
ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комн. 9-13

Внешний вид ломателя пластикового для индикатора биологического автономного одноразового для контроля паровой стерилизации «iPACK BIO-AUTO S» (АЙПАК БИО-АУТО С)

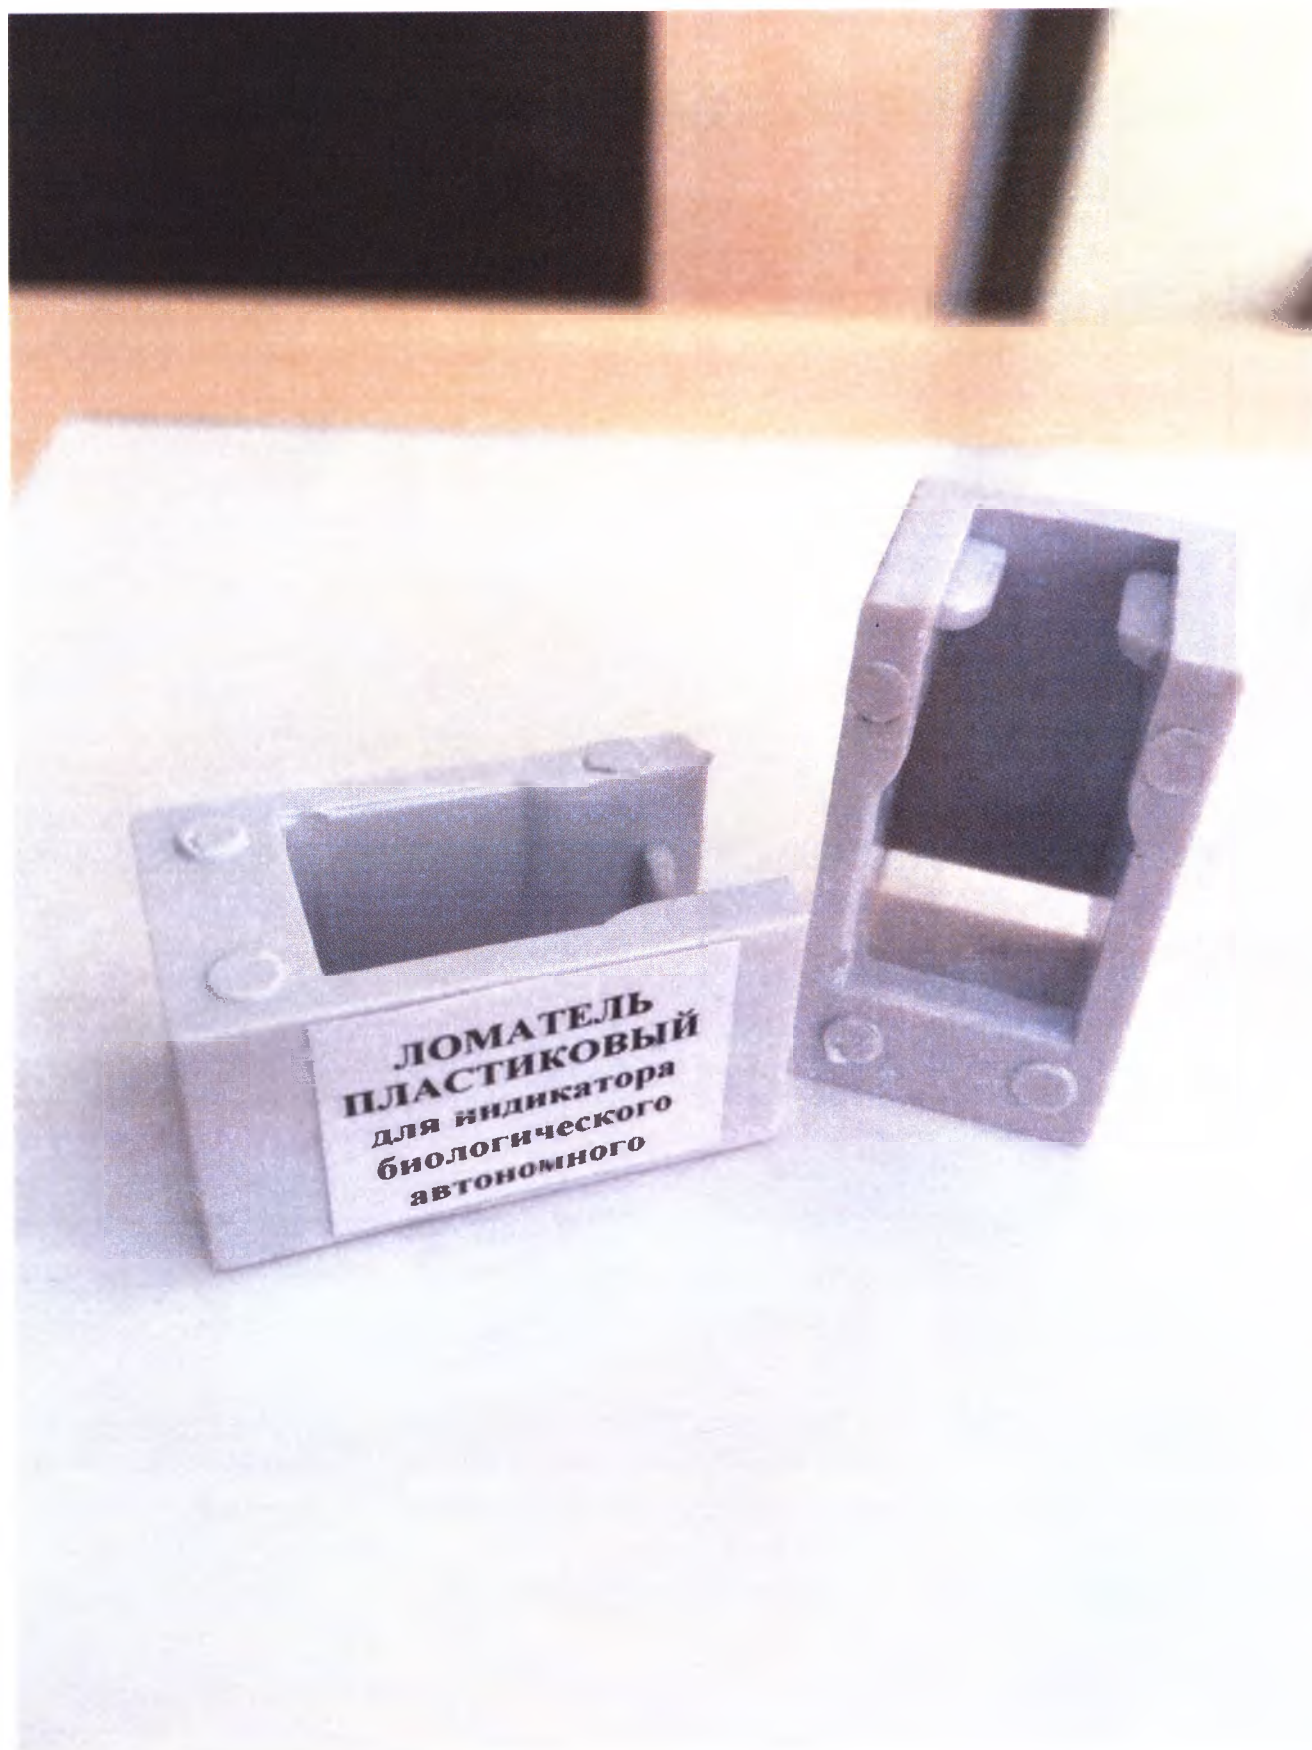

Внешний вид индикатора биологического автономного одноразового для контроля стерилизации оксидом этилена «iPACK BIO-AUTO EO» (АЙПАК БИО-АУТО ЭО)



Внешний вид ломателя пластикового для индикатора биологического автономного одноразового для контроля стерилизации оксидом этилена «iPACK BIO-AUTO EO» (АЙПАК БИО-АУТО ЭО)



Внешний вид индикатора биологического автономного одноразового для контроля стерилизации парами перекиси водорода «iPACK BIO-AUTO VH2O2» (АЙПАК БИО-АУТО ПЕР)



Внешний вид ломателя пластикового для индикатора биологического автономного одноразового
для контроля стерилизации парами перекиси водорода
«iPACK BIO-AUTO VH2O2» (АЙПАК БИО-АУТО ПЕР)



Пронумеровано, прошито,
скреплено печатью 20 листов

Генеральный директор
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» Д.А. Куршин Д.А. Куршин

