

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Набор для количественного определения РНК вируса Гепатита
С в сыворотке и плазме крови методом ПЦР в реальном вре-
мени AccuPower HCV
(для « in vitro » диагностики)**

**«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "ЛАБТРОНИКА"**



Григорян А. Р.

Набор для количественного определения РНК вируса Гепатита С в сыворотке и плазме крови методом ПЦР в реальном времени AssuPower HCV
(для «in vitro» диагностики)





- HCV SPC1 – 1 пробирка (1,3 мл);
- HCV SPC2 – 1 пробирка (1,3 мл);
- HCV SPC3 – 1 пробирка (1,3 мл);
- HCV SPC4 – 1 пробирка (1,3 мл);
- HCV SPC5 – 1 пробирка (1,3 мл).



Низко позитивный контроль HCV PC (LPC) – 3 пробирки (по 1,3 мл)

Высоко позитивный контроль HCV PC (HPC) – 3 пробирки (по 1,3 мл)




Негативный контроль NTC – 3 пробирки (по 1,3 мл)



Буфер SL – 2 пробирки (по 1,3 мл)



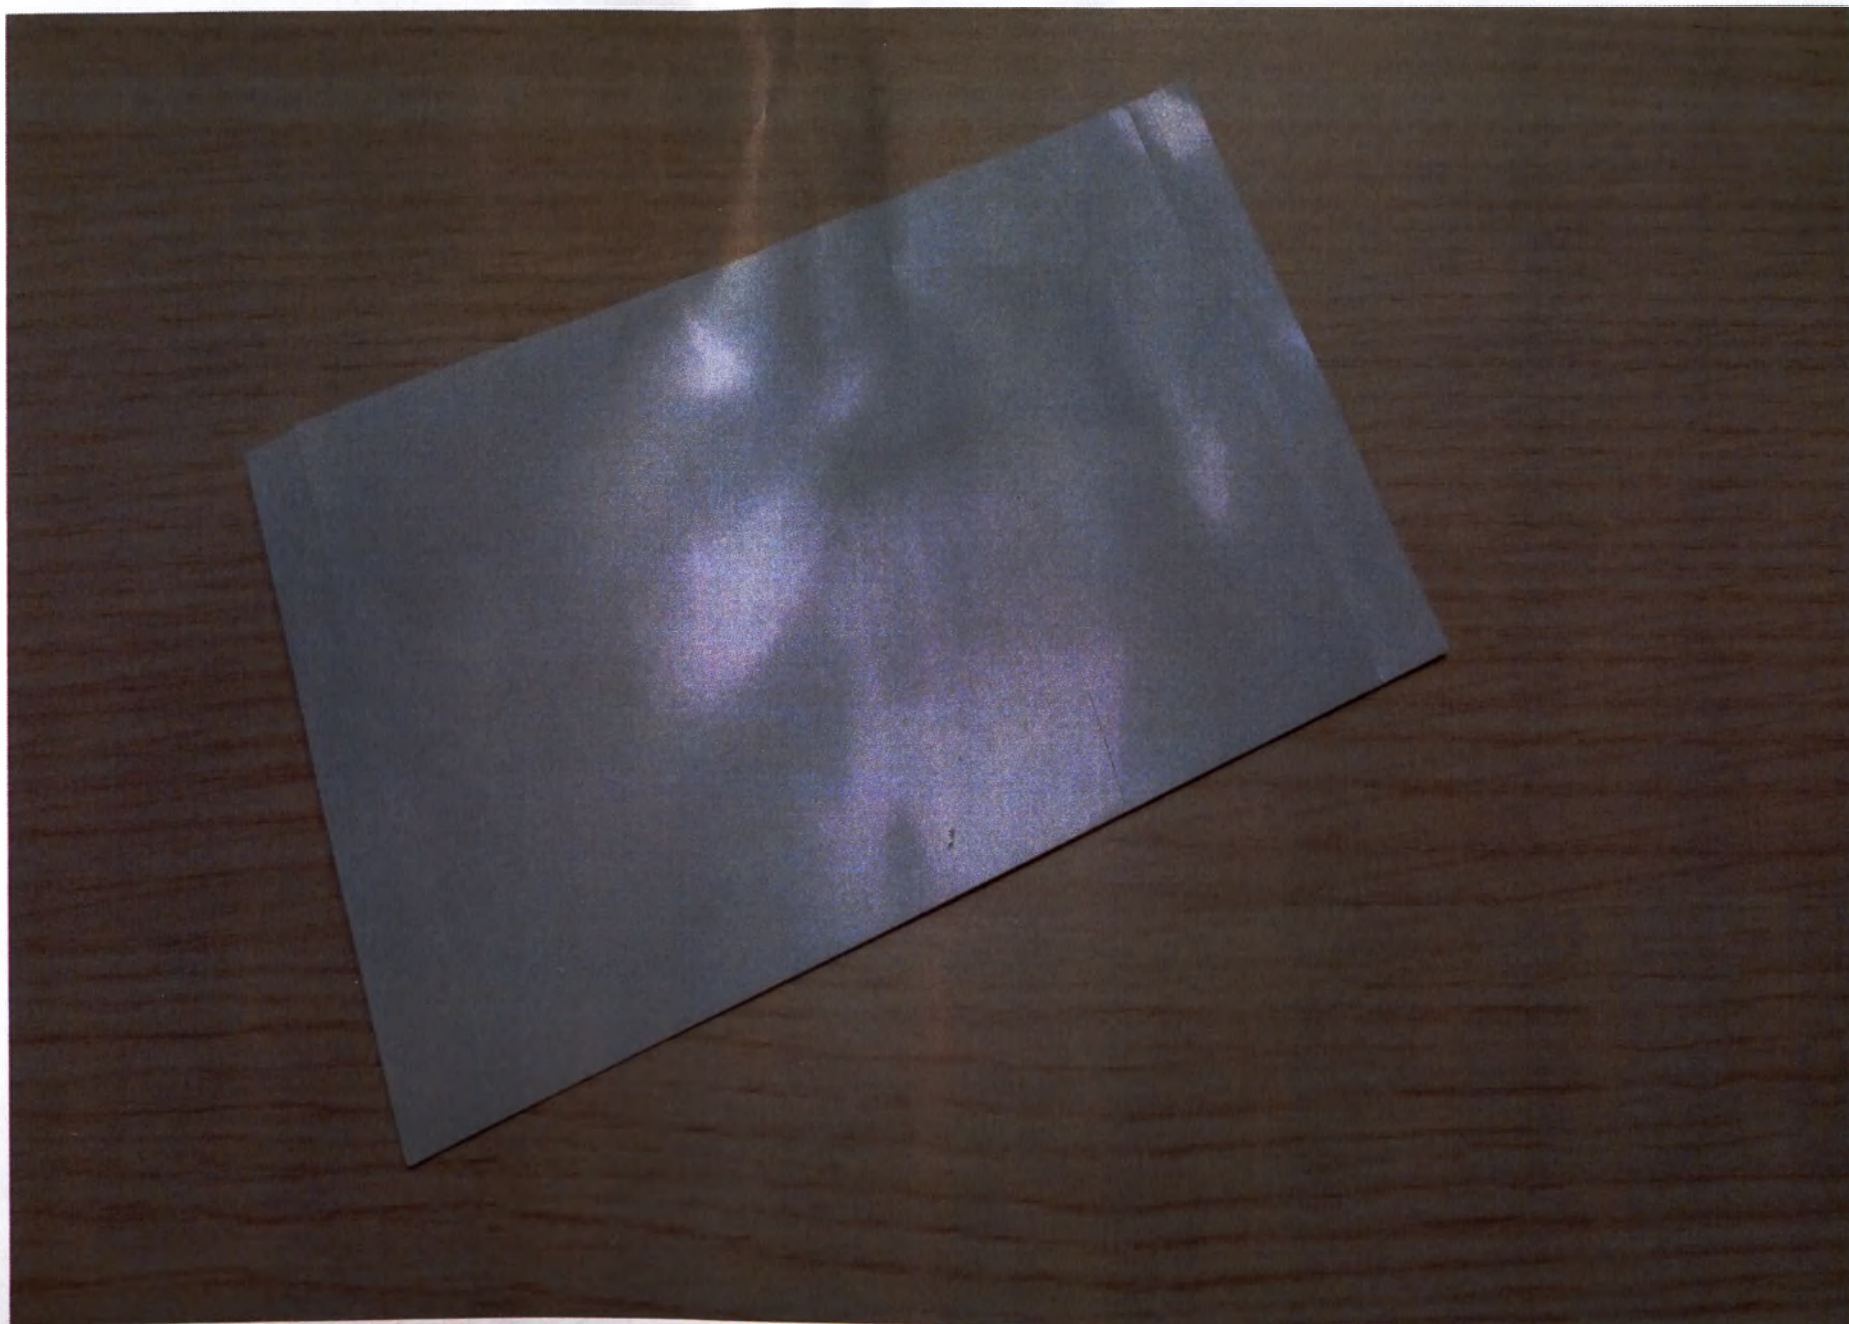

Прошито и пронумеровано 8 листов



Генеральный директор
ООО "ЛАБТРОНИКА"
А.Р.Григорян