





Бормашина электрическая с микромотором



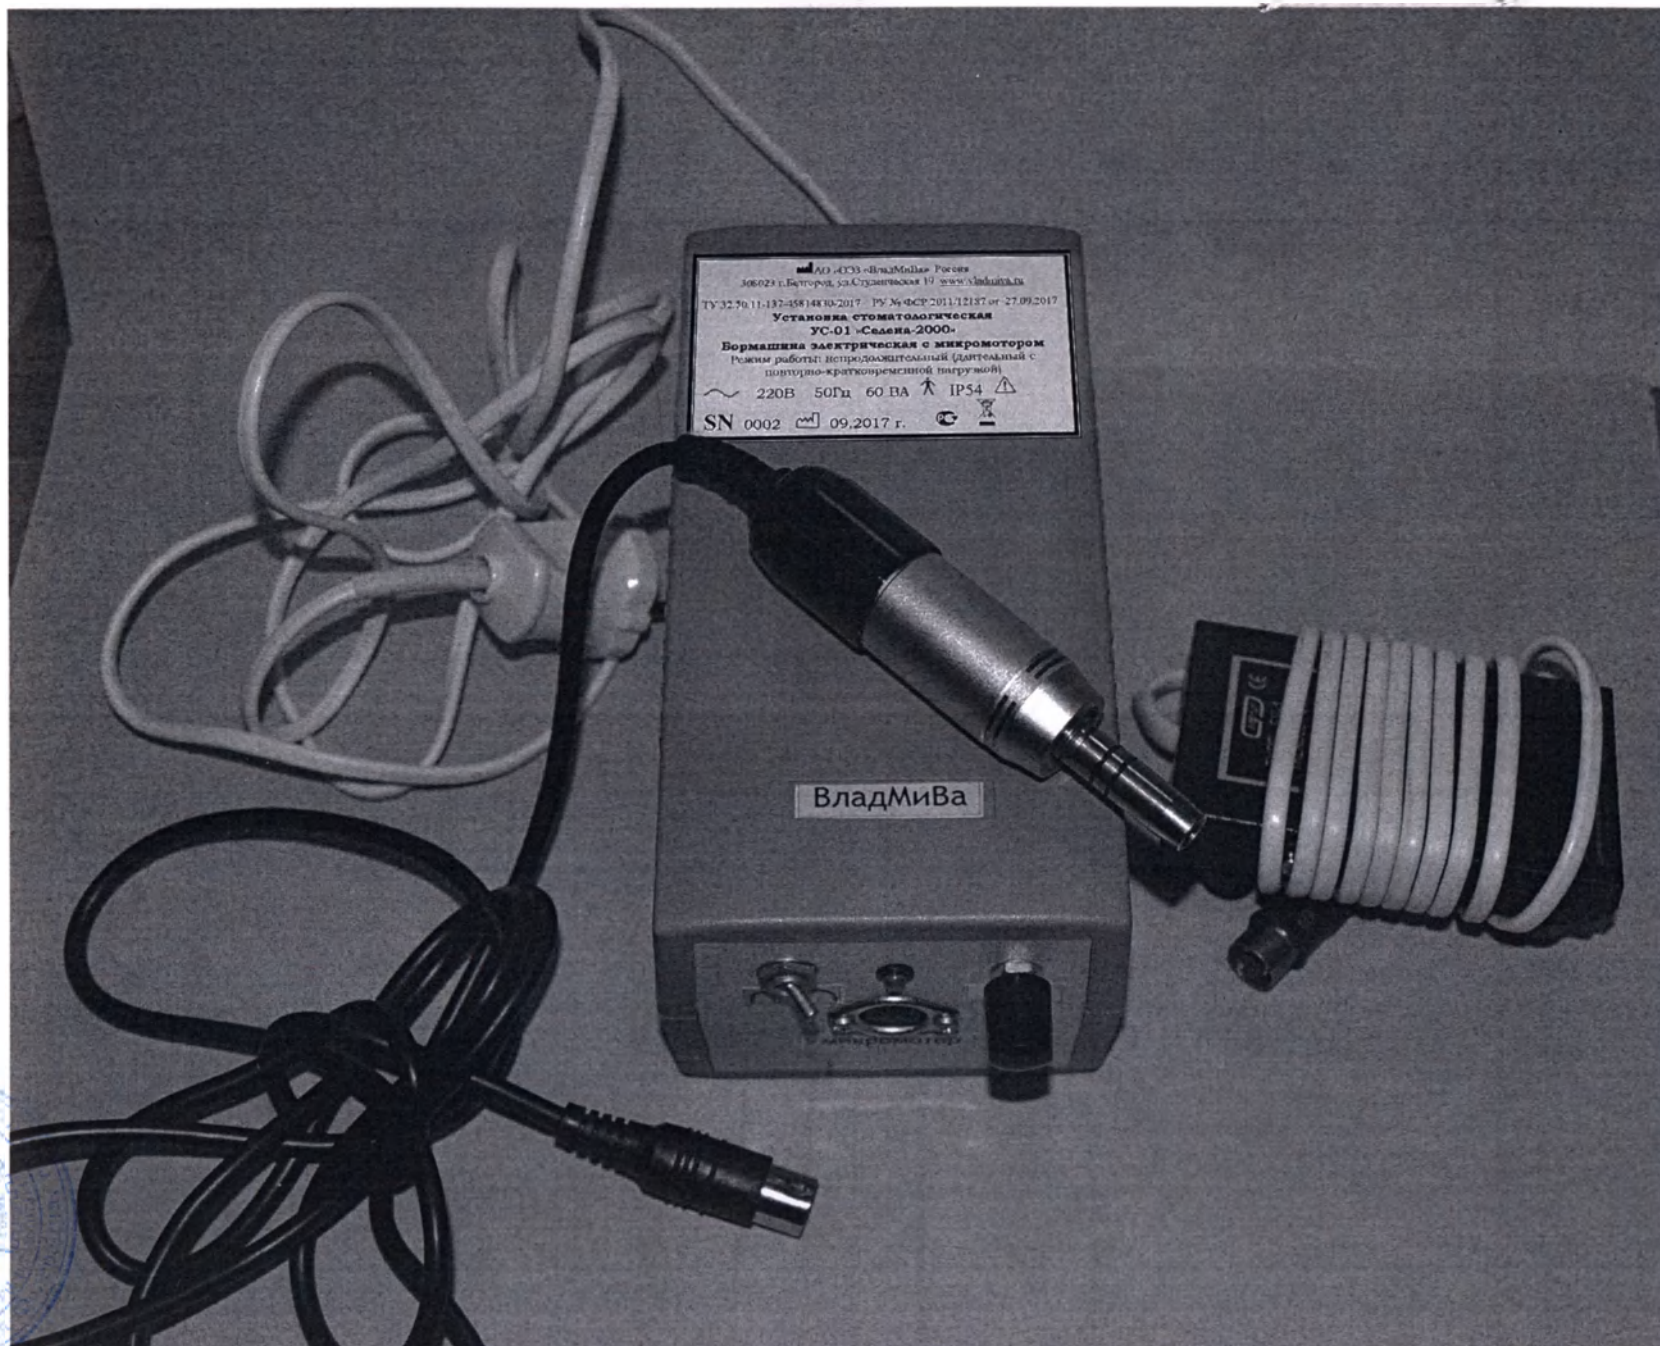

Бормашина электрическая с микро мотором (задняя стенка)



передняя панель



задняя панель

Фото: Бормашина электрическая с микро мотором (пояснительные надписи далее на рисунке В.6)

1. Шнур сетевой
2. Шнур подключения микро мотора
3. Шнур подключения педали
4. Разъем подключения микро мотора




Рис. В.6 - Бормашина электрическая с микромотором. Пояснительные надписи

АО «ОЭЗ «ВладМиВа» Россия
308023 г.Белгород, ул.Студенческая 19 www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017

РУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

**Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»**


Бормашина электрическая с микро мотором

Режим работы: непродолжительный (длительный
с повторно-кратковременной нагрузкой)

~ 220В 50Гц 60 ВА ⚡ IP54 ⚠

SN 0002 🏠 09.2017 г. Ⓢ ⚡


Информация на ярлычке, прикрепляемом к бормашине электрической с микро мотором

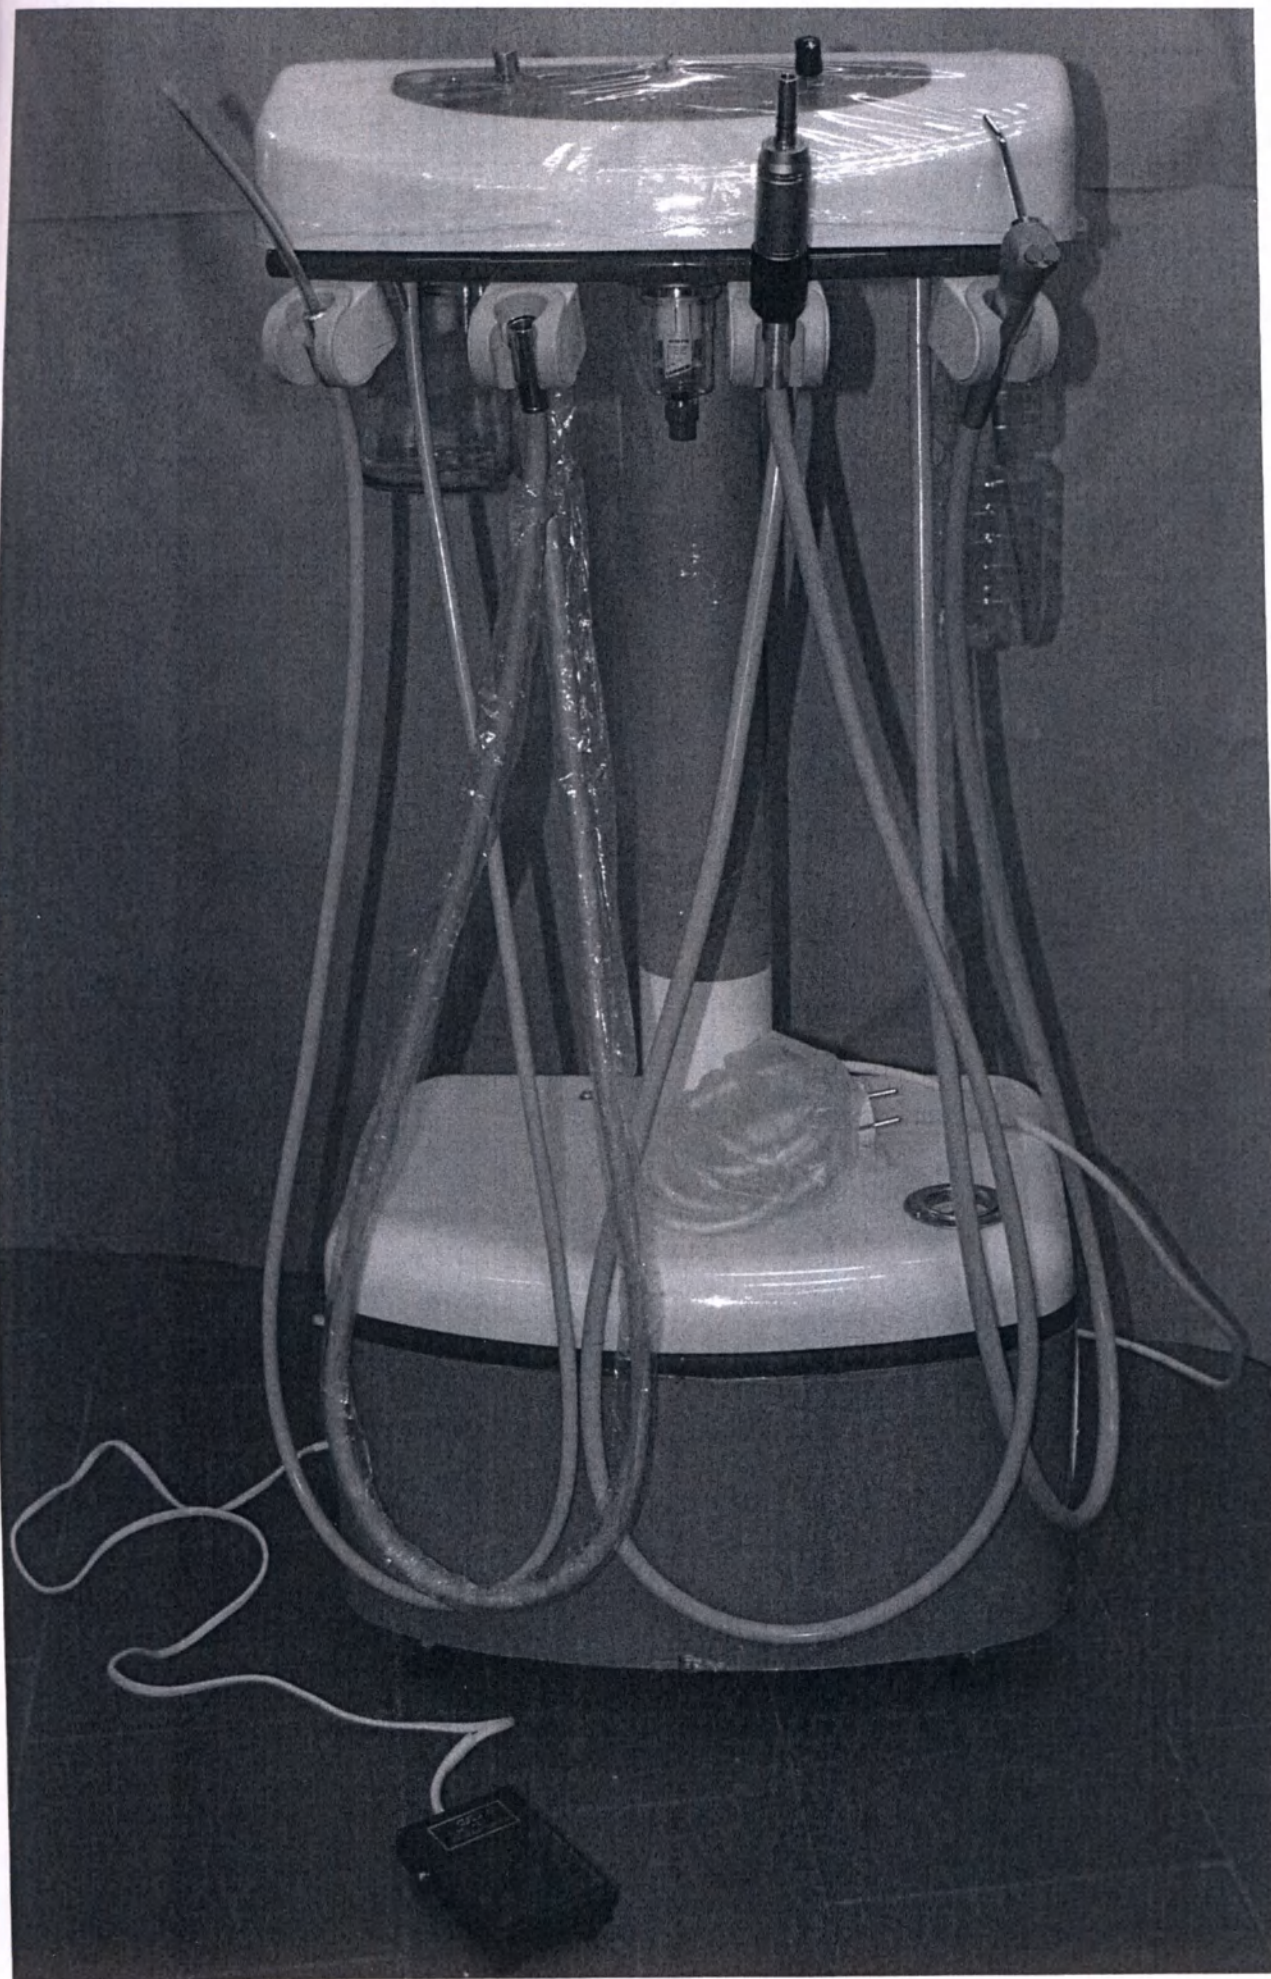

Модуль врача мобильный УС-01М



Модуль врача мобильный УС-01М (задняя стенка с маркировкой)

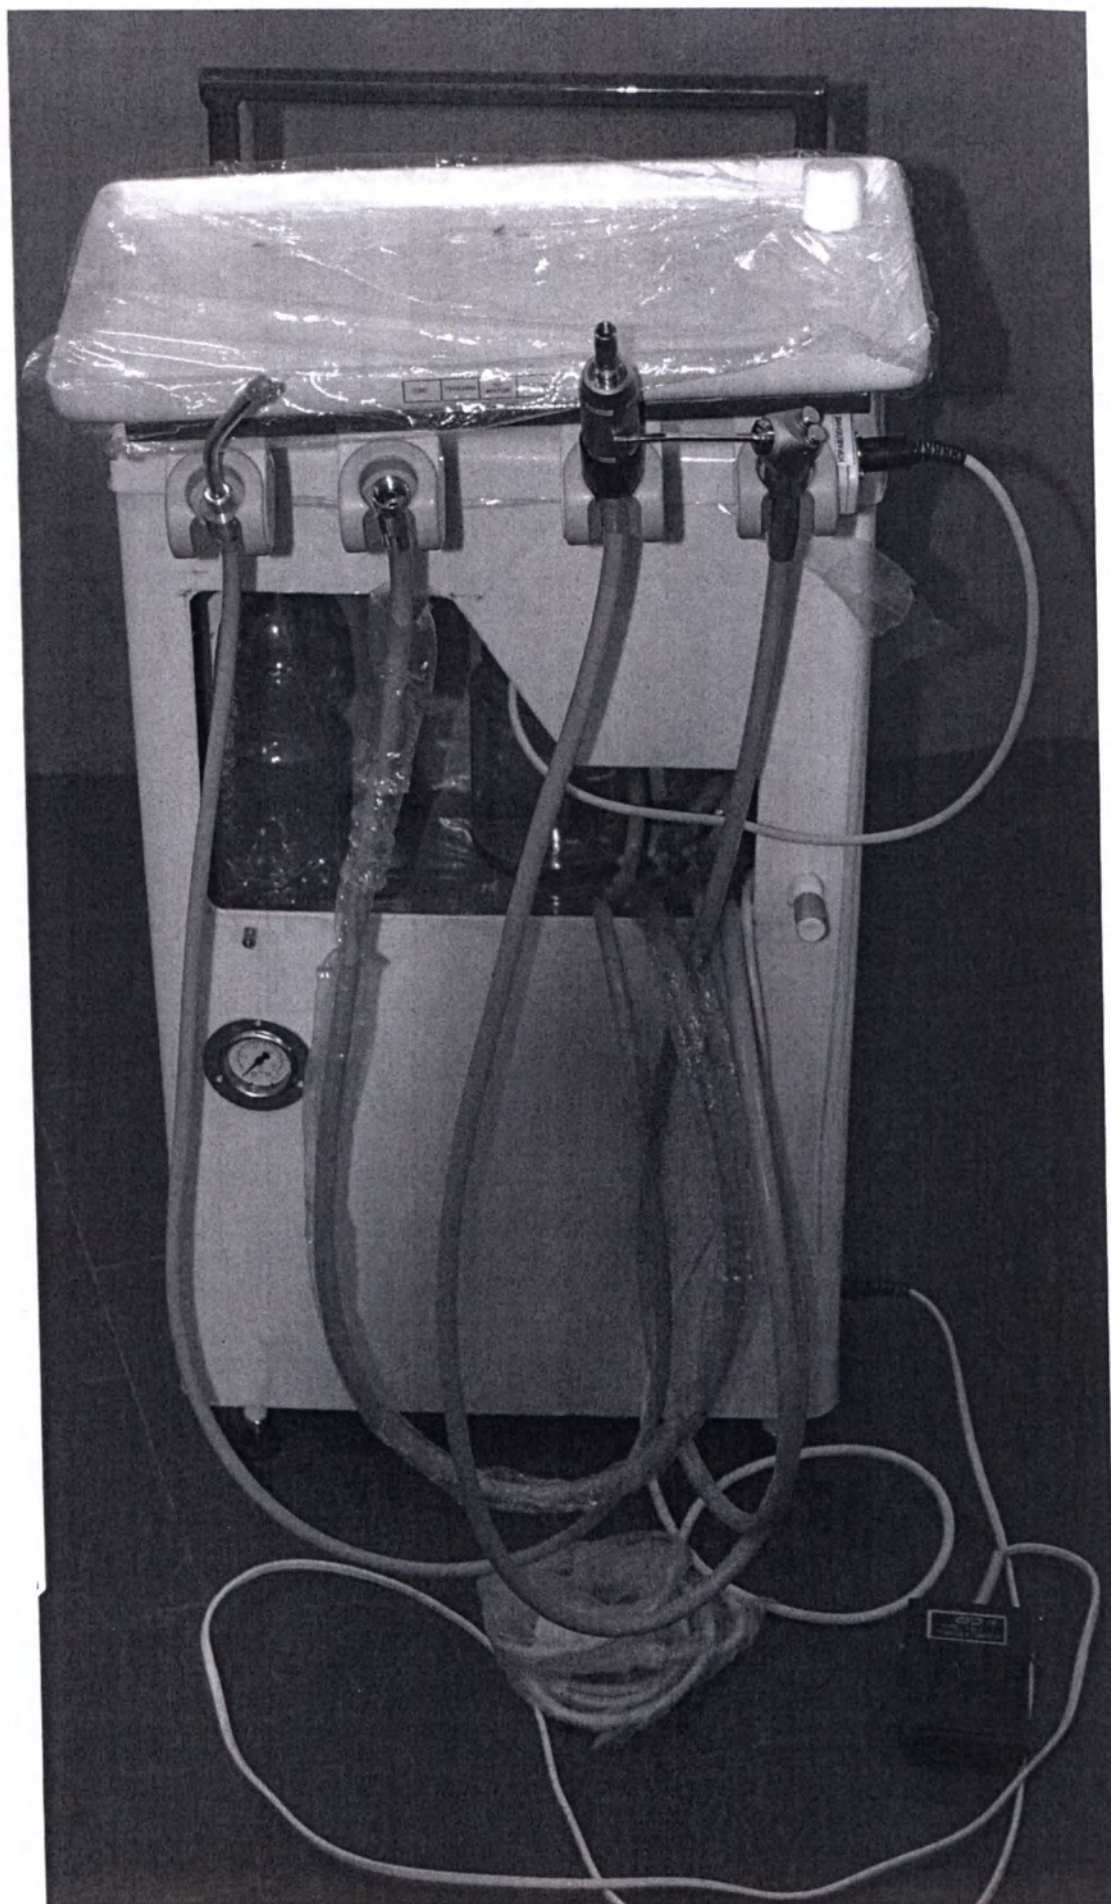

Модуль врача переносной УС-01П



Модуль врача переносной УС-01П (маркировка на задней стенке)


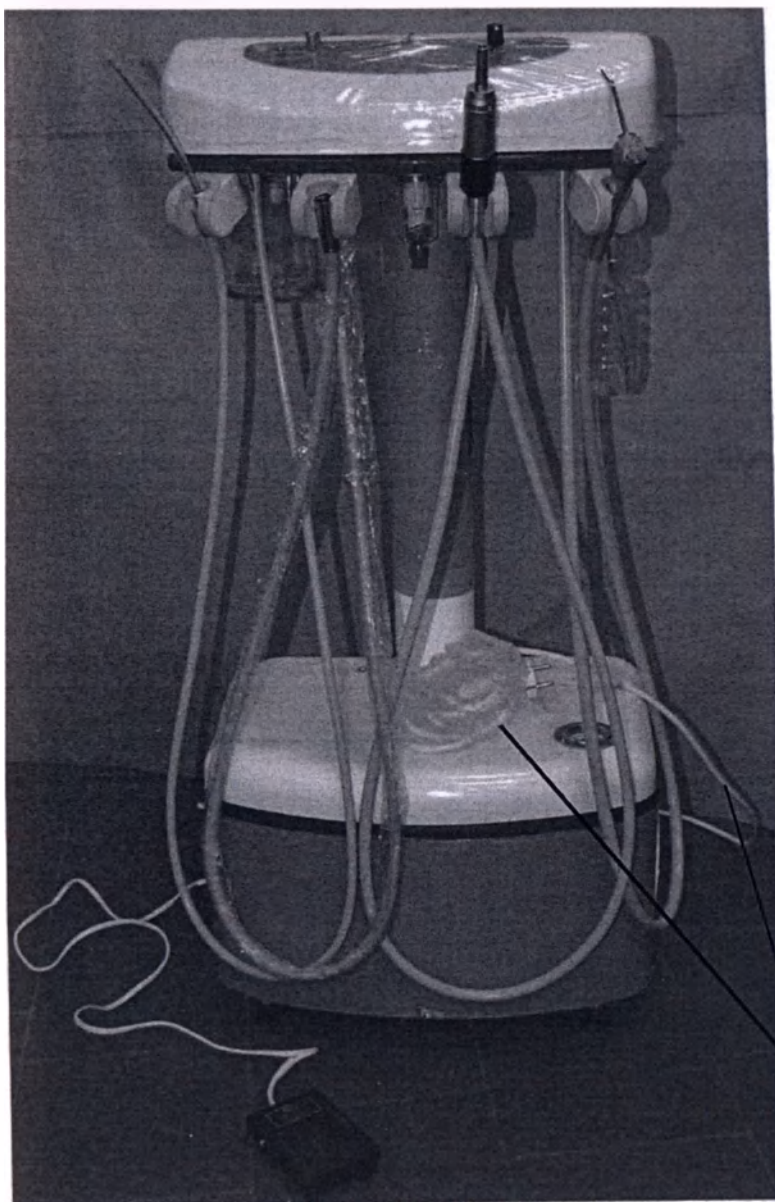



Фото: Модуль врача мобильный УС-01М

(пояснения далее на рисунке В.1)

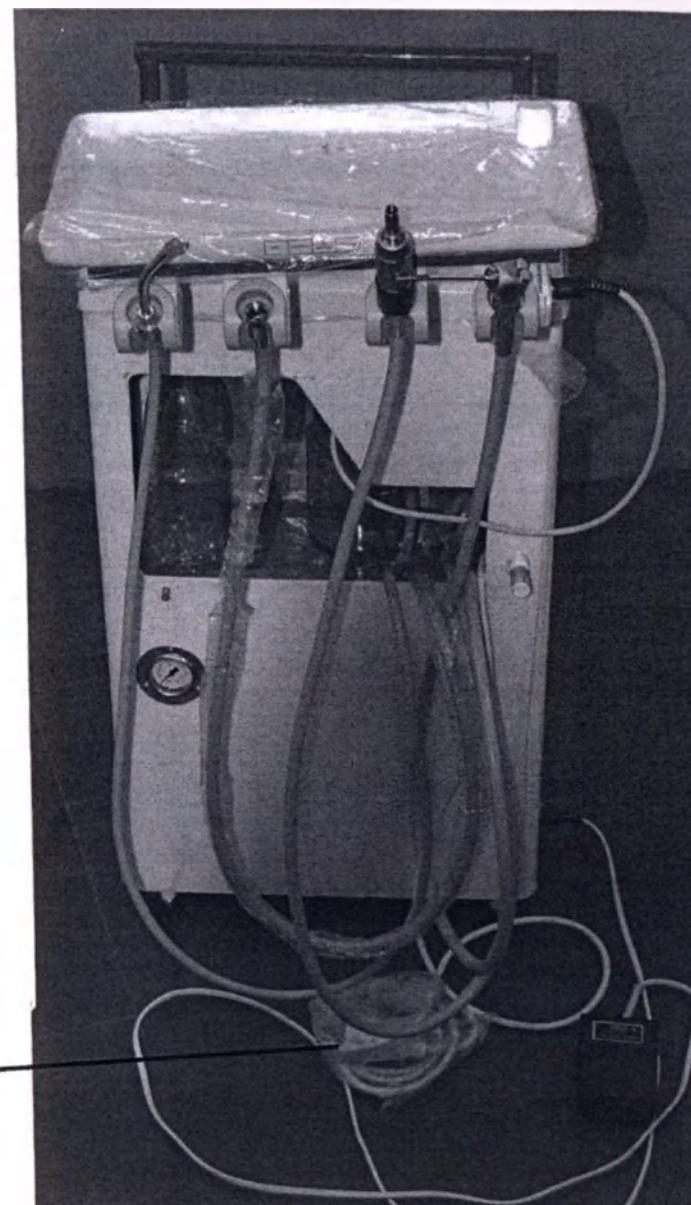

Модуль врача переносной УС-01П

1. Шнур сетевой



Исполнение UC-01M

Исполнение UC-01П

Рис. В.1 Модуль врача. Общий вид

- 1 – шланг с наконечником отсасывателя;
- 2 – шланг с микро мотором электрическим;
- 3 – шланг с присоединительным гнездом Мидвест (М4) для пневмотурбинного наконечника;
- 4 – шланг со стоматологическим пистолетом комбинированным.
- 5 – регулятор скорости вращения микро мотора бормашины электрической;
- 6 – сигнальные светодиоды (красного цвета) положения инструмента;
- 7 – сигнальные светодиоды отсасывателя;
- 8 – регулятор расхода воды на турбинный наконечник;
- 9 – блок врача с инструментами и элементами управления;
- 10 – педаль;
- 11 – место подключения кабеля на блоке врача модели UC-01П;
- 12 – столик инструментальный вращающийся на опоре модели UC-01П;
- 13 – манометр для индикации давления в воздушной магистрали в различных режимах;
- 14 – емкость для воды;
- сетевой шнур (не указан стрелкой)

АО «ОЭЗ «ВладМиВа» Россия
308023 г.Белгород, ул.Студенческая 19
www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017
РУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

**Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»
Модуль врача мобильный УС-01М**
Режим работы: непродолжительный
(длительный с повторно-кратковременной
нагрузкой)

~ 220В 50Гц 750 ВА ⤴ IP56 ⚠
SN 0002 📶 09.2017 г. Ⓜ ⚡


АО «ОЭЗ «ВладМиВа» Россия
308023 г.Белгород, ул.Студенческая 19
www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017
РУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017


**Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»
Модуль врача переносной УС-01П**
Режим работы: непродолжительный
(длительный с повторно-кратковременной
нагрузкой)

~ 220В 50Гц 750 ВА ⤴ IP56 ⚠
SN 0002 📶 09.2017 г. Ⓜ ⚡


Информация на ярлычке, прикрепляемом к модулю врача (УС-01П и УС-01М)

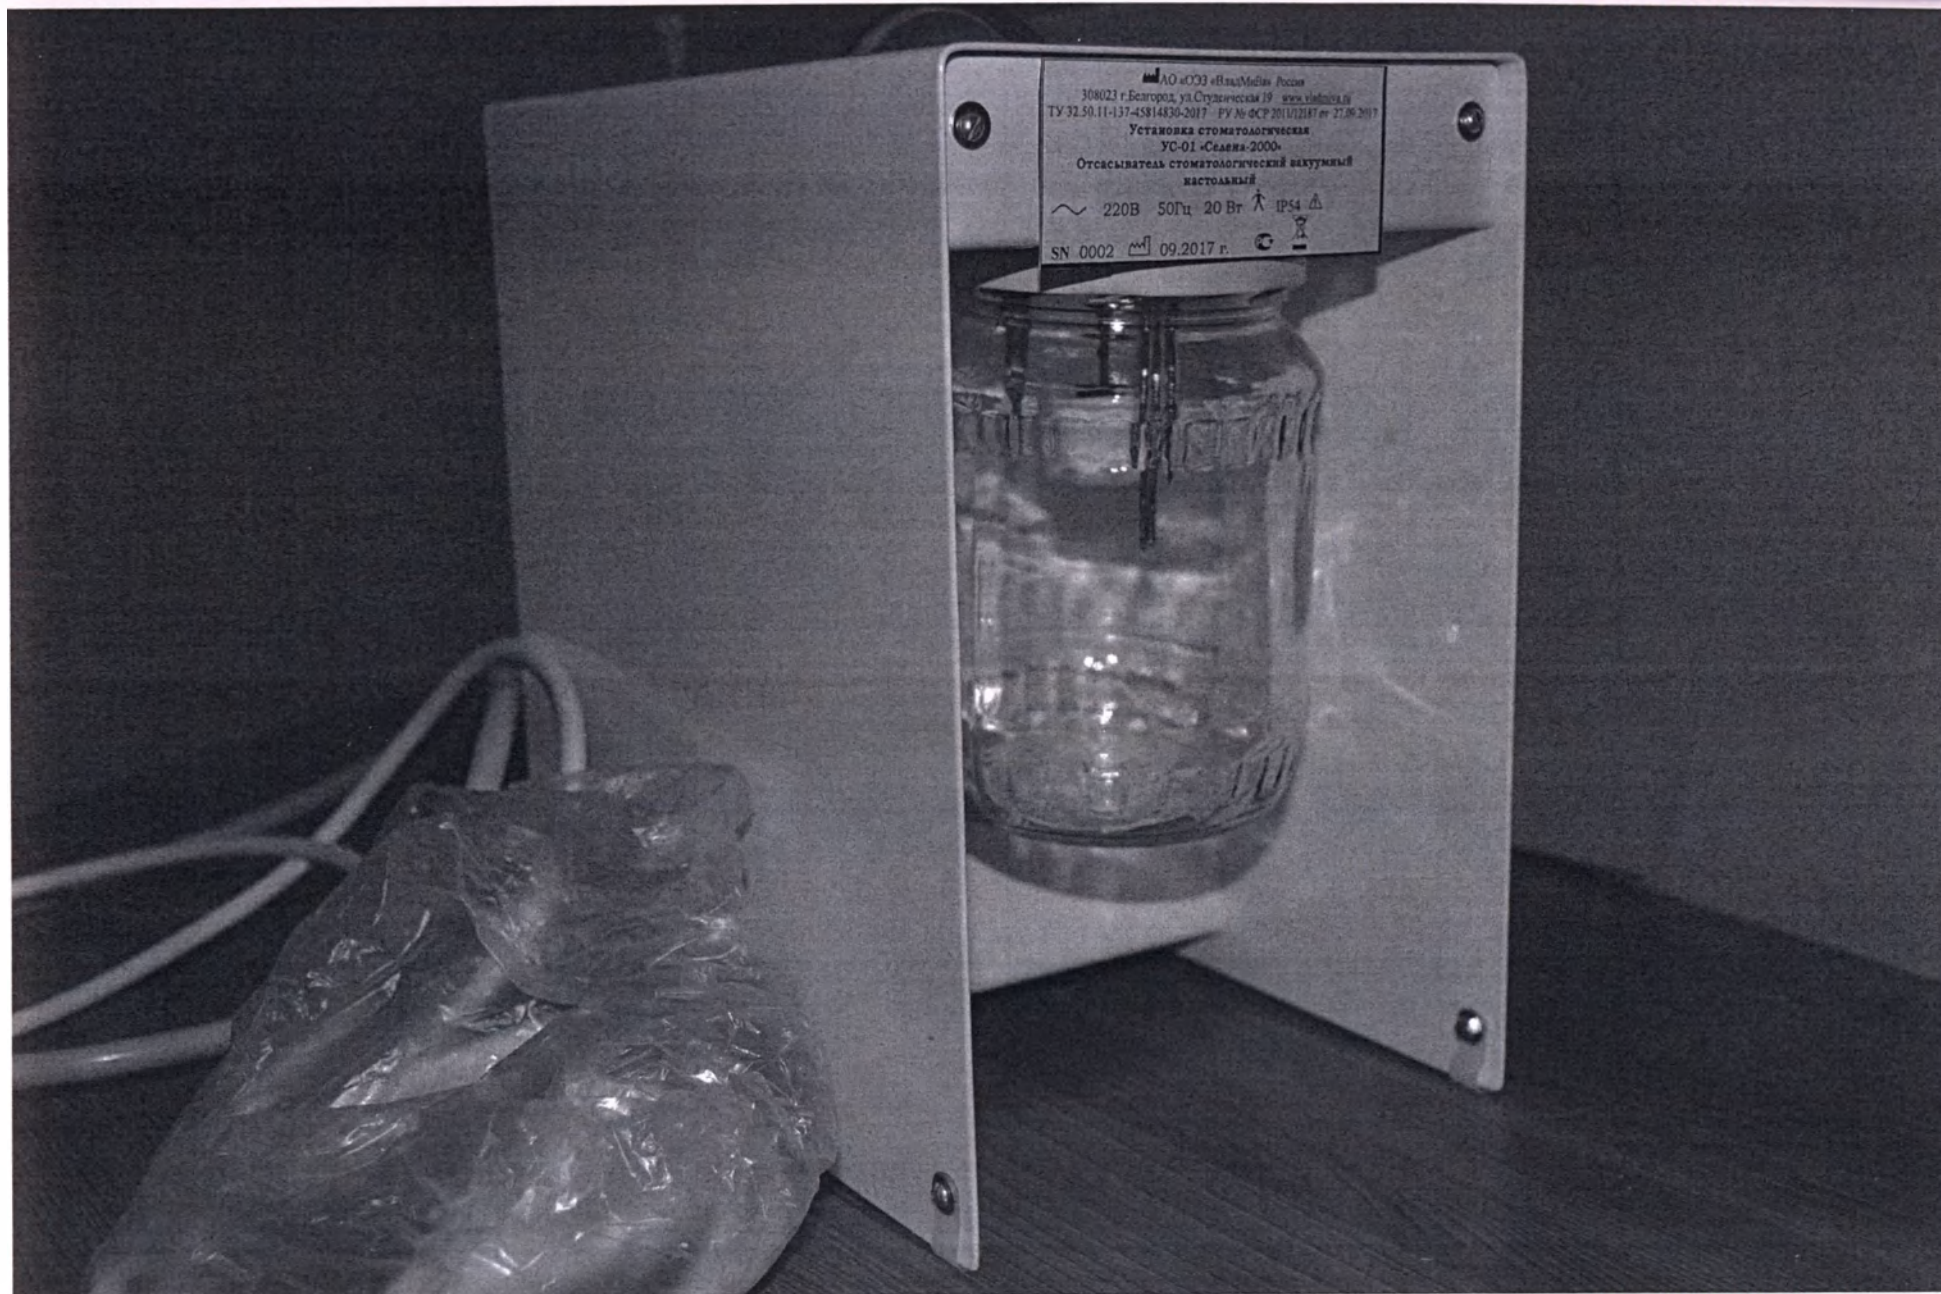


Отсасыватель стоматологический вакуумный настольный (задняя стенка)

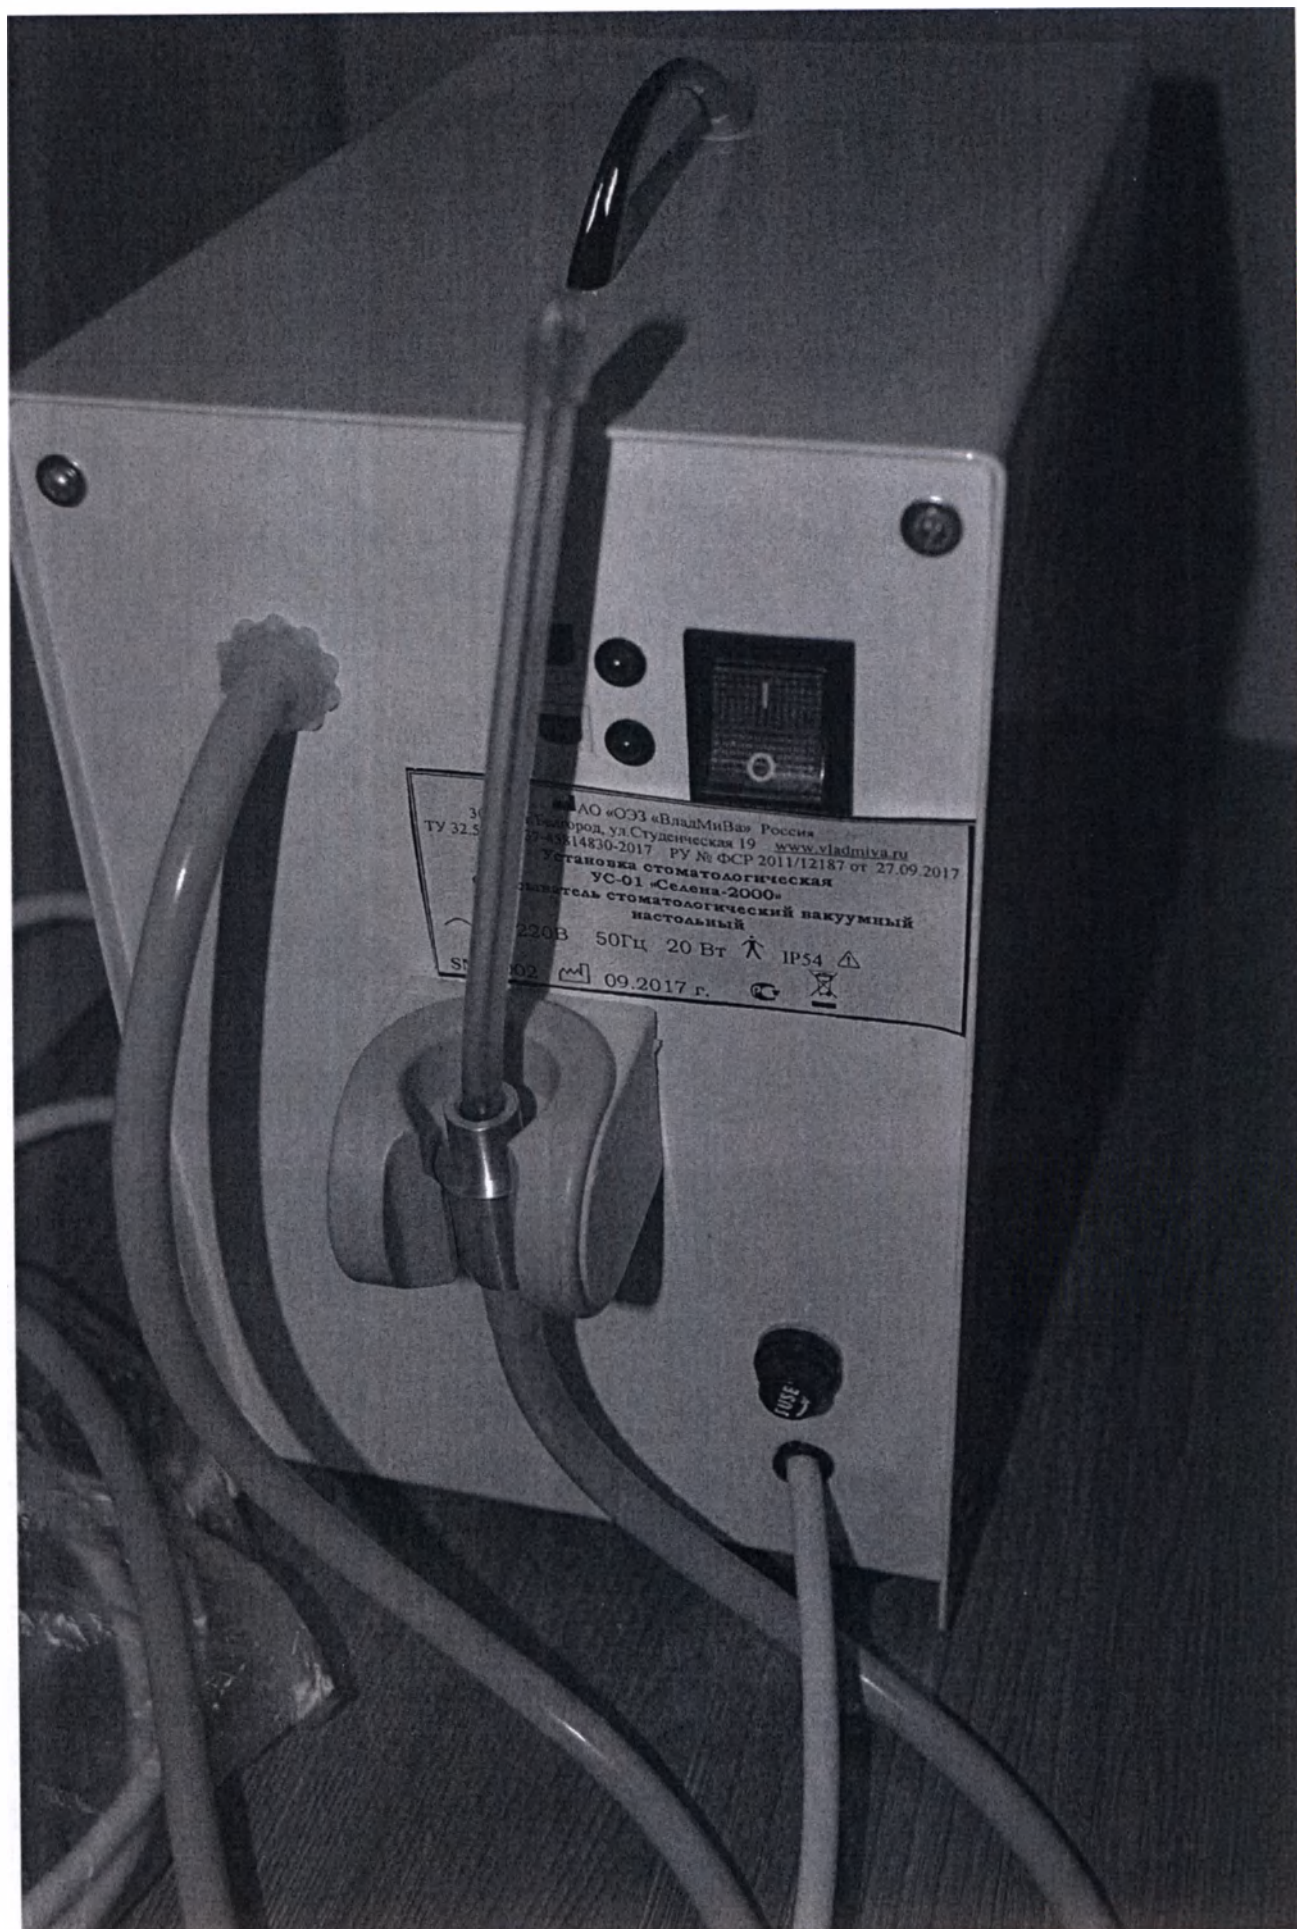

Отсасыватель стоматологический вакуумный настольный



(передняя панель)



(задняя панель)

Фото: Отсасыватель стоматологический вакуумный настольный
(пояснительные надписи далее на рисунке В.7)

1. Шнур сетевой

2. Шланг отсасывателя

3. Наконечник отсасывателя одноразовый

4. Приемная емкость отсасывателя




Рис. В.7 – Отсасыватель стоматологический вакуумный настольный

АО «ОЭЗ «ВладМиВа» Россия
308023 г.Белгород, ул.Студенческая 19
www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017
РУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

**Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»**

**Отсасыватель стоматологический
вакуумный настольный**

~ 220В 50Гц 20 Вт ⚡ IP54 ⚠

SN 0002 🏭 09.20 17 г. Ⓢ ⚠

Информация на ярлычке, прикрепляемом к отсасывателю стоматологическому
вакуумному настольному



Светильник стоматологический переносной

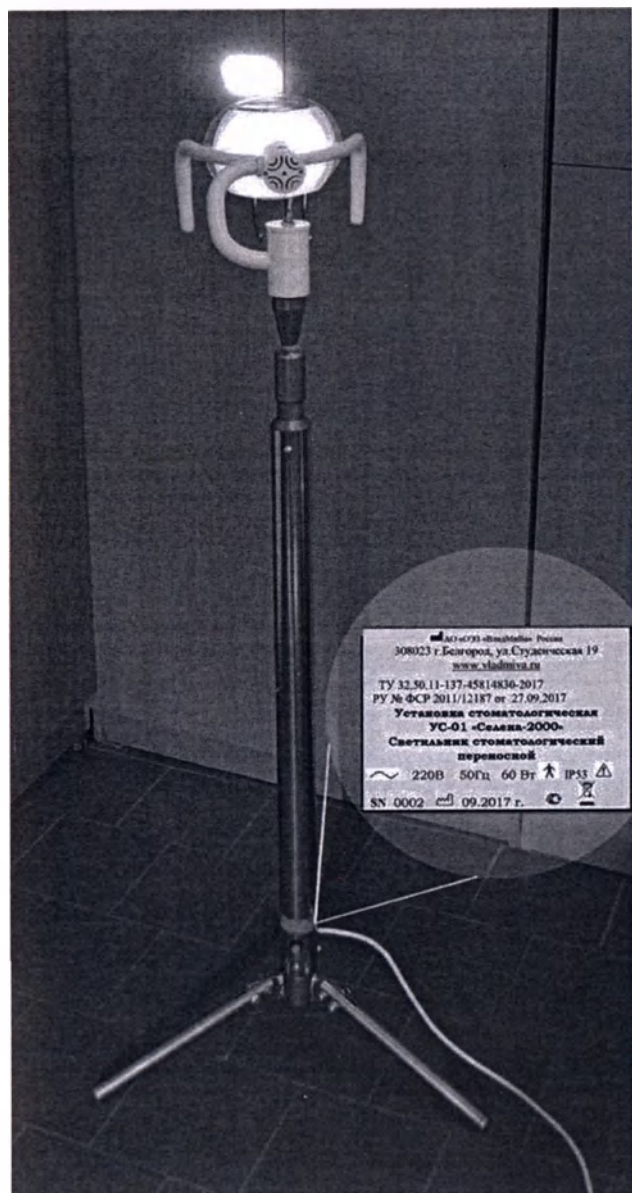


ФОТО: Светильник стоматологический переносной

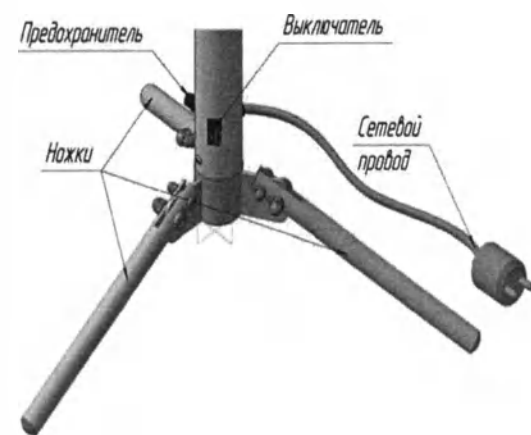



Рис. В.3 - Светильник стоматологический переносной

 АО «ОЭЗ «ВладМиВа» Россия

308023 г.Белгород, ул.Студенческая 19
www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017
ПУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

**Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»
Светильник стоматологический
переносной**

~ 220В 50Гц 60 Вт ⤴ IP53 ⚠

SN 0002  09.2017 г.



Информация на ярлычке, прикрепляемом к светильнику стоматологическому



Стол стоматологический инструментальный

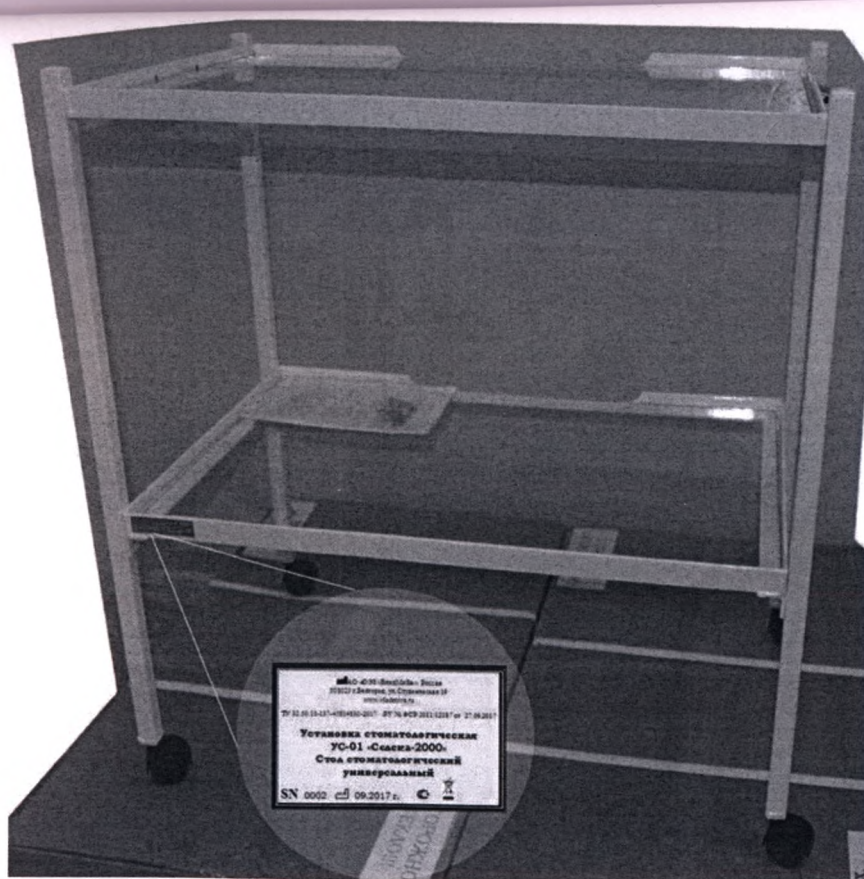


ФОТО: Стол стоматологический инструментальный

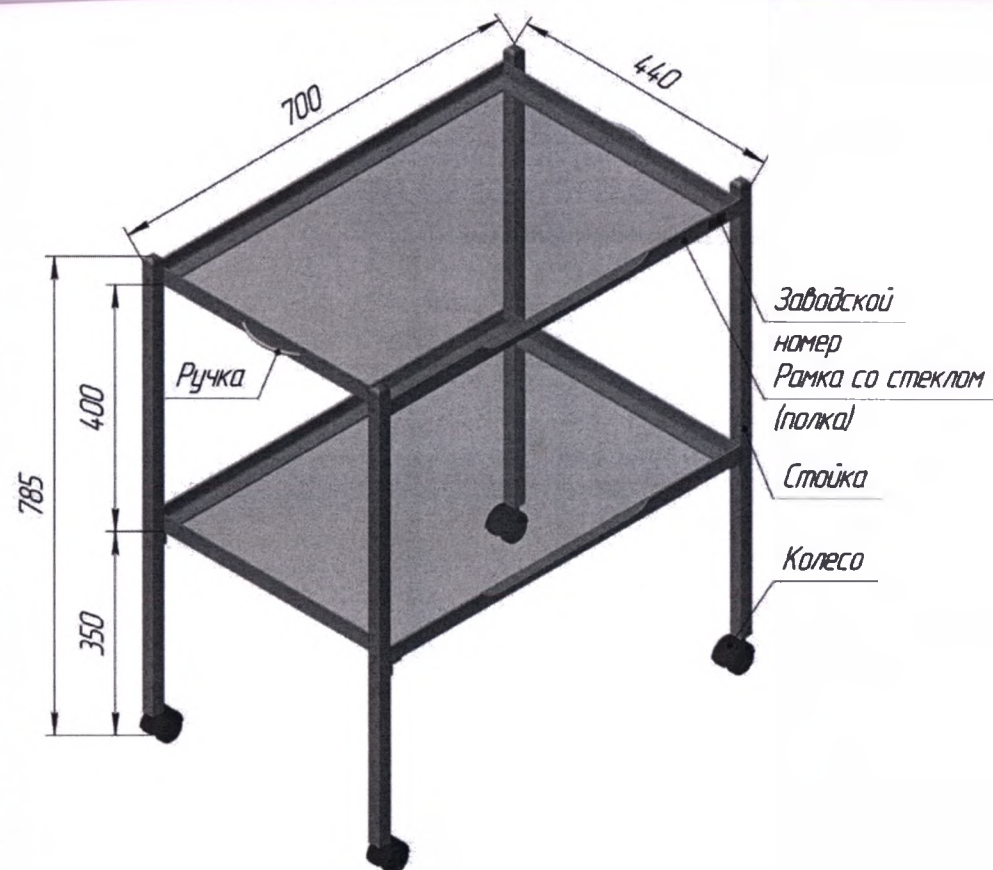


Рис. В.4 - Стол стоматологический инструментальный


АО «ОЭЗ «ВладМиВа» Россия
308023 г.Белгород, ул.Студенческая 19
www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017
ПУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

**Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»
Стол стоматологический универсальный**

SN 0002  09.2017 г.  

Информация на ярлычке, прикрепляемом к столу стоматологическому универсальному



Плевательница стоматологическая

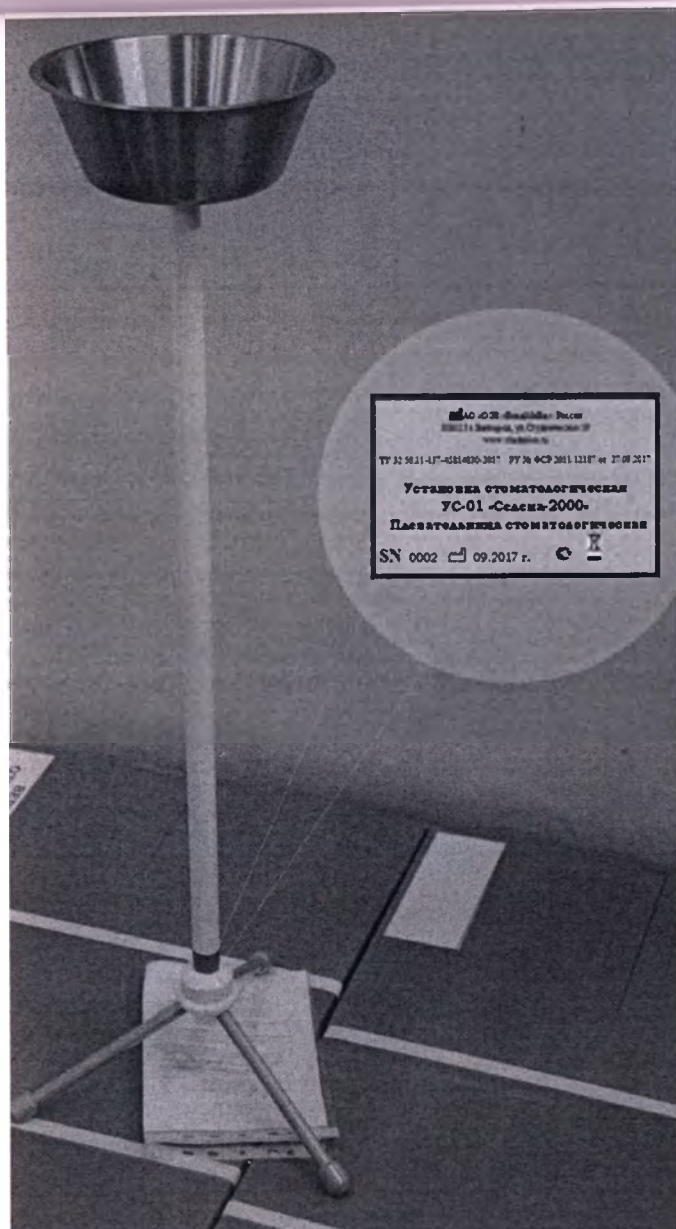


ФОТО: Плевательница стоматологическая

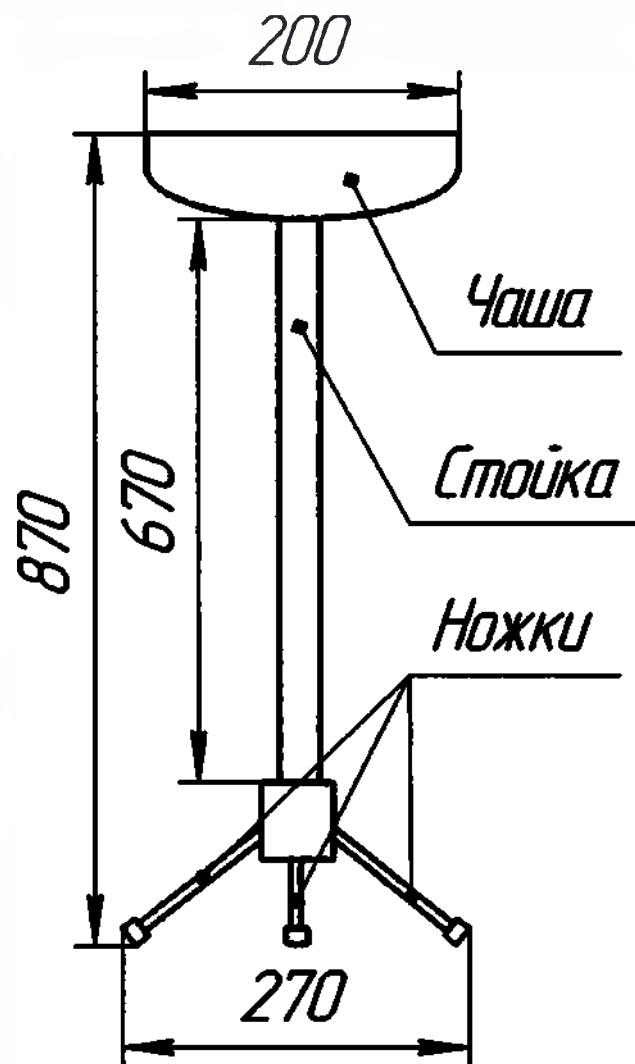


Рис. В.5 - Плевательница стоматологическая

АО «ОЭЗ «ВладМиВа» Россия
308023 г.Белгород, ул.Студенческая 19
www.vladmiva.ru


ТУ 32.50.11-137-45814830-2017
РУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

**Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»
Плевательница стоматологическая**

SN 0002  09.2017 г.



Информация на ярлычке, прикрепляемом к плевательнице стоматологической

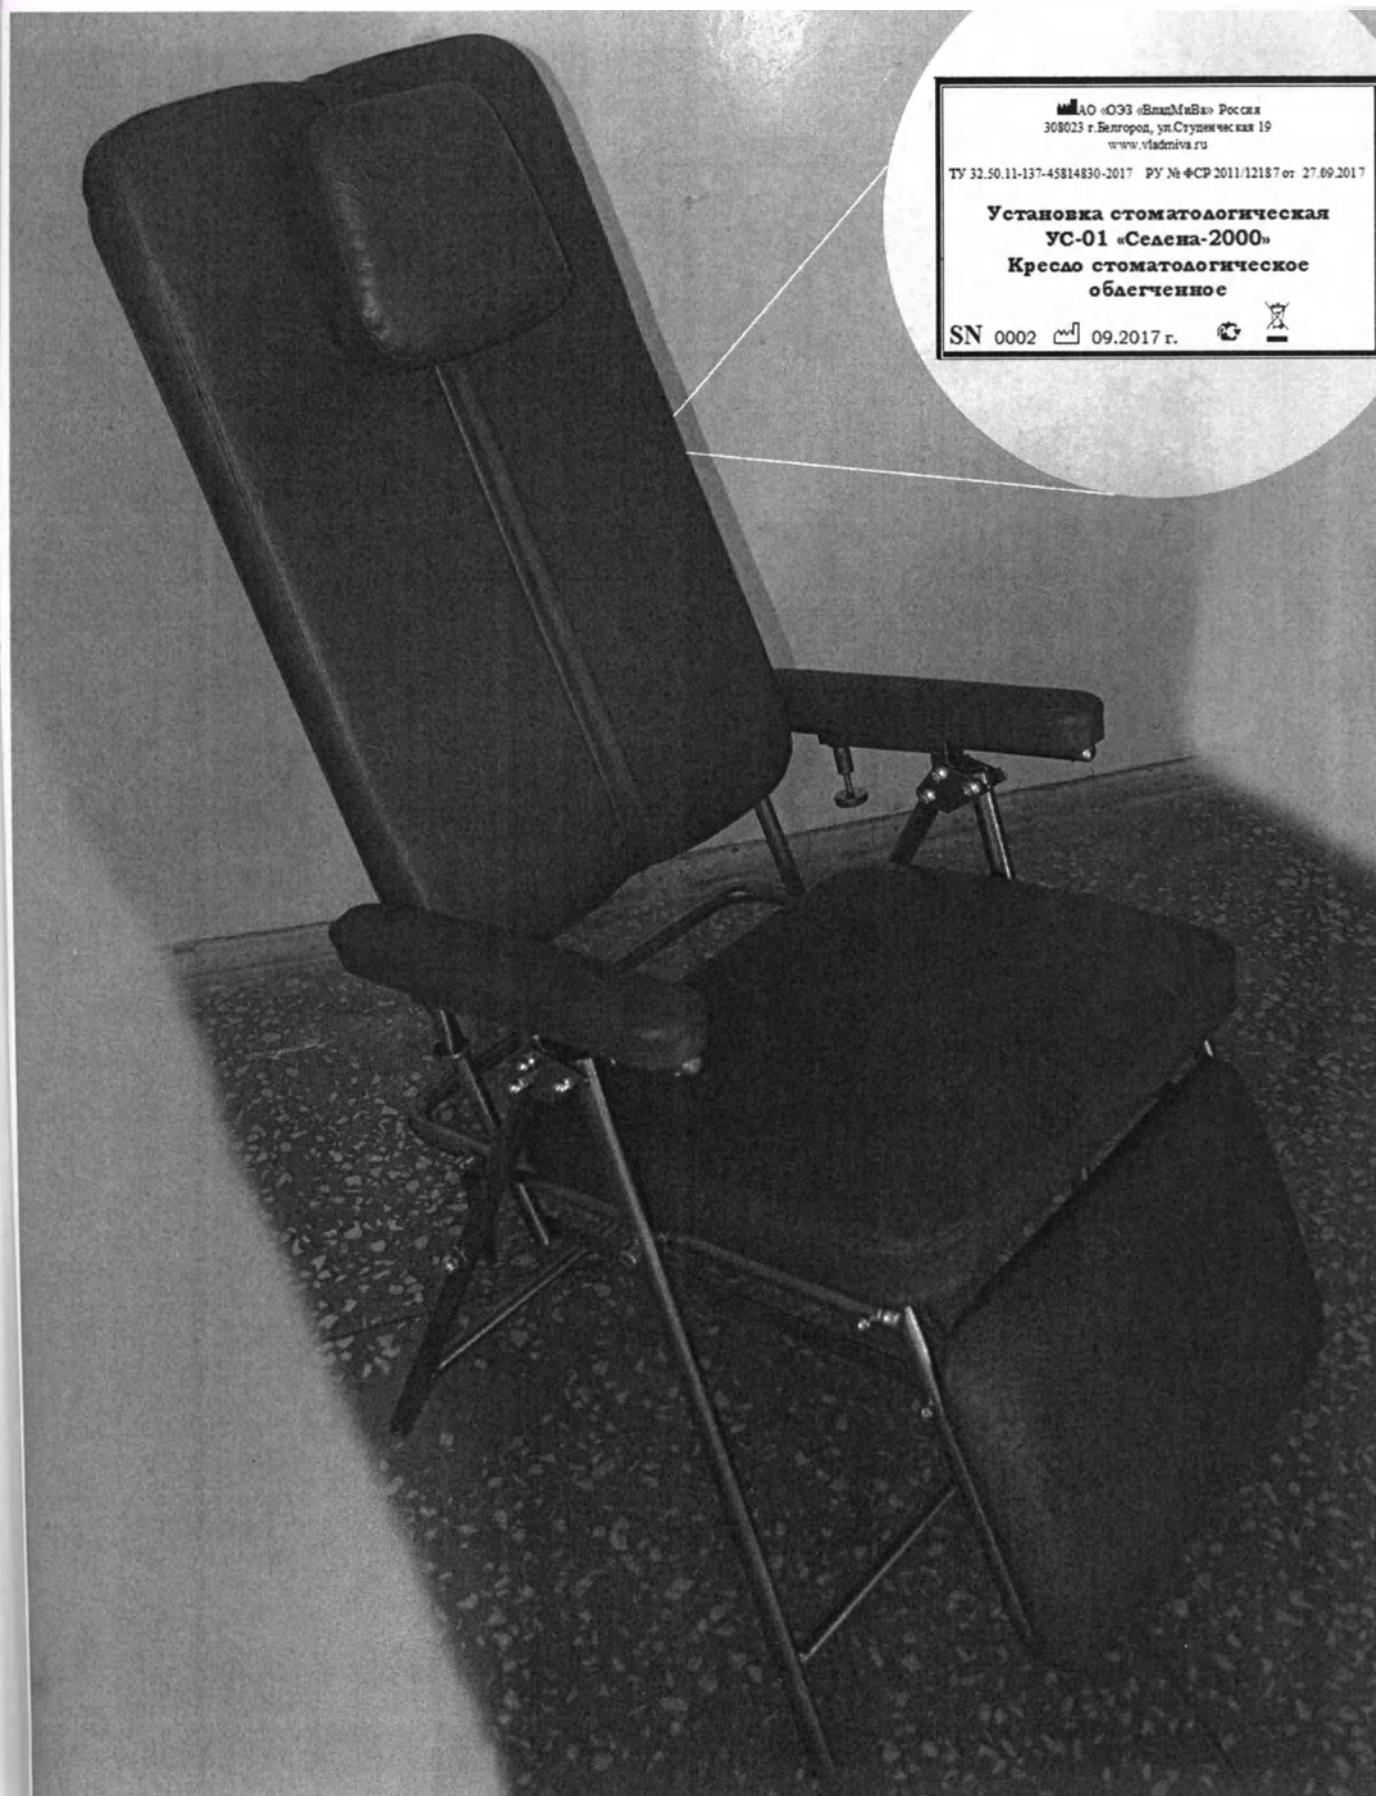

АО «ОЗБ «ВладМиВа» Россия
308023 г. Белгород, ул. Студенческая 19
www.vladmiva.ru
ТУ 32.50.11-137-45814830-2017 РУ №ФСР 2011/12187 от 27.09.2017
**Установка стоматологическая
УС-01 «Седена-2000»
Кресло стоматологическое
облегченное**
SN 0002 09.2017 г.

Кресло стоматологическое облегченное



Кресло стоматологическое облегченное (в сложенном виде)



ФОТО: Кресло стоматологическое облегченное

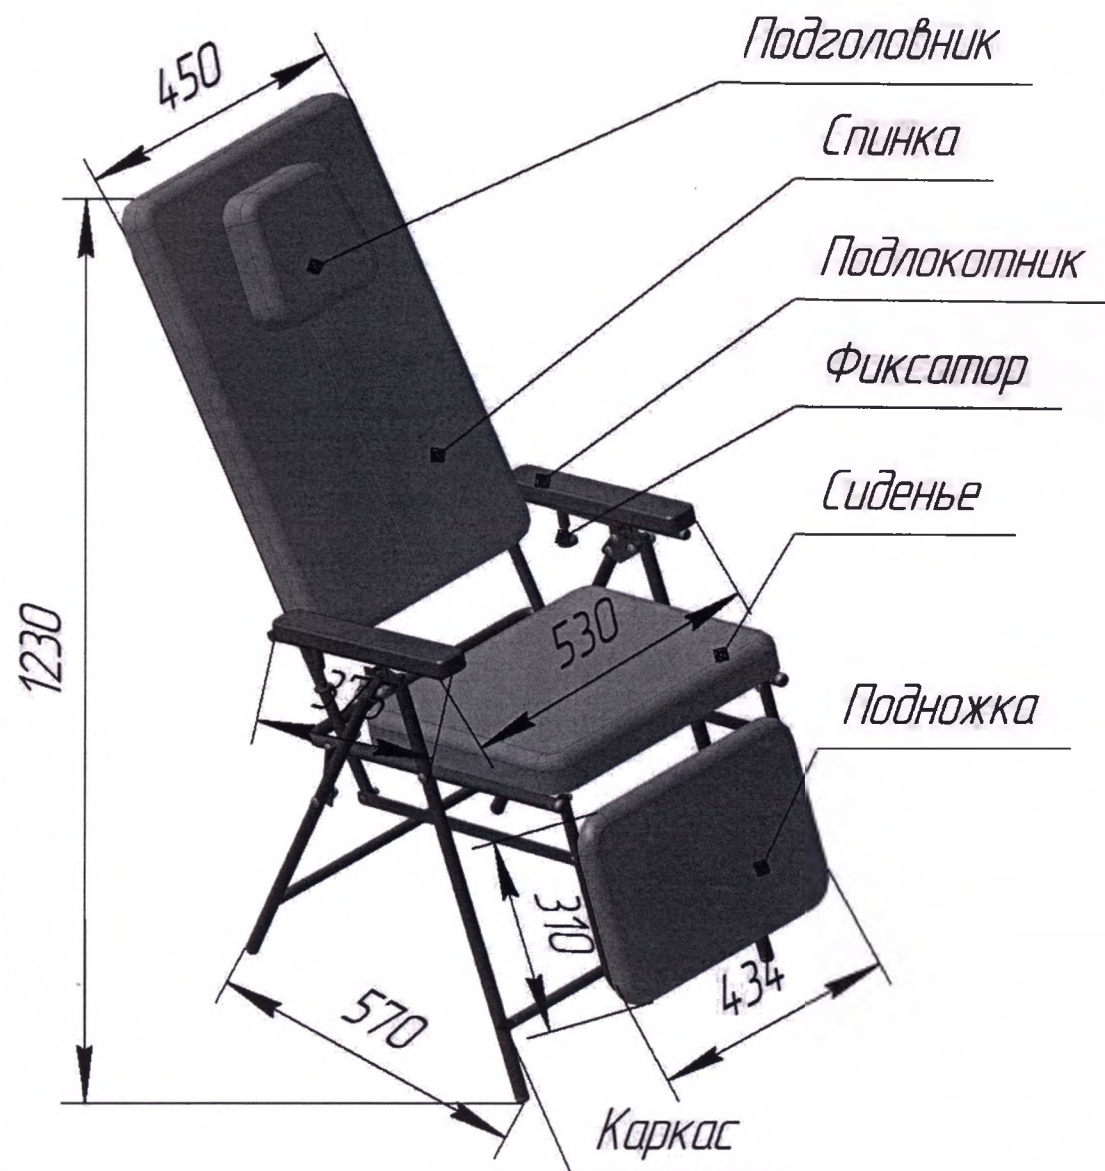


Рис. В.2 – Кресло стоматологическое облегченное

АО «ОЭЗ «ВладМиВа» Россия
308023 г.Белгород, ул.Студенческая 19
www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017
ПУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

**Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»
Кресло стоматологическое
облегченное**


SN 0002



09.2017 г.




Информация на ярлычке, прикрепляемом к креслу стоматологическому облегченному

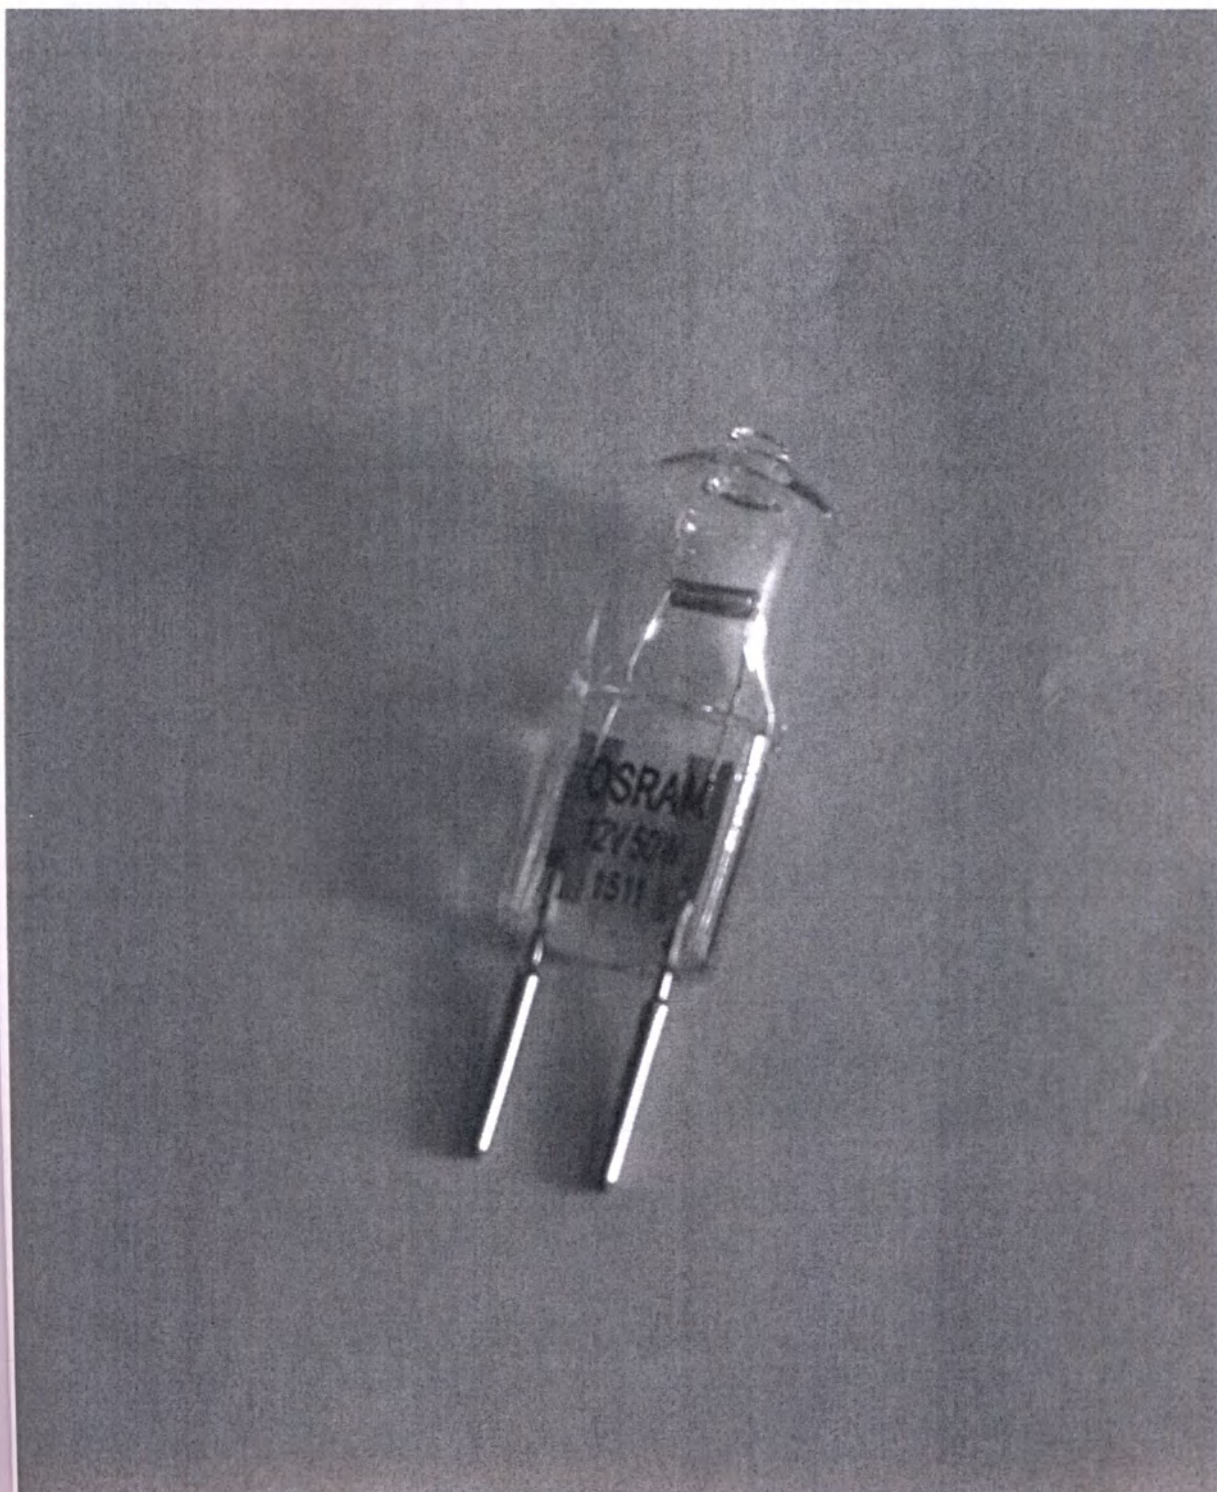


Лампа HL 12 В x 50 Вт

Запчасти (для светильника)

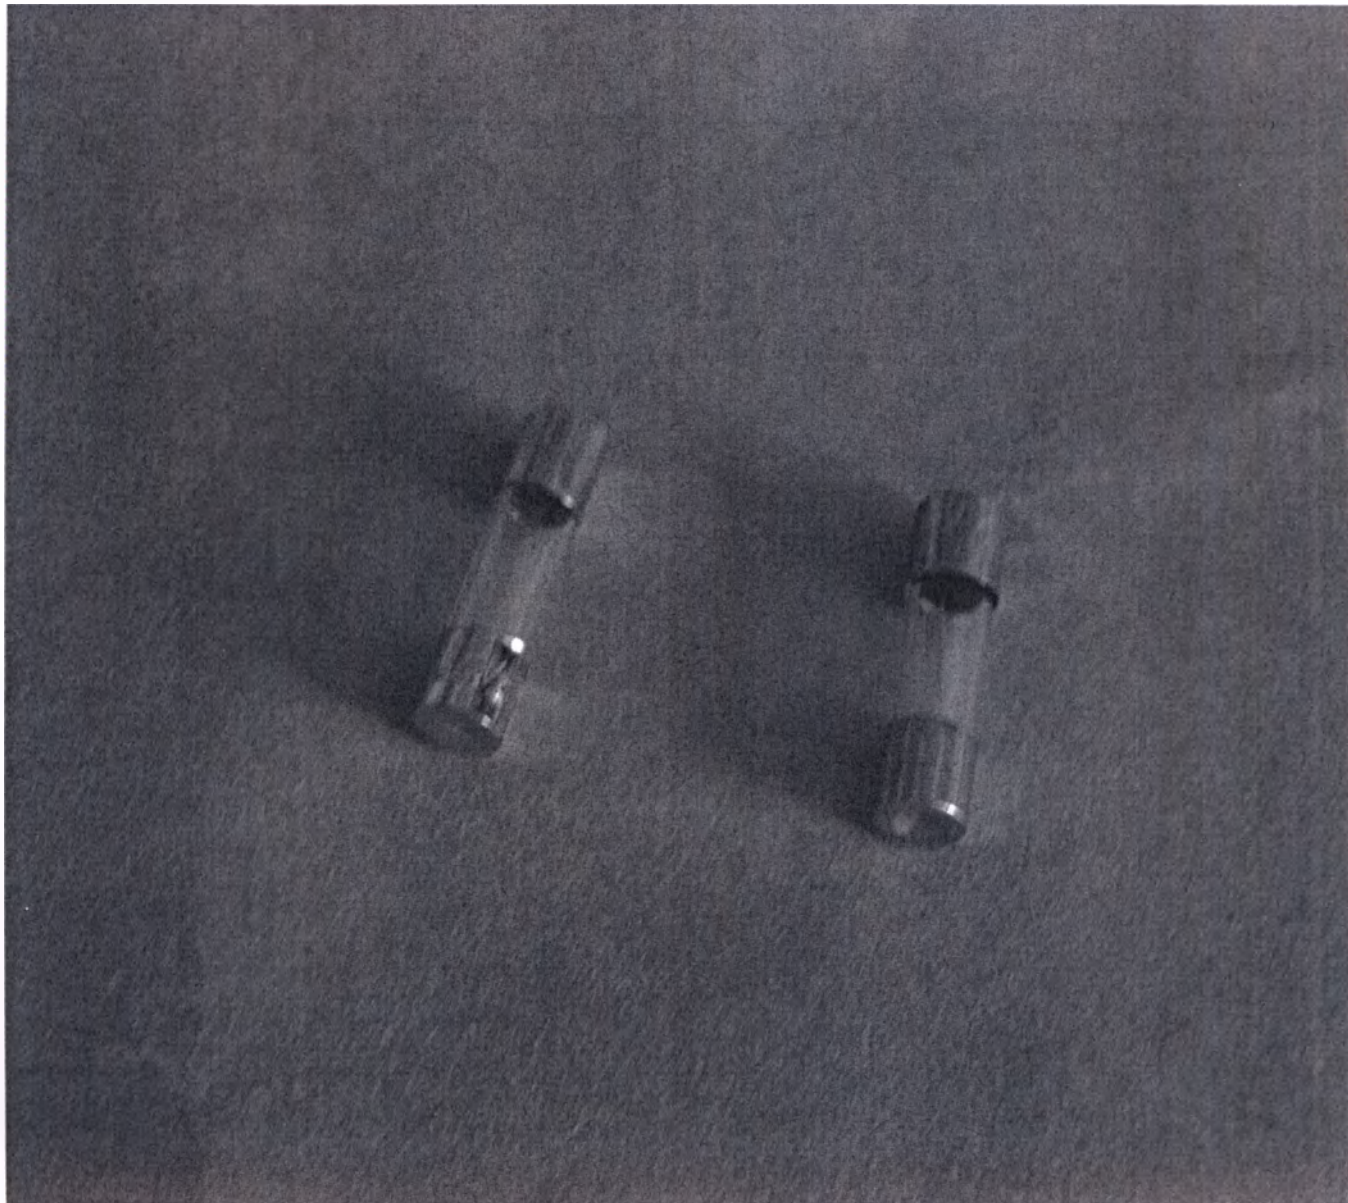


Вставка плавкая ВП2Б-1В 3,15 А

Запчасти (для модуля врача – 1 шт., для отсасывателя настольного – 1 шт.)



Вставка плавкая ВП2Б-1В 6,3 А

Запчасти (для модуля врача)

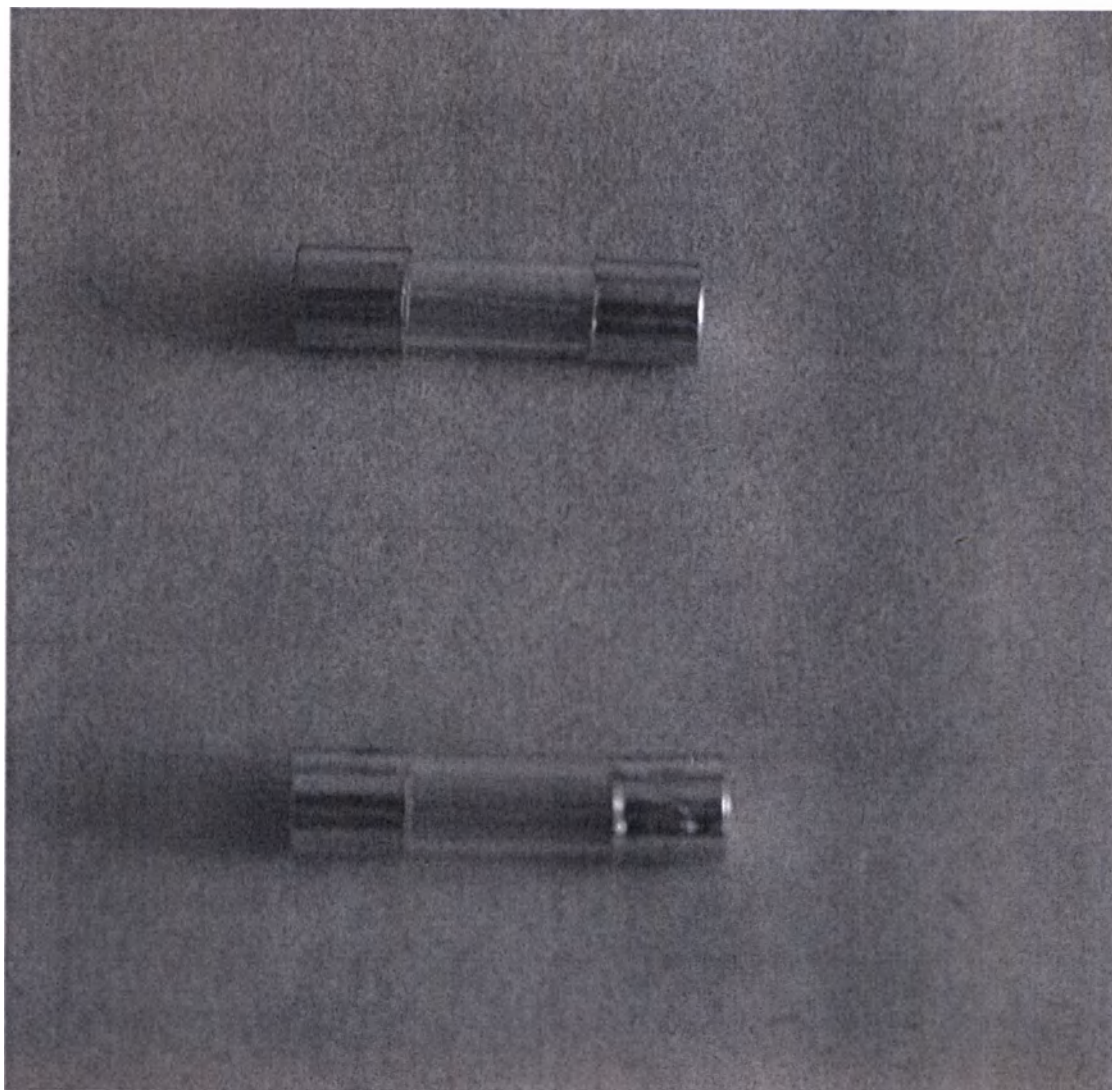

Вставка плавкая ВП2Б-1В 0,5 А

Запчасти (для светильника – 1 шт., для бормашины электрической – 1 шт.)



Ключ шестигранный 4 мм

Запчасти (для светильника)

В данном документе
пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
35 листа(ов)



ФОТО УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УС-01 «СЕЛЕНА-2000»





ВЛАДМИВА

Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»

Модуль врача мобильный УС-01М

~ 220 В 50 Гц 750 ВА IP56

SN _____ 

Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

Средний срок службы 10 лет.

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017

ПУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

Транспортировать по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 30 до плюс 50°C и относительной влажности, не более 98% при 35°C.

Хранить на складах по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не выше 80% при 25°C.



Масса брутто **28 кг**

Масса нетто **26 кг**

Производитель:

Акционерное общество
«Опытно-экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru



viv
ВЛАДМИВА

Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»

Модуль врача переносной УС-01П

~ 220 В 50 Гц 750 ВА IP56

SN _____



Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

Средний срок службы 10 лет.

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017

ПУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

Транспортировать по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 30 до плюс 50°C и относительной влажности, не более 98% при 35°C.

Хранить на складах по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не выше 80% при 25°C.



Масса брутто **28 кг**

Масса нетто **26 кг**

Производитель:

Акционерное общество
«Опытно-экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru

www. Установка стоматологическая
ВЛАДИВА УС-01 «Селена-2000»

Бормашина электрическая с микро мотором

~ 220 В 50 Гц 60 ВА IP54

SN _____


Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

Средний срок службы 10 лет.

TU 32.50.15-137-45814830-2017

РУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

Транспортировать по условиям хранения 3 (КЗ) по ГОСТ 19130 при температуре от минус 30 до плюс 50°C и относительной влажности, не более 98% при 35°C. Хранить на складах по условиям хранения 1 (П) по ГОСТ 19150 при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не выше 90% при 25°C.



Масса брутто 3,5 кг

Масса нетто 3 кг


Производитель:
Акционерное общество
«Смилто» экспортно-импортный завод
«ВладМай» (АО «ОЗЭ «ВладМай»)
239023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 99
+7 4722 200-555
info@smilto.ru
www.smilto.ru

vvv
ВЛАДМИВА

Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»

Бормашина электрическая с микро мотором

~ 220 В 50 Гц 60 ВА IP54

SN _____ 

Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

Средний срок службы 10 лет.

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017

ПУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

Транспортировать по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 30 до плюс 50°C и относительной влажности, не более 98% при 35°C.

Хранить на складах по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не выше 80% при 25°C.



Масса брутто 3,5 кг

Масса нетто 3 кг

Производитель:

Акционерное общество
«Опытно-экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru

ВВ
ВЛАДМИВА

Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»

Отсасыватель

стоматологический вакуумный настольный

~ 220 В 50 Гц 20 ВА IP54

SN _____



Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

Средний срок службы 10 лет.

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017

РУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

Транспортировать по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 30 до плюс 50°C и относительной влажности, не более 98% при 35°C.

Хранить на складах по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не выше 80% при 25°C.



Масса брутто 4 кг

Масса нетто 3,5 кг

Производитель:
Акционерное общество
«Опытно-экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555
postmaster@vladmiva.ru
www.vladmiva.ru


ВЛАДМИВА

Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»

Отсасыватель

стоматологический вакуумный настольный

~ 220 В 50 Гц 20 ВА IP54

SN _____ 

Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

Средний срок службы 10 лет.

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017

РУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

Транспортировать по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 30 до плюс 50°C и относительной влажности, не более 98% при 35°C.

Хранить на складах по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не выше 80% при 25°C.



Масса брутто **4 кг**

Масса нетто **3,5 кг**

Производитель:

Акционерное общество
«Опытно-экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru

Representatives
Representative offices
in various countries and
regions of the world
Karl's People's Bank
17 172 172 172
17 172 172 172


ВЛАДМИВА

Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»

Кресло стоматологическое облегченное

SN _____



Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

Средний срок службы 10 лет.

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017

ПУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

Транспортировать по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 30 до плюс 50°C и относительной влажности, не более 98% при 35°C.

Хранить на складах по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не выше 80% при 25°C.



Масса брутто **22 кг**

Масса нетто **20 кг**

Производитель:

Акционерное общество
«Опытно-экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru




ВЛАДМИВА

Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»

Стол стоматологический универсальный

SN _____ 

Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

Средний срок службы 10 лет.

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017

ПУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

Транспортировать по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 30 до плюс 50°C и относительной влажности, не более 98% при 35°C.

Хранить на складах по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не выше 80% при 25°C.



Масса брутто **18 кг**


Масса нетто **17 кг**

Производитель:

Акционерное общество
«Опытно-экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19

+7 4722 200-555
postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru



Установка стоматологическая
ВЛАДИВКА УС-01 «Сфера 2000»
Светильник
стоматологический переносной
~ 220 В 50 Гц 60 Вт IP53
SN: 10000000000000000000
Сертификат соответствия Еuras
Срок службы 10 лет
ТУ 12.001.01-001-00-000-000
РТУ 001-001-001-001-001-001
Полное наименование: Светильник стоматологический переносной УС-01 «Сфера 2000»
Изготовитель: ООО «Сфера»
Адрес: 690000, г. Владивосток, ул. Пушкина, д. 100
Тел: (423) 240-00-00
E-mail: info@sfera.ru
Сайт: www.sfera.ru
Дата выпуска: 01.01.2020
Место сборки: 6.02
Место сборки: 6.02


ВЛАДМИВА

Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»

СВЕТИЛЬНИК

стоматологический переносной

~ 220 В 50 Гц 60 ВА IP53

SN _____



Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

Средний срок службы 10 лет.

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017

ПУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

Транспортировать по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 30 до плюс 50°C и относительной влажности, не более 98% при 35°C.

Хранить на складах по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не выше 80% при 25°C.



Масса брутто **8 кг**


Масса нетто **6 кг**

Производитель:

Акционерное общество
«Опытно-экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru



ВНИМАНИЕ! При использовании препарата необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкции. Препарат не применять при беременности и кормлении грудью. При появлении побочных эффектов немедленно прекратить прием и обратиться к врачу.

СН
Леваятелинца
СТАНДАРТОВИСКАЯ
ВНИМАНИЕ! При использовании препарата необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкции. Препарат не применять при беременности и кормлении грудью. При появлении побочных эффектов немедленно прекратить прием и обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ! При использовании препарата необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкции. Препарат не применять при беременности и кормлении грудью. При появлении побочных эффектов немедленно прекратить прием и обратиться к врачу.

viv
ВЛАДМИВА

Установка стоматологическая
УС-01 «Селена-2000»

Плевательница стоматологическая

SN _____



Гарантийный срок эксплуатации 1 год.
Средний срок службы 10 лет.

ТУ 32.50.11-137-45814830-2017

ПУ № ФСР 2011/12187 от 27.09.2017

Транспортировать по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 30 до плюс 50°C и относительной влажности, не более 98% при 35°C.

Хранить на складах по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не выше 80% при 25°C.



Масса брутто **3 кг**

Масса нетто **2 кг**

Производитель:

Акционерное общество
«Опытно-экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия, г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru

В данном документе
пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
17 листа(ов)



[Handwritten signature]