

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Лаванда - Интермед»



В.Б. Ковбель

20/7г.

**Фотографическое изображение общего вида
медицинского изделия:**

**Бинты марлевые медицинские нестерильные
по ГОСТ 1172-93**



Фото 1. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 5 м х 7 см

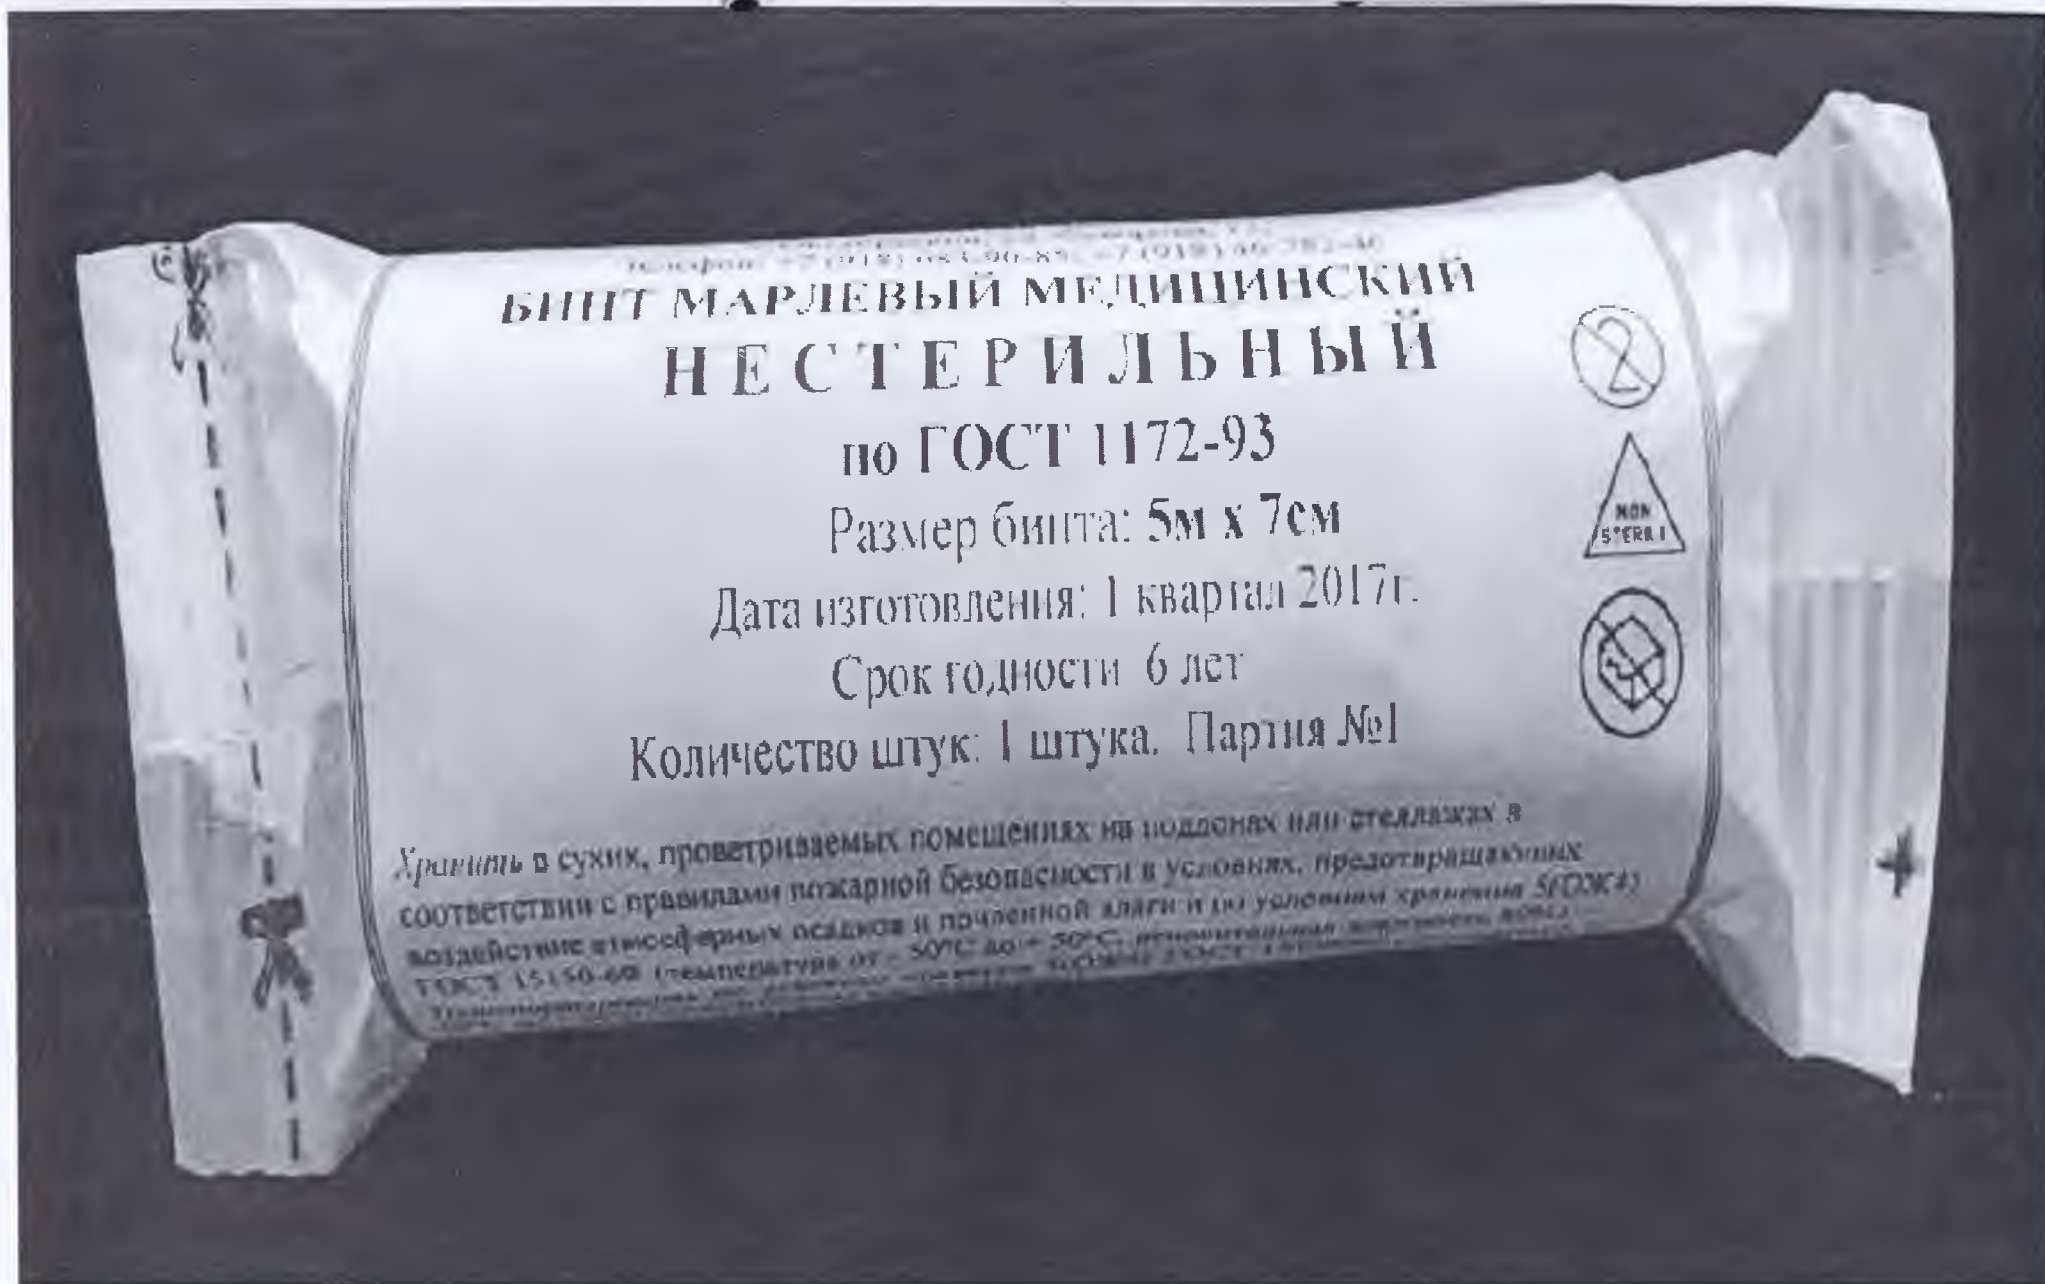


Фото 2. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 5 м x 7 см
 На примере упаковки – Бинт в индивидуальной упаковке (пленка полипропиленовая) – 1 шт.



Фото 3. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 5 м x 10 см



Фото 3. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 5 м x 10 см

ООО «Лаванда-Интермед»
353814 Россия, Краснодарский край, Красноармейский район,
п. Октябрьский, ул. Суворова, 12
телефон: +7 (918) 083-90-85; +7 (918) 46-382-46

**БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**

Размер бинта: 5 м x 10 см
Дата изготовления: 1 квартал 2017г.
Срок годности: 6 лет
Количество штук: 30 штук. Партия №1

Хранить в сухих, проветриваемых помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от - 50°C до + 50°C, относительная влажность 80%).

Транспортировать по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от - 50°C до + 50°C, относительная влажность 80%).

Утилизация как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10;

В домашних условиях использованные бинты утилизировать как бытовые отходы

Место производства:

ООО «Лаванда-Интермед», 353814 Россия, Краснодарский край, Красноармейский район,
п. Октябрьский, ул. Суворова, 14а

№ РЗНот



Фото 4. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 5 м x 10 см
На примере упаковки – Бинт в групповой упаковке (пленка полиэтиленовая) – 30 шт.

ООО «Лаванда-Интермед»
353814 Россия, Краснодарский край, Красноармейский район,
п. Октябрьский, ул. Суворова, 12
телефон: +7 (918) 083-90-85; +7 (918) 46-382-46

**БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**

Размер бинта: 5м x 10см
Дата изготовления: 1 квартал 2017г.
Срок годности 6 лет
Количество штук: 30 штук. Партия №1

Хранить в сухих, проветриваемых помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от - 50°C до + 50°C, относительная влажность 80%).

Транспортировать по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от - 50°C до + 50°C, относительная влажность 80%).

Утилизация как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10;

В домашних условиях использованные бинты утилизировать как бытовые отходы

Место производства:

ООО «Лаванда-Интермед», 353814 Россия, Краснодарский край, Красноармейский район,
п. Октябрьский, ул. Суворова, 14а

№ РЗНот



Фото 4. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 5 м x 10 см
На примере упаковки – Бинт в групповой упаковке (пленка полиэтиленовая) – 30 шт.



Фото 5. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 7 м x 5 см

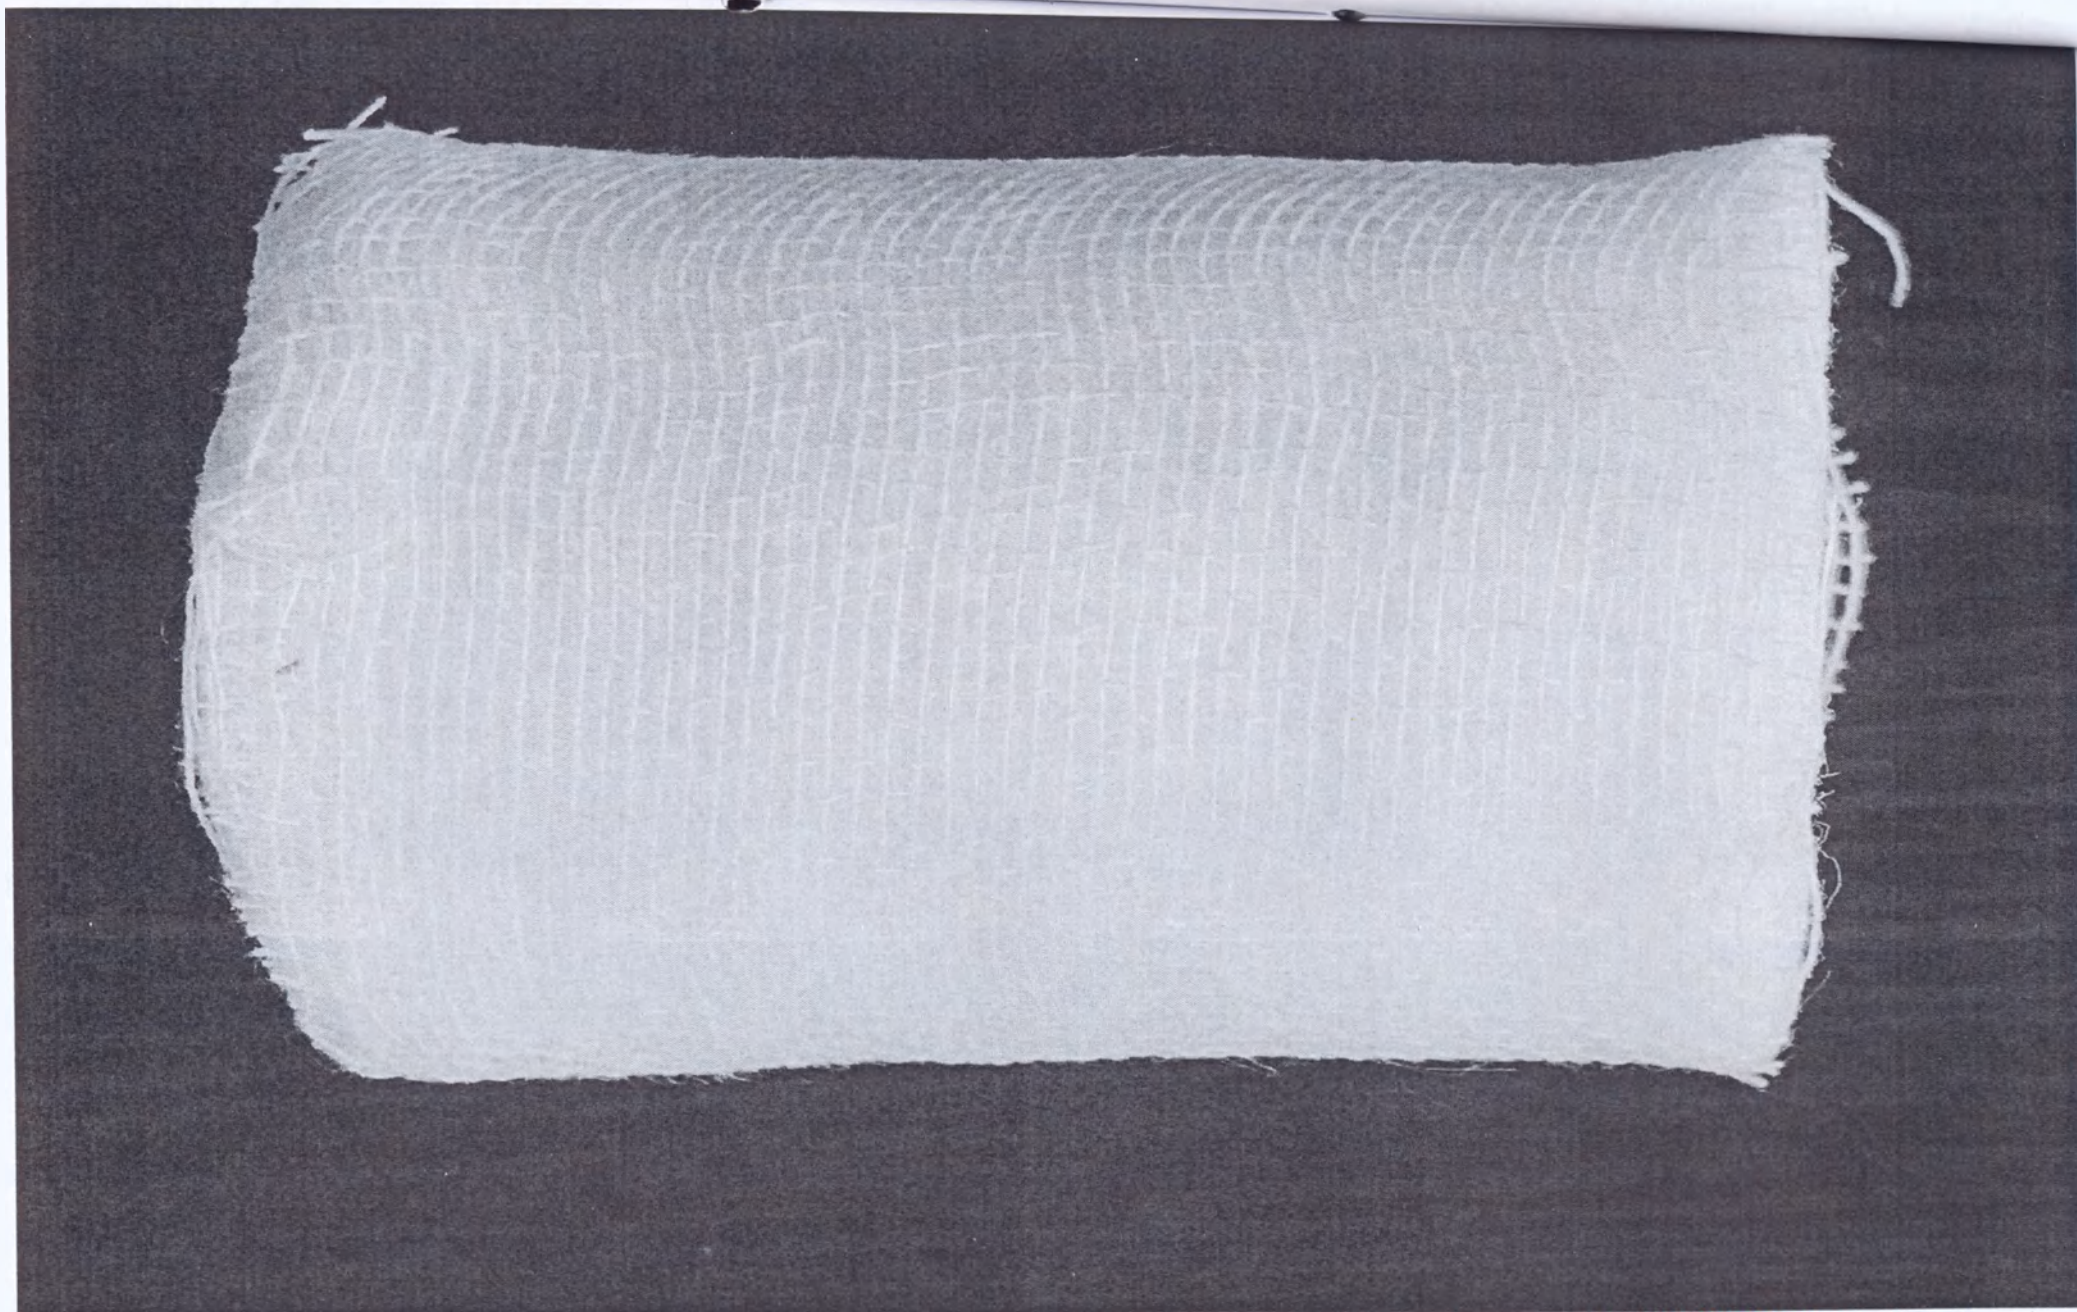


Фото 5. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 7 м x 5 см

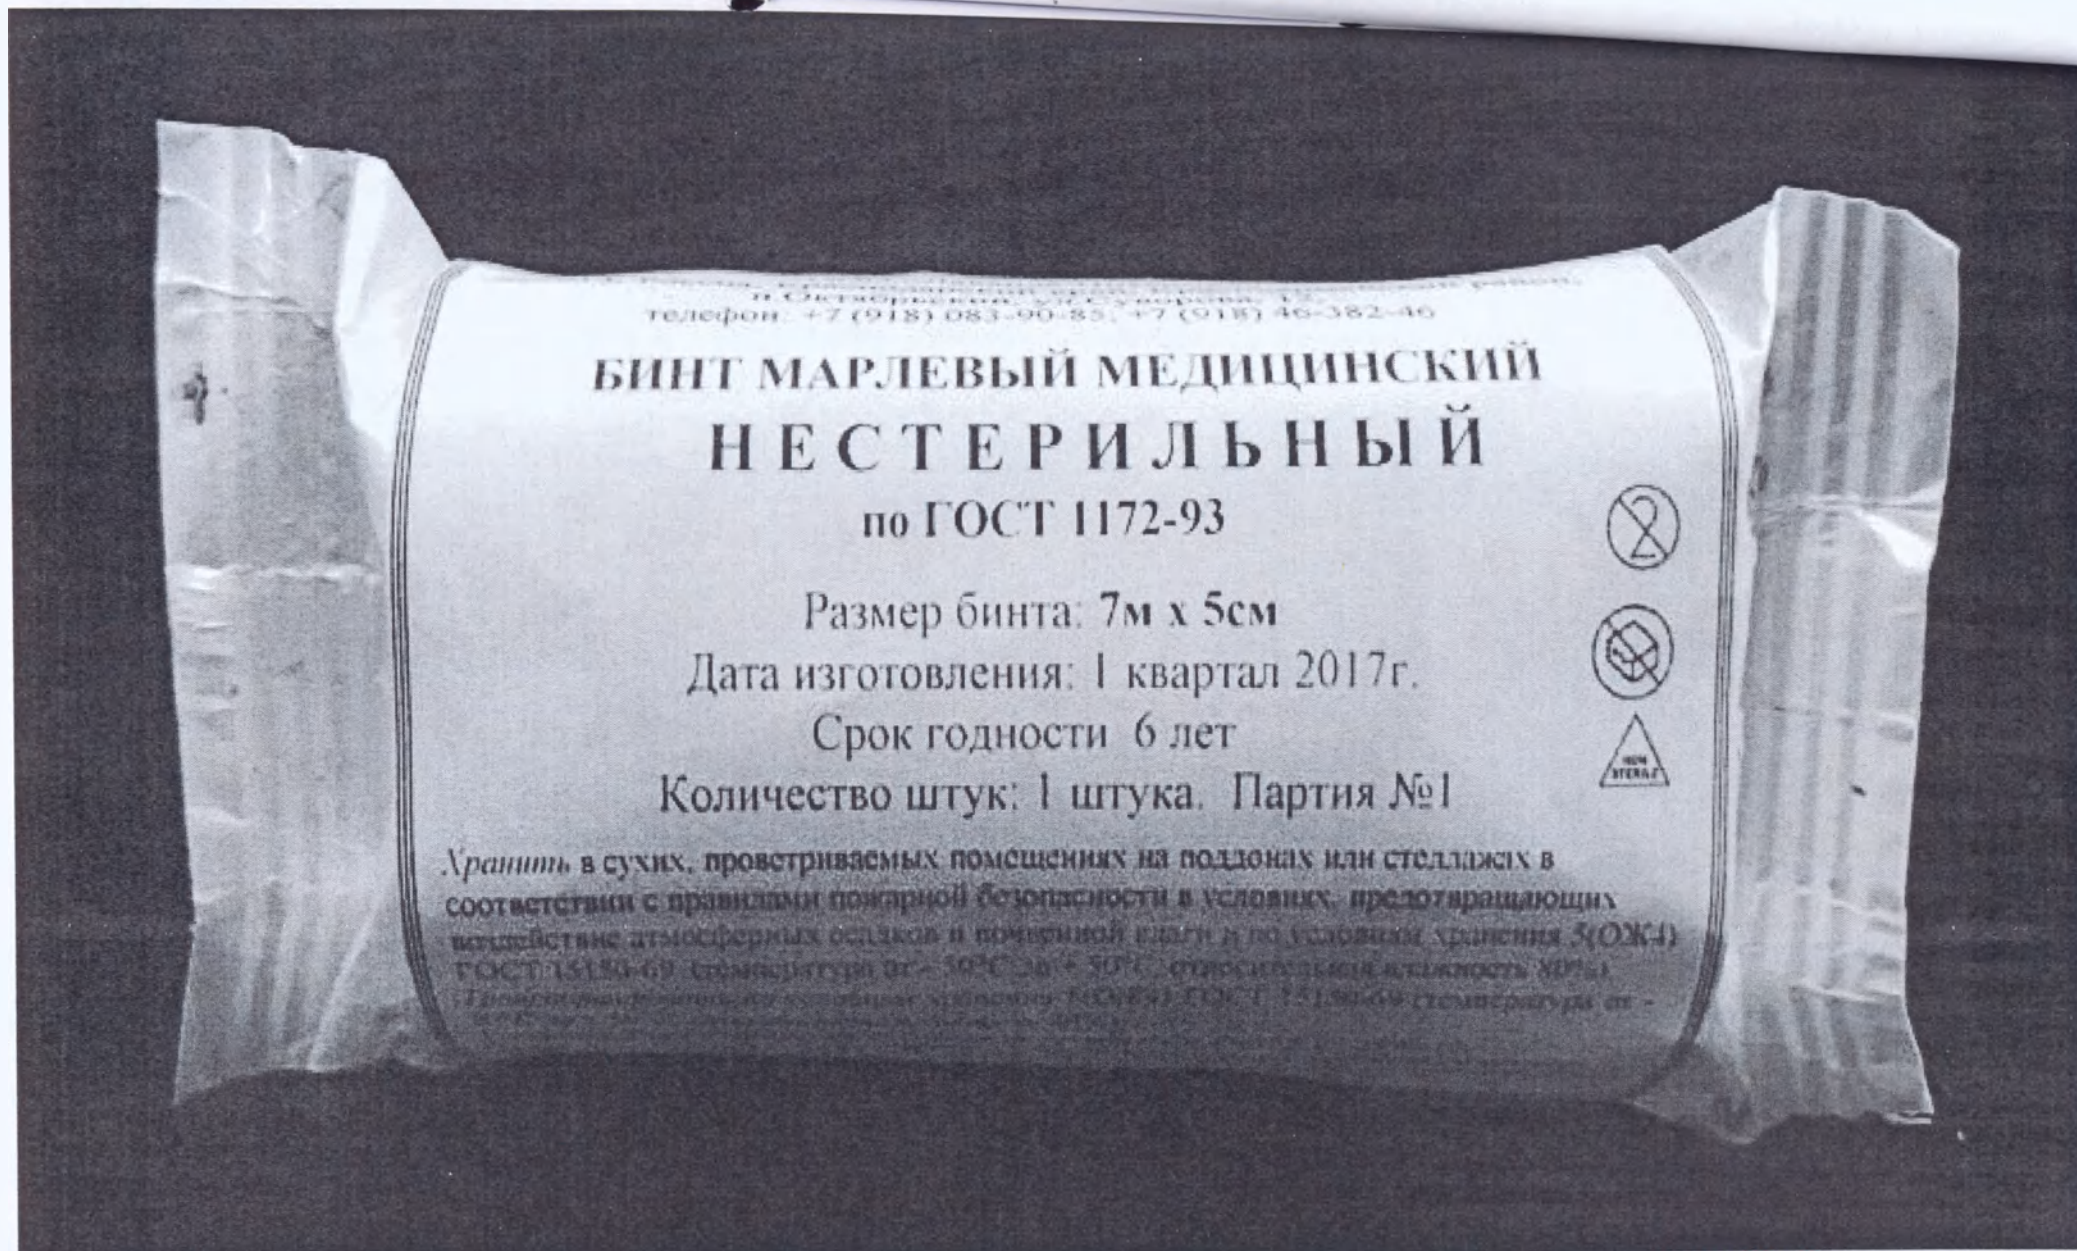


Фото 6. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 7 м x 5 см
На примере упаковки – Бинт в индивидуальной упаковке (пленка полипропиленовая) – 1 шт.

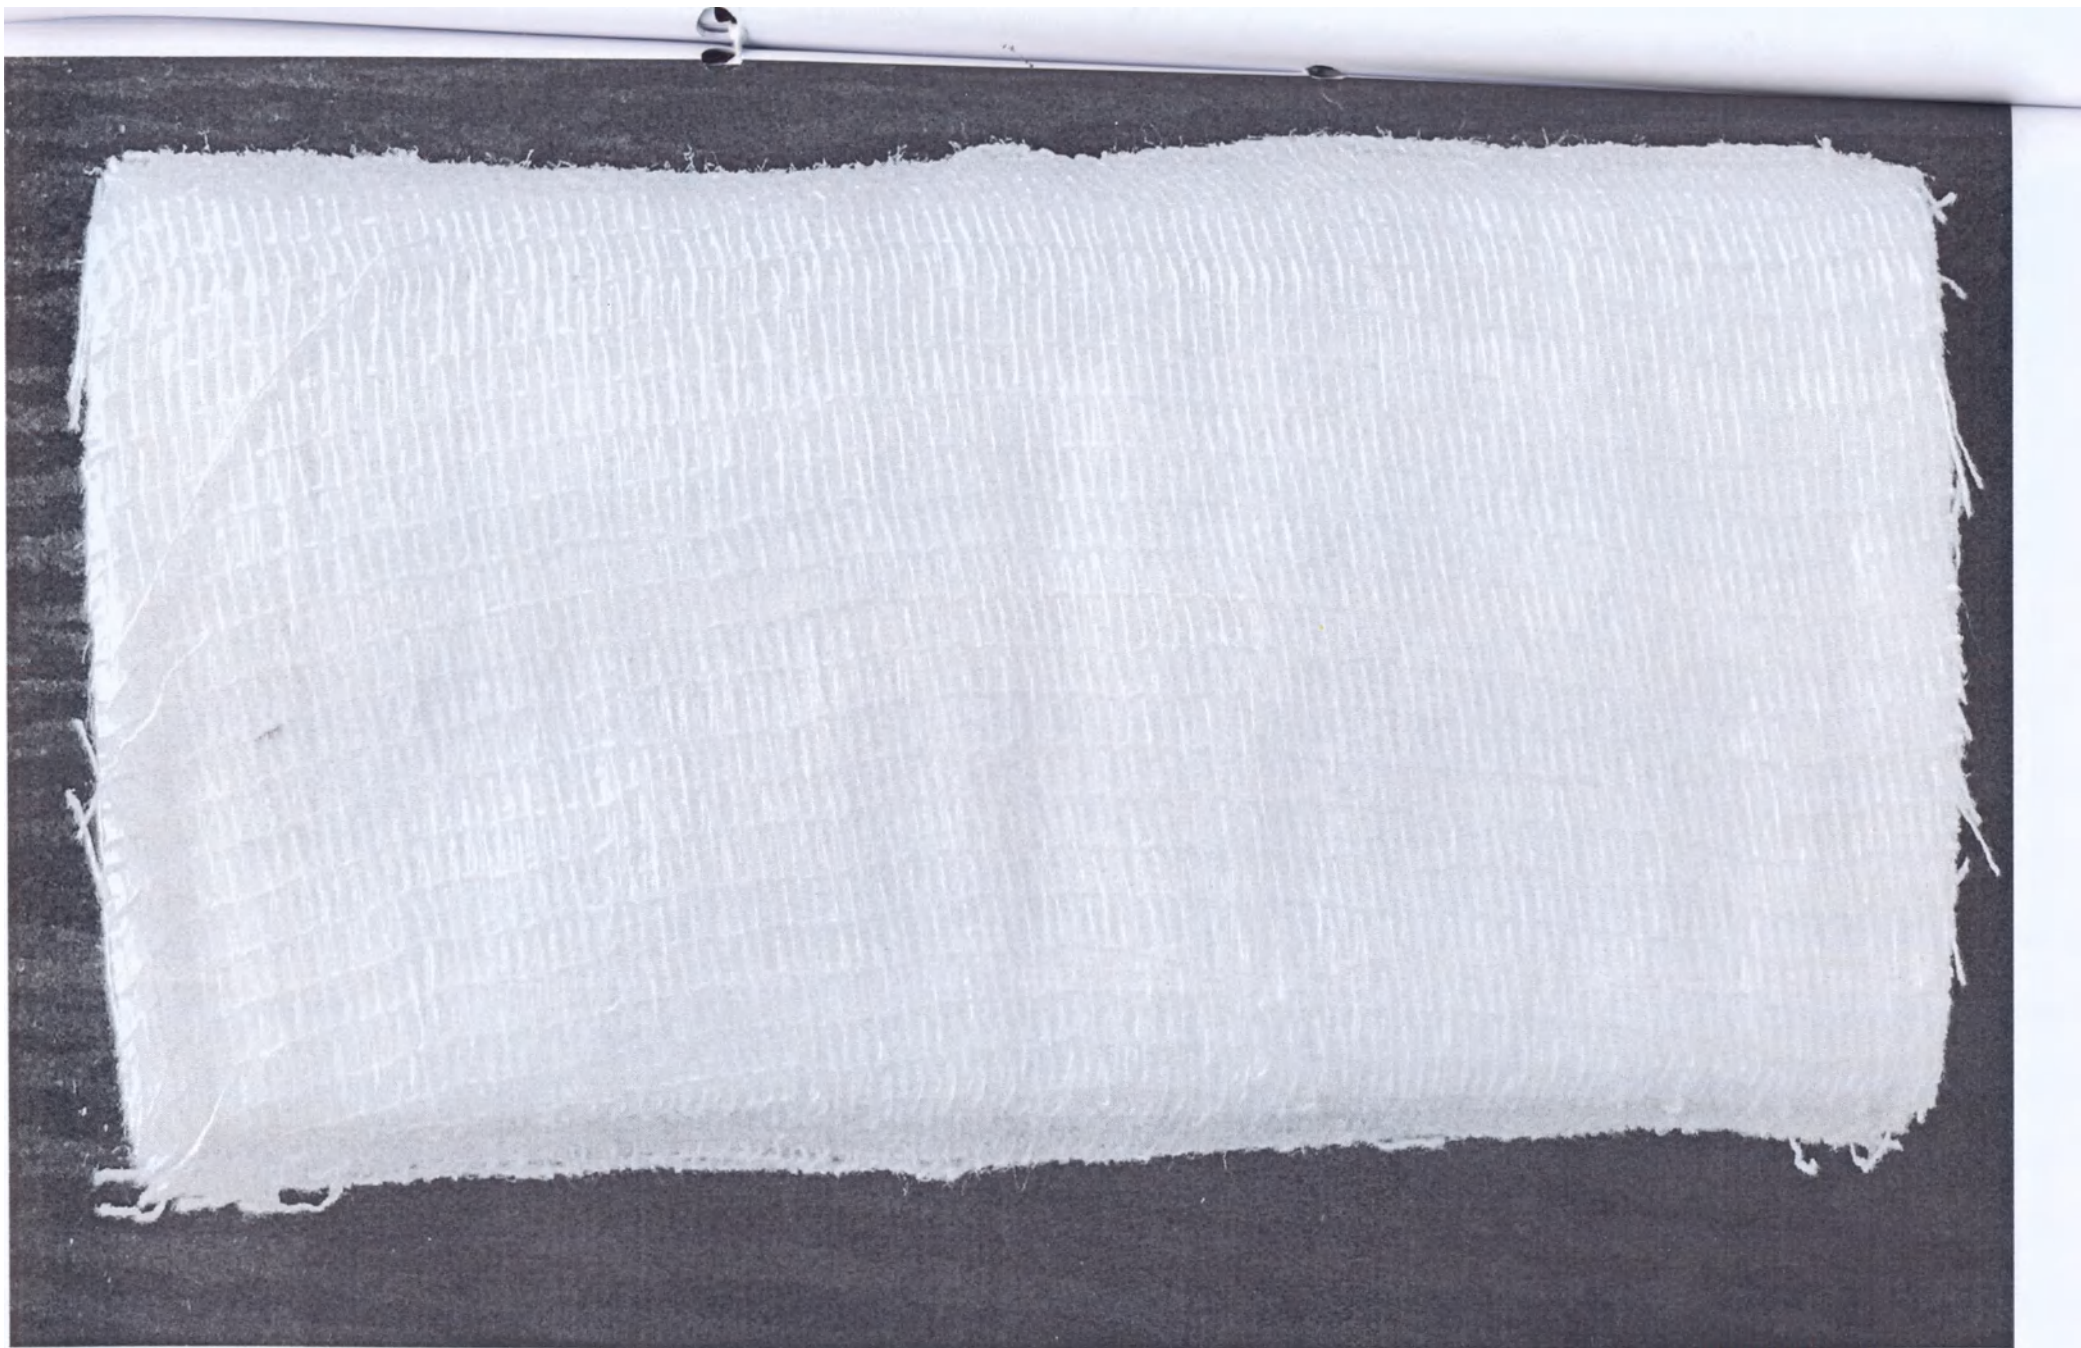


Фото 7. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 7 м x 10 см

телефон +7 (212) 083-00-33 +7 (212) 46-582-46
**БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**

по ГОСТ 1172-93

Размер бинта: 7м x 10см

Дата изготовления: 1 квартал 2017г.

Срок годности: 6 лет

Количество штук: 1 штука. Партия №1

Хранить в сухих, проветриваемых помещениях на поддонах или стеллажах
в соответствии с правилами пожарной безопасности и условиях, предотвращающих
воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 5(СЖ4);
ГОСТ 15150-69 температура от - 50°С до + 50°С, относительная влажность 80% и
Транспортировать по условиям хранения 5(СЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от



Фото 8. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 7 м x 10 см
На примере упаковки – Бинт в индивидуальной упаковке (пленка полиэтиленовая) – 1 шт.

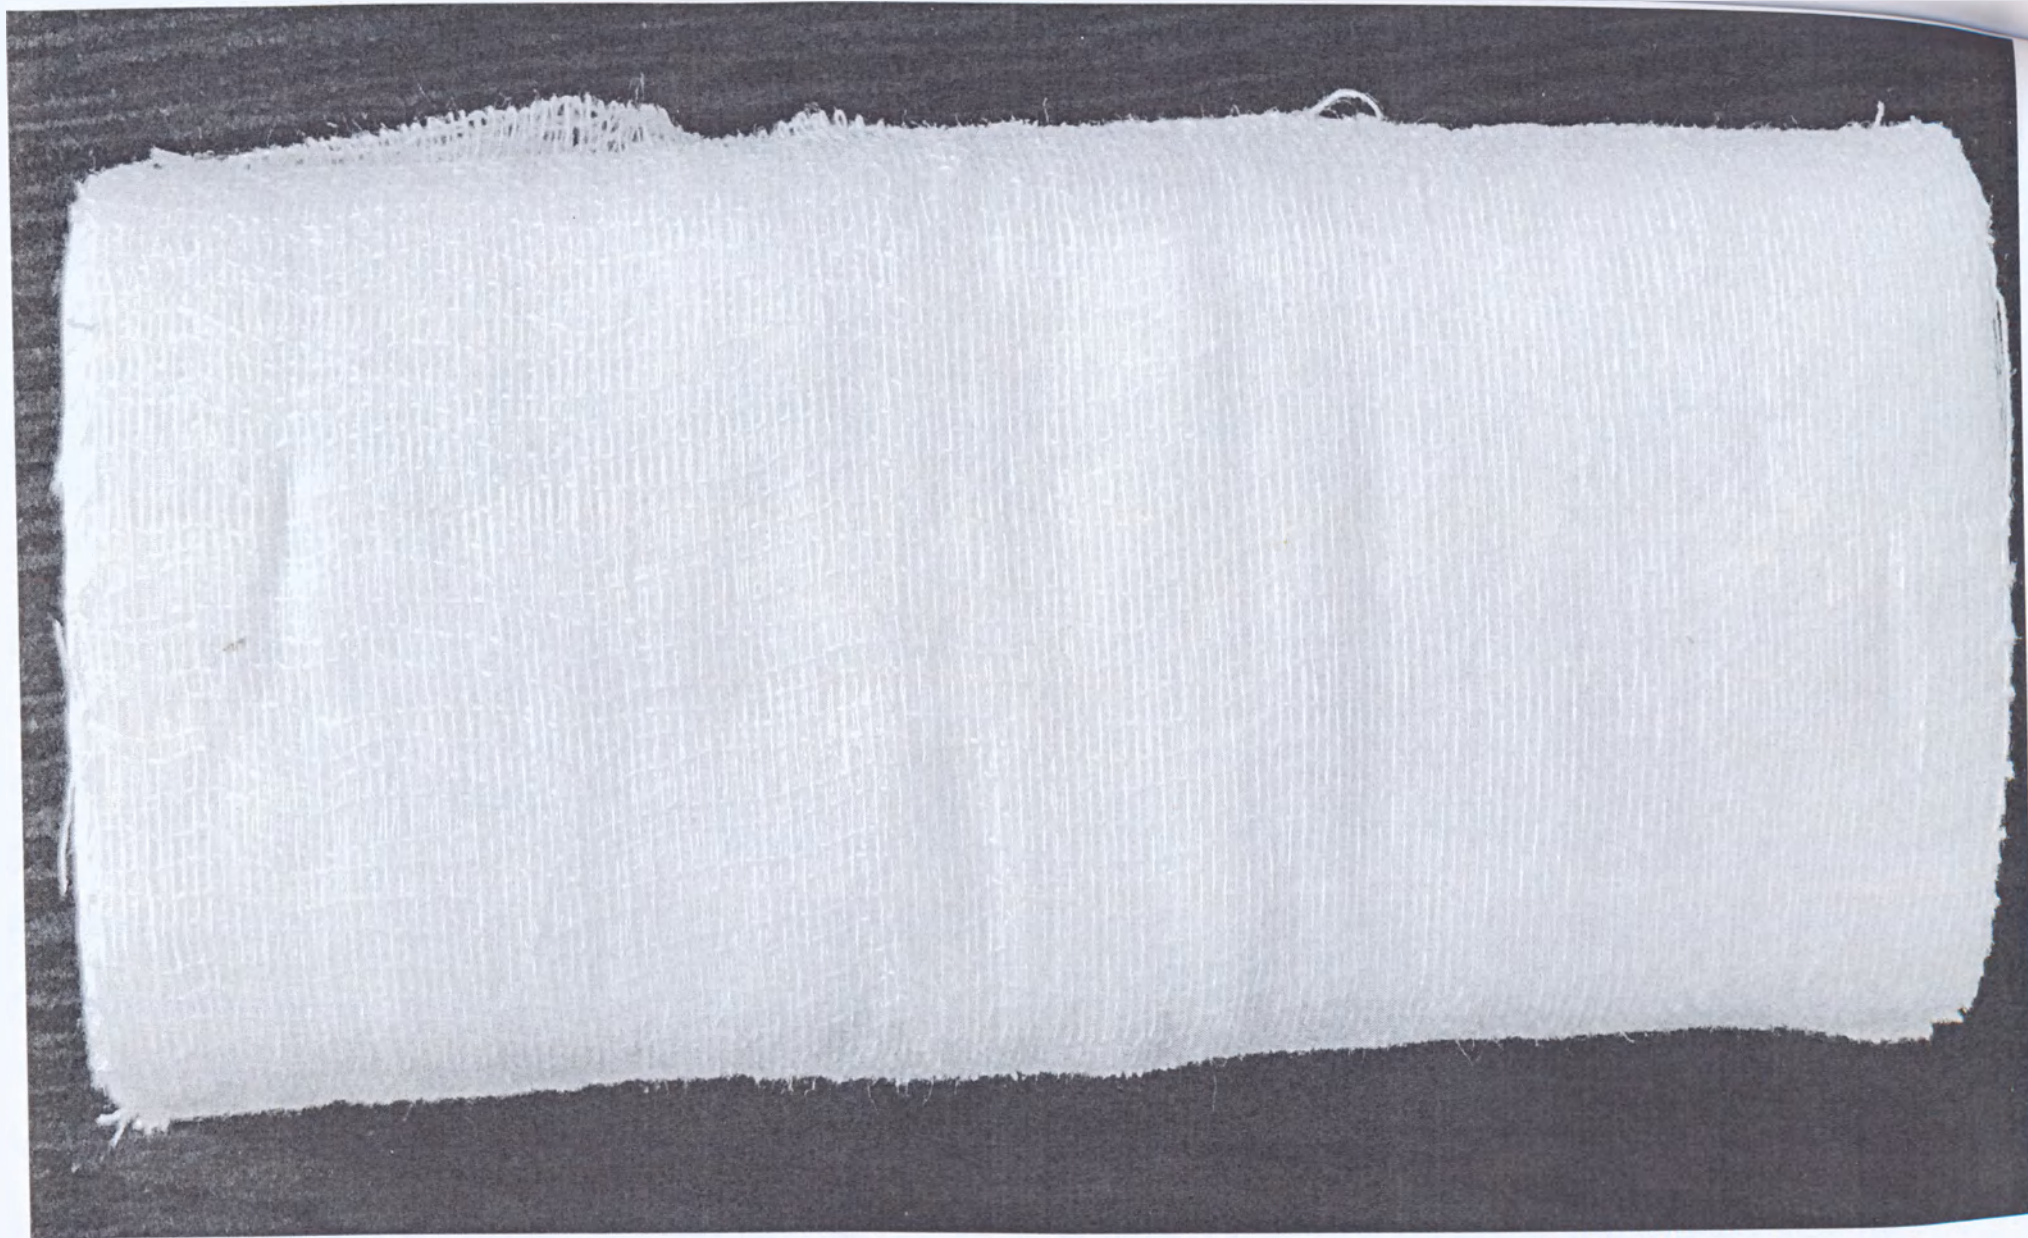


Фото 9. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 7 м х 14 см

**БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**
по ГОСТ 1172-93

Размер бинта: 7м x 14см

Дата изготовления: 1 квартал 2017г.

Срок годности: 6 лет

Количество штук: 1 штука. Партия №1

Хранить в сухих, проветриваемых помещениях на полках или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от - 50°C до + 50°C, относительная влажность 80%).

Транспортировать по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура



Фото 10. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 7 м x 14 см
На примере упаковки – Бинт в индивидуальной упаковке (пленка полиэтиленовая) – 1 шт.

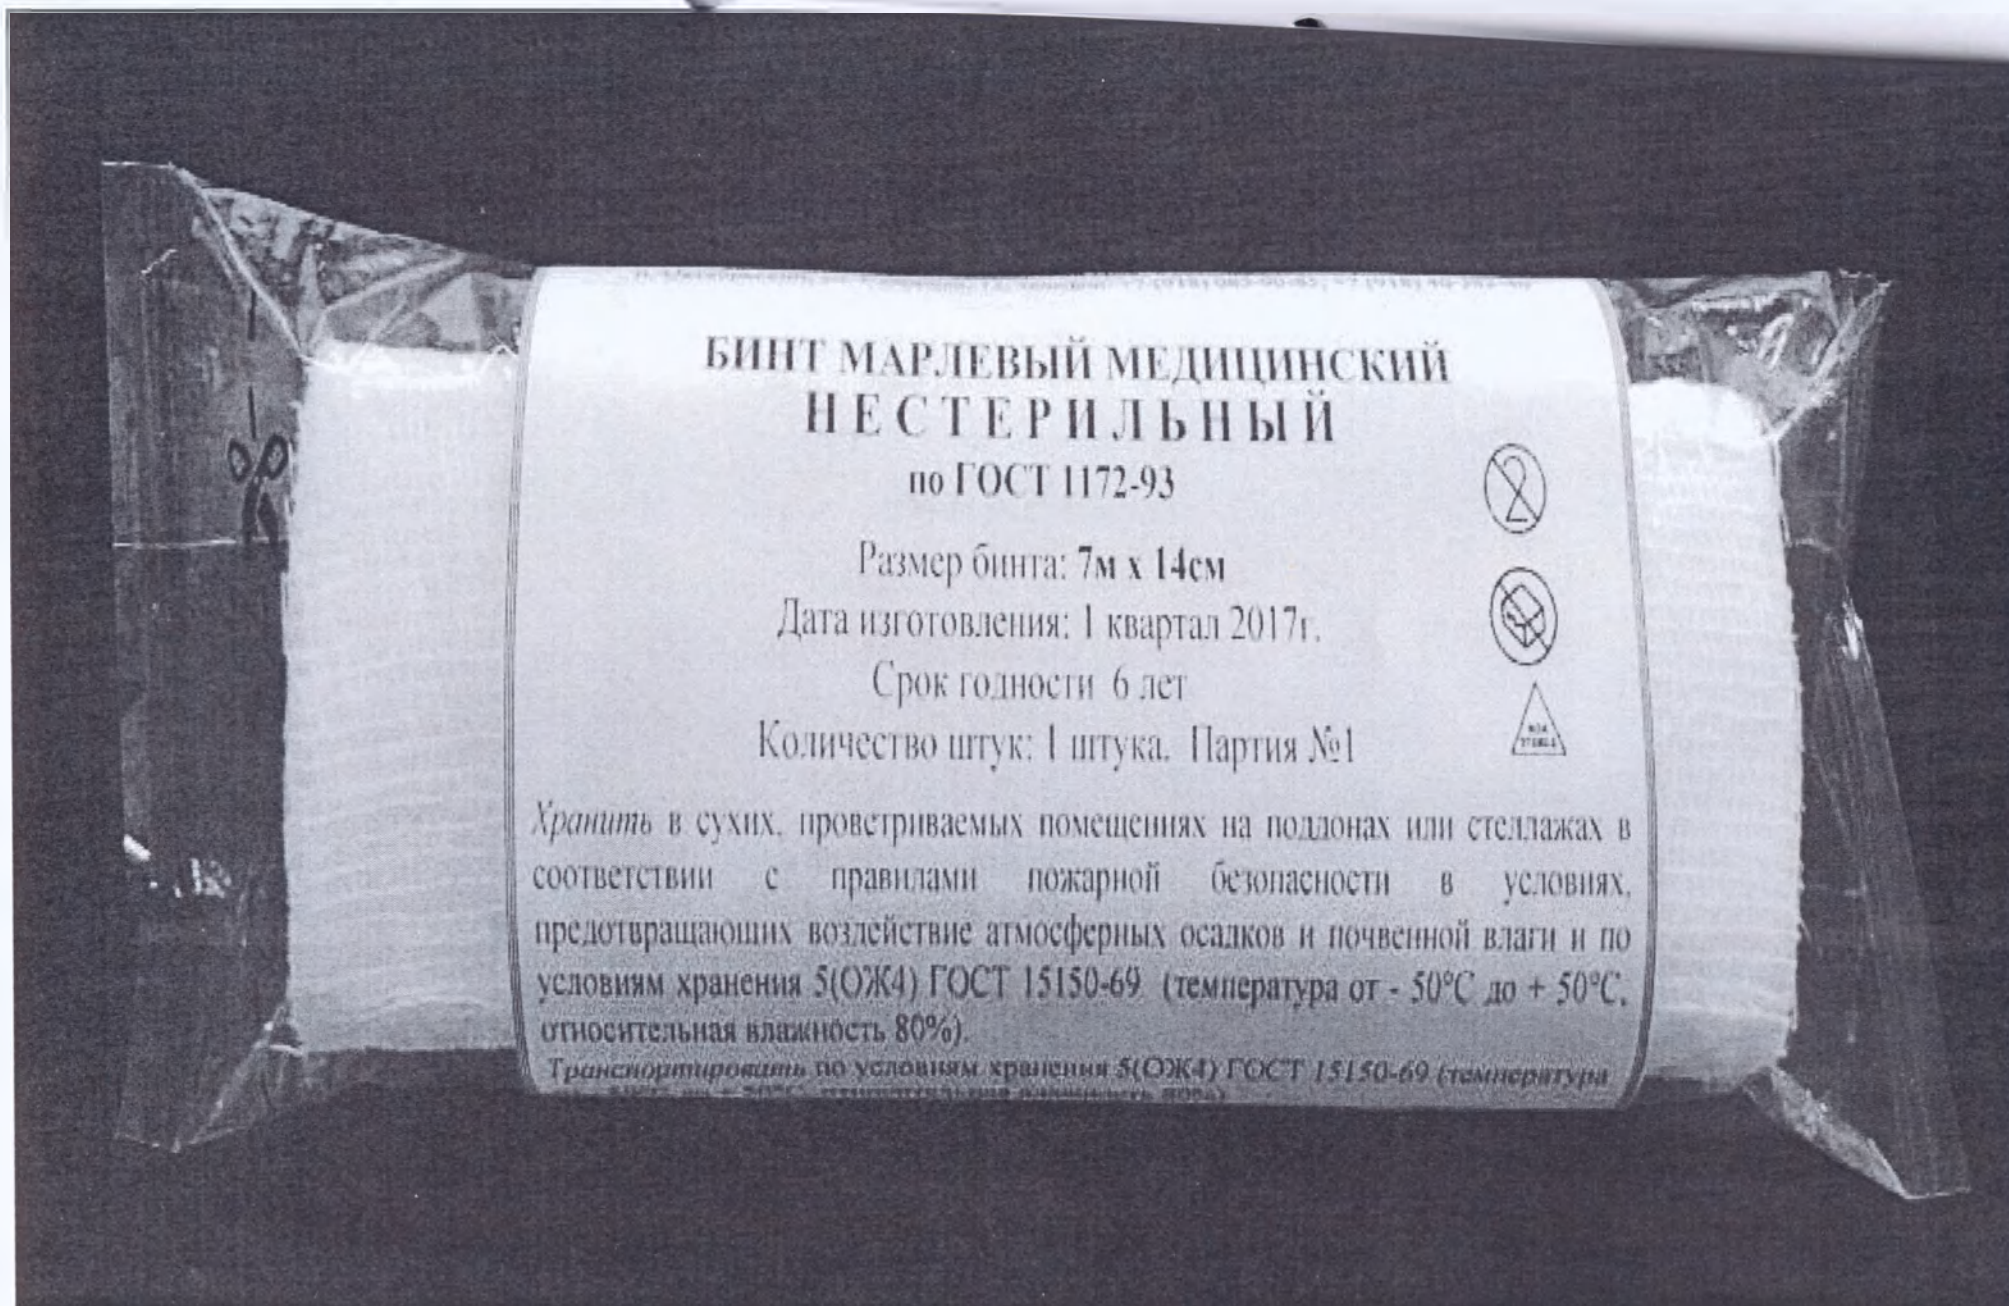


Фото 10. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 7 м x 14 см
На примере упаковки – Бинт в индивидуальной упаковке (пленка полиэтиленовая) – 1 шт.

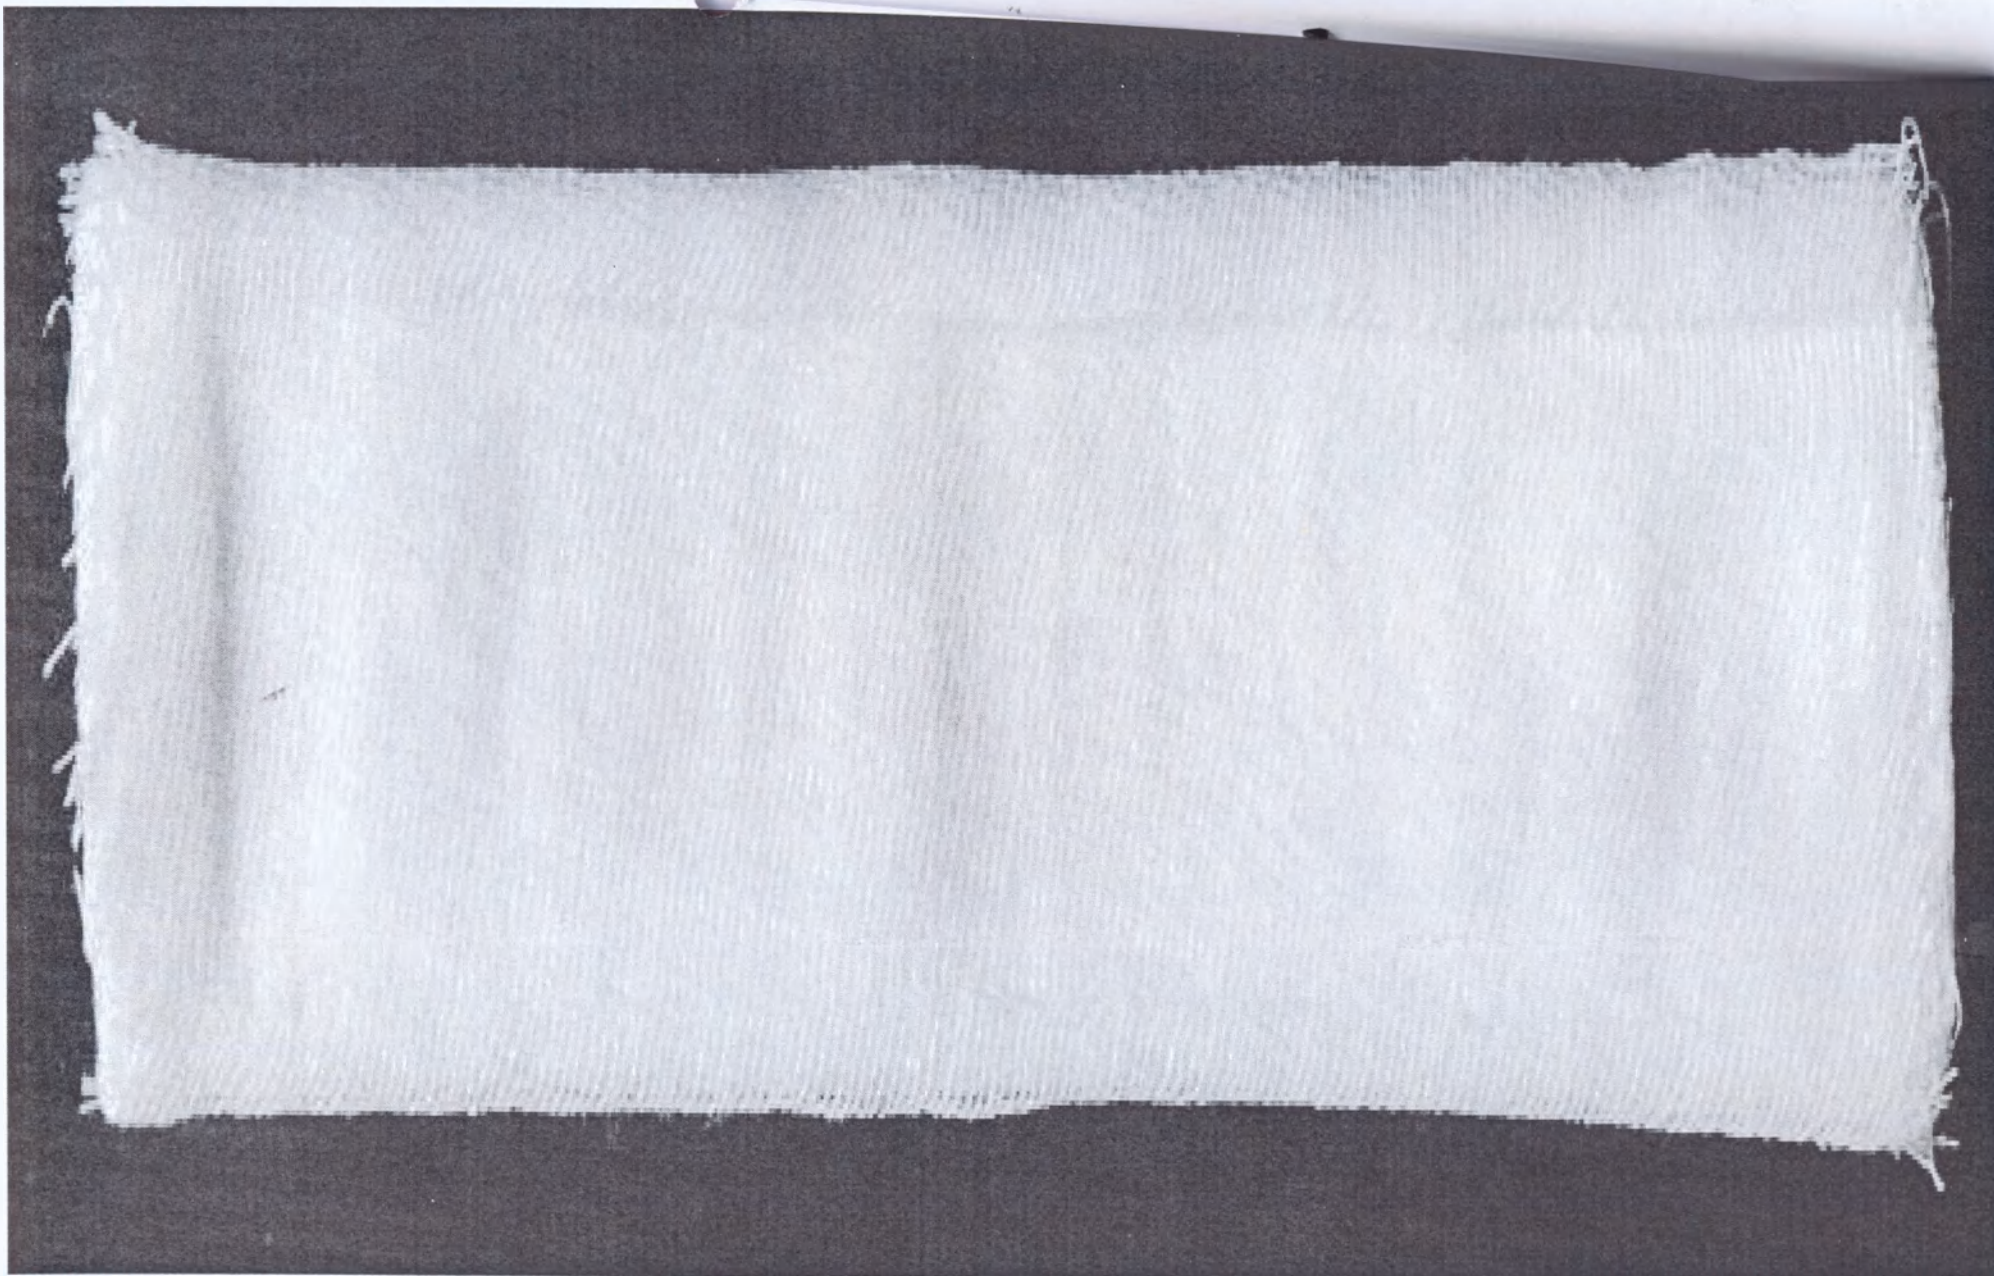


Фото 11. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 10 м x 16 см

ООО «Лаванда-Интермед»
353814 Россия, Краснодарский край, Красноармейский район,
п. Октябрьский, ул. Суворова, 12
телефон: +7 (918) 083-90-85; +7 (918) 46-382-46

**БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ**

Размер бинта: 10м x 16см
Дата изготовления: 1 квартал 2017г.
Срок годности: 6 лет
Количество штук: 5 штук. Партия №1

Хранить в сухих, проветриваемых помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от - 50°C до + 50°C, относительная влажность 80%).

Транспортировать по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от - 50°C до + 50°C, относительная влажность 80%).

Утилизация как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

В домашних условиях неиспользованные бинты утилизировать как бытовые отходы.

Место производства

ООО «Лаванда-Интермед», 353814 Россия, Краснодарский край, Красноармейский район,
п. Октябрьский, ул. Суворова, 14а

№ РЗНот



Фото 12. Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93: 10 м x 16 см
На примере упаковки – Бинт в групповой упаковке (пленка полиэтиленовая) – 5 шт.

Сшито и заверено печатью 13

(м.п.) лист 06

Общество с ограниченной ответственностью
«Счастье»
ОГРН 10332020437
Счастьинский район Хабаровского края

ООО «Лаванда-Лит»
Б.Б. Коробко
Директор

103360162
Хабаровская область