

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности определения ТТГ
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i «ТТГ Калибраторы (Alinity i TSH
Calibrators)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i TSH Calibrators



CONTAINS: AZIDE

		CONC	CONC
		$\mu\text{IU/mL}$	mIU/L
CAL 1	1 x 3.0 mL	0	0
CAL 2	1 x 3.0 mL	40	40



www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF

07P4801



Exp.

2018-04-24


LOT

75162UI00





G70695R02

R01



(01) 00380740131128 (17) 180424
(10) 75162UI00 (240) 07P4801 (91) TSH

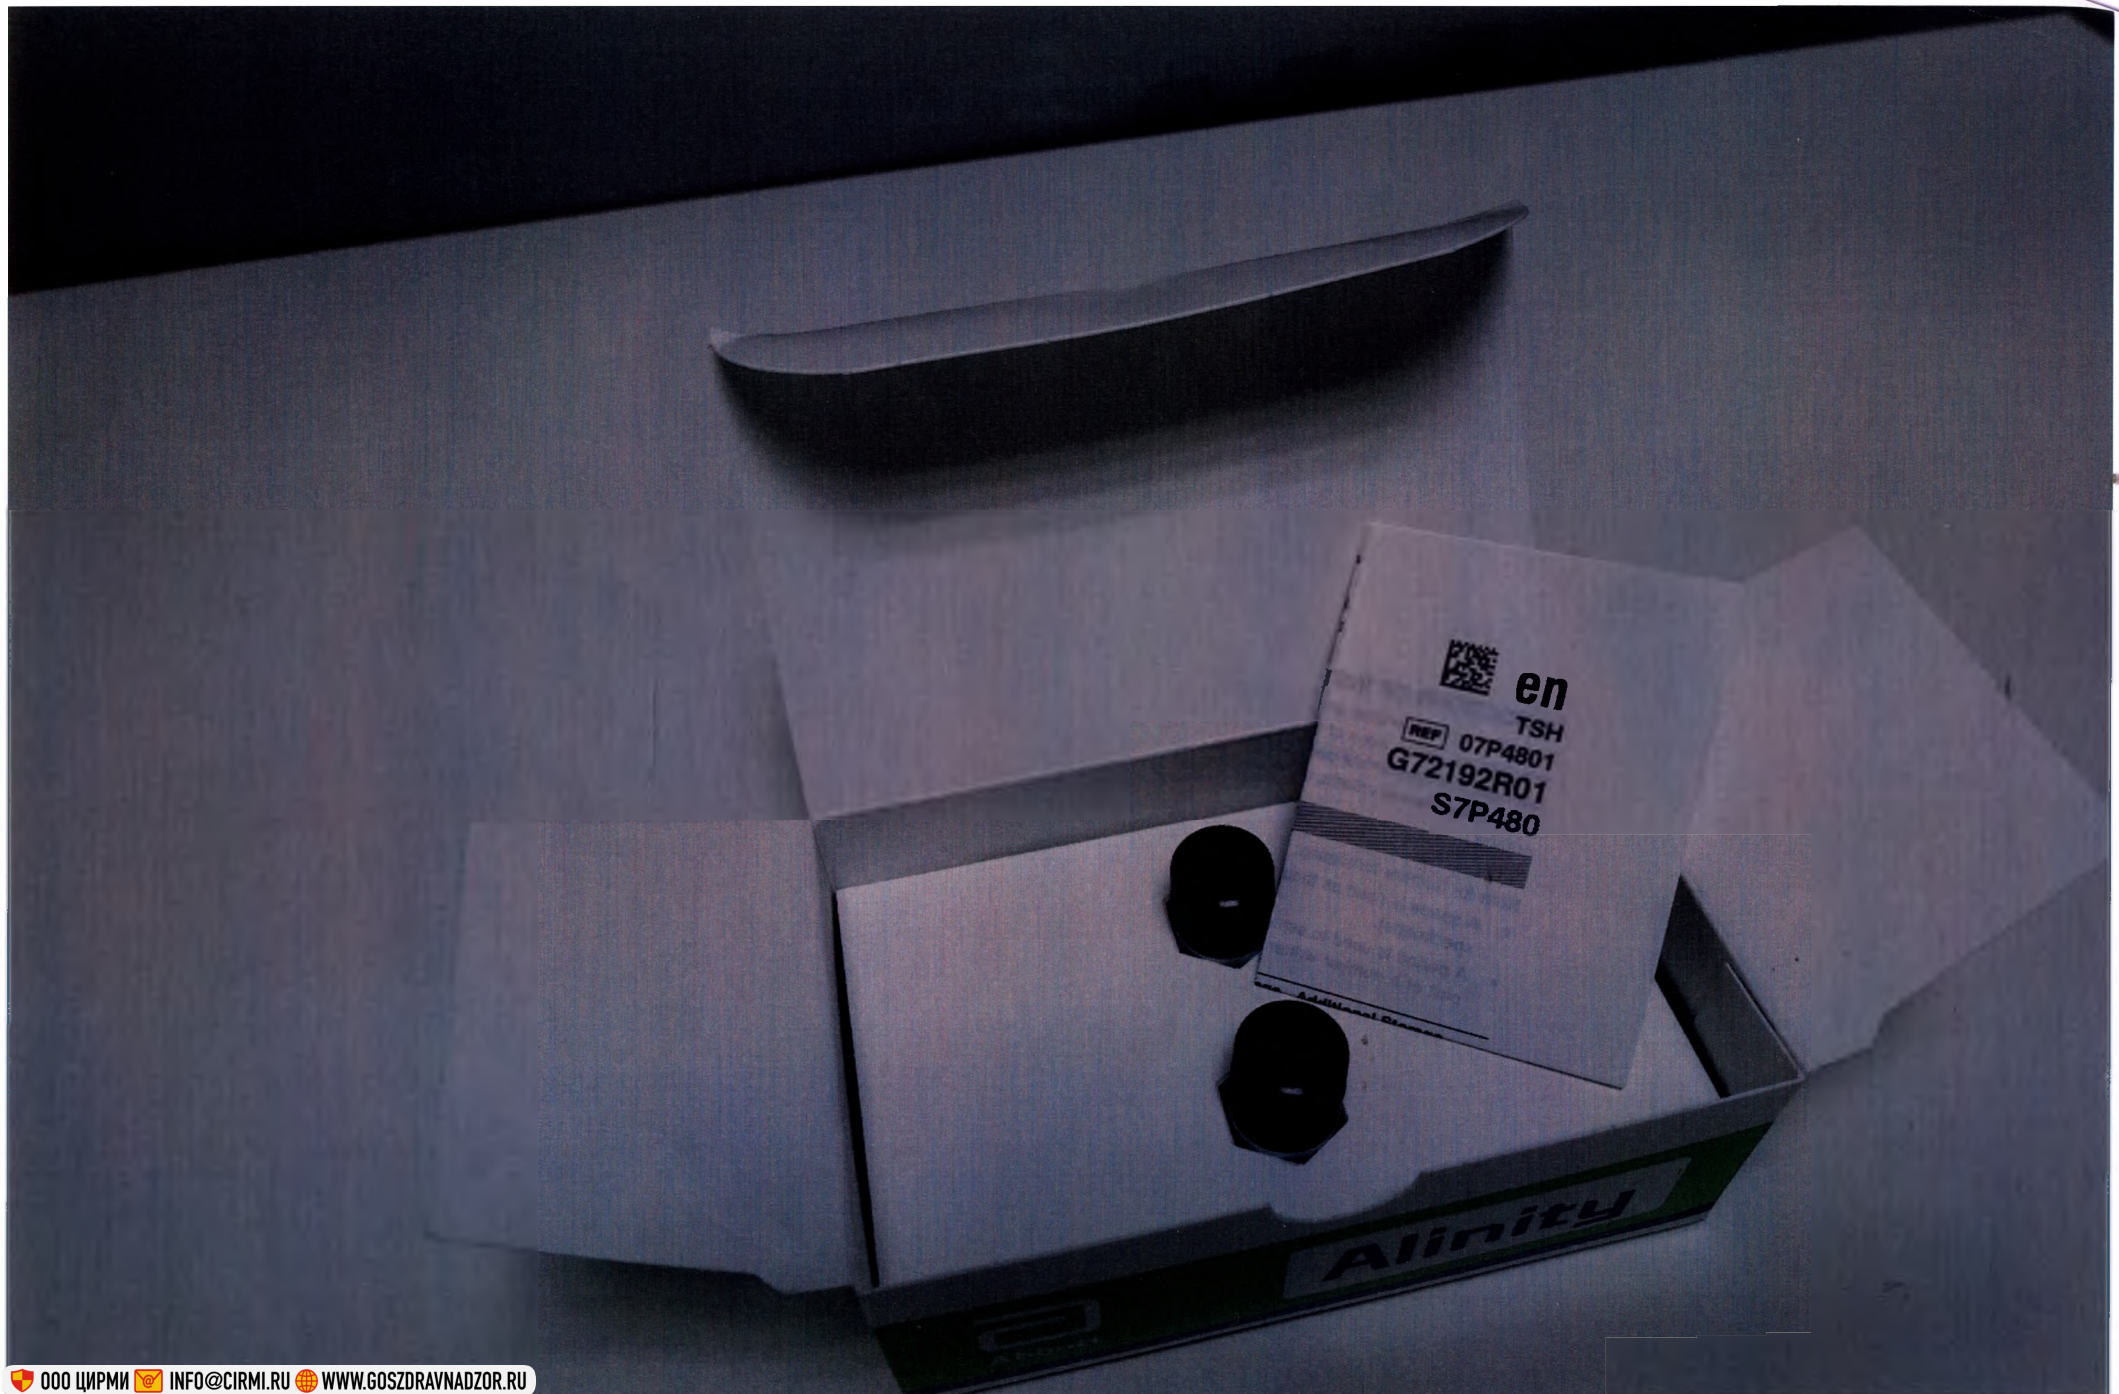

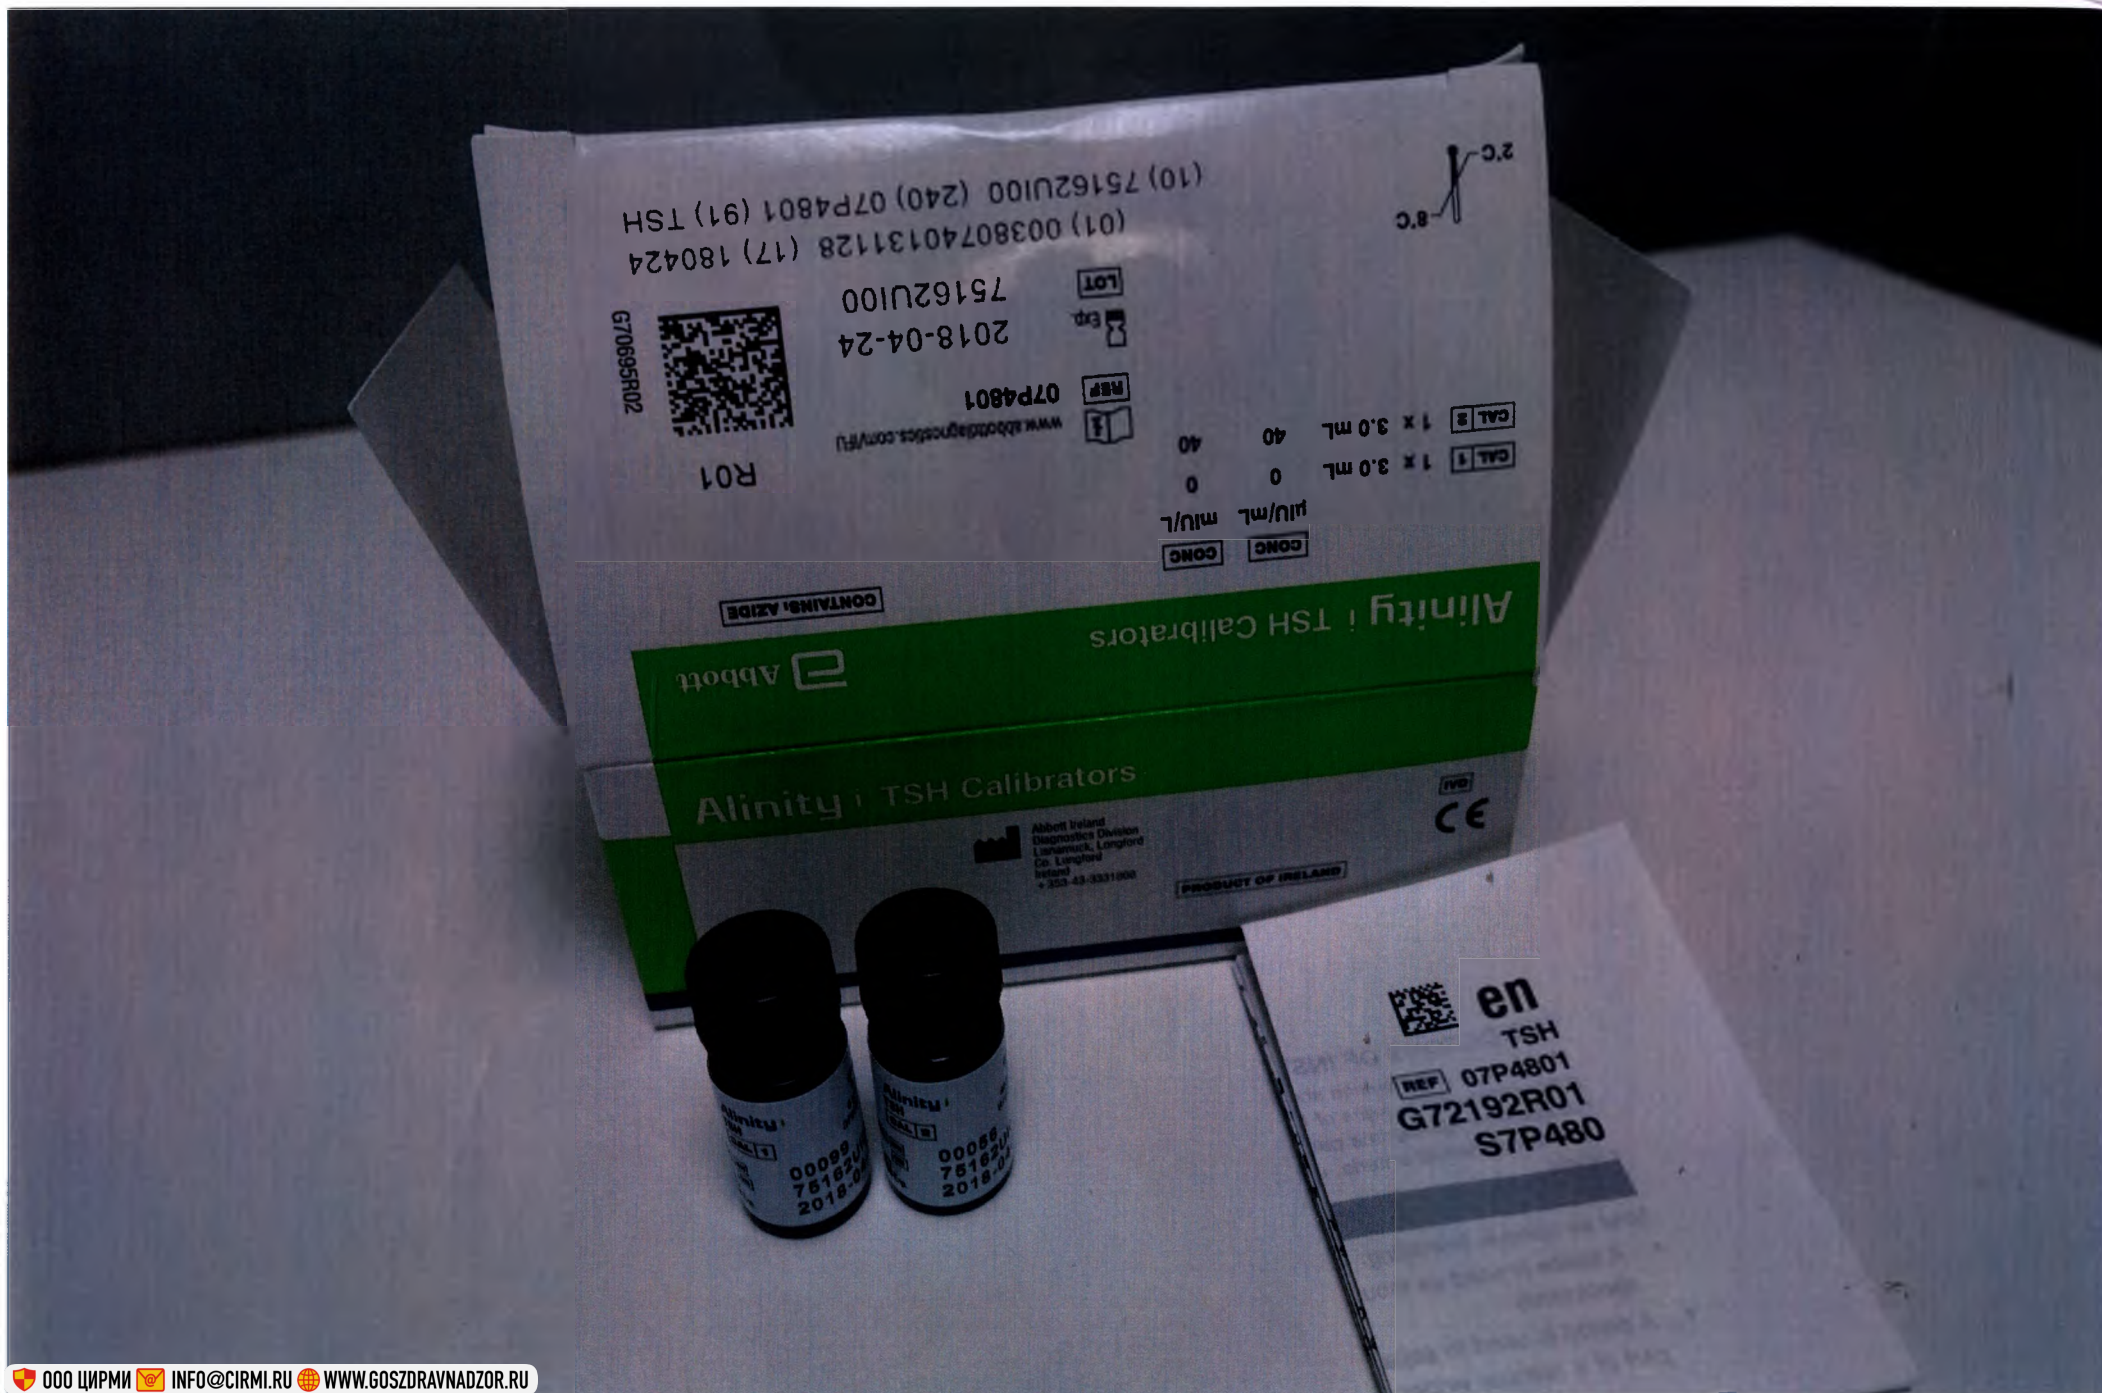



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов

Подпись

