

- Выписка из технической документации медицинского изделия «Материал композитный пломбировочный светового отверждения CHARISMA CLASSIC в наборах и отдельных упаковках»;
 - Инструкция по применению на медицинское изделие «Материал композитный пломбировочный светового отверждения CHARISMA CLASSIC в наборах и отдельных упаковках»;
 - Фотографии медицинского изделия;
 - Отчет о клинической оценке Материал композитный пломбировочный светового отверждения CHARISMA CLASSIC, версия 1 от 08.2013 г.;
- Указанные документы представлены в полном объеме и соответствуют требованиям, изложенным в Приказе № 2н.

2. Идентификация и описание испытываемого медицинского изделия

Ознакомление с образцами МИ проводилось в КЦС ФМБА России.

Представлены образцы материала:

- CHARISMA CLASSIC SYR COMBI KIT 8x4 g+ G2B лот 8
 - CHARISMA CLASSIC SYR REFILL в шприце 4г – 1 шт., оттенка – А4 лот 010023А;
 - CHARISMA CLASSIC SYR REFILL в шприце 4г – 1 шт., оттенка – В3 лот 010024А;
 - CHARISMA CLASSIC SYR REFILL в шприце 4г – 1 шт., оттенка – ОА3.5 лот 010023;
- Внешний вид образцов на фото 1-



Фото1

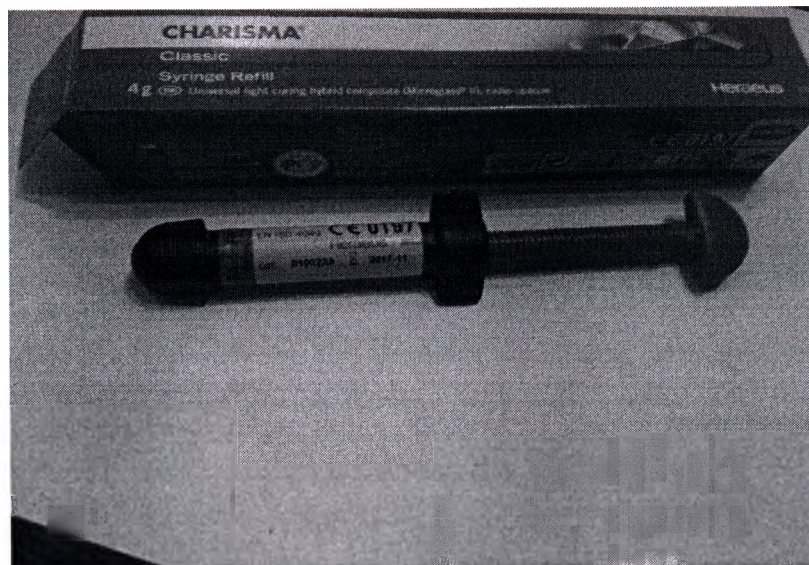


Фото 2

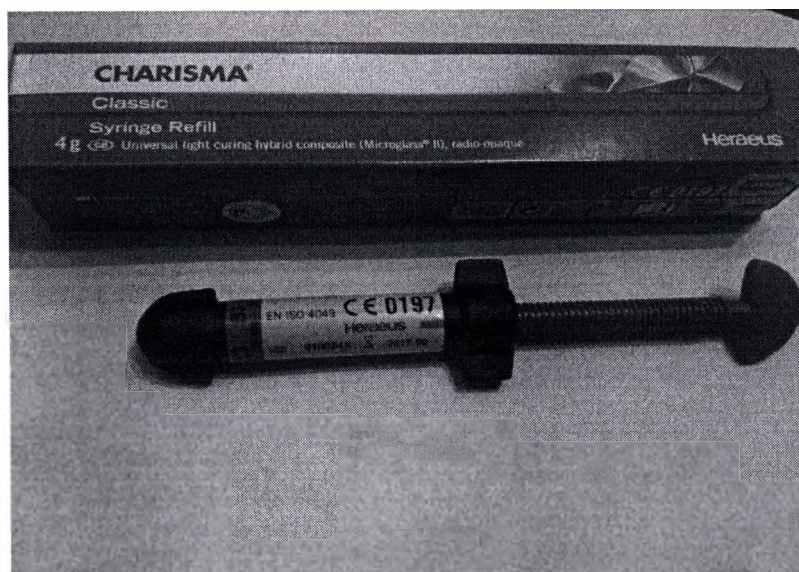


Фото 3

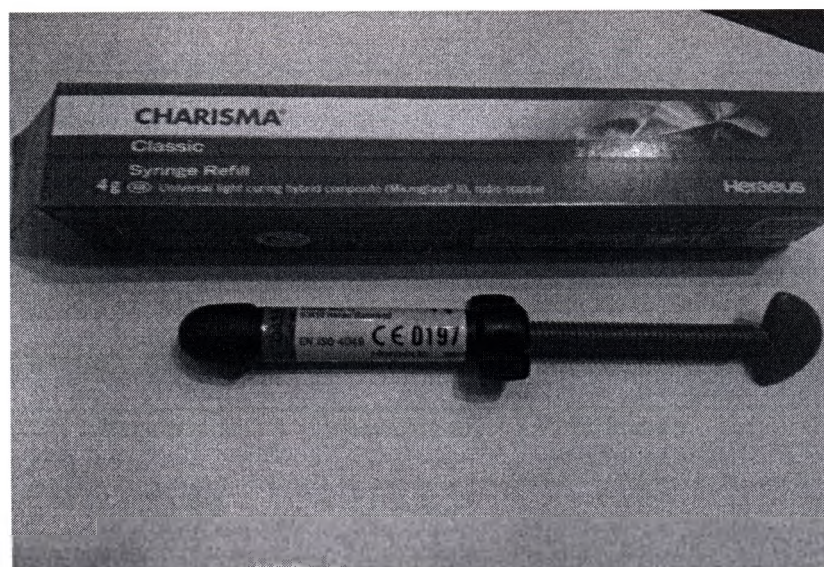


Фото 4