





### **Комплект поставки на фото:**

- 1 - расходомер воздуха (трубка Флейша)- 1 шт;
- 2 - блок преобразования – 1 шт;
- 3 - мундштук картонный одноразовый – 500 шт;
- 4 - носовой зажим – 1 шт;
- 5 - трубка соединительная – 2 шт;
- 6- комплект кабелей – 1 компл;
- 7 - калибровочный шприц – 1 шт;
- 8 - пакет программного обеспечения - 1 шт;
- 9 - компьютер и принтер - 1 компл;

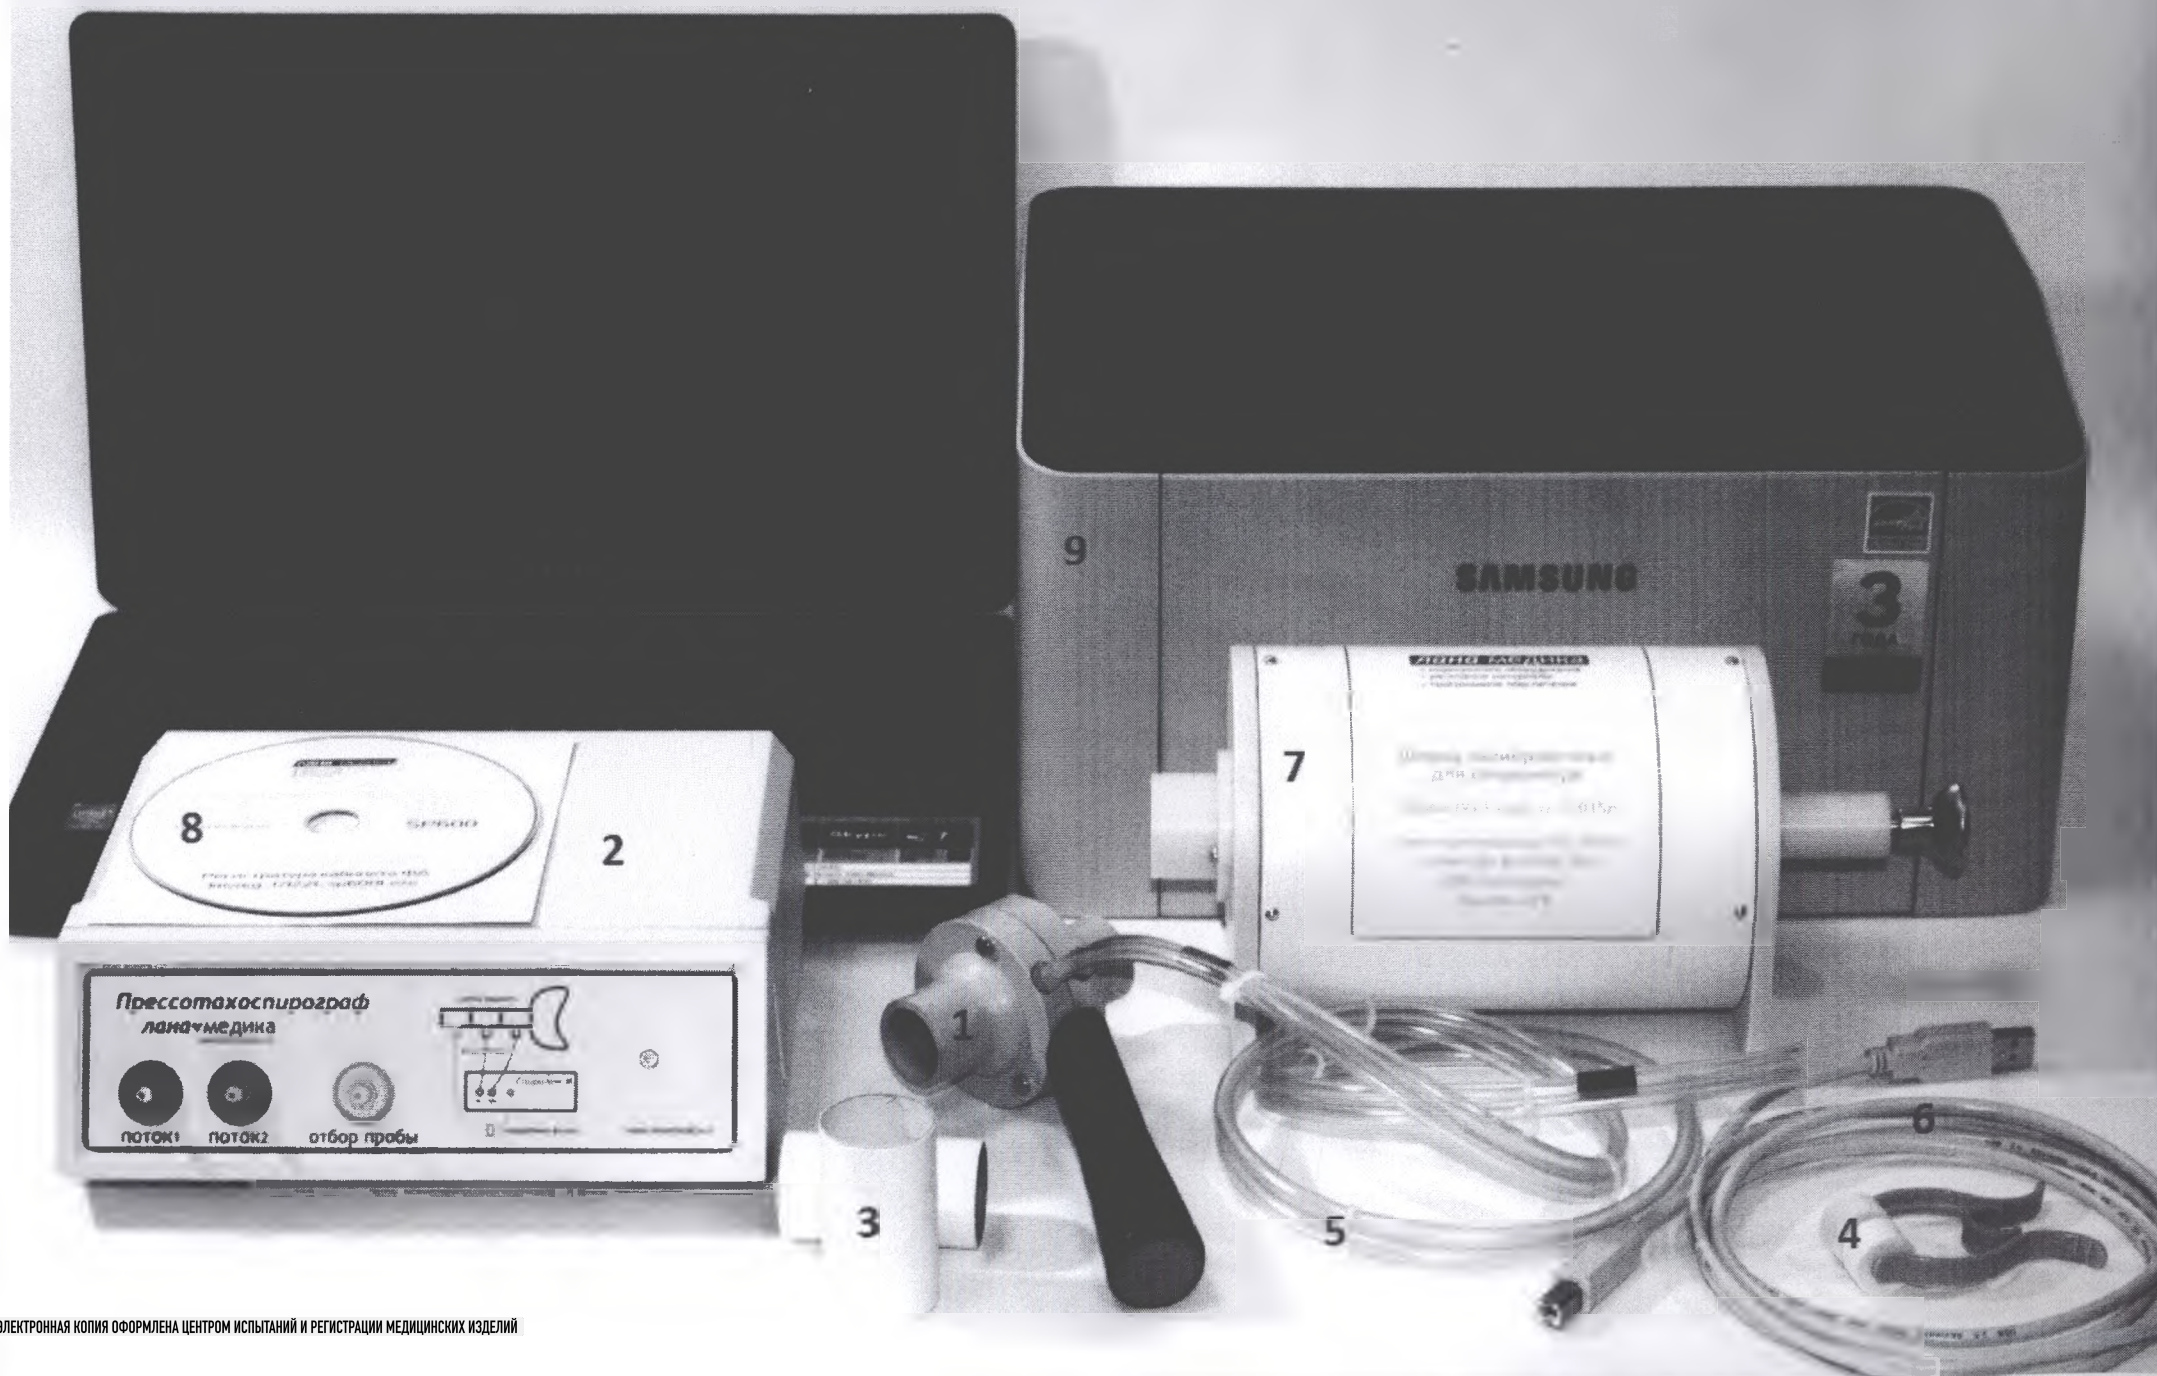

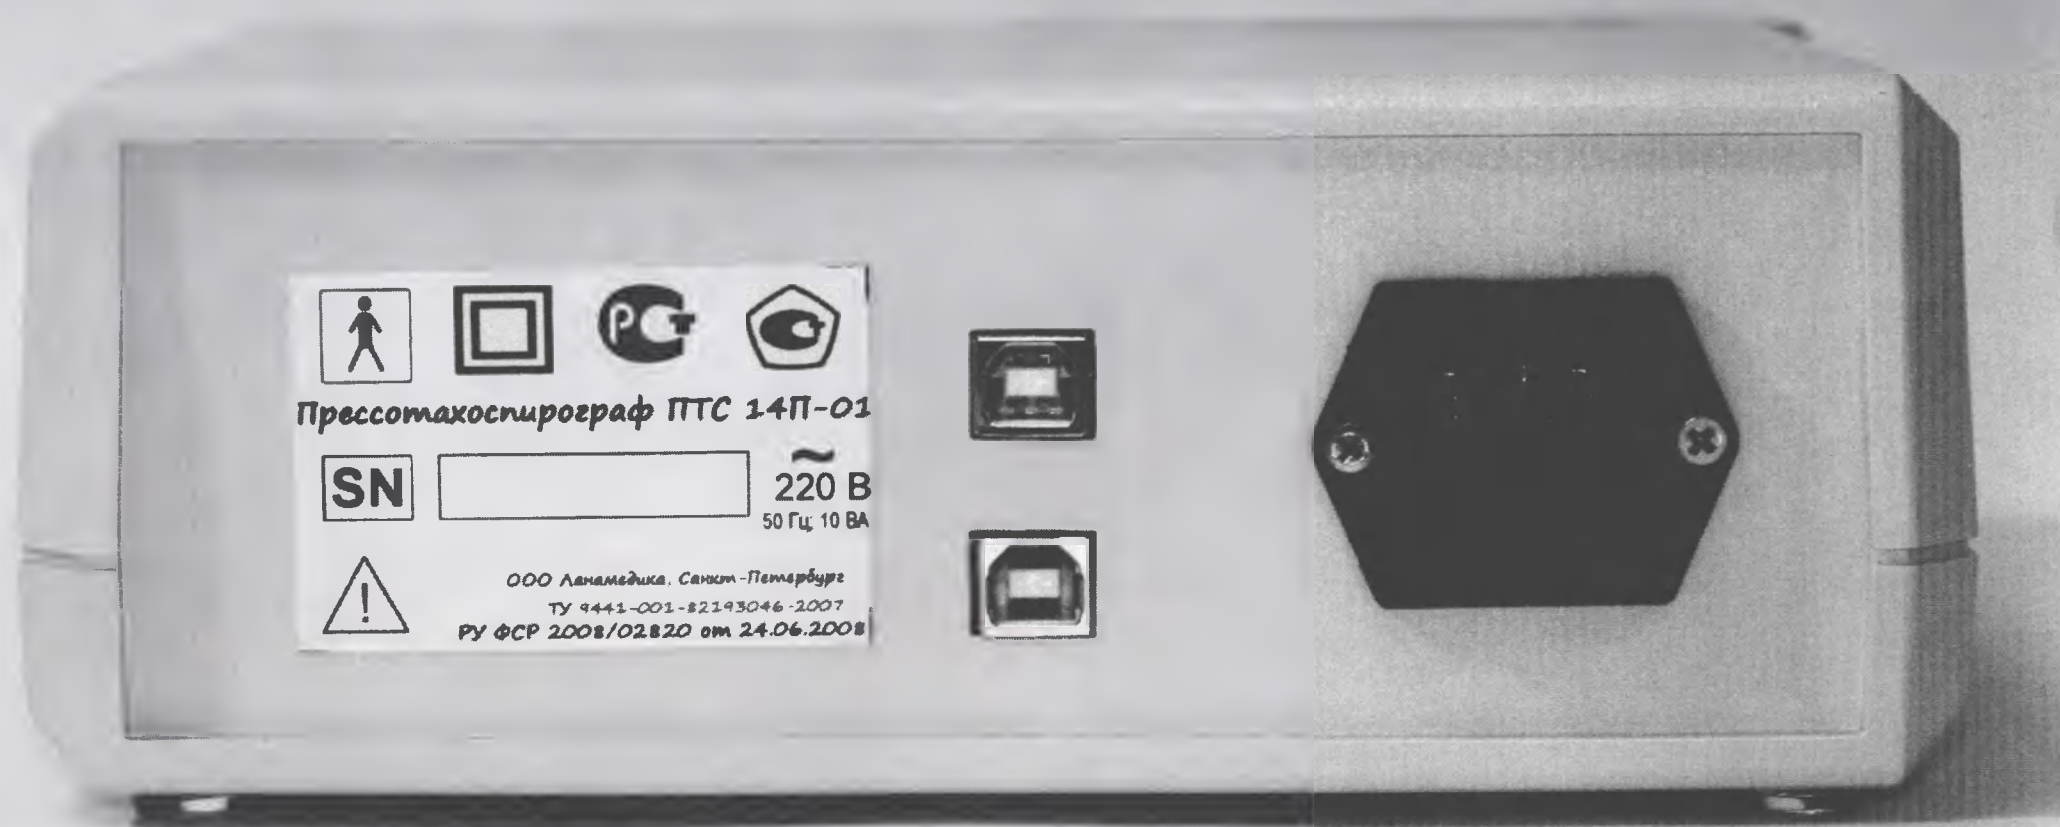

Прессотахоспирограф ПТС 14П-01

SN

220 В  
50 Гц 10 ВА



ООО Ланамедика, Санкт-Петербург  
ТУ 9441-001-82193046-2007  
ПУ ФСР 2008/02820 от 24.06.2008


*Задняя панель блока преобразования*

Промито!  
Кол-во! 4  
(четыре)  
места

Ген. директор

Ю.М.Букашкова



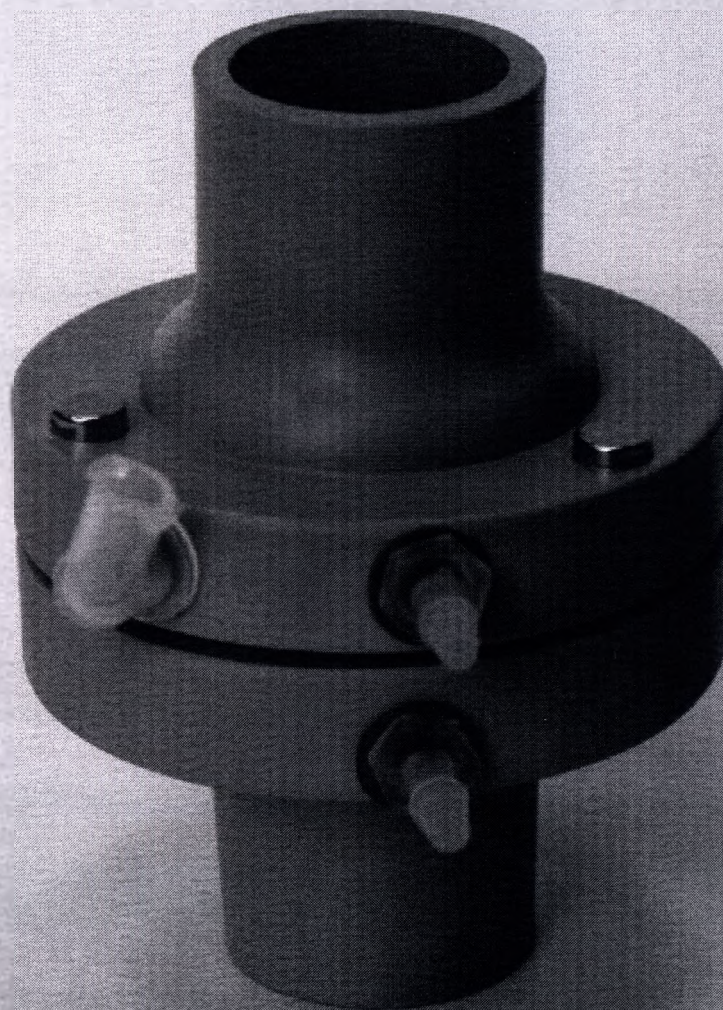


**РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА (трубка Флейша)**

**ПСГИ.941324.002**




**БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ**

**ПГСИ.941324.003**

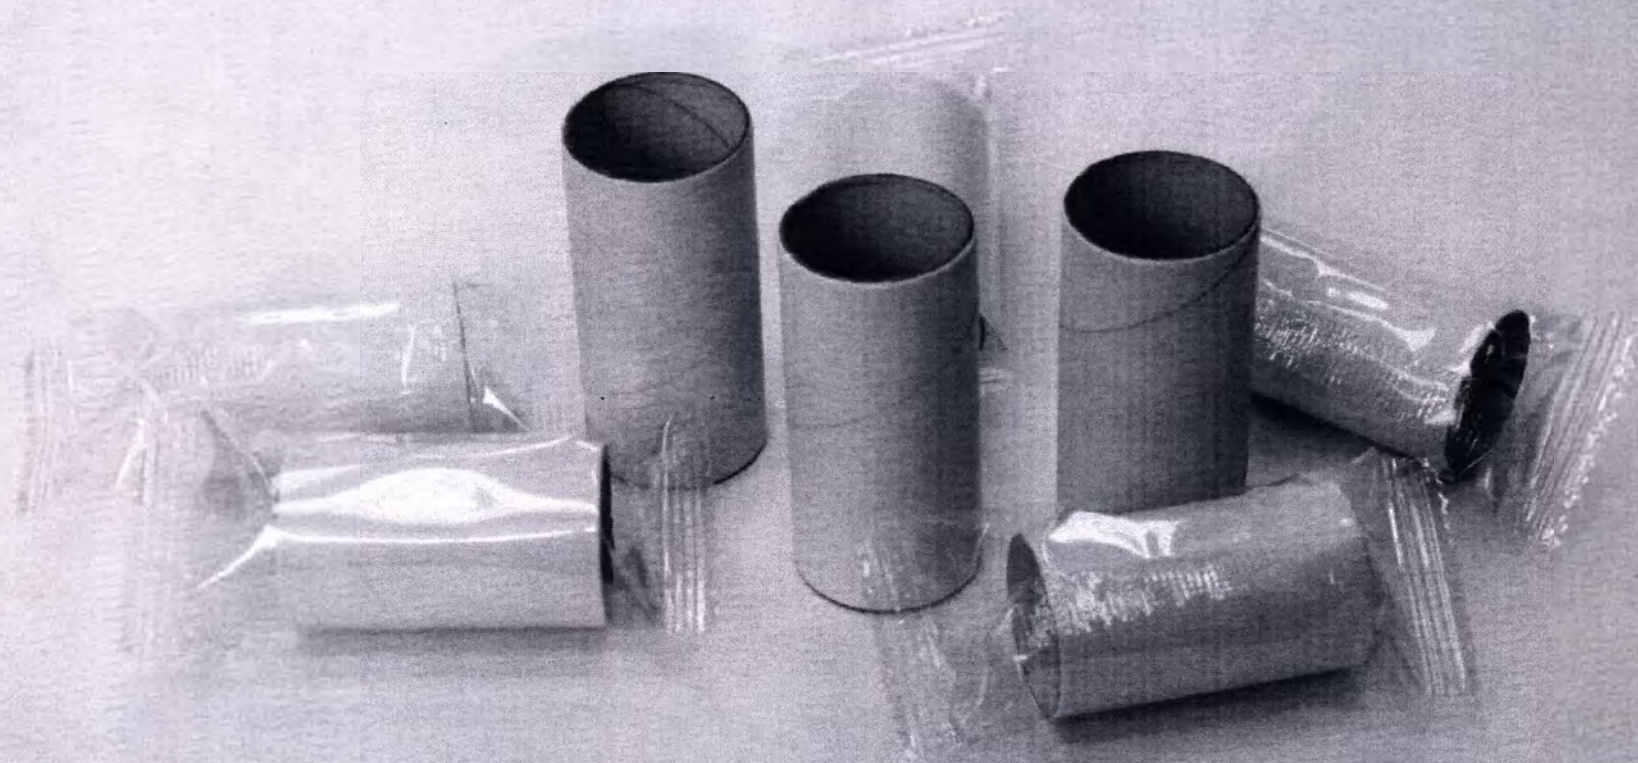


**МУНДШТУК КАРТОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ**

**(ПУ №ФСР 2012/13317)**

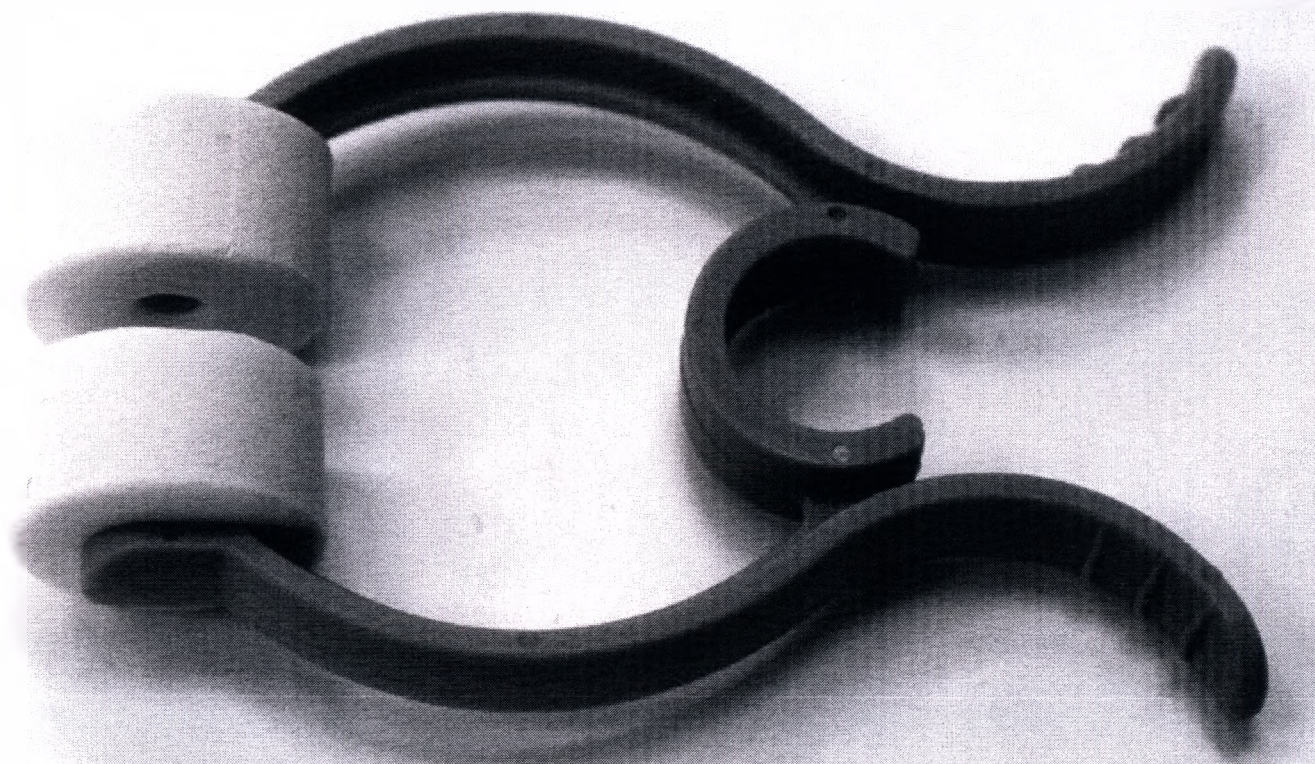

**НОСОВОЙ ЗАЖИМ      РУ РЗН №2016/3559**

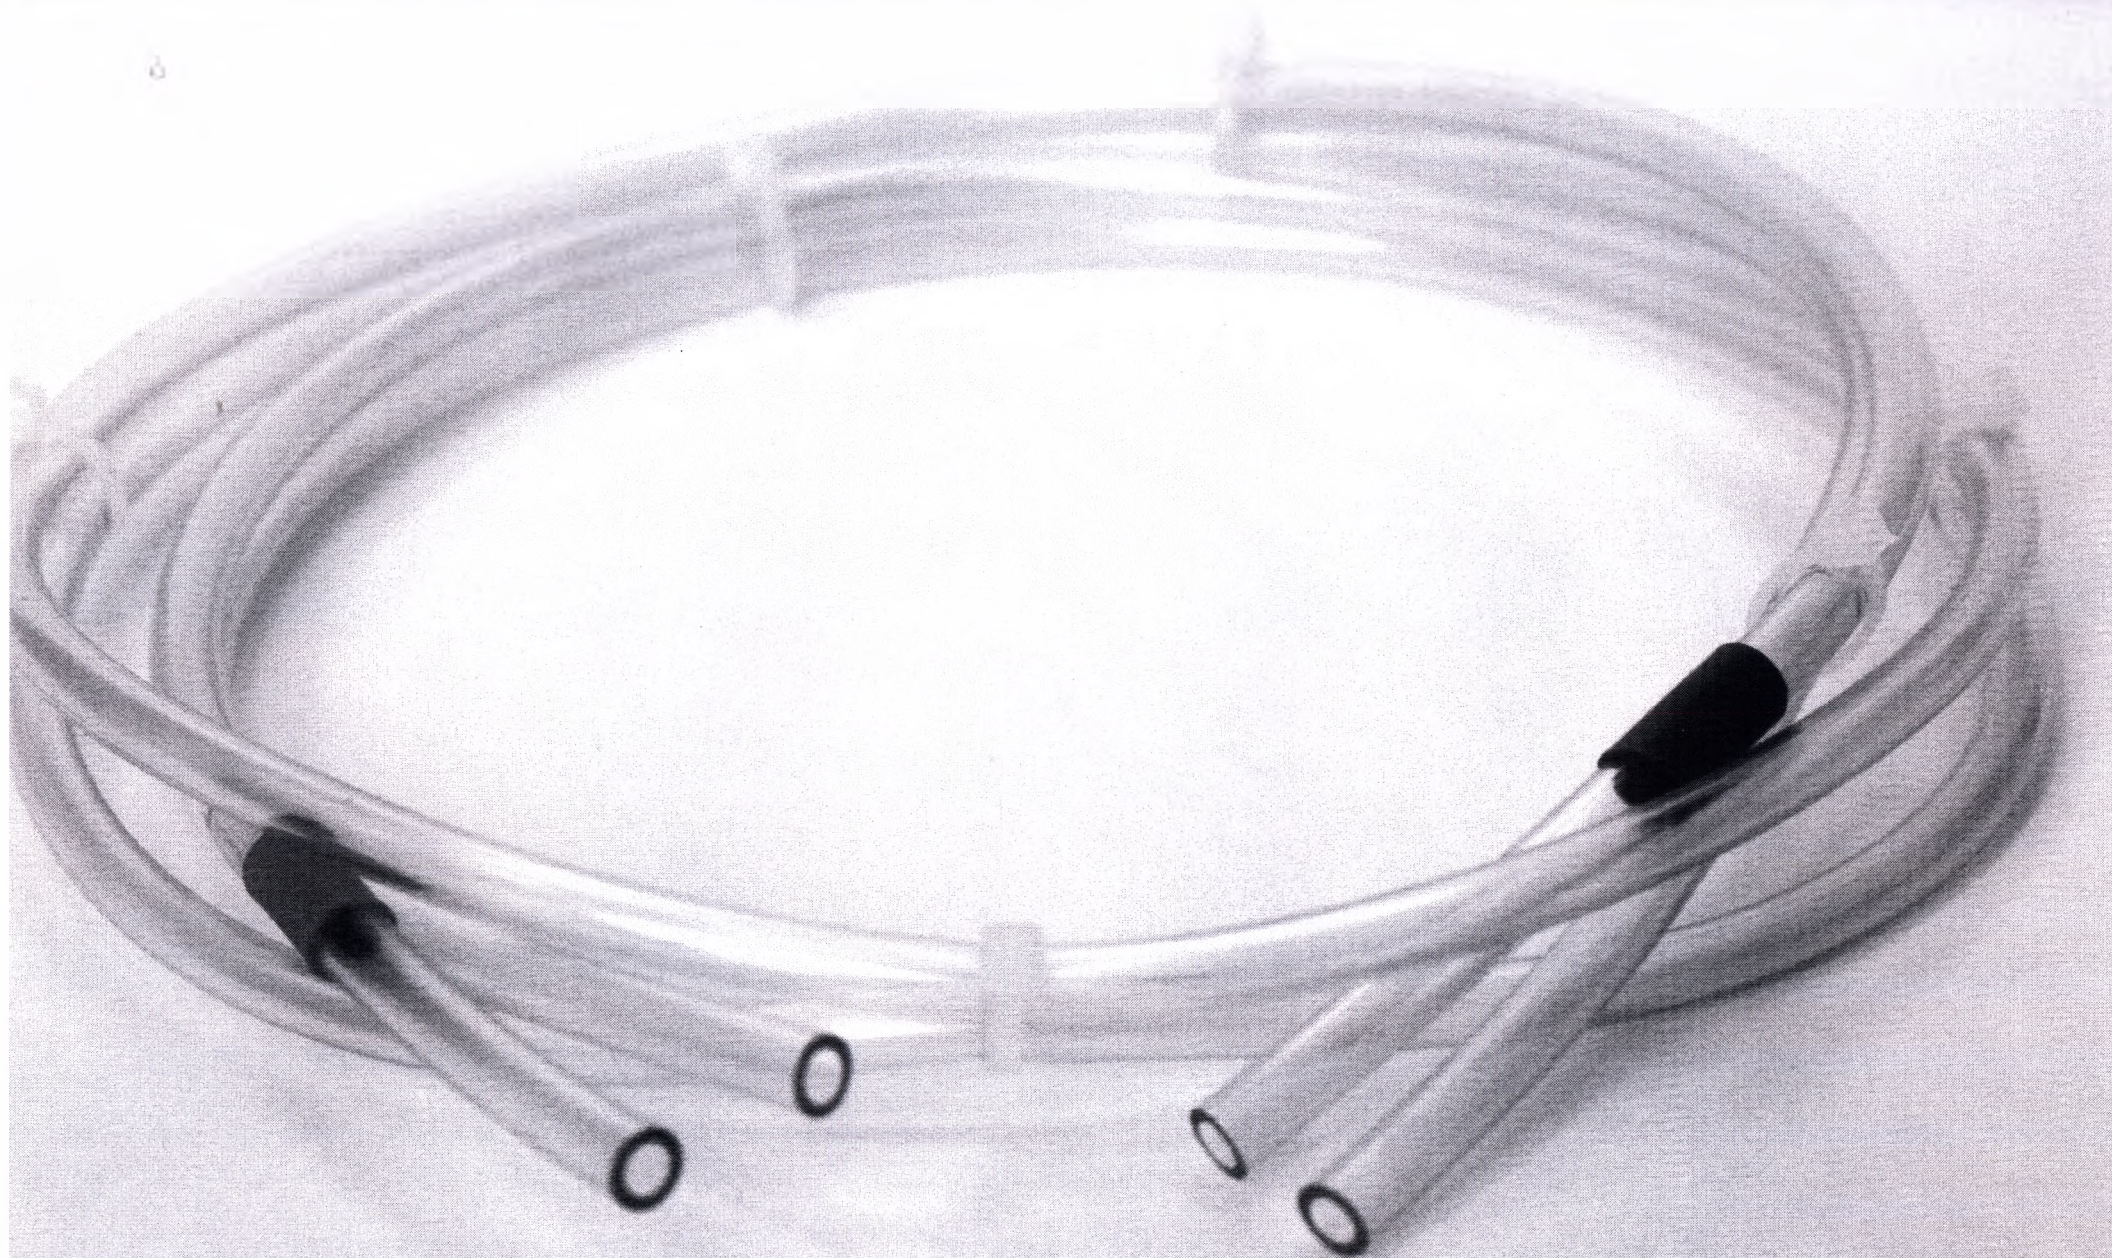

**ТРУБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ**

**ПГСИ.941324.004**



**КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ**

**ПГСН.941324.005**



КАЛИБРОВОЧНЫЙ ШПРИЦ

ПГСИ.941324.006

**Прибор для оценки функционального  
состояния органов дыхания  
«ПРЕССОТАХОСПИРОГРАФ ПТС-14П-01»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
(ТУ 9441-001-82193046-2007)

Санкт-Петербург

2018

**РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ПГСИ.941324.001 РЭ**

**Регистратура кабинета ФД  
[v. 140117]**

**RM055**

**[www.lanamedica.ru](http://www.lanamedica.ru)**

**ПАКЕТ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**ПГСИ.941324.001 ПО**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПУЛЬМОЛОГИИ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И УНИФИЦИРОВАННАЯ  
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
АППАРАТА ВЕНТИЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ СПИРОМЕТРИИ


Пособие для врачей

Санкт-Петербург

1996-2016

(переработано и дополнено в 2001г.)

## МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

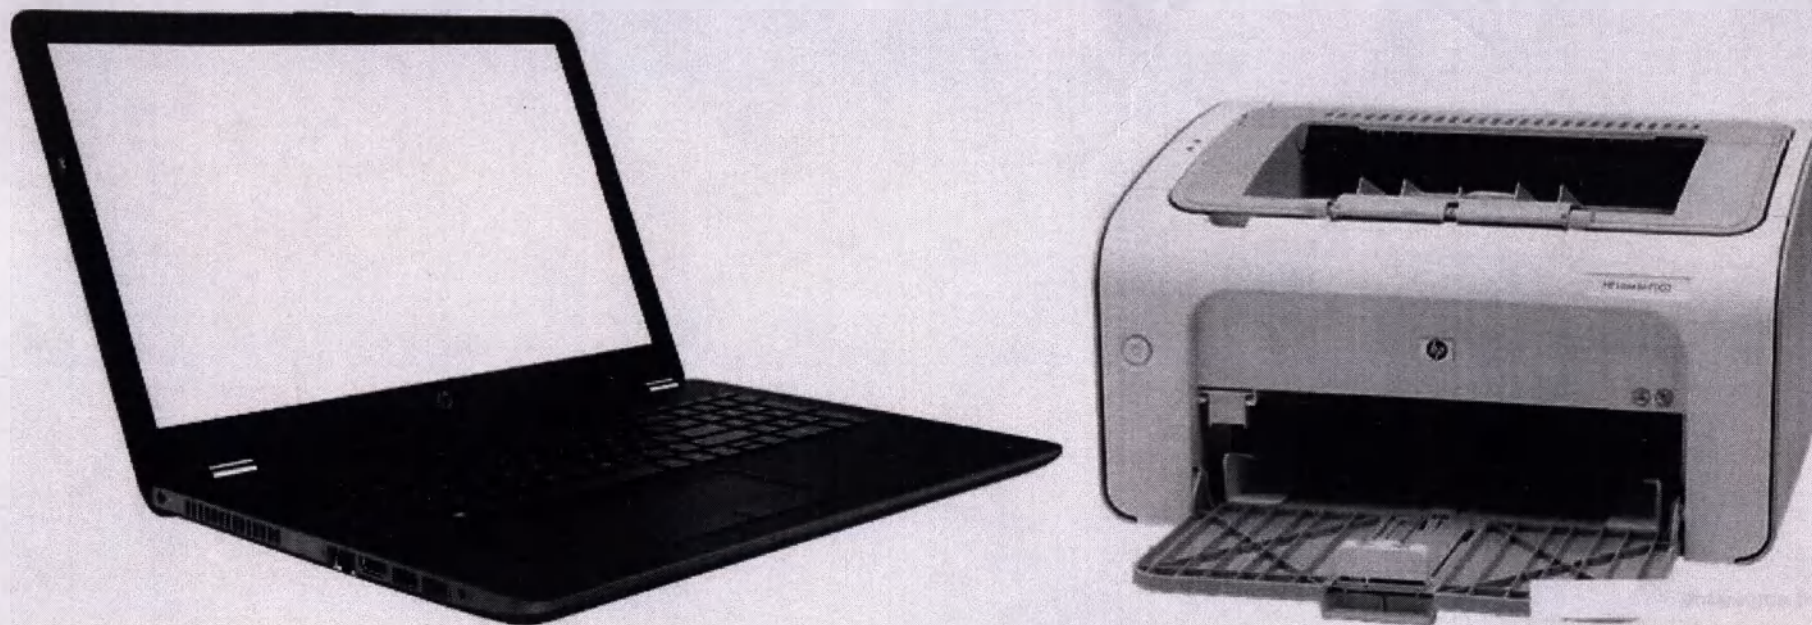

**КОМПЬЮТЕР  
(принтер HP в комплекте)**


Промпто.  
Лей. Со: 11 (единица)  
мест





Ген. директор

Букашко Ю. М.

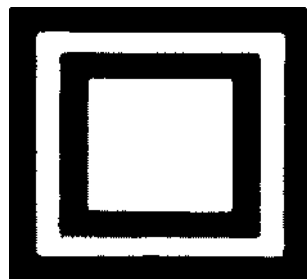

## Прессотахоспирограф ПТС-14П-01

|                |       |     |
|----------------|-------|-----|
| серийный номер |       |     |
| дата выпуска   | месяц | год |

~  
**220 В**  
50 Гц; 10 ВА



ООО «Ланамедика», Санкт-Петербург

ТУ 9441-001-82193046-2007

РУ ФСР 2008/02820 от 24.06.2008

**МАКЕТ МАРКИРОВКИ ПРИБОРА**




ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА ПРИБОРА С МАРКИРОВКОЙ

# ПРЕССОТАХОСПИРОГРАФ ПТС-14П-01

| серийный номер | дата упаковывания<br>месяц и год | количество |
|----------------|----------------------------------|------------|
|                |                                  |            |

ООО «Ланамедика»

ТУ 9441-0091-82193046-2007

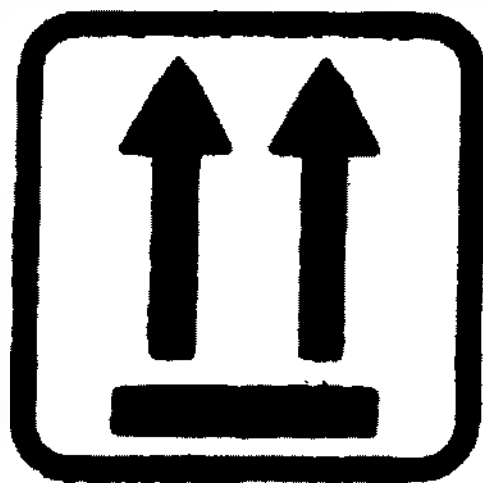

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ

Промито,

Кол. во: 3 (три) листа

Ген. директор

Букашко А.М.

