






Трубка гастростомическая (Набор гастростомический по ТУ 32.50.13-011-89134710-2017)

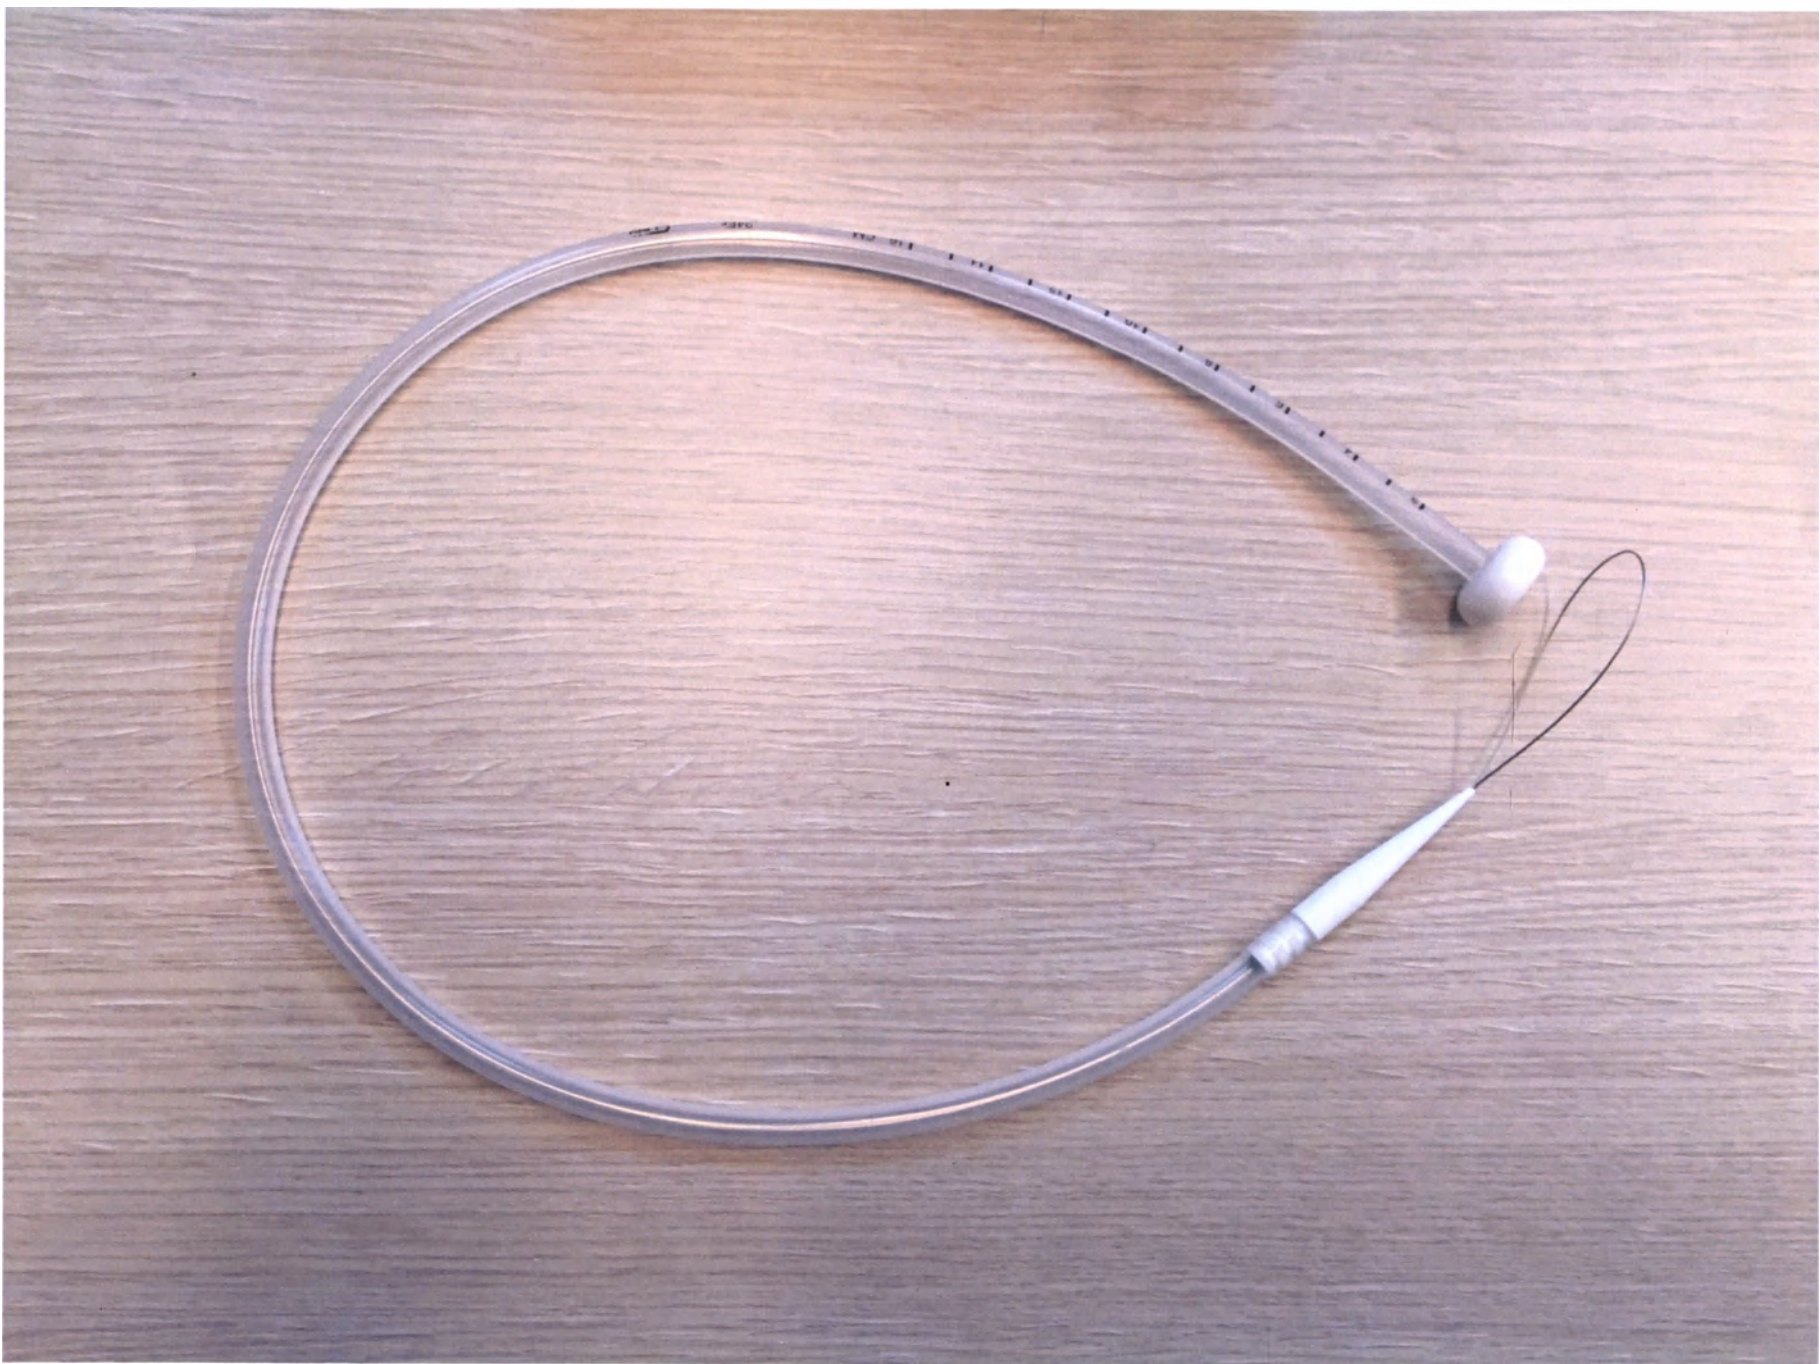

Адаптер для введения питания с насадкой Луер-Лок (Набор гастростомический по ТУ 32.50.13-011-89134710-2017)

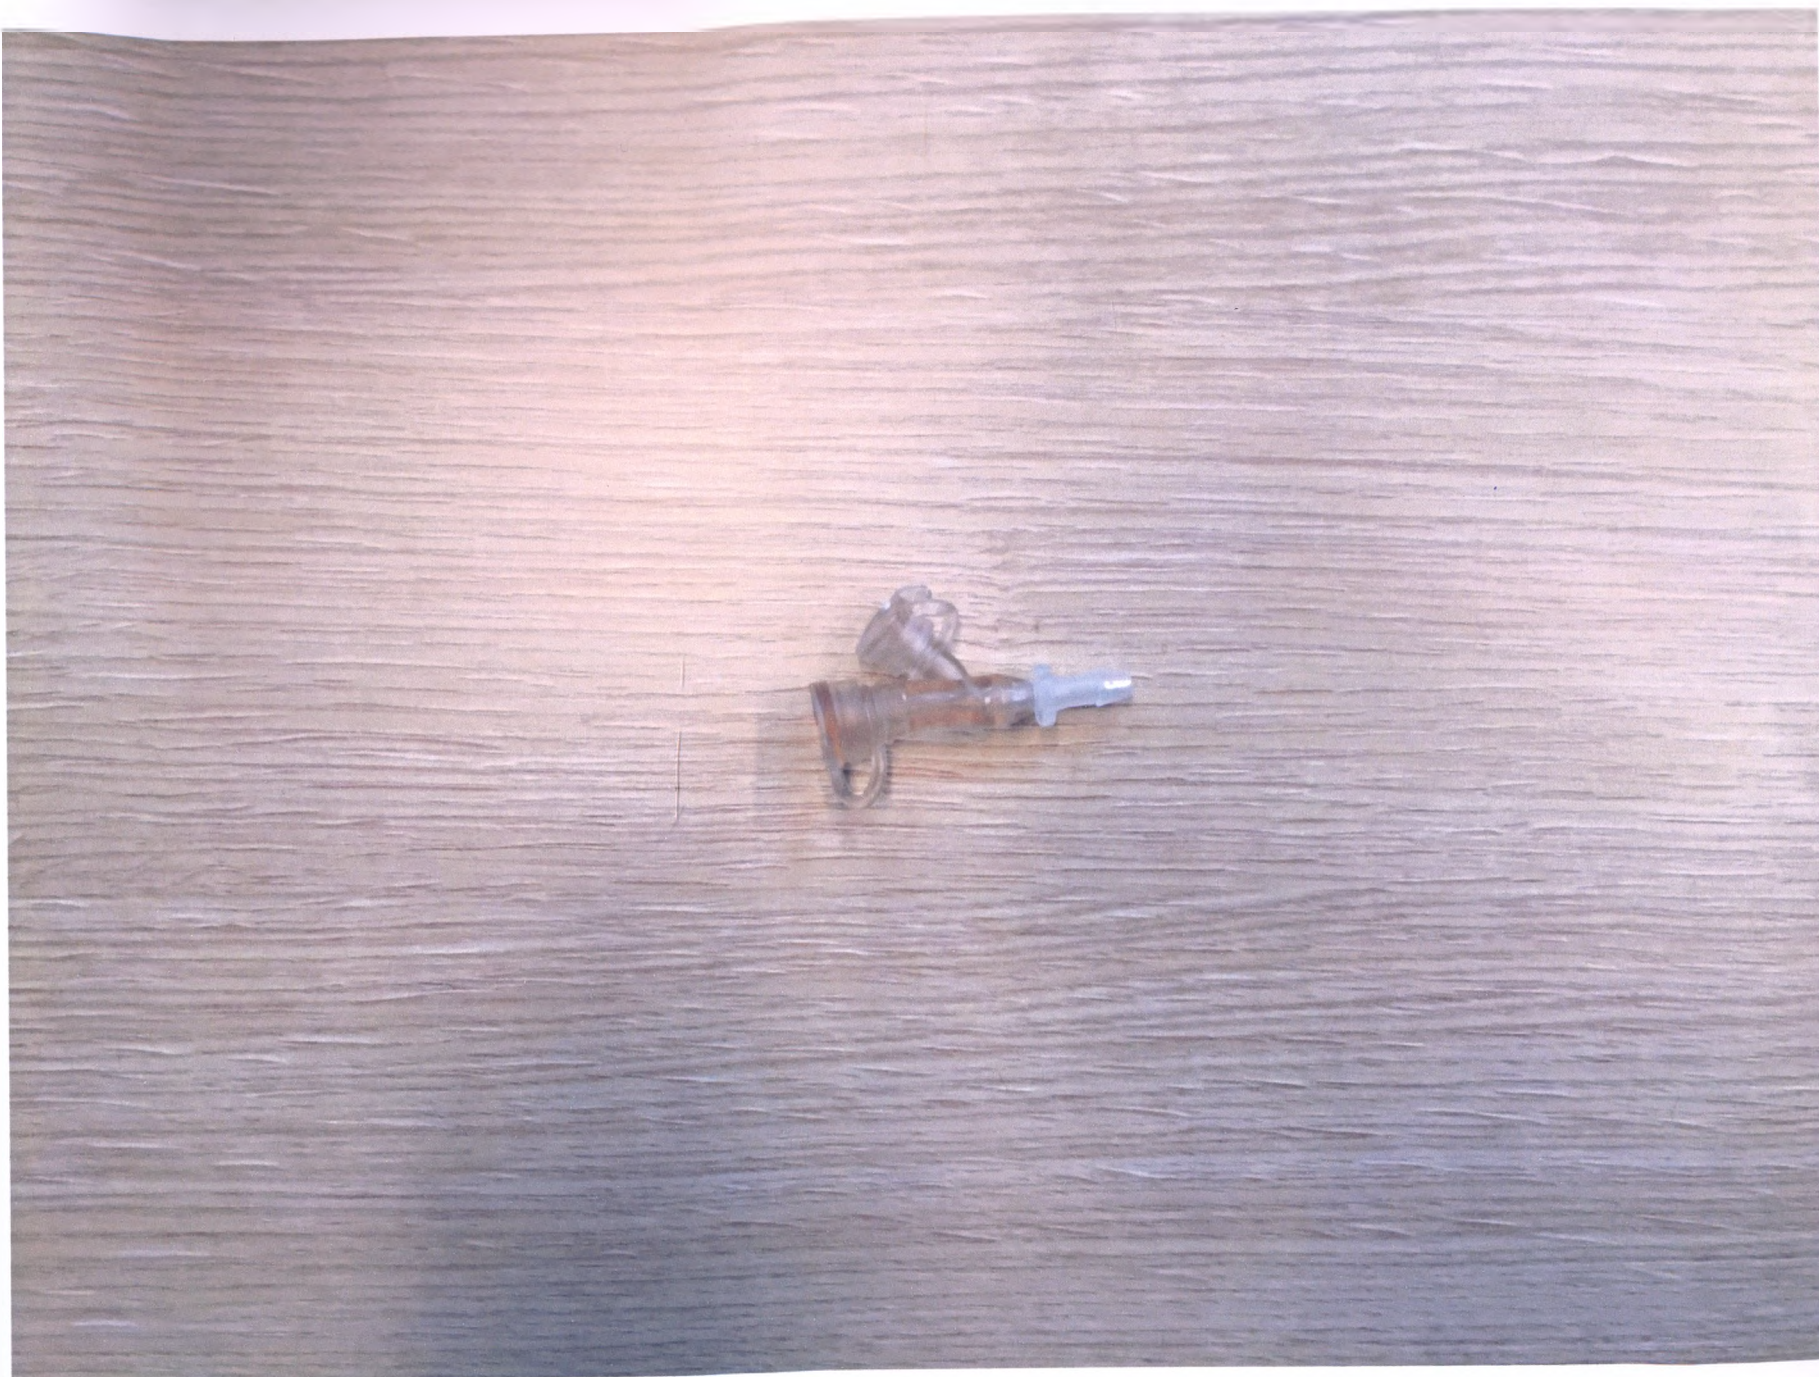

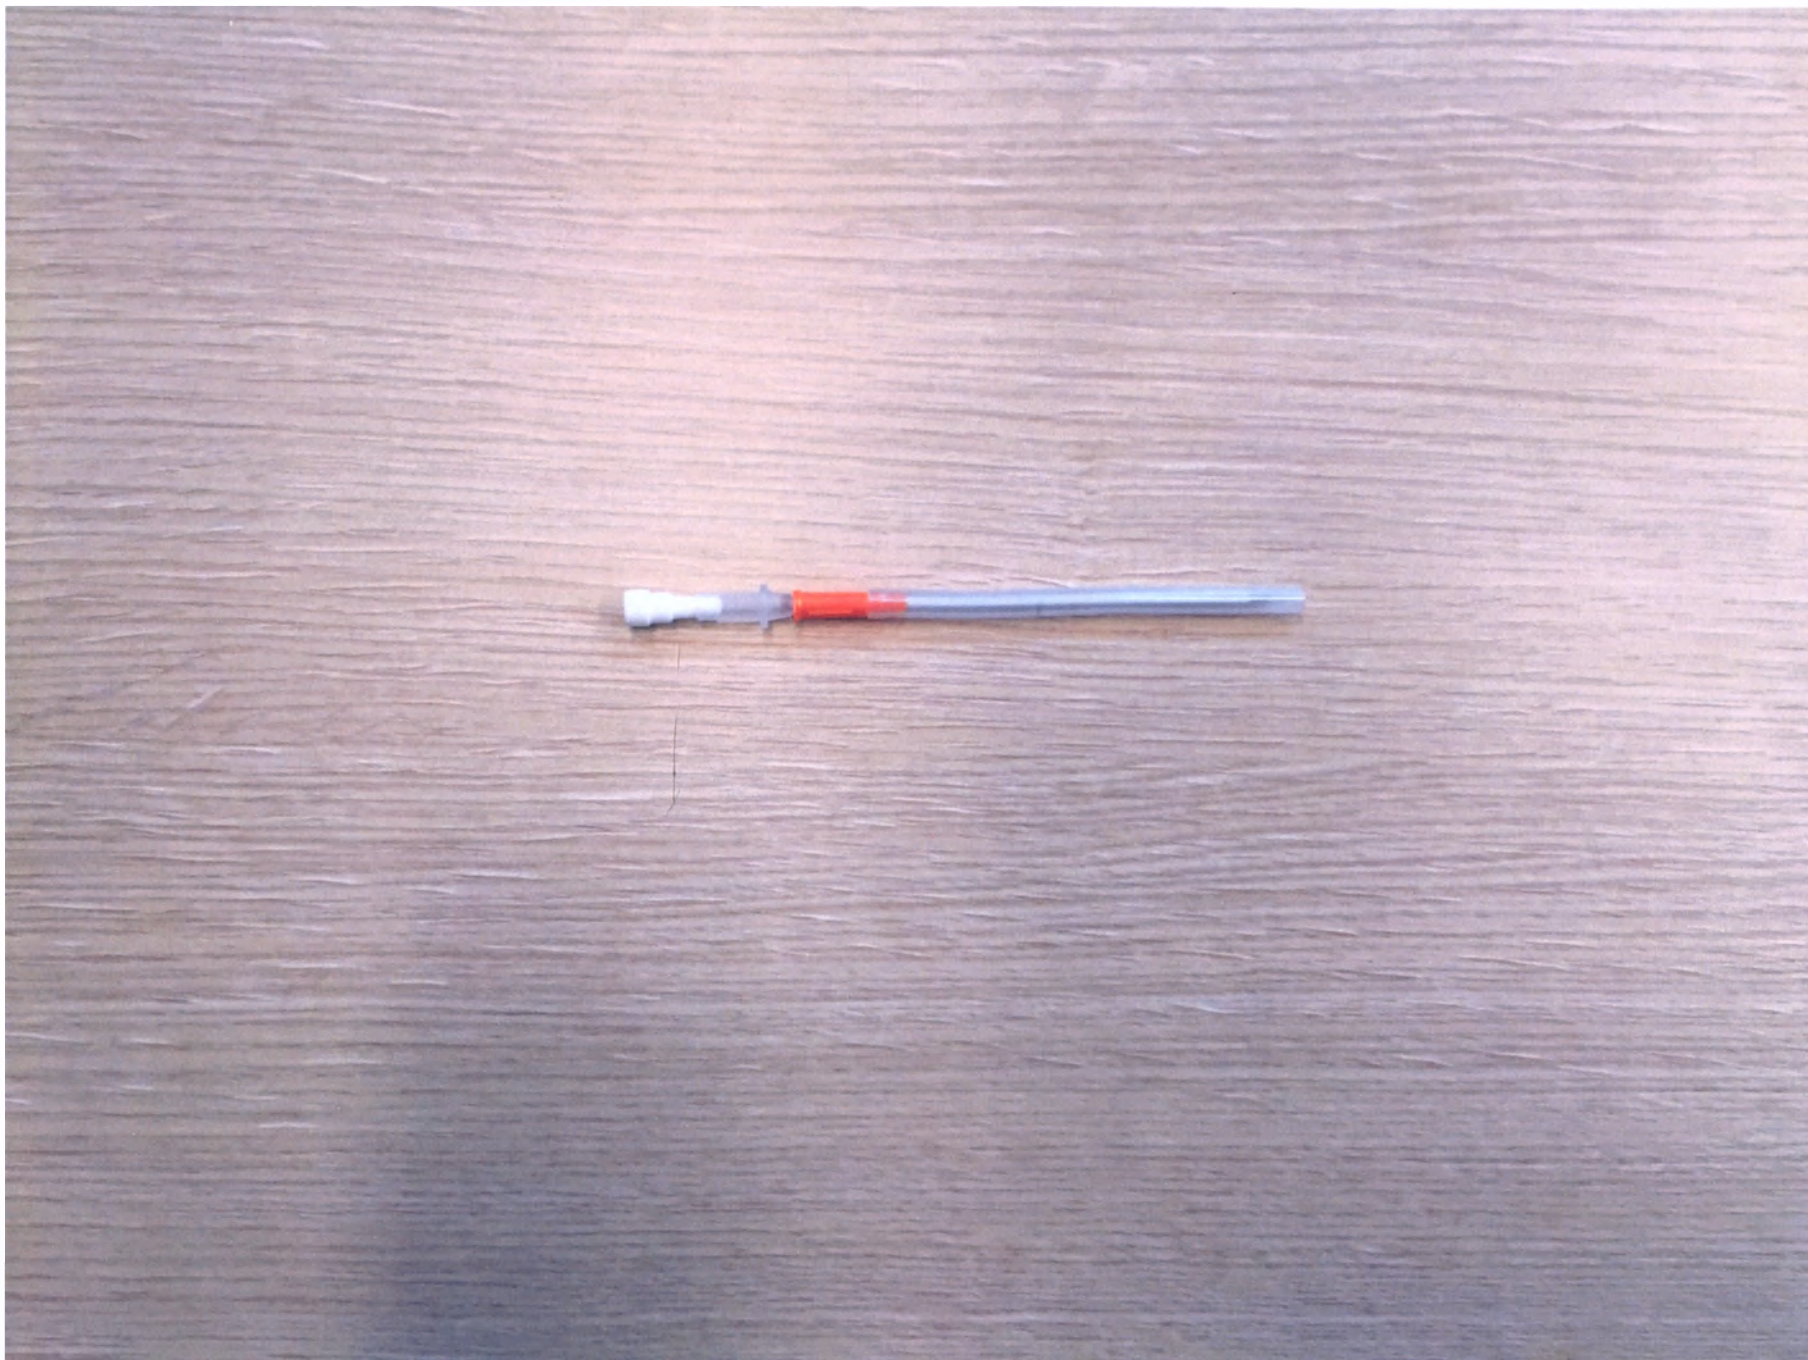


Проводниковая игла

( ООО ЦРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru .13-011-89134710-2017)



Зажим пластиковый (Набор гастростомический по ТУ 32.50.13-011-89134710-2017)

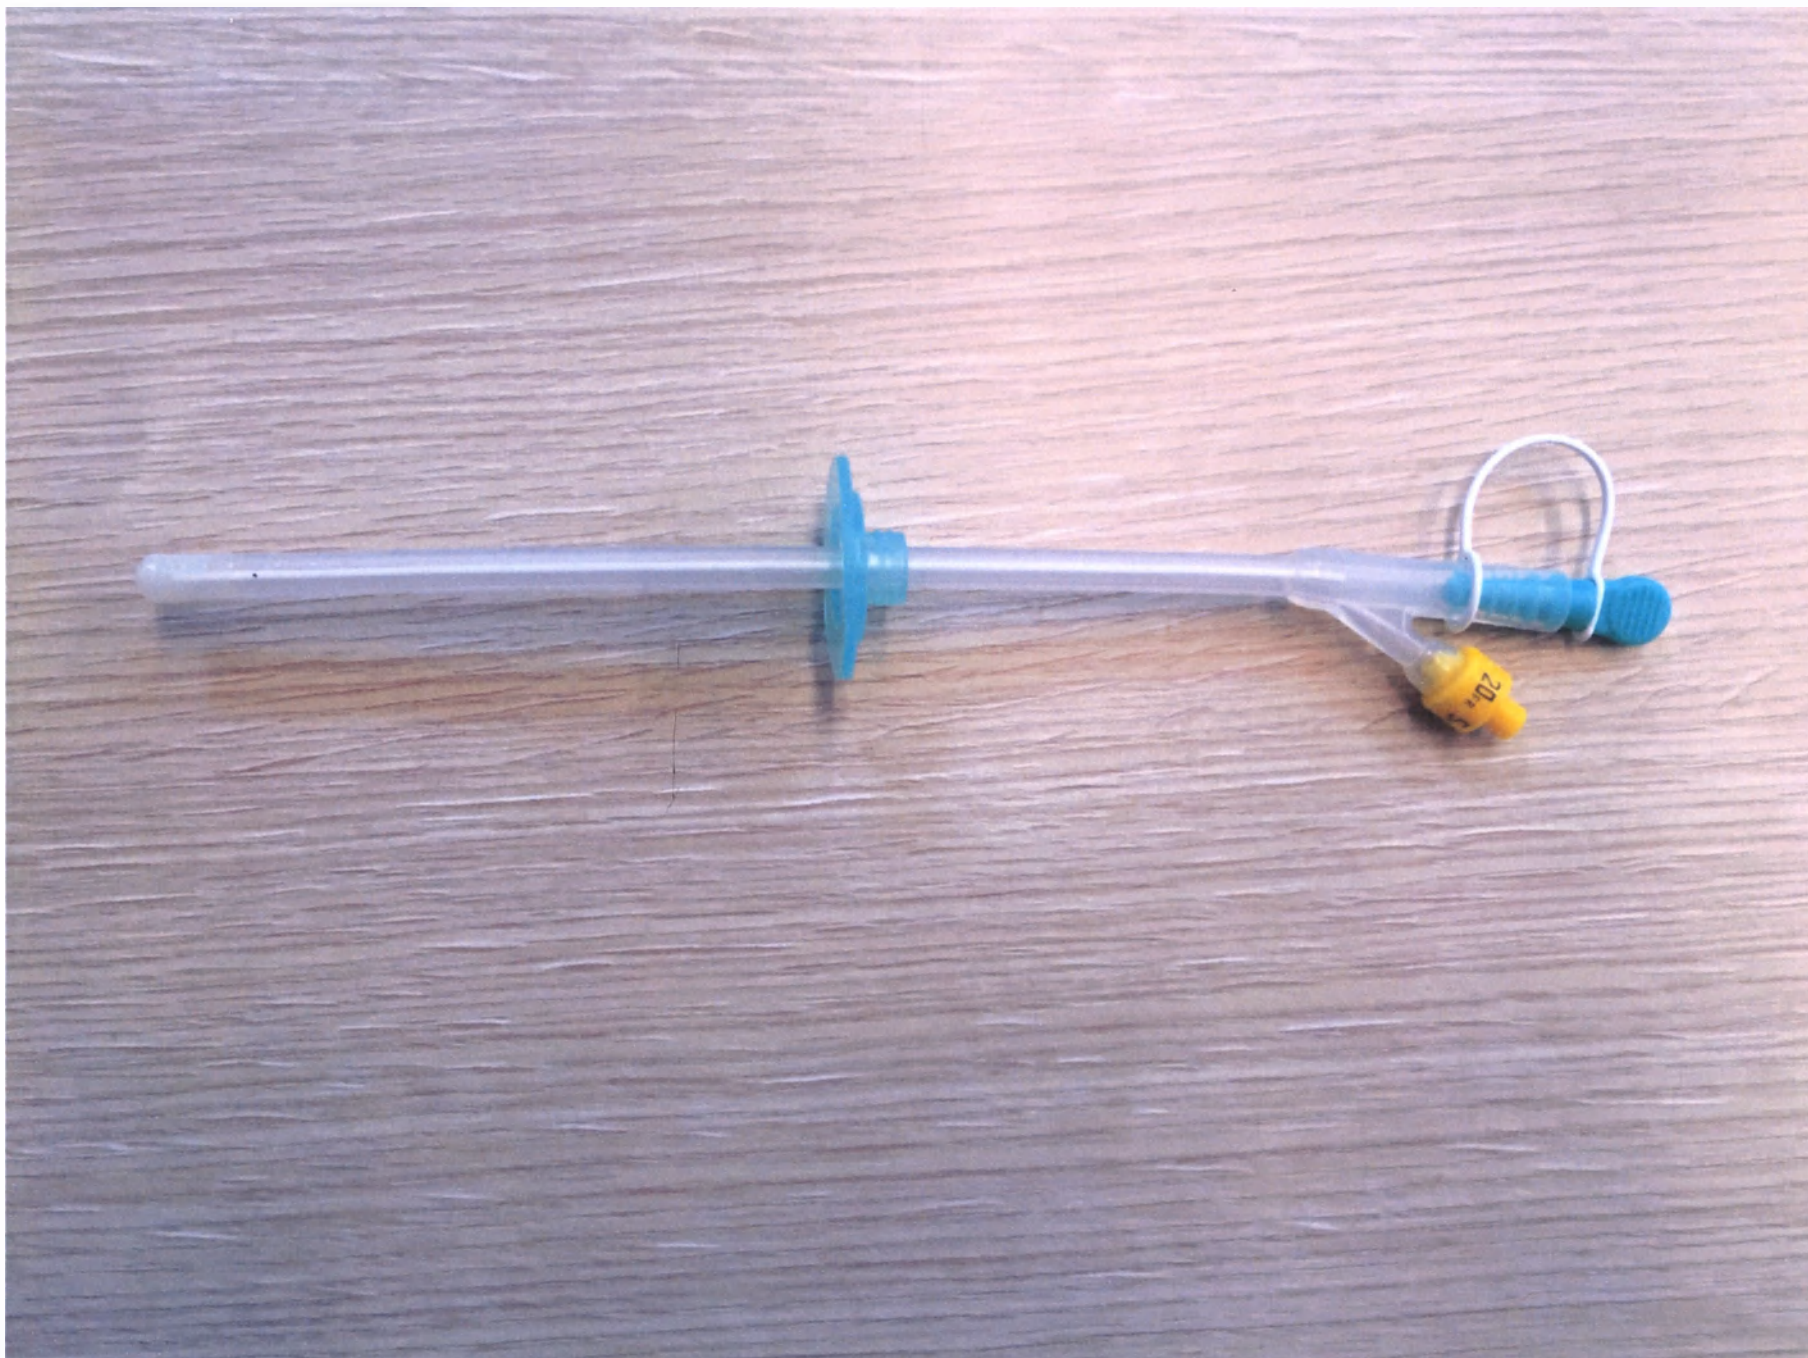

Катетер для кормления

( ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU), 13-011-89134710-2017)





Проводник для проведения (Набор гастростомический по ТУ 32.50.13-011-89134710-2017)

Набор гастростомический

Произведено в соответствии с ГОСТ 90444-92

Произведено в соответствии со стандартом менеджмента качества ISO 13485
Сертификат № СДСНЦ.С.0964ММ.05/15

APT
LOT
SN

ES-STANDARD-18FR
20170811/5
230000002300

Диаметр 18 Fr	Сделано в России

 **2017-08**
 **2019-08**

Апирогенно.
Не токсично.

STERILE | EO


(01)04048467004694(17)141126(10)913249

ООО «Эндо Старс» (Россия)
197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 27А, 12Н
тел.: 8(800) 555-56-57,
+7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.com
www.endo-stars.ru

EndoStars
...all you need for endoscopy!

Пронумеровано, прочитано и
скреплено печатью № 9

(Девелопер)

листах

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
САМАРЕЦ П. В.

