

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Регистр-СЮ»

Ф. С. Агапов



«08» апреля 2019 г.

ФОТОГРАФИИ

медицинского изделия

**Амплификатор нуклеиновых кислот Applied Biosystems QuantStudio 5 с
гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР
в режиме реального времени**

производства


**Life Technologies Holdings Pte.Ltd.
(Лайф Текнолоджис Холдингс Пте. Лтд.)
Сингапур**

I. Applied Biosystems QuantStudio 5, в составе:


I. Базовый блок- 1 шт.



2. Шнур питания – 1 шт.

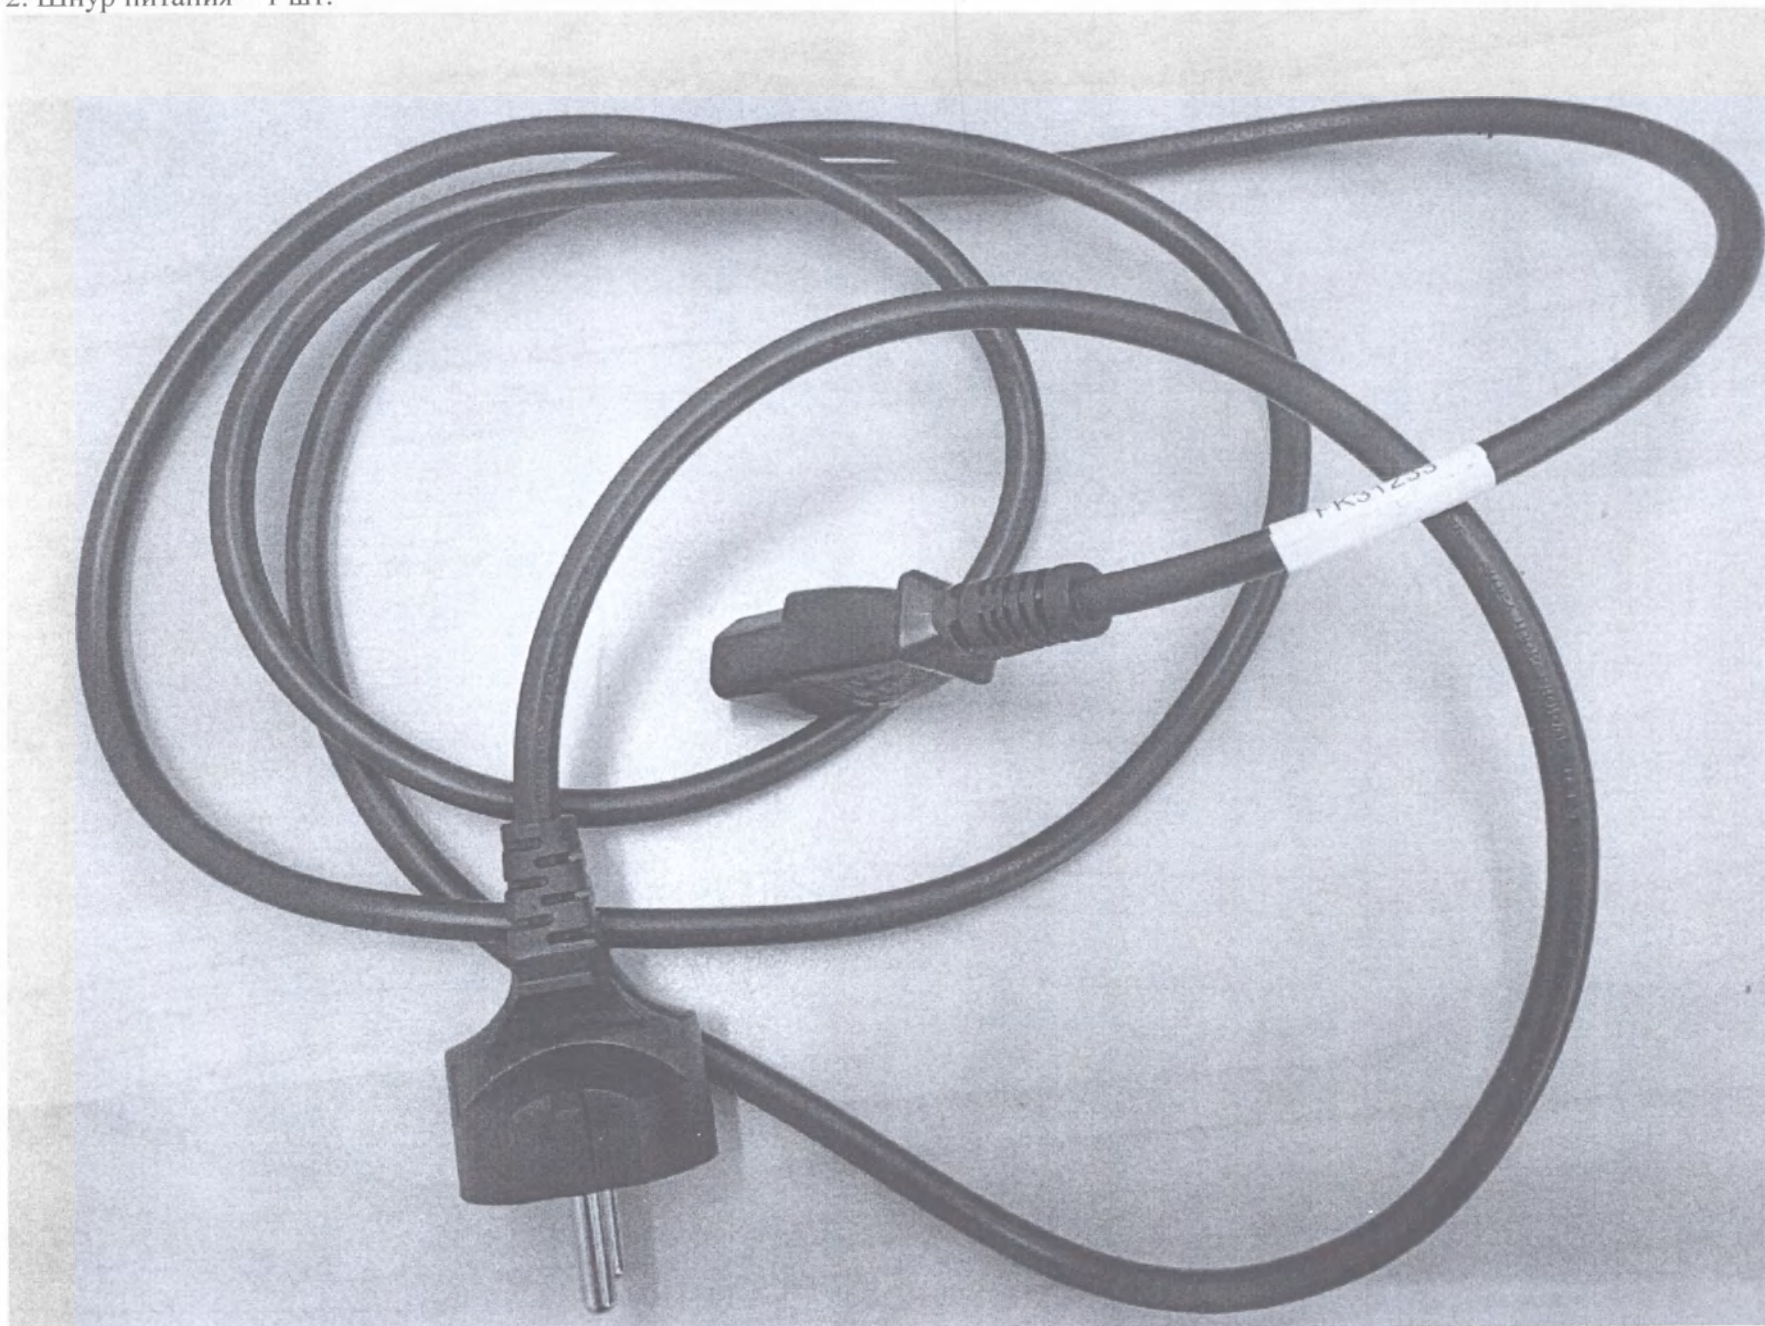

3. Программное обеспечение QuantStudio Design and Analysis software для прибора на электронном носителе (QuantStudio Design and Analysis software) – 1 шт.

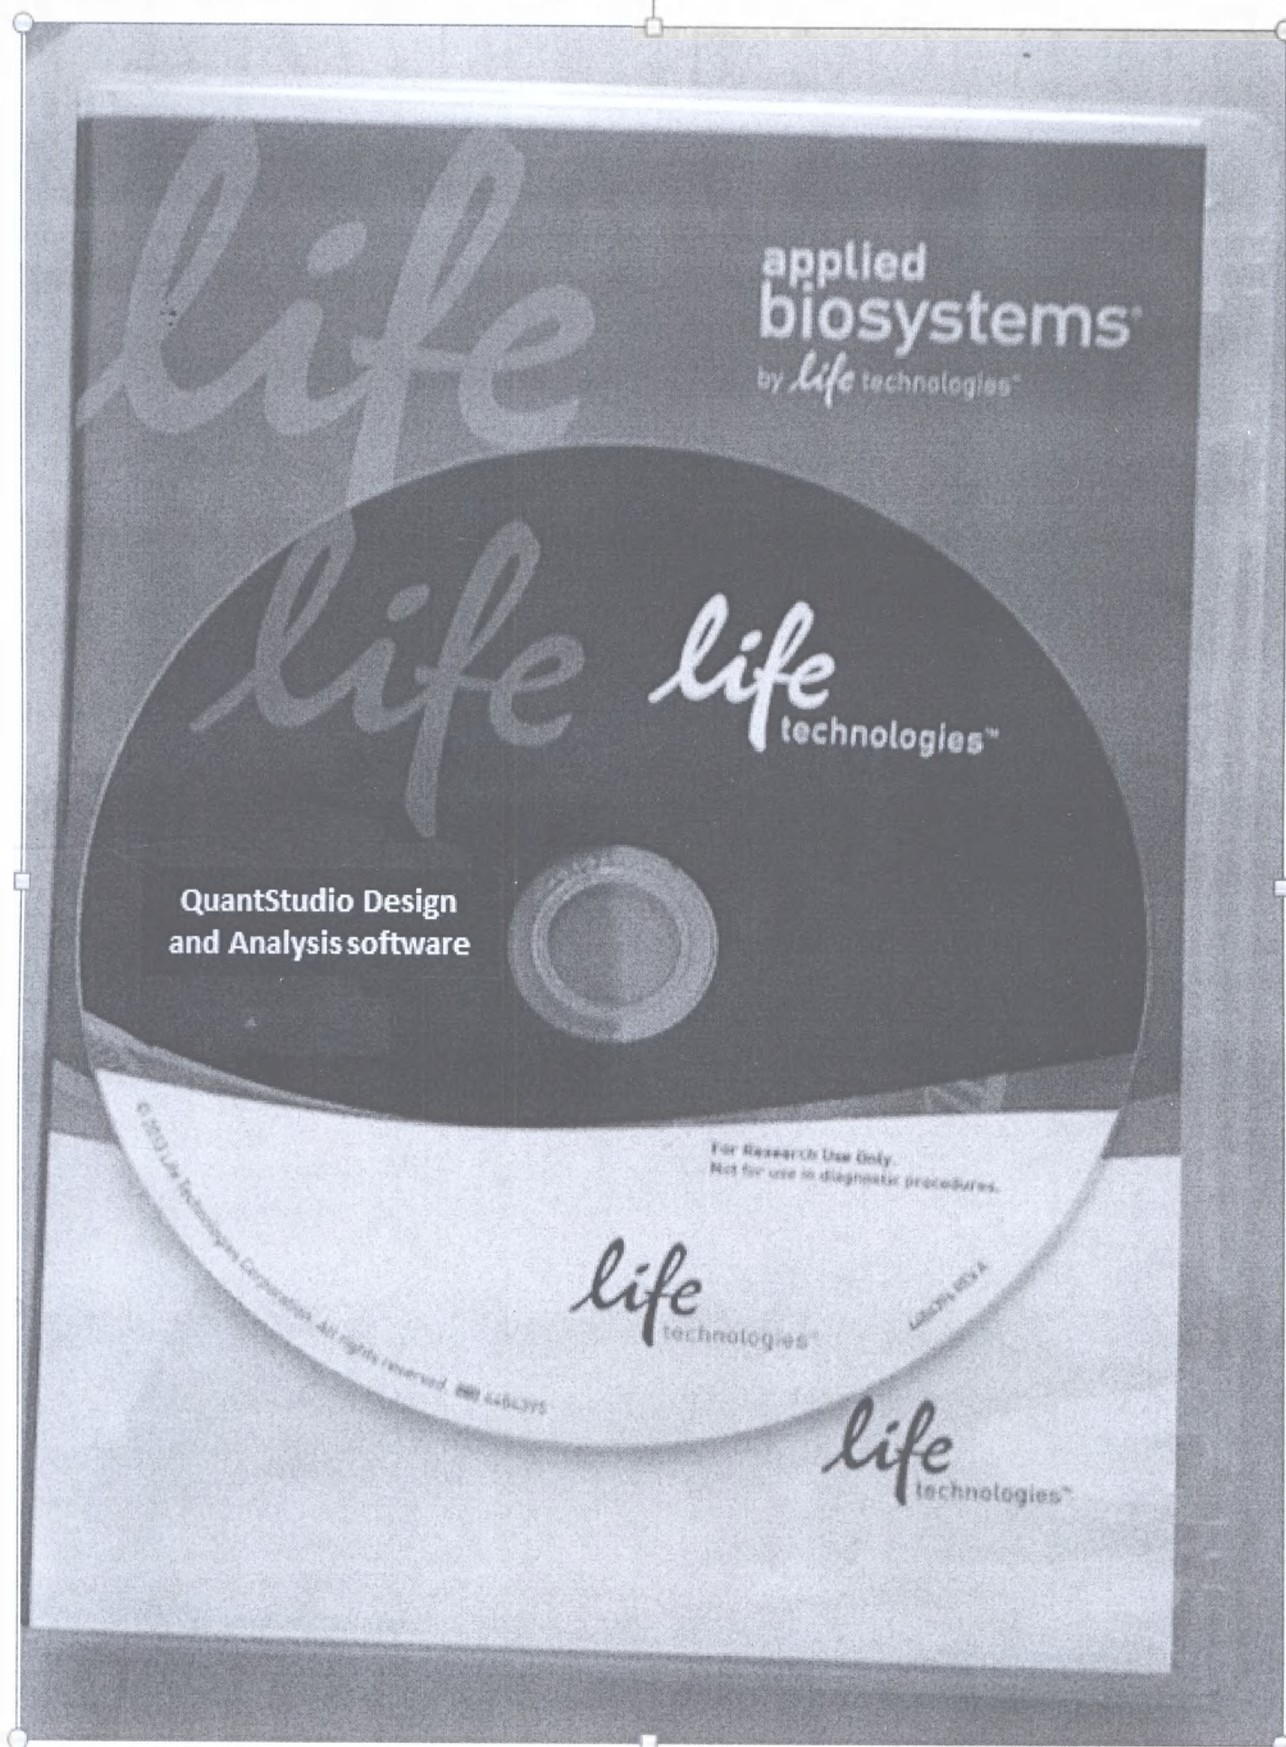

4. Сопроводительная документация по работе с программным обеспечением на бумажном носителе – 1 шт.

appliedbiosystems

QuantStudio™ Design and Analysis Software USER GUIDE

Getting started with design and analysis of experiments in the
desktop software v1.2.x

for use with: QuantStudio™ 3 and 5 Real-Time PCR Systems

Publication Number: MAN0010408

Revision: B.0



ThermoFisher
SCIENTIFIC

5. Сопроводительная документация по работе с прибором на бумажном носителе – 1 шт.

appliedbiosystems


QuantStudio™ 3 and 5 Real-Time PCR Systems INSTALLATION, USE, AND MAINTENANCE

Publication Number MAN0010407
Revision C.0



ThermoFisher
SCIENTIFIC

6. 96-луночная плашка с реагентами для количественного определения гена РНКазы Р для верификации прибора с термоблоком на 96 лунок (RNase P 96-well instrument verification plate)- 3 шт.

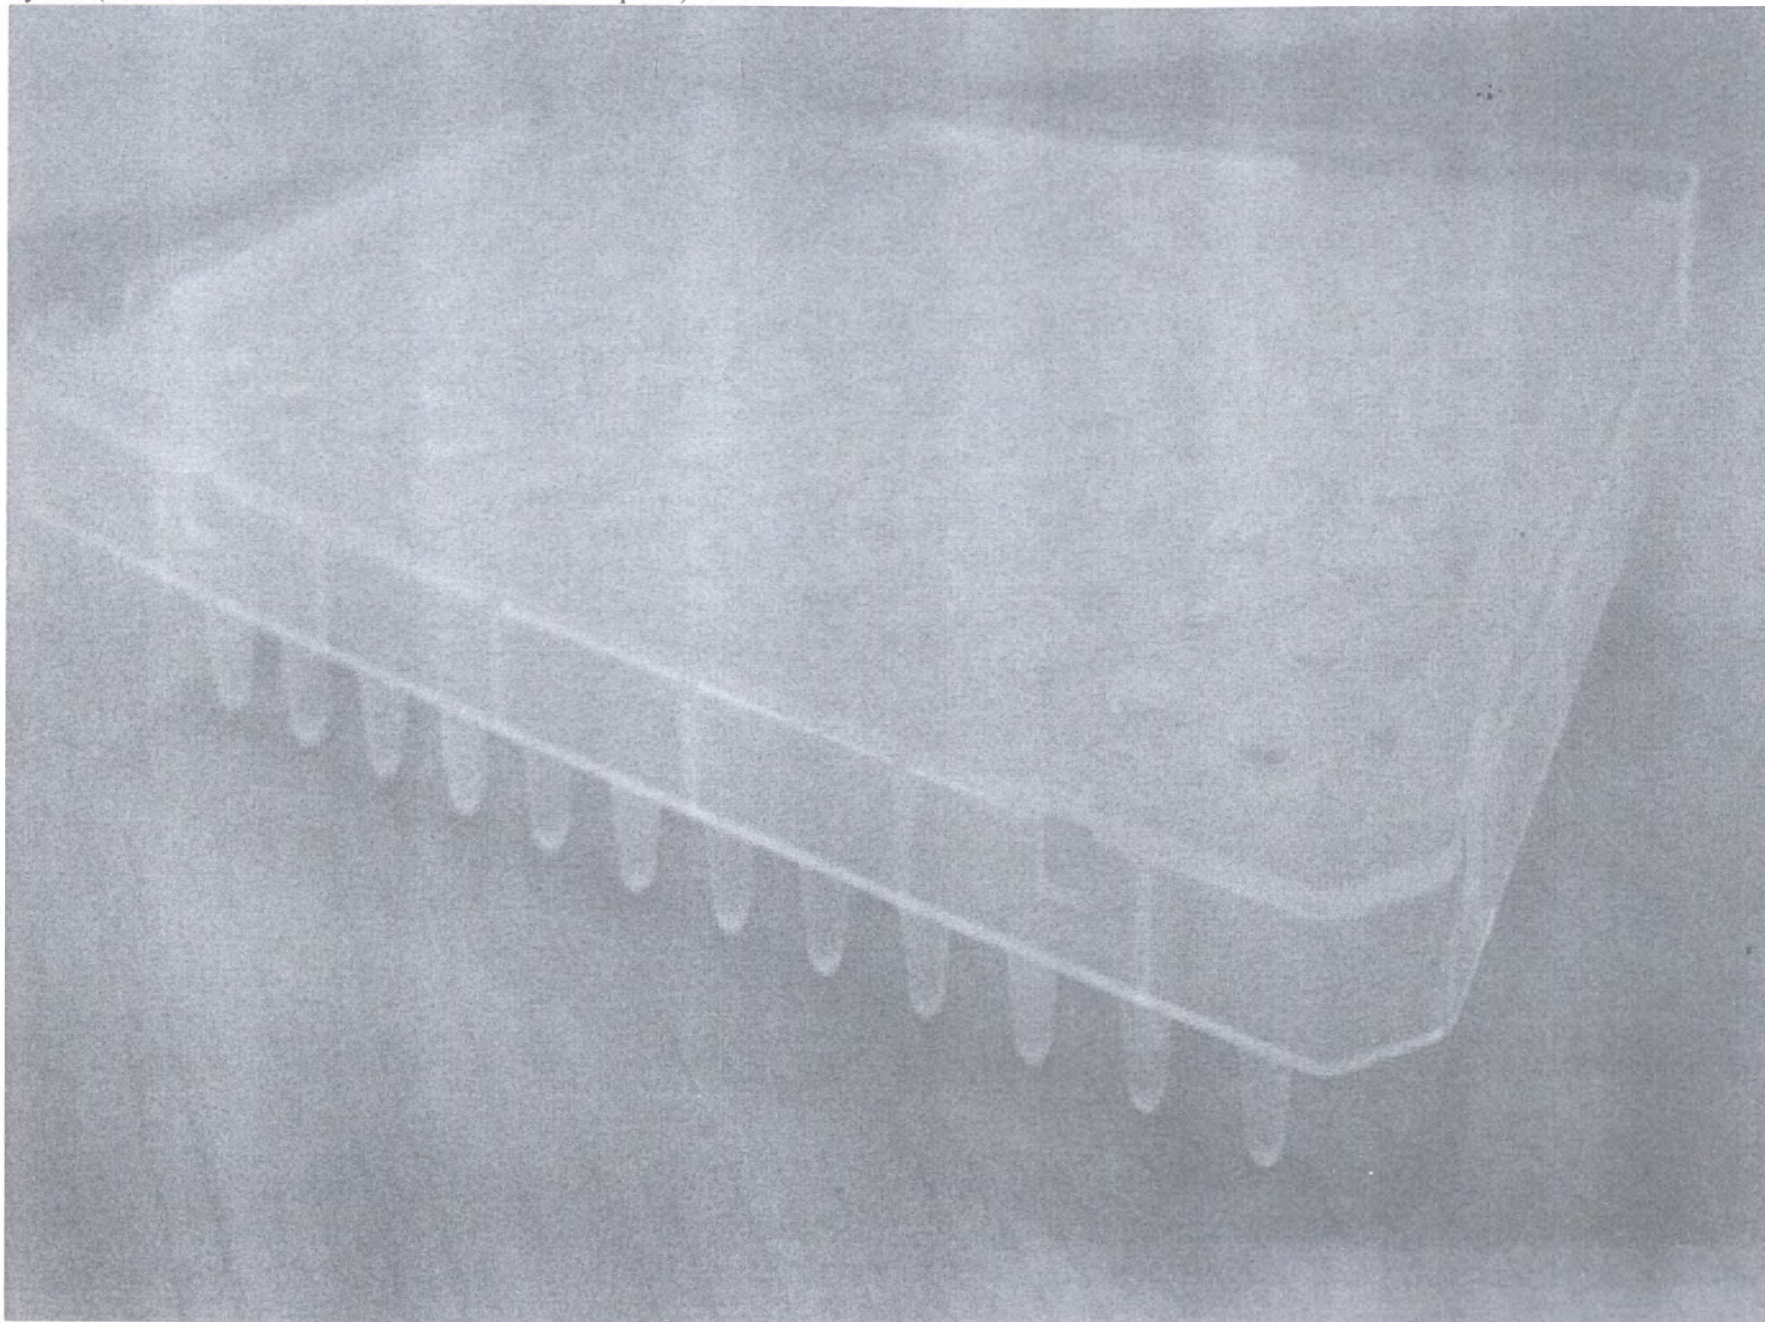

ViiA™ 7 System

TaqMan® RNase P 96-Well Instrument Verification Plate

P/N: 4432382

L/N: 1610074

Contents: One 96-Well Plate


Exp Date: 2017-09-06

Store at -15 °C to -25 °C


Made in Singapore at Life Technologies Holdings Pte Ltd

www.lifetechnologies.com


For Research Use Only. Not
intended for any animal or human
therapeutic or diagnostic use



2017-09-06



P/N:




L/N:


AB applied
biosystems™

II. Applied Biosystems QuantStudio 5Dx, в составе:


1. Базовый блок- 1 шт.

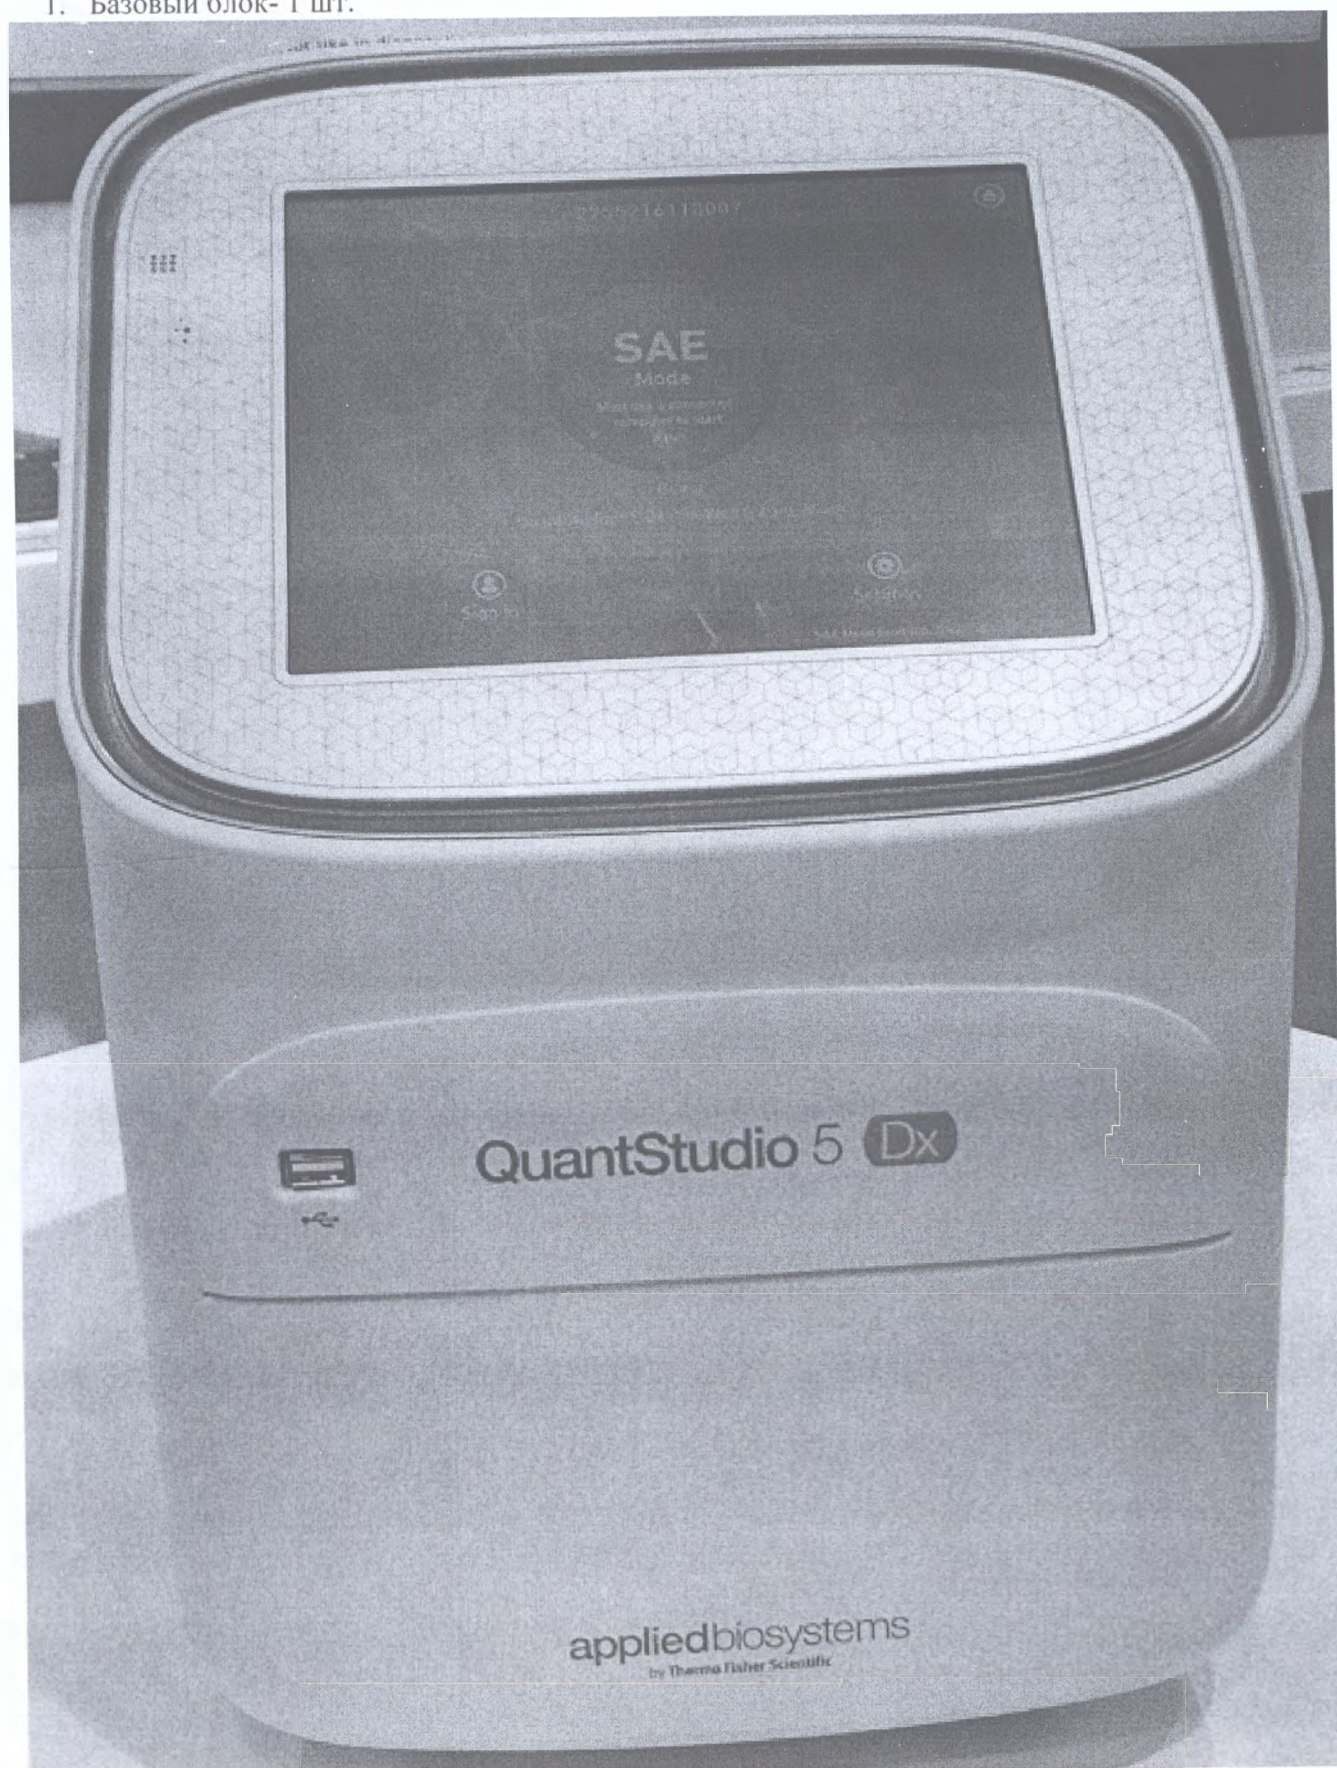


2. Шнур питания – 1 шт.

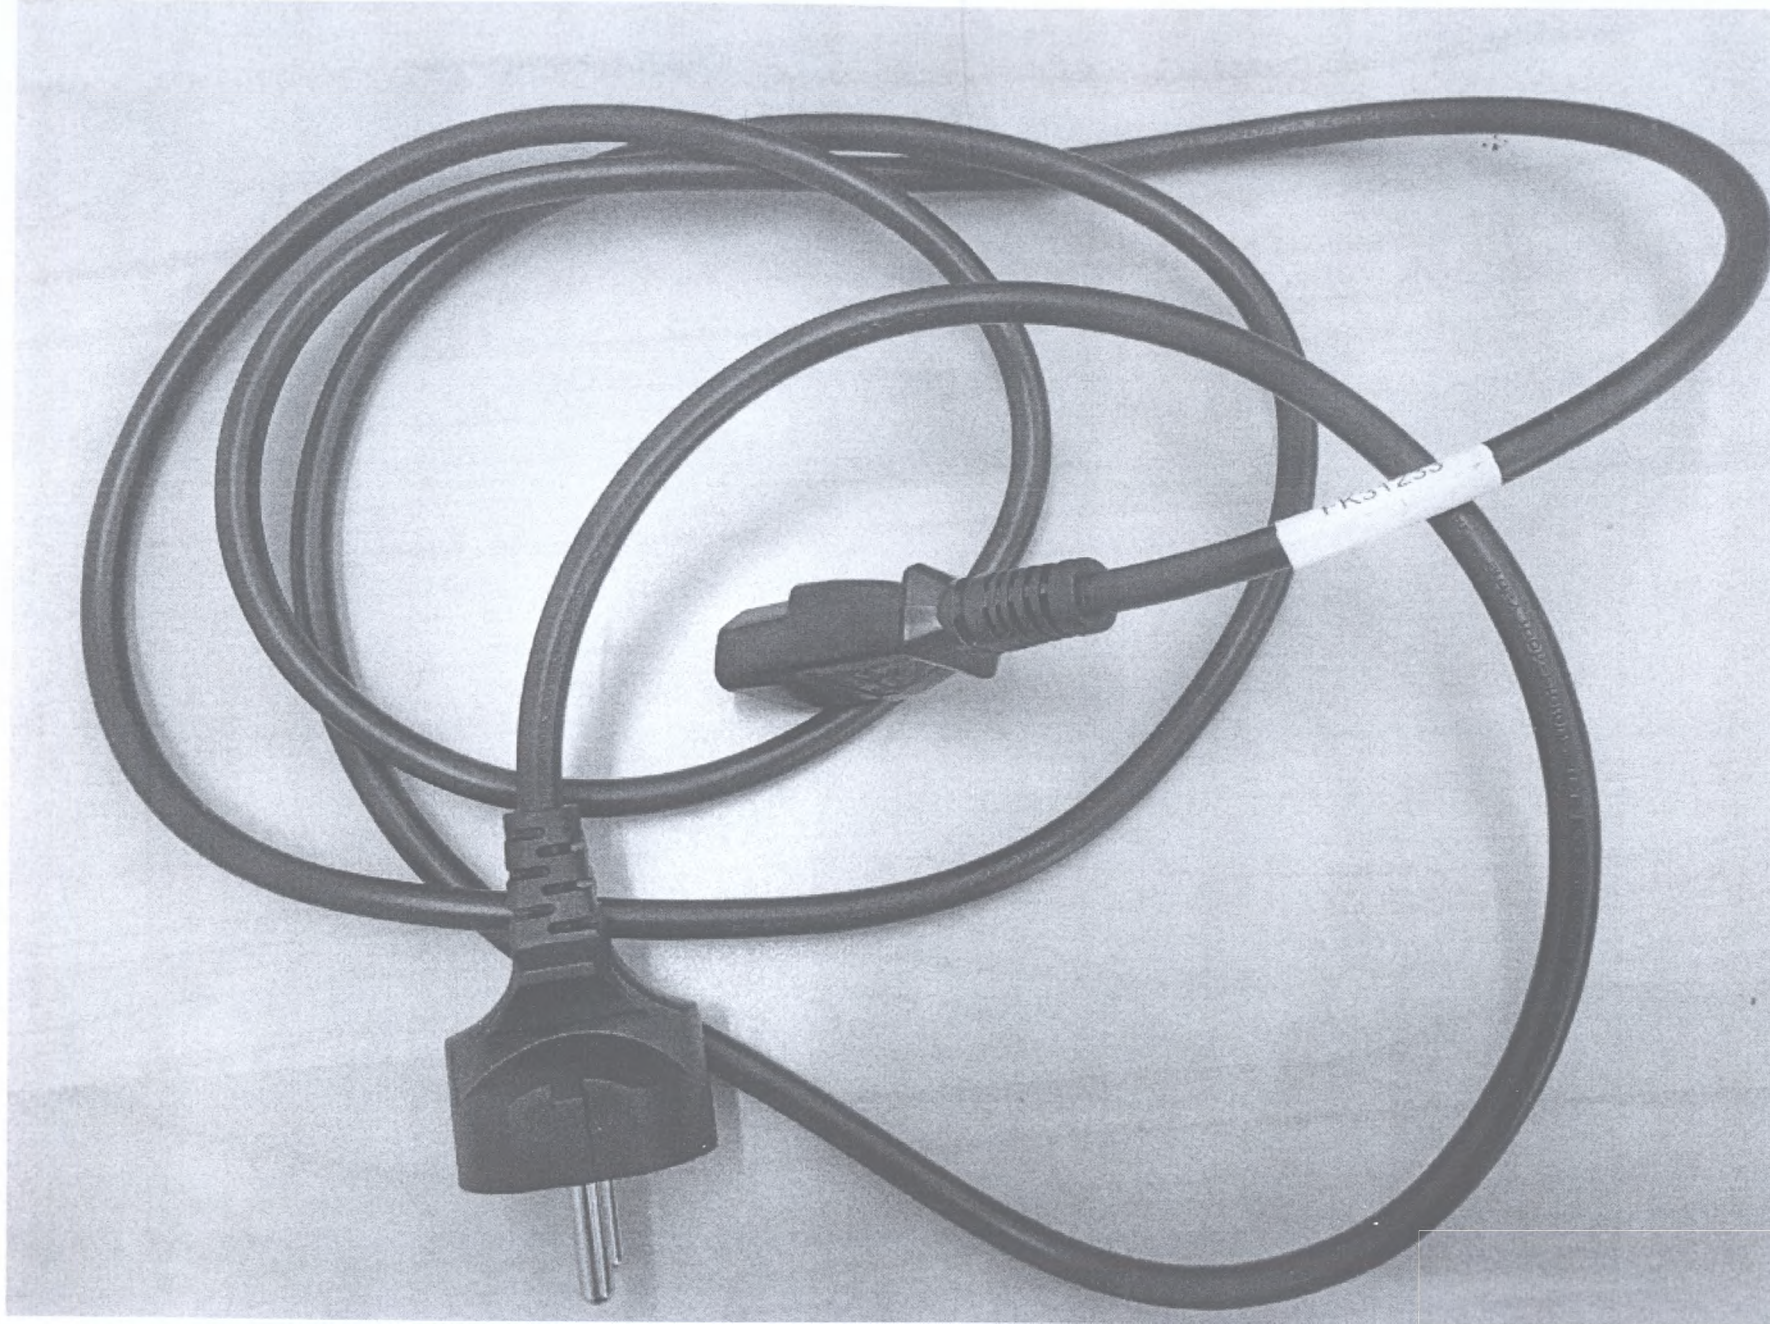

3. Программное обеспечение QuantStudio 5 Dx для прибора на электронном носителе (QuantStudio 5 Dx software) – 1 шт.

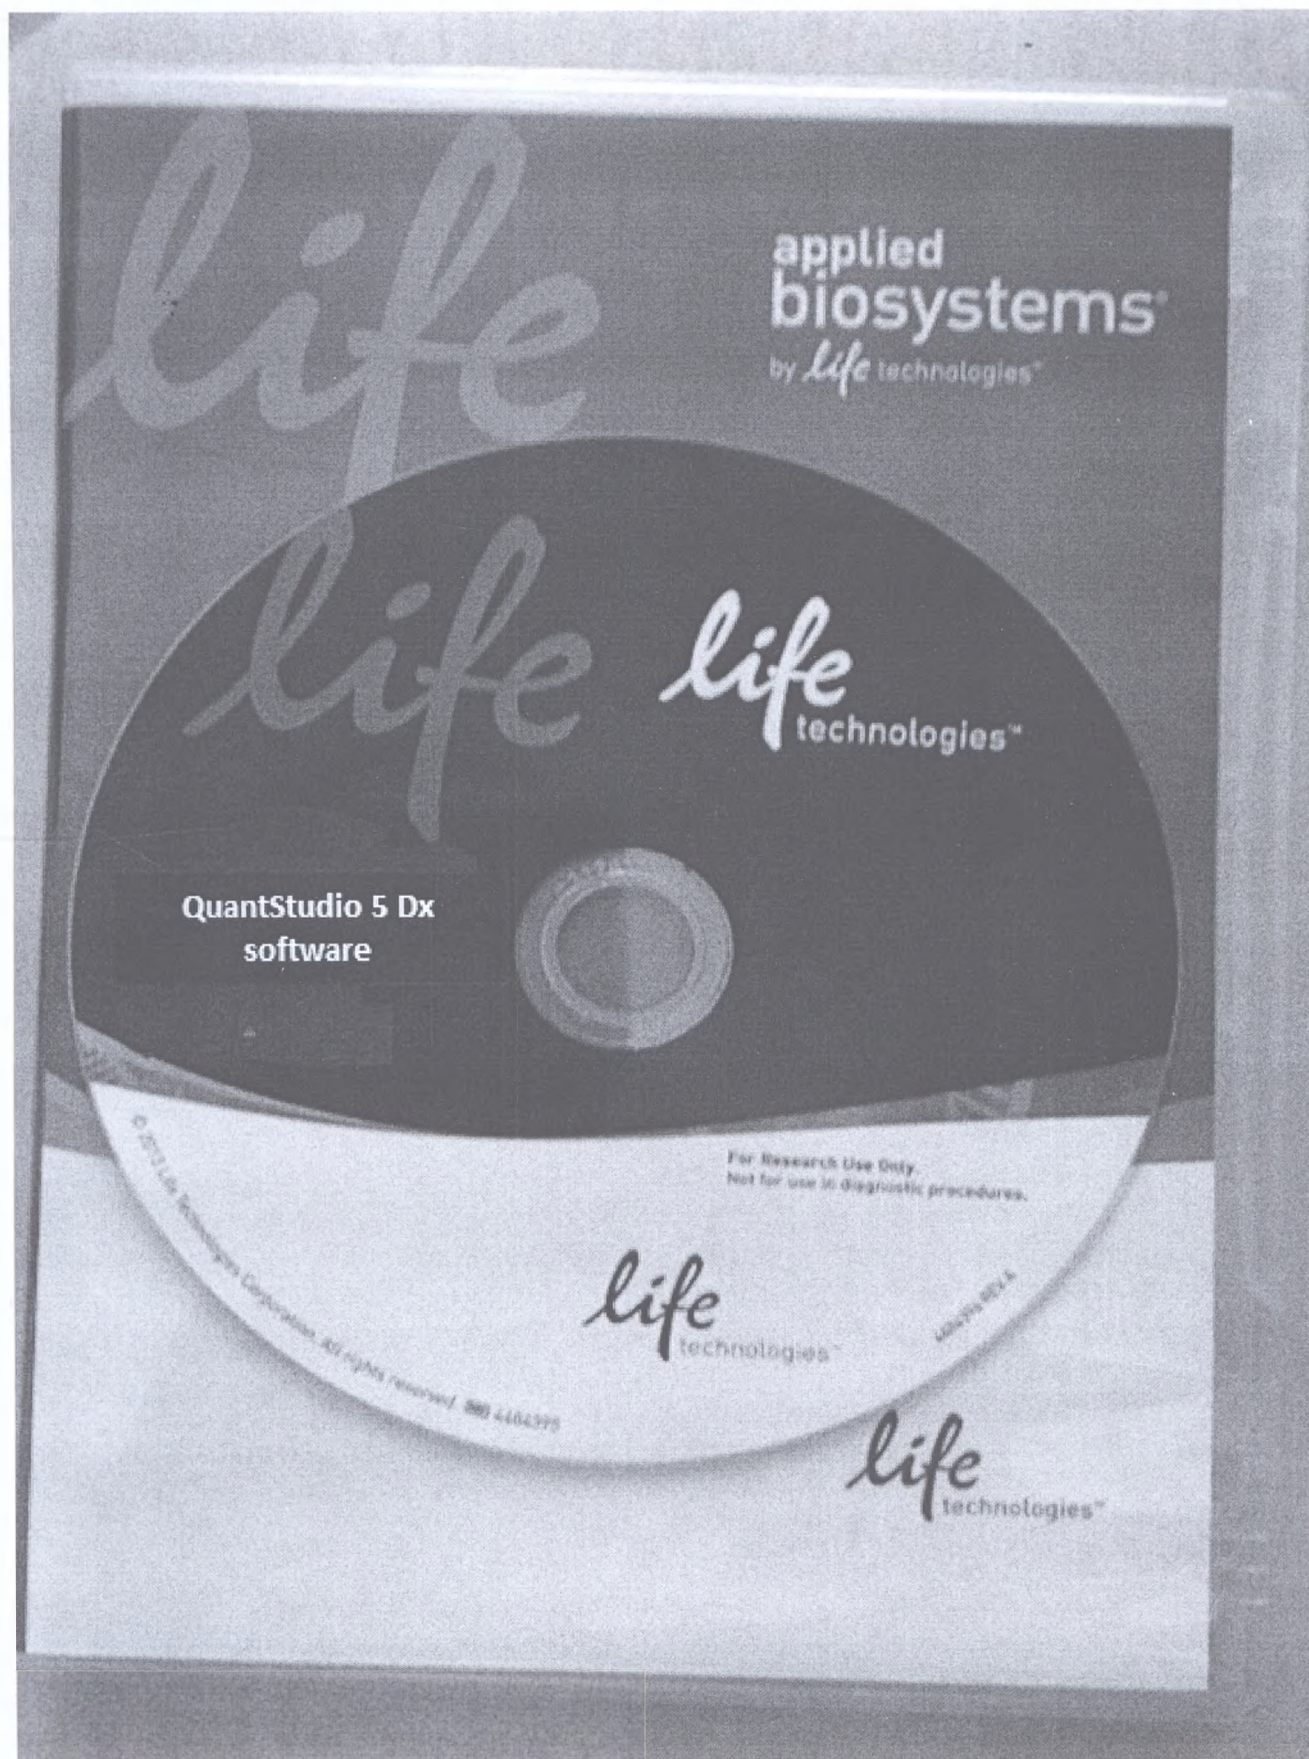

4. Сопроводительная документация по работе с программным обеспечением на бумажном носителе — 2 шт.

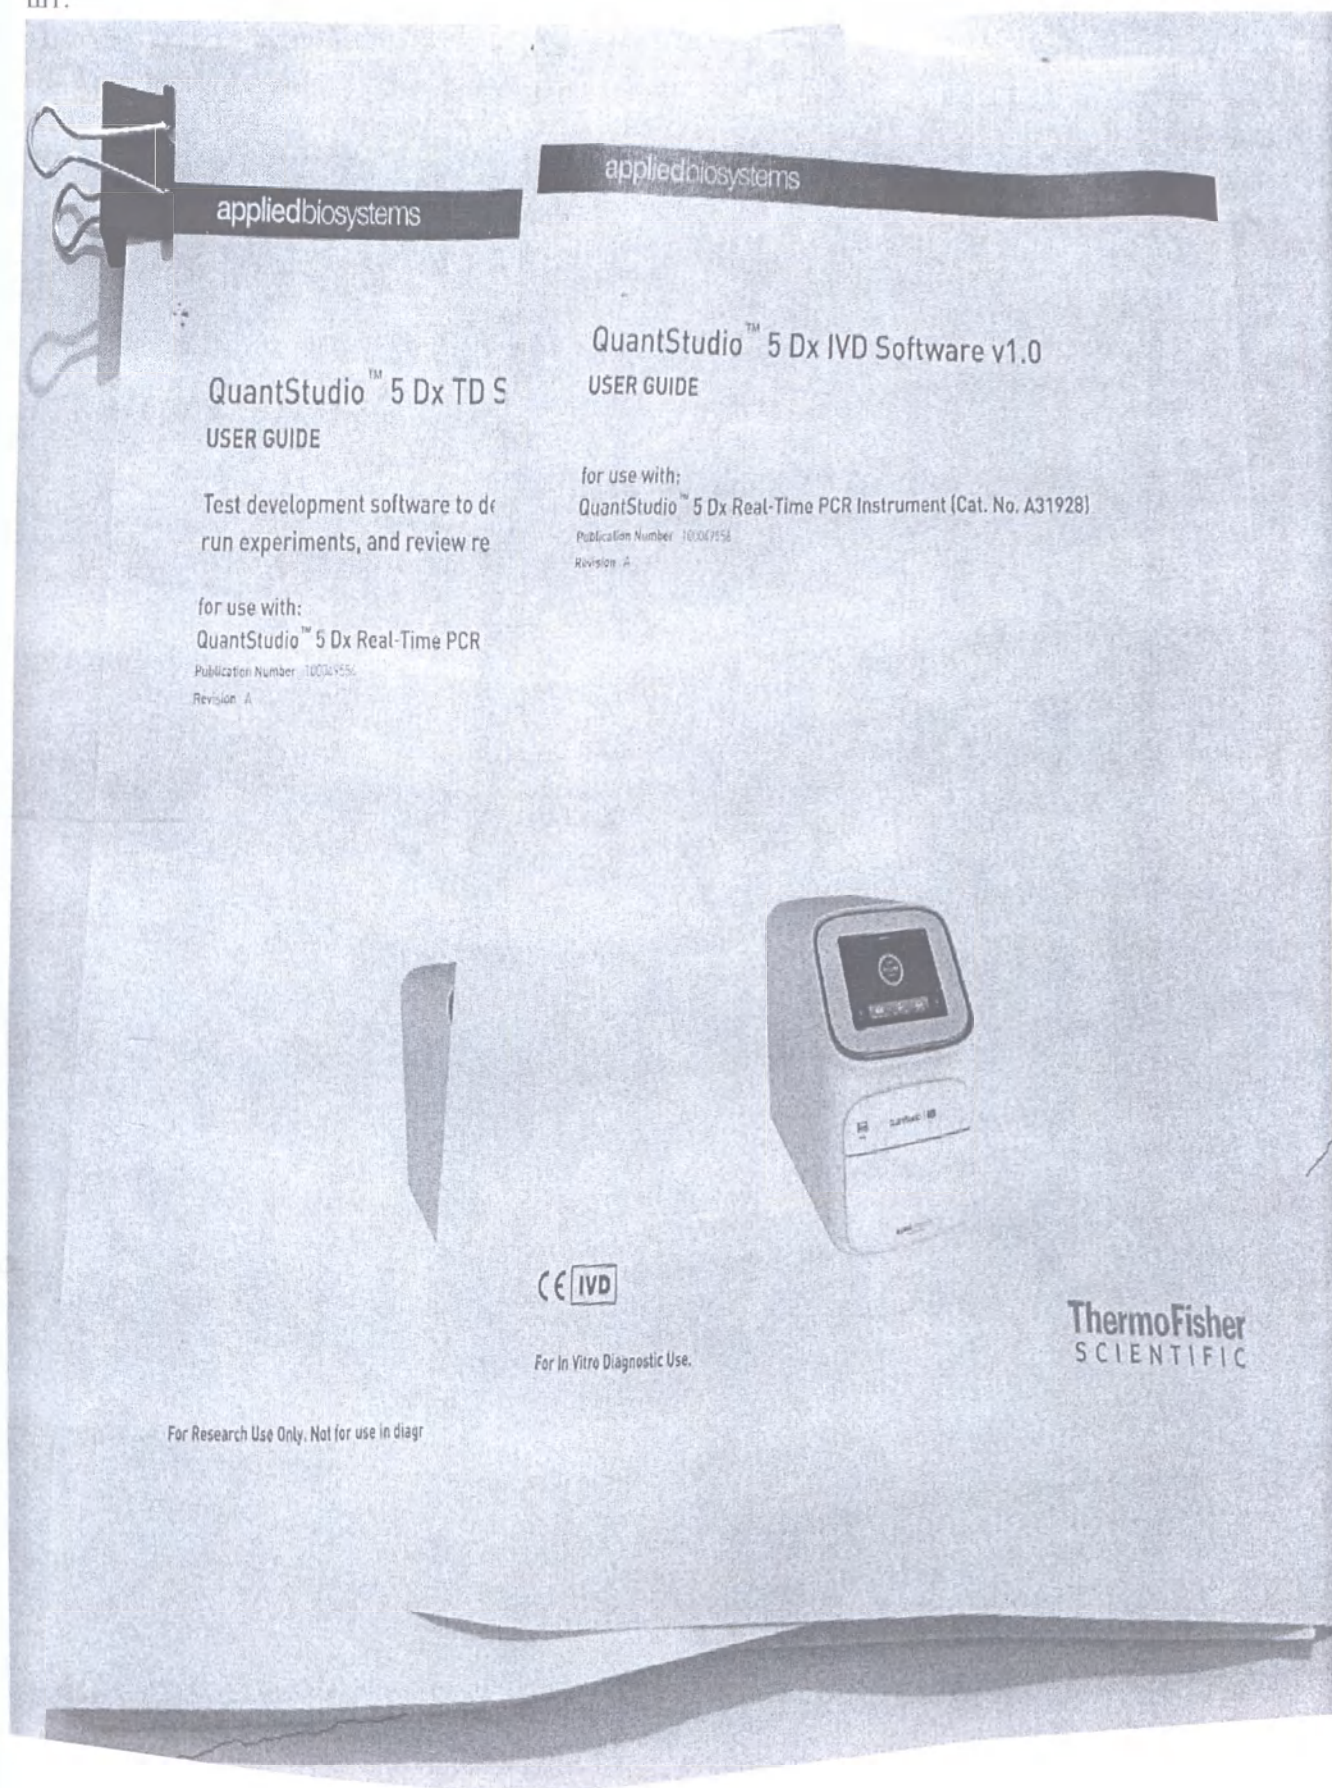

5. Сопроводительная документация по работе с прибором на бумажном носителе – 1 шт.

appliedbiosystems

по подготовке
ЖА

QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR Instrument USER GUIDE

5 с

ов ПЦР

Maintenance and administration

IMI»

for use with:

QuantStudio™ 5 Dx TD Software


QuantStudio™ 5 Dx IVD Software

Catalog Number A31928

Publication Number 100042188

Revision A


.....	2
.....	3
.....	4
.....	5
.....	10
.....	11
.....	11
.....	12
.....	13
.....	14
.....	18
1 для	
кислот	
дуктов	
ю™ 5,	




For In Vitro Diagnostic Use.

ThermoFisher
SCIENTIFIC

6. Сопроводительная документация по работе с прибором и программным обеспечением на электронном носителе – 1 шт.

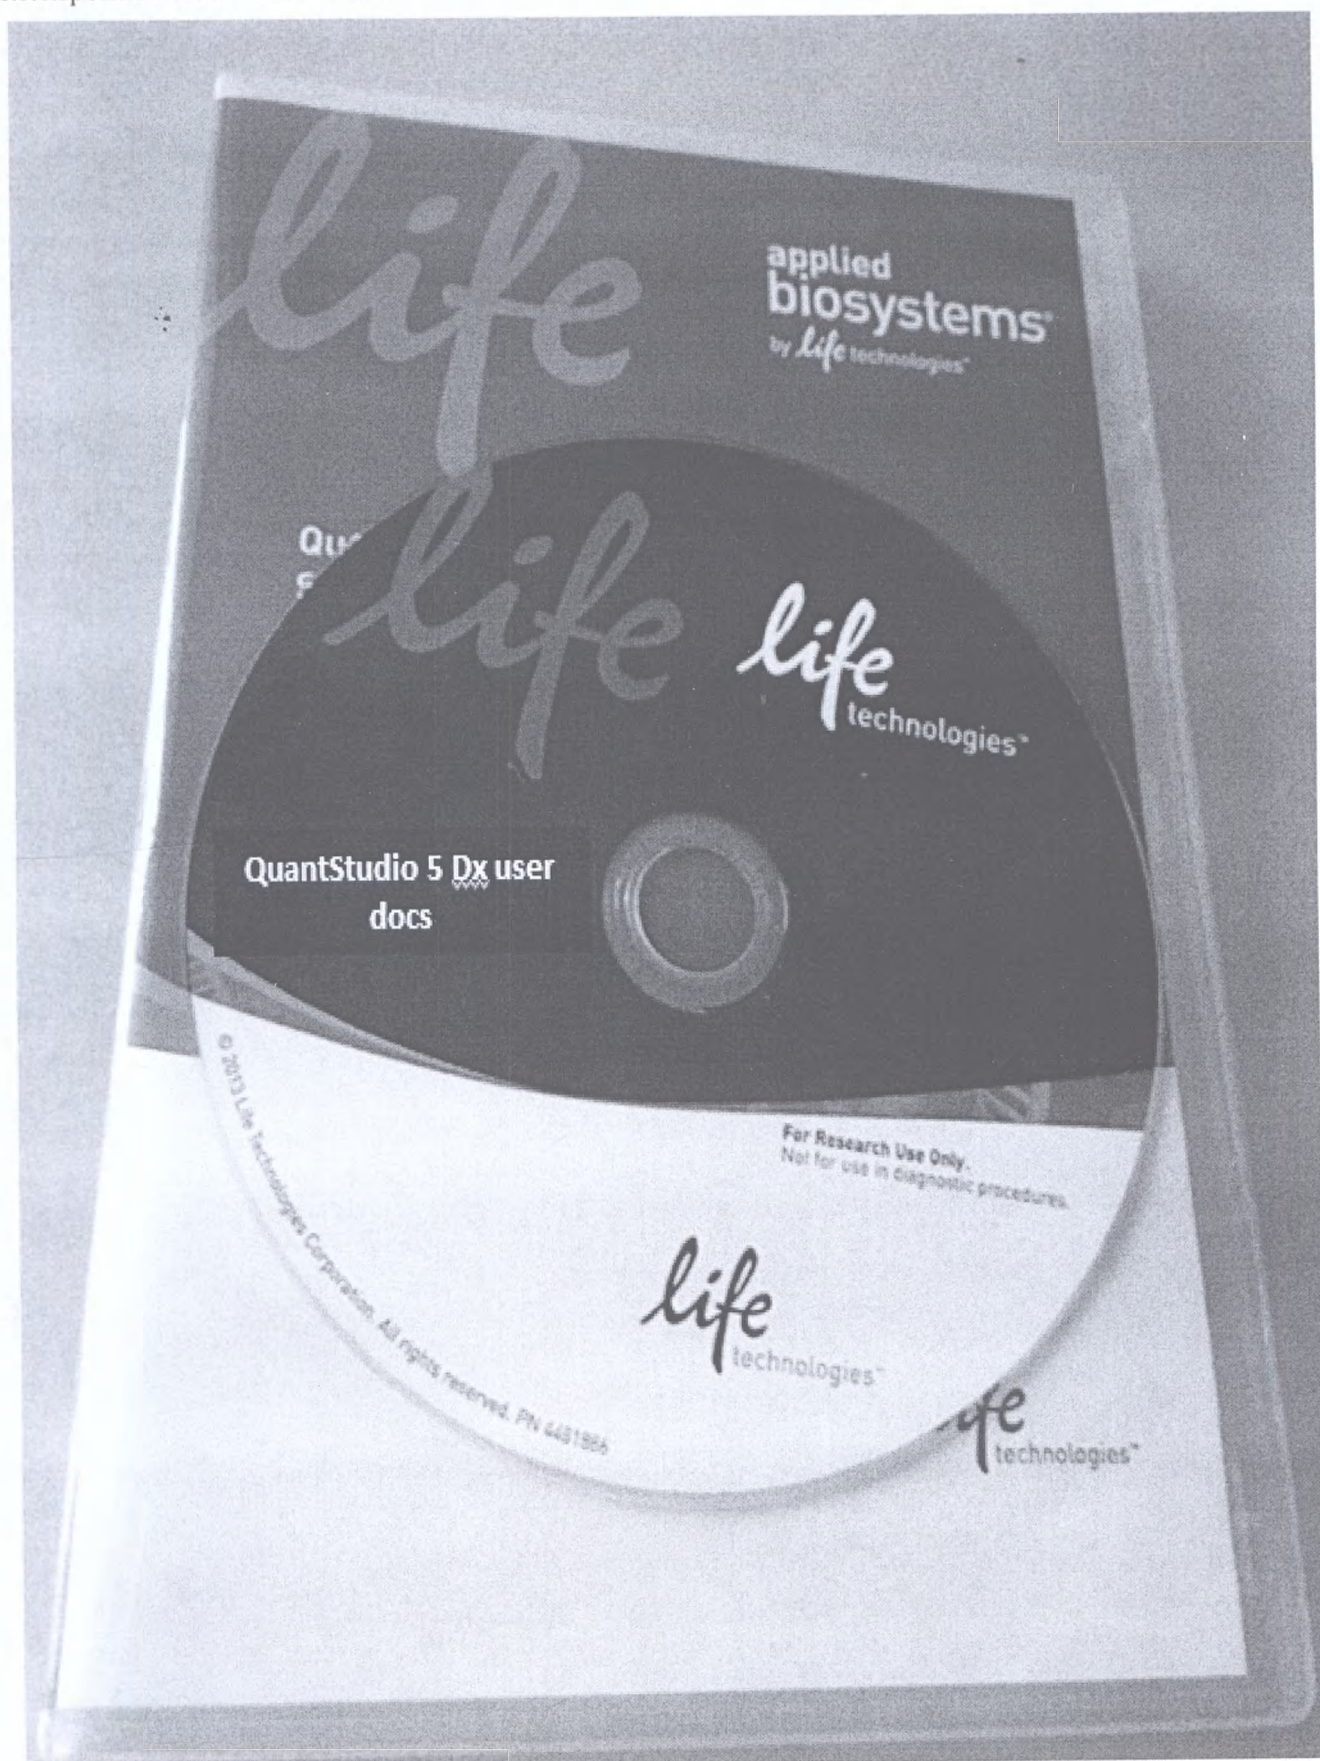

7. 96-луночная плашка с реагентами для количественного определения гена РНКазы Р для верификации прибора с термоблоком на 96 лунок (RNase P 96-well instrument verification plate)- 3 шт.

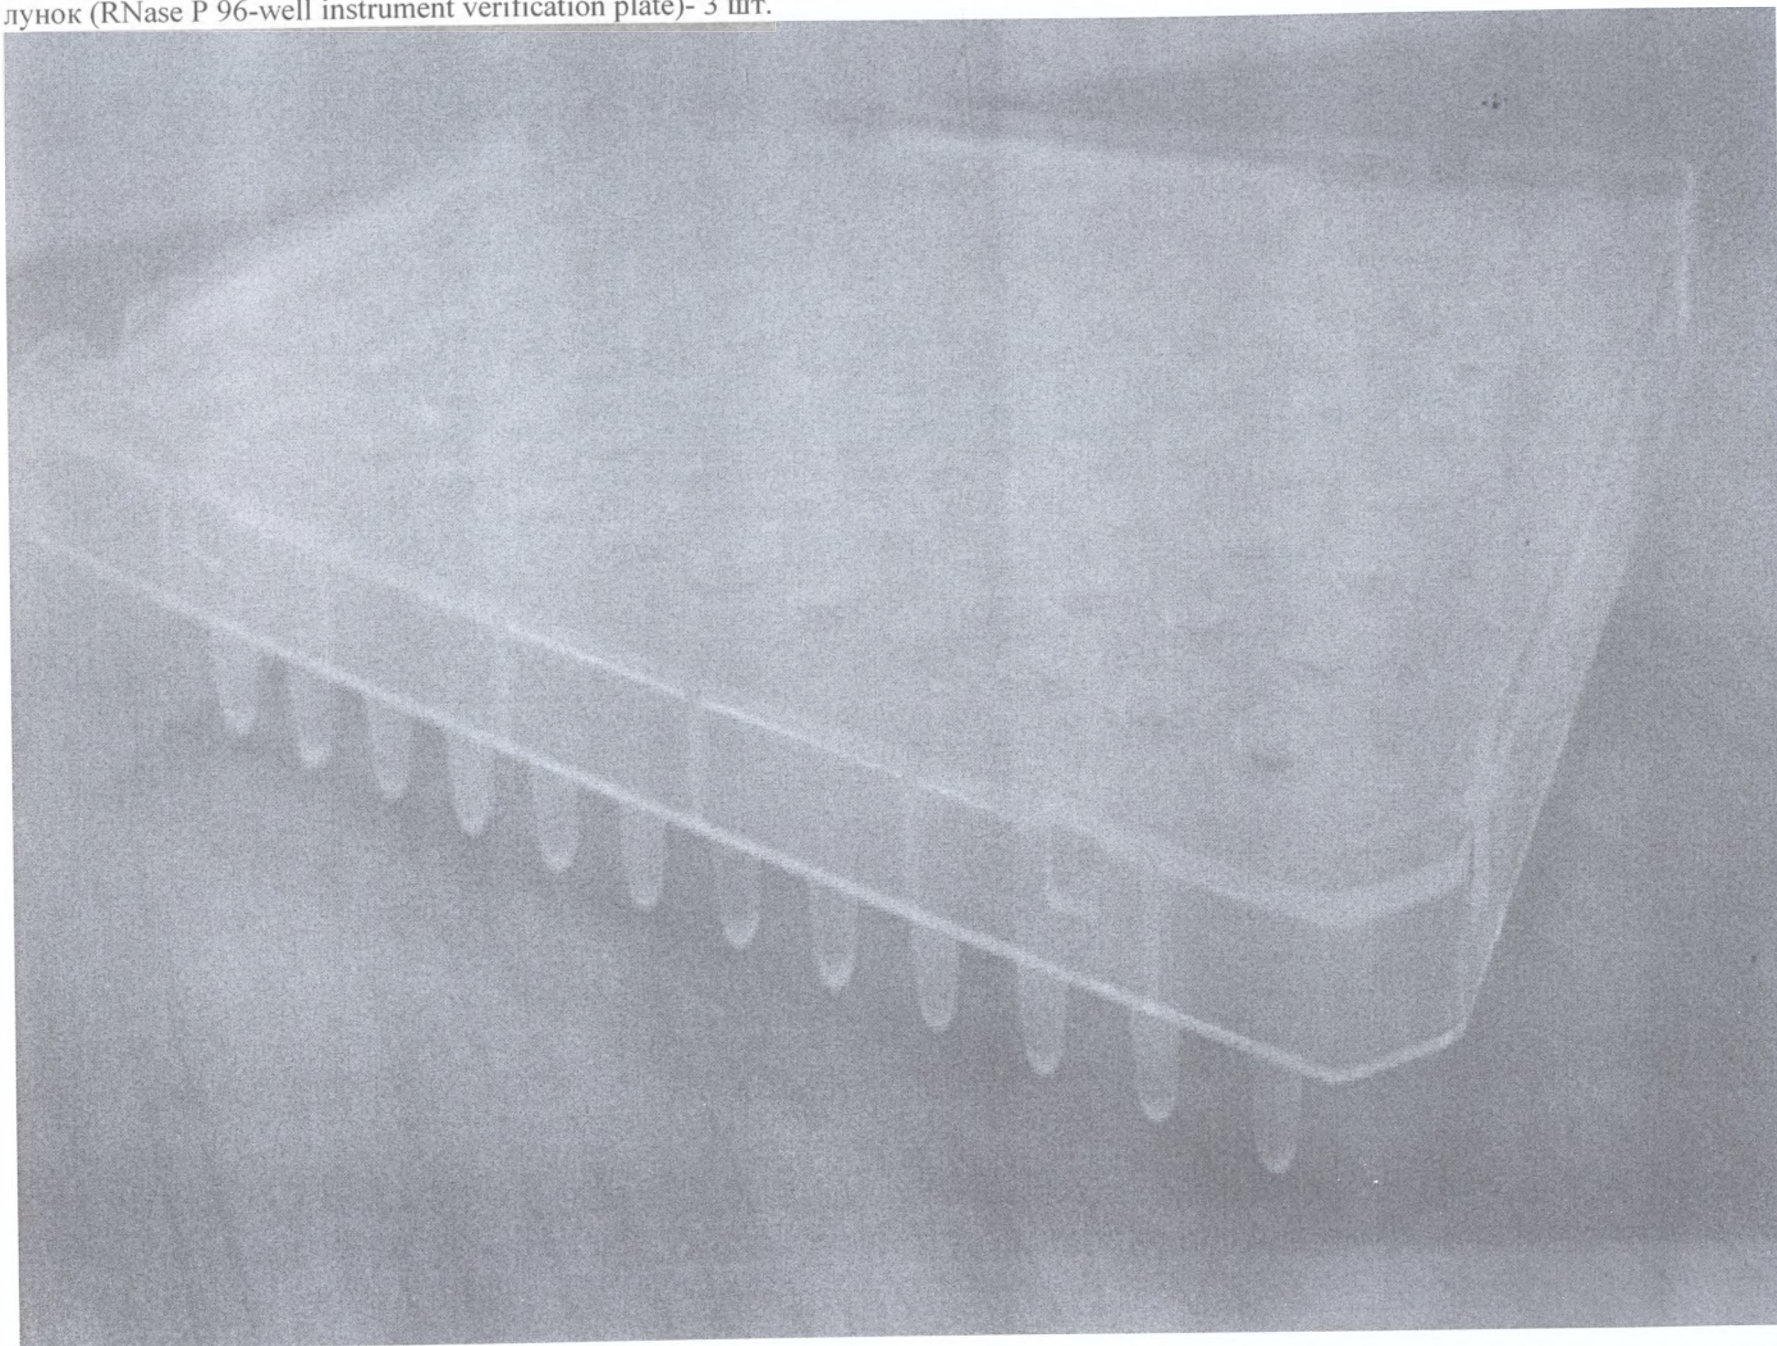

ViiA™ 7 System

TaqMan® RNase P 96-Well Instrument Verification Plate

P/N: 4432382

L/N: 1610074

Contents: One 96-Well Plate

Exp Date: 2017-09-06

Store at -15 °C to -25 °C


Made in Singapore at Life Technologies Holdings Pte Ltd

www.lifetechnologies.com

For Research Use Only. Not
intended for any animal or human
therapeutic or diagnostic use.




2017-09-06



P/N:

4432382



L/N:

1610074

AB applied
biosystems

Исполнитель
не несет
ответственности
за нарушение
установленного
порядка