

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2018 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

«Троакар хирургический одноразовый с канюлей»

(Unimicro Medical Systems (Shenzhen) Co., Ltd.
(«Юнимикро Медикал Системс (Шеньчжэнь) Ко.,
Лтд.»), Китай)




Рис.1 – Троякар хирургический одноразовый с канюлей Key Switch Auto-locking Trocar (неразъемный тип) в исполнении ATRKFS1010;

Троакар хирургический одноразовый с канюлей Key Switch Auto-locking Trocar (неразъемный тип)

REF : ATRKFS1010	SIZE: 10MMx10CM	- Апиrogenно; - Нетоксично;				
LOT : U1702205	 2017-02  2020-02					
 STERILE EO						
	 CE 0120					
 UNIMICRO «Юнмикро Медикал Системс (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.», Китай 1-2/F, Bldg 31, The 3rd Industrial Area, Mashantou, Gongming Street, Guangming New District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518106, P.R. China						
Тел.: +86(0)755-8258 6331 www.unimicromed.com		Факс: +86(0)755-8258 6704				
<table border="1"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Wellang Ltd The Black Church, St. Mary's Place, Dublin, Ireland </td> </tr> </table>		EC	REP	Wellang Ltd The Black Church, St. Mary's Place, Dublin, Ireland		 955797 713012
EC	REP					
Wellang Ltd The Black Church, St. Mary's Place, Dublin, Ireland						

Рис.2 – Маркировка индивидуальной упаковки троакара хирургического одноразового с канюлей Key Switch Auto-locking Trocar (неразъемный тип) в исполнении ATRKFS1010;



Рис.3 – Троакар хирургический одноразовый с канюлей Key Switch Auto-locking Trocar (разъемный тип) в исполнении ATRKSB1010;

Троакар хирургический одноразовый с канюлей Key Switch Auto-locking Trocar (разъемный тип)

REF : ATRKSB1010	SIZE: 10MMx10CM	- Апиrogenно; - Нетоксично;
LOT : U1702206	 2017-02  2020-02	
 STERILE EO	  	 CE 0120
 UNIMICRO «Юнмикро Медикал Системс (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.» Китай 1-2/F, Bldg 31, The 3rd Industrial Area, Mashantou, Gongming Street, Guangming New District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518106, P.R. China Тел.: +86(0)755-8258 6331 Факс: +86(0)755-8258 6704 www.unimicromed.com		
EC REP Wellbong Ltd The Black Church, St. Mary's Place, Dublin, Ireland		 6 955797 713012

Рис.4 – Маркировка индивидуальной упаковки троакара хирургического одноразового с канюлей Key Switch Auto-locking Trocar (разъемный тип) в исполнении ATRKSB1010;

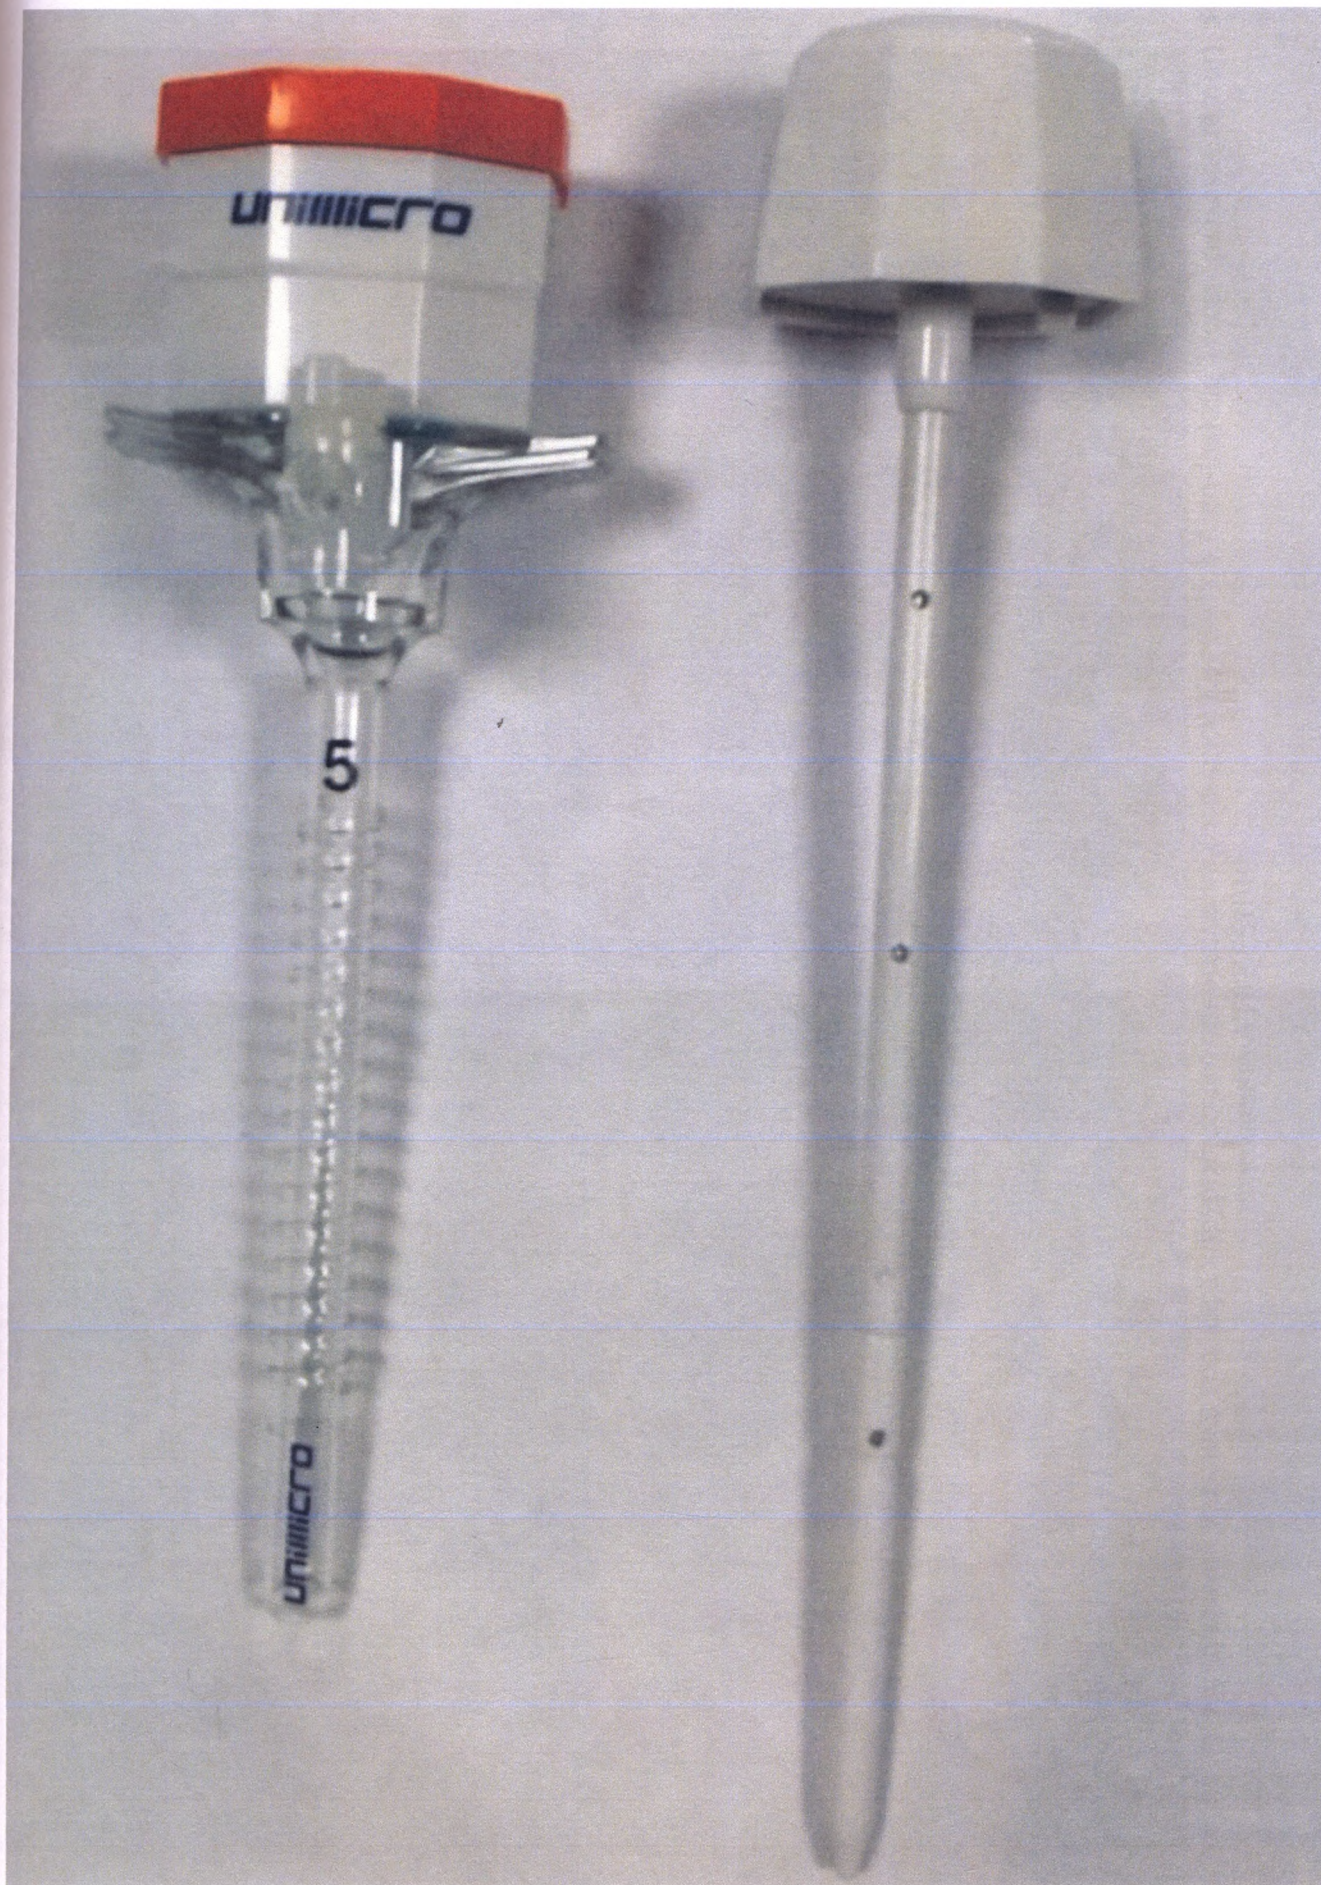


Рис.5 – Троакар хирургический одноразовый с канюлей Hand Pressed Auto-locking Trocar (неразъемный тип) в исполнении ATRHS0507

Троакар хирургический одноразовый с канюлей Hand Pressed Auto-locking Trocar (неразъемный тип)

REF : ATRHFS0507



SIZE: 5MMx70CM

- Апиrogenно;
- Нетоксично;

LOT : U1702208

 2017-02

 2020-02



UNIMICRO

«Юнимикро Медикал Системс (Шеньчжень) Ко., Лтд.», Китай
1-2/F, Bldg 31, The 3rd Industrial Area, Mashantou, Gongming Street, Guangming
New District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518106, P.R. China,

Тел.: +86(0)755-8258 6331

Факс: +86(0)755-8258 6704

www.unimicromed.com

EC REF
Wellness Ltd
The Black Church, St. Mary's Place, Dublin, Ireland




Рис.6 – Маркировка индивидуальной упаковки троакара хирургического одноразового с канюлей Key Switch Auto-locking Trocar (разъемный тип) в исполнении ATRKFS1010;



Рис.7 – Троякар хирургический одноразовый с канюлей Hasson Trocar (разъемный тип) в исполнении HTRRSB1210

Троакар хирургический одноразовый с канюлей Hasson Trocar (разъемный тип)

REF : HTRRBS1210	SIZE : 12MMx10CM	- Апиrogenно; - Нетоксично;
LOT : U1702211	2017-02 2020-02	

 STERILE EO				 CE 0120
--	---	---	---	--

 **UNIMICRO** «Юнмикро Медикал Системс (Шеньчэн) Ко., Лтд.», Китай
1-2/F, Bldg 31, The 3rd Industrial Area, Mashantou, Gongming Street, Guangming
New District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518106, P.R. China.

Тел.: +86(0)755-8258 6331 Факс: +86(0)755-8258 6704
www.unimicromed.com

EC	REF
Wellbanc Ltd The Black Church, St. Mary's Place, Dublin, Ireland	



6 955797 713012

Рис.8 – Маркировка индивидуальной упаковки троакара хирургического одноразового с канюлей Hasson Trocar (разъемный тип) в исполнении HTRRSB1210;



Рис.9 – Троакар хирургический одноразовый с канюлей Bladeless trocar (разъемный тип) в исполнении BTRDSB1210

Троакар хирургический одноразовый с канюлей Bladeless trocar (разъемный тип)

REF : BTRDSB1210	SIZE : 12MMx10CM	- Апиrogenно; - Нетоксично;
LOT : U1702212	 2017-02  2020-02	
 STERILE EO	  	 CE 0120
 UNIMICRO «Юнимикро Медикал Системс (Шеньчжень) Ко., Лтд.», Китай 1-2/F, Bldg 31, The 3rd Industrial Area, Mashantou, Gongming Street, Guangming New District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518106, P.R. China. Тел.: +86(0)755-8258 6331 Факс: +86(0)755-8258 6704 www.unimicromed.com		
EC REP Wellbong Ltd The Black Church, St. Mary's Place, Dublin, Ireland		 6 955797 713012

Рис.10 – Маркировка индивидуальной упаковки троакара хирургического одноразового с канюлей Bladeless Trocar (разъемный тип) в исполнении BTRDSB1210;



Рис.11 – Троакар хирургический одноразовый с канюлей Bladeless trocar (неразъемный тип) в исполнении BTRDFS1010

Троакар хирургический одноразовый с канюлей Bladeless trocar (неразъемный тип)

REF : BTRDFS1010	SIZE: 10MMx10CM	- Апиrogenно; - Нетоксично;
LOT : U1702213	 2017-02  2020-02	
 STERILE EO		
	 CE 0120	
 UNIMICRO «Юнимикро Медикал Системс (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.», Китай 1-2/F, Bldg 31, The 3rd Industrial Area, Mashantou, Gongming Street, Guangming New District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518106, P.R. China, Тел.: +86(0)755-8258 6331 Факс: +86(0)755-8258 6704 www.unimicromed.com		
EC REP Wellang Ltd The Black Church, St. Mary's Place, Dublin, Ireland		 955797 719012

Рис.12 – Маркировка индивидуальной упаковки троакара хирургического одноразового с канюлей Bladeless Trocar (неразъемный тип) в исполнении BTRDFS1010;



Рис.13 – Троакар хирургический одноразовый с канюлей Bladeless visible trocar (разъемный тип) в исполнении VTRDSB0510

Троакар хирургический одноразовый с канюлей Bladeless visible trocar (разъемный тип)


REF : VTRDSB0510	SIZE: 7MMx10CM	- Апиrogenно; - Нетоксично;
LOT : U1702214	 2017-02  2020-02	
 STERILE EO		
		
 UNIMICRO «Юнимикро Медикал Системс (Шеньчжень) Ко., Лтд., Китай 1-2/F, Bldg 31, The 3rd Industrial Area, Mashantou, Gongming Street, Guangming New District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518106, P.R. China. Тел.: +86(0)755-8258 6331 Факс: +86(0)755-8258 6704 www.unimicromed.com		
EC REP Wellbong Ltd The Black Church, St. Mary's Place, Dublin, Ireland		 935797 713012

Рис. 14 – Маркировка индивидуальной упаковки троакара хирургического одноразового с канюлей Bladeless visible trocar (разъемный тип) в исполнении VTRDSB0510

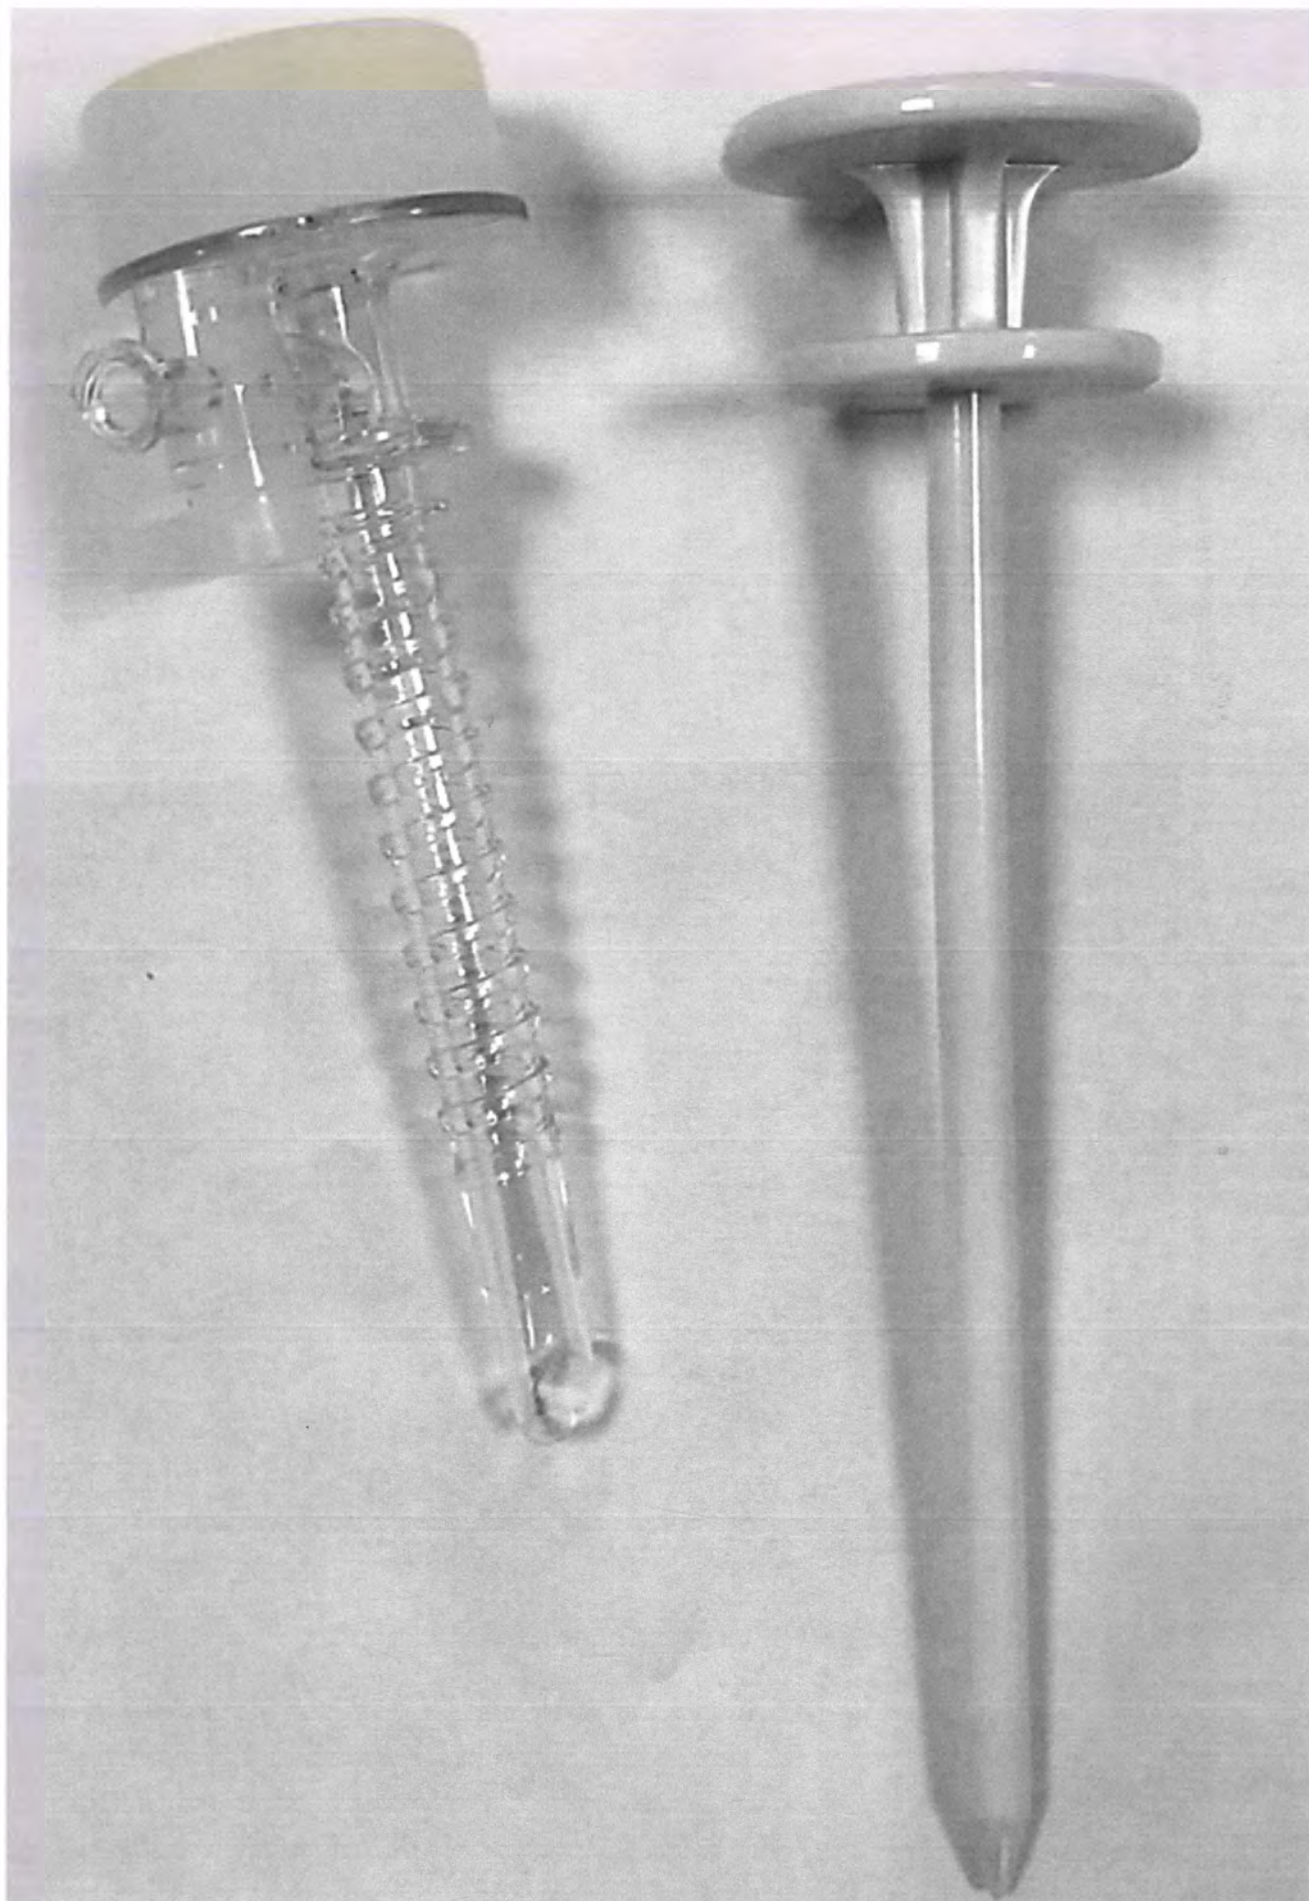


Рис.15 – Троакар хирургический одноразовый с канюлей Secondary trocar (неразъемный тип) в исполнении STRBFS0507

Троакар хирургический одноразовый с канюлей
Secondary trocar (неразъемный тип)




REF : STRBFS0507	SIZE: 5MMx70CM	- Апиrogenно; - Нетоксично;				
LOT : U1702218	 2017-02  2020-02					
 STERILE EO						
						
 UNIMICRO «Юнмикро Медикал Системс (Шеньчжень) Ко., Лтд», Китай 1-2/F, Bldg 31, The 3rd Industrial Area, Mashantou, Gongguang Street, Guangming New District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518106, P.R. China. Тел.: +86(0)755-8258 6331 Факс: +86(0)755-8258 6704 www.unimicromed.com						
<table border="1"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> WellKang Ltd The Black Church, St. Mary's Place, Dublin, Ireland </td> </tr> </table>	EC	REP	WellKang Ltd The Black Church, St. Mary's Place, Dublin, Ireland		 6 955797 713012	
EC	REP					
WellKang Ltd The Black Church, St. Mary's Place, Dublin, Ireland						

Рис. 16 – Маркировка индивидуальной упаковки троакара хирургического одноразового с канюлей Bladeless visible trocar (разъемный тип) в исполнении STRBFS0507;

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 17 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова Т.А. / Носова Т.А.
М.П.

