

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие:

Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения трансферрина в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Трансферрин Калибраторы (Alinity с Transferrin Calibrator Kit)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Фотографические изображения МИ Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения трансферрина в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Трансферрин Калибраторы (Alinity с Transferrin Calibrator Kit)

Alinity c Transferrin Calibrator Kit



www.abbottdiagnostics.com/IFU

R01

CAL

1-5

1 x 1.0 mL

Transf Cals

REF

02R5101



Exp.


2017-12-27

LOT

100091531



G72031R01

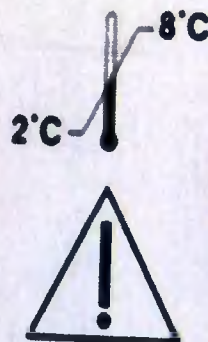

CONTAINS: AZIDE



Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

IVD




PRODUCT OF JAPAN


(01) 0000000000000000 (17) 171227

(10) 100091531 (240) 1234567 (91) A2B3C4D5E6


Фотографические изображения МИ Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения трансферрина в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Трансферрин Калибраторы (Alinity с Transferrin Calibrator Kit

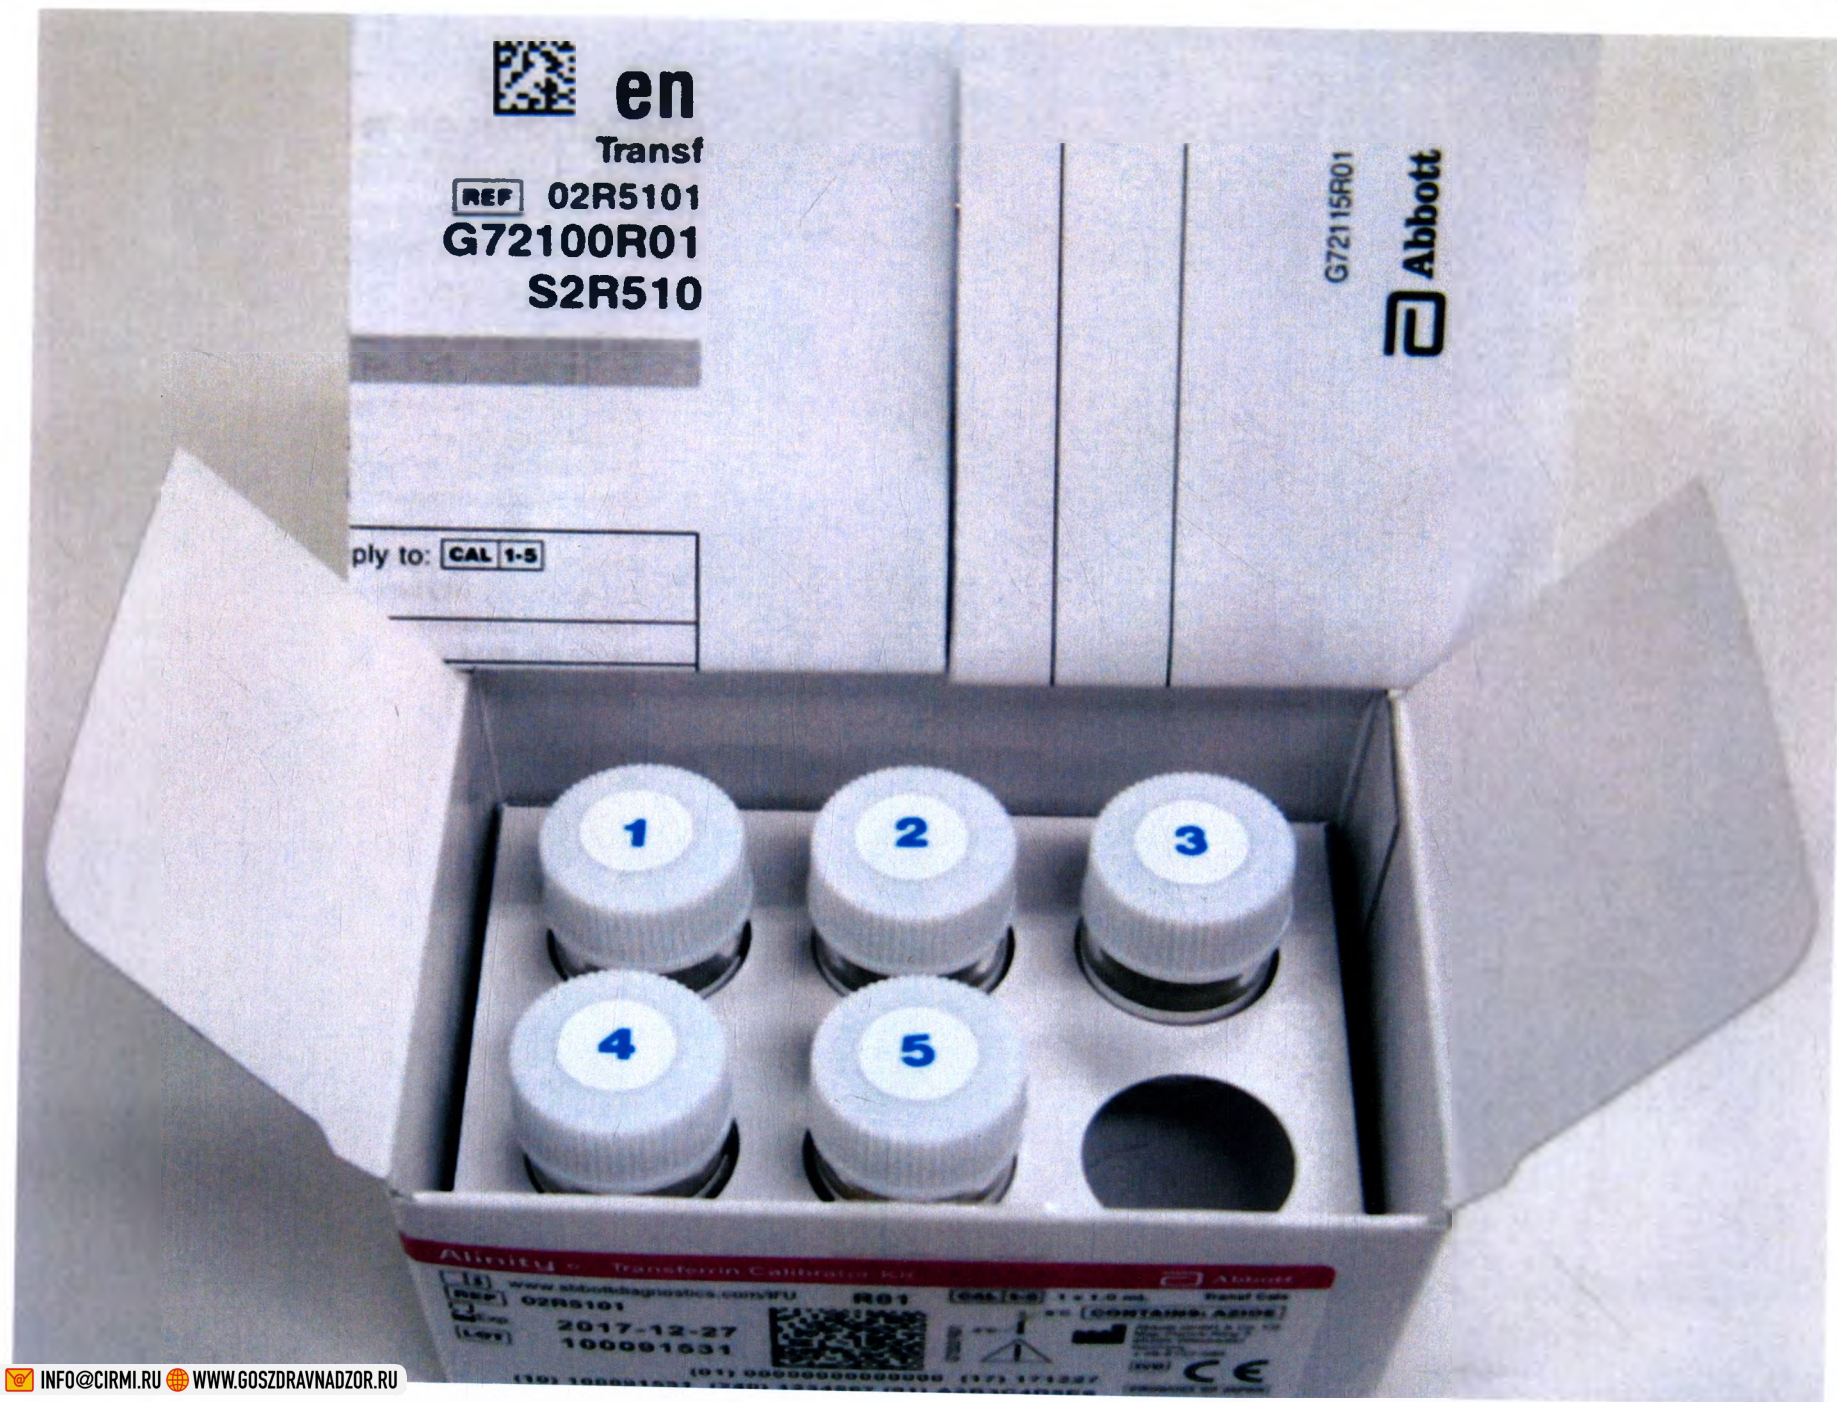

Фотографические изображения МИ Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения трансферрина в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Трансферрин Калибраторы (Alinity с Transferrin Calibrator Kit

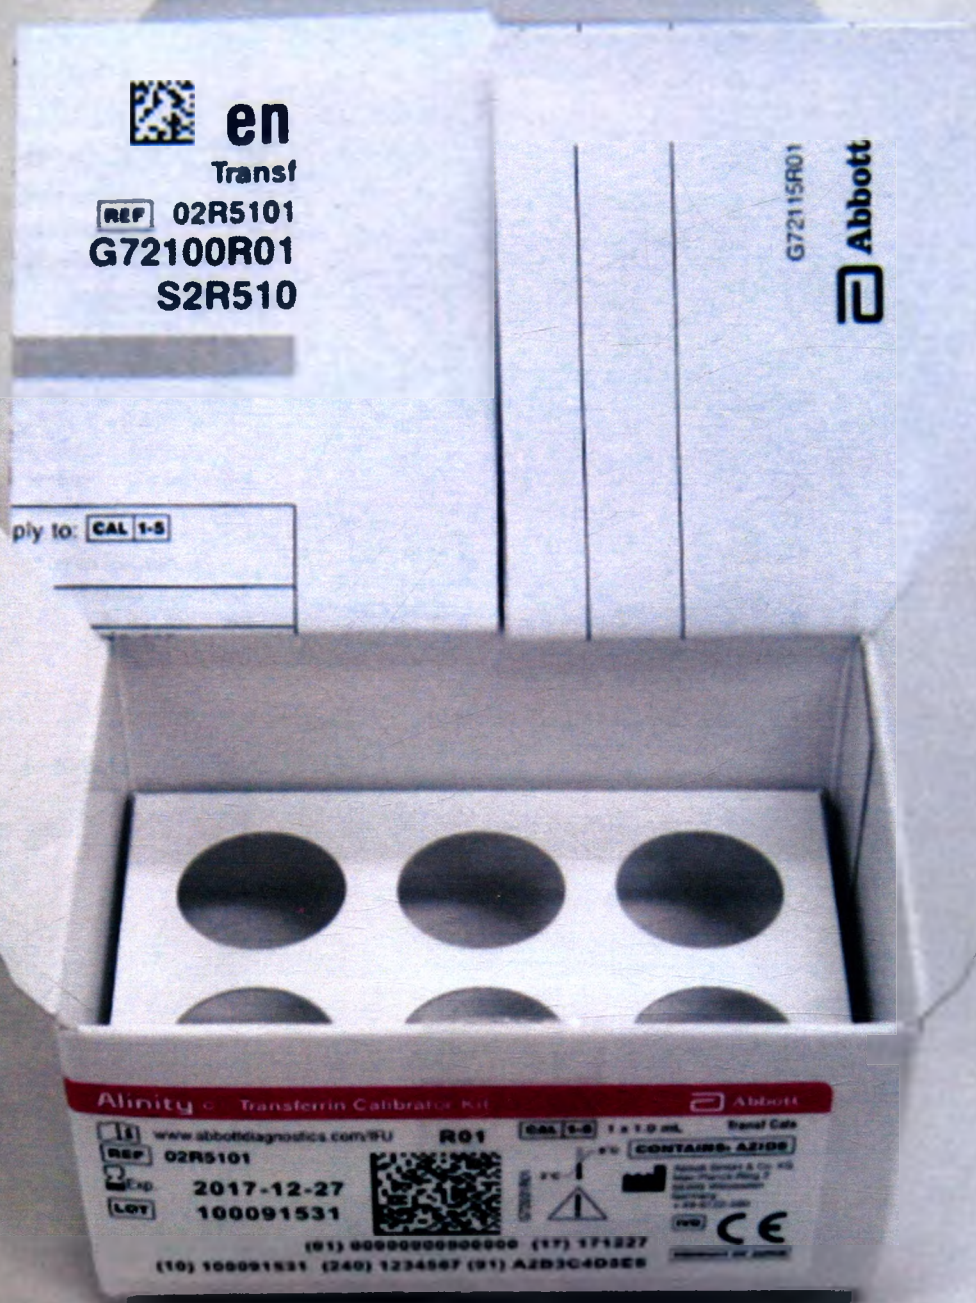

Фотографические изображения МИ Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения трансферрина в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Трансферрин Калибраторы (Alinity с Transferrin Calibrator Kit)

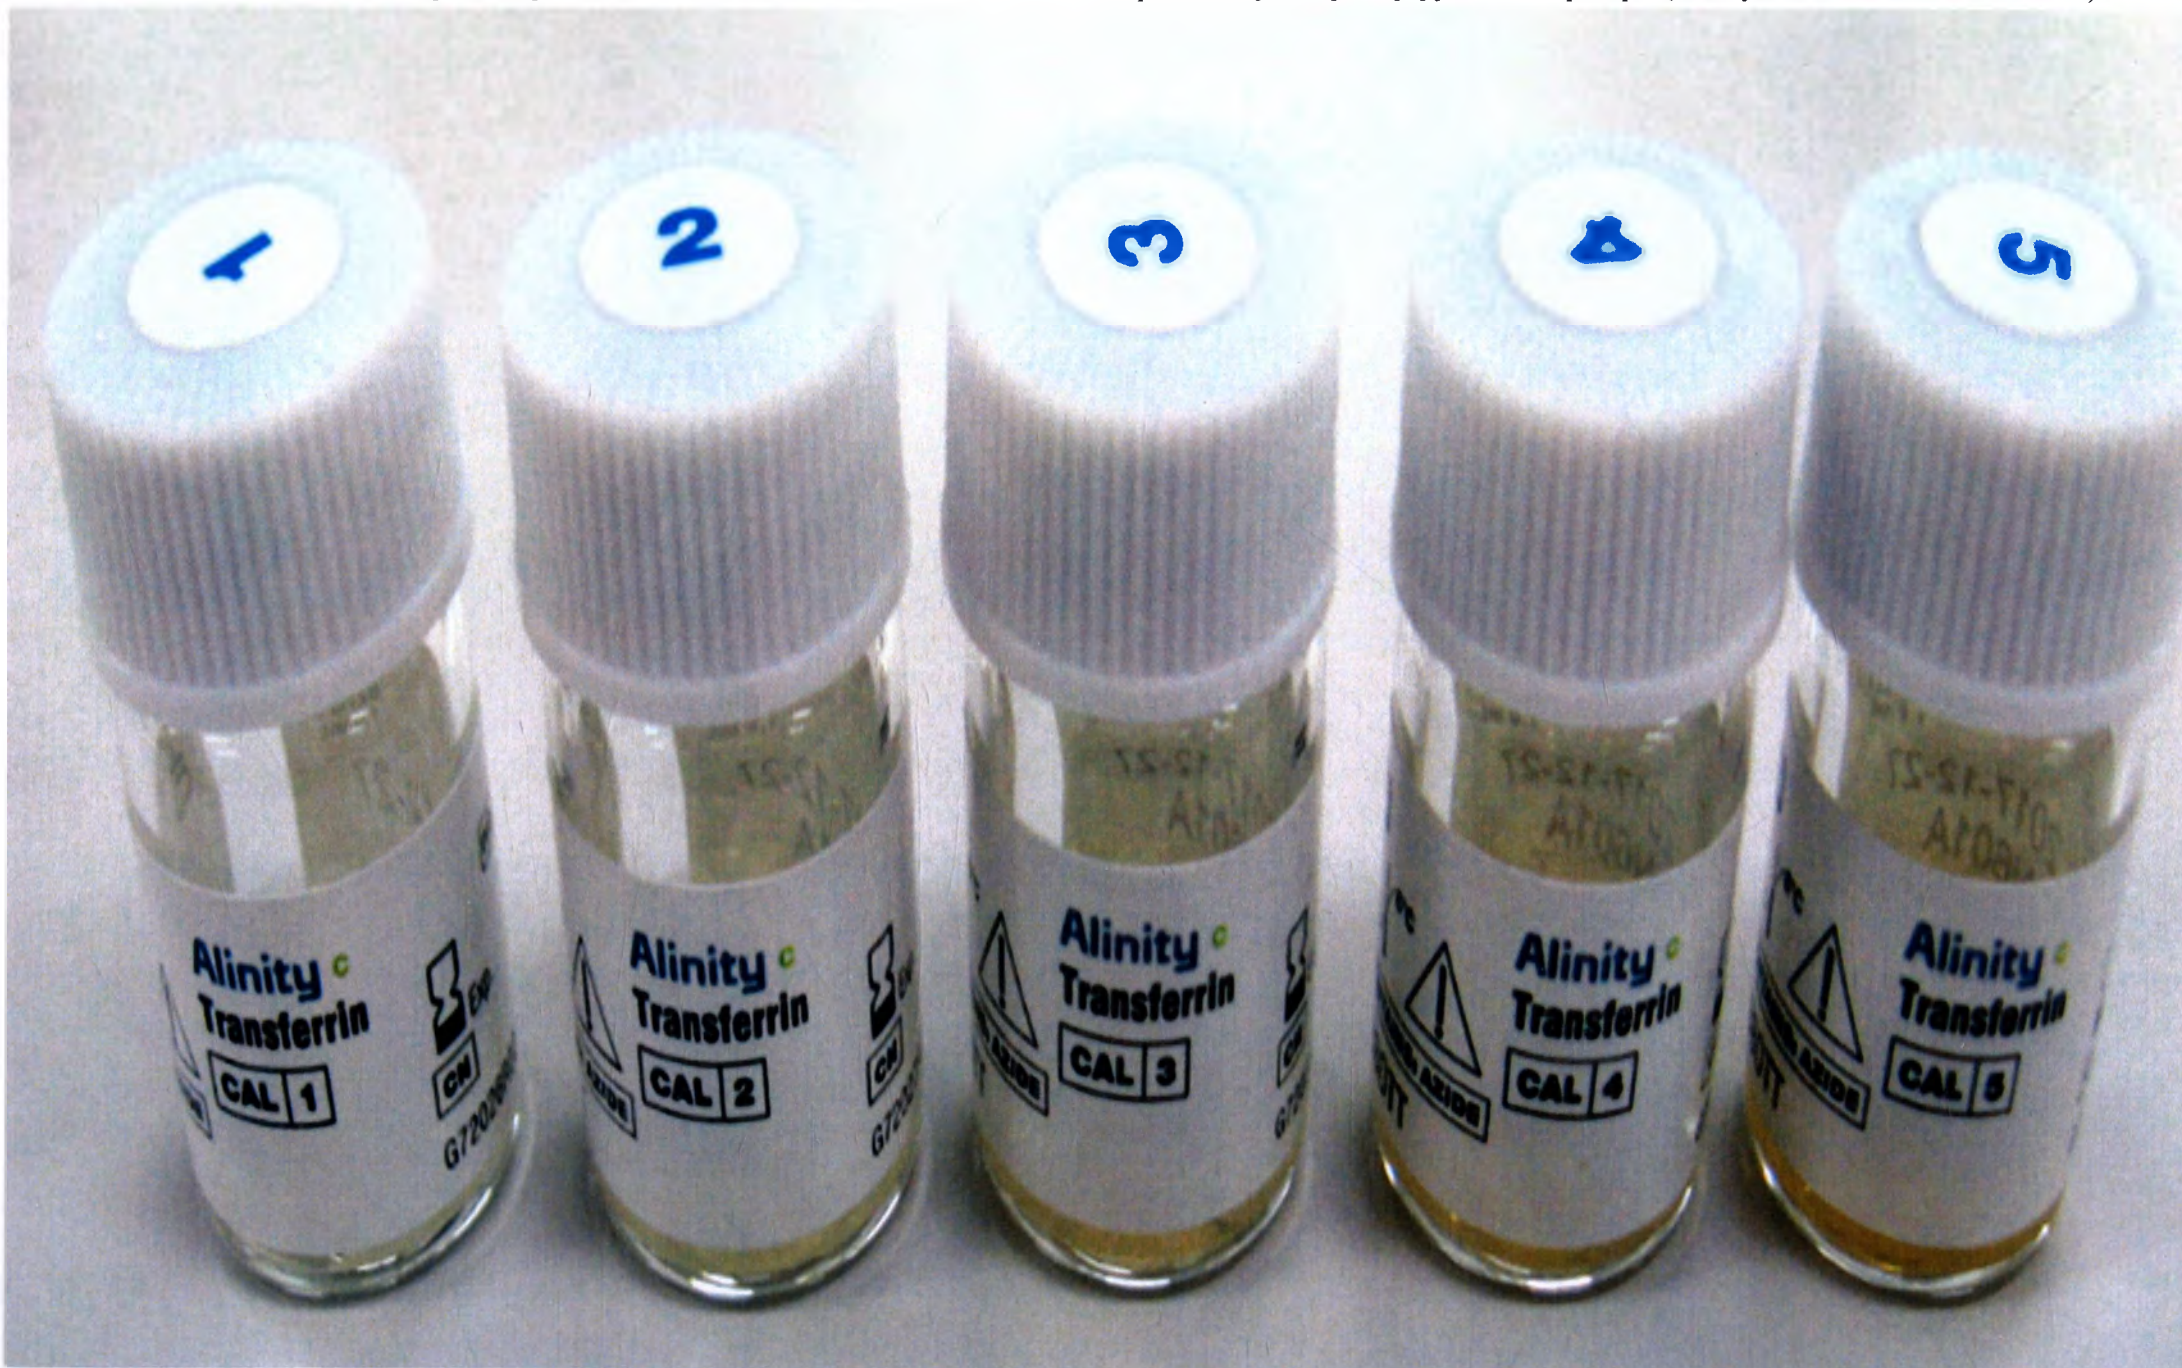

5/12 ЛИСТОВ

5/02/2018 ЛИСТОВ
ОДПИСЬ Евгения Ефимовича
Литвинова

Общество с ограниченной ответственностью "Абботт Лаборатории"
Limited liability company
Abbott Laboratories

ИНН 77-07-00693 ОГРН 1077707006934
МОСКВА * РОССИЯ * 125080

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор калибраторов для обеспечения правильности
количественного определения трансферрина в сыворотке или плазме
крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических
анализаторах Alinity с «Трансферрин Калибраторы (Alinity с Transferrin
Calibrator Kit)»**

REF

02R51-01

KxxxxR
xxxxxxRxx

Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения трансферрина в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c «Трансферрин Калибраторы (Alinity c Transferrin Calibrator Kit)»

Состав:

- Калибратор 1 (Alinity c Transferrin CAL 1) -1 флакон x 1,0 мл
 - Калибратор 2 (Alinity c Transferrin CAL 2) -1 флакон x 1,0 мл
 - Калибратор 3 (Alinity c Transferrin CAL 3) -1 флакон x 1,0 мл
 - Калибратор 4 (Alinity c Transferrin CAL 4) -1 флакон x 1,0 мл
 - Калибратор 5 (Alinity c Transferrin CAL 5) -1 флакон x 1,0 мл
 - Инструкция по применению
- Производитель:** NITTOBO MEDICAL CO. LTD. MEDICAL DEVELOPMENT CENTER 1, Shiojima Fukuhara Fukuyama-Machi Koriyama – City, Fukushima-Pref. 963 8061 Japan (Япония) для Abbott GmbH & Co. KG (Эбботт ГмбХ и Ко. КГ), Max-Planck-Ring 2 65205 Wiesbaden Germany (Германия). РУ № _____/_____ от _____/_____ Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Антитела к ВИЧ1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО «Эбботт», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81.

TOP

Transf Cals

Alinity c Transferrin Calibrator Kit



CAL 1-5 1 x 1.0 mL

www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF 02R5101


Exp.

LOT

CAL 1-5 1 x 1.0 mL Transf Cals

CONTAINS: AZIDE

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6121-24-80



PRODUCT OF JAPAN



File: 02R51-TF-01_Eng_PO1e.indd
 Template: Alinity CC Ctrl Gr1 KitA Template.indd
 Label Size: 132 mm x 31 mm Drawing: AK4490R0
 Refer to the drawing for stamp fields and material
 Colors: Text, Symbols: Black Branding: PMS 233, Text reversed
 Material: Refer to drawing

Маркировка компонентов:



2°C

CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

Alinity^c
Transferrin

CAL 1

IVD

Exp.

CN

G72026R02

02R51
1.0 mL



2°C

CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

Alinity^c
Transferrin

CAL 2

IVD

Exp.

CN

G72027R01

02R51
1.0 mL



2°C

CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

Alinity^c
Transferrin

CAL 3

IVD

Exp.

CN

G72028R01

02R51
1.0 mL



2°C

CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

Alinity^c
Transferrin

CAL 4

IVD

Exp.

CN

G72029R01

02R51
1.0 mL



2°C

CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

Alinity^c
Transferrin

CAL 5

IVD

Exp.

CN

G72030R01

02R51
1.0 mL

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.

ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4/серия листов 2

