


Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»


Е.Н.Схолль-Энгбертс

« 15 »  2018 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**АНАЛИЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОГО И ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА «ВитаЛайн 150» (VitaLine 150)
ПО ТУ 26.51.53-003-94568735-2018 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ**

**Фото 1. Анализатор автоматический для биохимического и иммунотурбидиметрического анализа
«ВитаЛин 150» (VitaLine 150). Общий вид**



Фото 2. Плавкий предохранитель




Фото 3. Кабель последовательной передачи данных

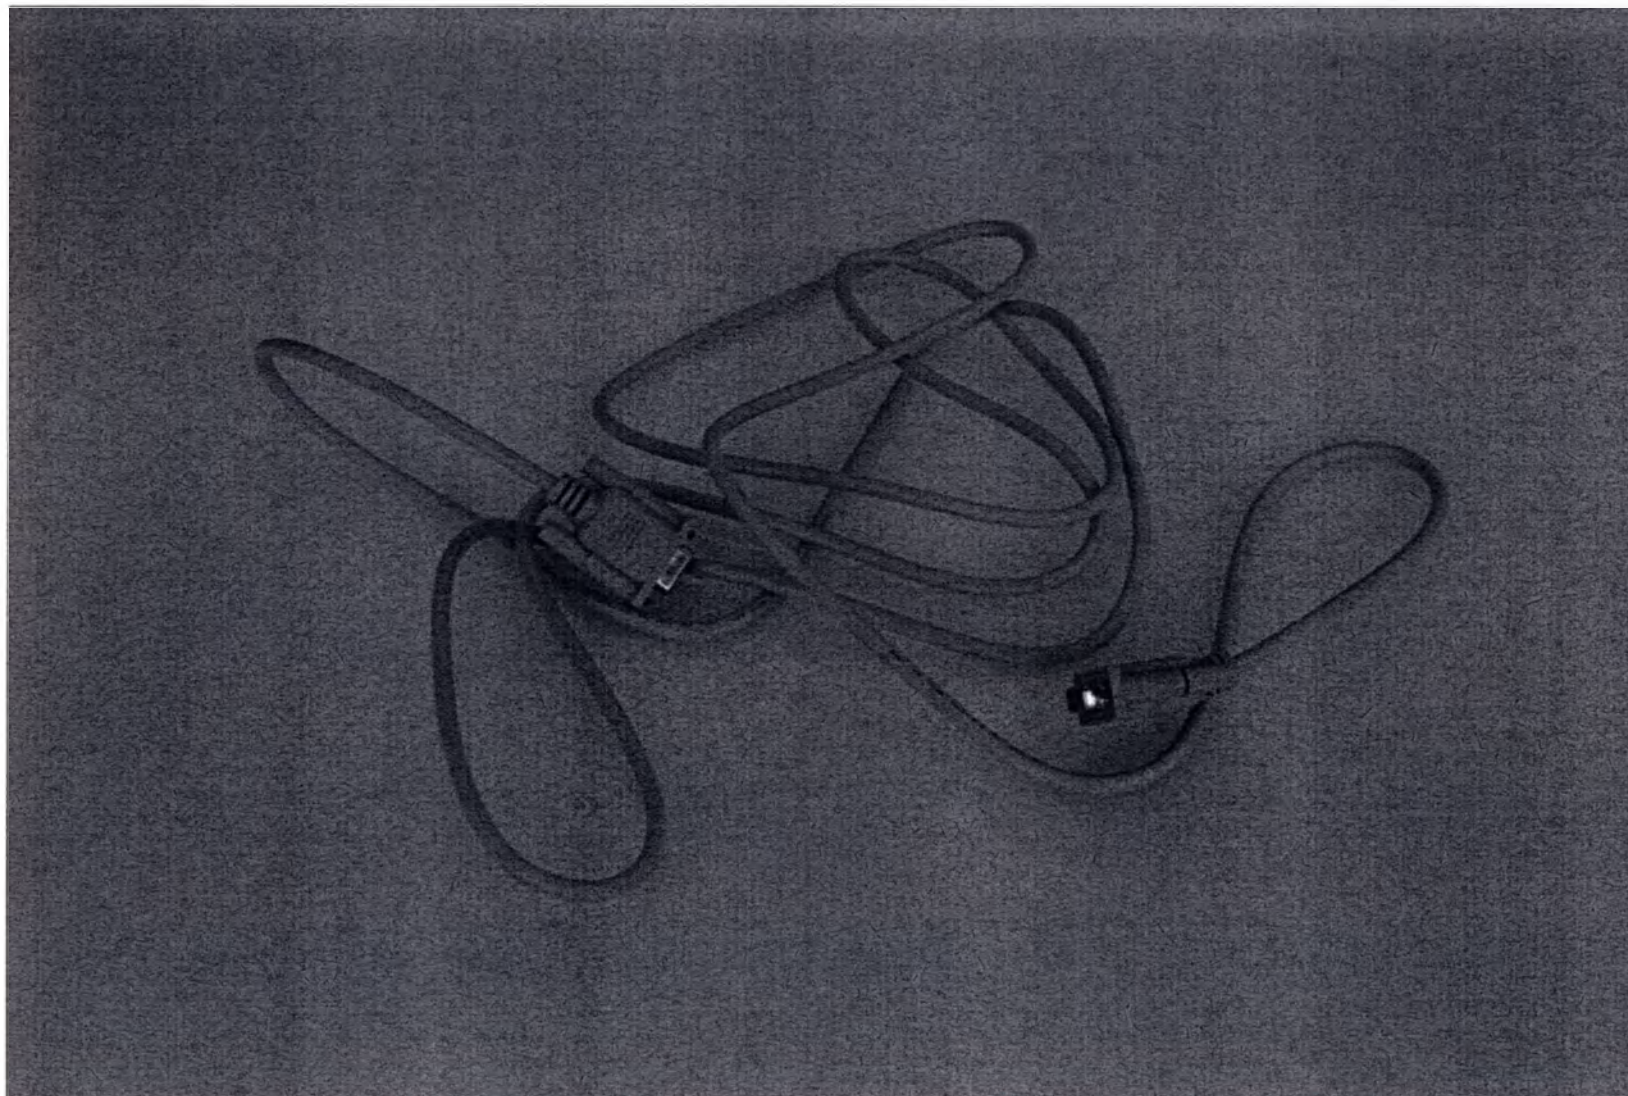


Фото 4. Лампа

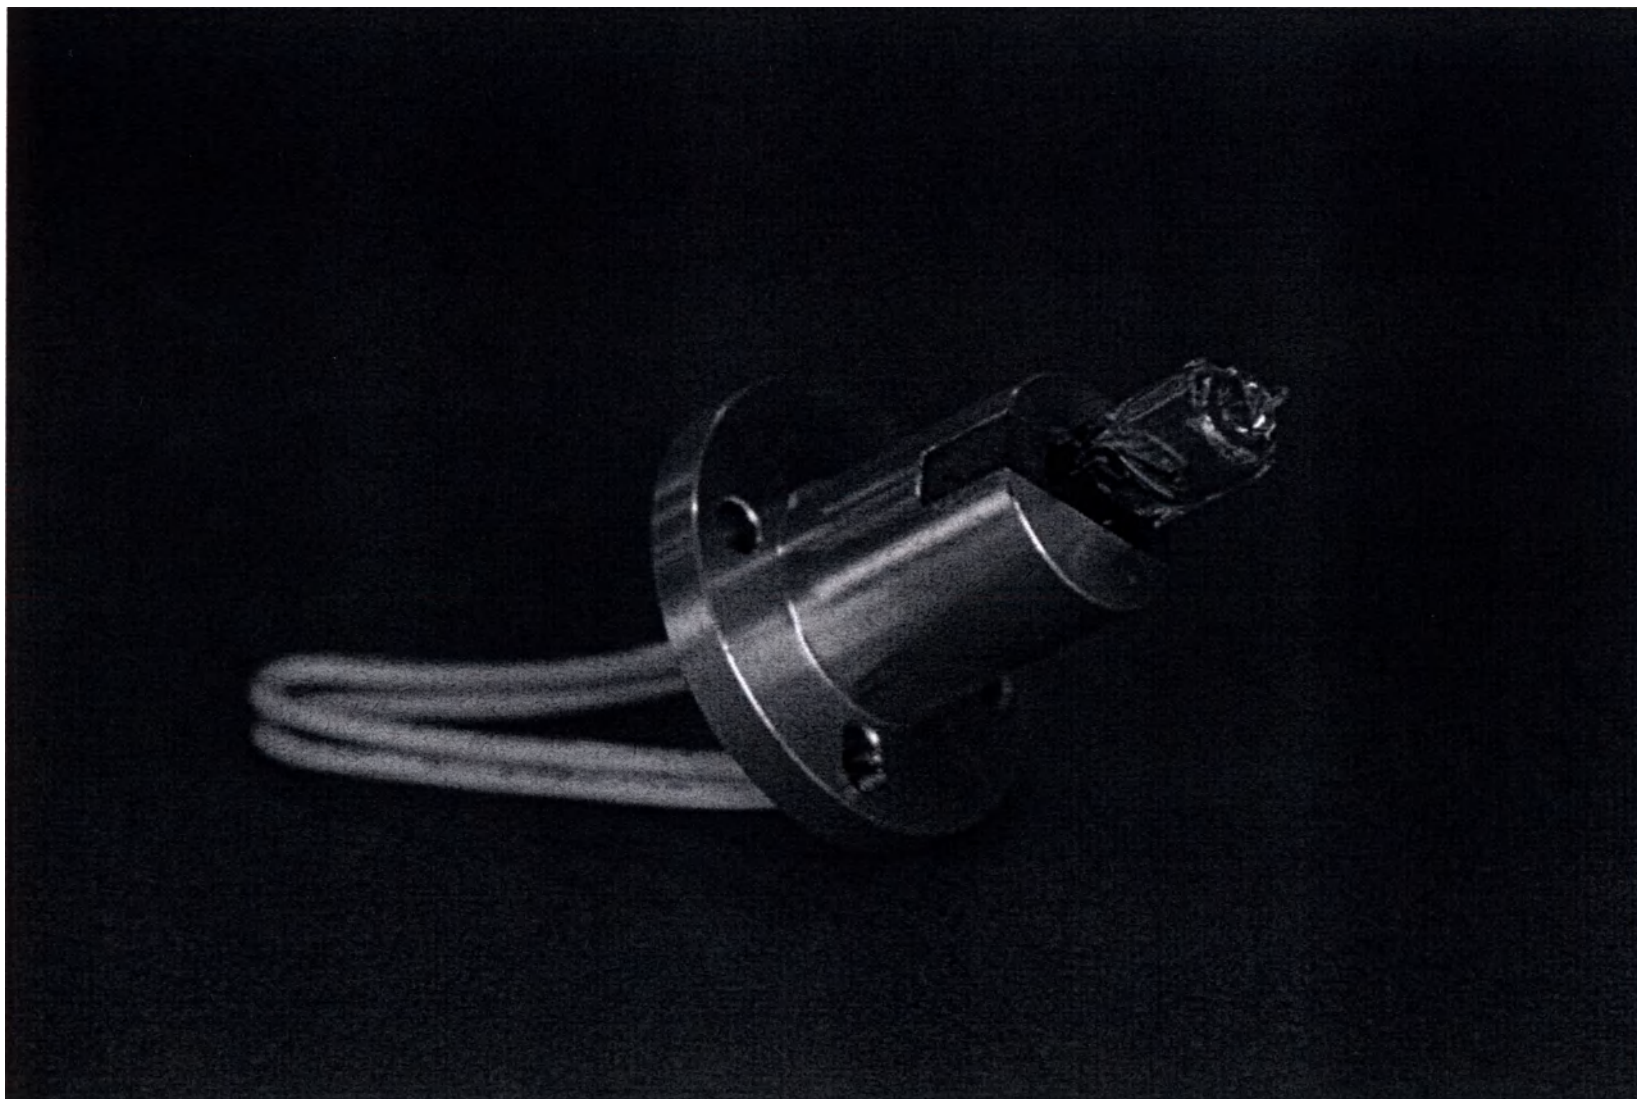


Фото 5. Кабель питания

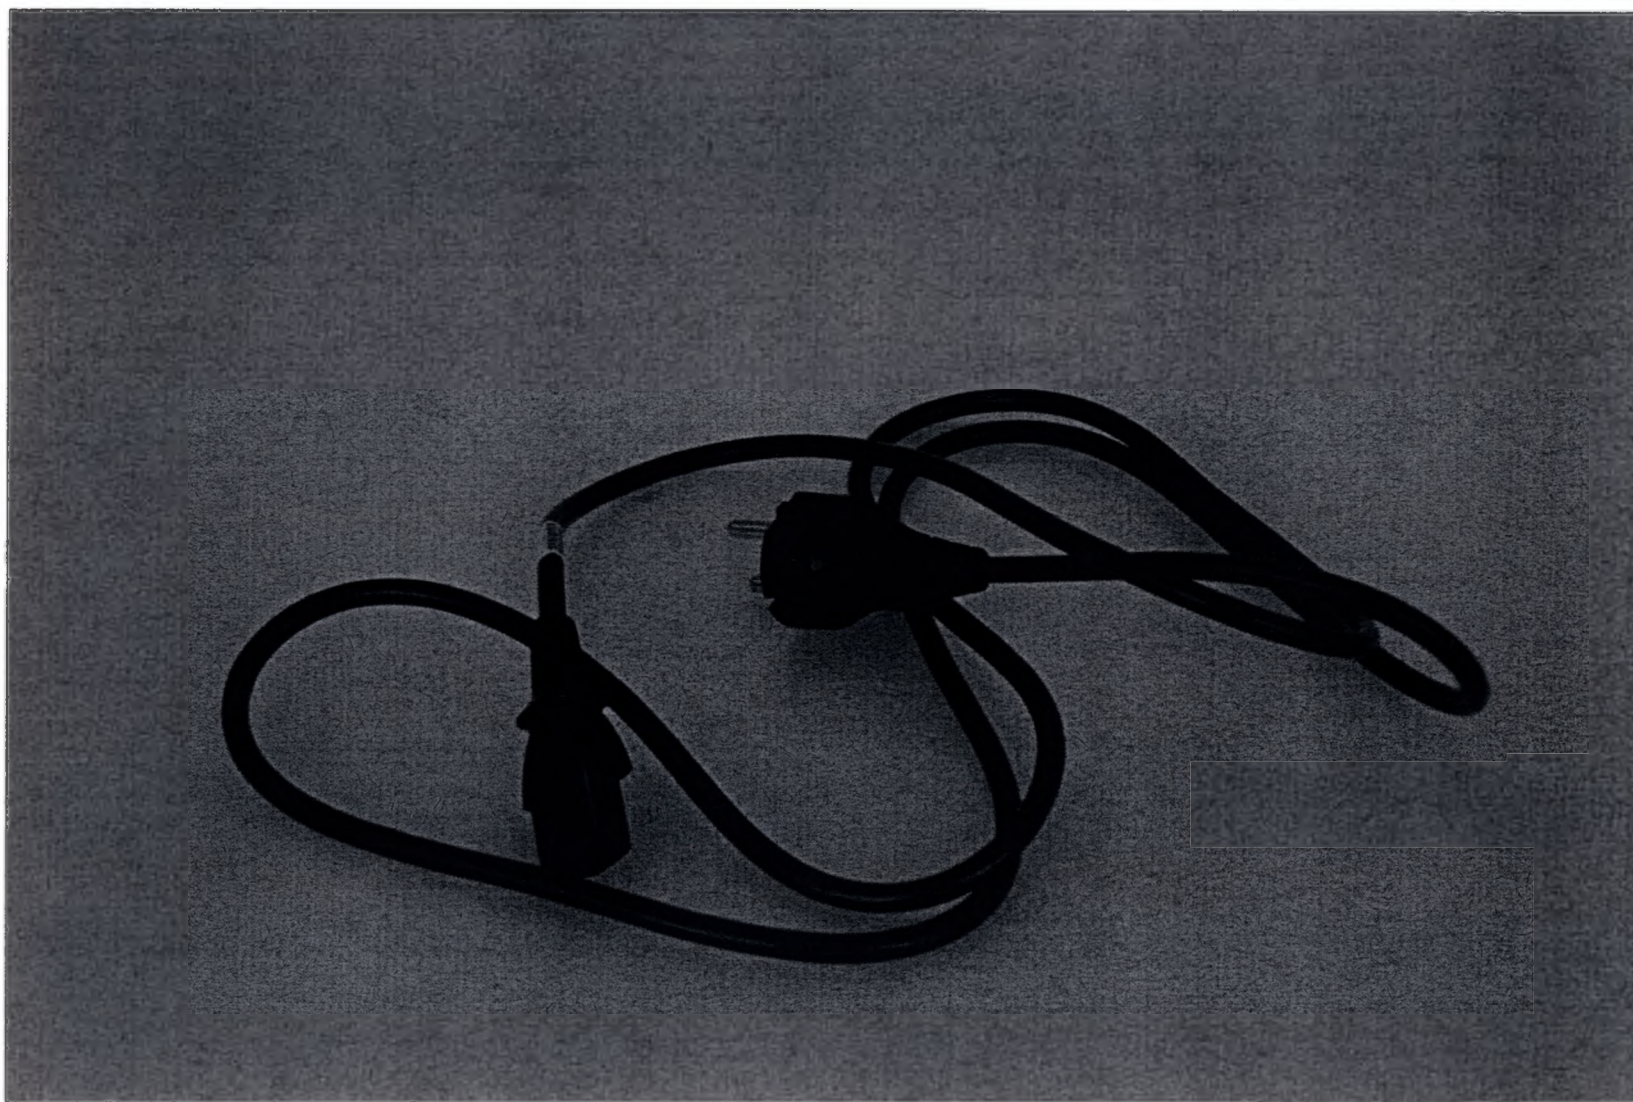


Фото 6. Кабель заземления

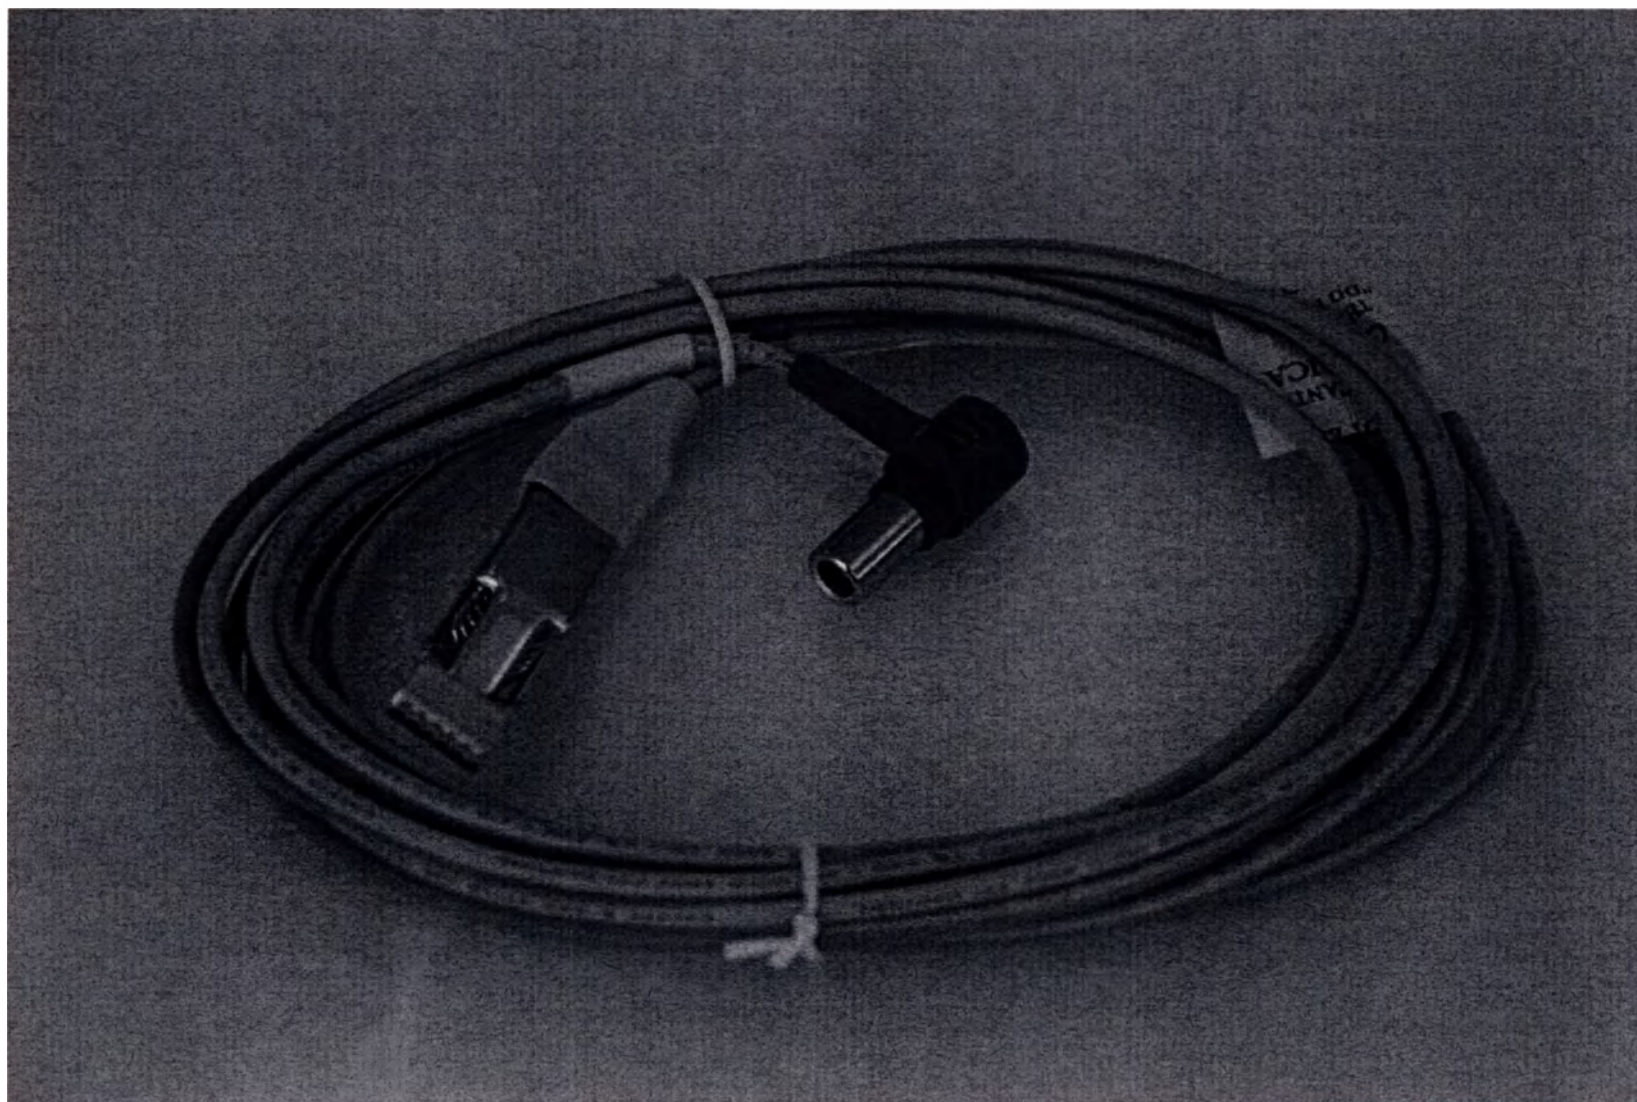


Фото 7. Проволока для очистки игл




Фото 8. Флаконы для реагентов 40 мл

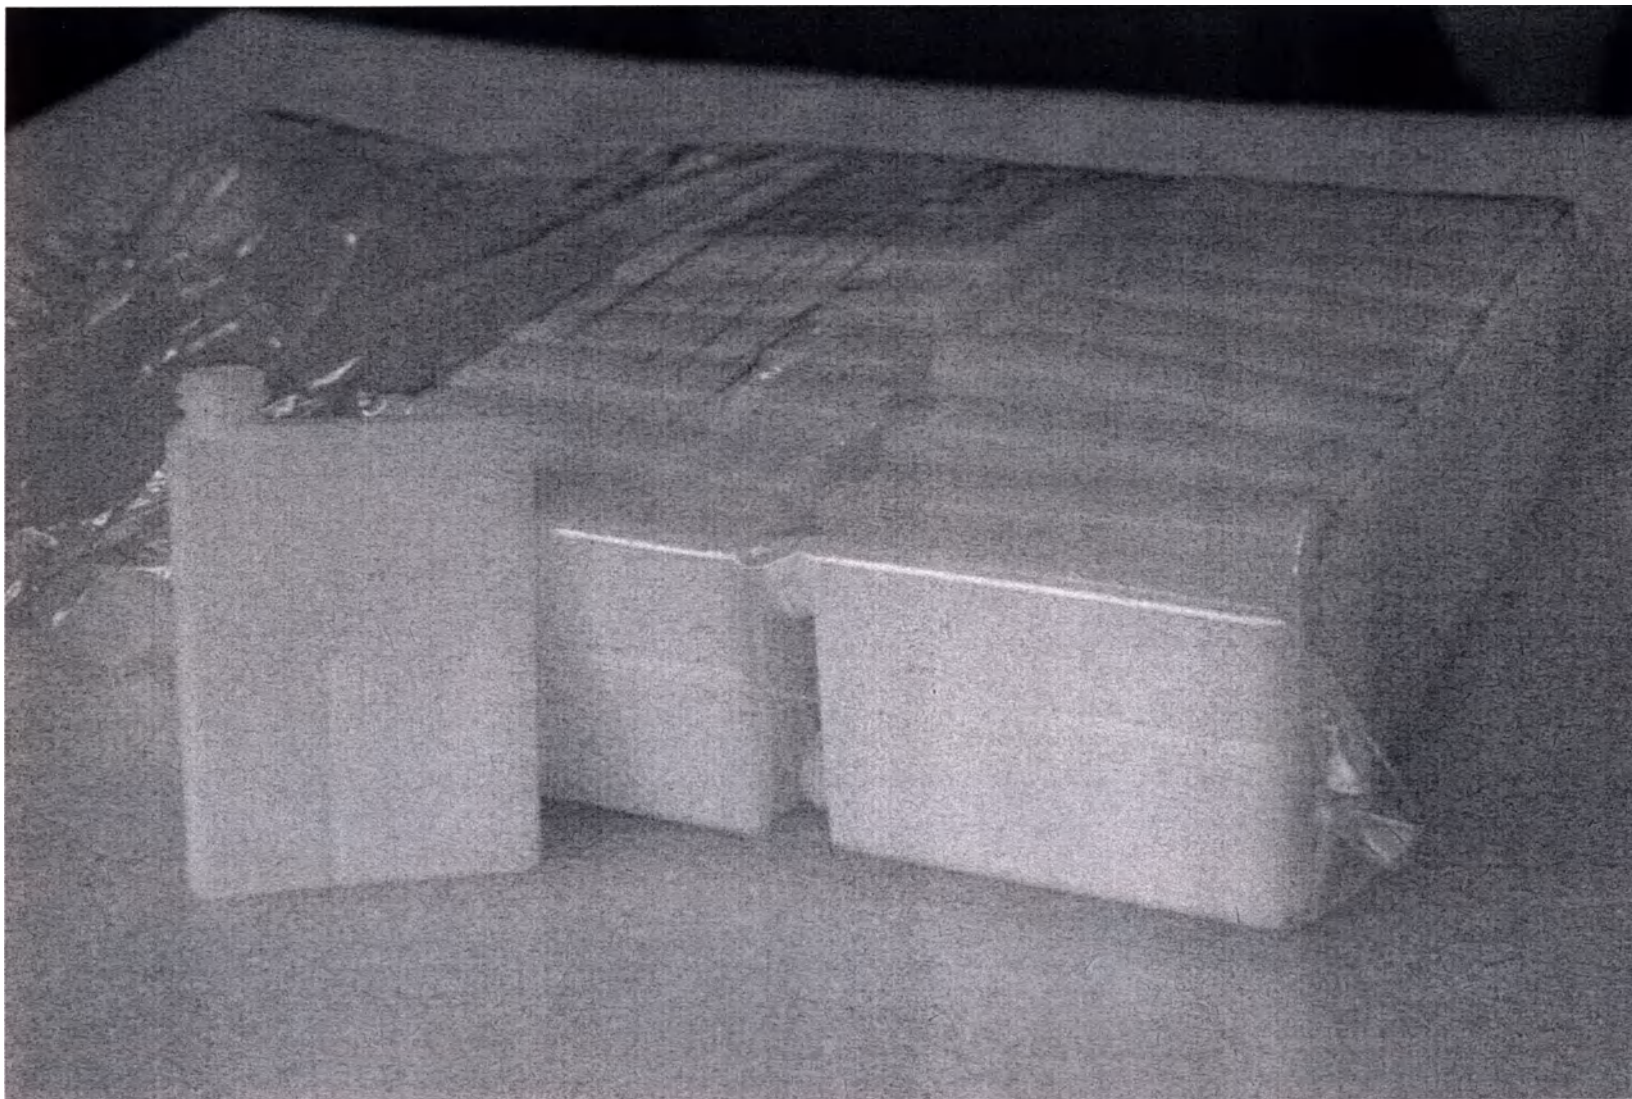


Фото 9. Флаконы для реагентов 18 мл

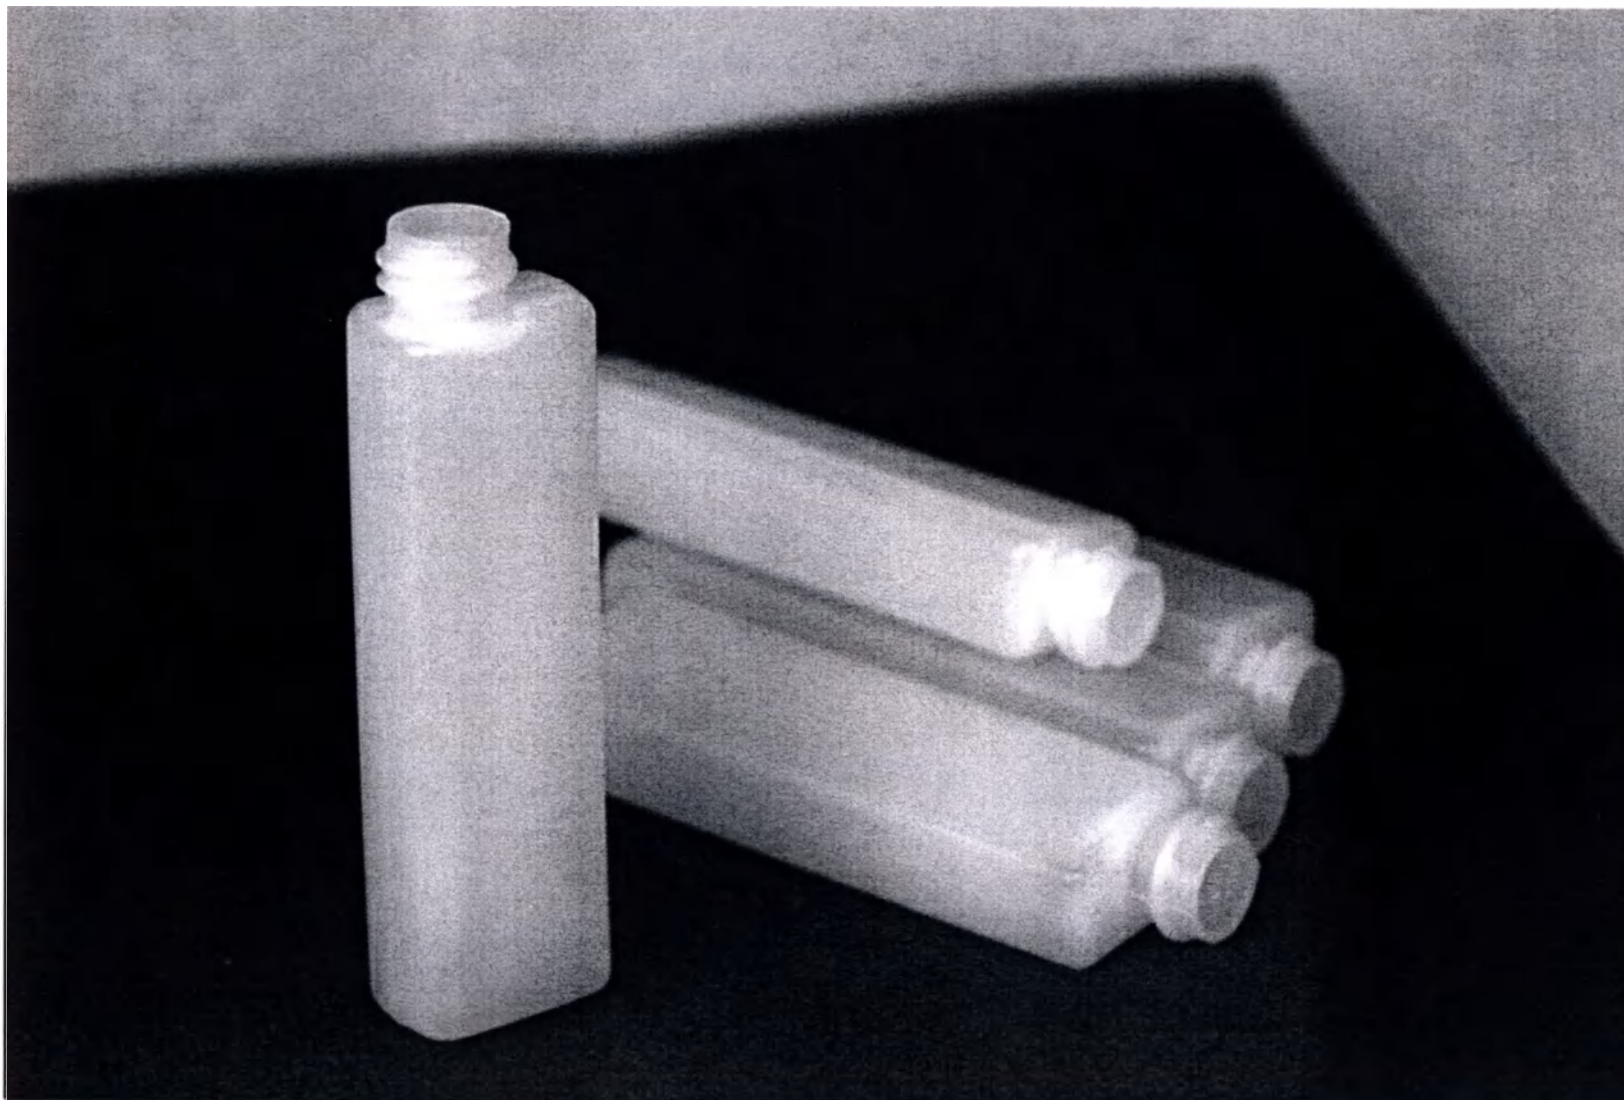


Фото 10. Крышки флаконов для реагентов



Фото 11. Кювета для анализа

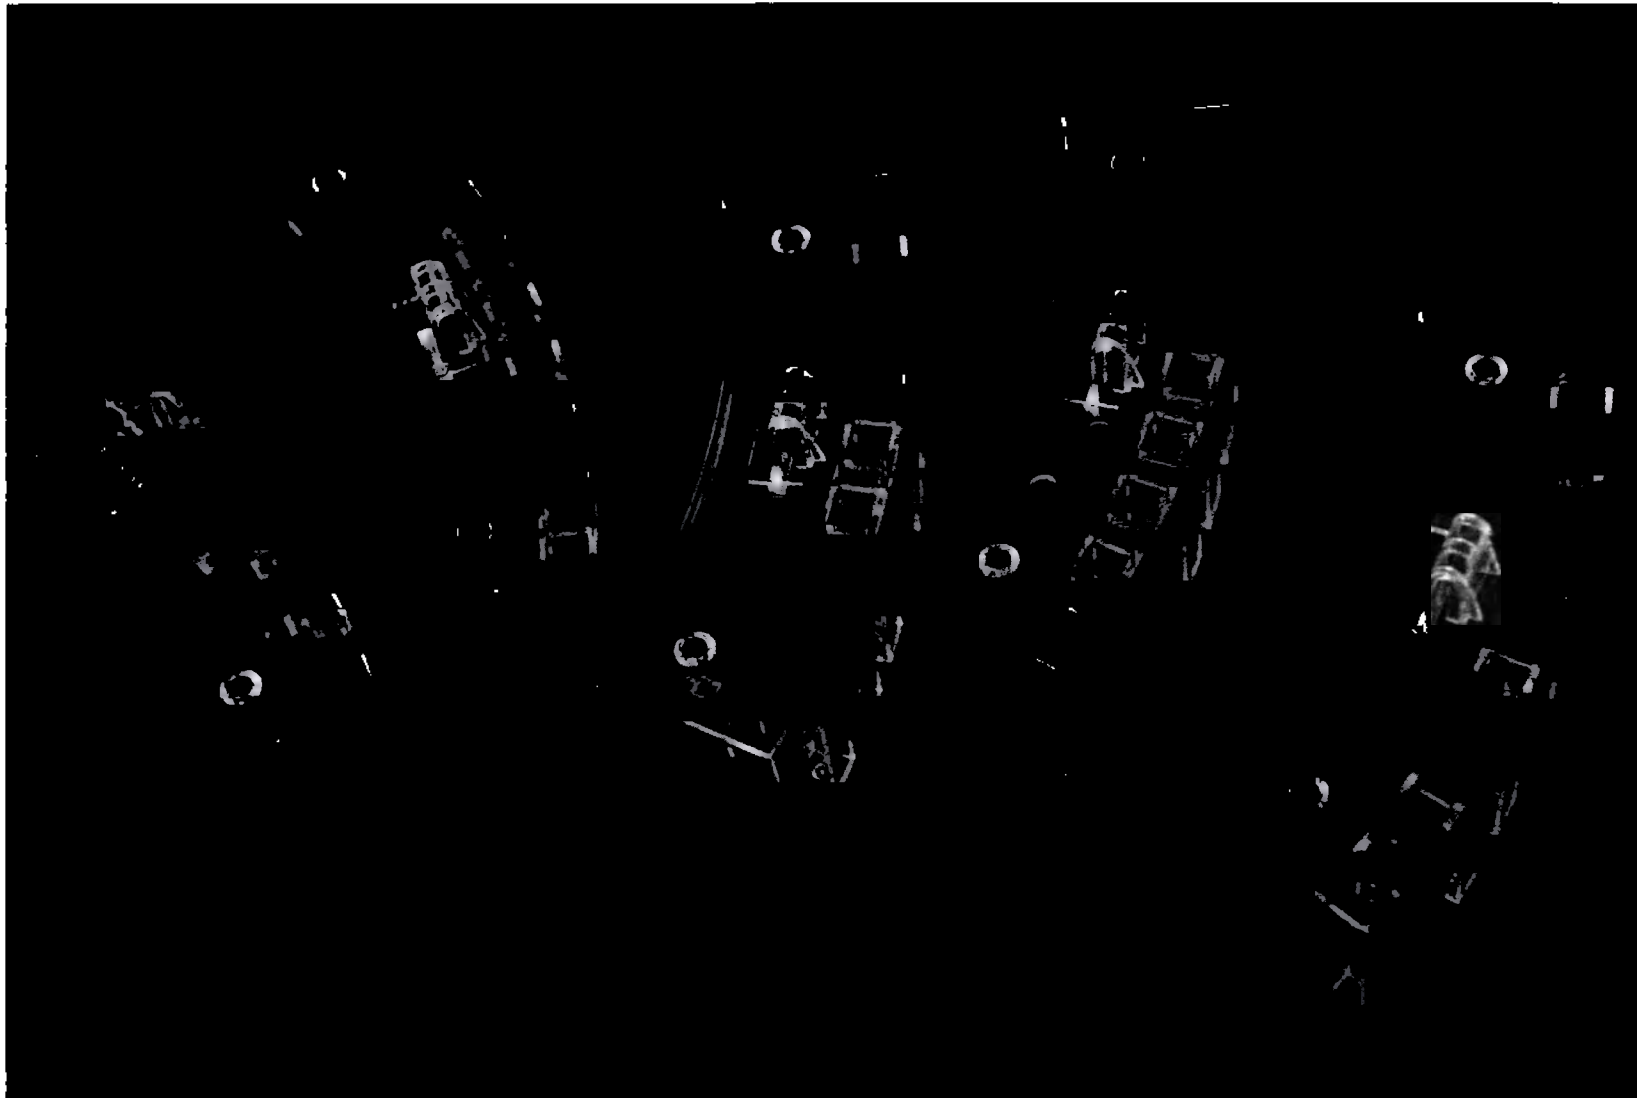


Фото 12. Пробирки для образцов



Фото 13. Переходник для АМС0407

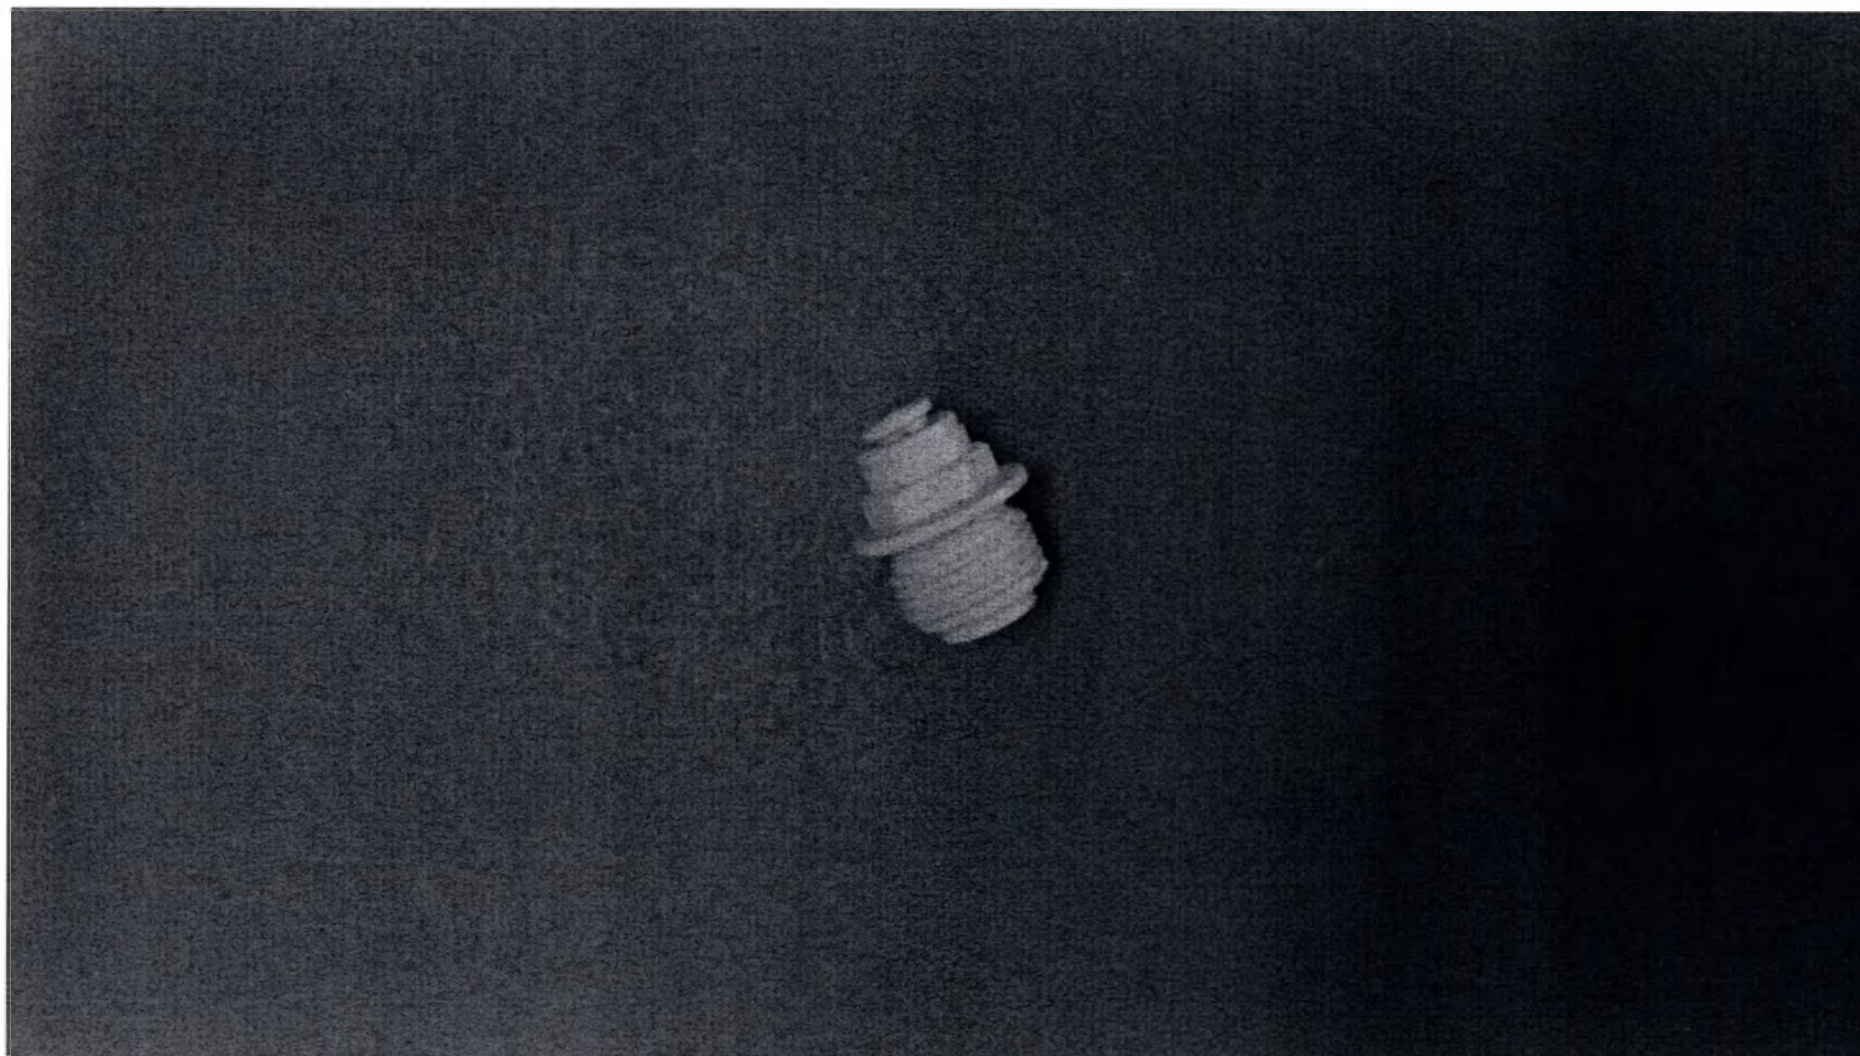


Фото 14. Ключ для корпуса фильтров

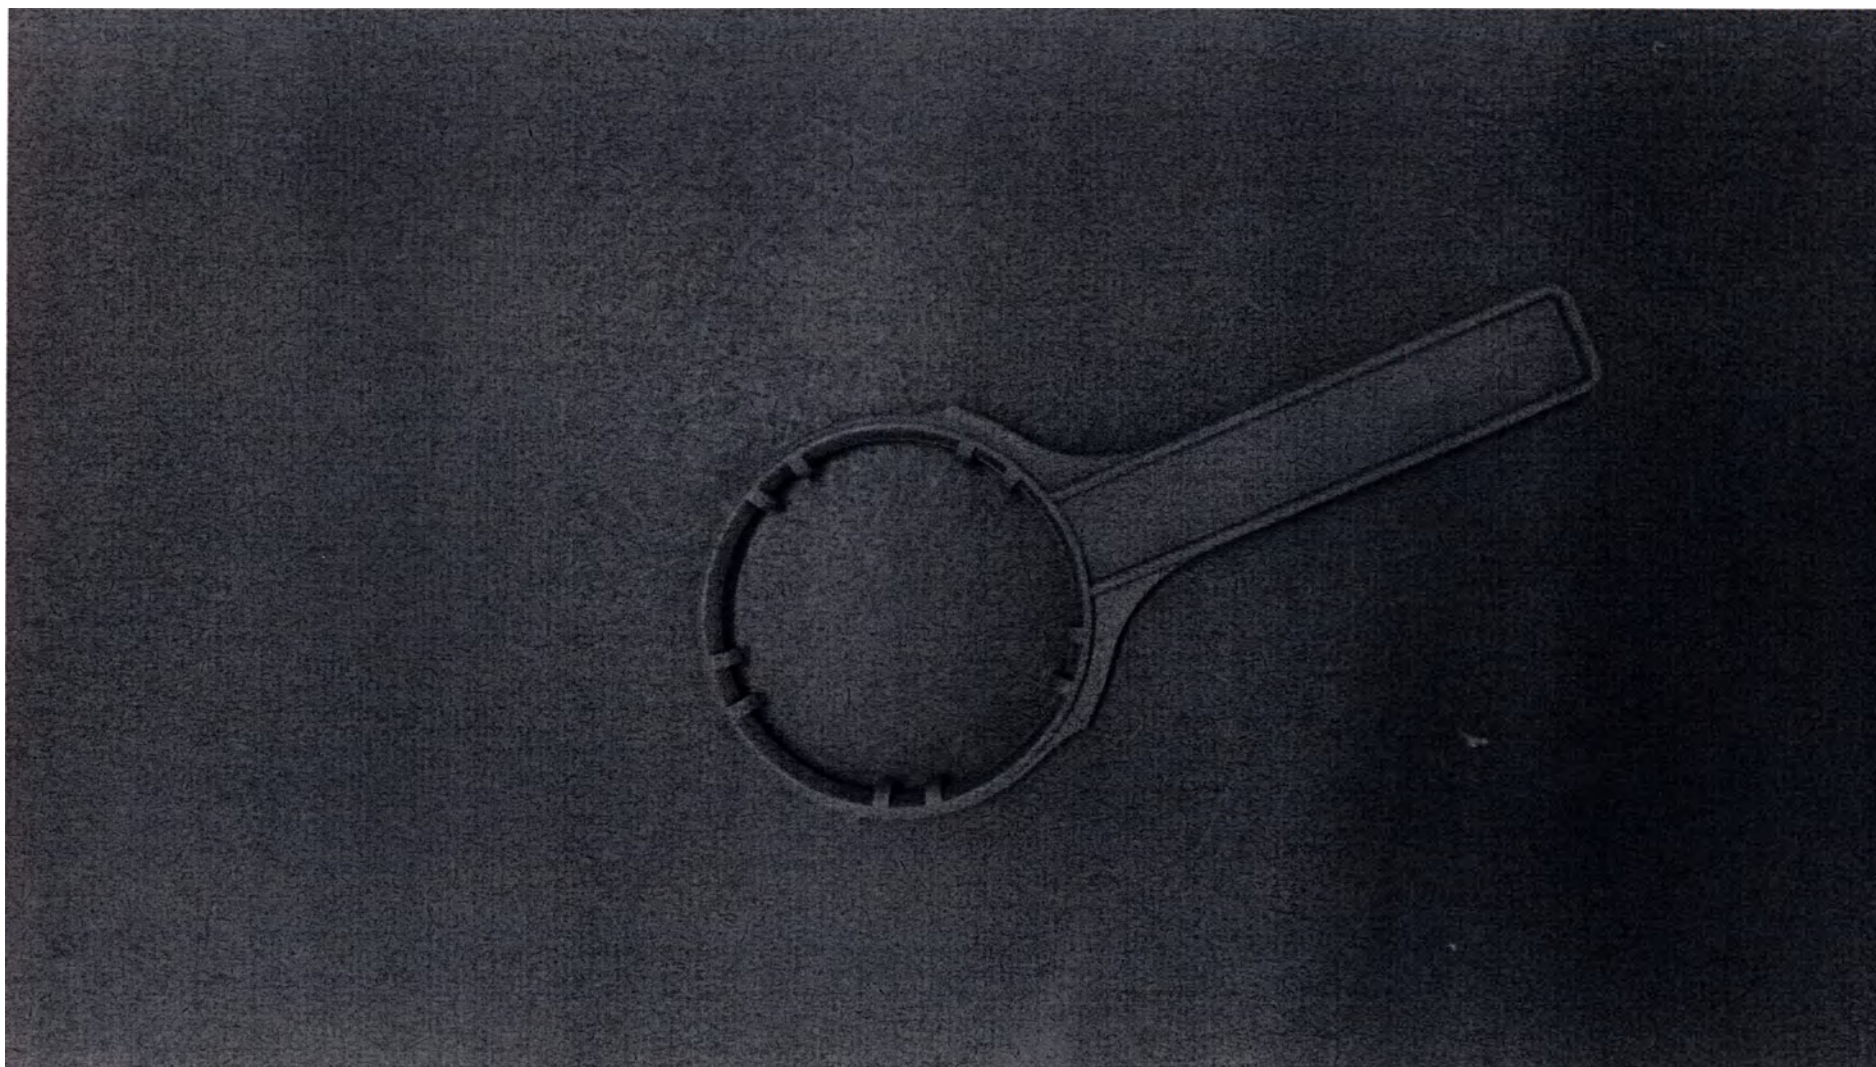


Фото 15. Канистра для моющего раствора с крышкой

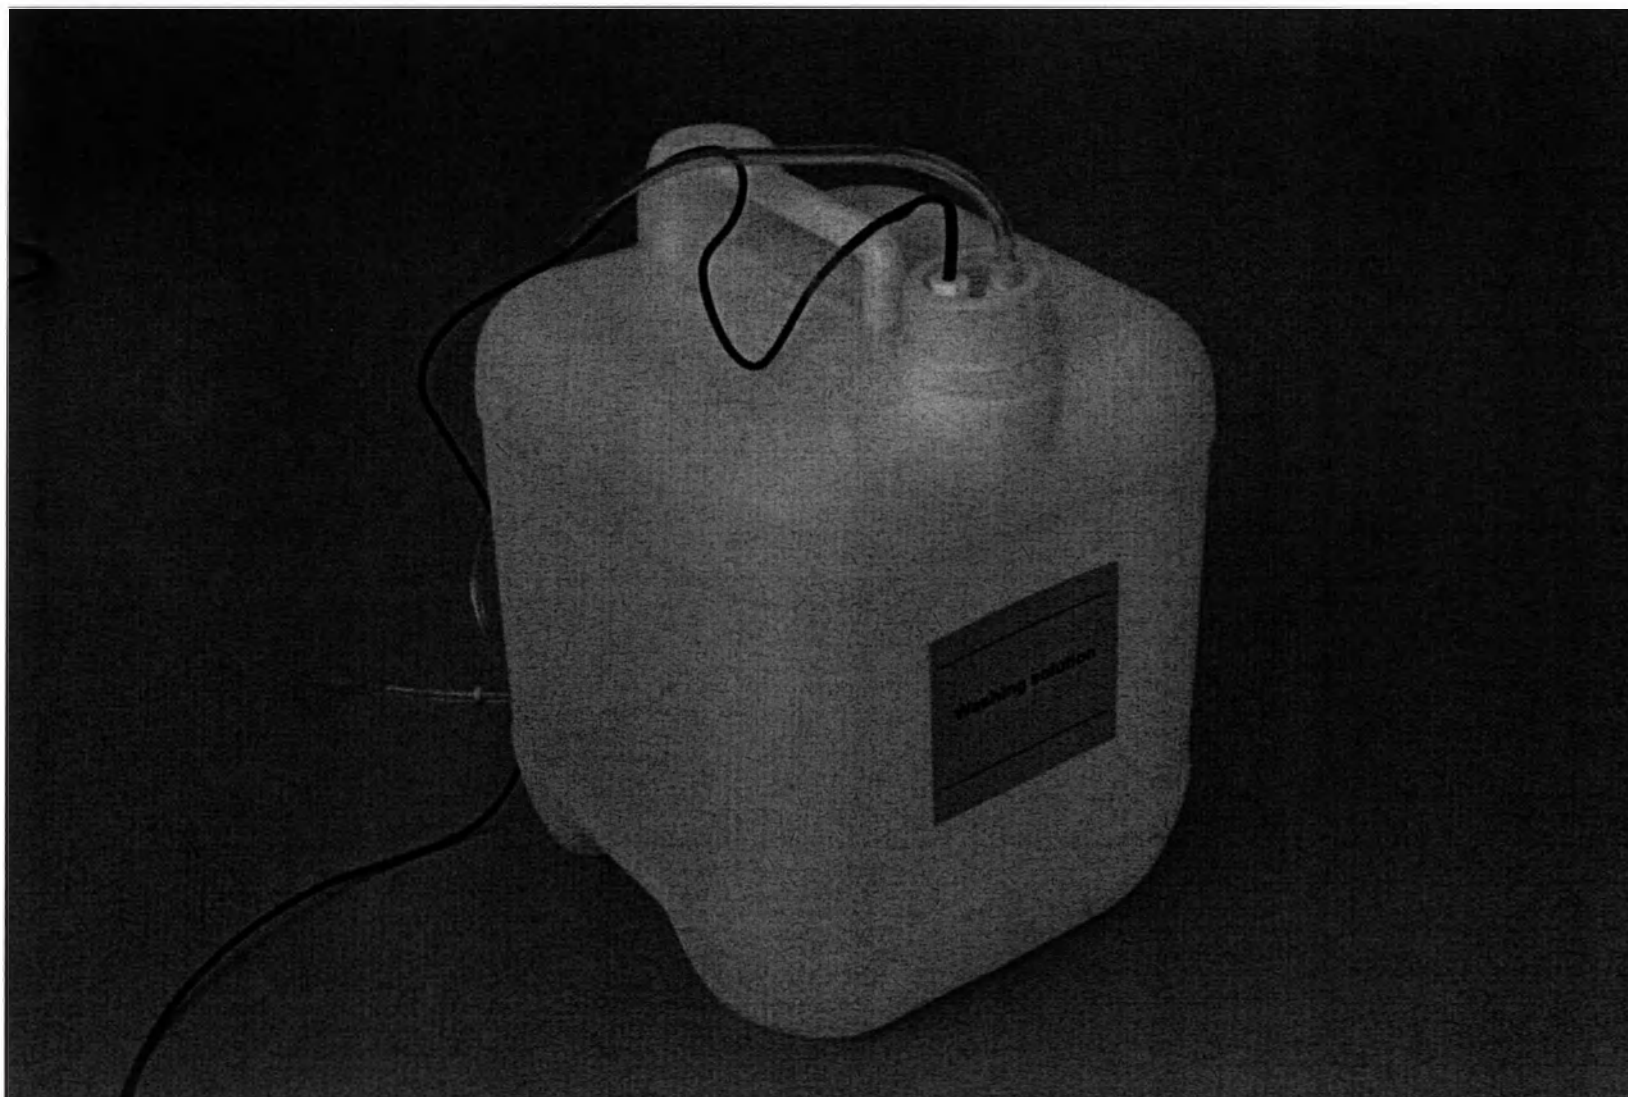


Фото 16. Канистра для деионизированной воды с крышкой

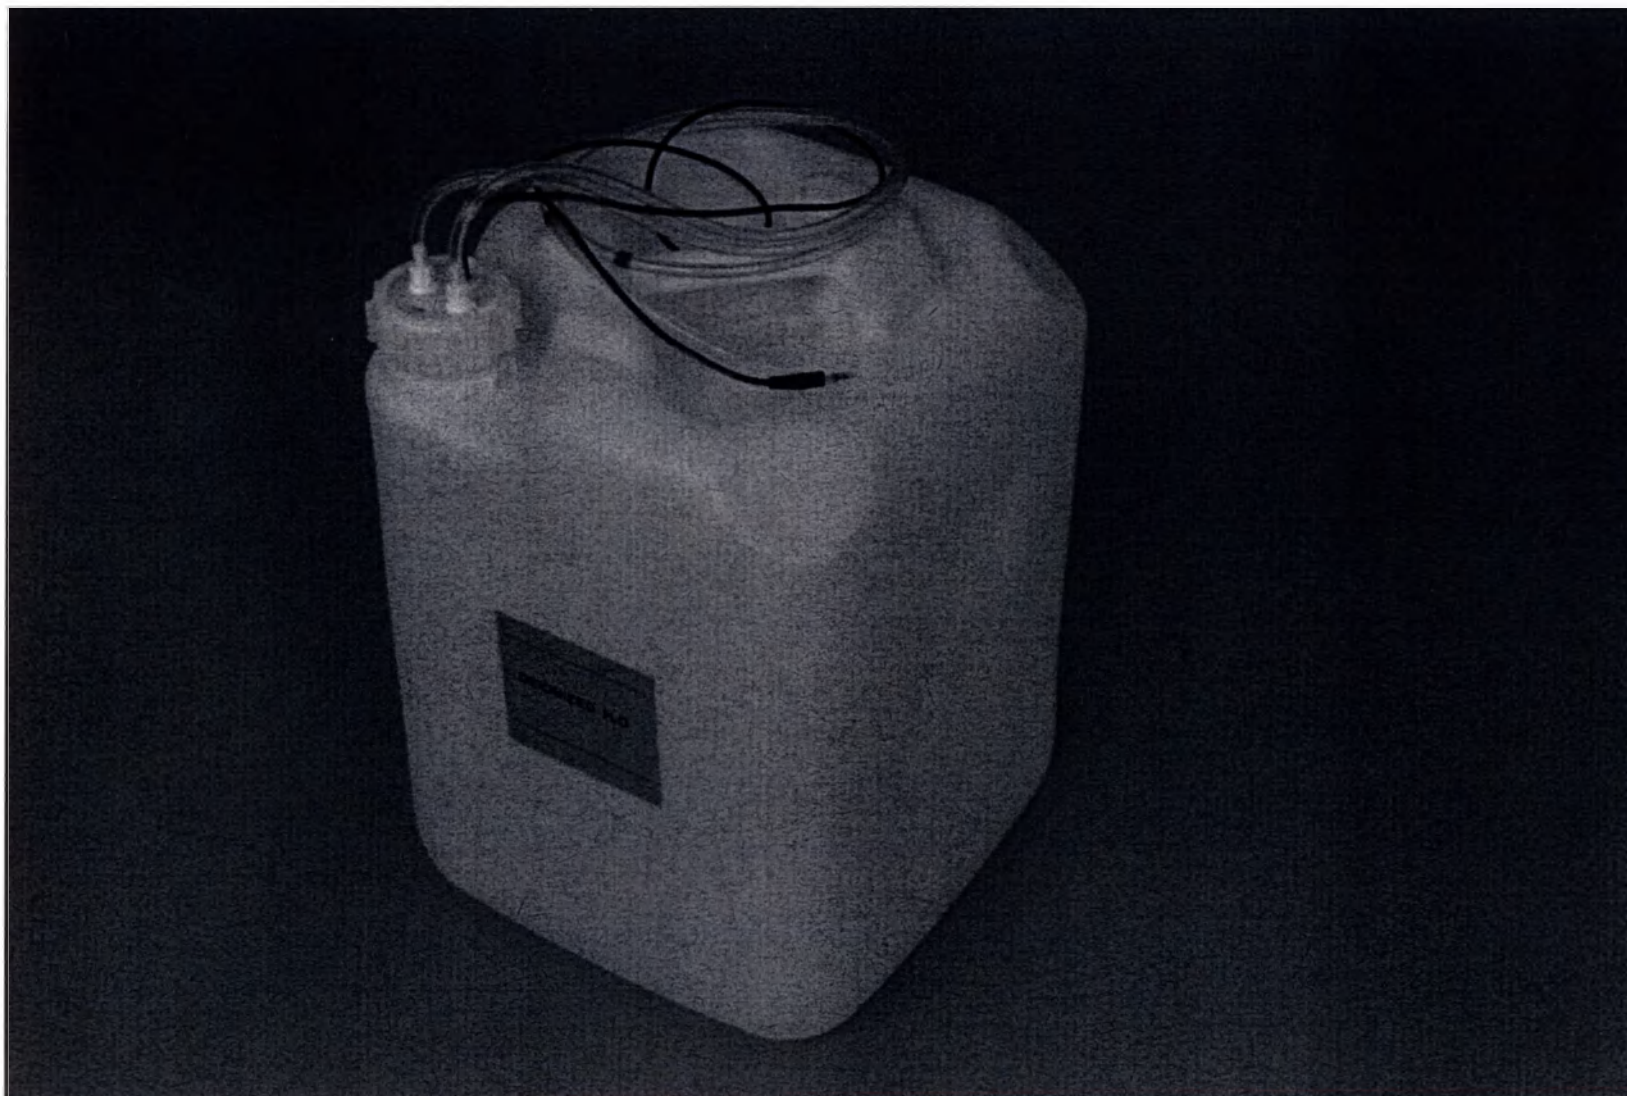


Фото 18. Чехол для защиты от пыли

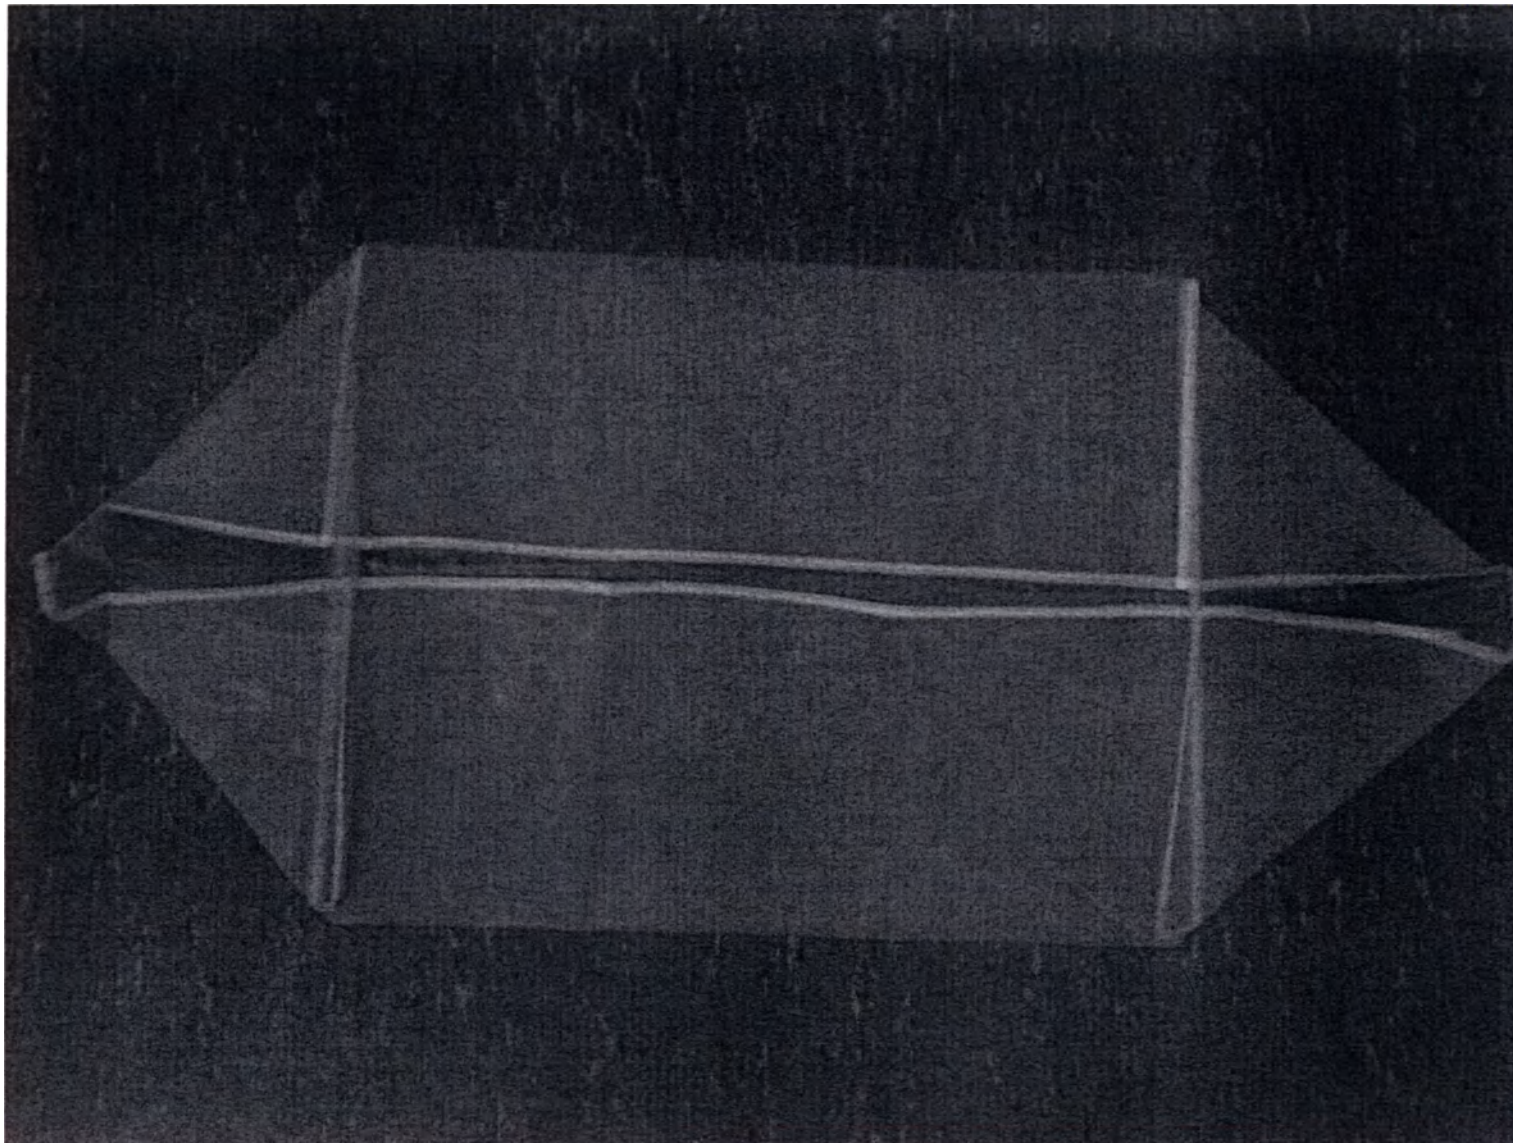


Фото 19. Манипулятор типа «мышь»

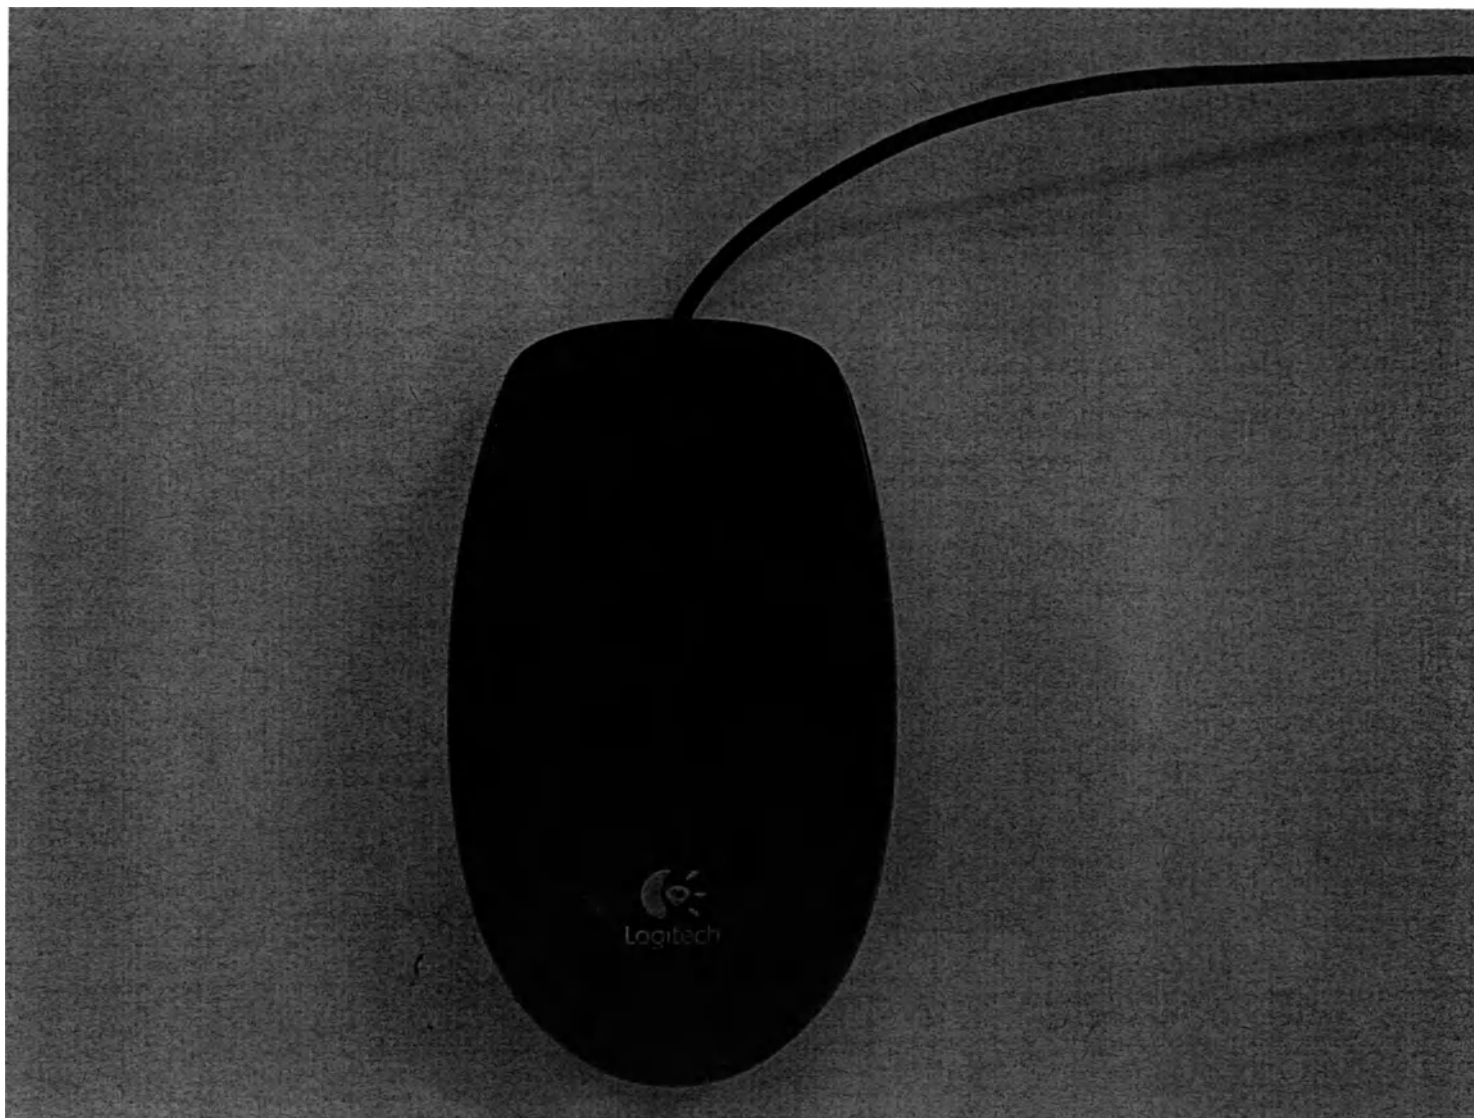


Фото 20. Клавиатура


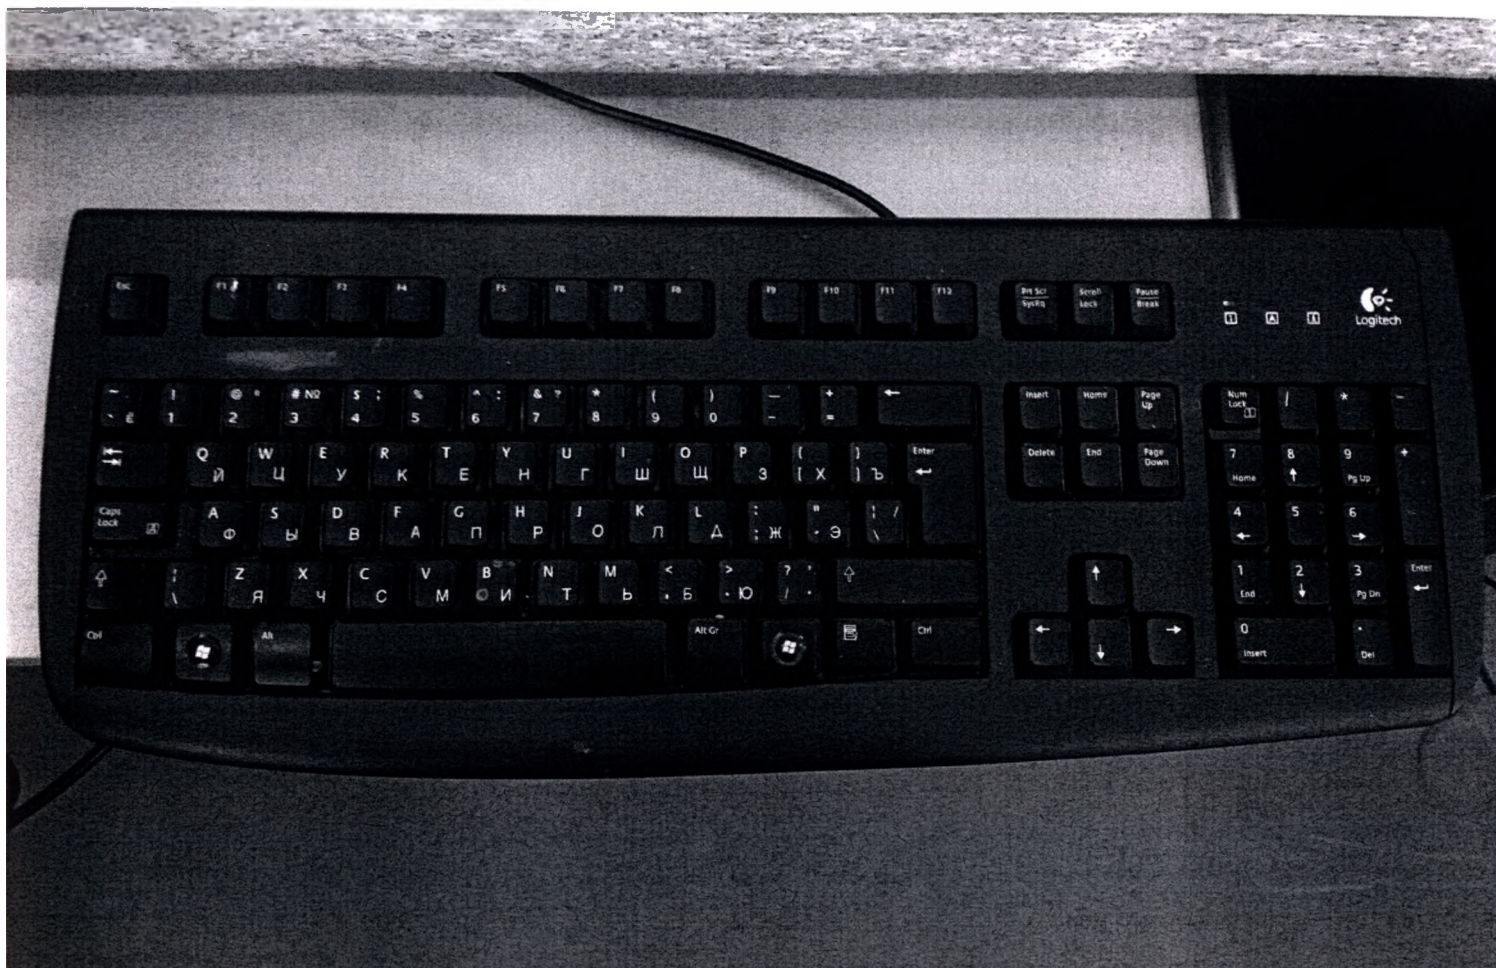


Фото 21. Монитор



Фото 22. Маркировка прибора

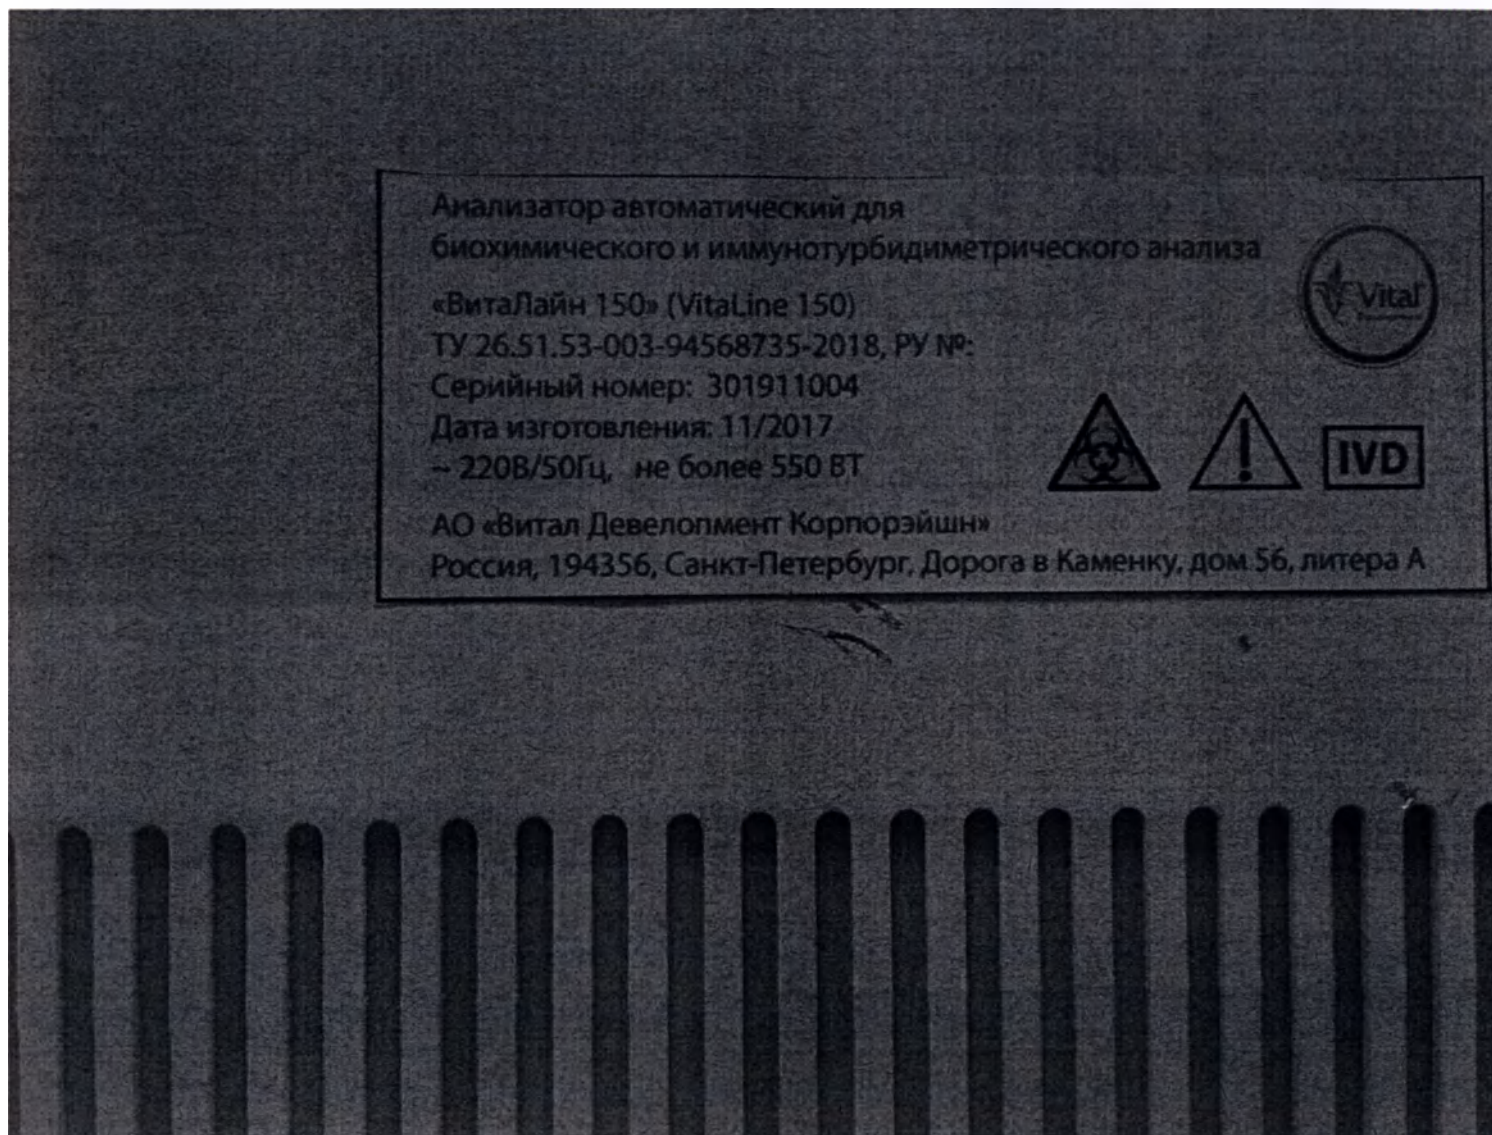

прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 23 листа(ов)



Ген. директор

Схолль-Энгбертс Е.Г

[Handwritten signature]