

Уоткарное дело
N 2298 от 11.10.2017г


Фотографическое изображение

Диагностическая ультразвуковая система HS50-RUS/
Диагностическая ультразвуковая система HS60-RUS


I.Диагностическая ультразвуковая система HS30-RUS




Сетевой кабель

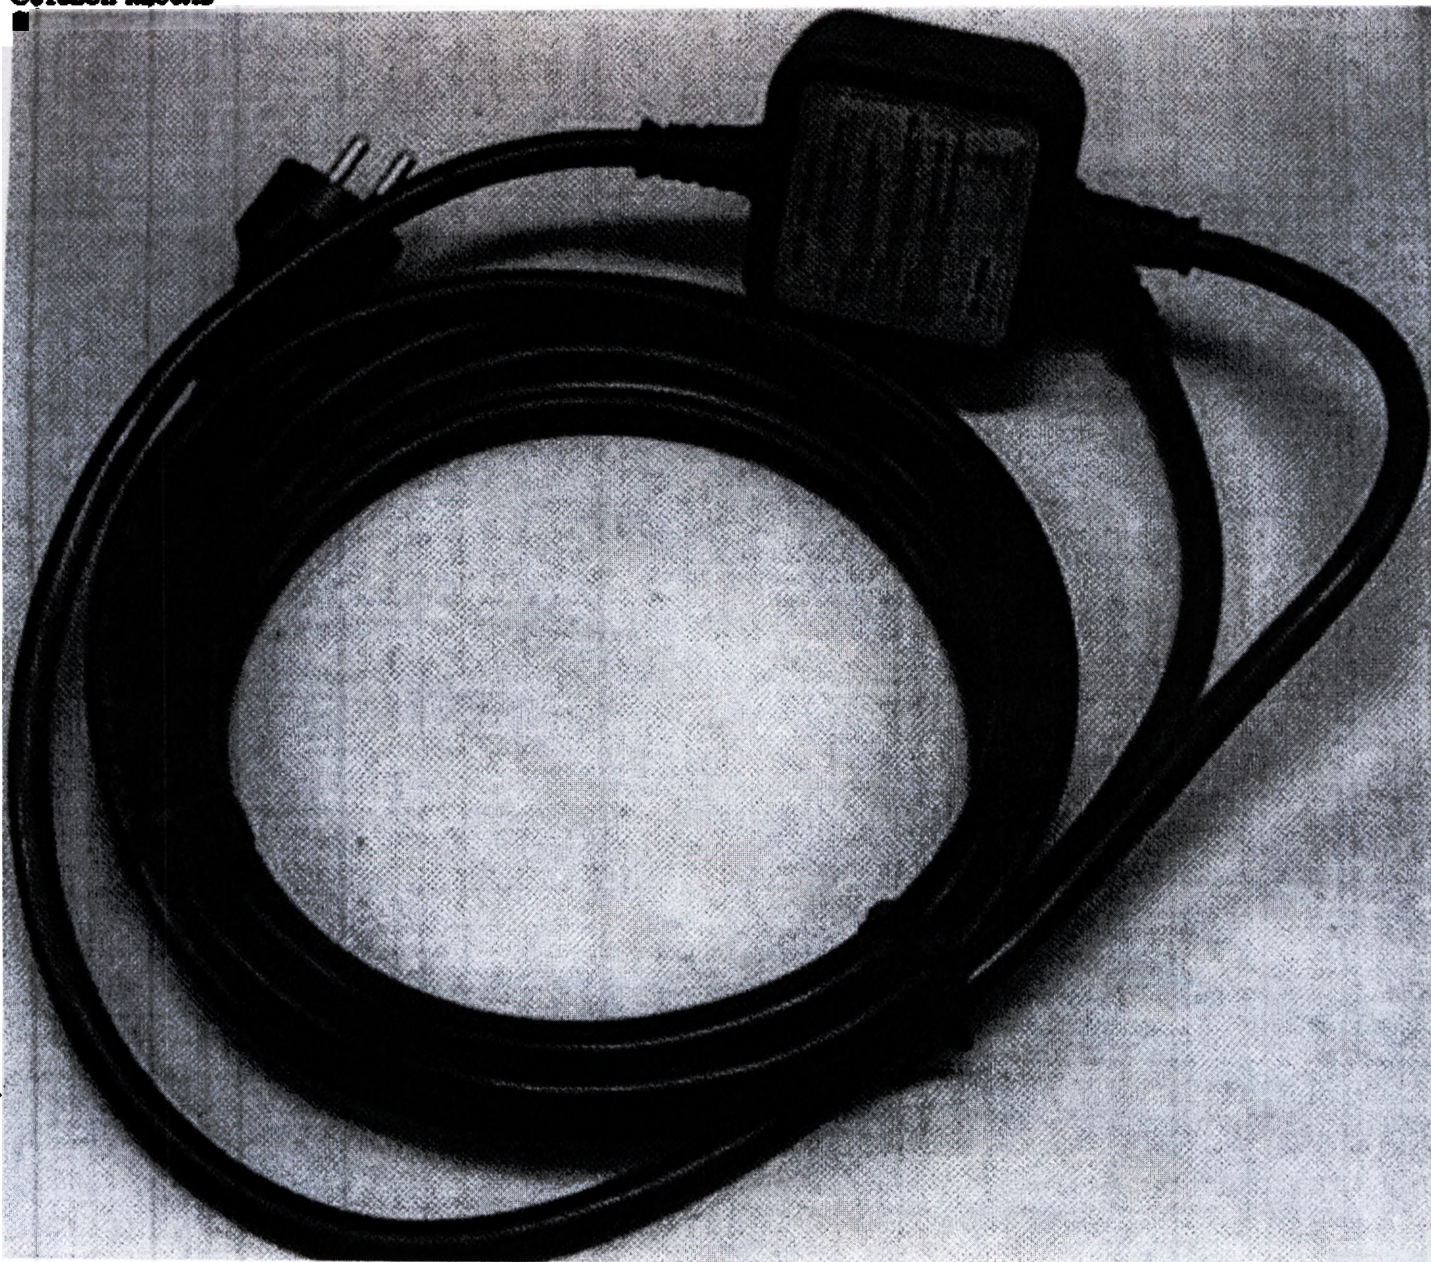


Линейный датчик: LA3-14AD,

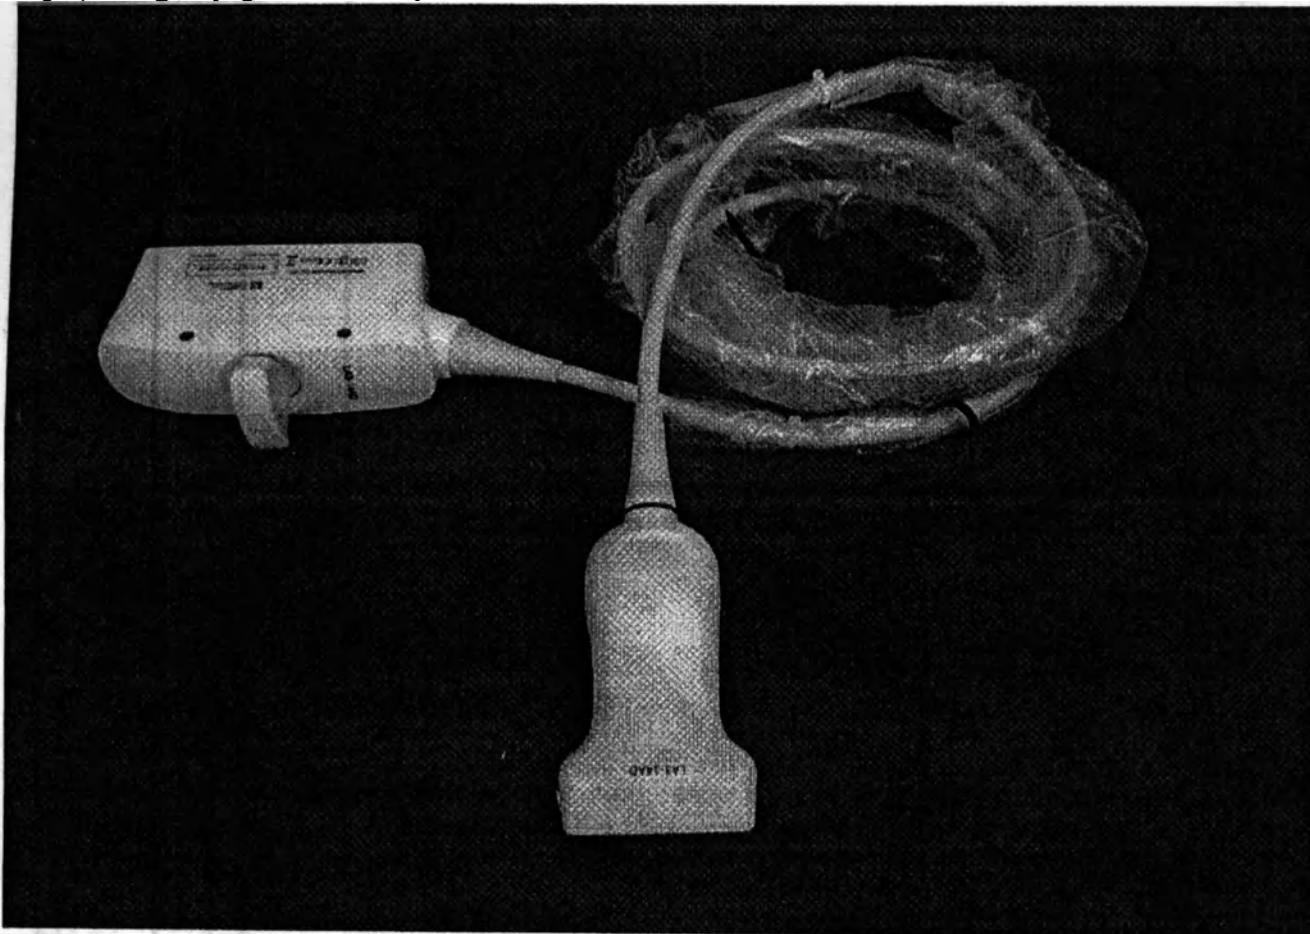


LA3-16A,

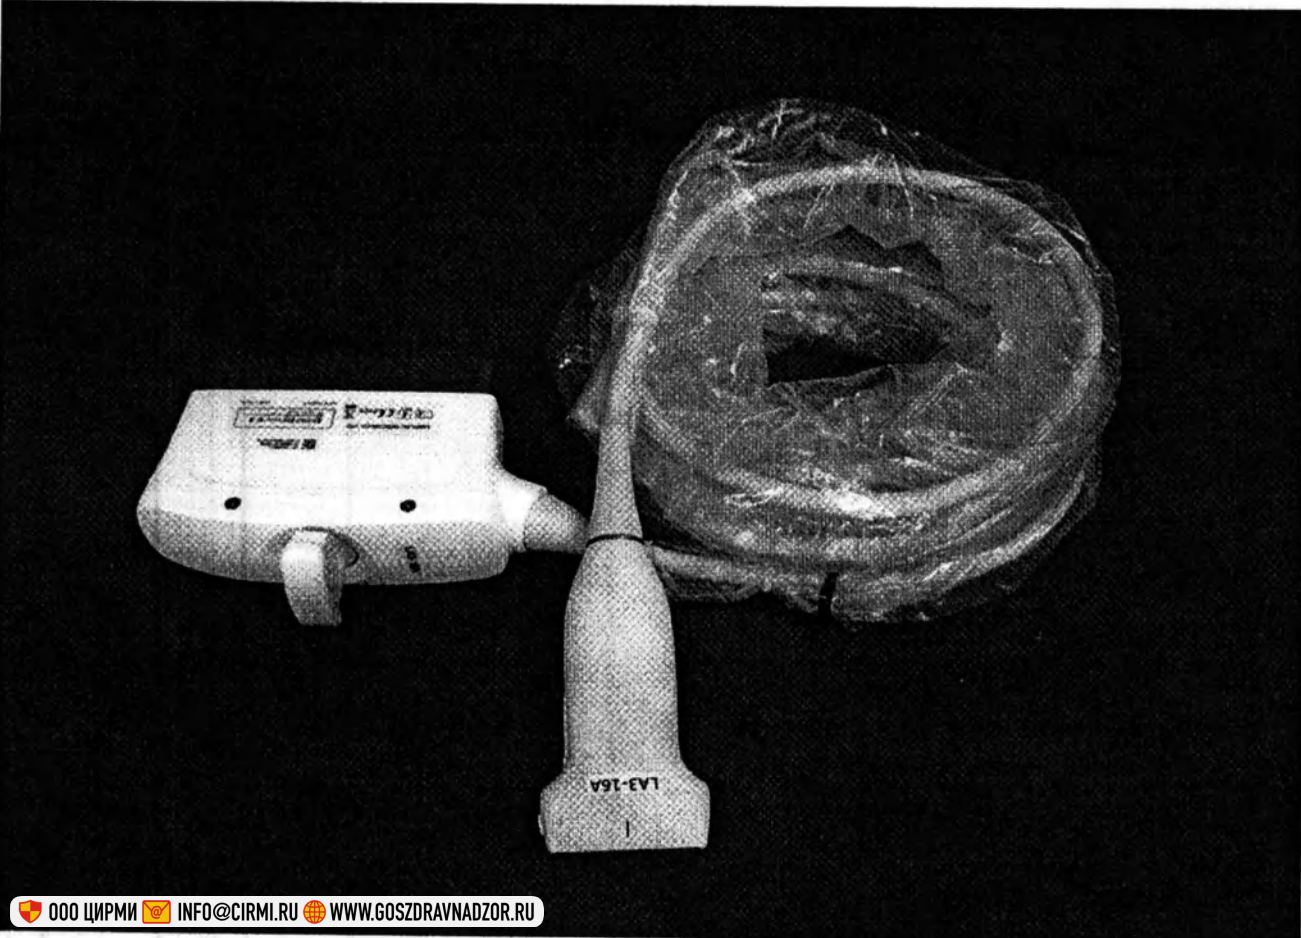


LA3-16AI

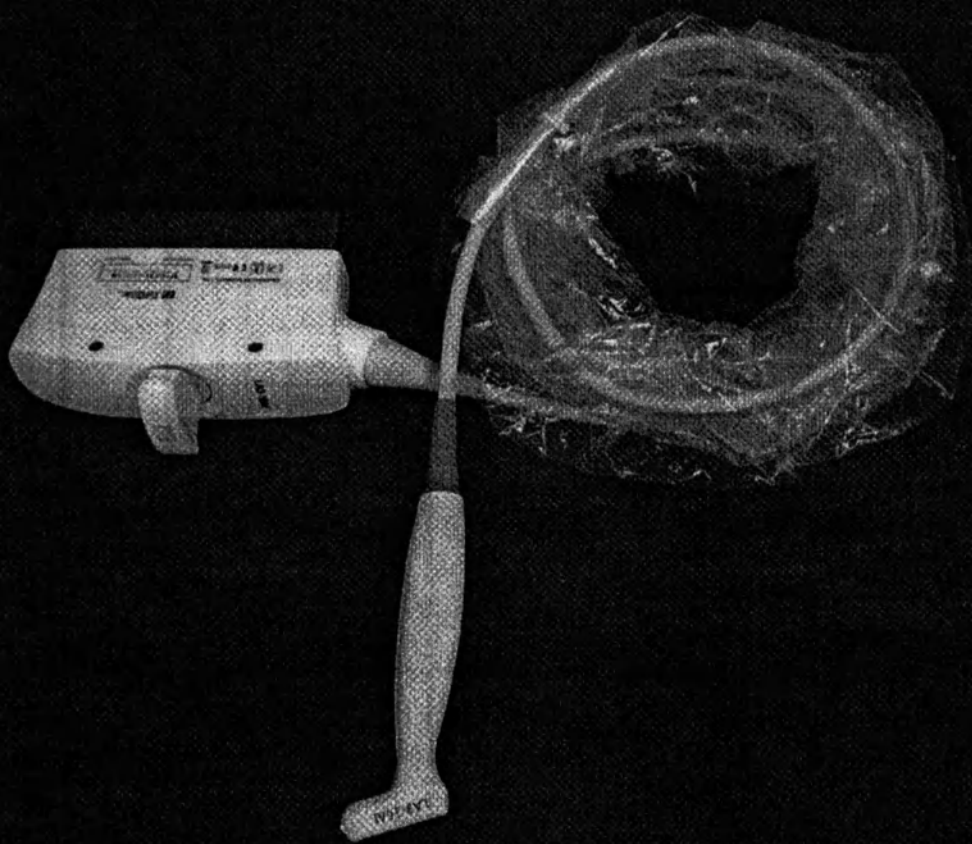


LM4-15BD

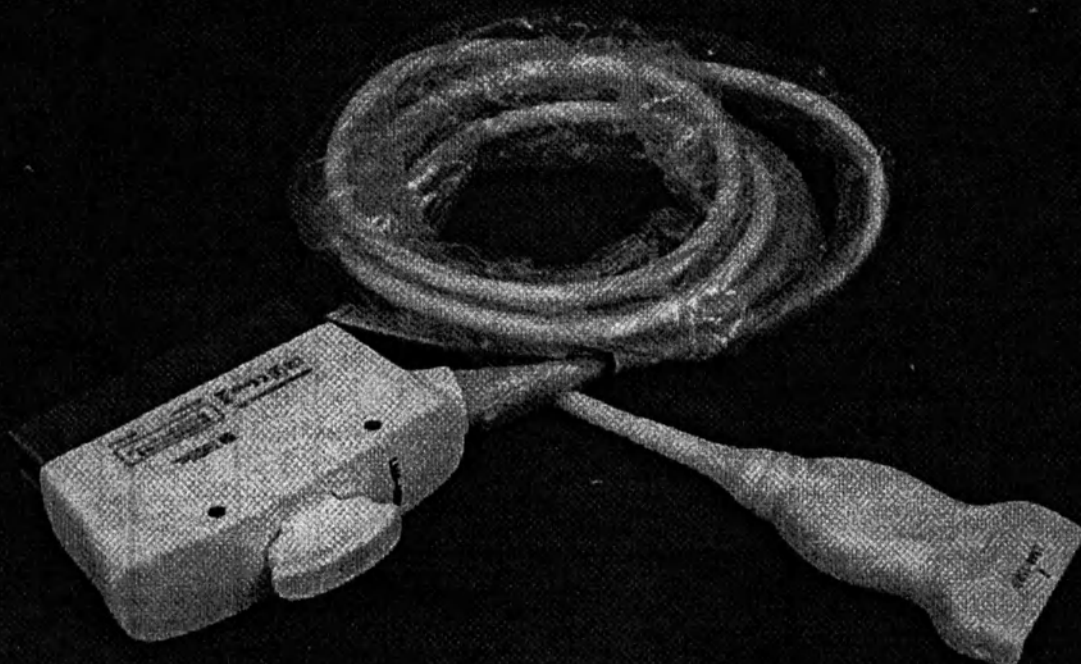


LA2-9A (только для HS60-RUS)

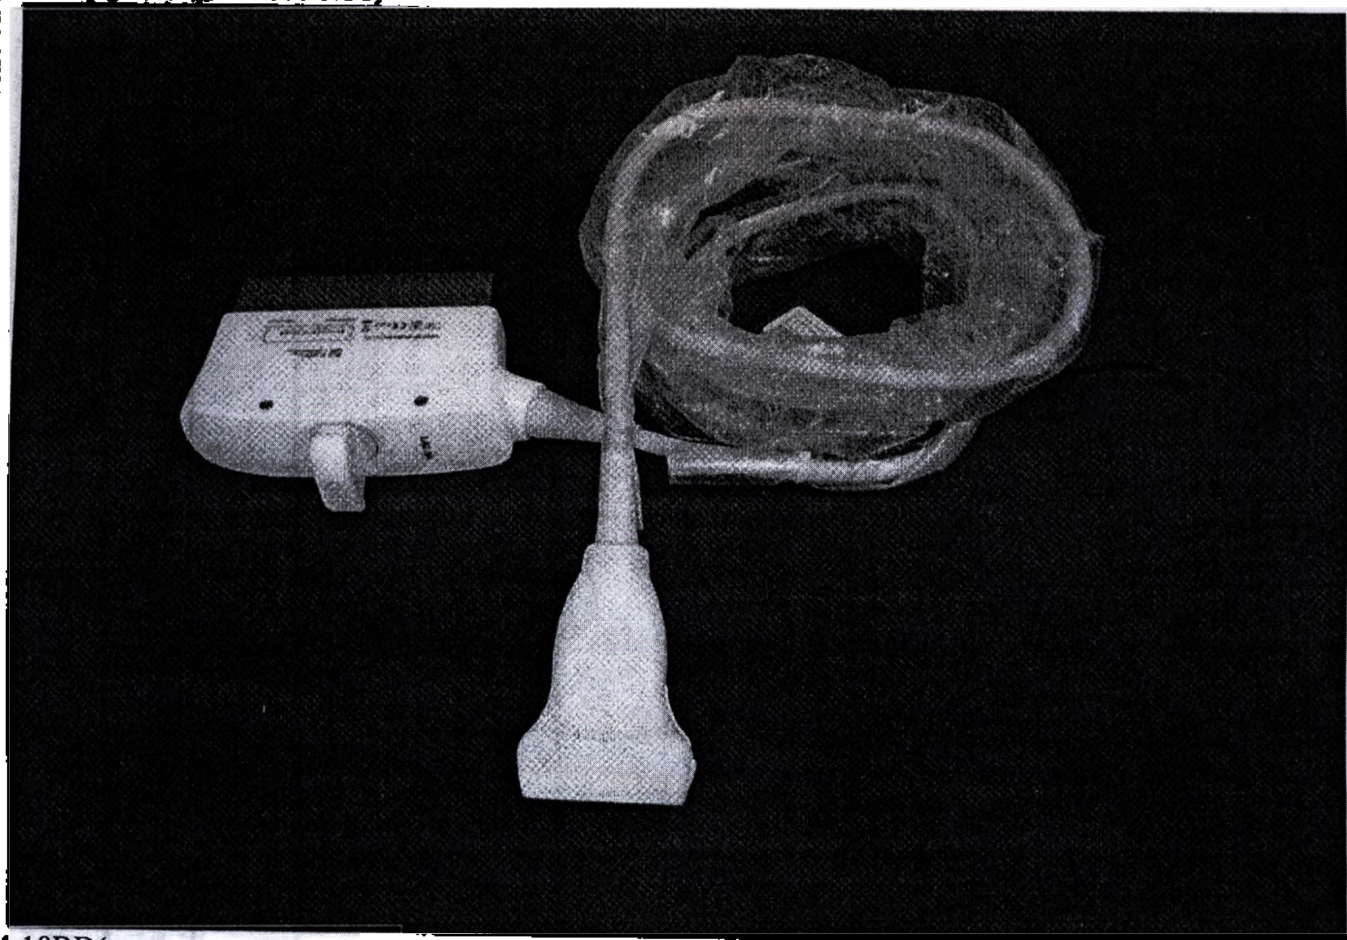


LA4-18BD (только для HS60-RUS)

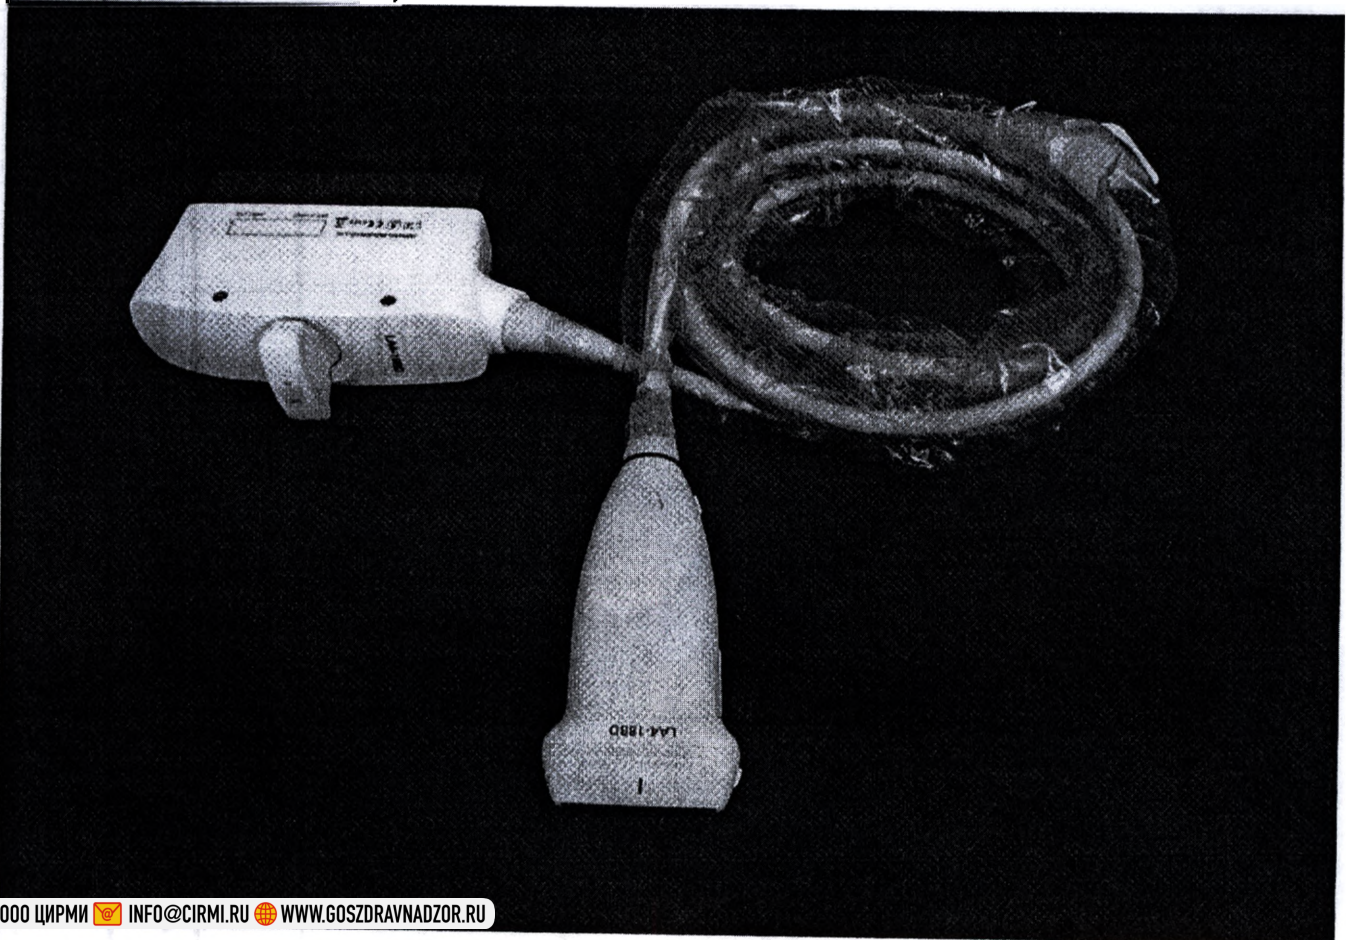


Конвексный датчик: CA1-7AD

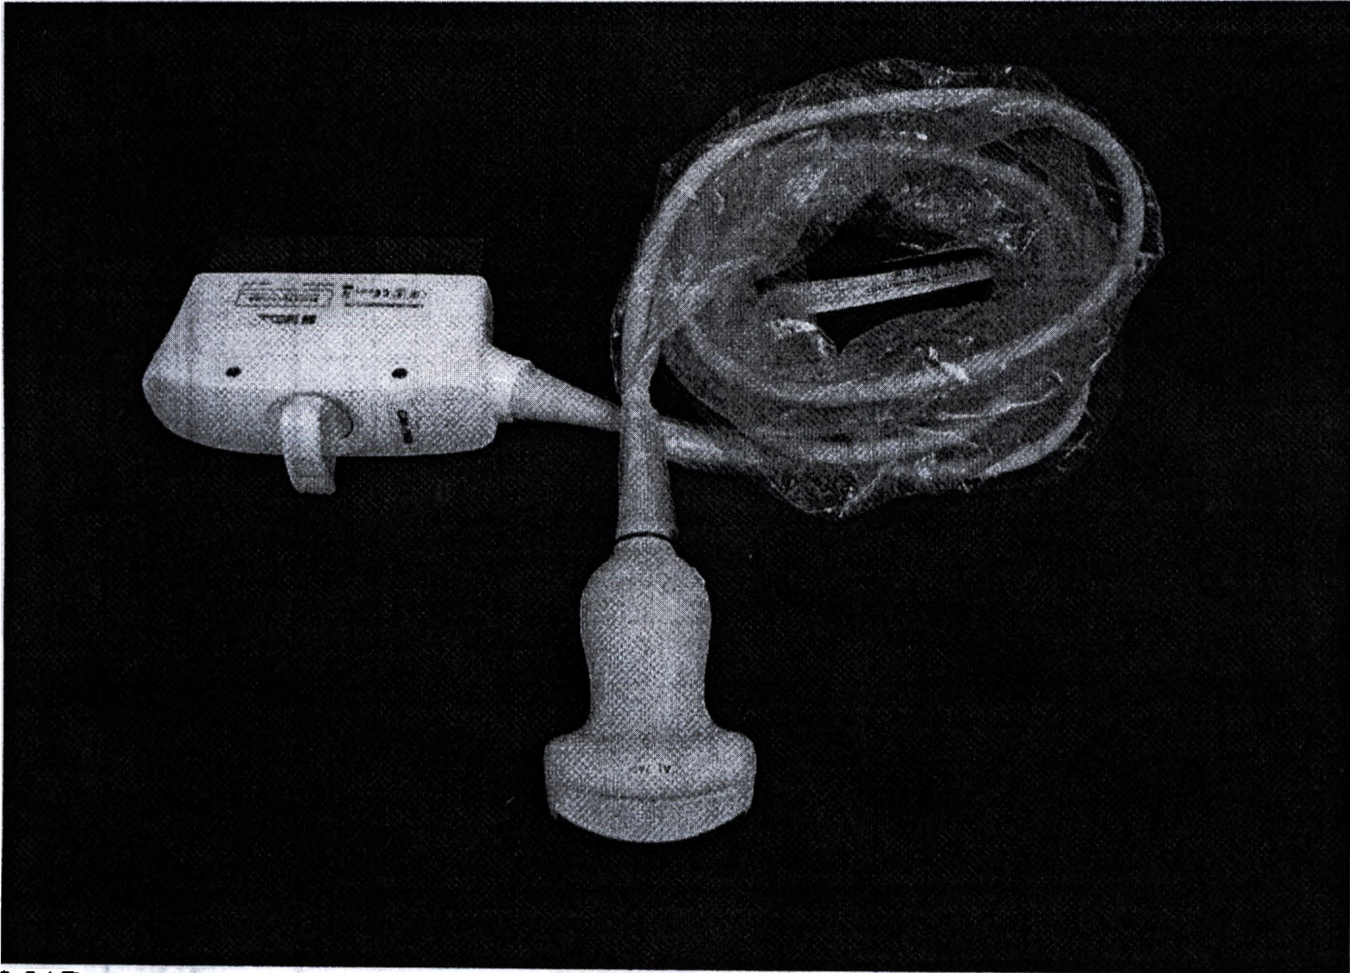


CA2-9AD

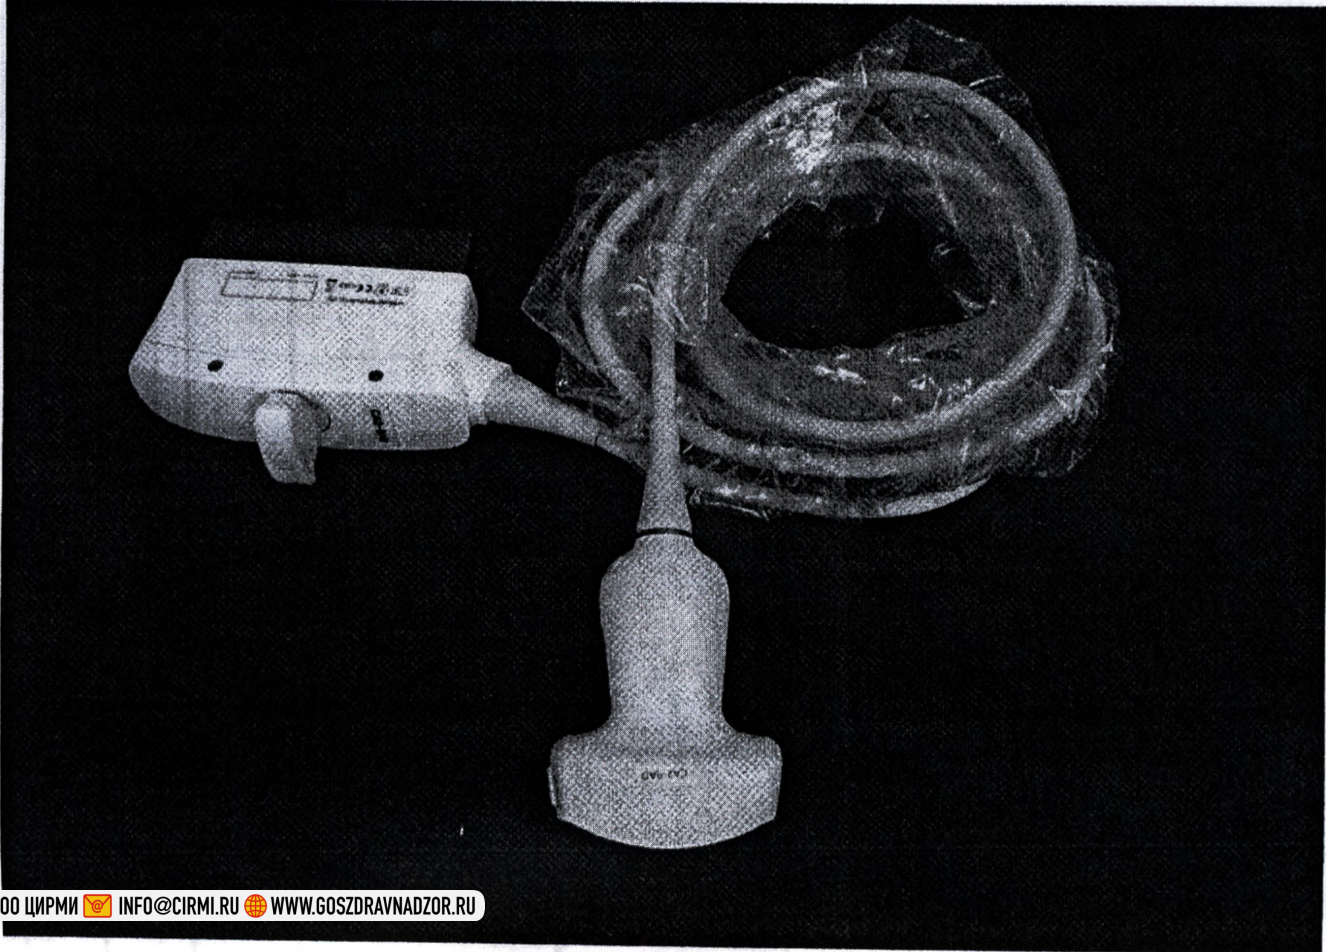


CA3-10A

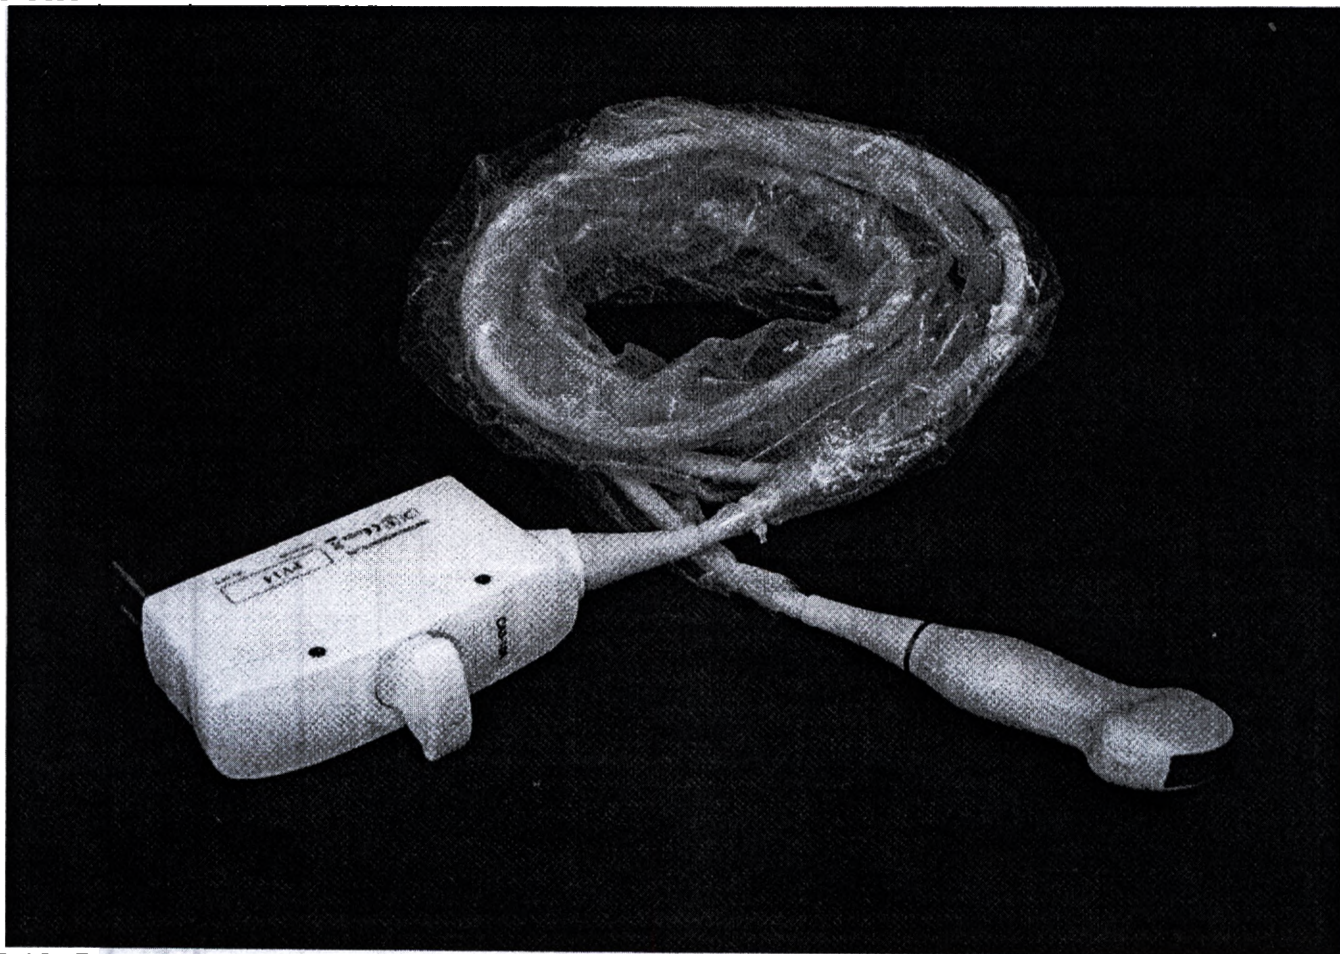


CA3-10AD

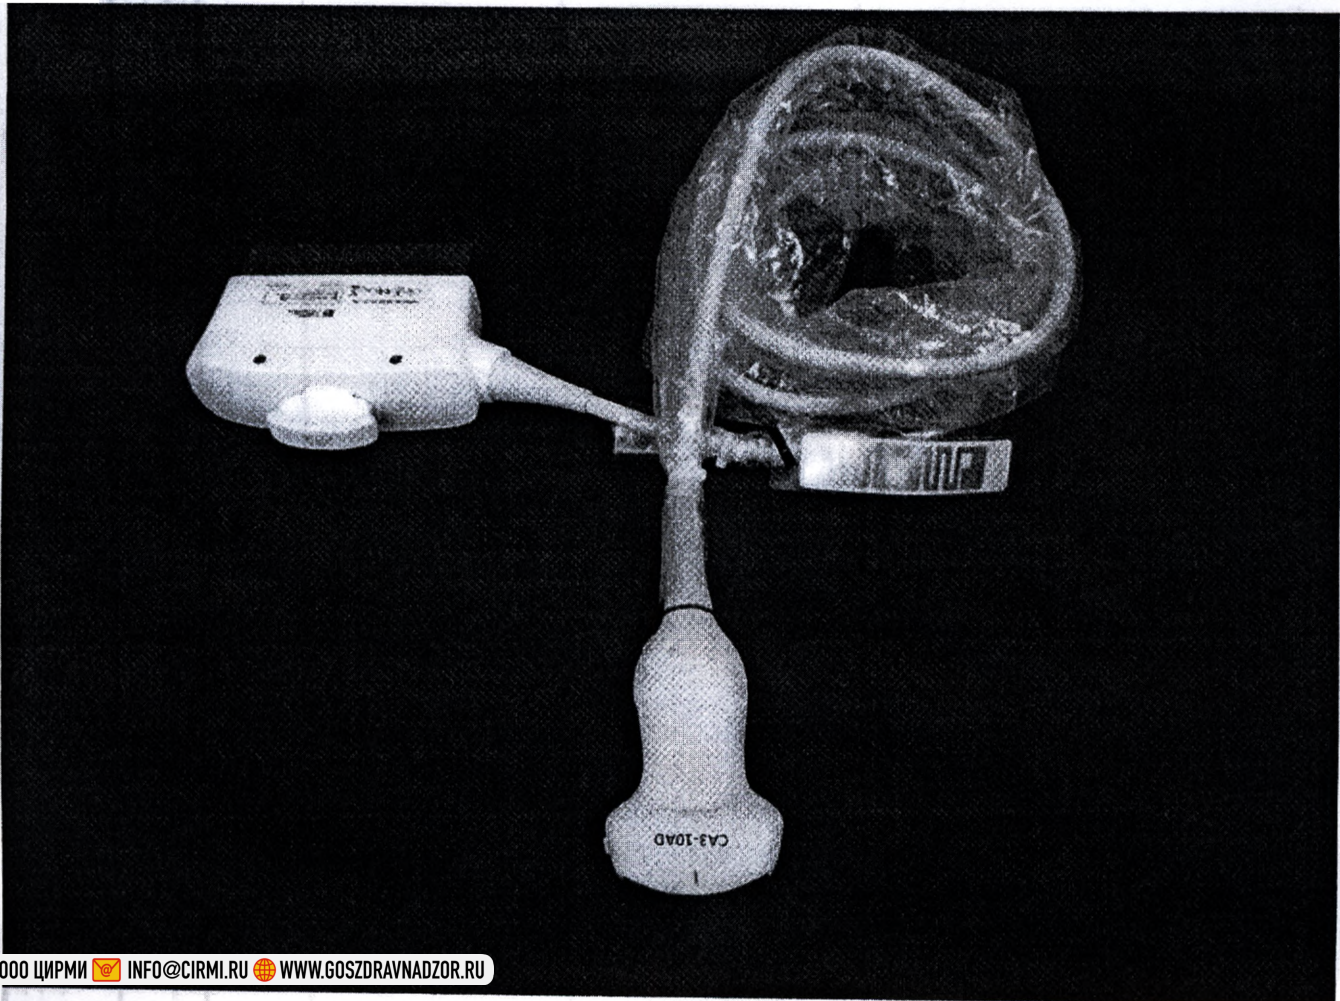


Эндоканальный: ER4-9(только для HS50-RUS)

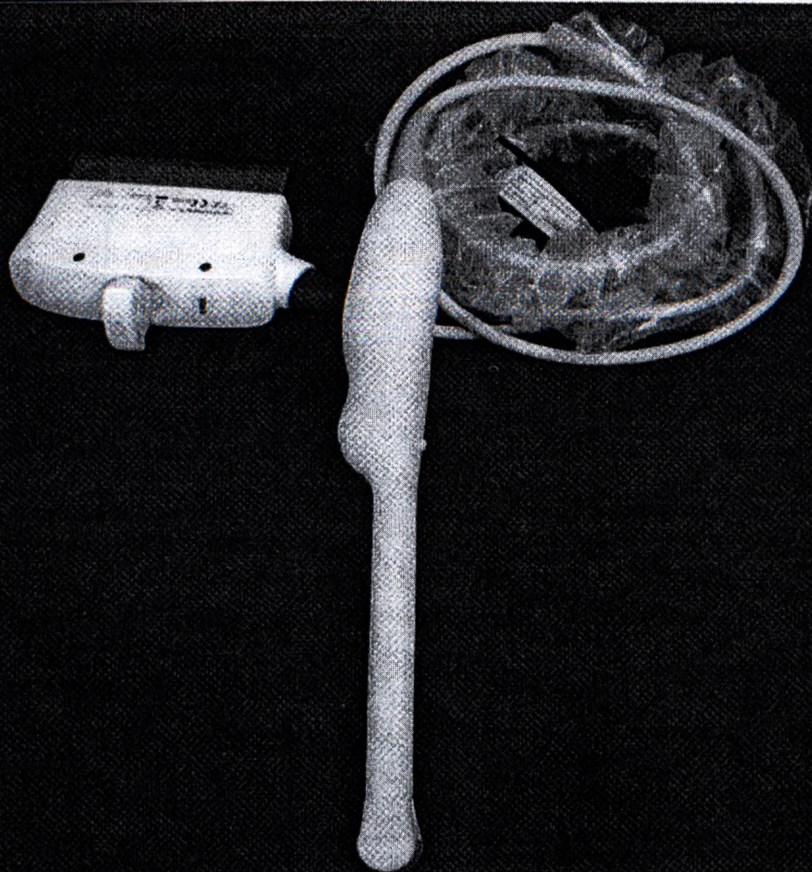


EVN4-9(только для HS50-RUS)

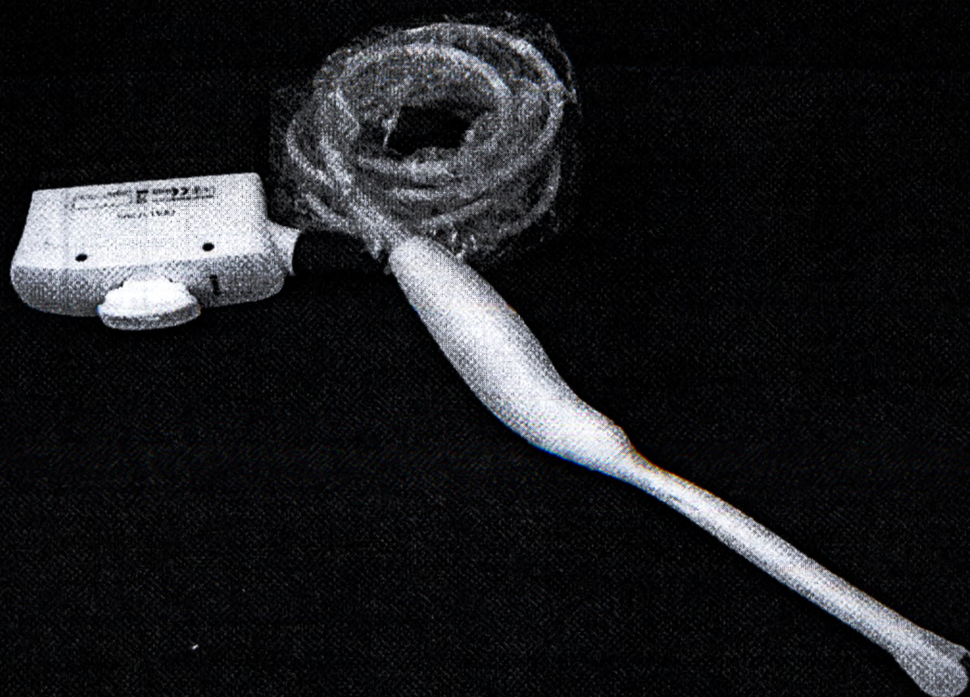


Эндокавитальный: ER4-9(только для HS50-RUS)

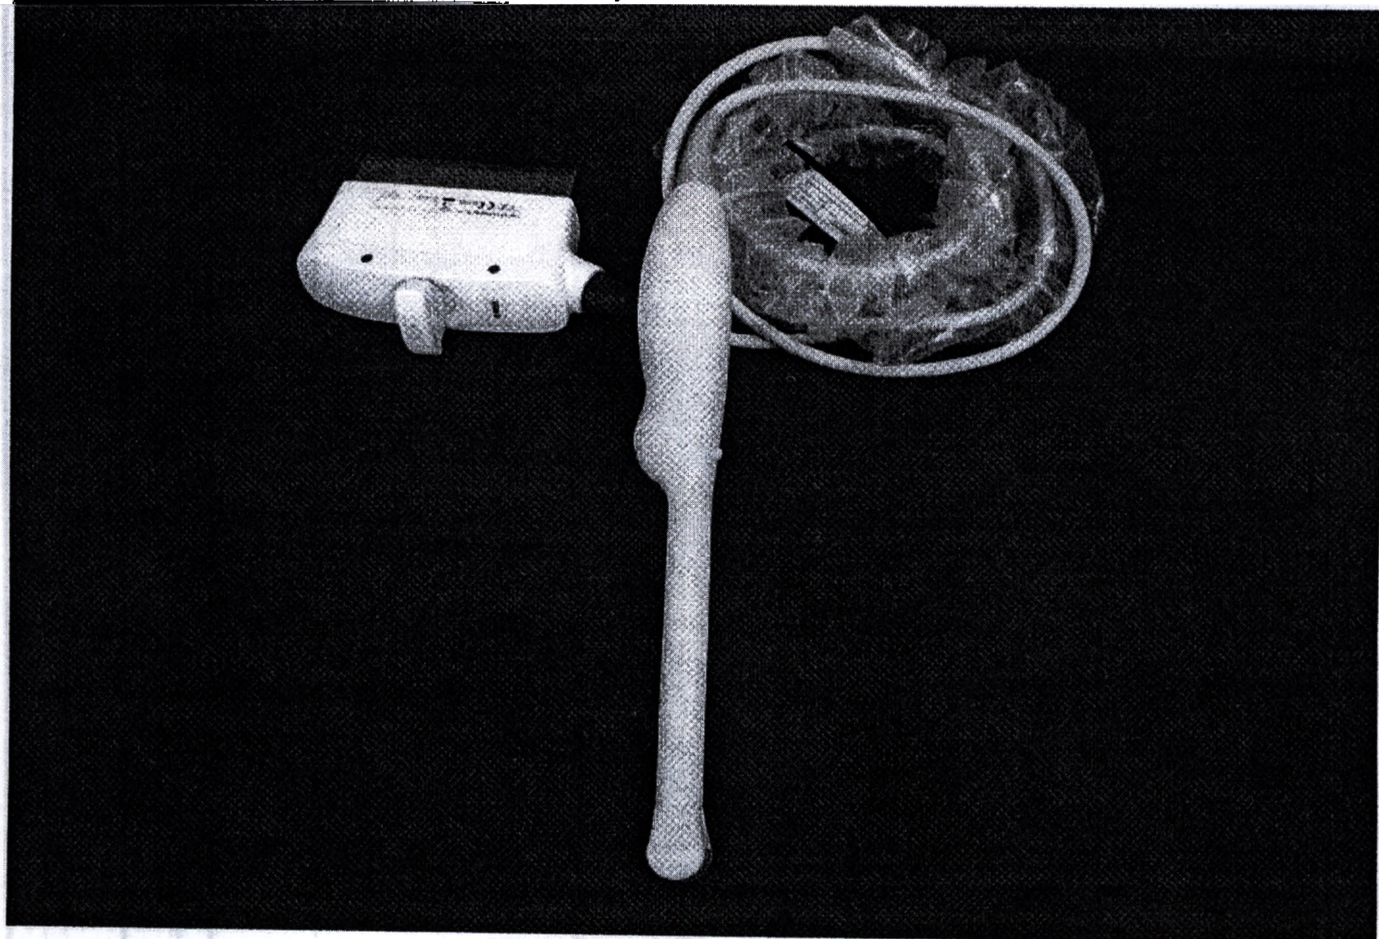


EVN4-9(только для HS50-RUS)

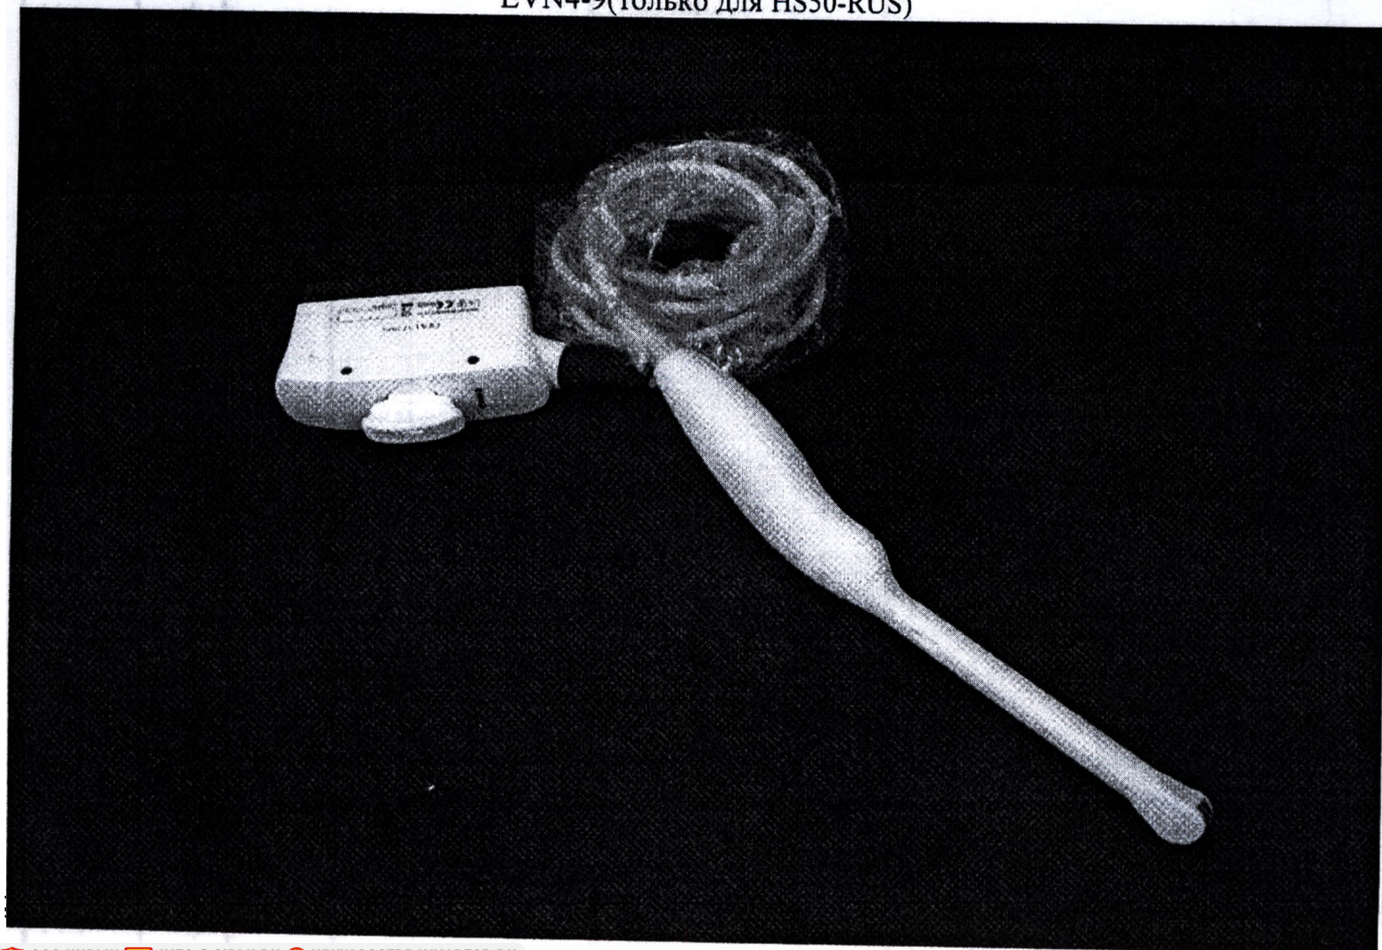


BCC4-9

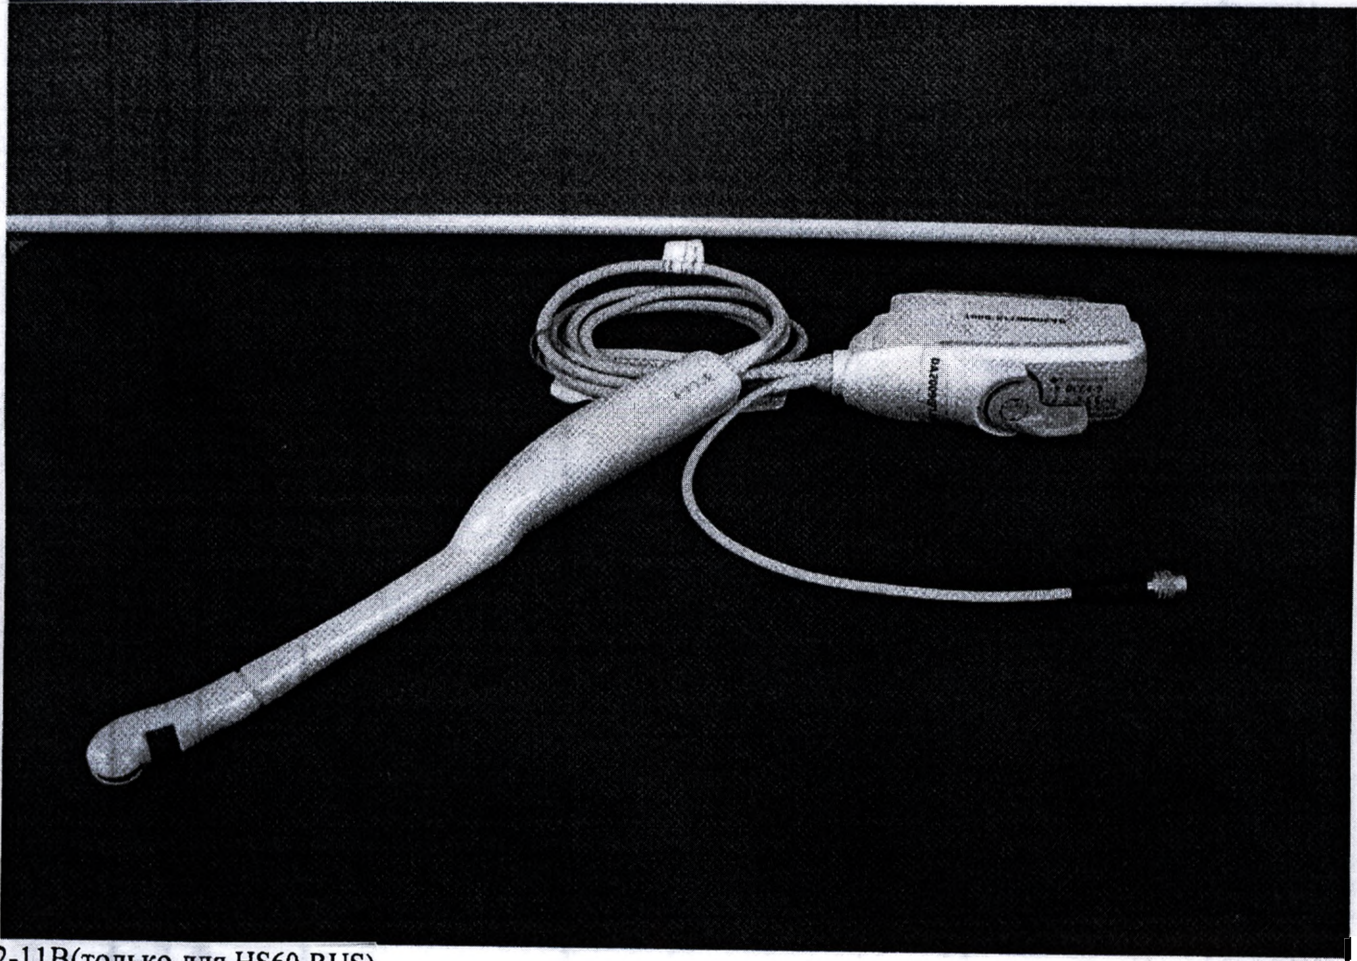


EA2-11B(только для HS60-RUS)

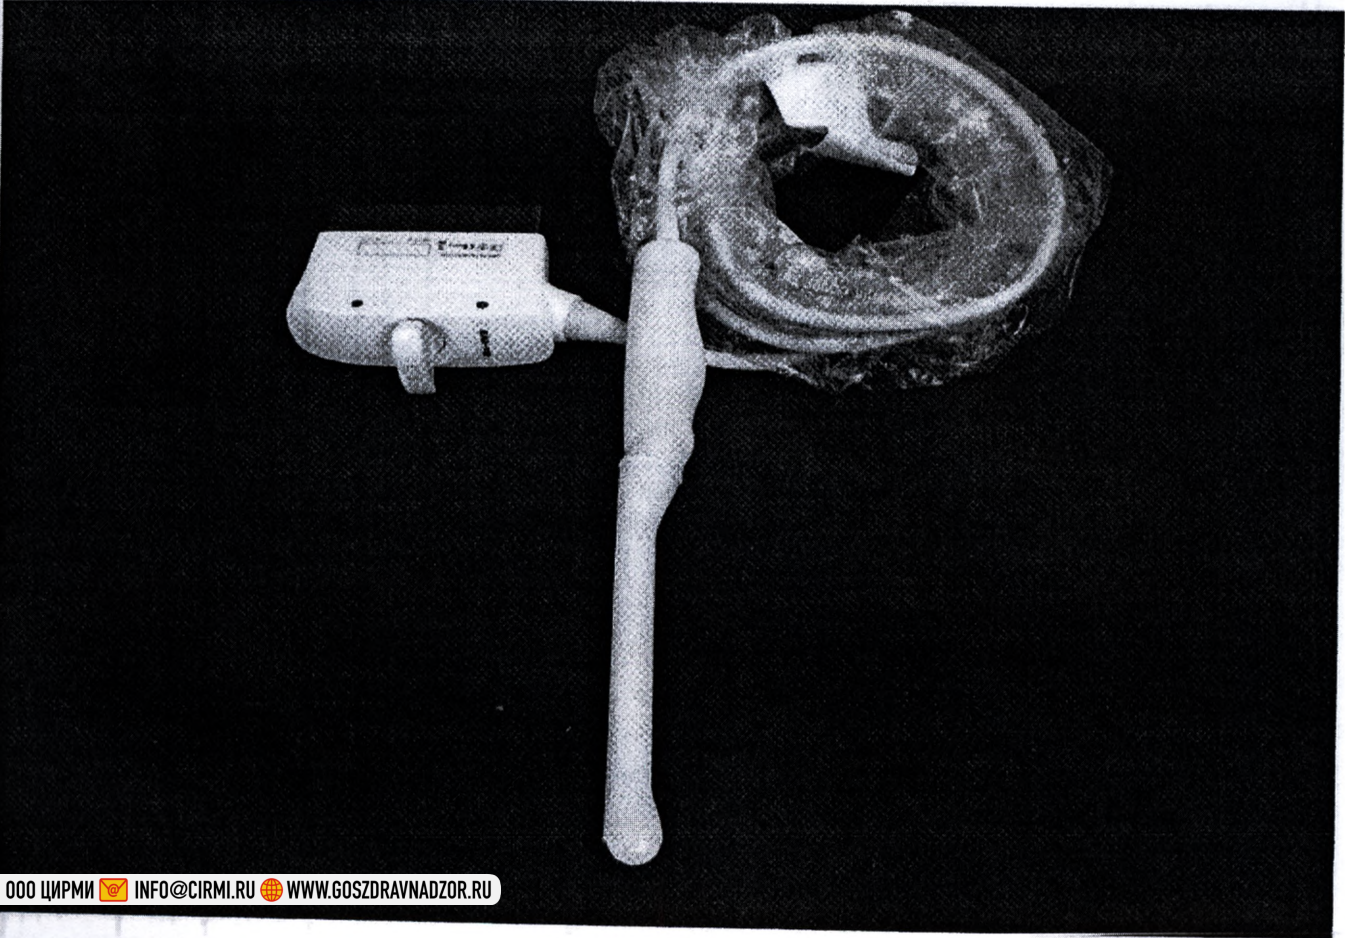


VR5-9(только для HS60-RUS)

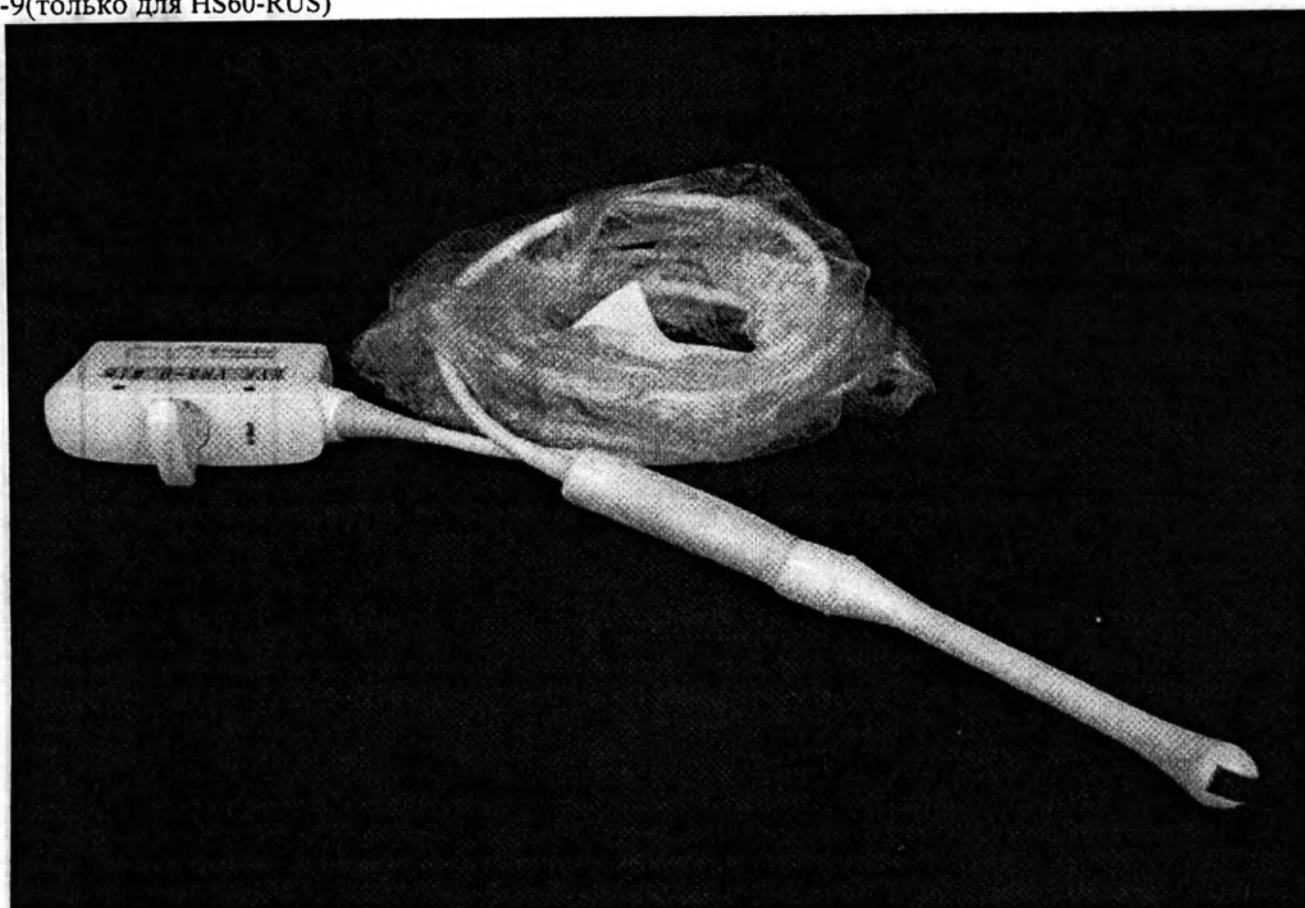


Микро-конвексный датчик: CF4-9

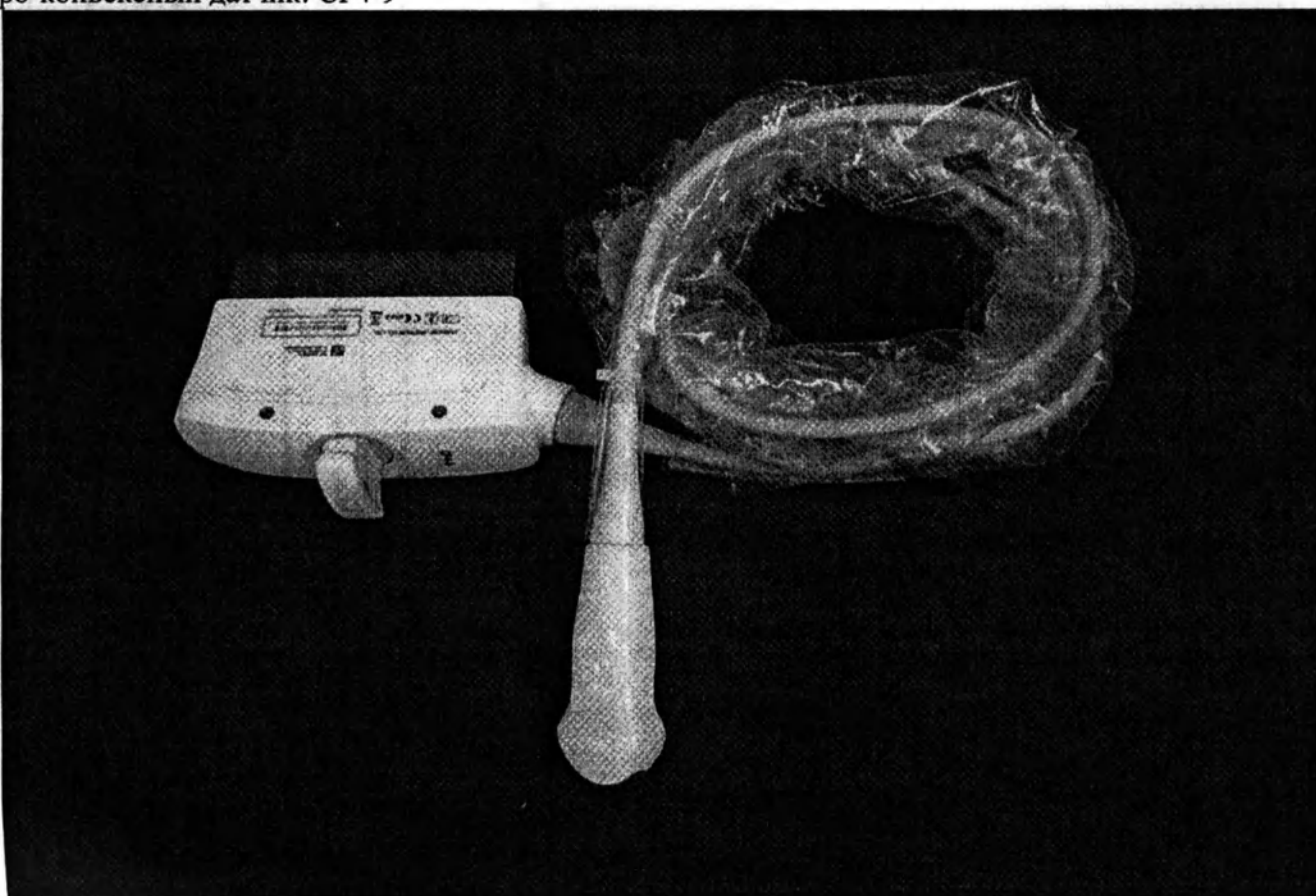


CA2-6BM (только для HS50-RUS)

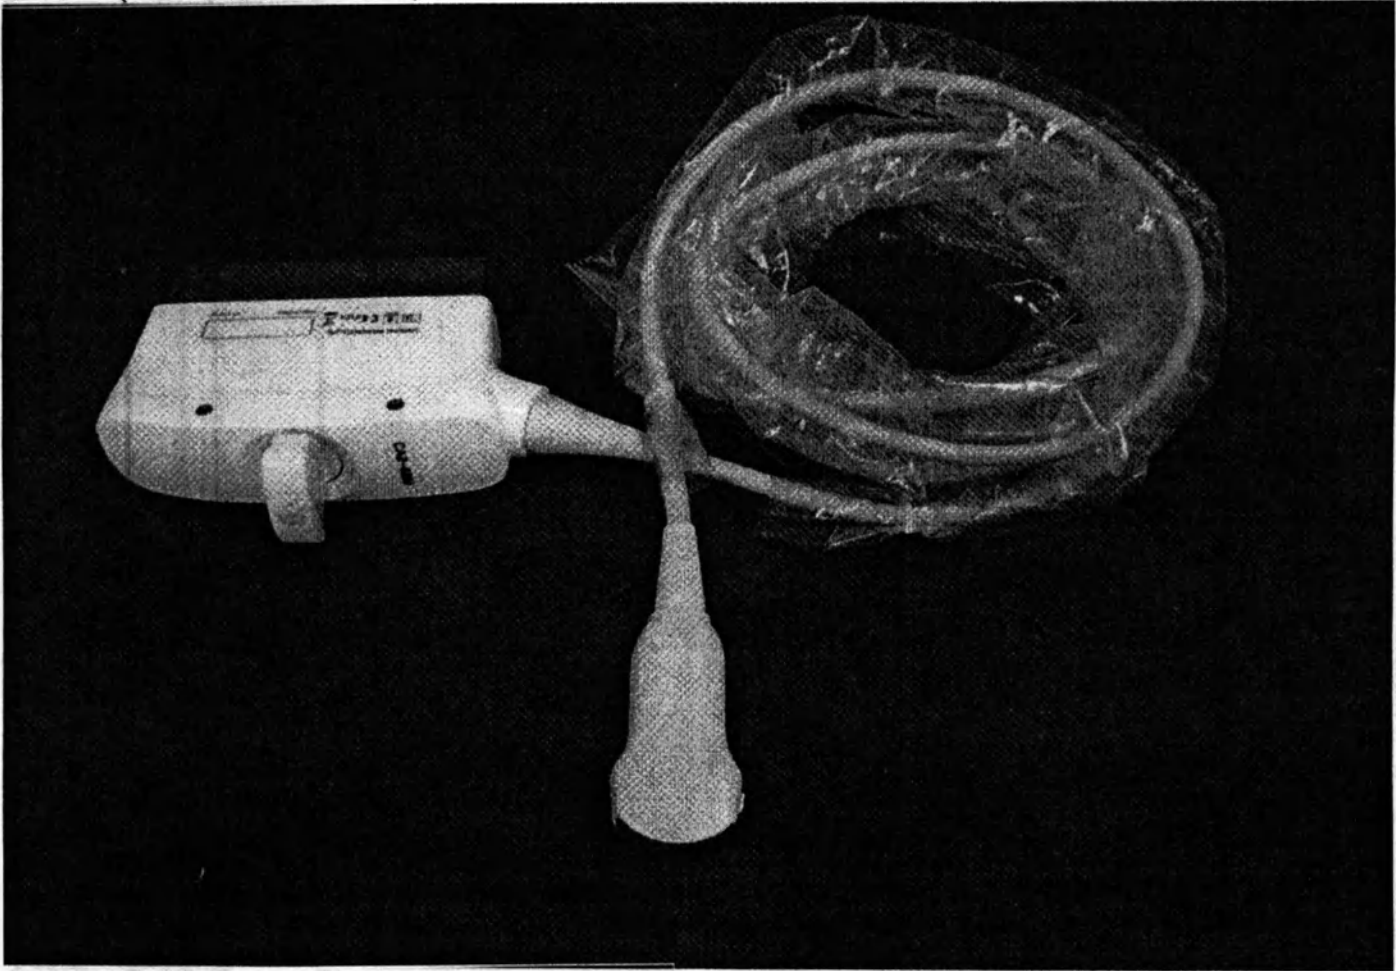


Фазированный датчик: PE2-4(только для HS50-RUS)

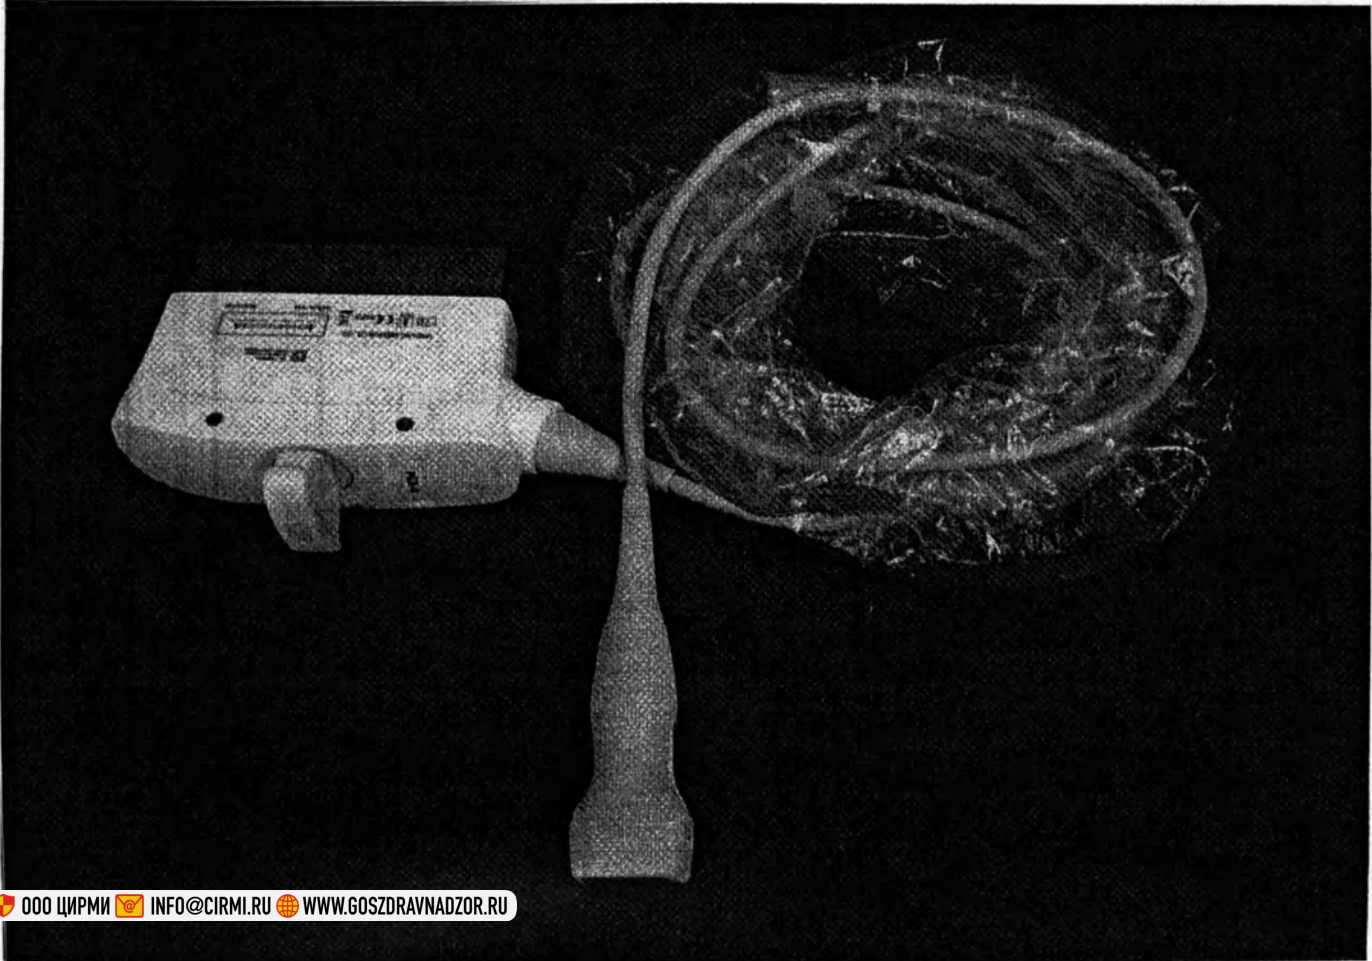


PA3-8B

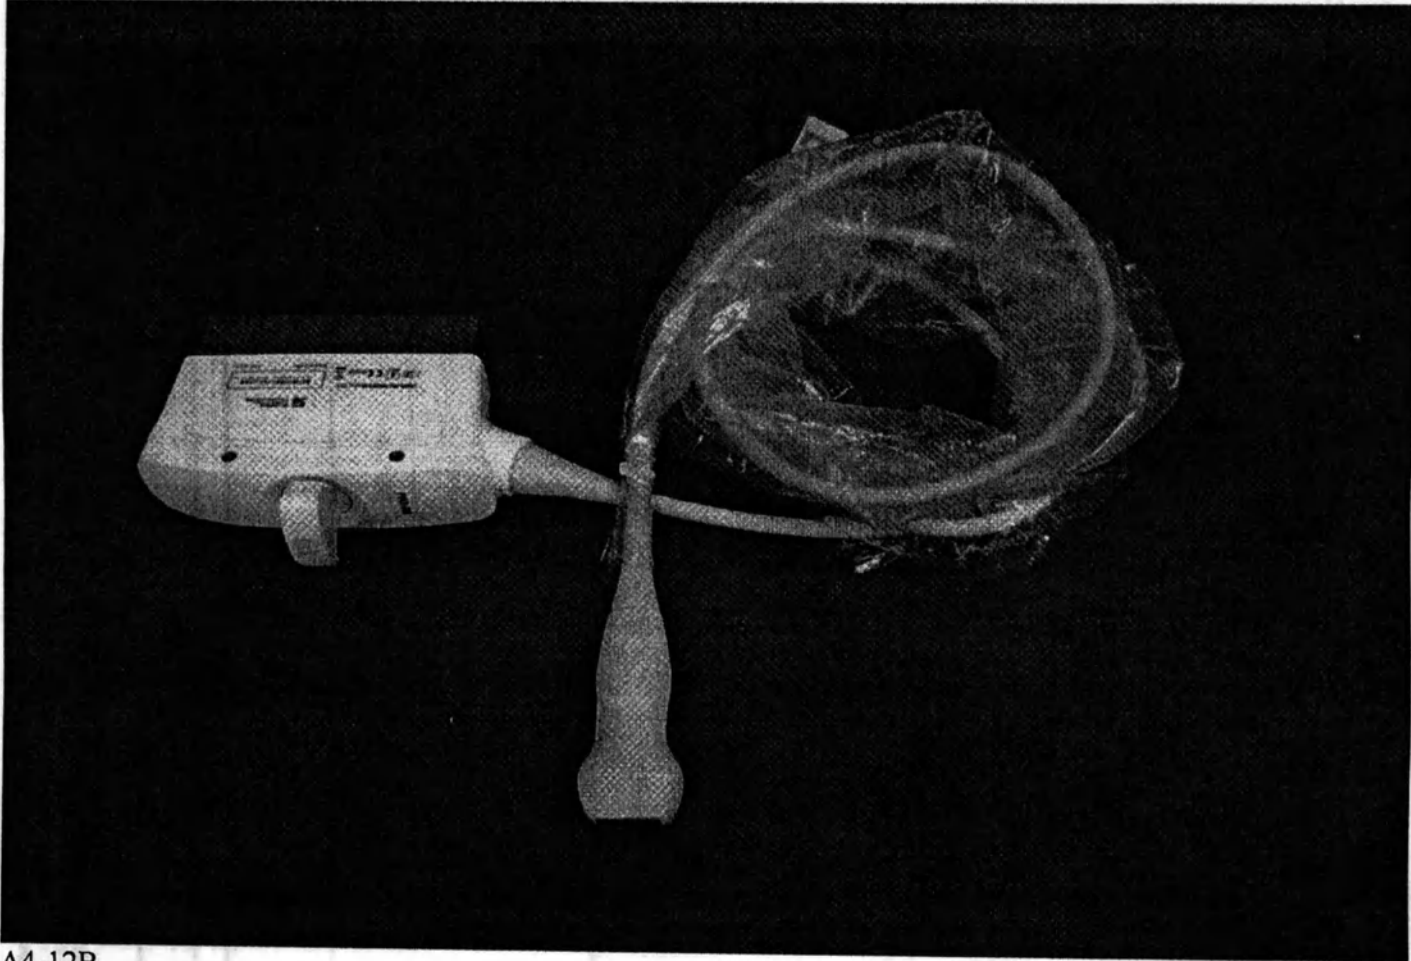


PA4-12B

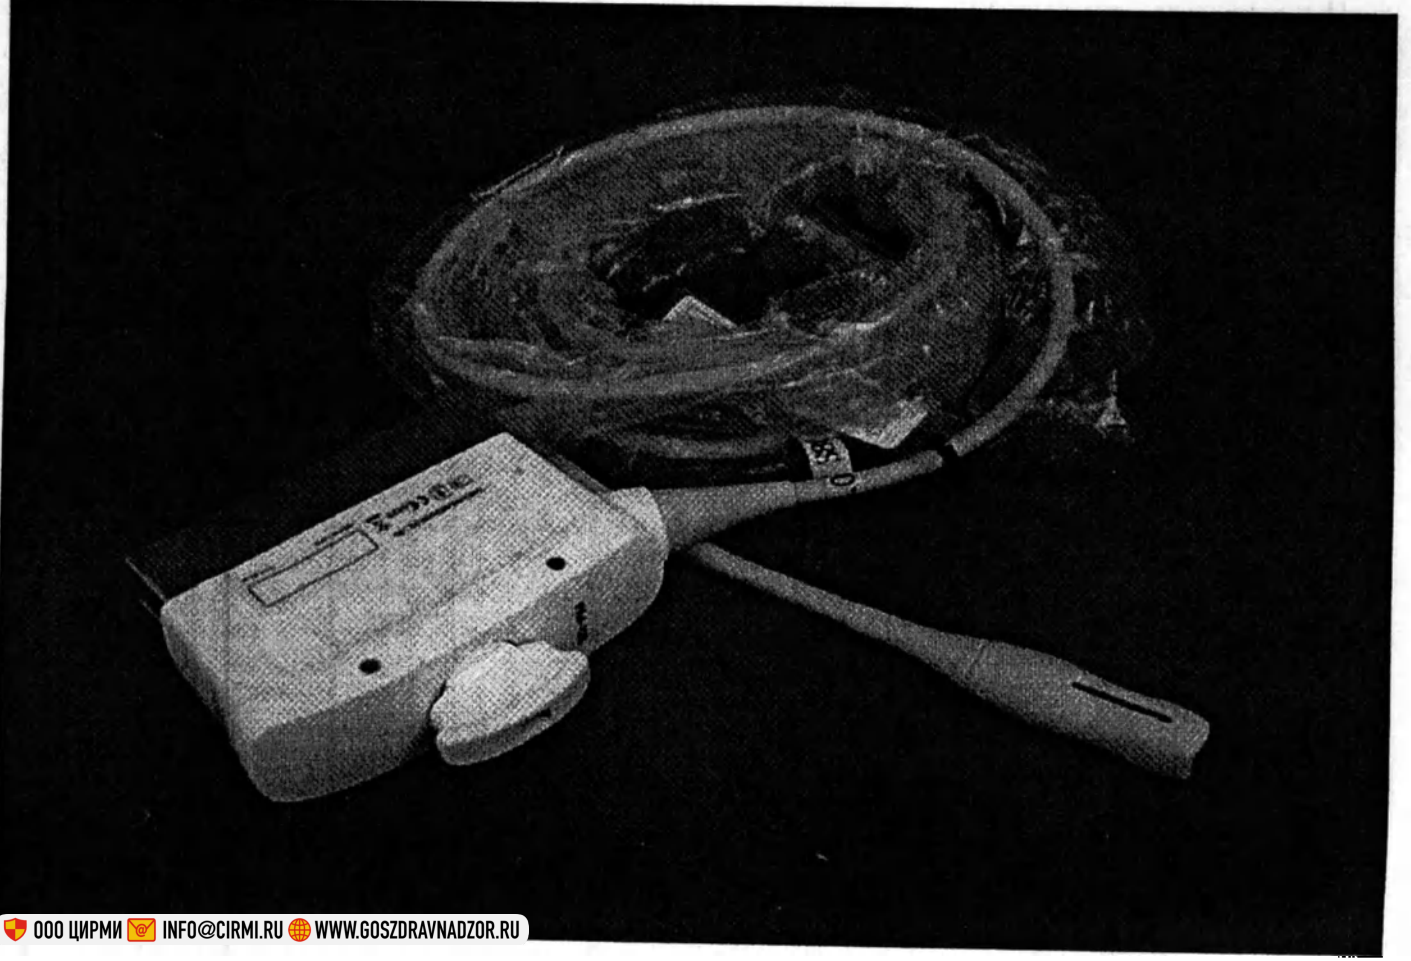


PA1-5A(только для HS60-RUS)

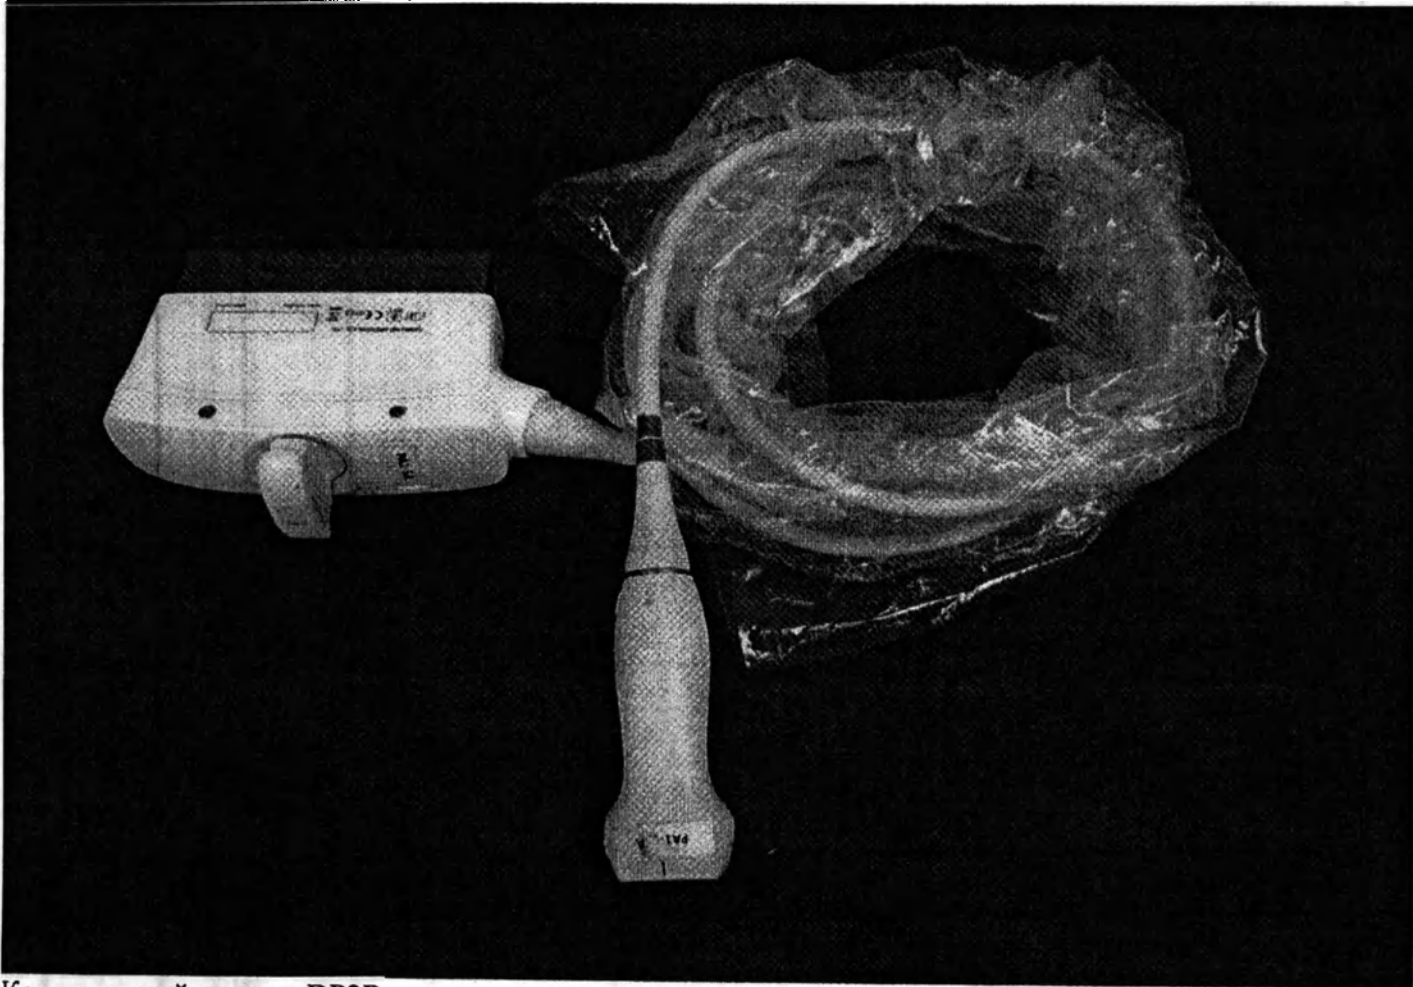


Карандашный датчик: DP2B

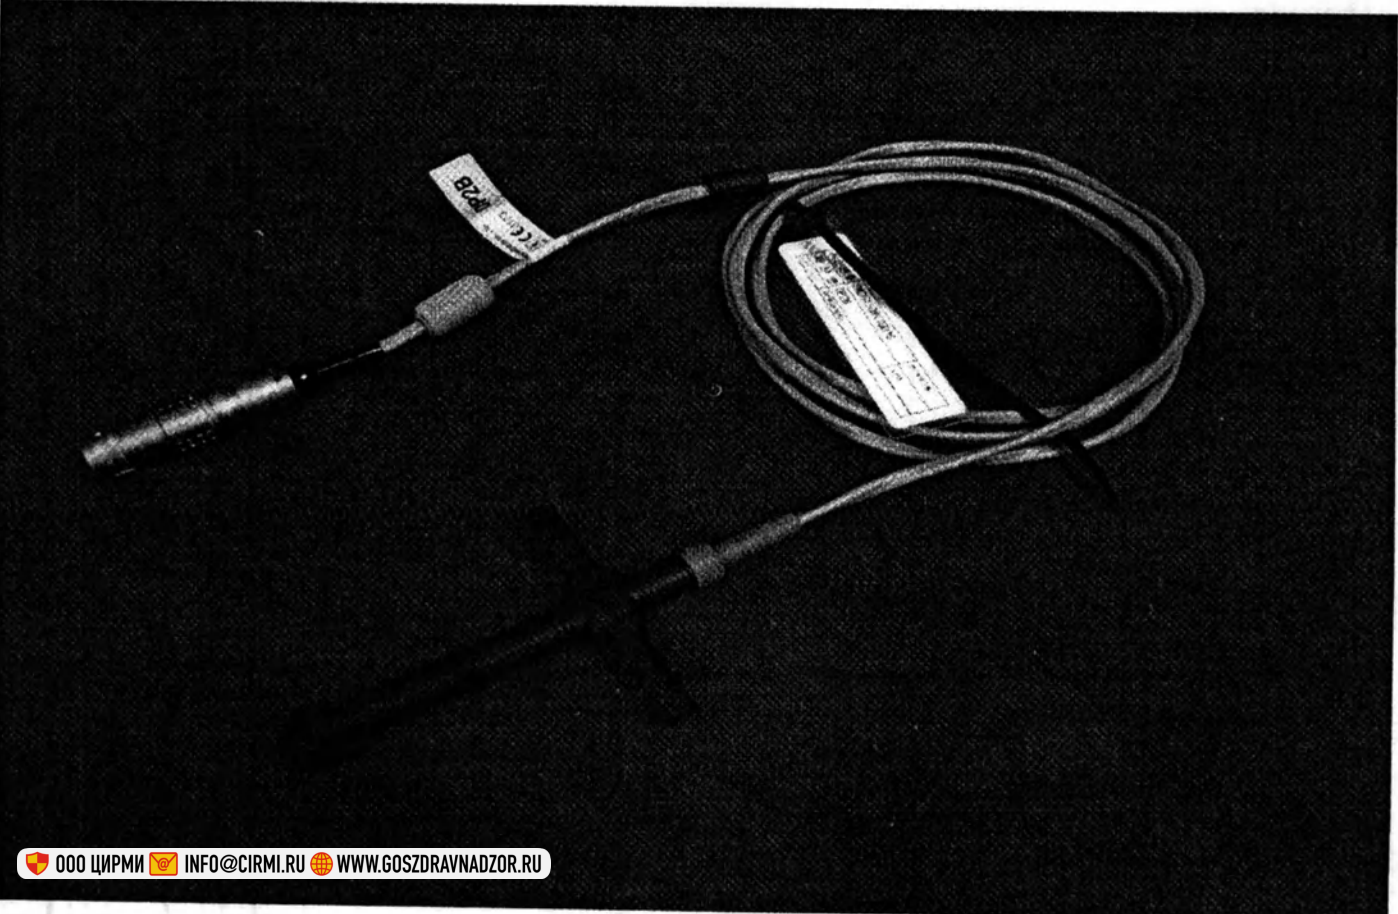


CW6.0

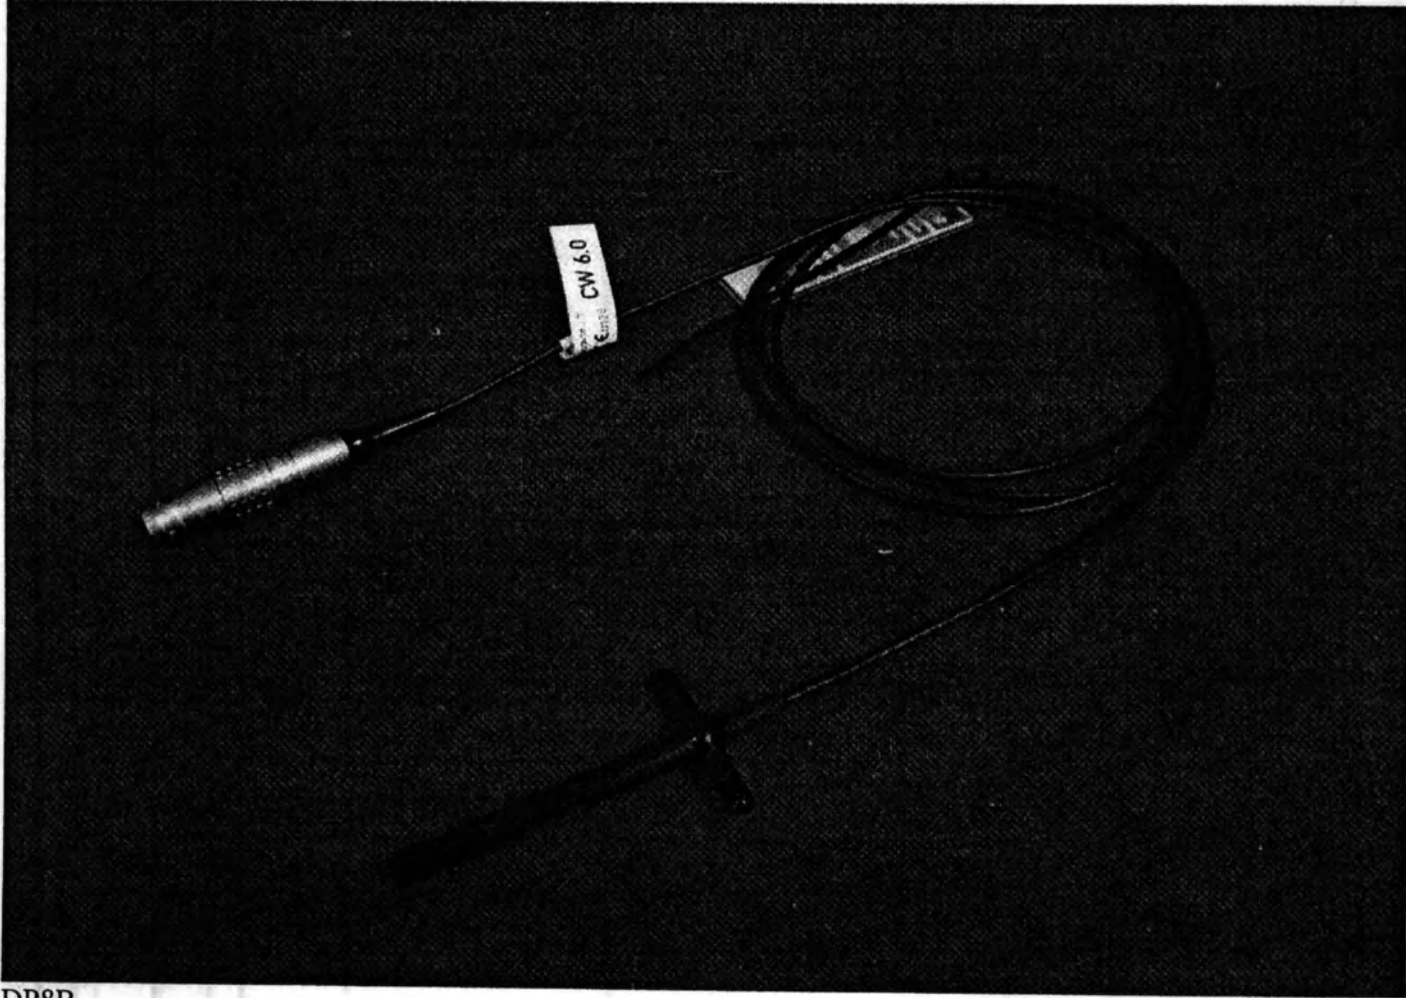


DP8B

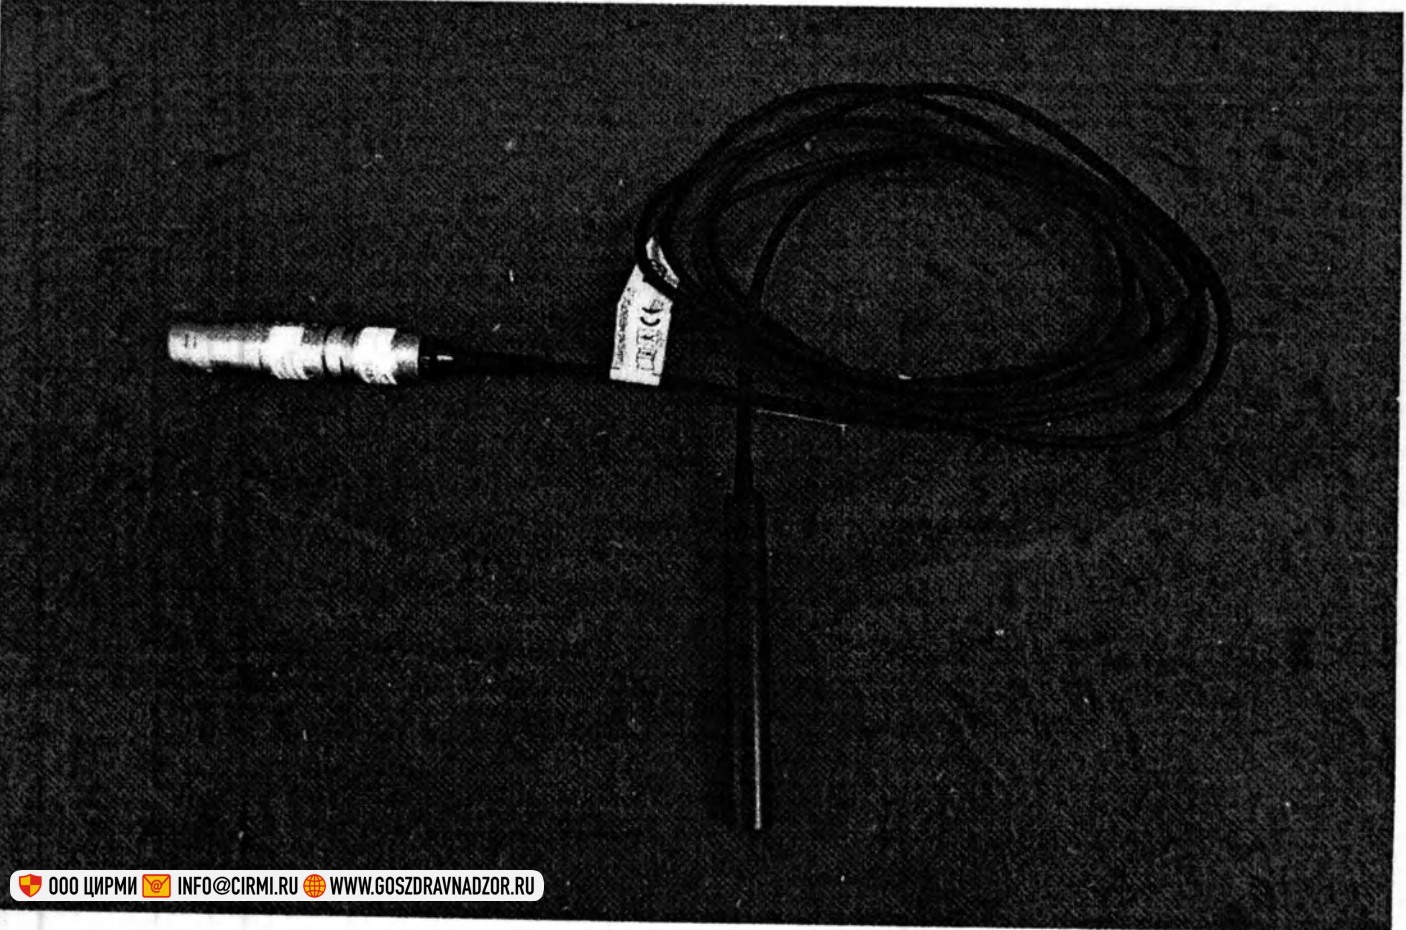


Конвексный объемный: CV1-8AD

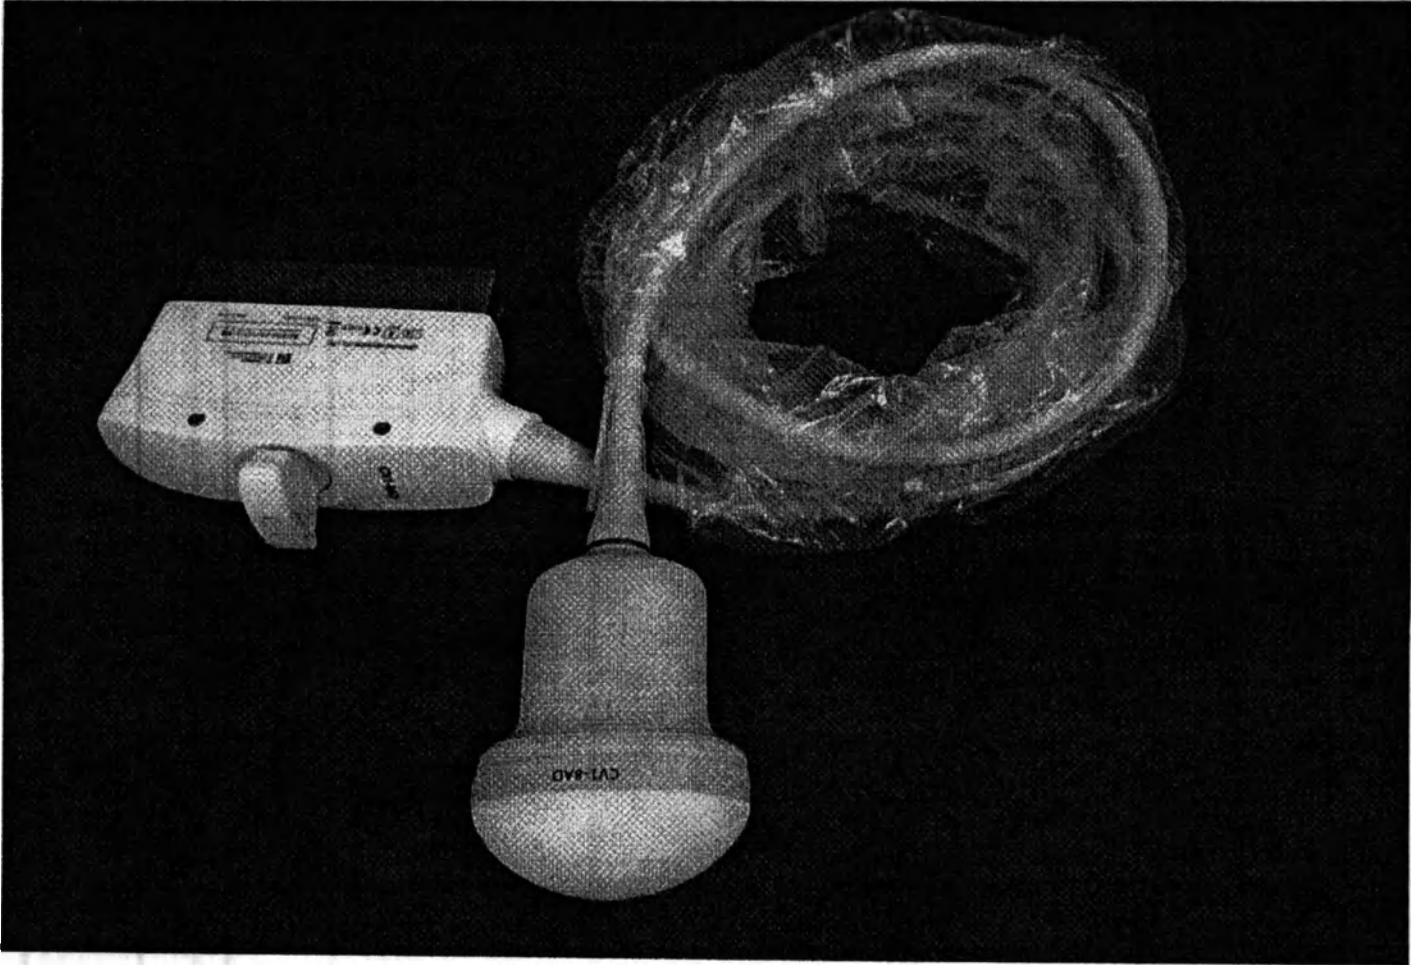


Эндокавитальный объемный: V5-9

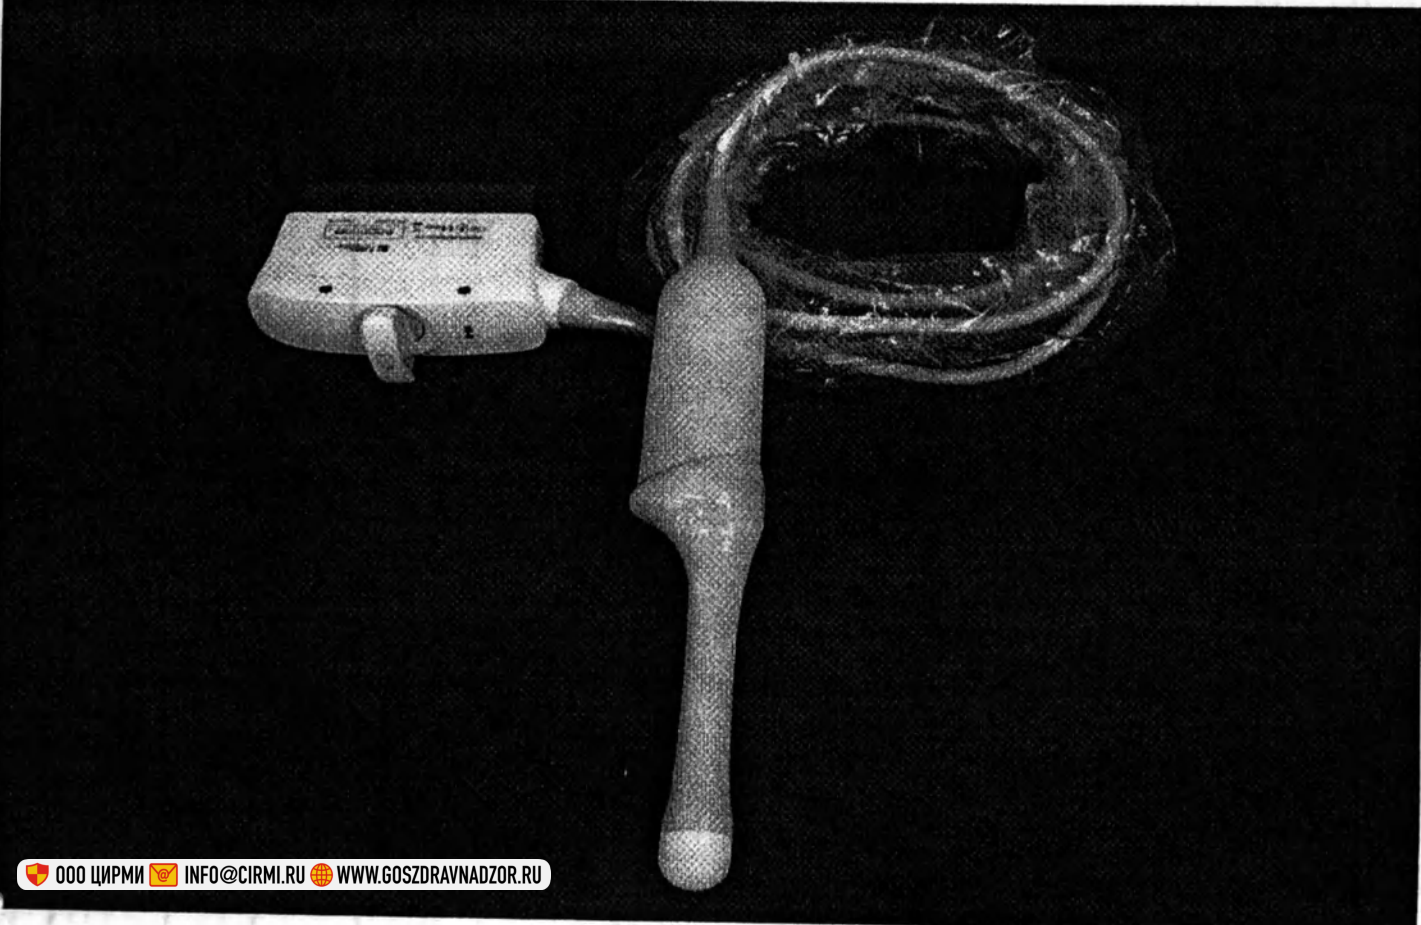


Чреспищеводный: ММРТ3-7

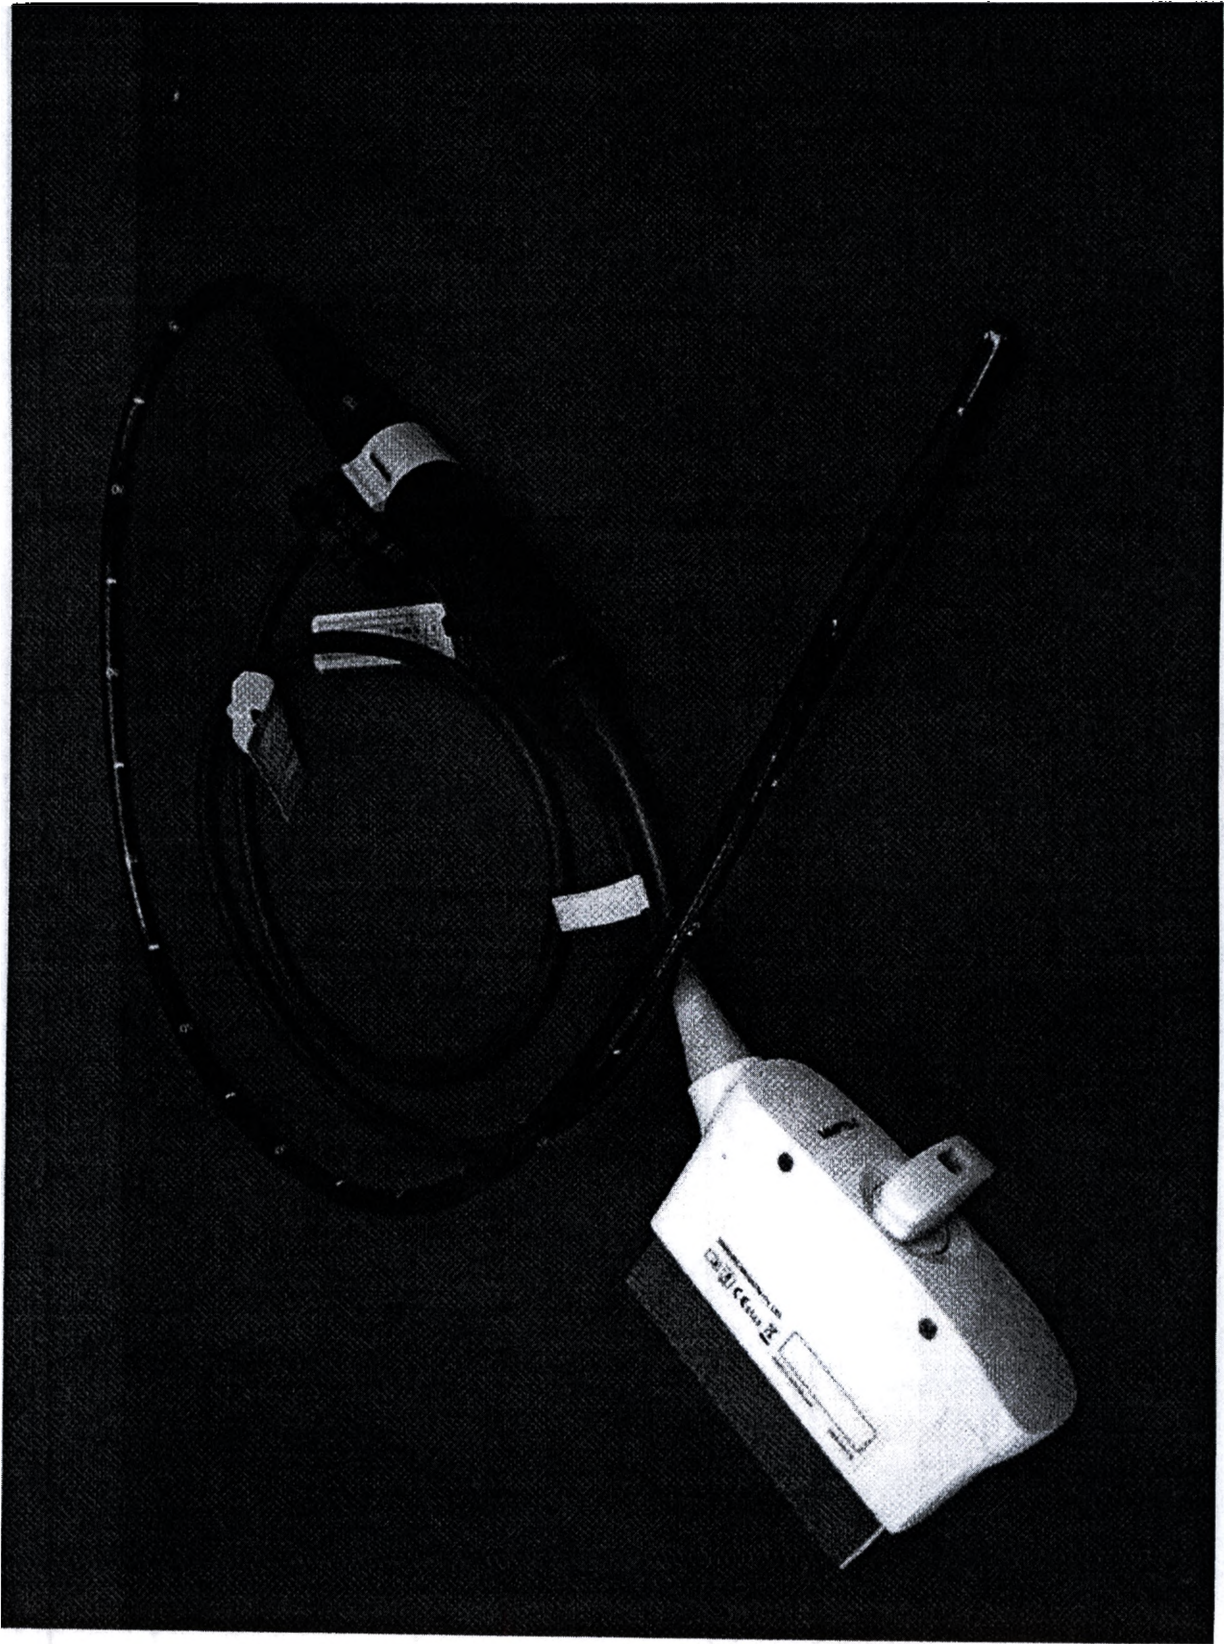

4P коннектор PSA (при необходимости)

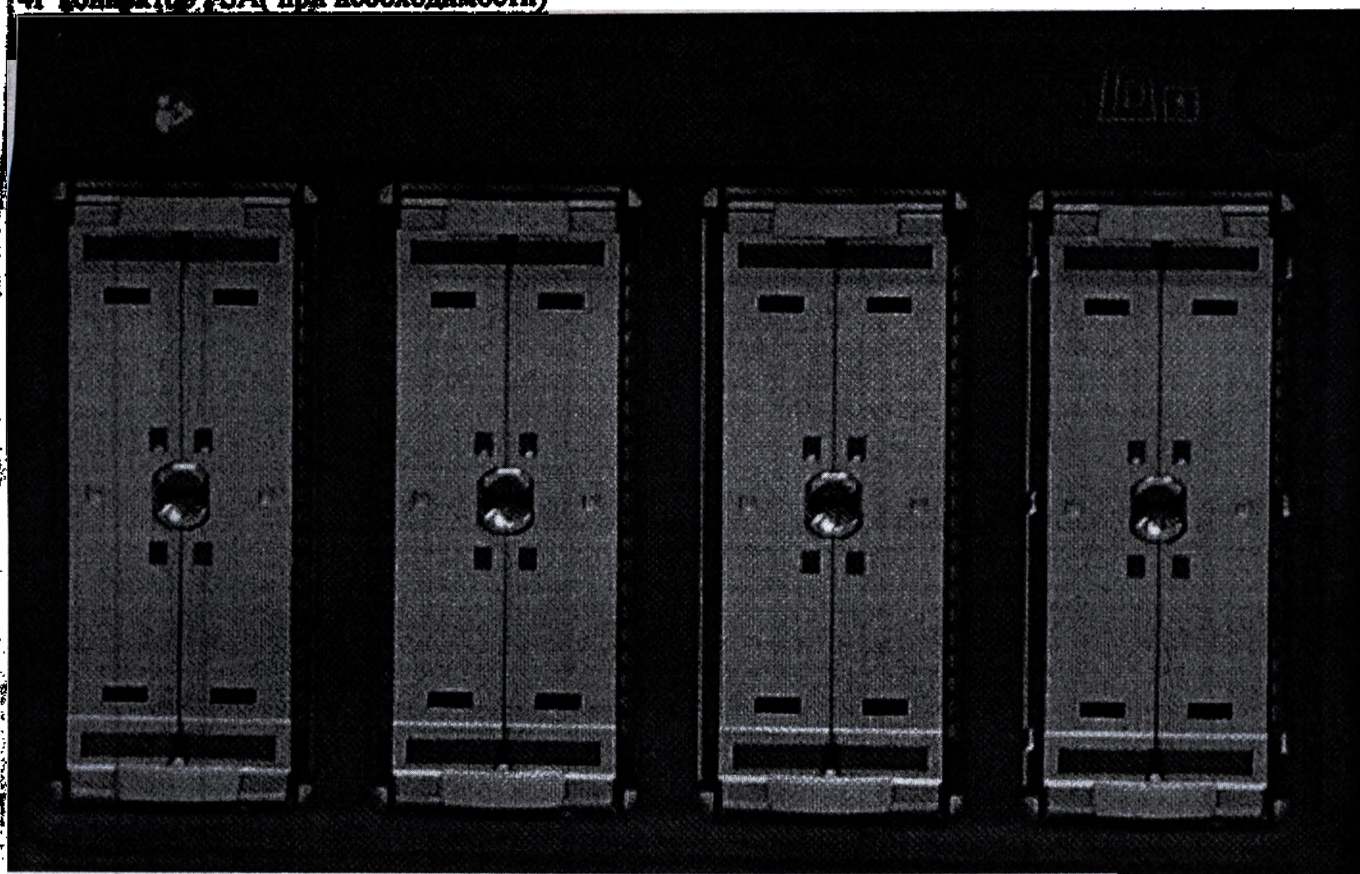

4P коннектор PSA (с разъемом для "карандашного" датчика) (при необходимости)

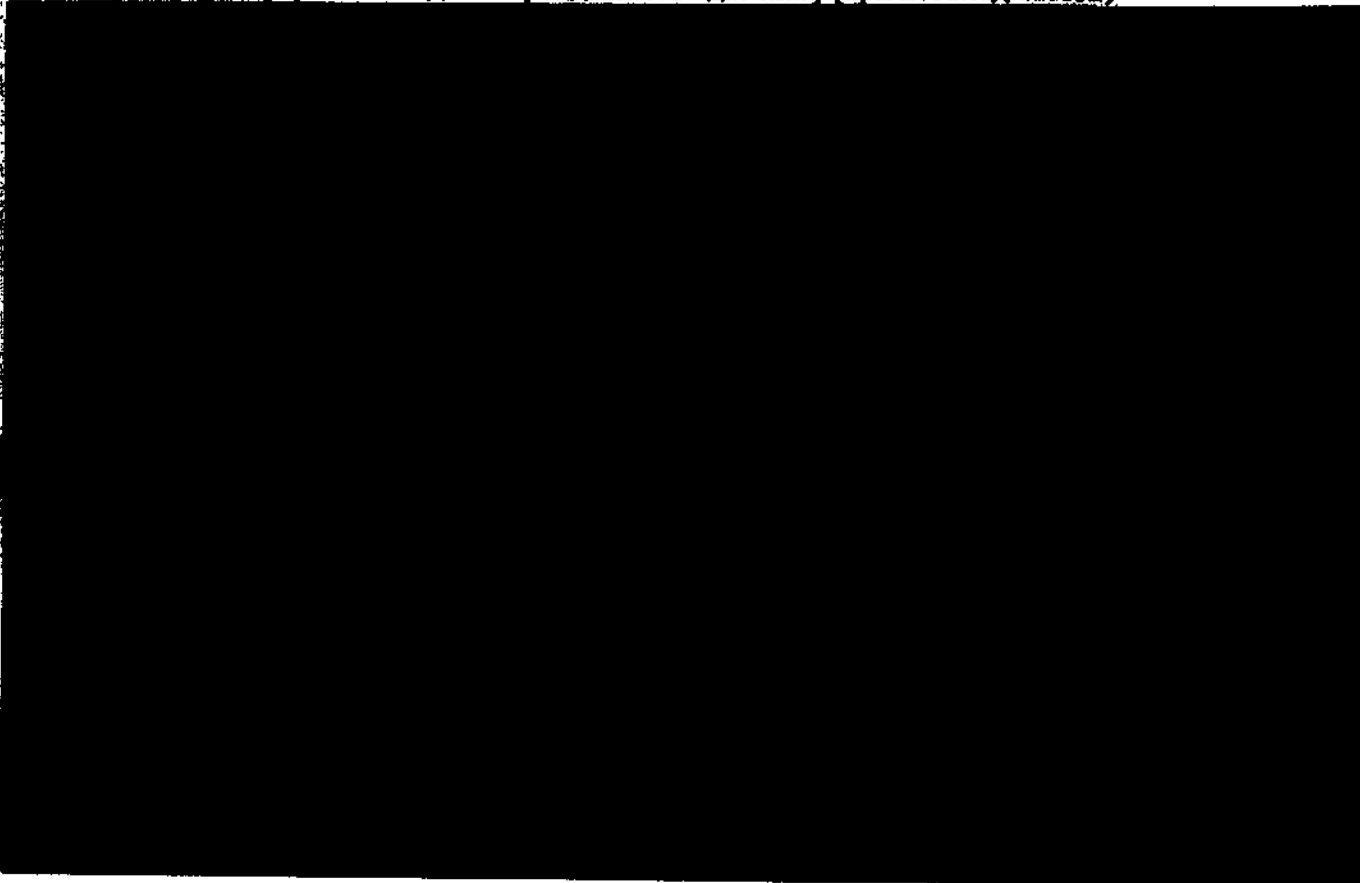

3P коннектор PSA (с разъемом для "карандашного" датчика) при необходимости)


Руководство пользователя

SAMSUNG

SAMSUNG MEDICAL
IMAGING & IVC SYSTEMS

HS50/HS60 User Manual


Volume 1

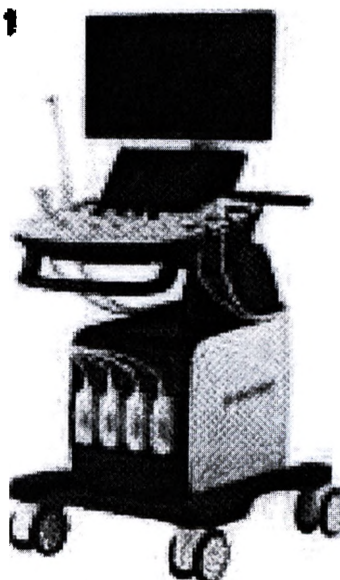


Диагностическая ультразвуковая система HS60-RUS :




Лицензионный ключ для активации функции получения изображения высокой четкости HDVI-USB

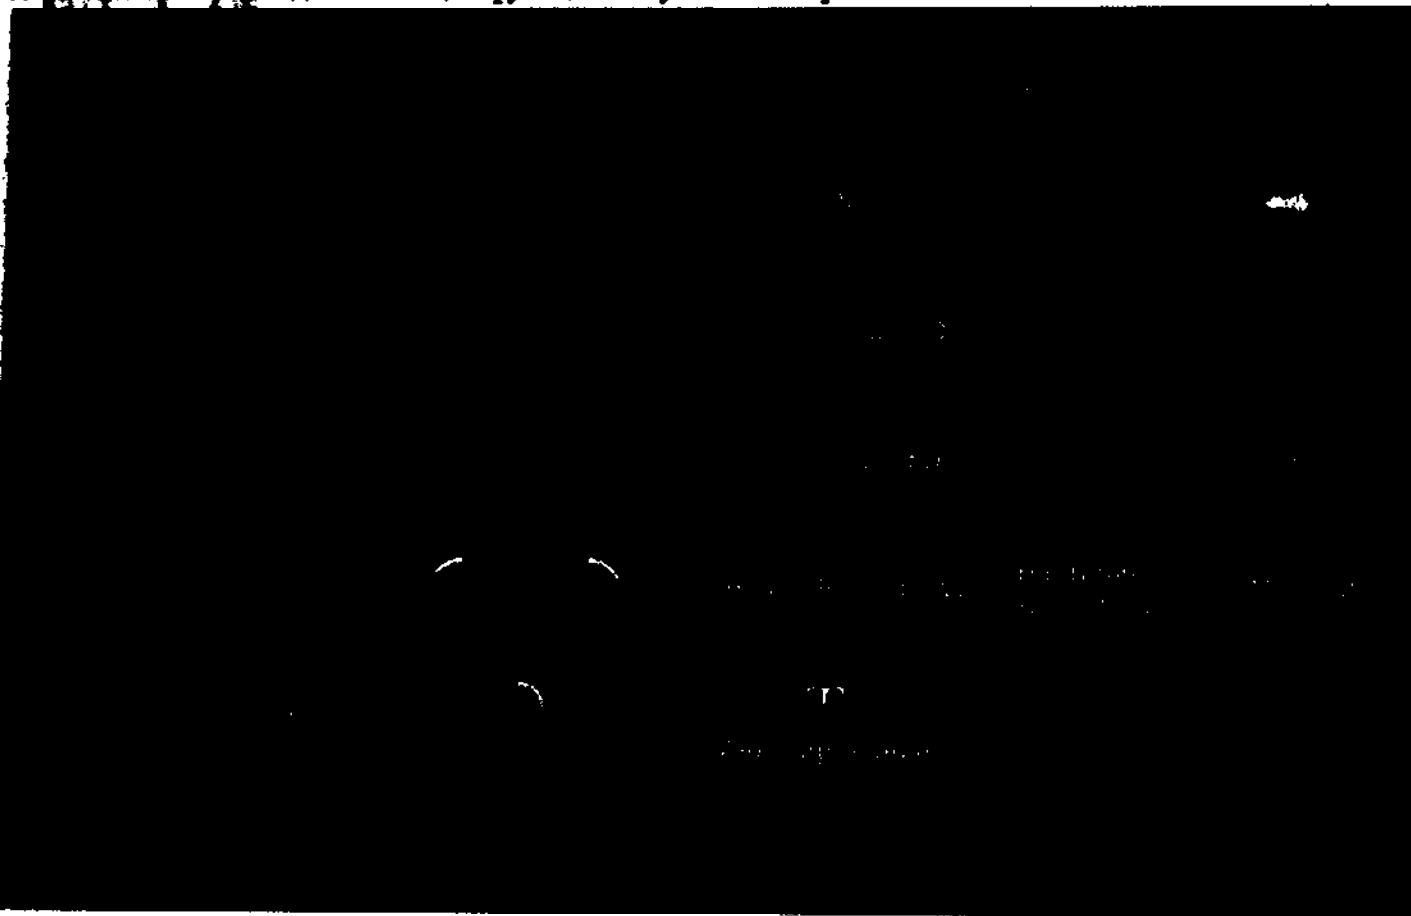


Лицензионный ключ для активации функции 5D Heart



Лицензионный ключ для активации функции 5D Heart Color

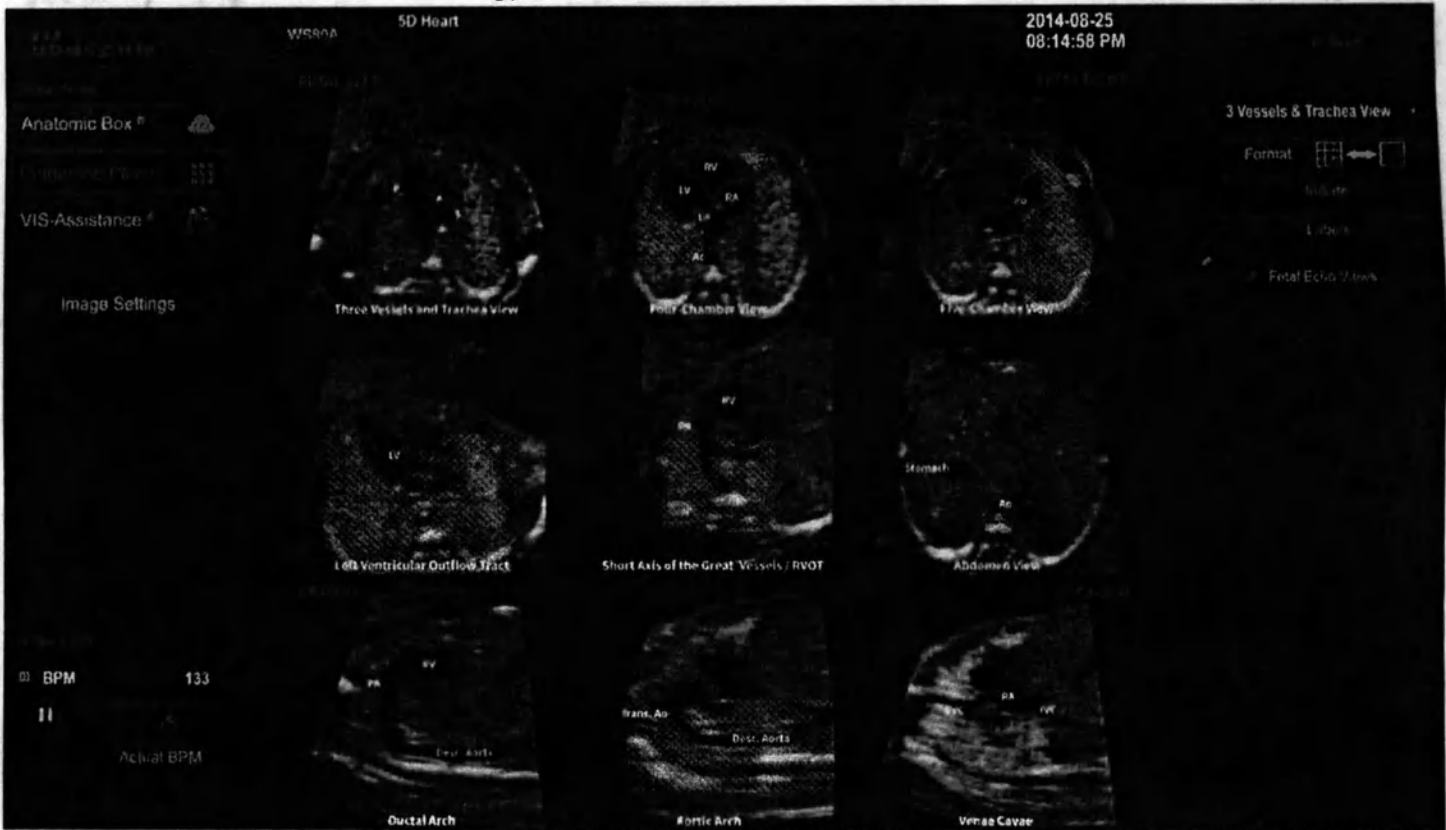


Лицензионный ключ для активации функции 5D CNS+

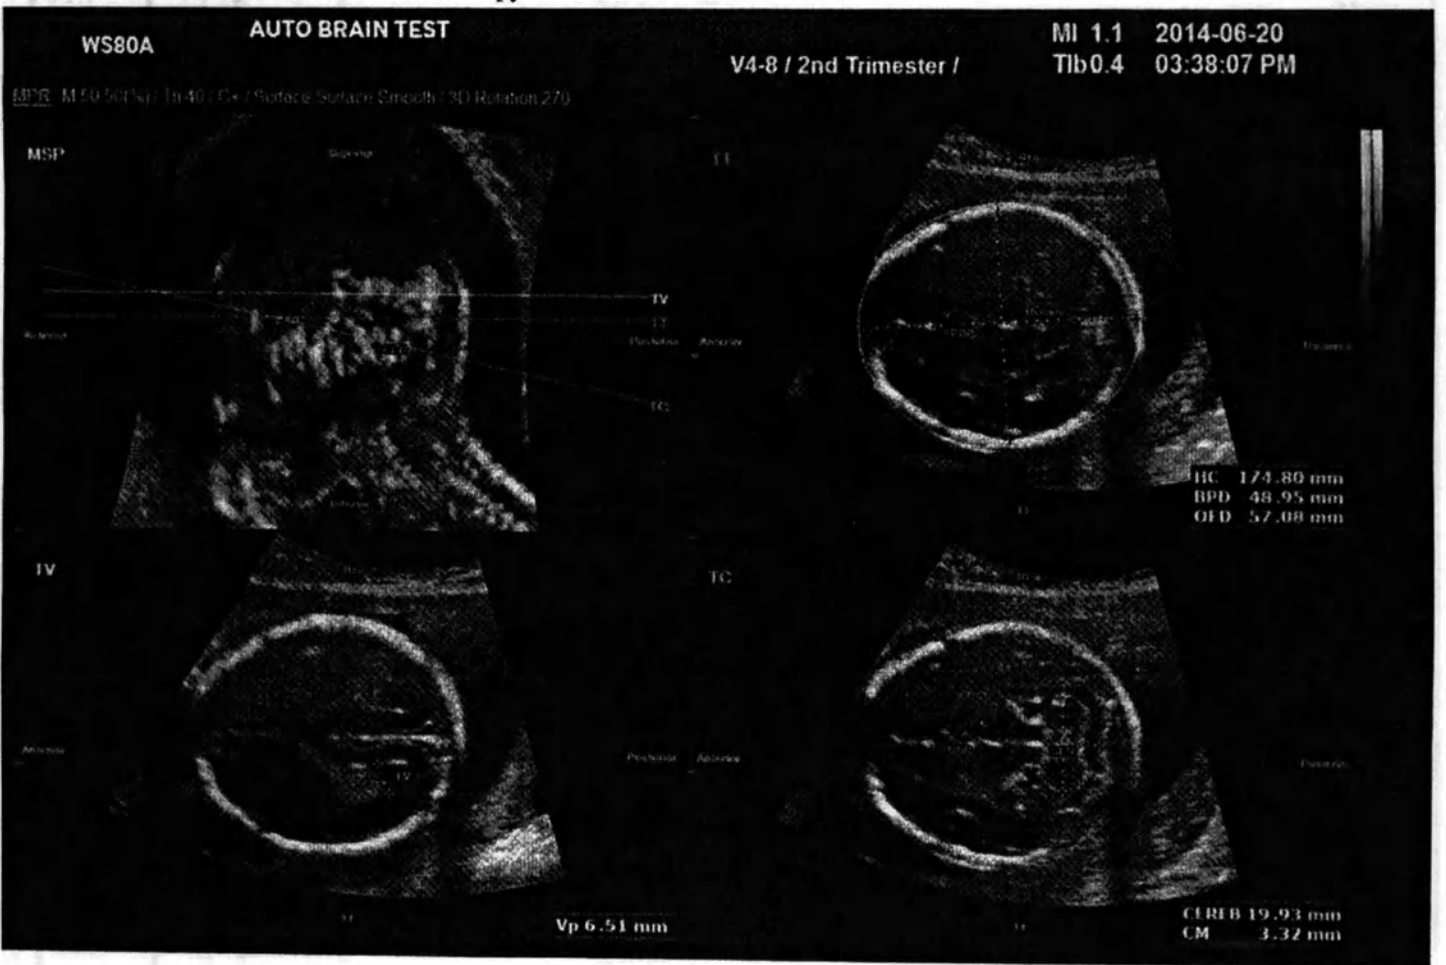


Лицензионный ключ для активации функции 5D Limb Vol



Лицензионный ключ для активации функции SEE Stream




Лицензионный ключ для активации функции Crystal Vue



Fetal spine with Crystal Vue Flow™

I. Принадлежности:

Набор для проведения биопсии, в составе: насадка для биопсии; направляющая иглы; крепление.

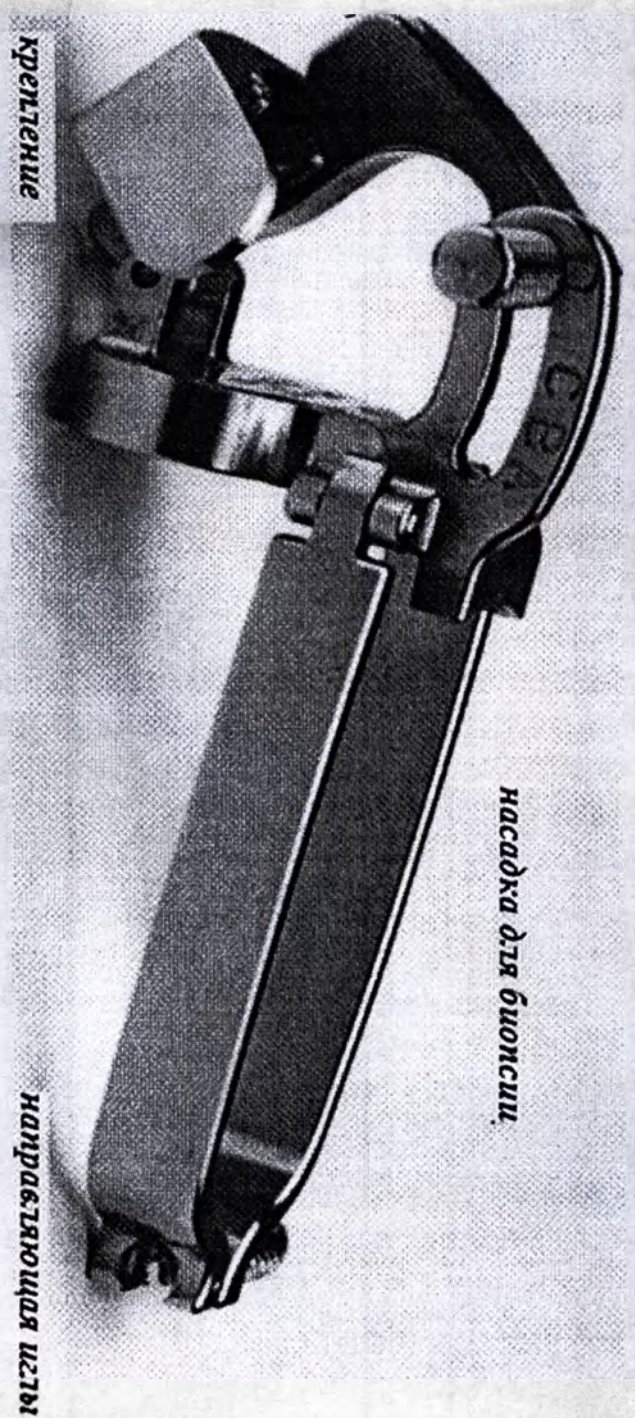

Лицензионный ключ для активации функции определения комплекса Интима/Медиа (Авто IMT+);

Hand-Foot
LA3-1440
2.5 cm
30 Hz
[20]
Frg 11.4 MHz
Gn 52
DR 130
Map 10
FA 9
P 90%

Лицензионный ключ для активации функции, обеспечивающей передачу данных DICOM 3.0;

Настройка DICOM

Имя AE

Set AETitle

Название станции

Set Station Name

№ порта

104

Имя службы	Псевдоним	Имя AE	IP адрес	Порт	Запрос	Проверка
ХРАНИЛИЩЕ	123	12	10.20.13.2	104		

Добавить

Очередь

Формат отправки DICOM

2D-режим

Цветной

Режим ЦДК

Цветной

Компр. DICOM

Непод. изобр.

Несж.

☒ Сохранить СтрОтч в конце осмотра

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Лицензионный ключ для активации функции проведения кардиологических измерений

ЭхоКГ
взрослого-камерн.

ЭхоКГ
взрослого-клапан

ЭхоКГ
взрослого-Системный

детск. ЭхоКГ

Выход

ЛЖ (2D)

ПЖ (2D)

Все КДР ЛЖ (2D)

Все КСР ЛЖ (2D)

ПЖ (M)

ОЖ (M)

МЖПд

МЖПс

Об. ЛЖс (по Симпсону)

пп

ВнутрДиамЛЖ(д)

ВнутрДиамЛЖ(с)

Масса ЛЖ

ТЗСЛЖд

ТЗСЛЖс

ЛП

Аорта

Маркер тела

Т
Аннотирование

Отменить


активировать дані

Результат
действия
Переместить


Пакеты
3. Кардиология

Размер
шрифта
11


Лицензионный ключ для активации функции получения панорамного изображения

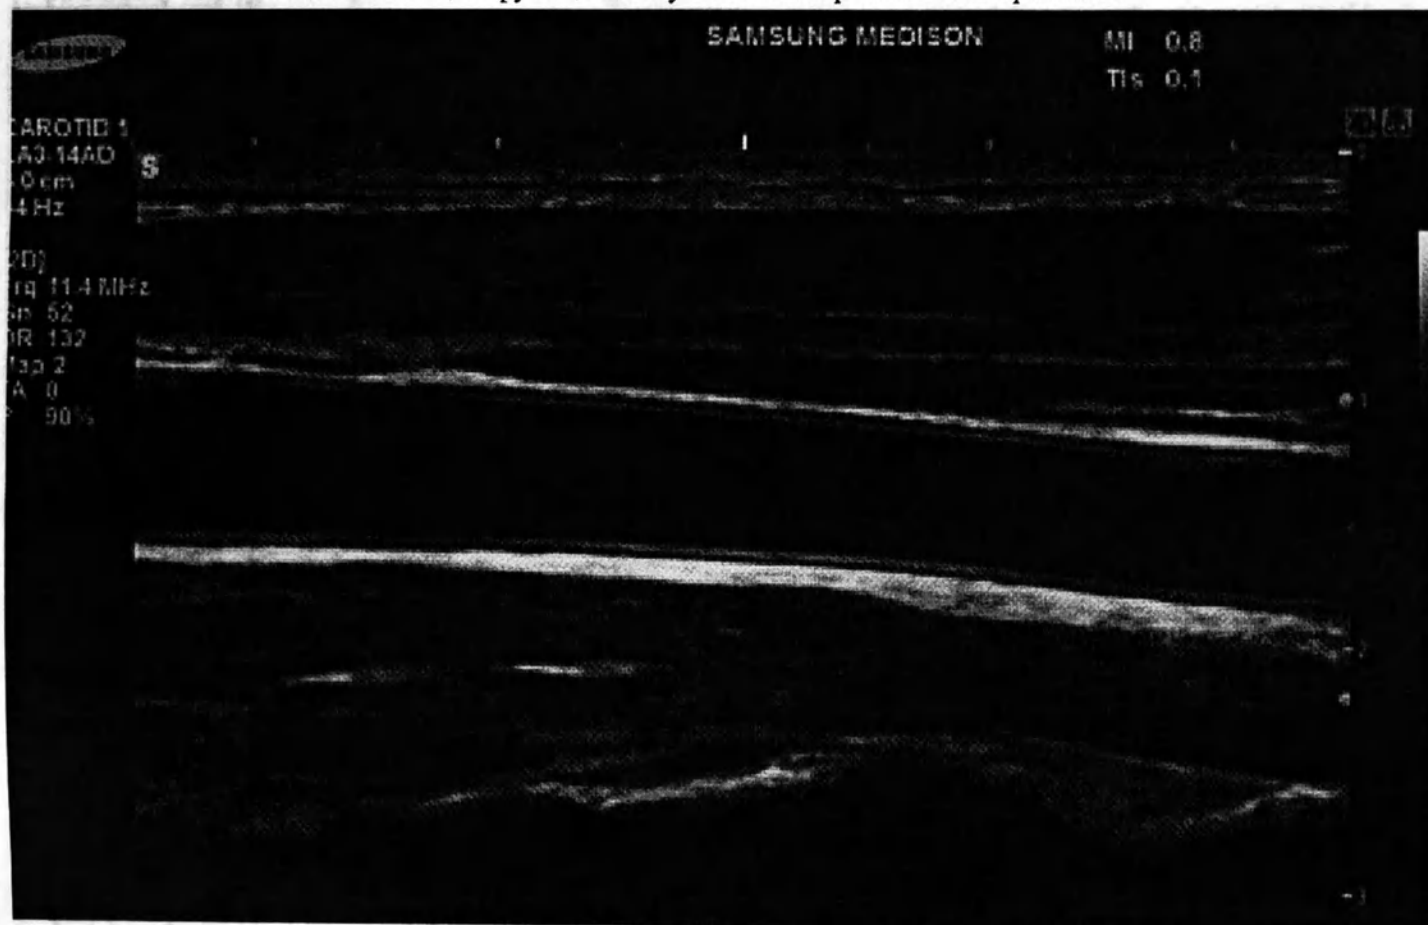


Лицензионный ключ для активации режима эластографии (Elastoscan)

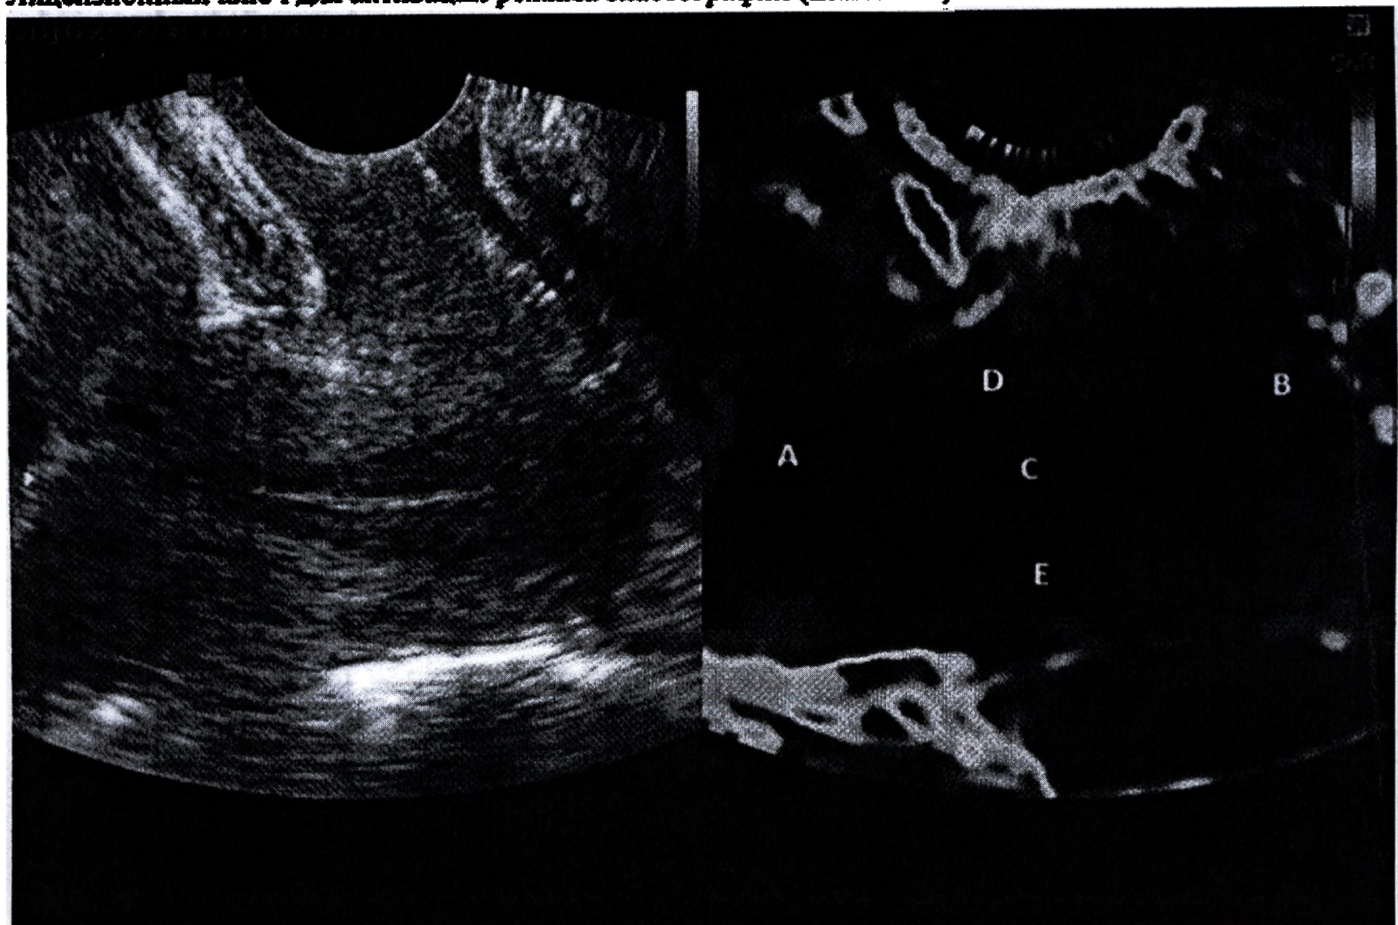


Лицензионный ключ для активации функции стресс-эхо

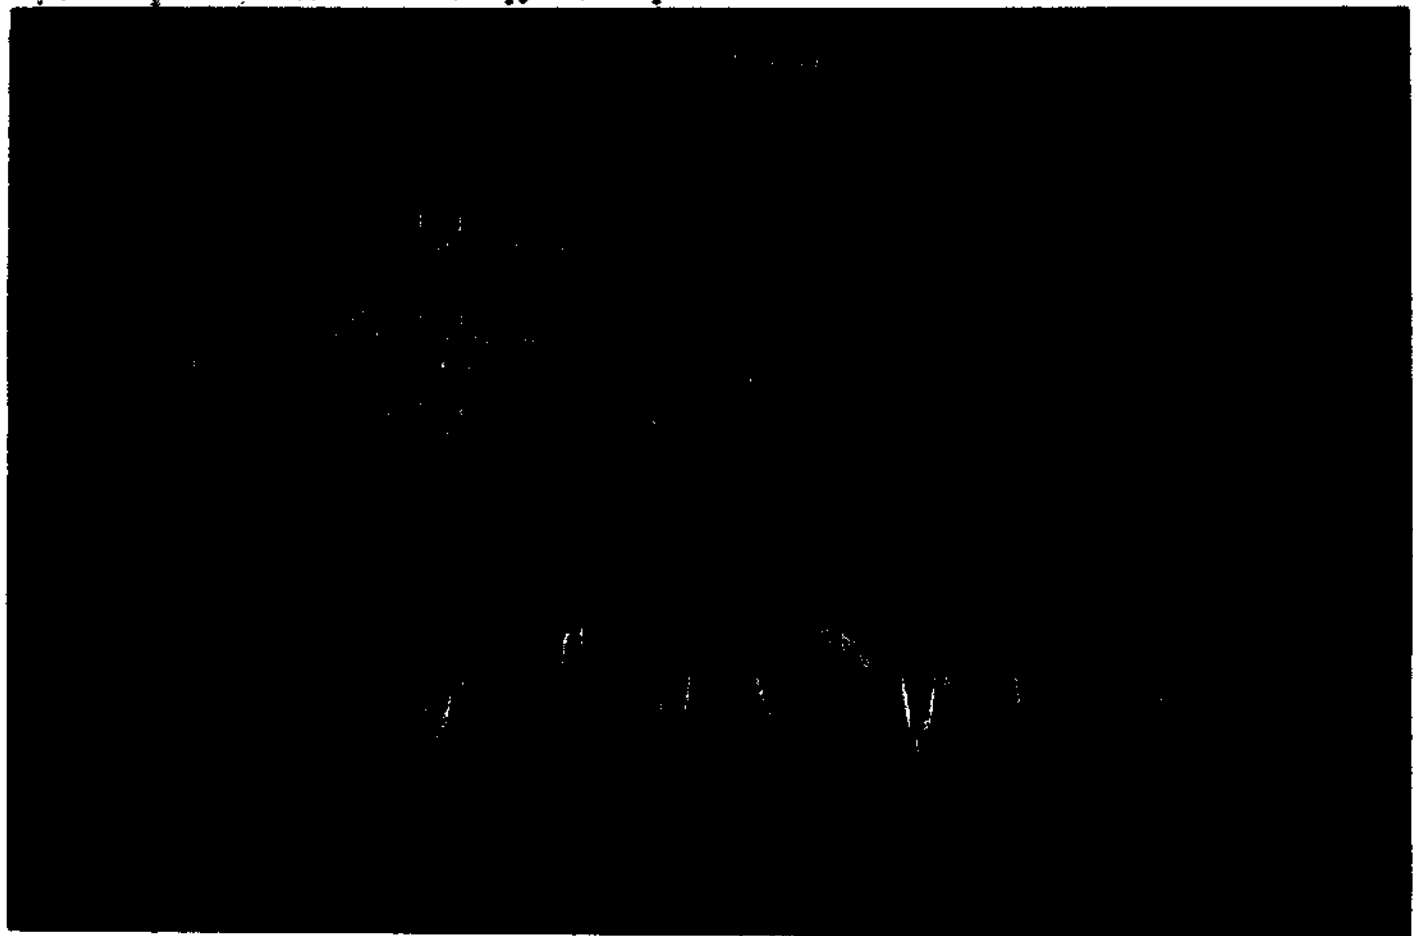

Лицензионный ключ для активации функции E-Cervix

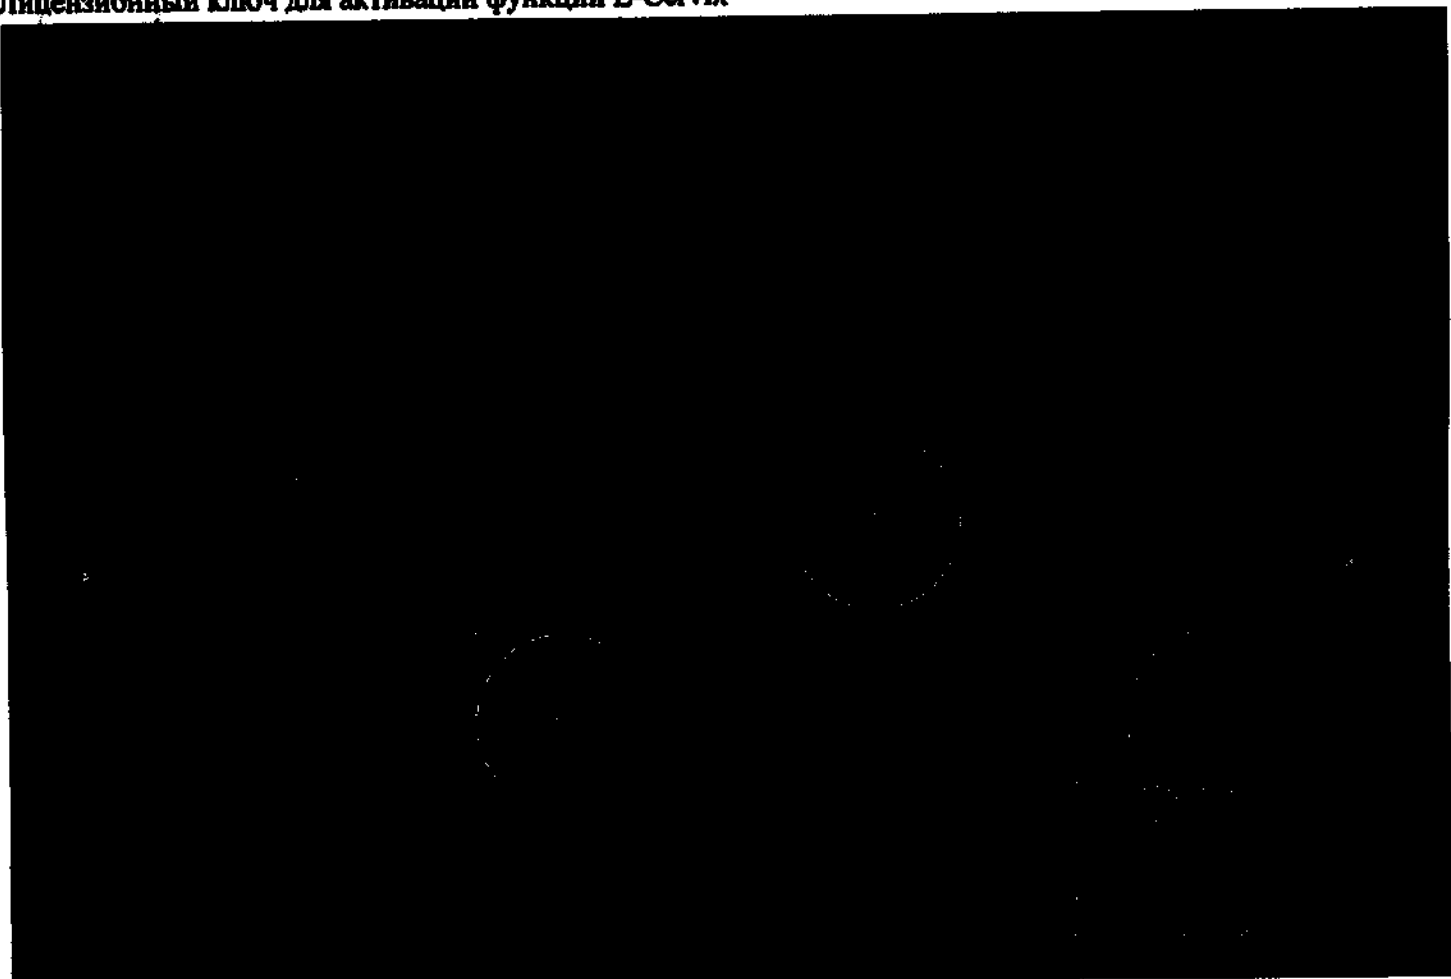

Лицензионный ключ для активации функции Needle Mate+

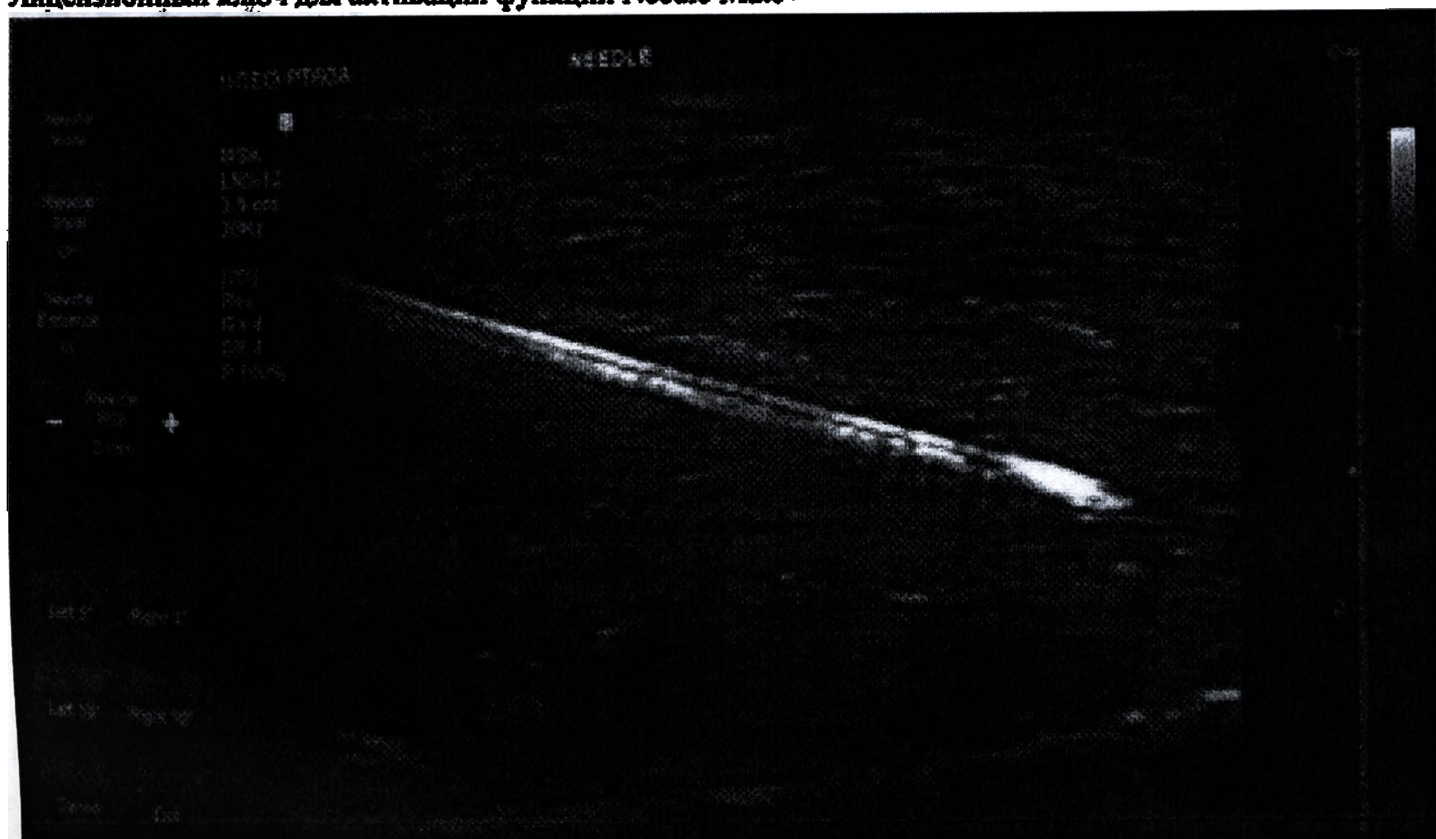

Лицензионный ключ для активации функции EZ Exam+



EZ Exam™ Designer mode




EZ Exam™ screen in liver exam


Лицензионный ключ для активации режима получения объемных данных в режиме реального времени 4D




Лицензионный ключ для активации режима обработки трехмерного изображения в 3DXI

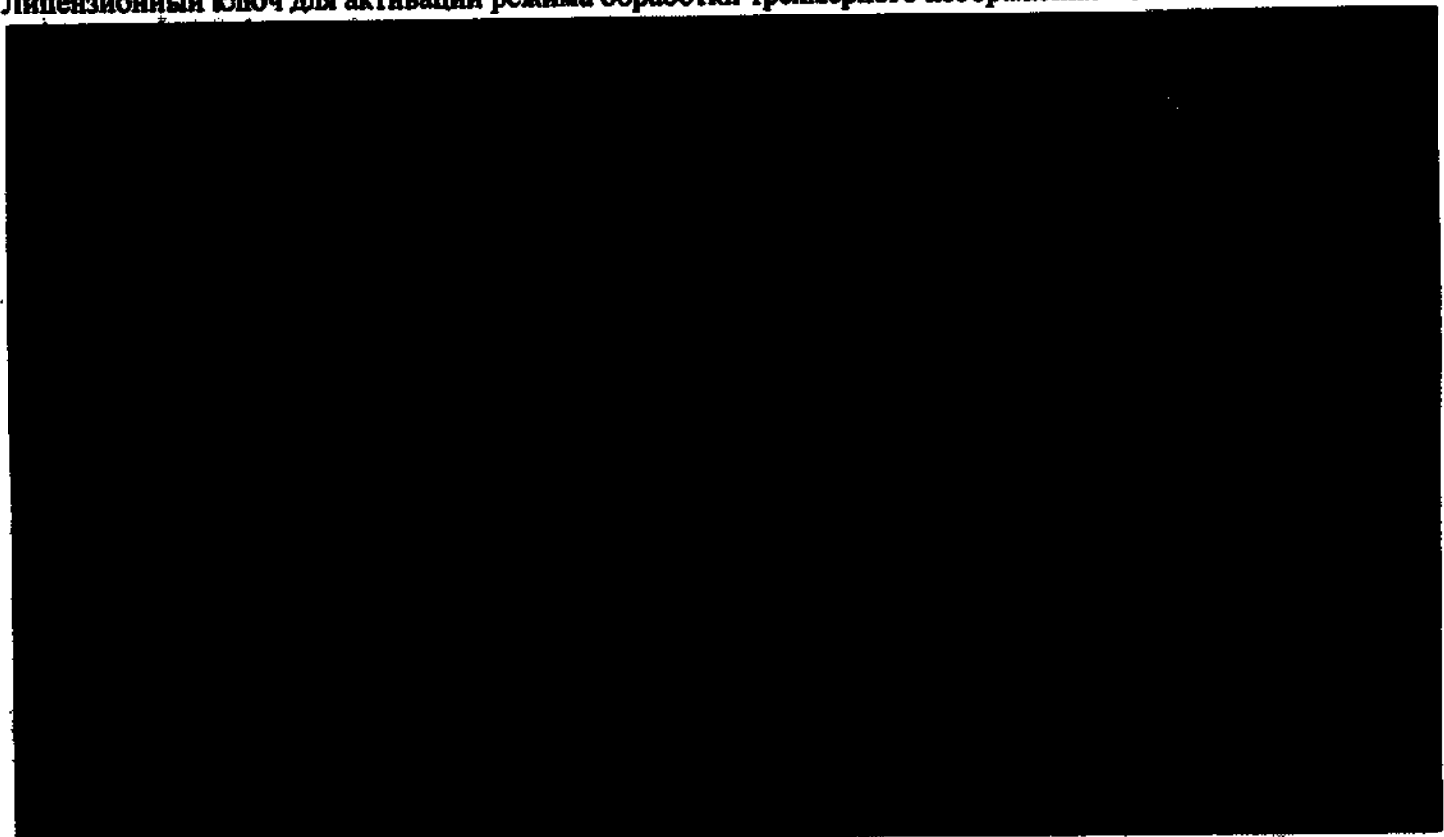


Лицензионный ключ для активации функции регистрации работы сердца плода в режиме XI STIC

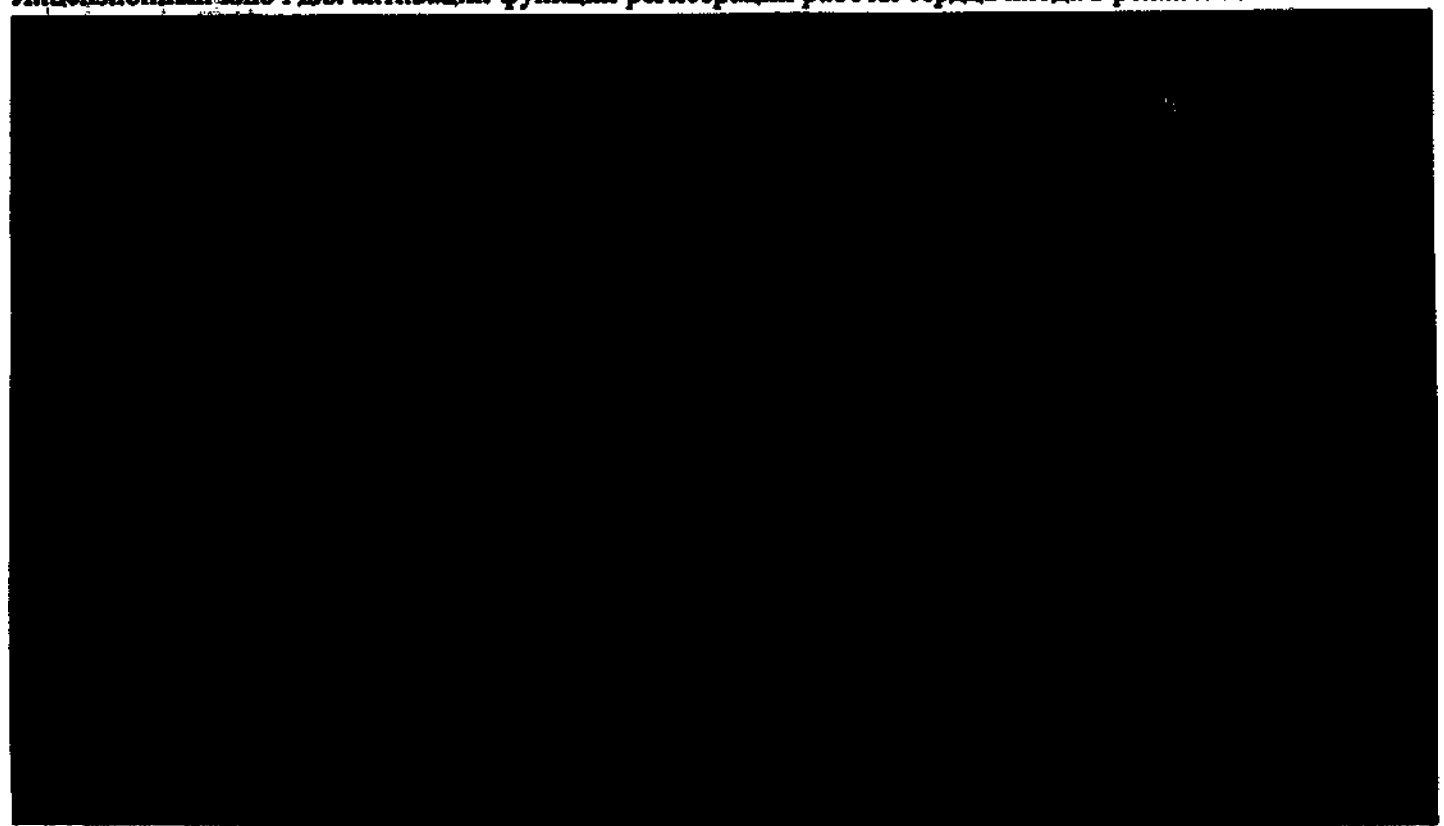

Лицензионный ключ для активации функции исследований в режиме постоянно-волнового доплера;

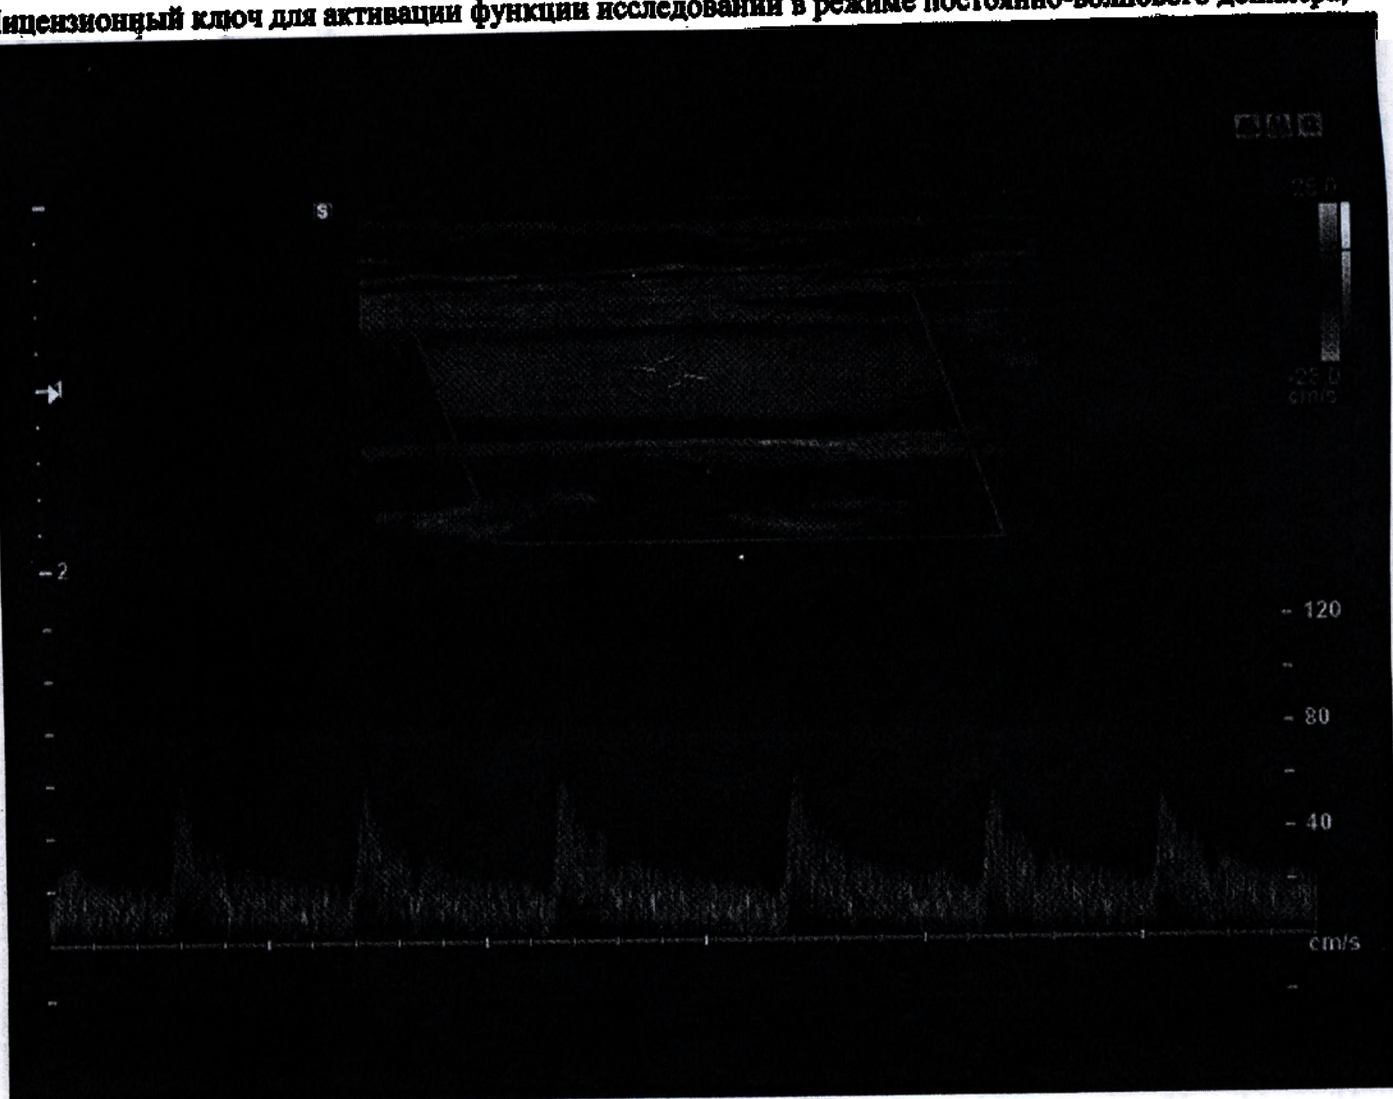

Лицензионный ключ для активации режима Realistic Vue;

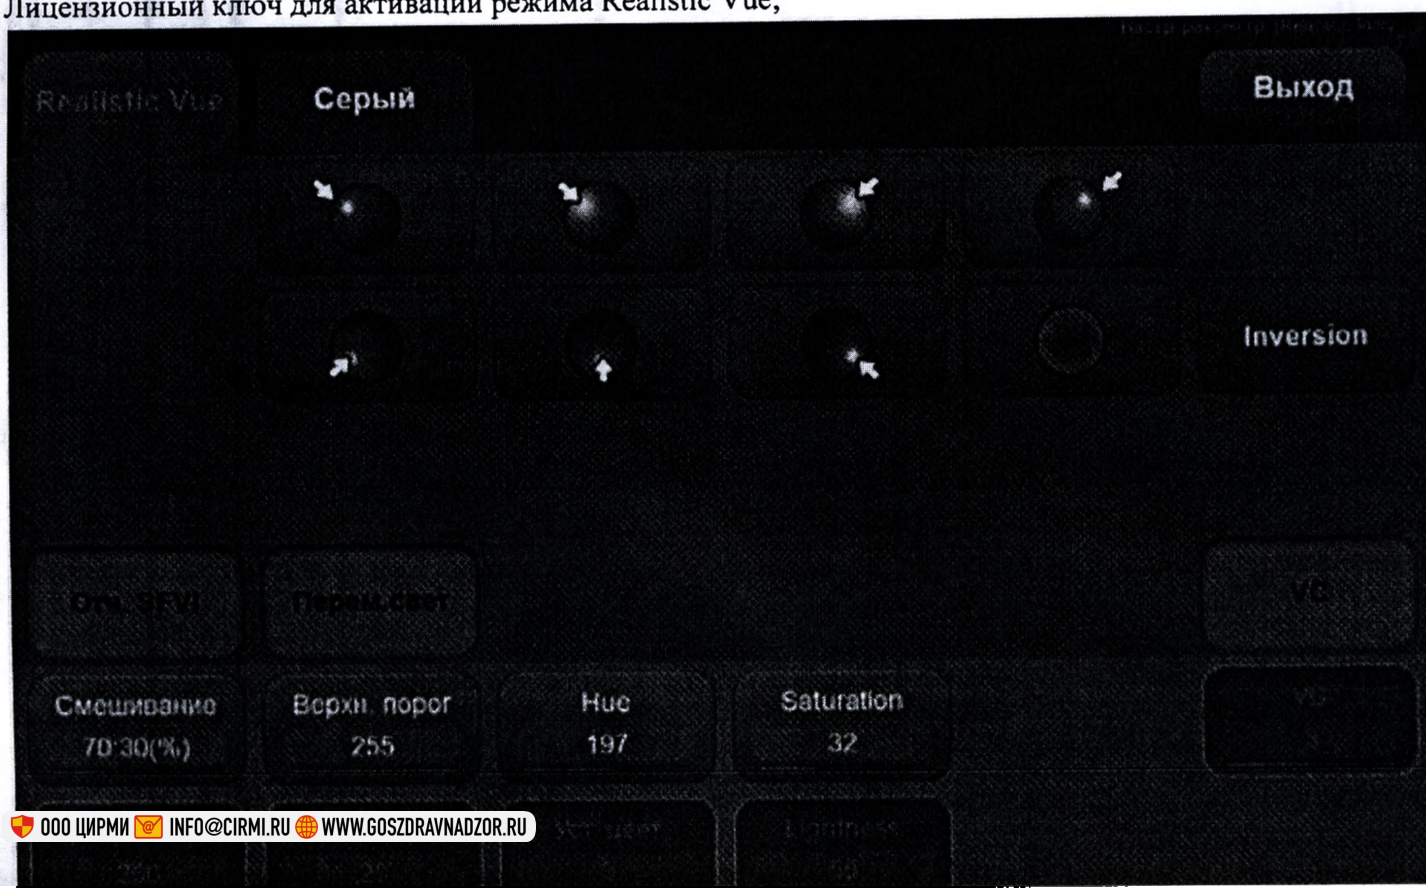


Лицензионный ключ для активации функции 5D NT;




Лицензионный ключ для активации функции 5D Follicle




Лицензионный ключ для активации функции 2D NT

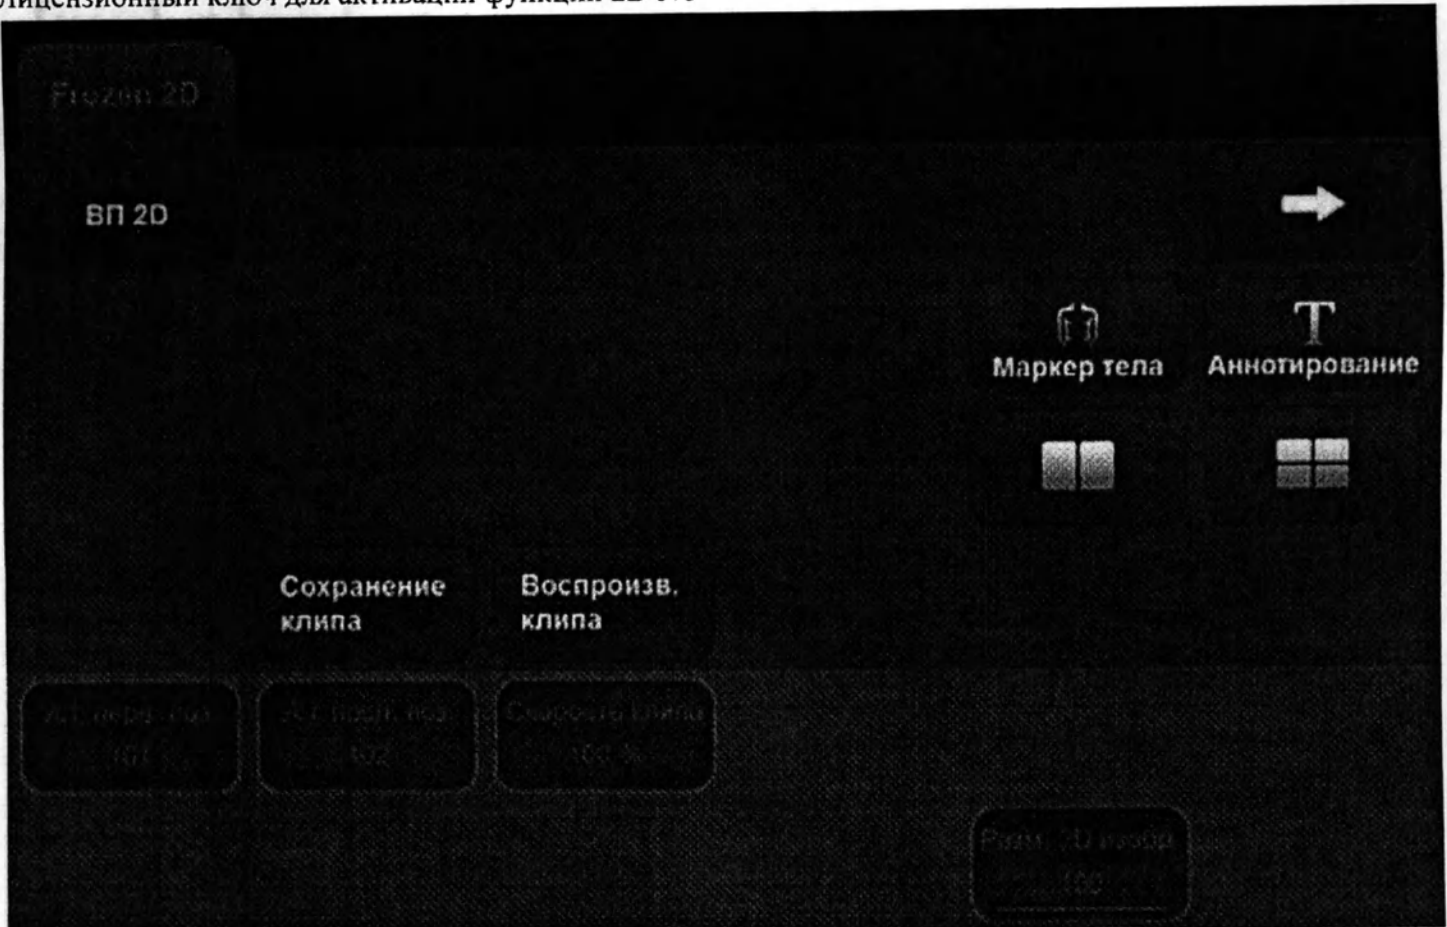

Лицензионный ключ для активации функции 3D MXI

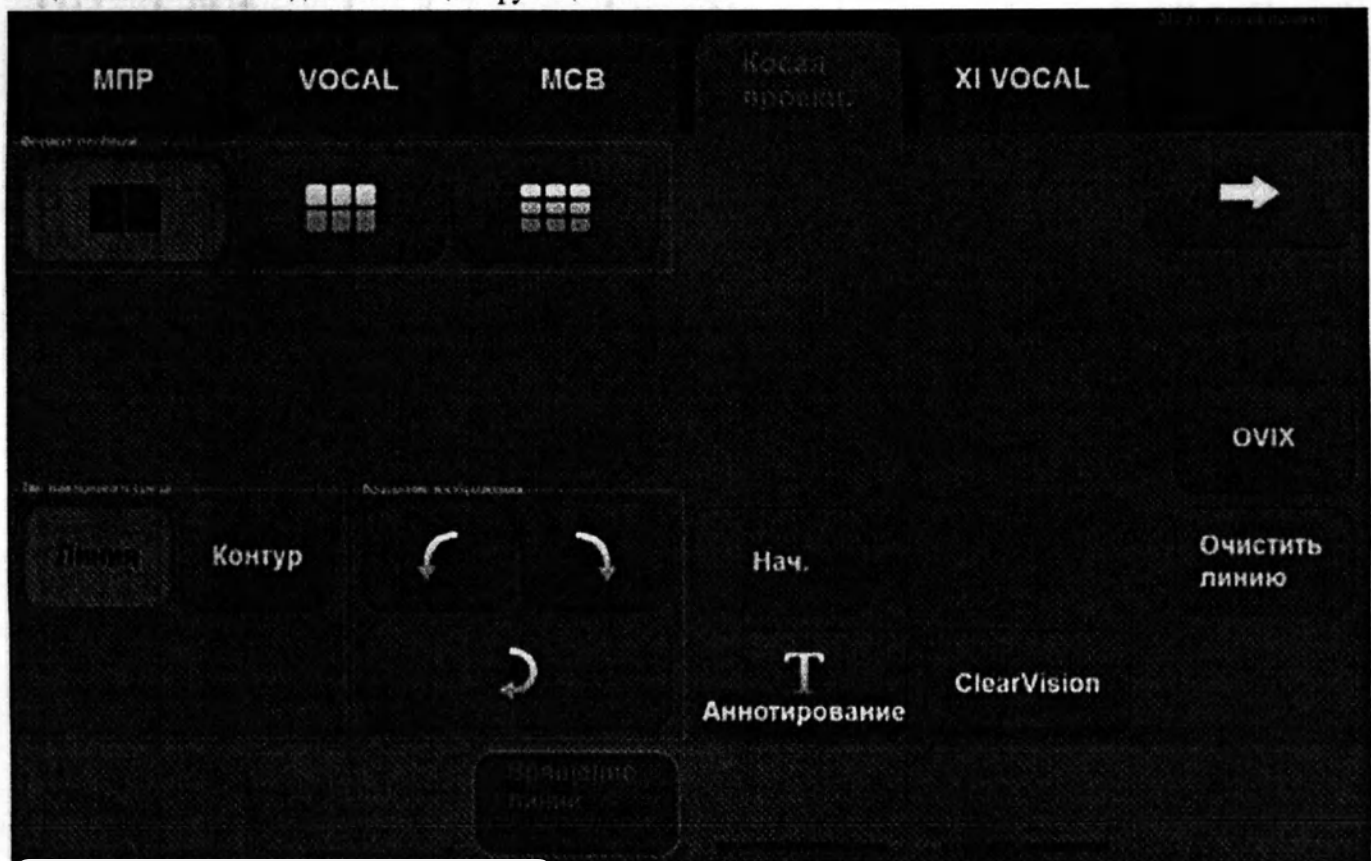


Лицензионный ключ для активации функции CEUS+

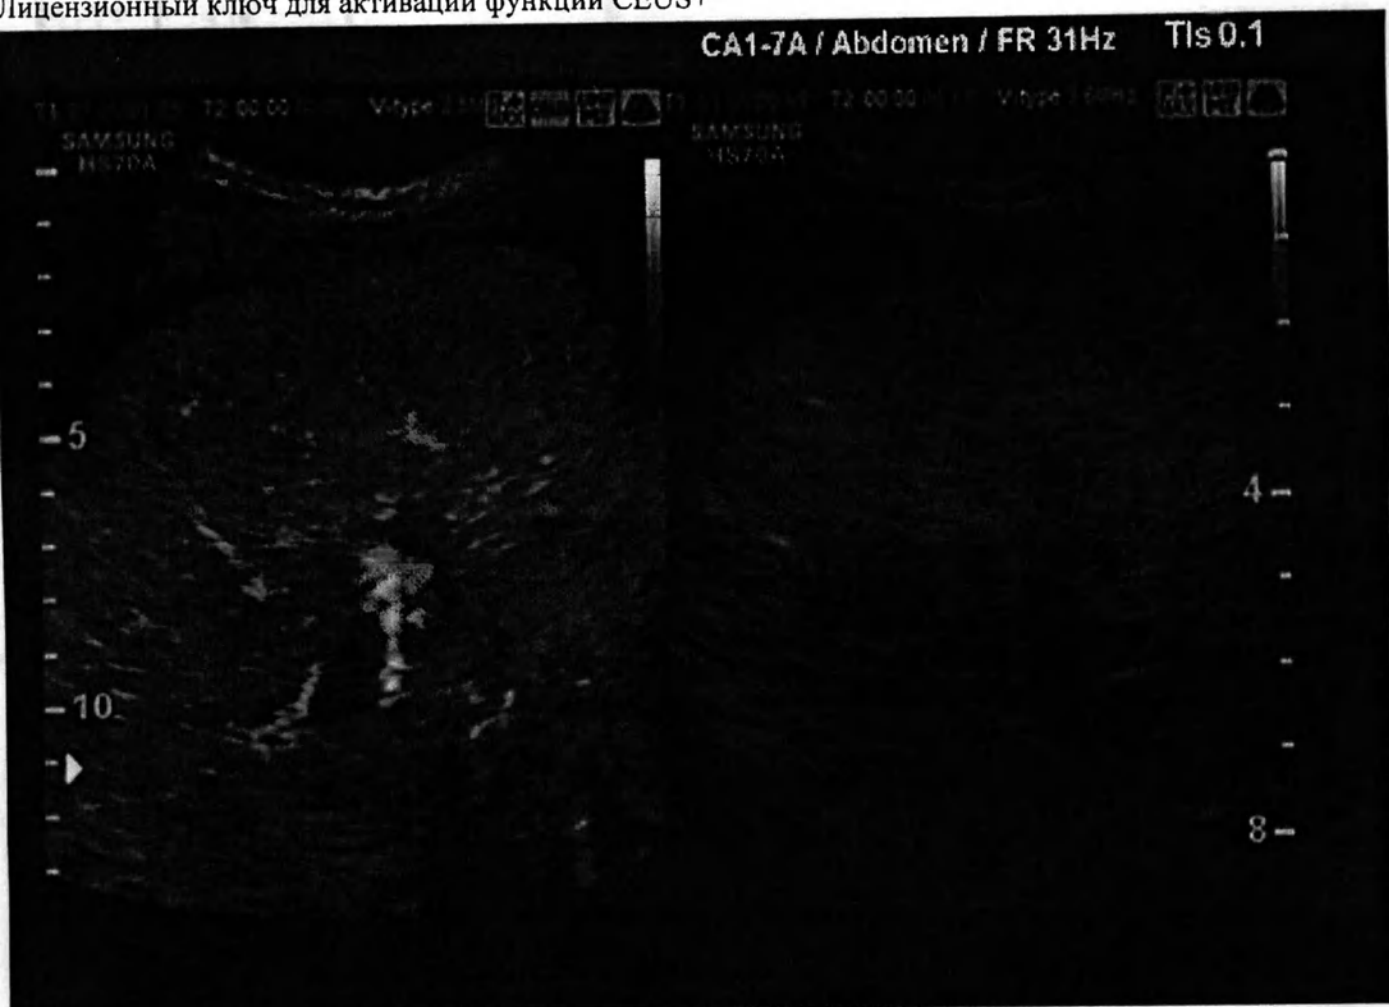

Лицензионный ключ для программы передачи данных Mobile export;




Лицензионный ключ для активации функции E-Strain

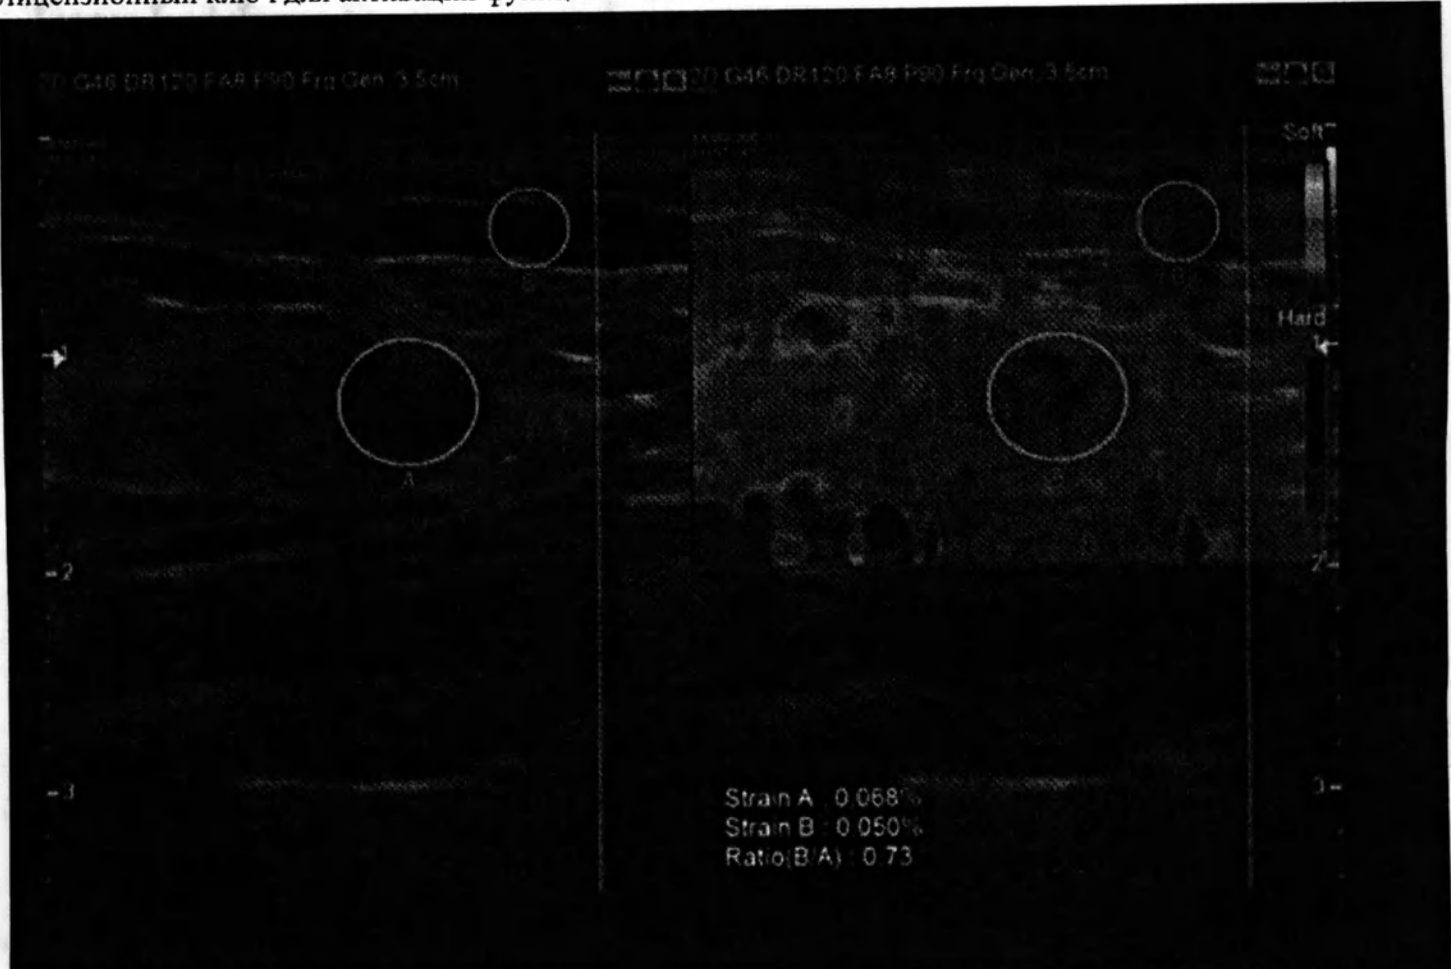


Лицензионный ключ для активации функции Strain+




Лицензионный ключ для активации функции S-Detect для молочной железы

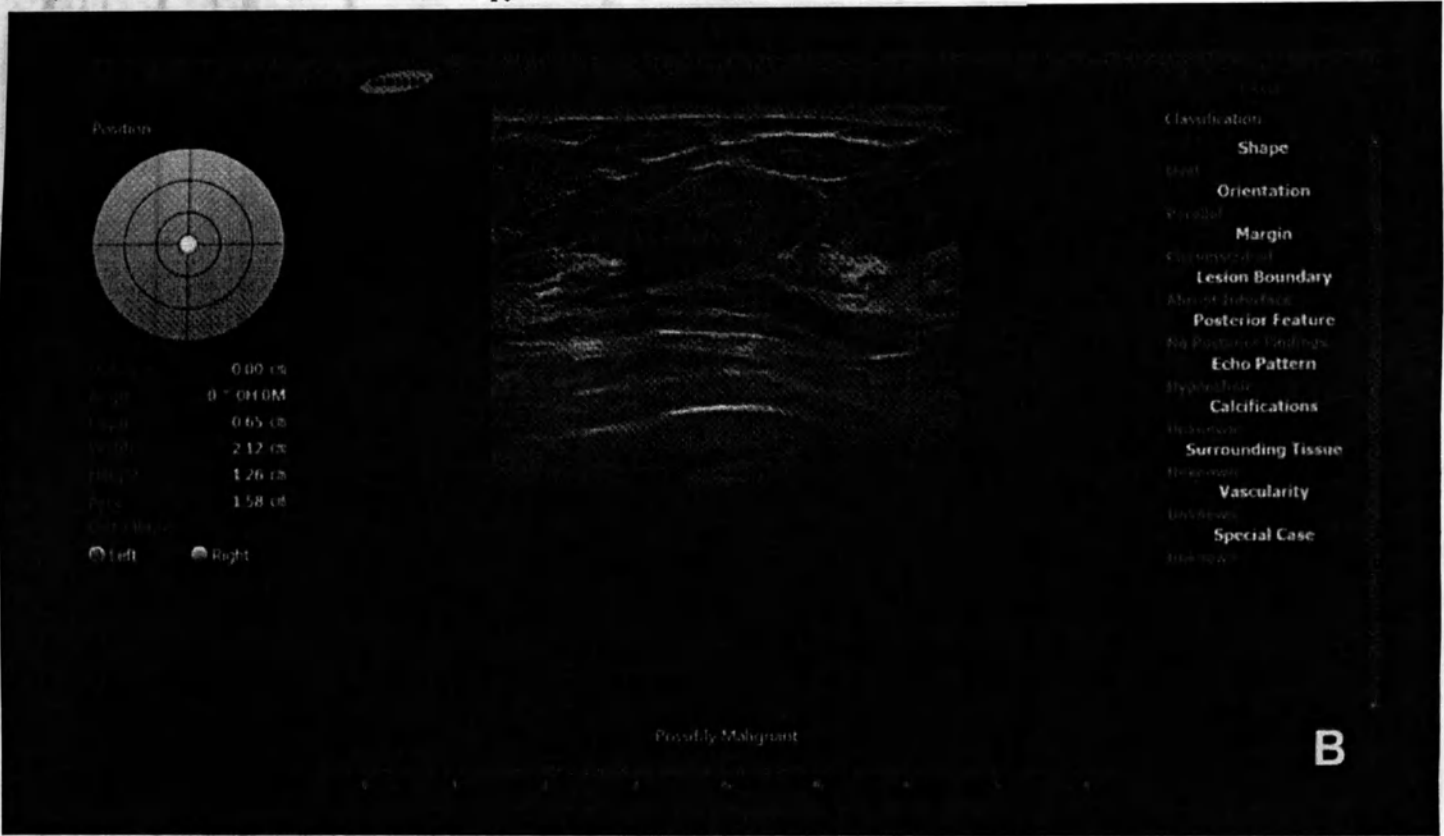


Лицензионный ключ для активации функции S-Detect для щитовидной железы

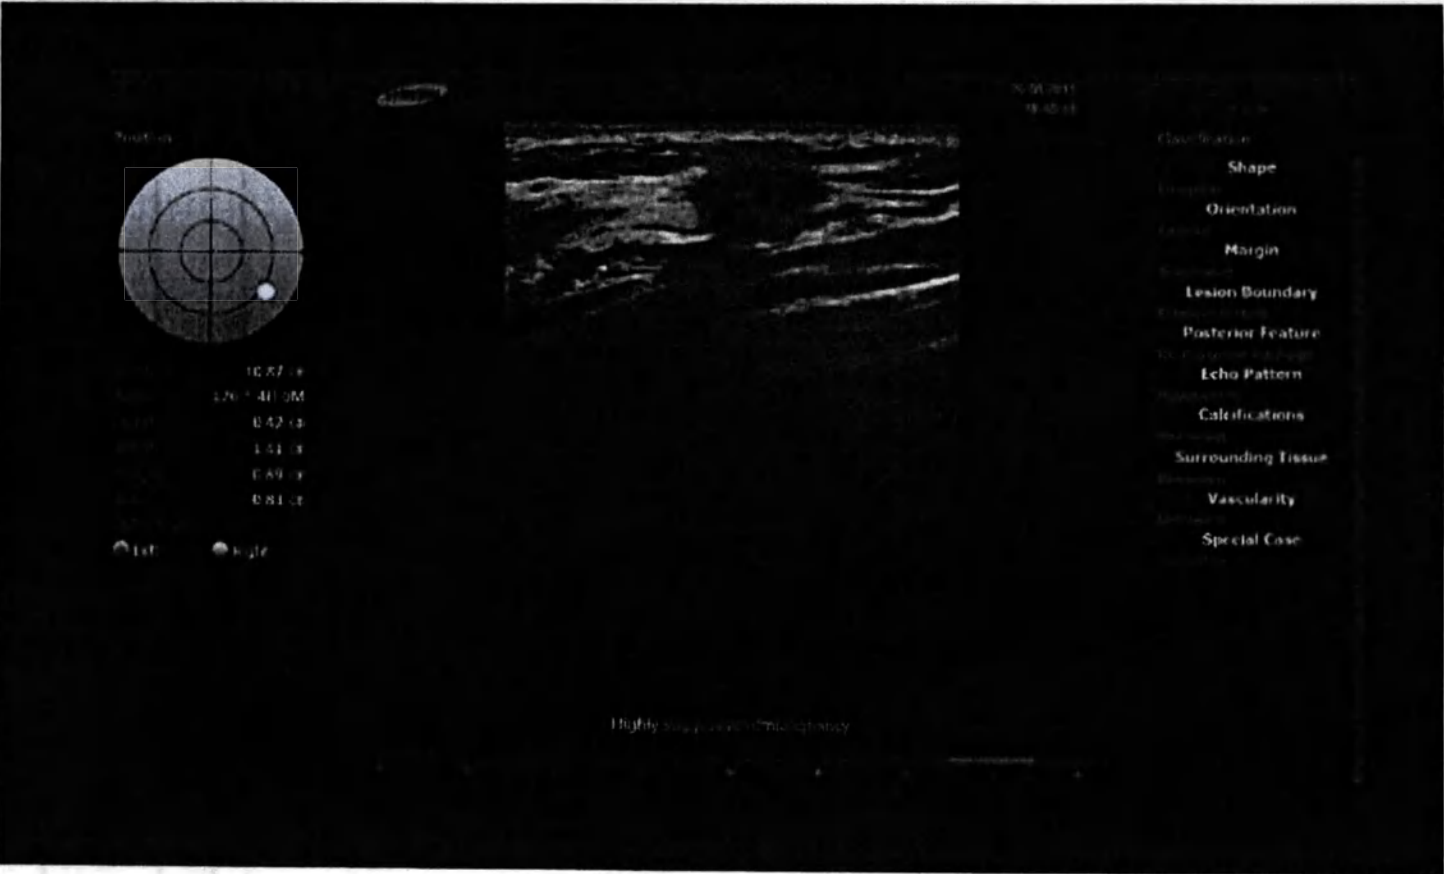

Лицензионный ключ для активации функции E-Thyroi

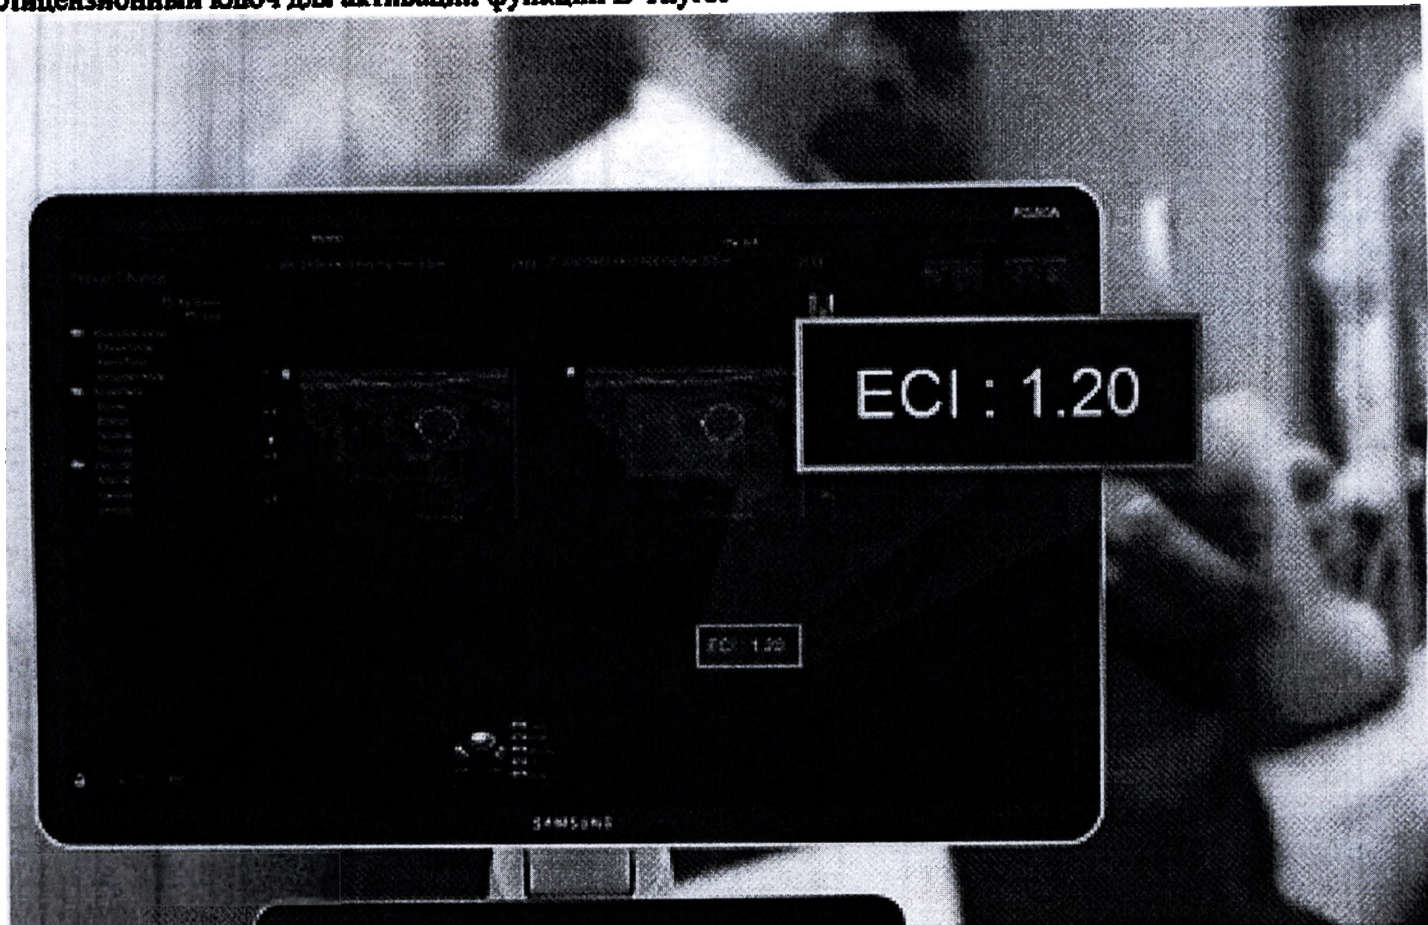

Лицензионный ключ для активации функции BiometryAssist

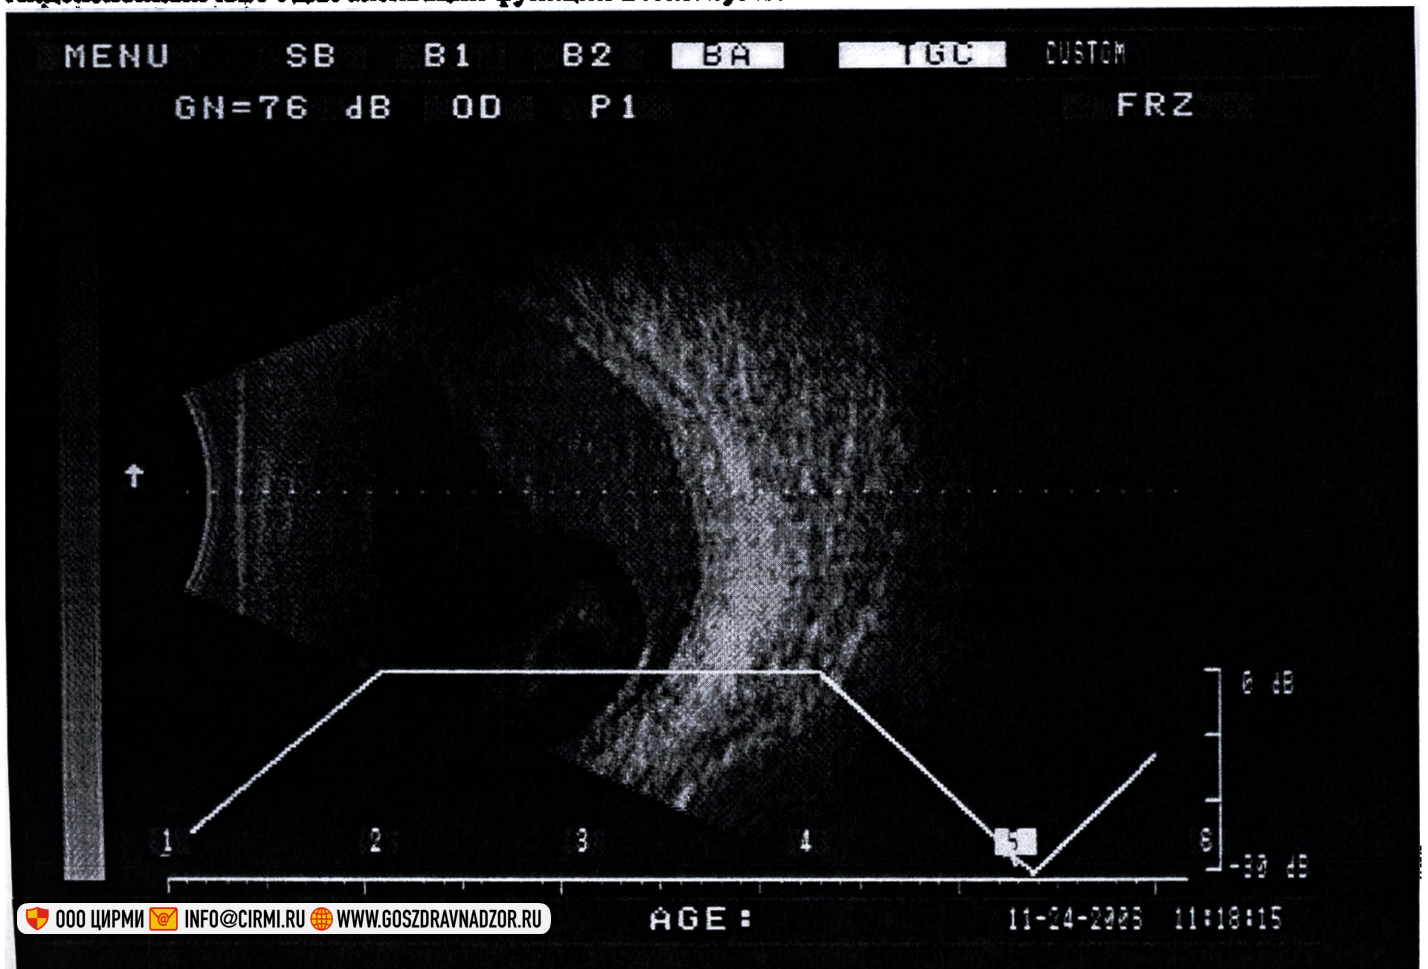

Лицензионный ключ для активации функции DICOM Q&R

Установка

Общие Свойства Директор Директорские параметры Интеграция DICOM Утилиты Интеграция

Настройка DICOM

Имя AE: Имя AE Title: Назначение станции: Фот. Screen Name:

Тел. порта: 301

Имя сервера	Соединение	Имя AE	IP Адрес	Порт	Запрос	Правка

Добавить Удалить Изменить

Формат отправки DICOM

2D режим: ☐ Цветной: ☐

Режим ЦИК: ☐ Цветная: ☐

Компр. DICOM

Метод сжатия: Имя:

ОК Отмена

Лицензионный ключ для активации функции IOTA-Adnex (International Ovarian Tumor Analysis - международный анализ опухолей яичников)

Установка

Общие Свойства Директор Директорские параметры Интеграция DICOM Утилиты Интеграция

Настройка IOTA-Adnex

Имя сервера: Соединение: Имя AE: IP Адрес: Порт: Запрос: Правка:

Добавить Удалить Изменить

Формат отправки IOTA-Adnex

2D режим: ☐ Цветной: ☐


Режим ЦИК: ☐ Цветная: ☐

Компр. IOTA-Adnex


Метод сжатия: Имя:

ОК Отмена


Лицензионный ключ для активации функции HQ Vision (получение изображения высокого разрешения)




ЭКГ модуль;

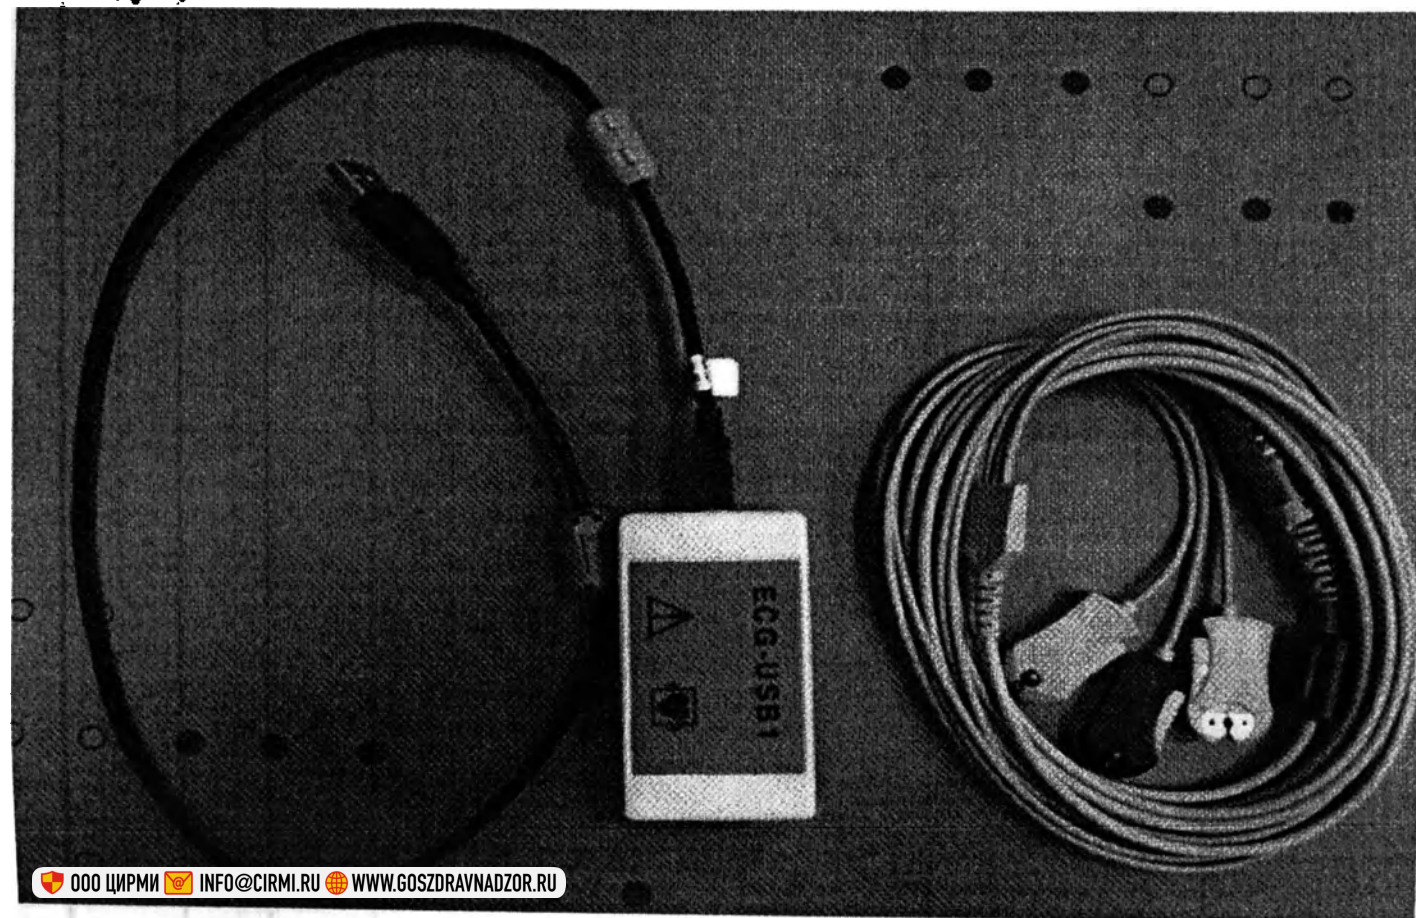


Кабель заземления

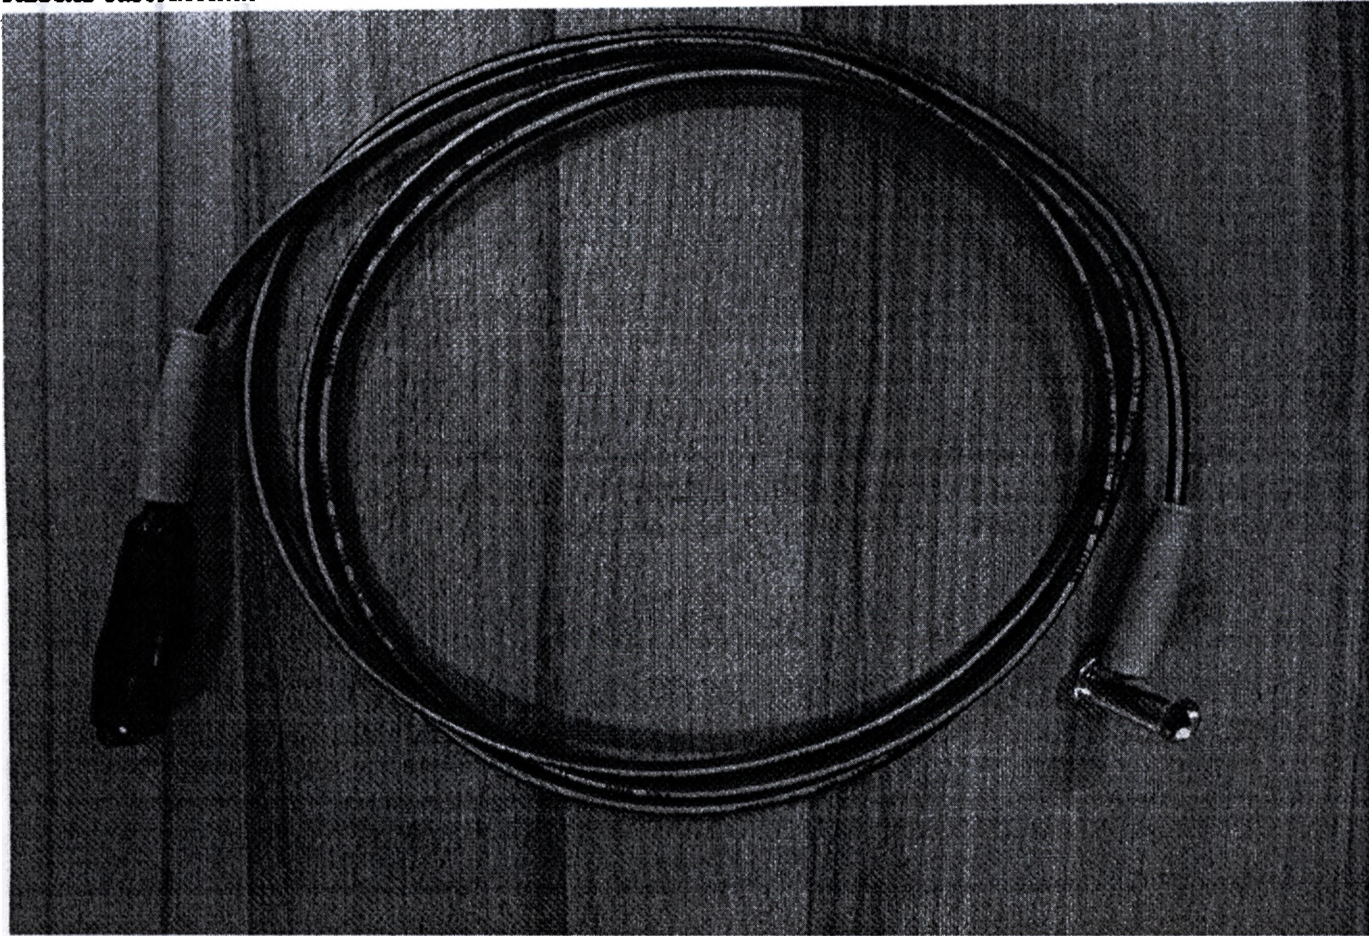


Соединительные провода и кабели.

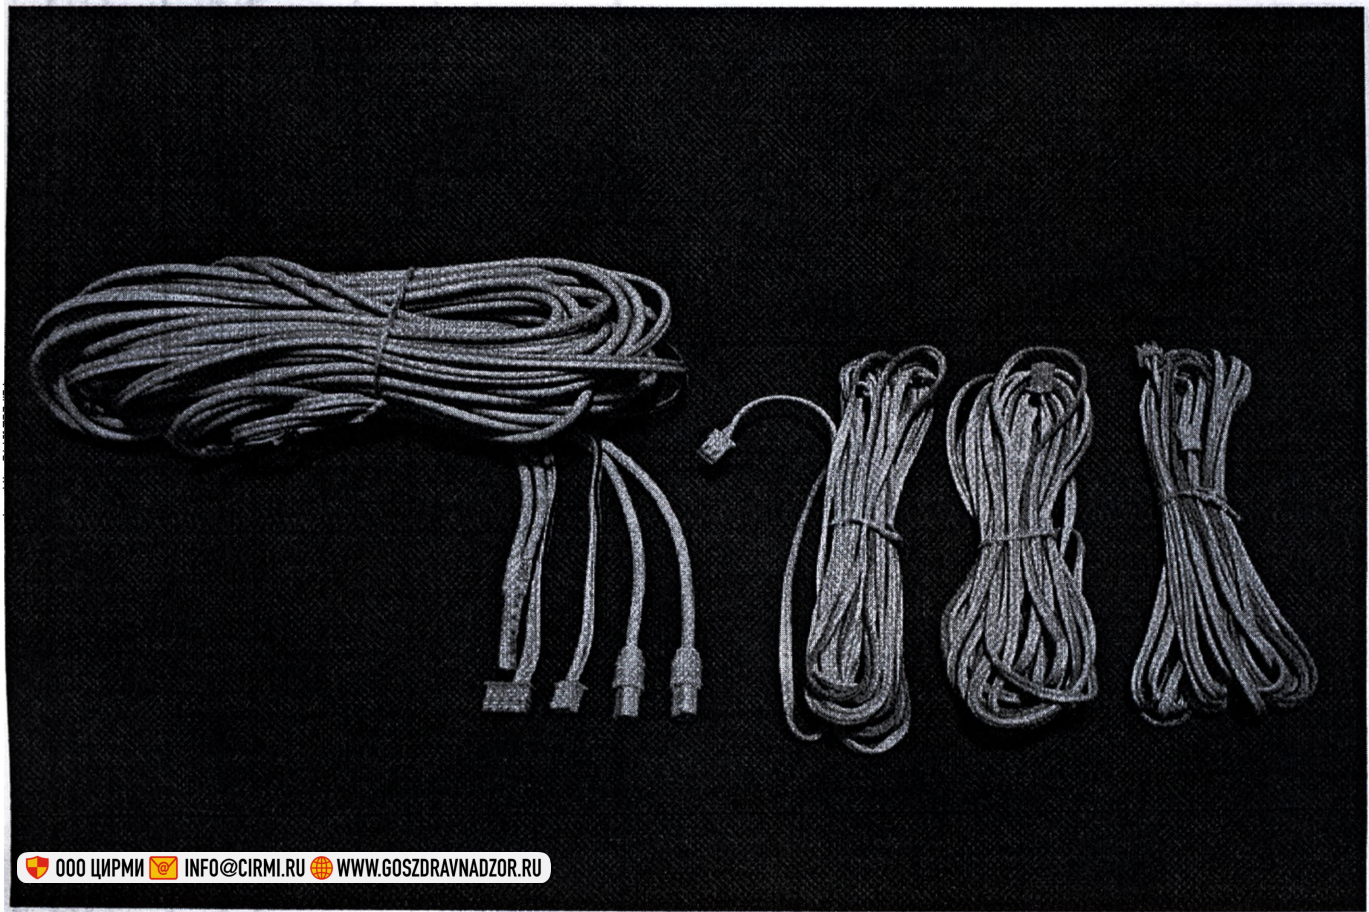

Ножной переключатель

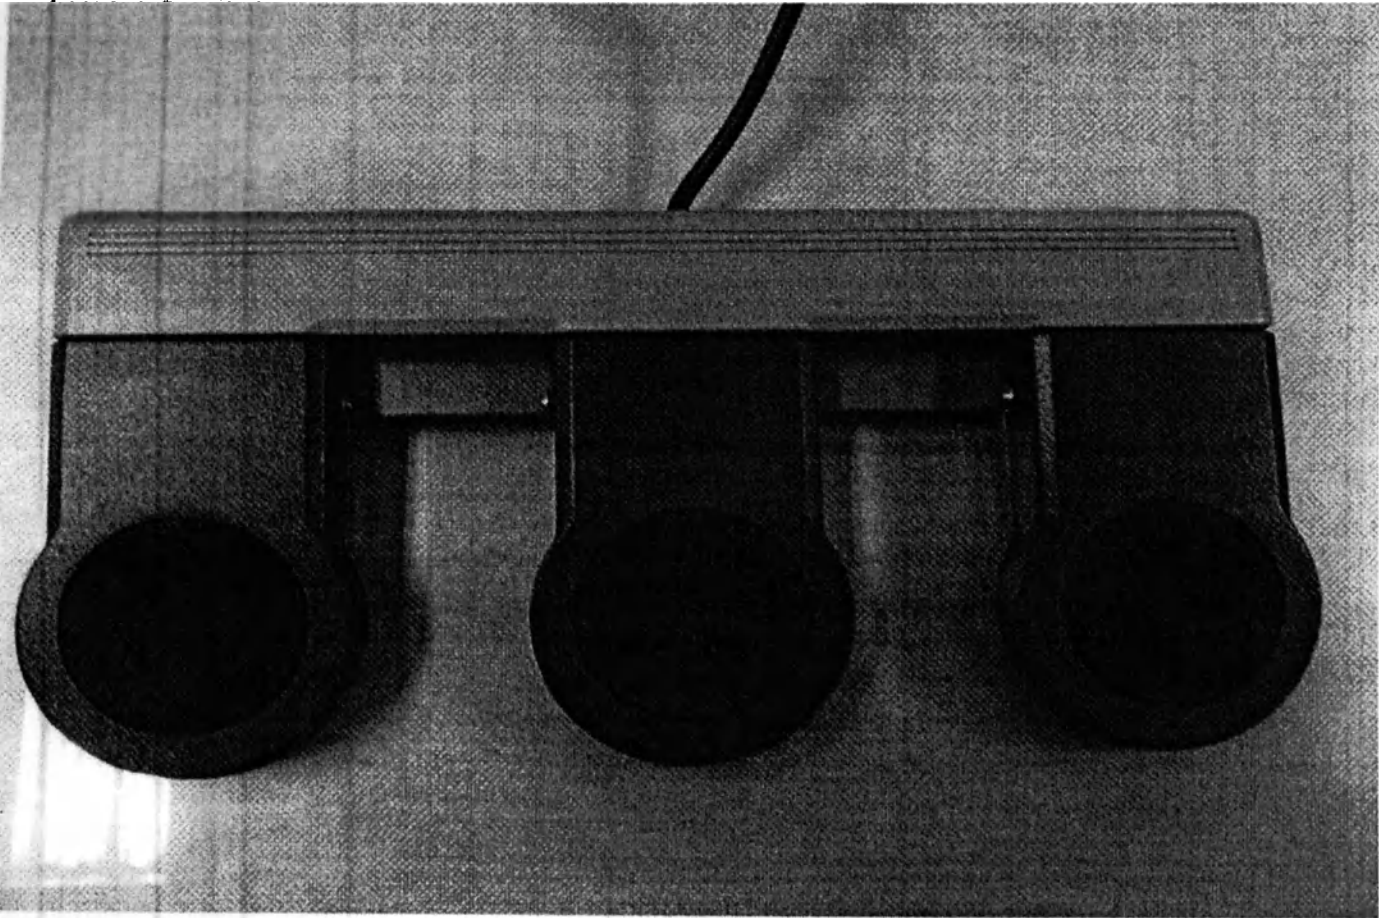

Подогреватель геля

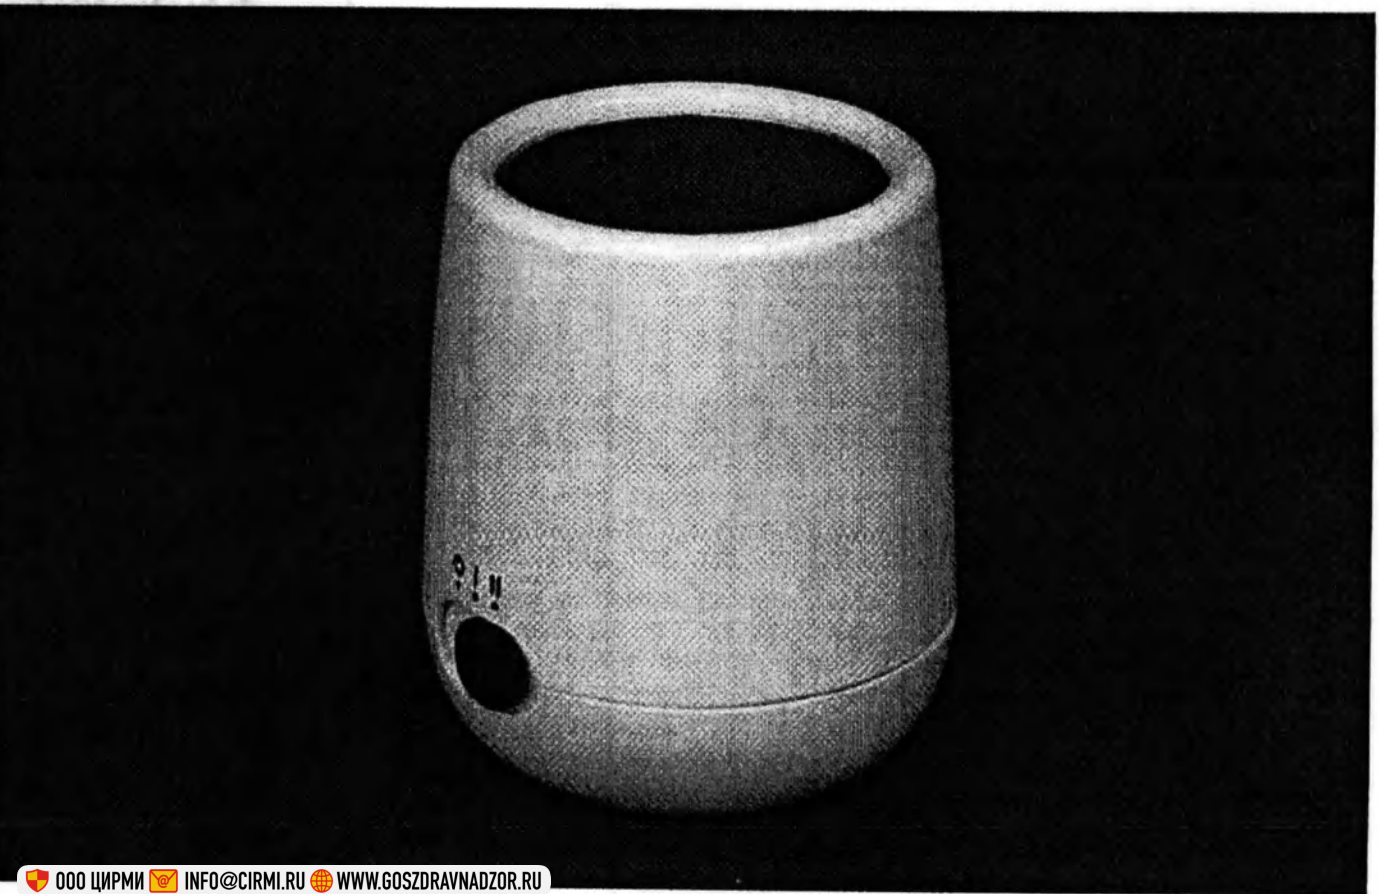

Лоток для принтера (большой / малый)

