

Руководитель направления по регистрации
продукции для диагностической визуализации,
высокотехнологичной терапии и ультразвуковой диагностики



ООО «Сименс Здравоохранение»


«Сименс Здравоохранение» Е. С. Тисленко

«15» июля 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Аппарат передвижной рентгеновский цифровой С-дуга для рентгеноскопии «Cios Fusion» с принадлежностями»

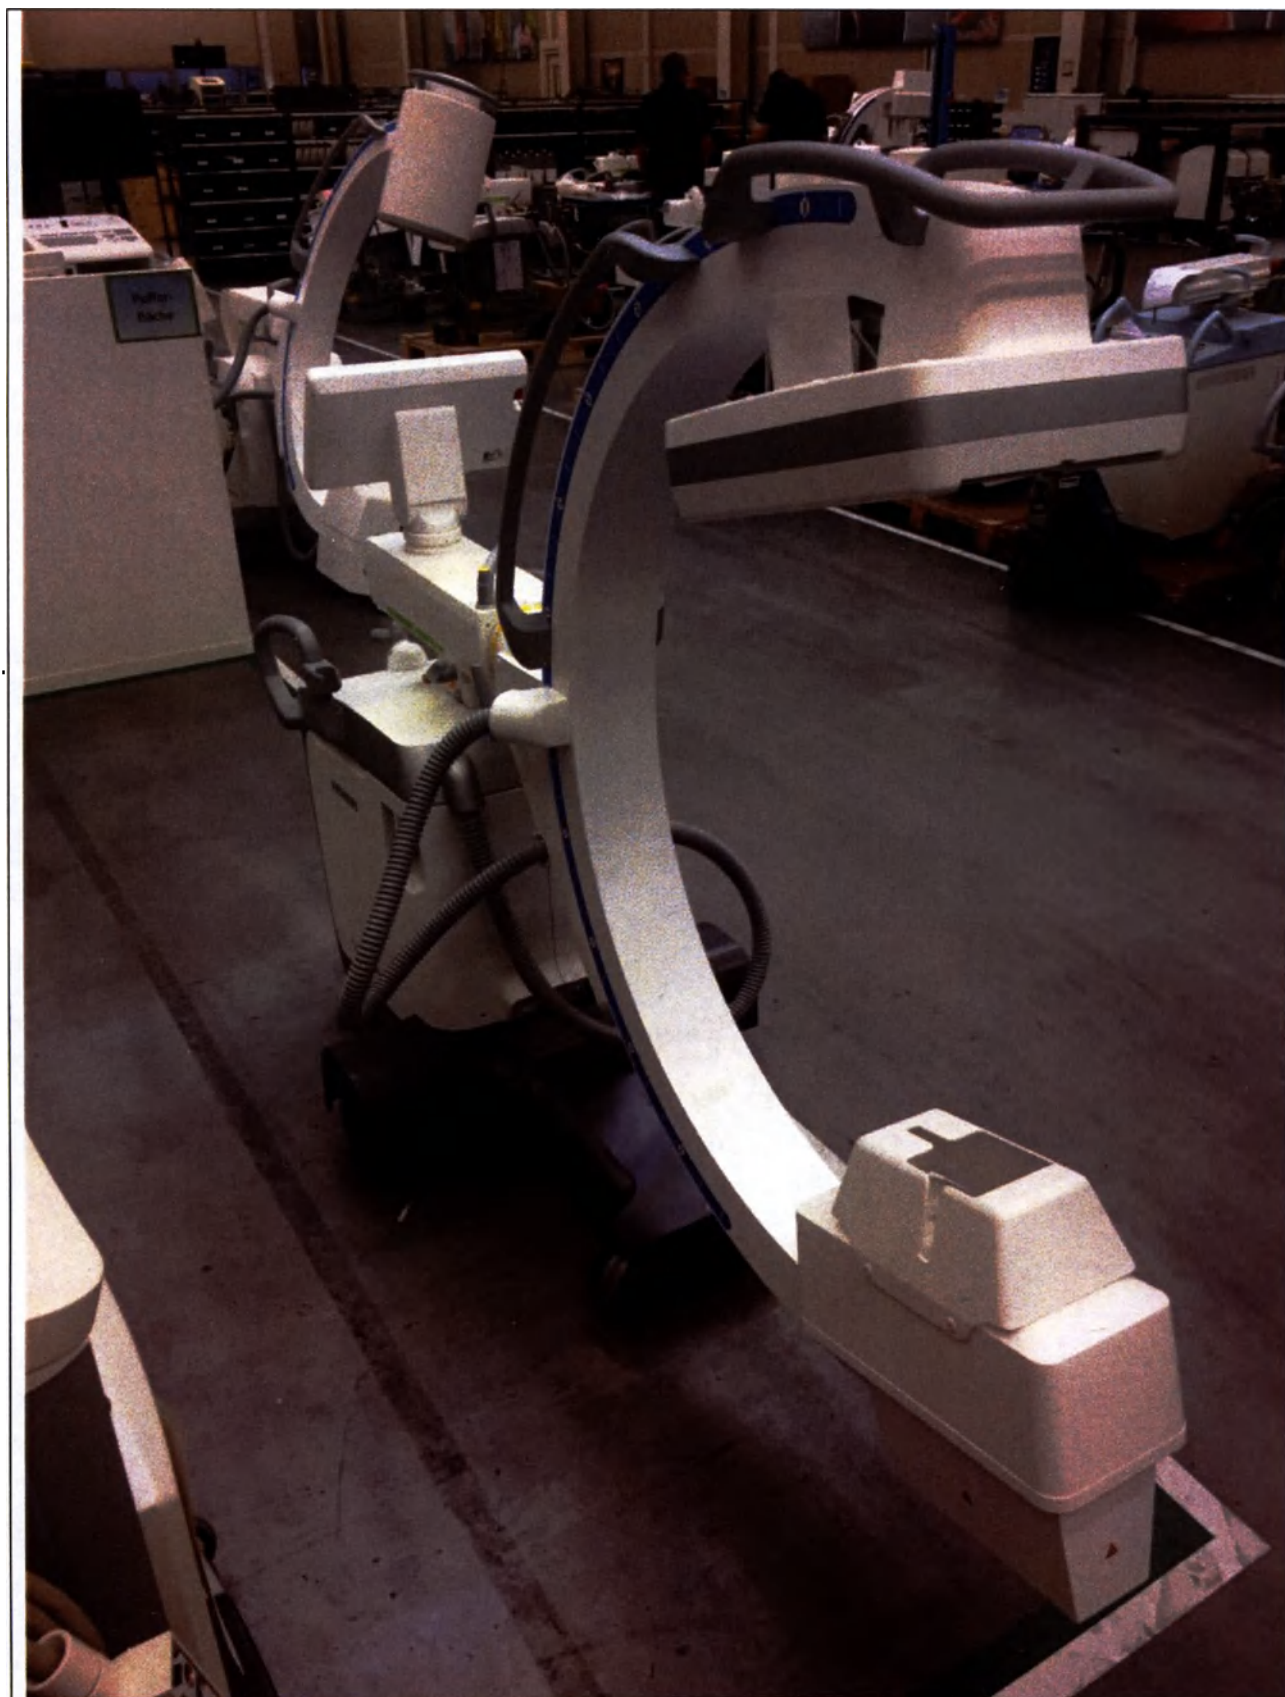

Общий вид медицинского изделия «Аппарат передвижной рентгеновский цифровой С-дуга для рентгеноскопии «Clos Fusion» с принадлежностями»

Базовый блок



1.1 С-образная дуга с рентгеновским генератором, рентгеновской трубкой с фиксированным анодом, блоком управления, ручным переключателем и плоским детектором, варианты исполнения: плоский детектор 20 x 20 см или плоский детектор 30 x 30 см.



1.2 С-образная дуга с рентгеновским генератором, рентгеновской трубкой с фиксированным анодом, блоком управления, ручным переключателем и плоским детектором, варианты исполнения: плоский детектор 20 x 20 см или плоский детектор 30 x 30 см.



1.3 С-образная дуга с рентгеновским генератором, рентгеновской трубкой с фиксированным анодом, блоком управления, ручным переключателем и плоским детектором, варианты исполнения: плоский детектор 20 x 20 см или плоский детектор 30 x 30 см.




1.4 С-образная дуга с рентгеновским генератором, рентгеновской трубкой с фиксированным анодом, блоком управления, ручным переключателем и плоским детектором, варианты исполнения: плоский детектор 20 x 20 см или плоский детектор 30 x 30 см.



2.1 Мониторная стойка, в составе: штатив мониторов, варианты исполнения стойка дисплея Flex или стойка дисплея Flex Plus; панель управления с сенсорным экраном, мышь, порт USB, монитор, дисковод для дисков DVD.




2.2 Мониторная стойка, в составе: штатив мониторов, варианты исполнения стойка дисплея Flex или стойка дисплея Flex Plus; панель управления с сенсорным экраном, мышь, порт USB, монитор, дисковод для дисков DVD.

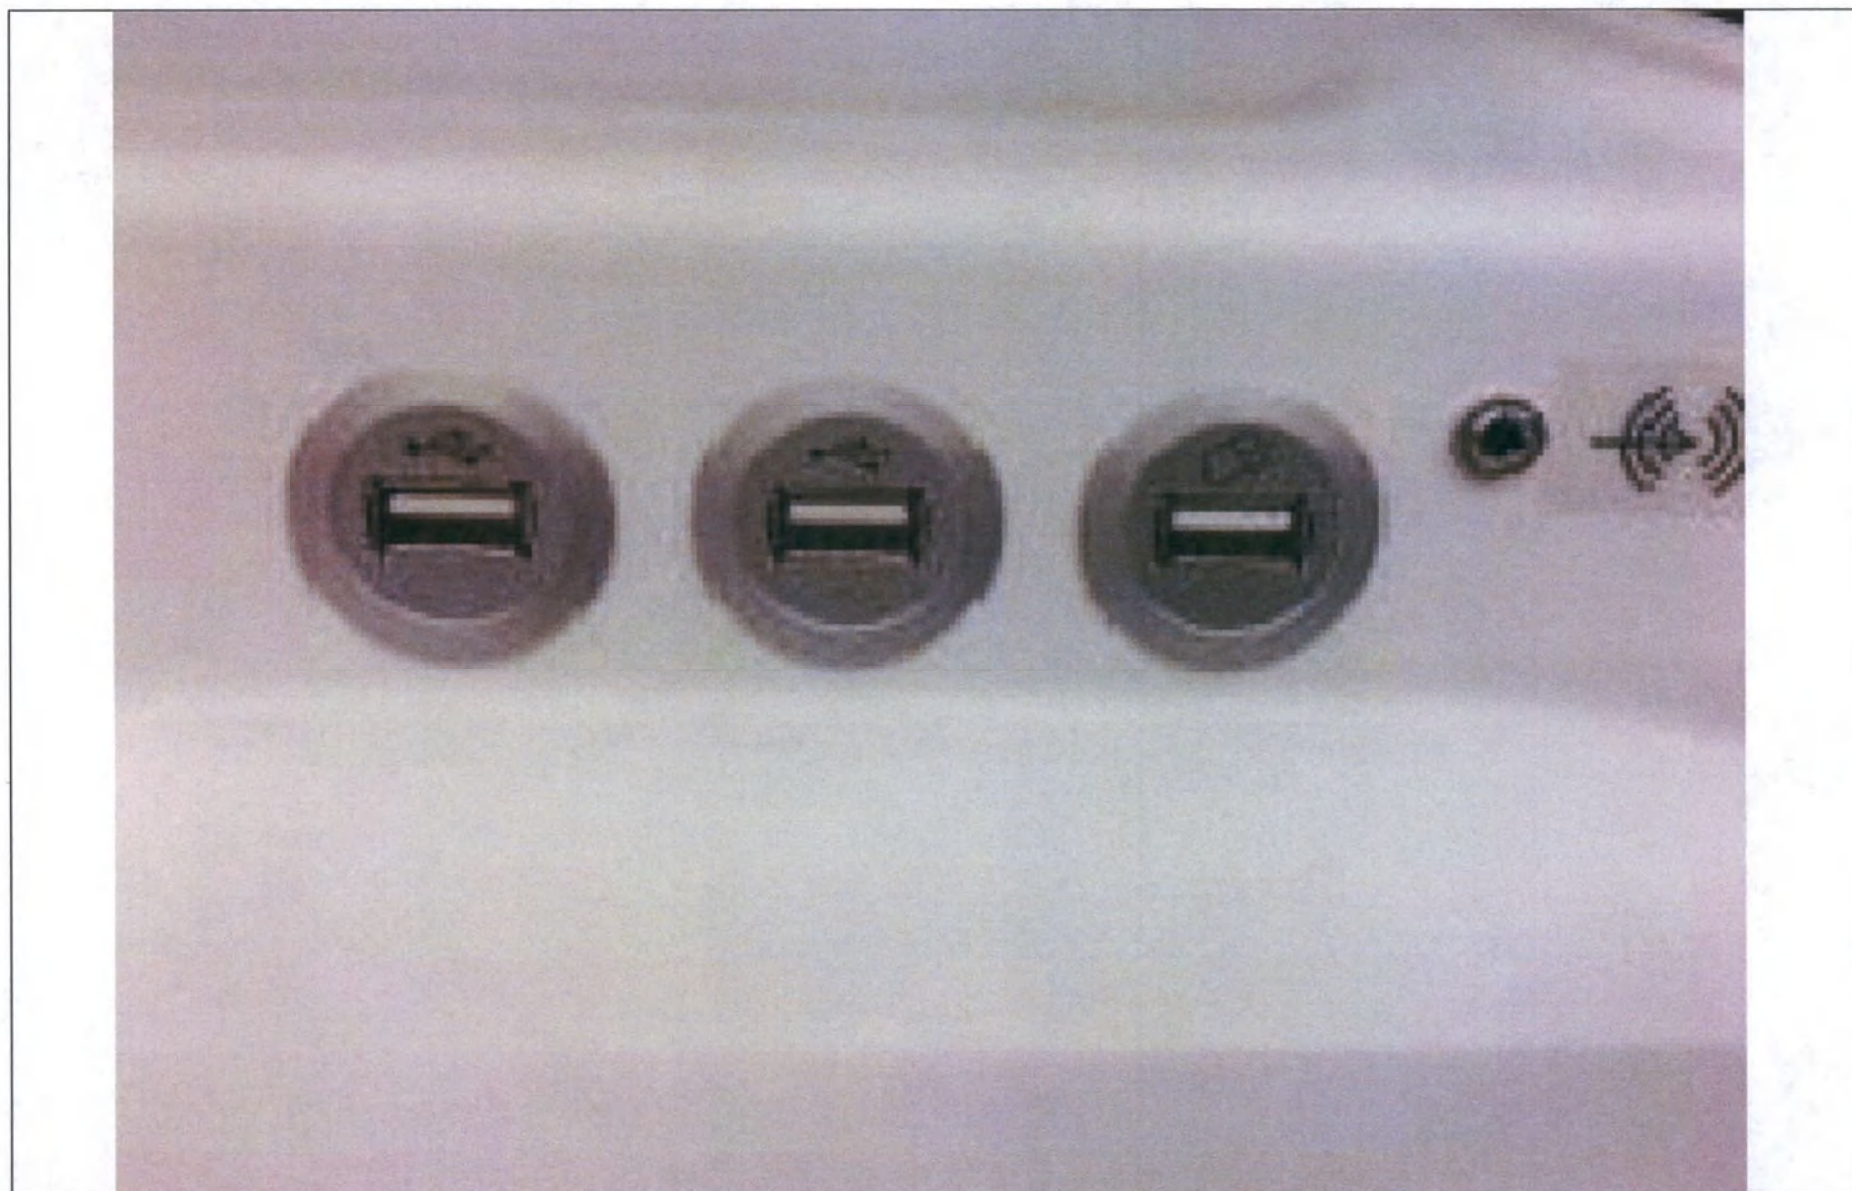


2.3 Мониторная стойка, в составе: штатив мониторов, варианты исполнения стойка дисплея Flex или стойка дисплея Flex Plus; панель управления с сенсорным экраном, мышь, порт USB, монитор, дисковод для дисков DVD.




2.4 Мониторная стойка, в составе: штатив мониторов, варианты исполнения стойка дисплея Flex или стойка дисплея Flex Plus; панель управления с сенсорным экраном, мышь, порт USB, монитор, дисковод для дисков DVD.

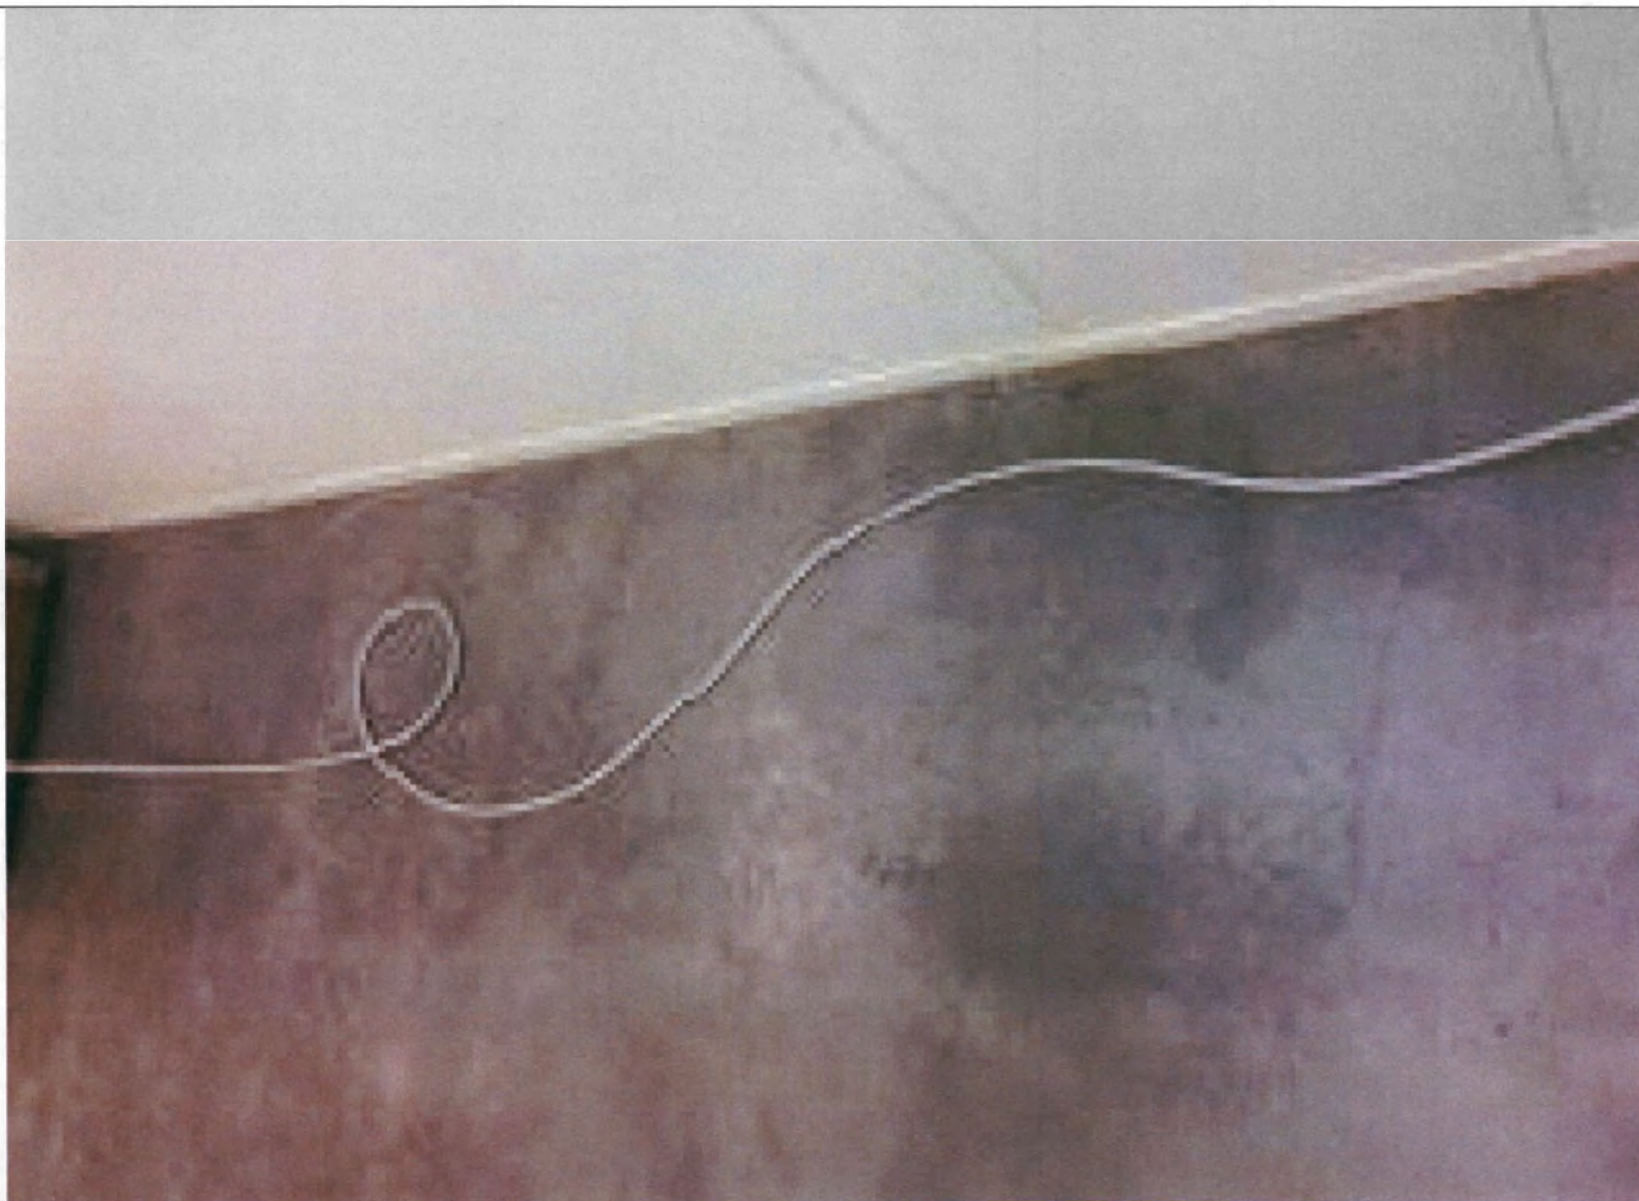

3. Кабель питания.

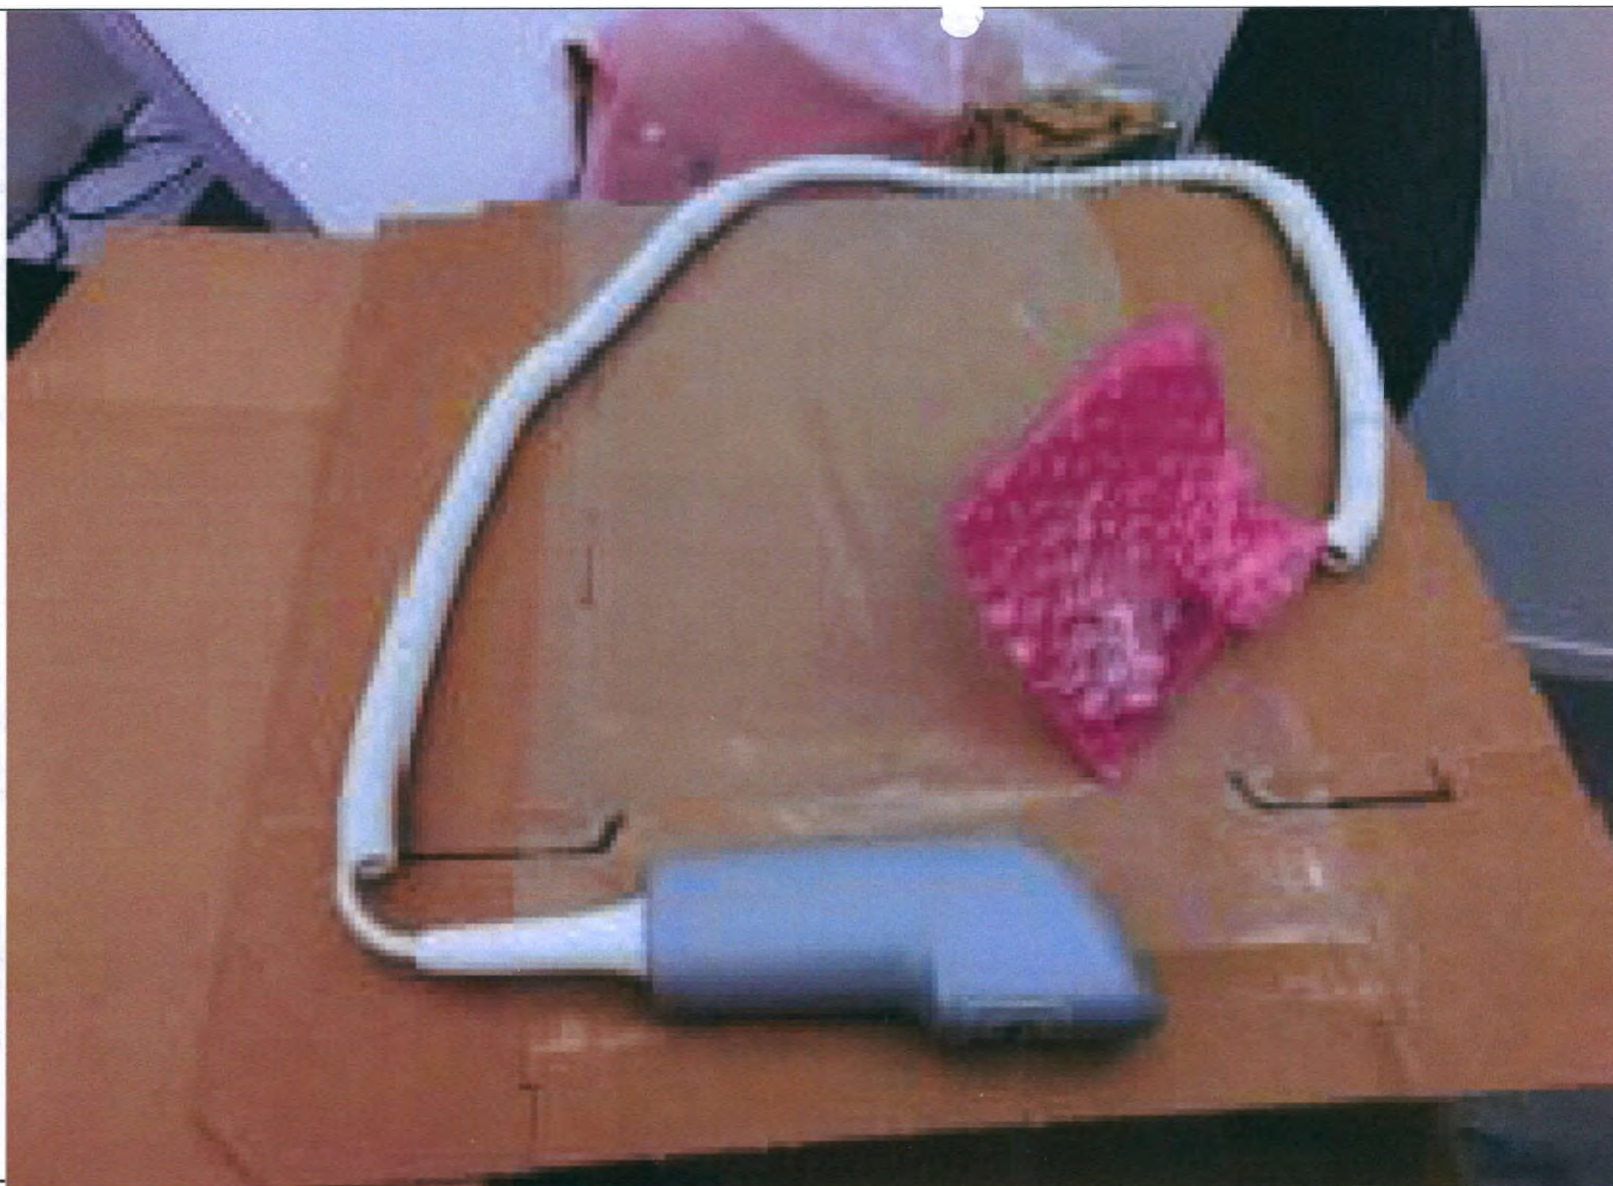

4. Ручной переключатель.

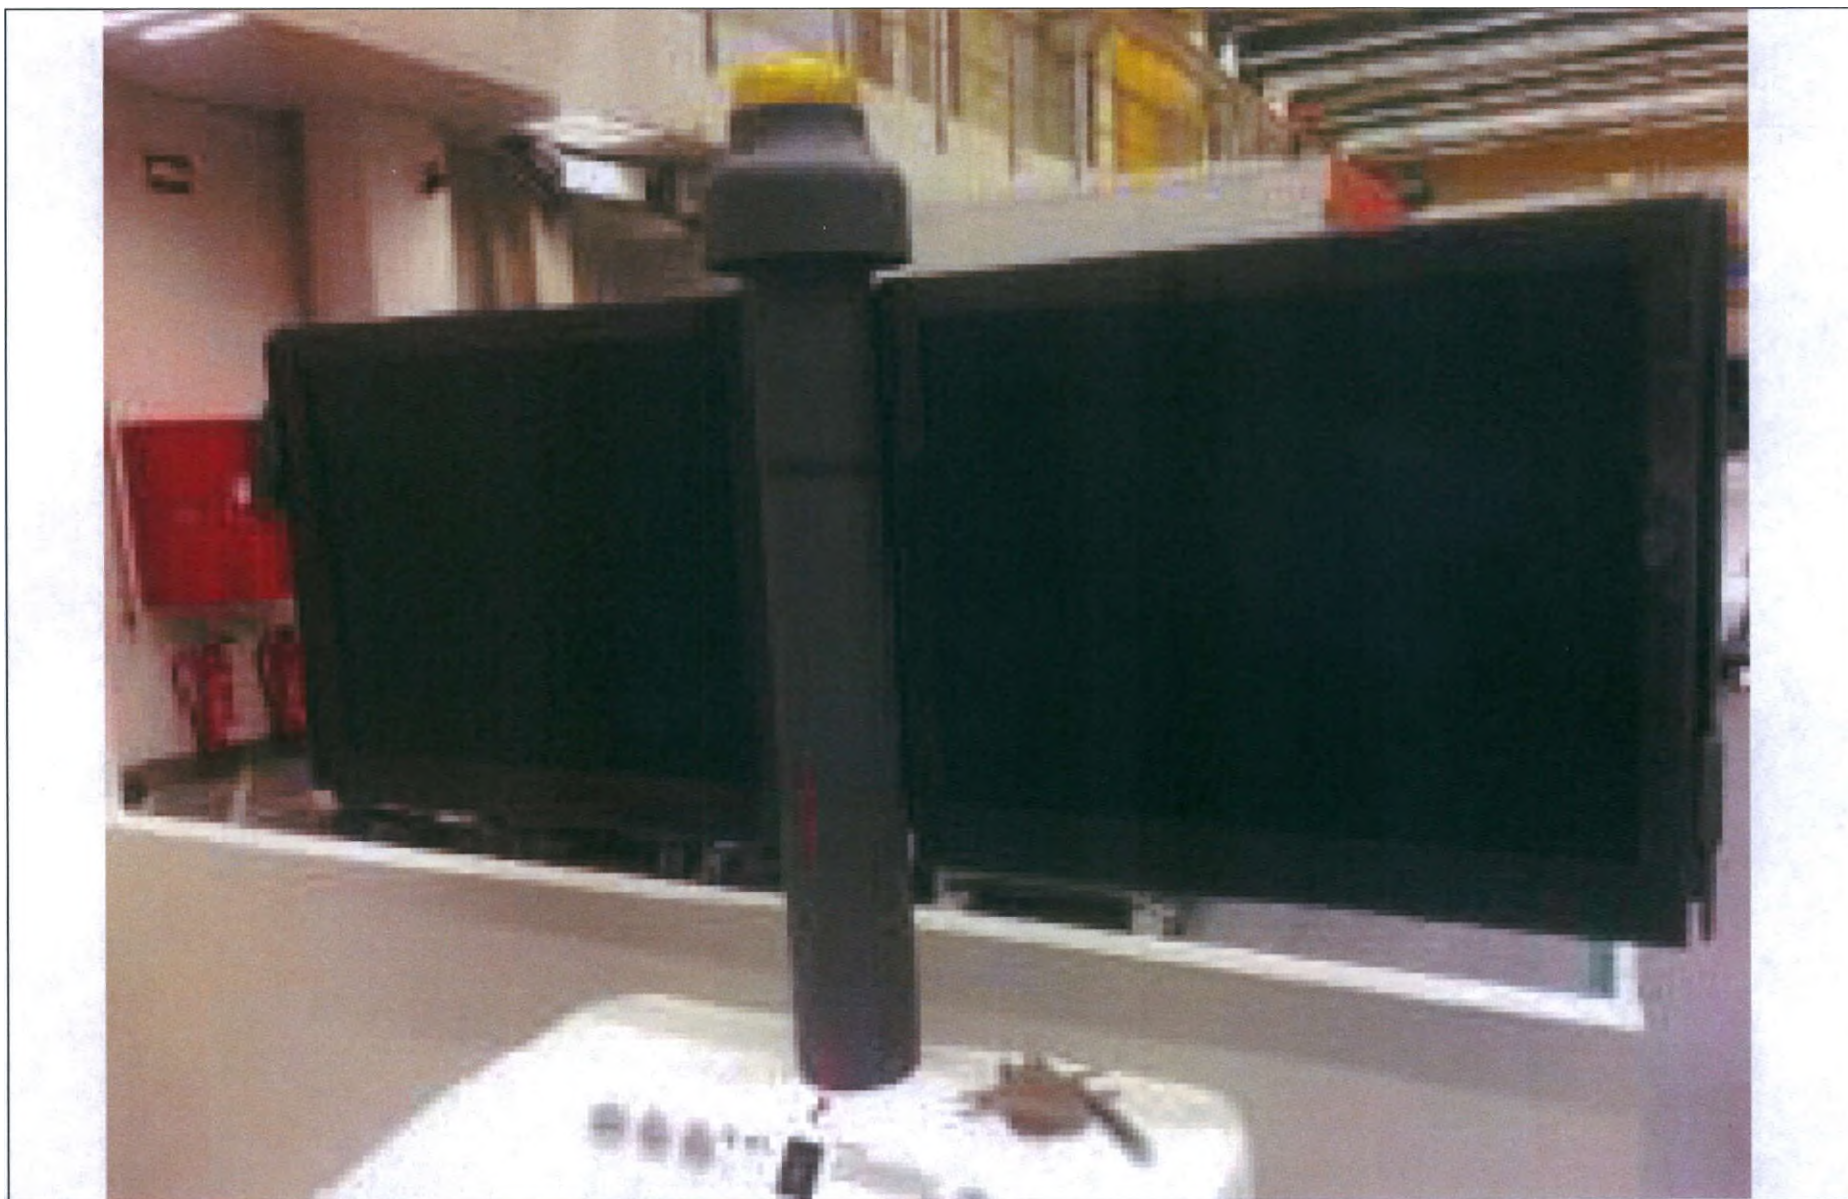

5. Мониторы для стойки, варианты исполнения: стандартный, высокой яркости.



6.1 Педальный переключатель, варианты исполнения: стандартный и/или многофункциональный.



6.2 Педальный переключатель, варианты исполнения: стандартный и/или многофункциональный.



7. Камера для измерения дозы облучения.

SIEMENS



www.siemens.com/healthcare

Cios Fusion

Руководство пользователя

8. Документация пользователя на русском языке.

Принадлежности




1. Лазерный оптический центратор детектора.




2. Моноблочный лазерный оптический центратор.

High Speed Fluoro, Cont. (key)	Yes
Medium Speed Fluoro (key)	Yes ▾
Sub/Road Basic Module (key)	No
Sub/Road Advanced Module (key)	Yes ▾
Stenosis Quantification (key)	No
2D Measuring (key)	Yes ▾
DVD Recorder (key)	Yes ▾
Memory Extension (100,000 images) (key)	No
Dicom Send (key)	Yes ▾
Dicom Print (key)	Yes ▾
Dicom Worklist (key)	Yes ▾
Dicom Query (key)	Yes ▾
LithoReport (key)	Yes ▾
NavLink 2D (key)	Yes ▾
X-Ray Barcode (key)	Yes ▾
HIPAA (key)	Yes ▾
Remote Assist (key)	Yes ▾
Video Manager (key)	No
Simulation	
Teaching mode	No ▾
Default Values Auto	


3. Программный режим Памяти положения.

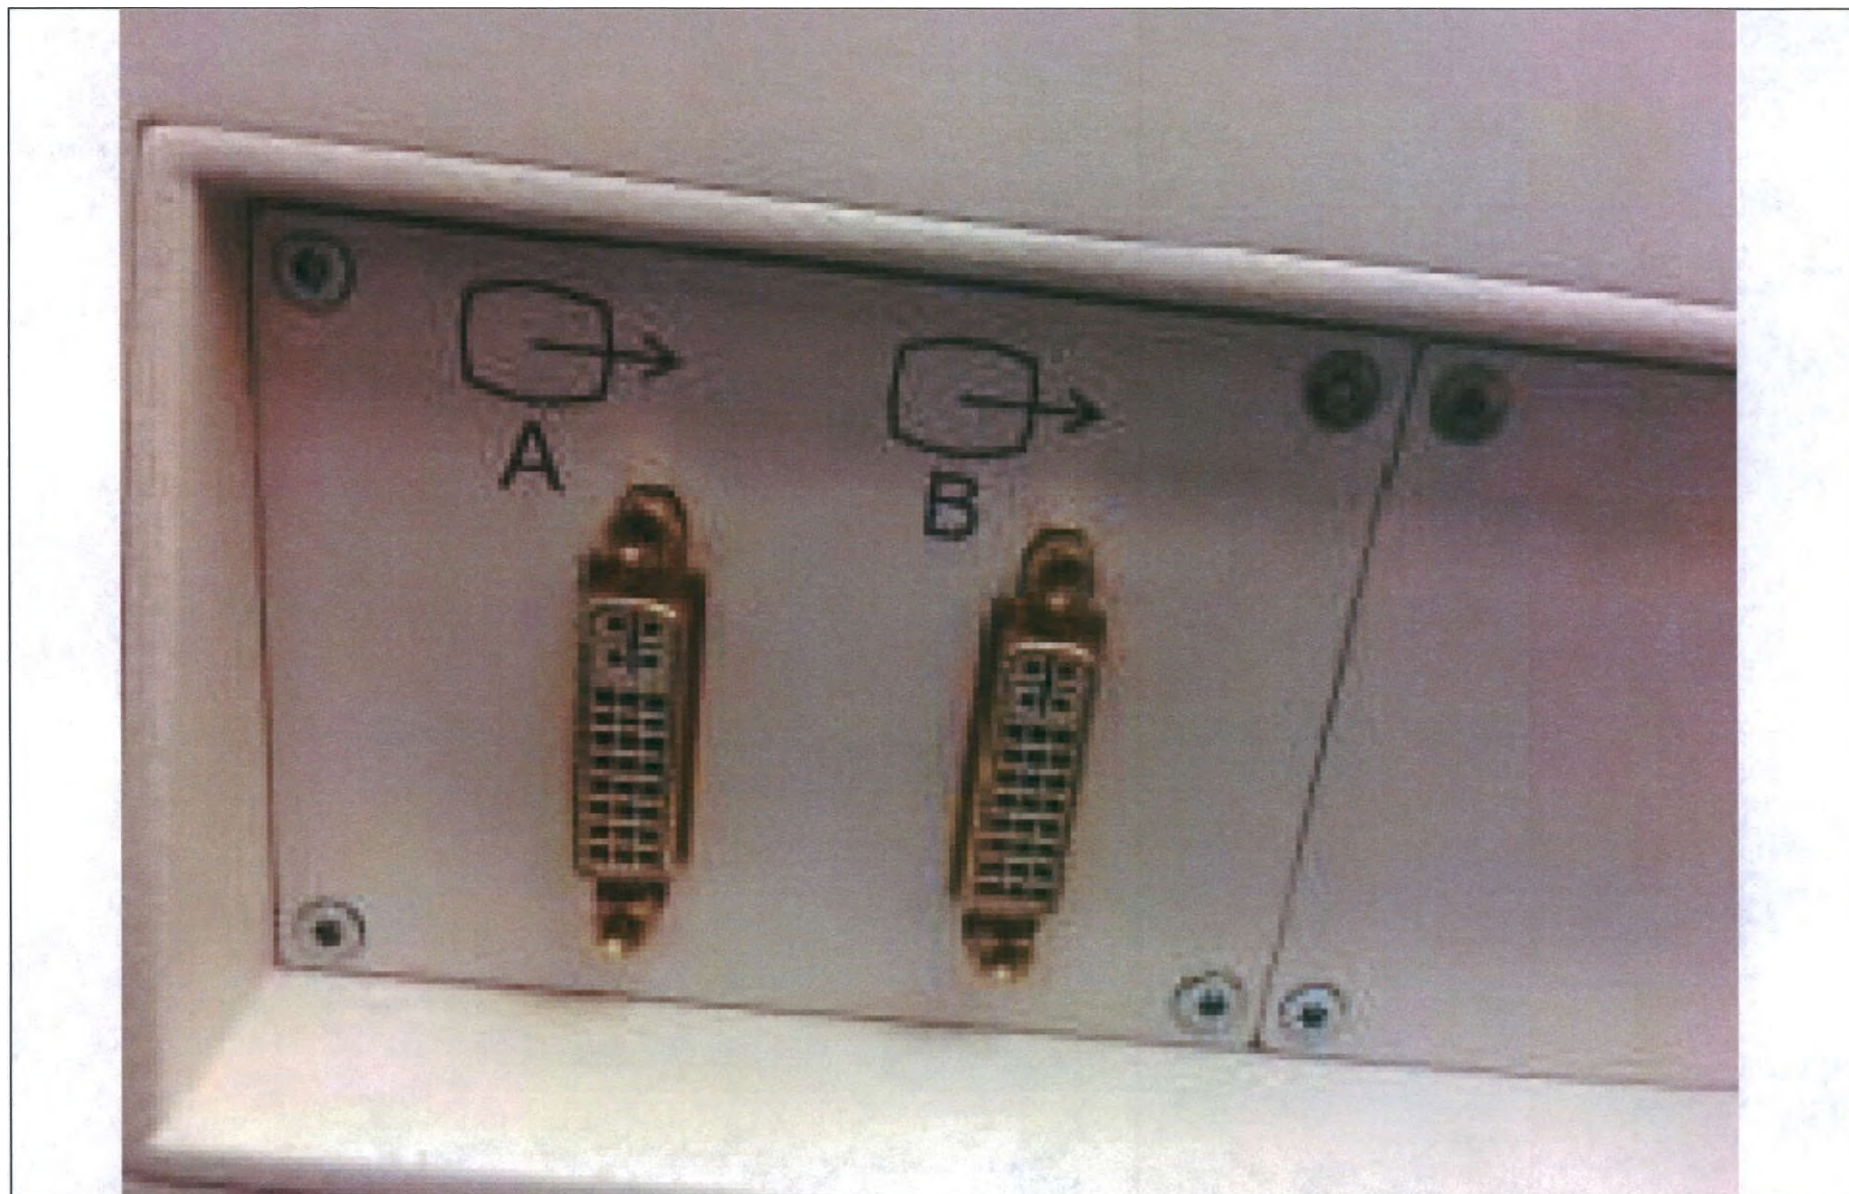

4. Разветвитель видеосигнала DVI.

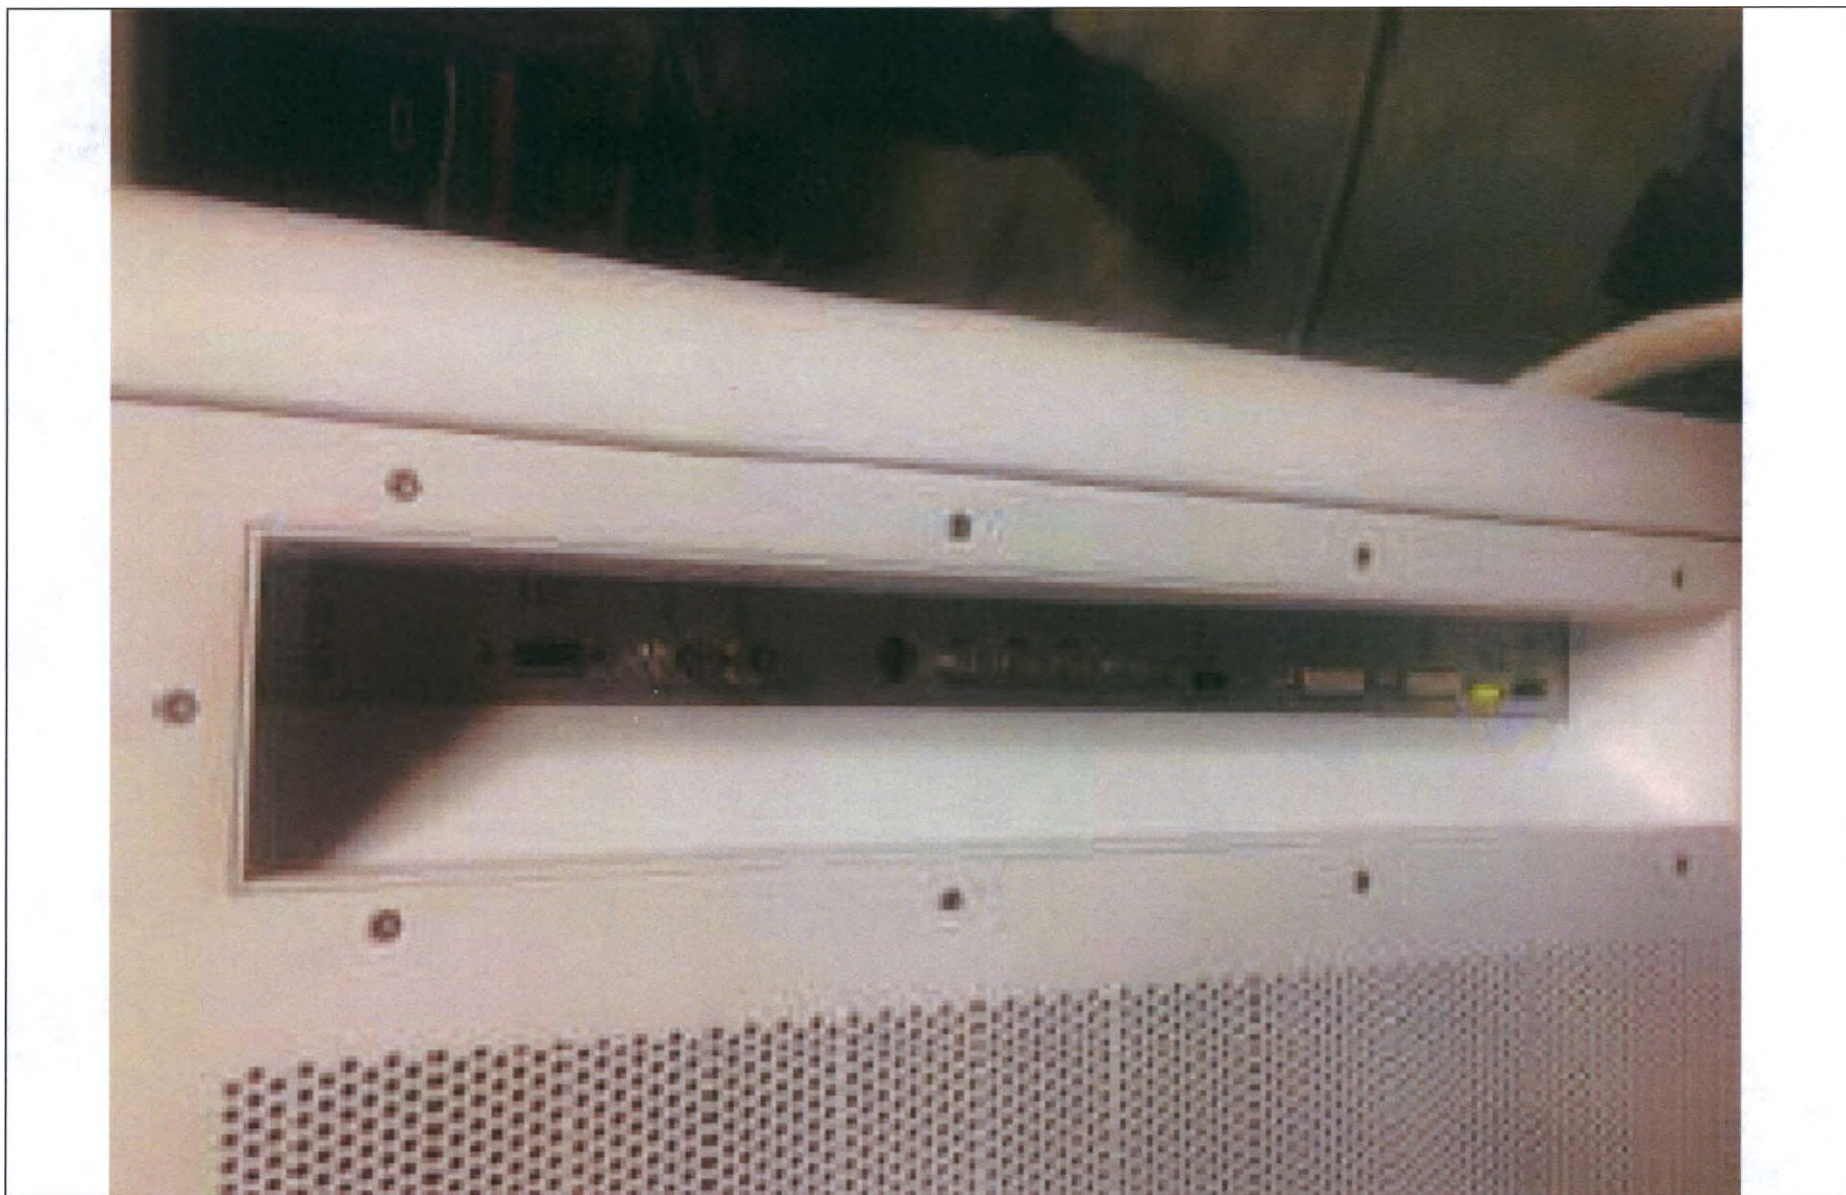

5. Диспетчер видеоизображения HD (SmartView).

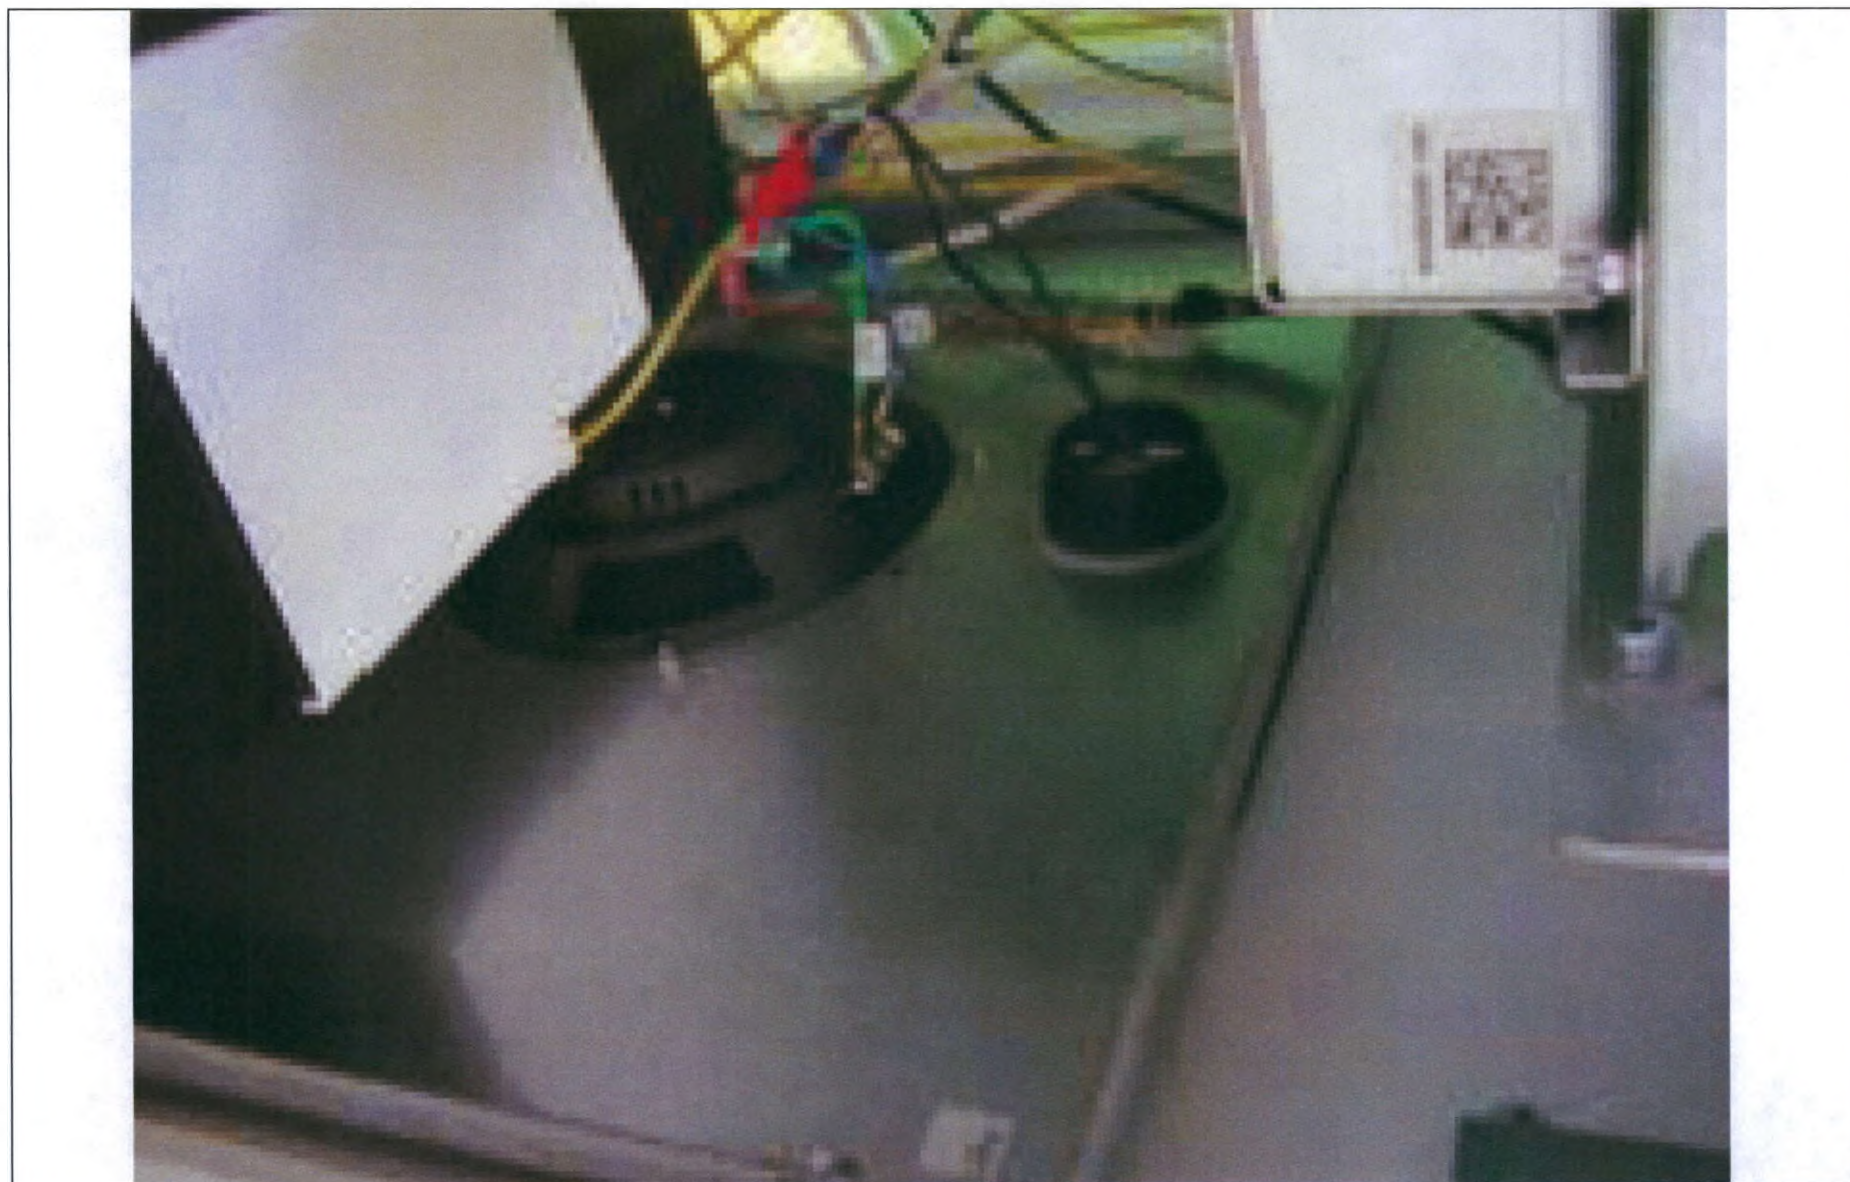

6. Встраиваемая акустическая стереосистема.



7. Пульт дистанционного управления с держателем.



8. Дополнительный держатель для пульта дистанционного управления.



9. Программный режим 2D измерения (для измерения углов и расстояний).


High Speed Fluoro, Cont. (key)	Yes
Medium Speed Fluoro (key)	Yes ▾
Sub/Road Basic Module (key)	No
Sub/Road Advanced Module (key)	Yes ▾
Stenosis Quantification (key)	No
2D Measuring (key)	Yes ▾
DVD Recorder (key)	Yes ▾
Memory Extension (100,000 images) (key)	No
Dicom Send (key)	Yes ▾
Dicom Print (key)	Yes ▾
Dicom Worklist (key)	Yes ▾
Dicom Query (key)	Yes ▾
LaboReport (key)	Yes ▾
Navilink 2D (key)	Yes ▾
X-Ray Pascode (key)	Yes ▾
HIPAA (key)	Yes ▾
Remote Assist (key)	Yes ▾
Value Manager (key)	No
Simulation	
Tracking mode	No ▾

Default Values | Auto

10. Программный режим для обследования сосудов.

Laser Detector	Yes
Laser Microblotch	Yes
<u>Other HW</u>	
Generator	Polydram M3
X-Ray Tube	EB 110
CIAP Menu	Yes
WLAN Module	Yes
<u>FW Options</u>	
Language Setting	Russian
Keyboard Layout	Russian
High Speed Flare, Cont. (org)	Yes
Maximum Speed Flare (org)	Yes
Auto Focus Drive Module (org)	No
Auto Focus Adjustment Module (org)	No
Auto Focus Precision Module (org)	Yes
Intense Quantification (org)	Yes
2D Measurement (org)	Yes
Advanced H2 Quantification (org)	No
Line Graphing (org)	No
Dr. Li Examination (org)	Yes
Intensity Level (org)	Yes
Time Point (org)	Yes
Intensity Window (org)	Yes
Dynamic Query (org)	Yes
Auto Report (org)	No
Max. Line TD (org)	Yes
X-Ray Fluorescence (org)	No
HEPA (org)	No
Remote Image Save	Yes
Video Monitoring (org)	Yes
Save menu	
Exit menu	

11. Программный режим для обследования сосудов Premium.

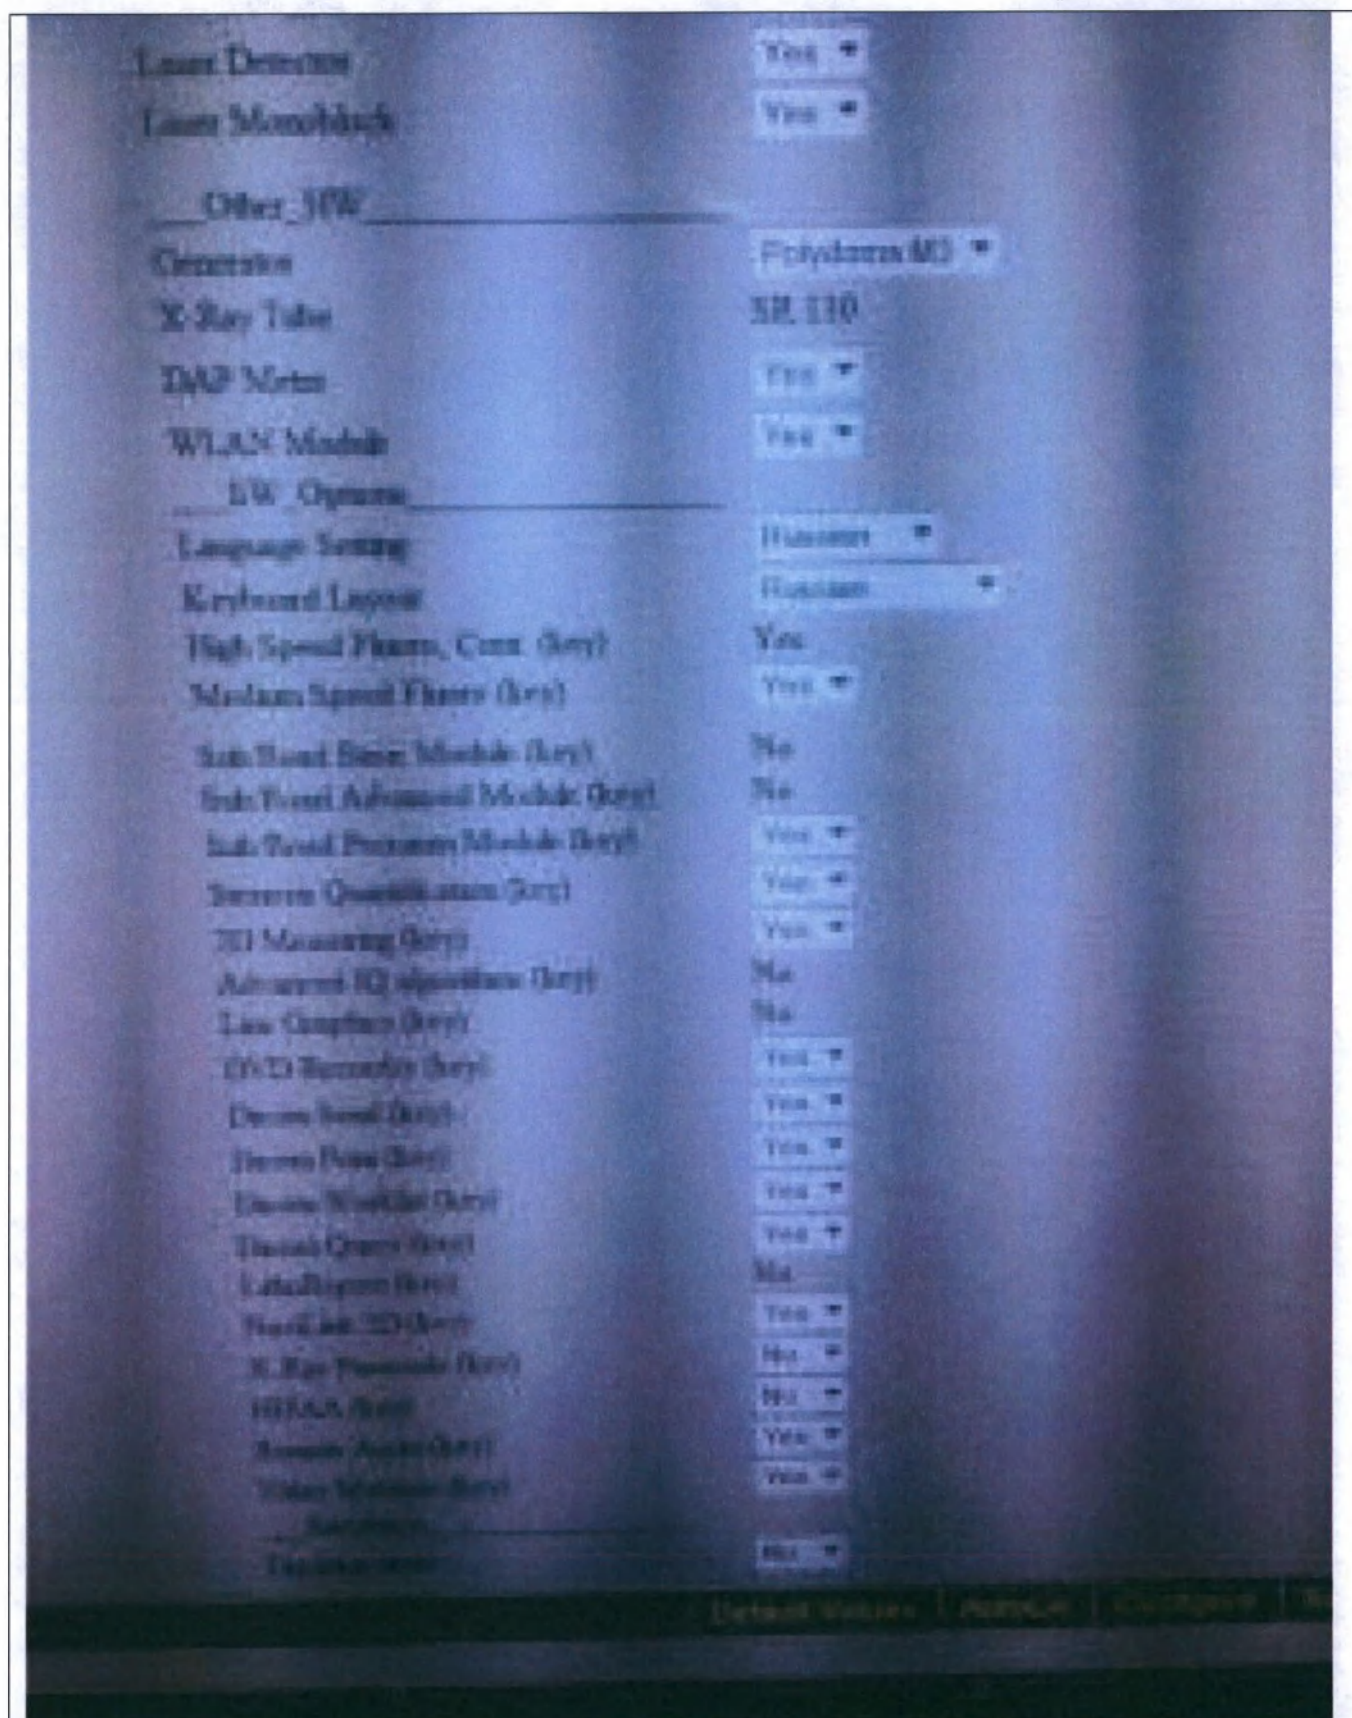


12. Программный режим активного наложения графики (построение линий и отображение на прямом изображении).



13. Программный режим Количественное представление стеноза.



14. Разъем для инжектора контрастного вещества.

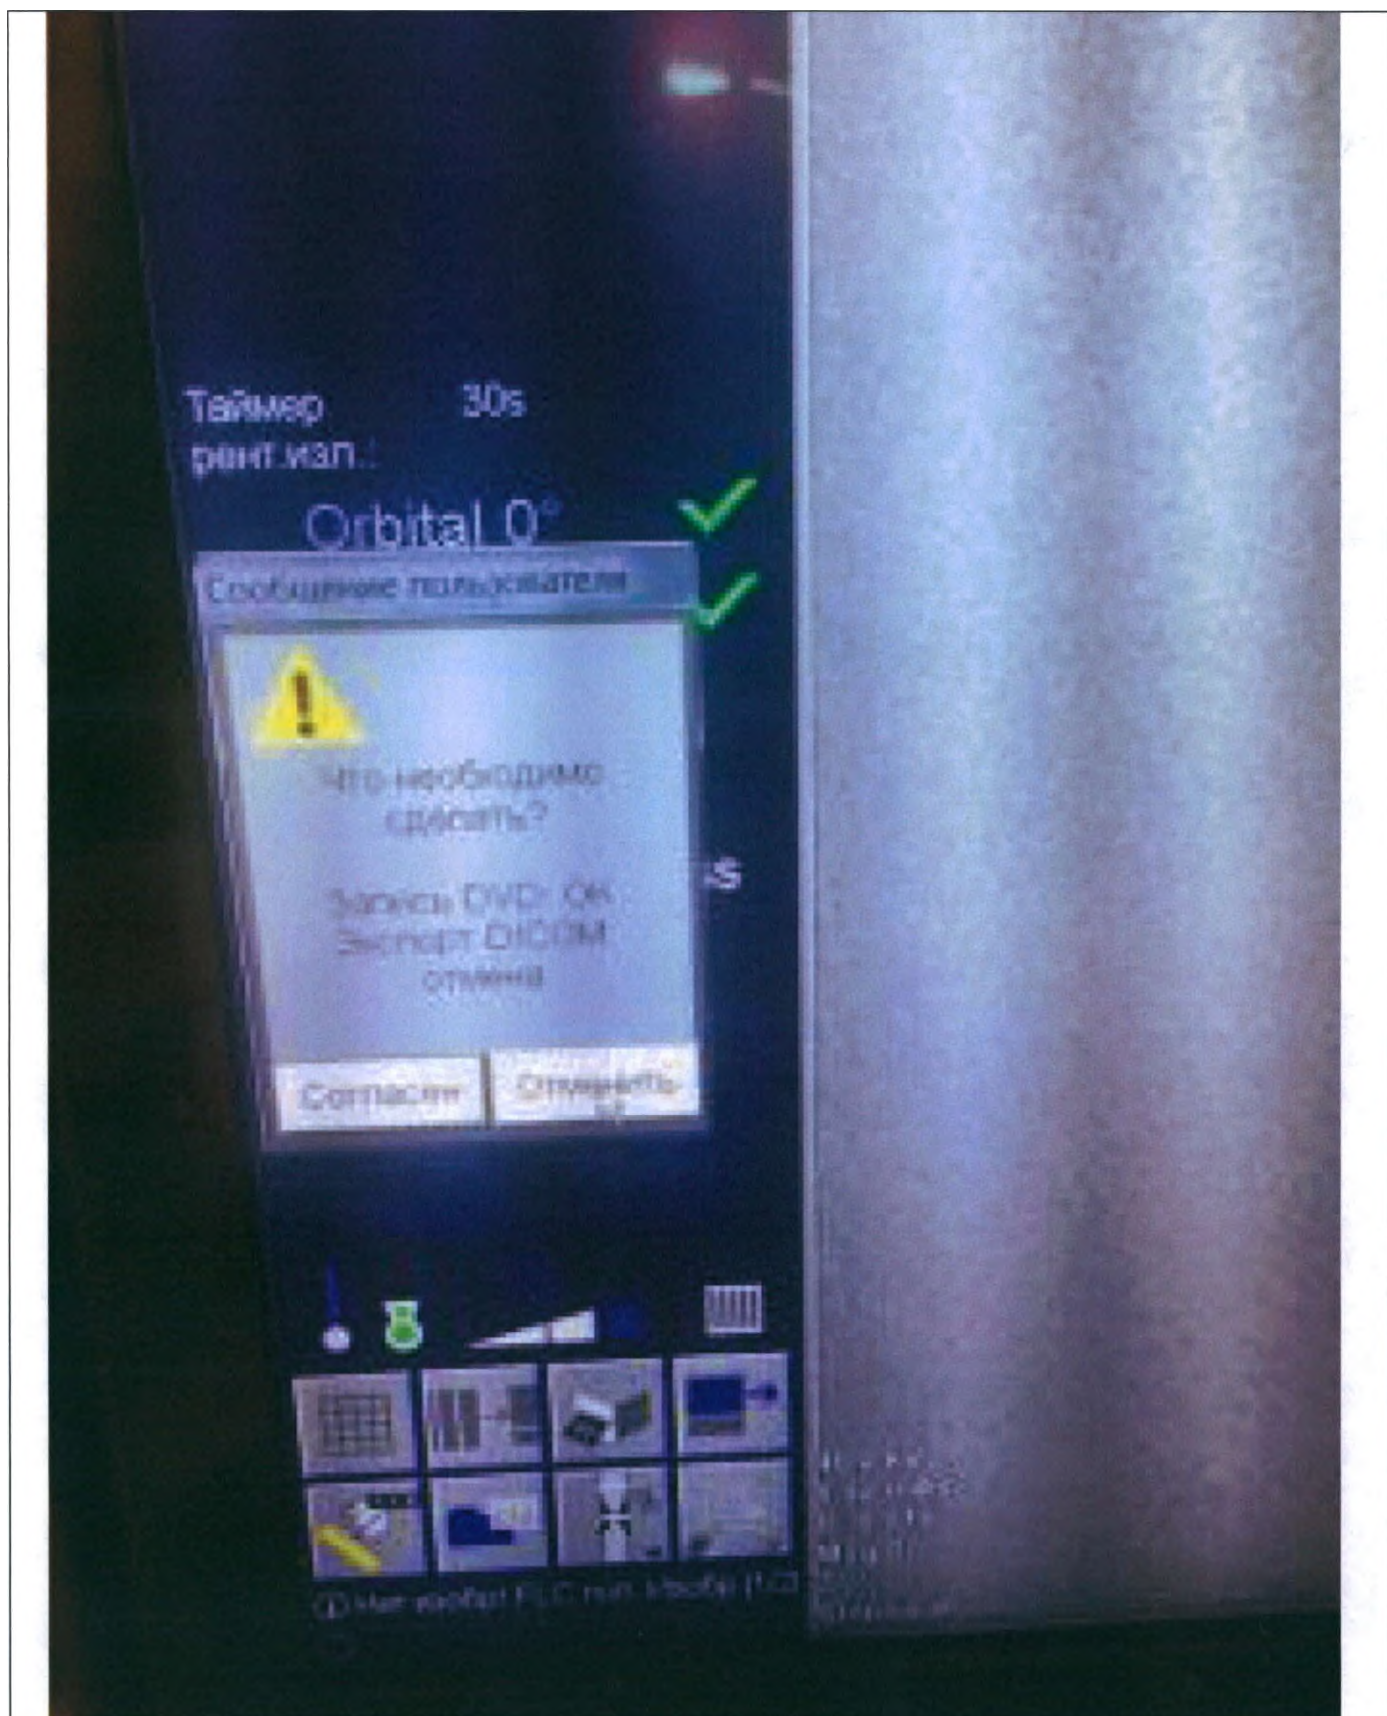

15. Программный режим для записи рентгеноскопических последовательностей на CD/DVD-диске в формате MPEG2.

Laser Detector	Yes
Laser Microblock	Yes
<u>Other HW</u>	
Generator	Polydoron M3
X-Ray Tube	SR 110
DAP Meter	Yes
WLAN Module	Yes
<u>SW Options</u>	
Language Setting	Russian
Keyboard Layout	Russian
High Speed Flame, Curt. (key)	Yes
Medium Speed Flame (key)	Yes
Soft Flood Beam Module (key)	No
Soft Flood Advanced Module (key)	No
Soft Flood Premium Module (key)	Yes
Microton Quantification (key)	Yes
2D Measuring (key)	Yes
Advanced IQ algorithm (key)	No
Line Graphics (key)	No
DVD Recorder (key)	Yes
Diagnosis Panel (key)	Yes
Diagnosis Panel (key)	Yes
Diagnosis Worklist (key)	Yes
Diagnosis Queue (key)	Yes
Lab Report (key)	No
Stand alone 2D (key)	Yes
X-Ray Parameters (key)	No
DRFA (key)	No
Program Assist (key)	Yes
Value Selection (key)	Yes
Simulation	No
Preload image	No
Default Values Help Configure Exit	

16. Программный режим DICOM Send (Отправка DICOM).

Linux Desktop	Yes
Linux Microblock	Yes
<u>Other HW</u>	
Graphics	Performance M1
X-Ray Tube	SR 110
DAP Motor	Yes
WLAN Module	Yes
<u>SW Options</u>	
Language Setting	Russian
Keyboard Layout	Russian
High Speed Phantom (Qty)	Yes
Mechanical Speed Phantom (Qty)	Yes
Soft Tissue Bone Module (Qty)	No
Soft Tissue Adipose Module (Qty)	No
Soft Tissue Protein Module (Qty)	Yes
Thermal Quantification (Qty)	Yes
2D Measuring (Qty)	Yes
Advanced IQ algorithm (Qty)	No
Low Dosephant (Qty)	No
IPVLI Processor (Qty)	Yes
Demon Head (Qty)	Yes
Demon Head (Qty)	Yes
Demon Workset (Qty)	Yes
Demon Queue (Qty)	Yes
Lab Support (Qty)	No
Head End: ITD (Qty)	Yes
ITD Base Component (Qty)	No
ITD A/A (Qty)	No
Extensive Audit (Qty)	Yes
Video Comments (Qty)	Yes
Education	Yes
Microblock 1000	Yes


Default Values | Russian | Microblock 1000

17. Программный режим DICOM Print (Печать DICOM).


Lease Detection	Yes
Lease Mismatch	Yes
Online HW	
Computer	PlayStation 3
X-Ray Tube	SR 110
DAP Motor	Yes
WLAN Module	Yes
SW Options	
Language Setting	Japanese
Keyboard Layout	Japanese
High Speed Fluoro (Cnst. Gxy)	Yes
Medium Speed Fluoro (kxy)	Yes
Sub-Tread Beam Module (kxy)	No
Sub-Grid Advanced Module (kxy)	No
Sub-Tread Precision Module (kxy)	Yes
Intensive Quantization (kxy)	Yes
3D Measurement (kxy)	Yes
Advanced IQ algorithm (kxy)	No
Low Graphics (kxy)	No
DVD Recorder (kxy)	Yes
Dynamic Beam (kxy)	Yes
Dynamic Field (kxy)	Yes
Dynamic Focus (kxy)	Yes
Dynamic Window (kxy)	Yes
Dynamic Zoom (kxy)	Yes
1.5k/2k/3k (kxy)	No
Stand-Still (kxy)	Yes
Hi-Res. Scan (kxy)	No
3D/4D (kxy)	No
Dynamic Focus (kxy)	Yes
Dynamic Window (kxy)	Yes
Default Values	No

[Default Values] [Cancel] [Configure] [X]


18. Программный режим DICOM Query/Retrieve (Запрос/получение DICOM).

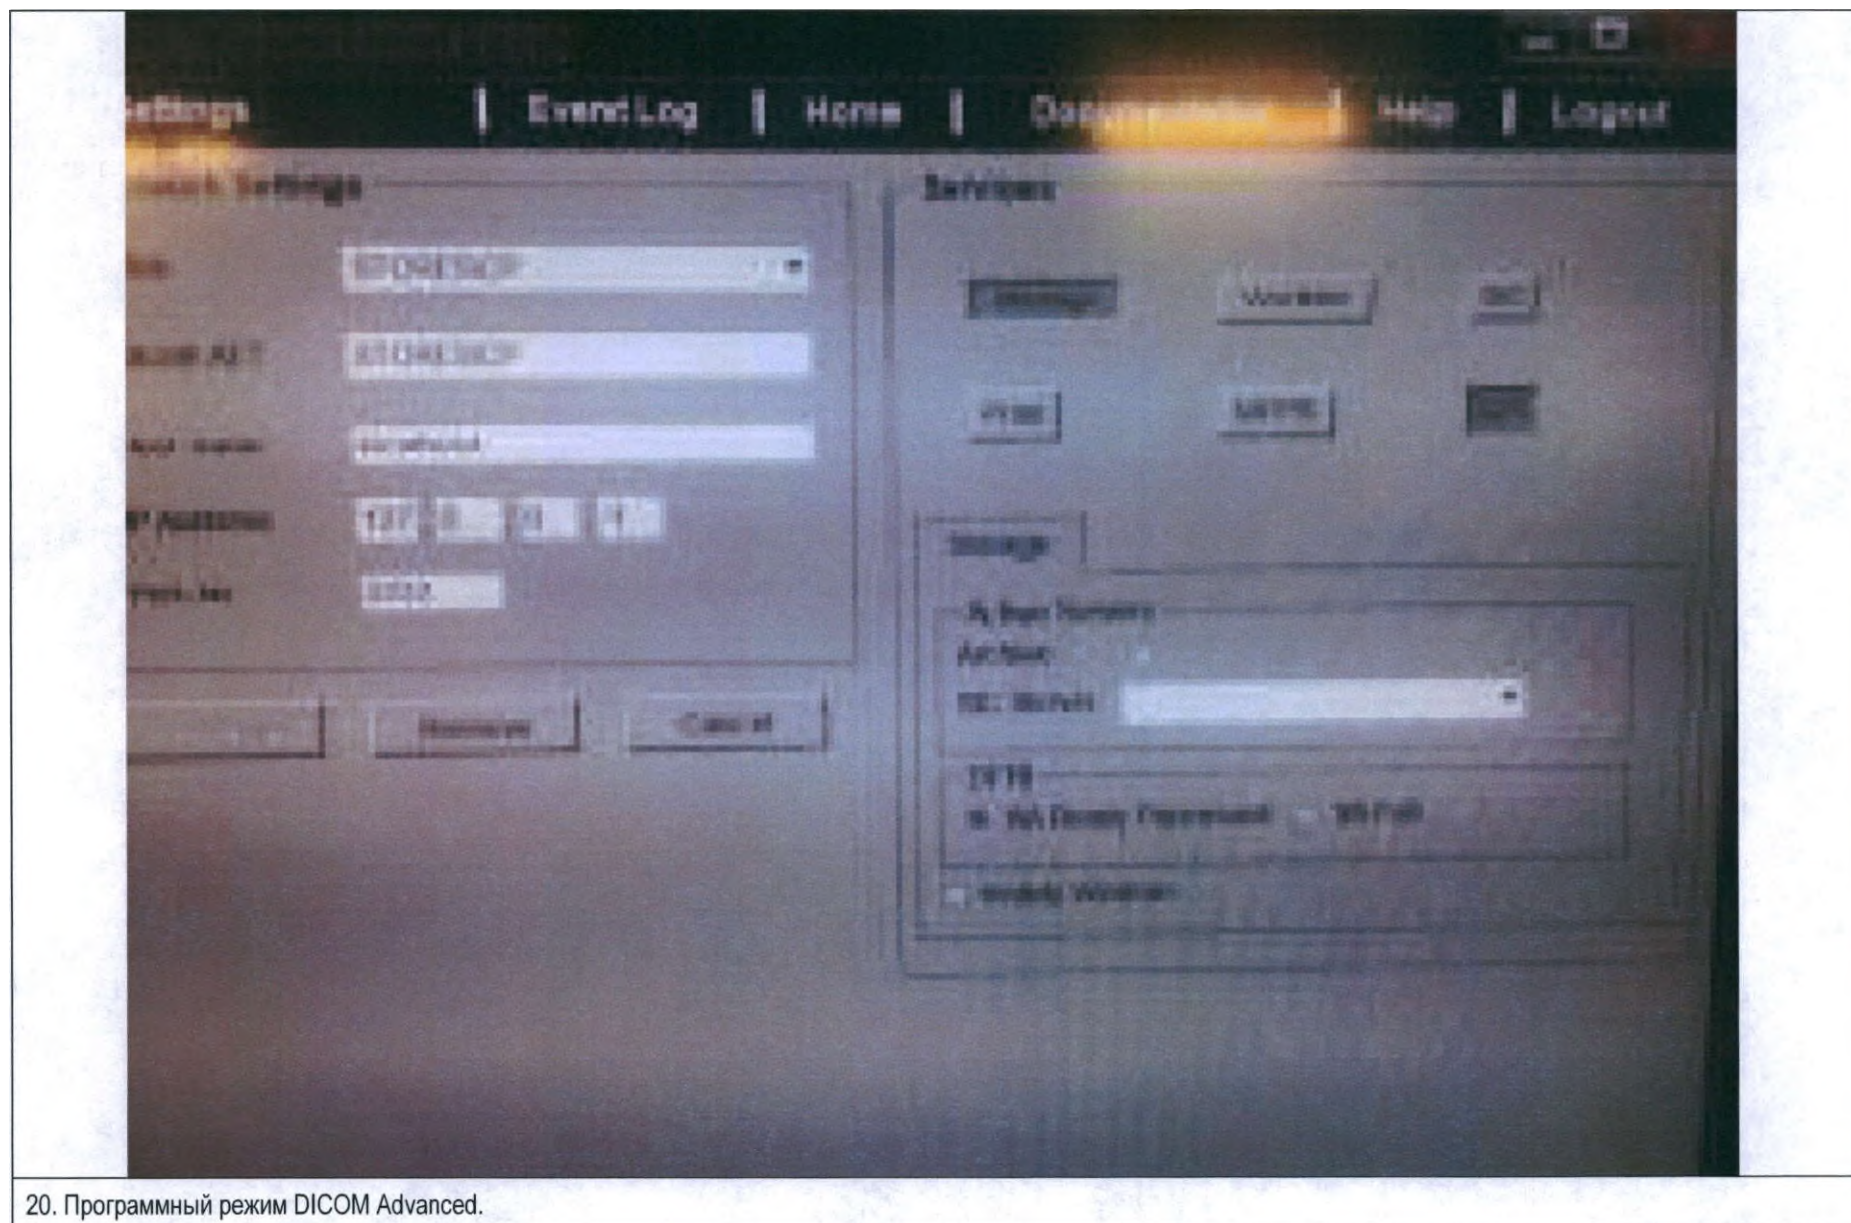

20. Программный режим DICOM Advanced.

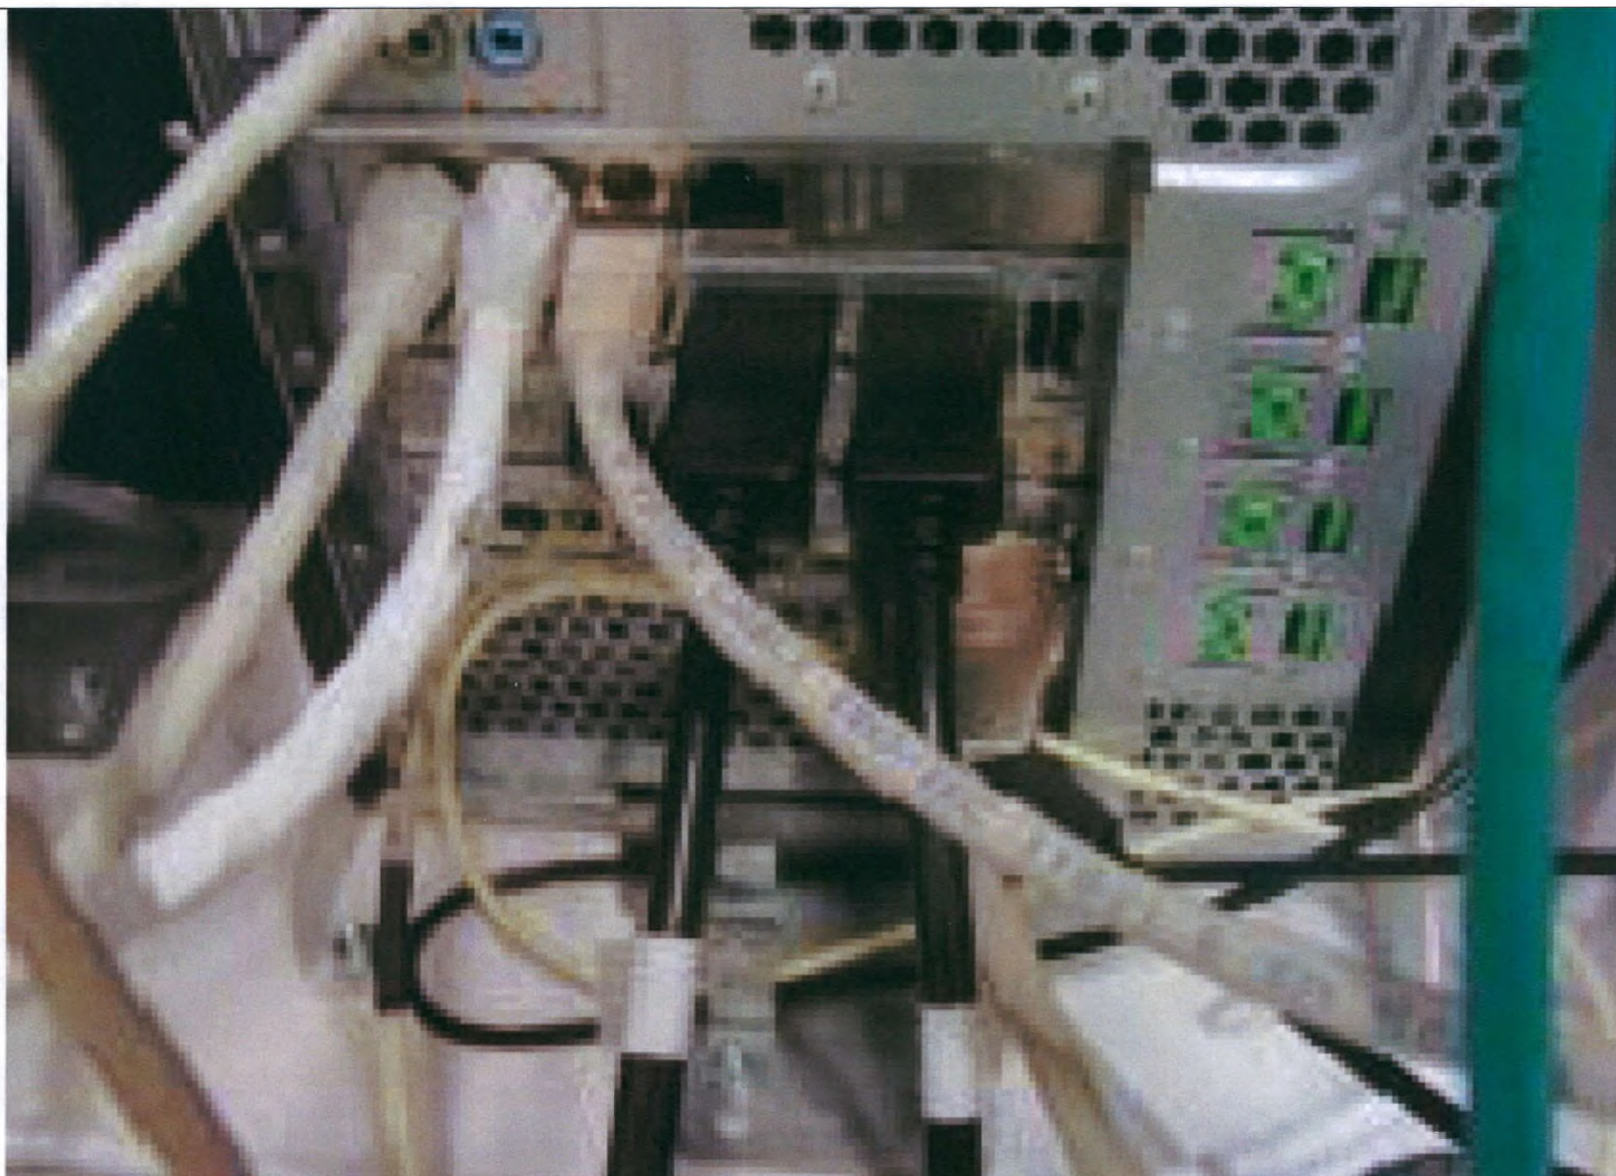


21. Цифровой интерфейс для передачи без потерь данных двухмерного изображения в навигационную систему – NaviLink 2D.

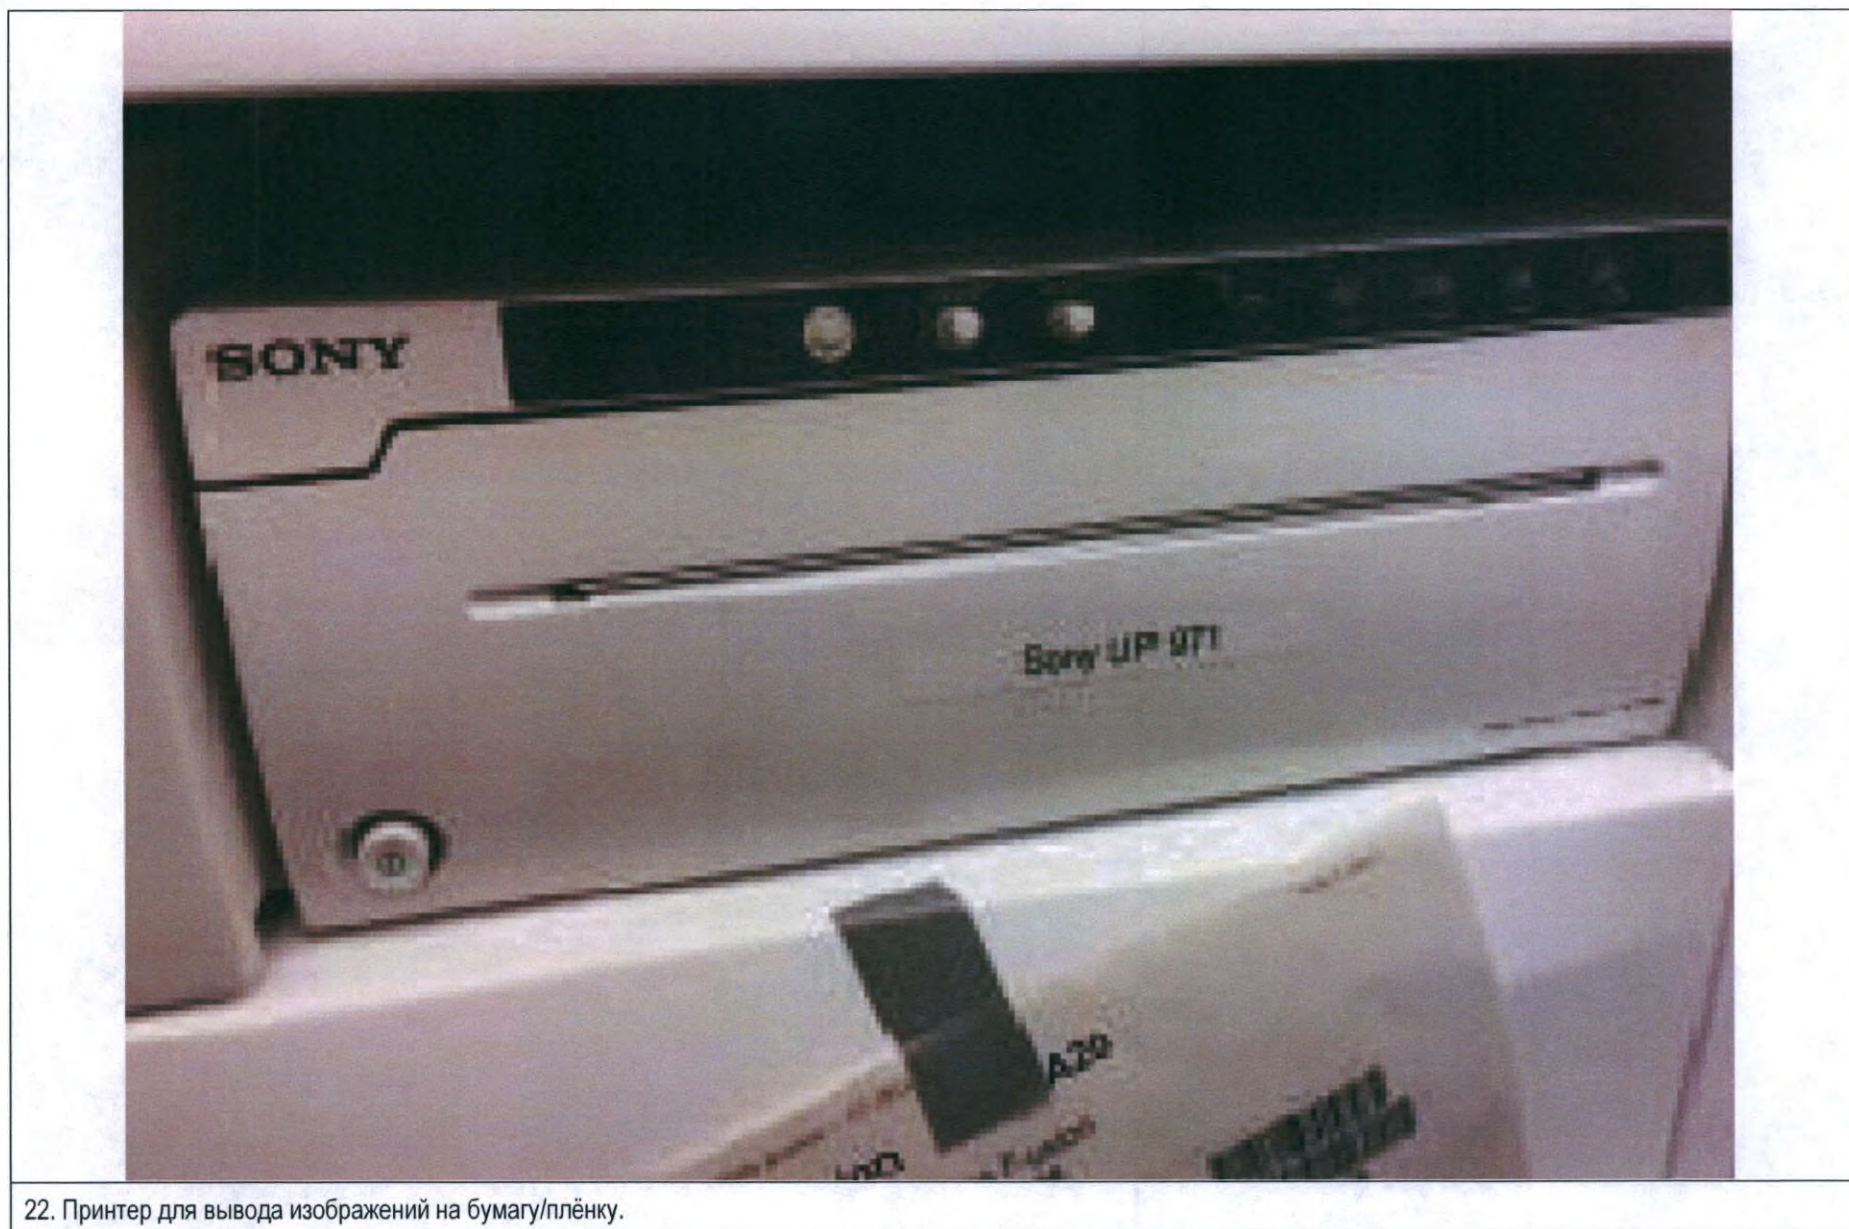

22. Принтер для вывода изображений на бумагу/плёнку.



23. Устройство для установки принтера.

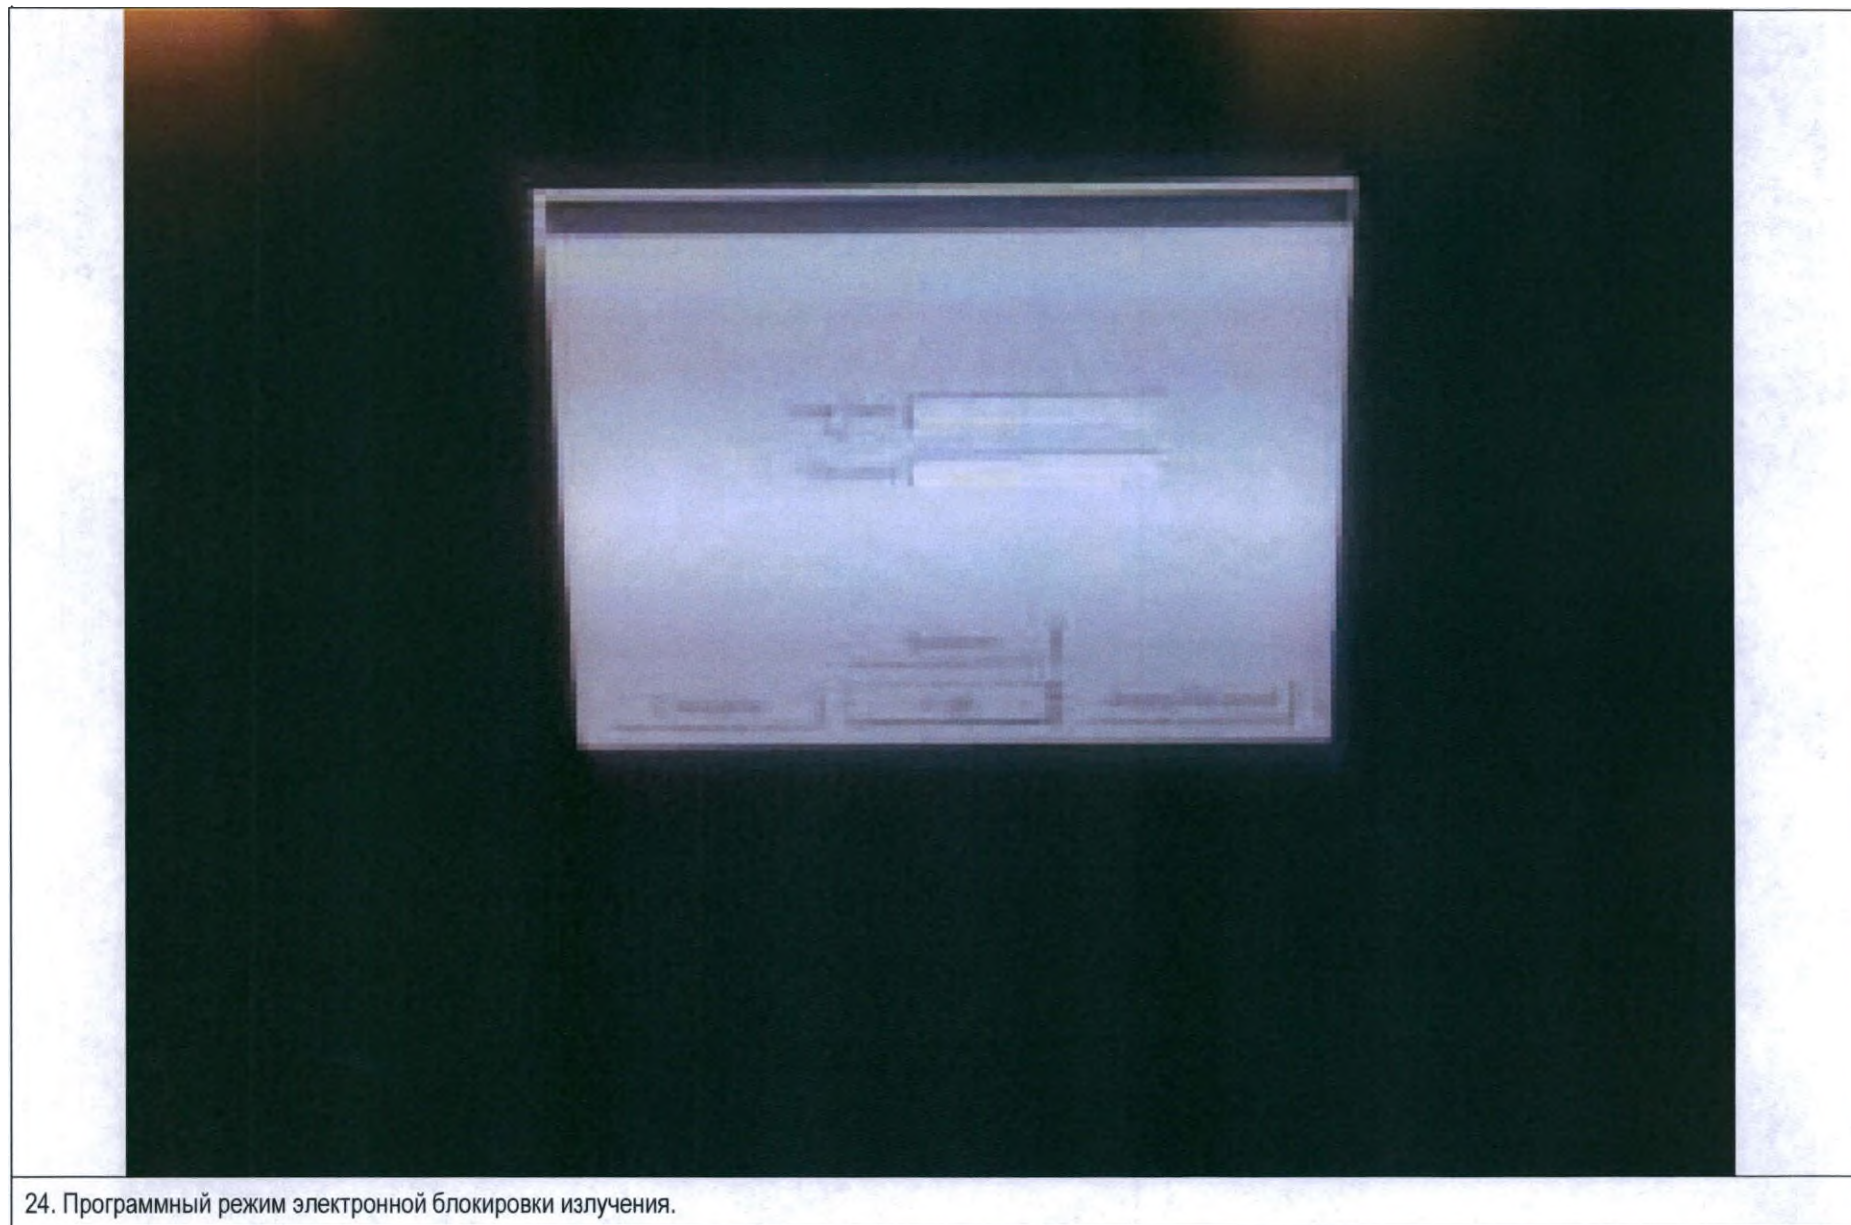

24. Программный режим электронной блокировки излучения.

25. Программный режим HIPAA (Закон об отчетности и использовании данных в сфере медицинского страхования).



26. Заземляющий кабель.



27.1 Стерильные чехлы для С-образной дуги с пластиковыми зажимами.



27.2 Стерильные чехлы для С-образной дуги с пластиковыми зажимами.



28. Стерильные чехлы для рентгеновской трубки с эластичным ремнем.



29. Стерильные чехлы для плоского детектора 20 x 20 см. с эластичным ремнем.




30. Стерильные чехлы для плоского детектора 30 x 30 см. с эластичным ремнем.



31. Стерильные чехлы для пульта дистанционного управления.



32. Нестерильные чехлы для стандартного педального переключателя.

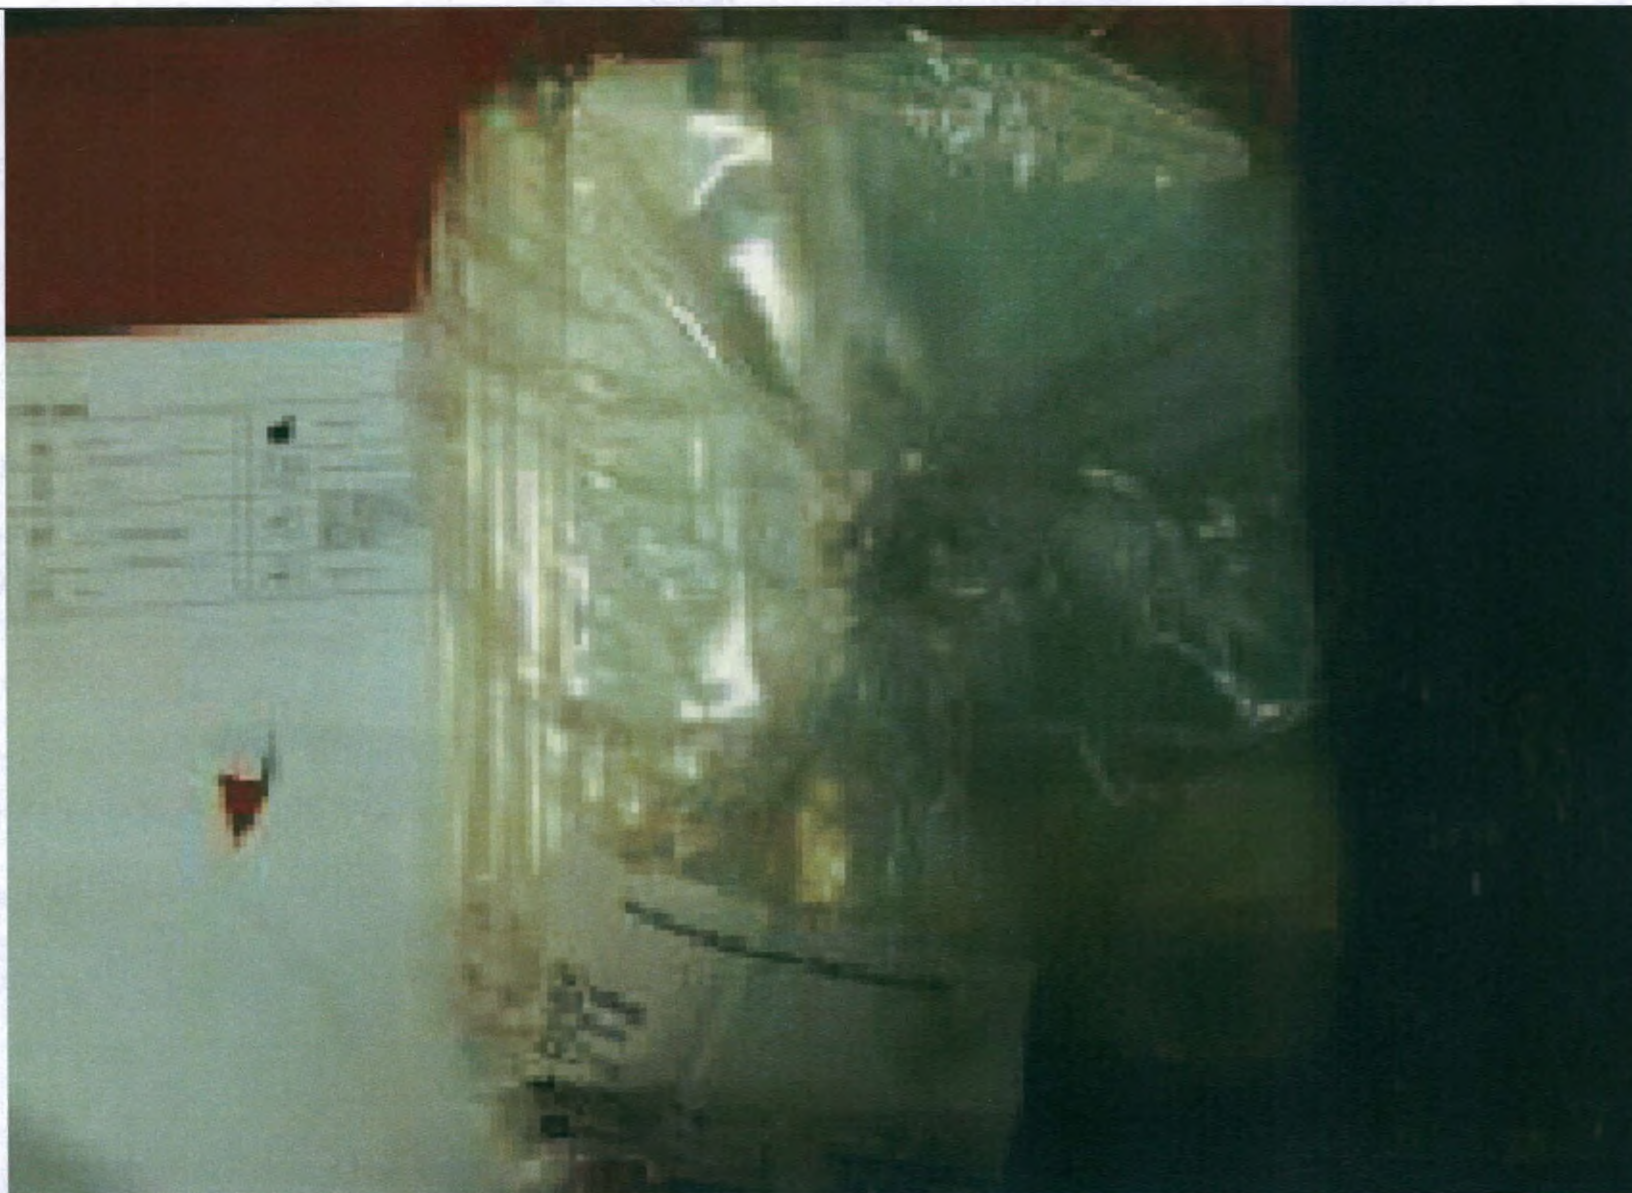

33. Нестерильные чехлы для многофункционального педального переключателя.

Аппарат передвижной рентгеновский цифровой С-дуга для рентгеноскопии "Cios Fusion" с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7914 от дд.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует изделие;
массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская., д. 96

~ 100/110/120/127/200/220/230/240 В; 50/60 Гц 475 Вт/2.6 кВт

34. Маркировки медицинского изделия на русском языке



Всего прошито и пронумеровано
листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»