




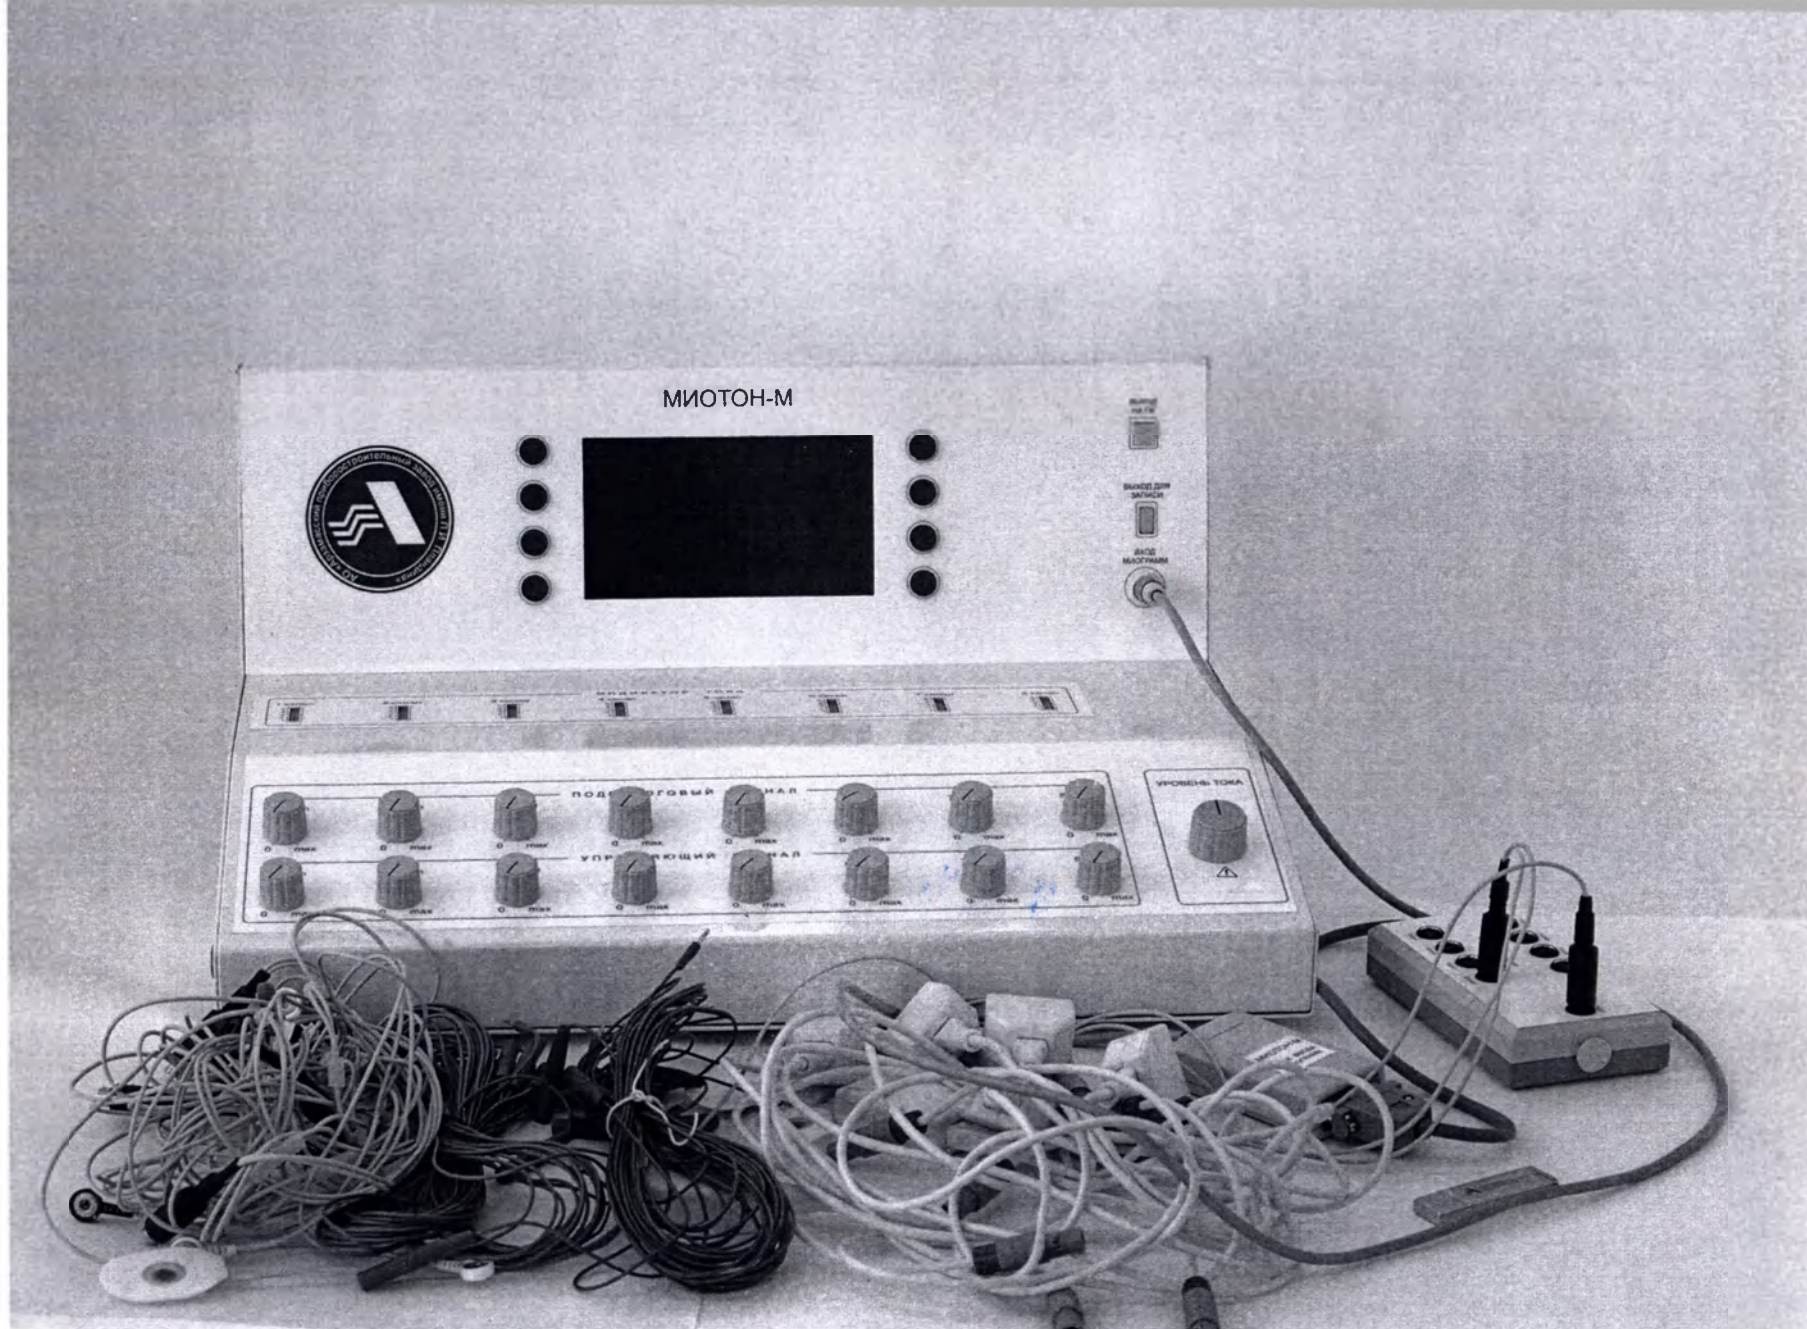


Комплекс аппаратуры физиотерапевтической для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Общий вид комплекта поставки

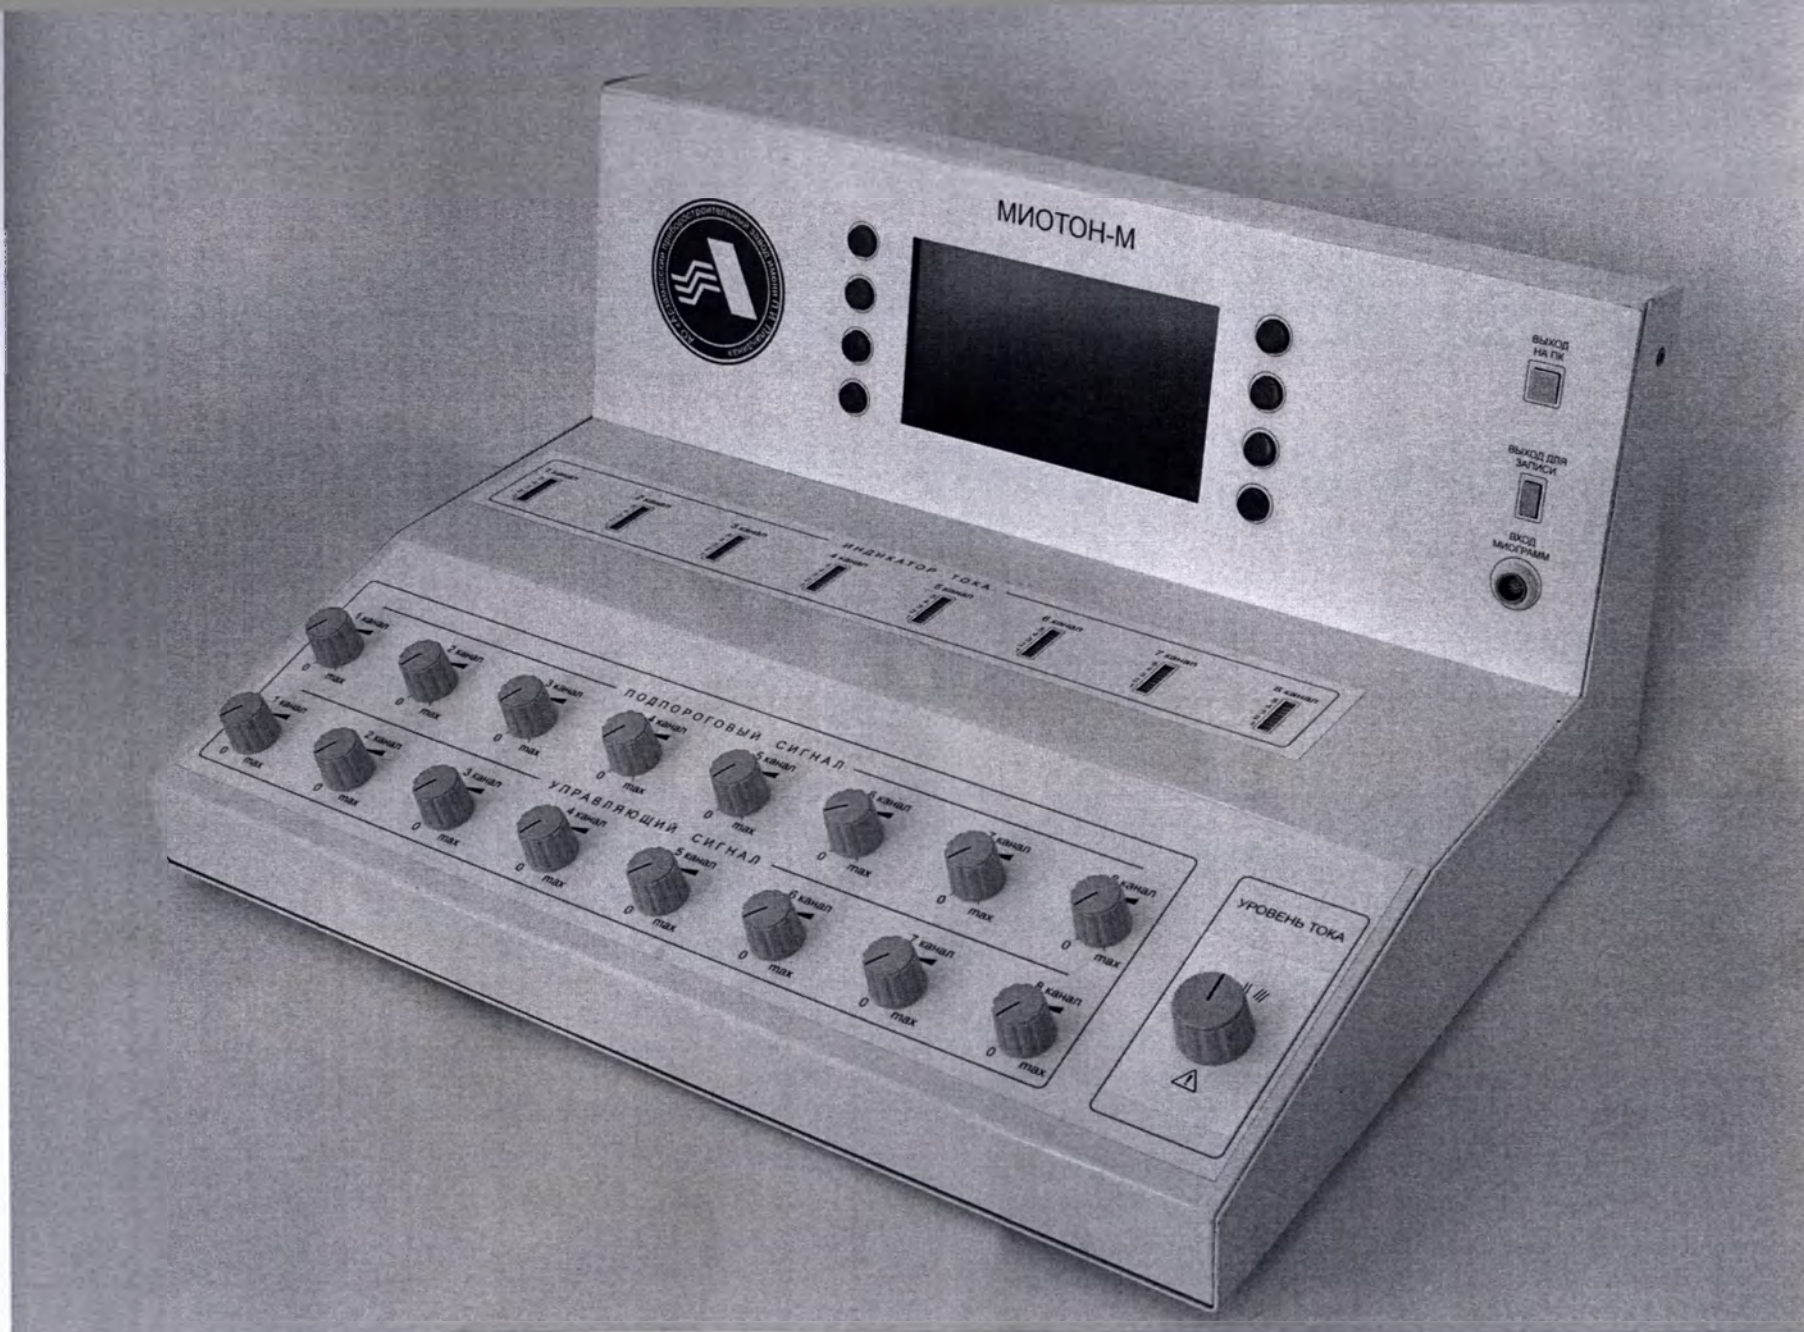

Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
 ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Блок синтезатора программ

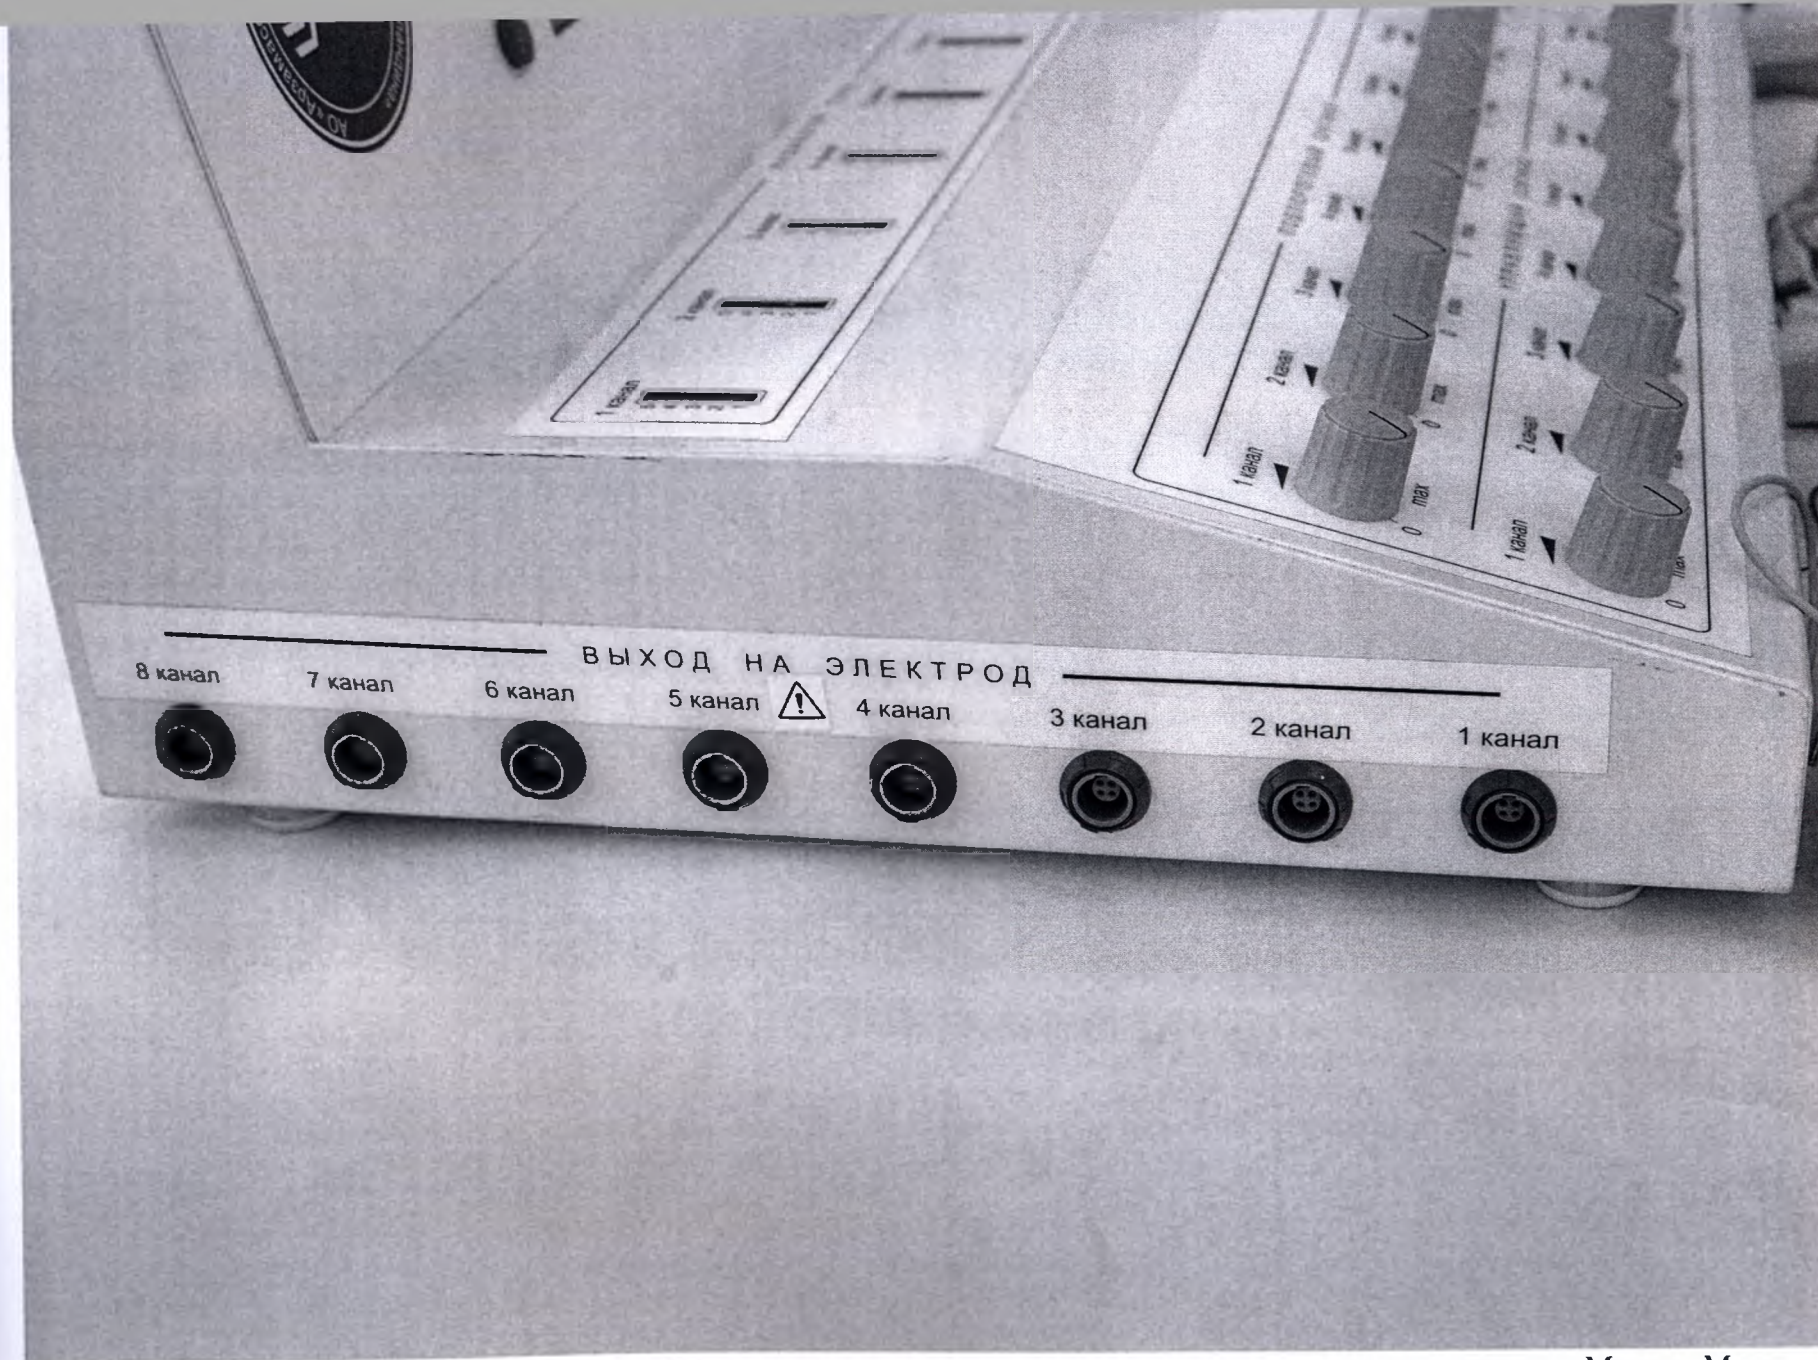

Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Выход на электрод

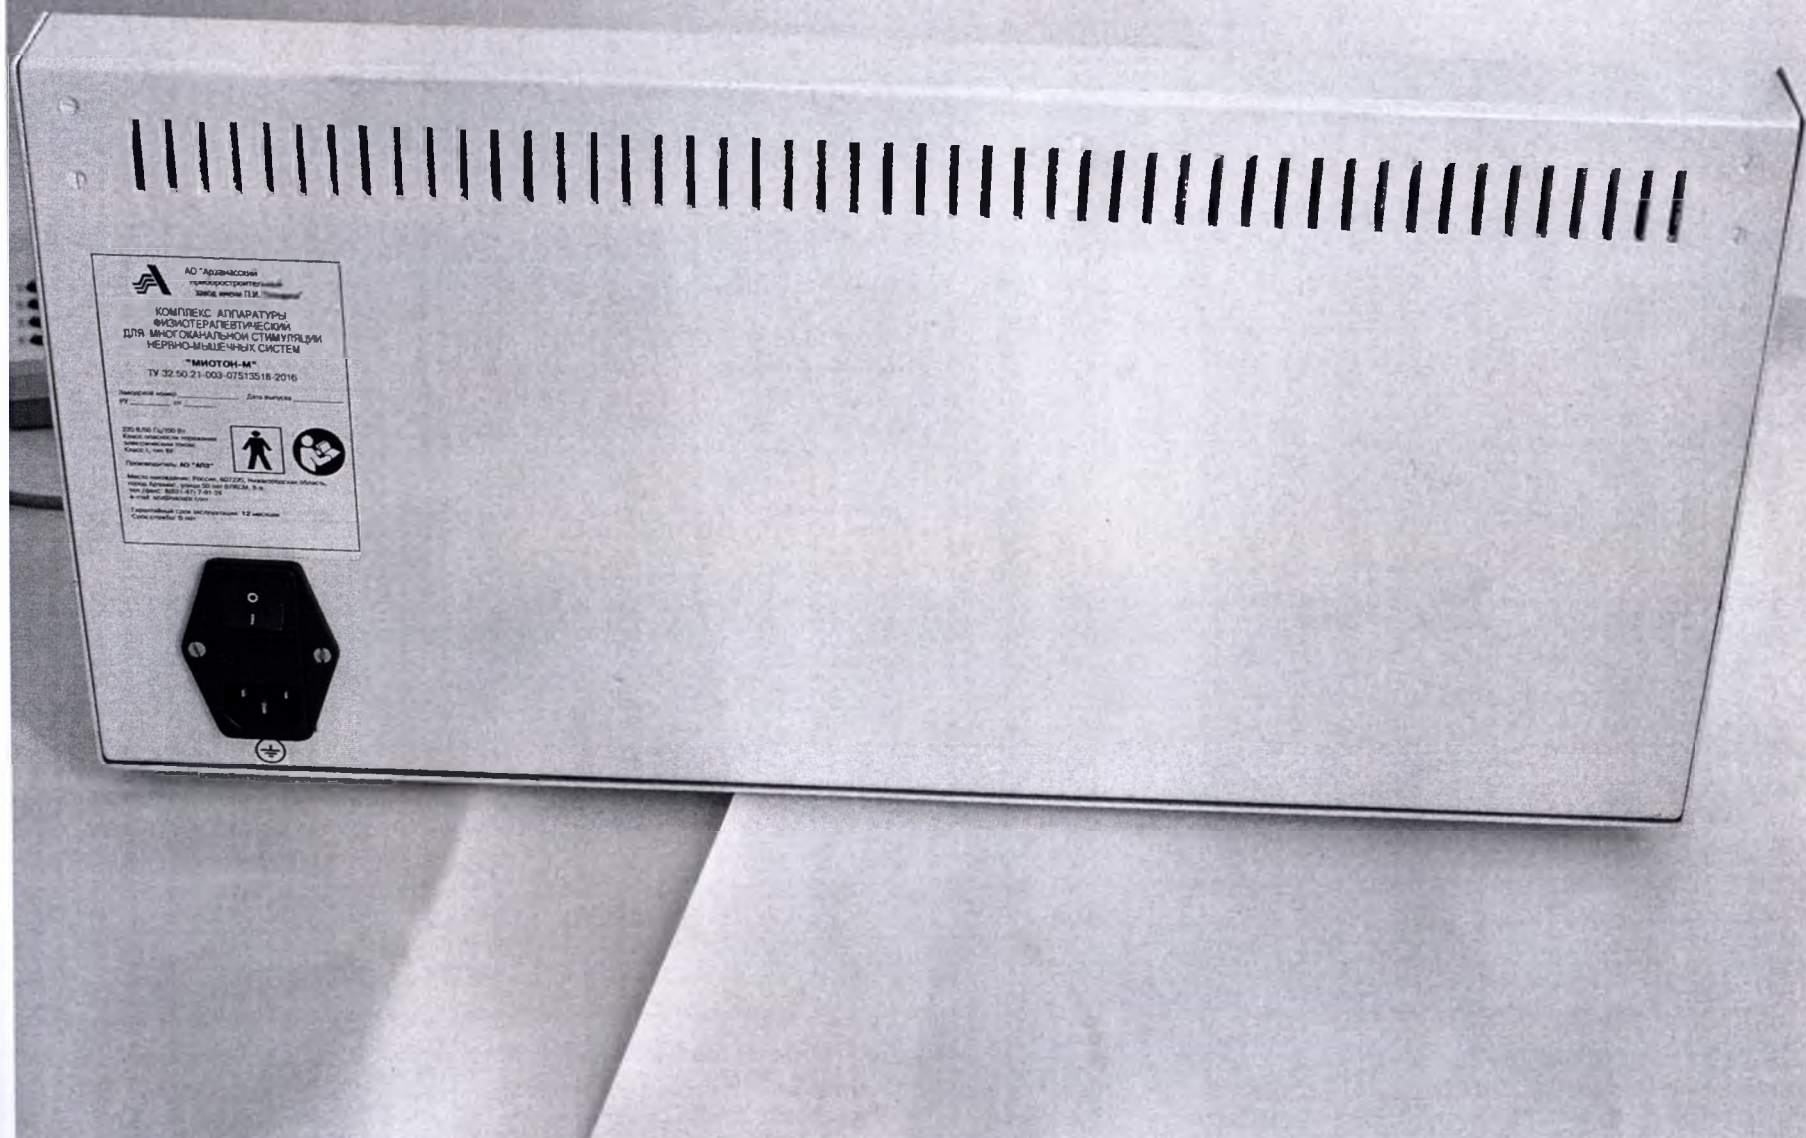

Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
 ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Маркировка блока синтезатора программ



АО "Арзамасский
приборостроительный
завод имени П.И. Пландина"

КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ СИСТЕМ

"МИОТОН-М"

ТУ 32.50.21-003-07513518-2016

Заводской номер _____ Дата выпуска _____
РУ _____ ОТ _____


220 В/50 Гц/100 Вт
Класс опасности поражения
электрическим током:
Класс I, тип BF



Производитель: АО "АПЗ"

Место нахождения: Россия, 607220, Нижегородская область,
город Арзамас, улица 50 лет ВЛКСМ, 8-а.
тел./факс: 8(831-47) 7-91-24
e-mail: apz@oaoapz.com


Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев
Срок службы: 5 лет.

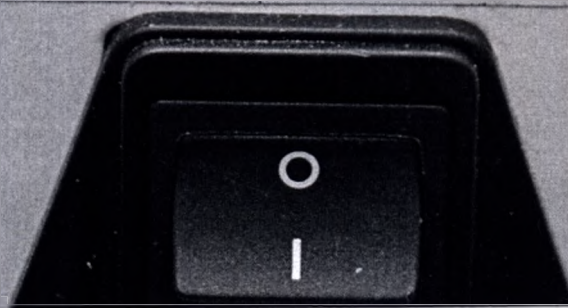

Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем
«Миотон-М» ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Маркировка блока синтезатора программ




Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Блок ввода миограмм

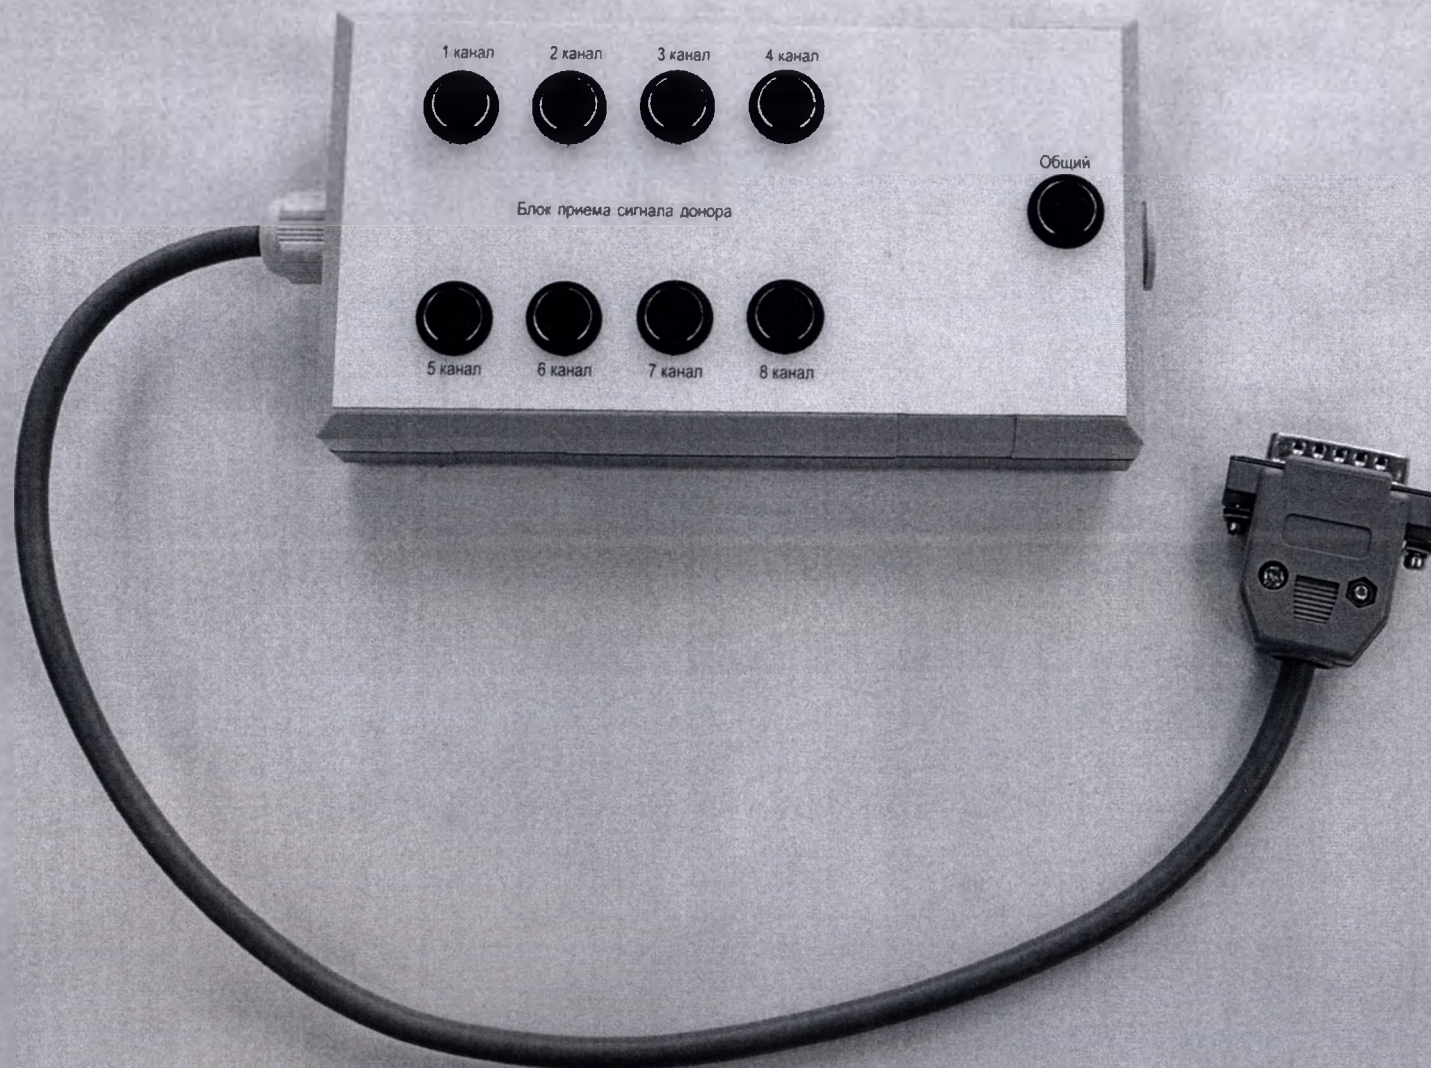


Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Блок приема сигнала с донора




Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Флэш-носитель

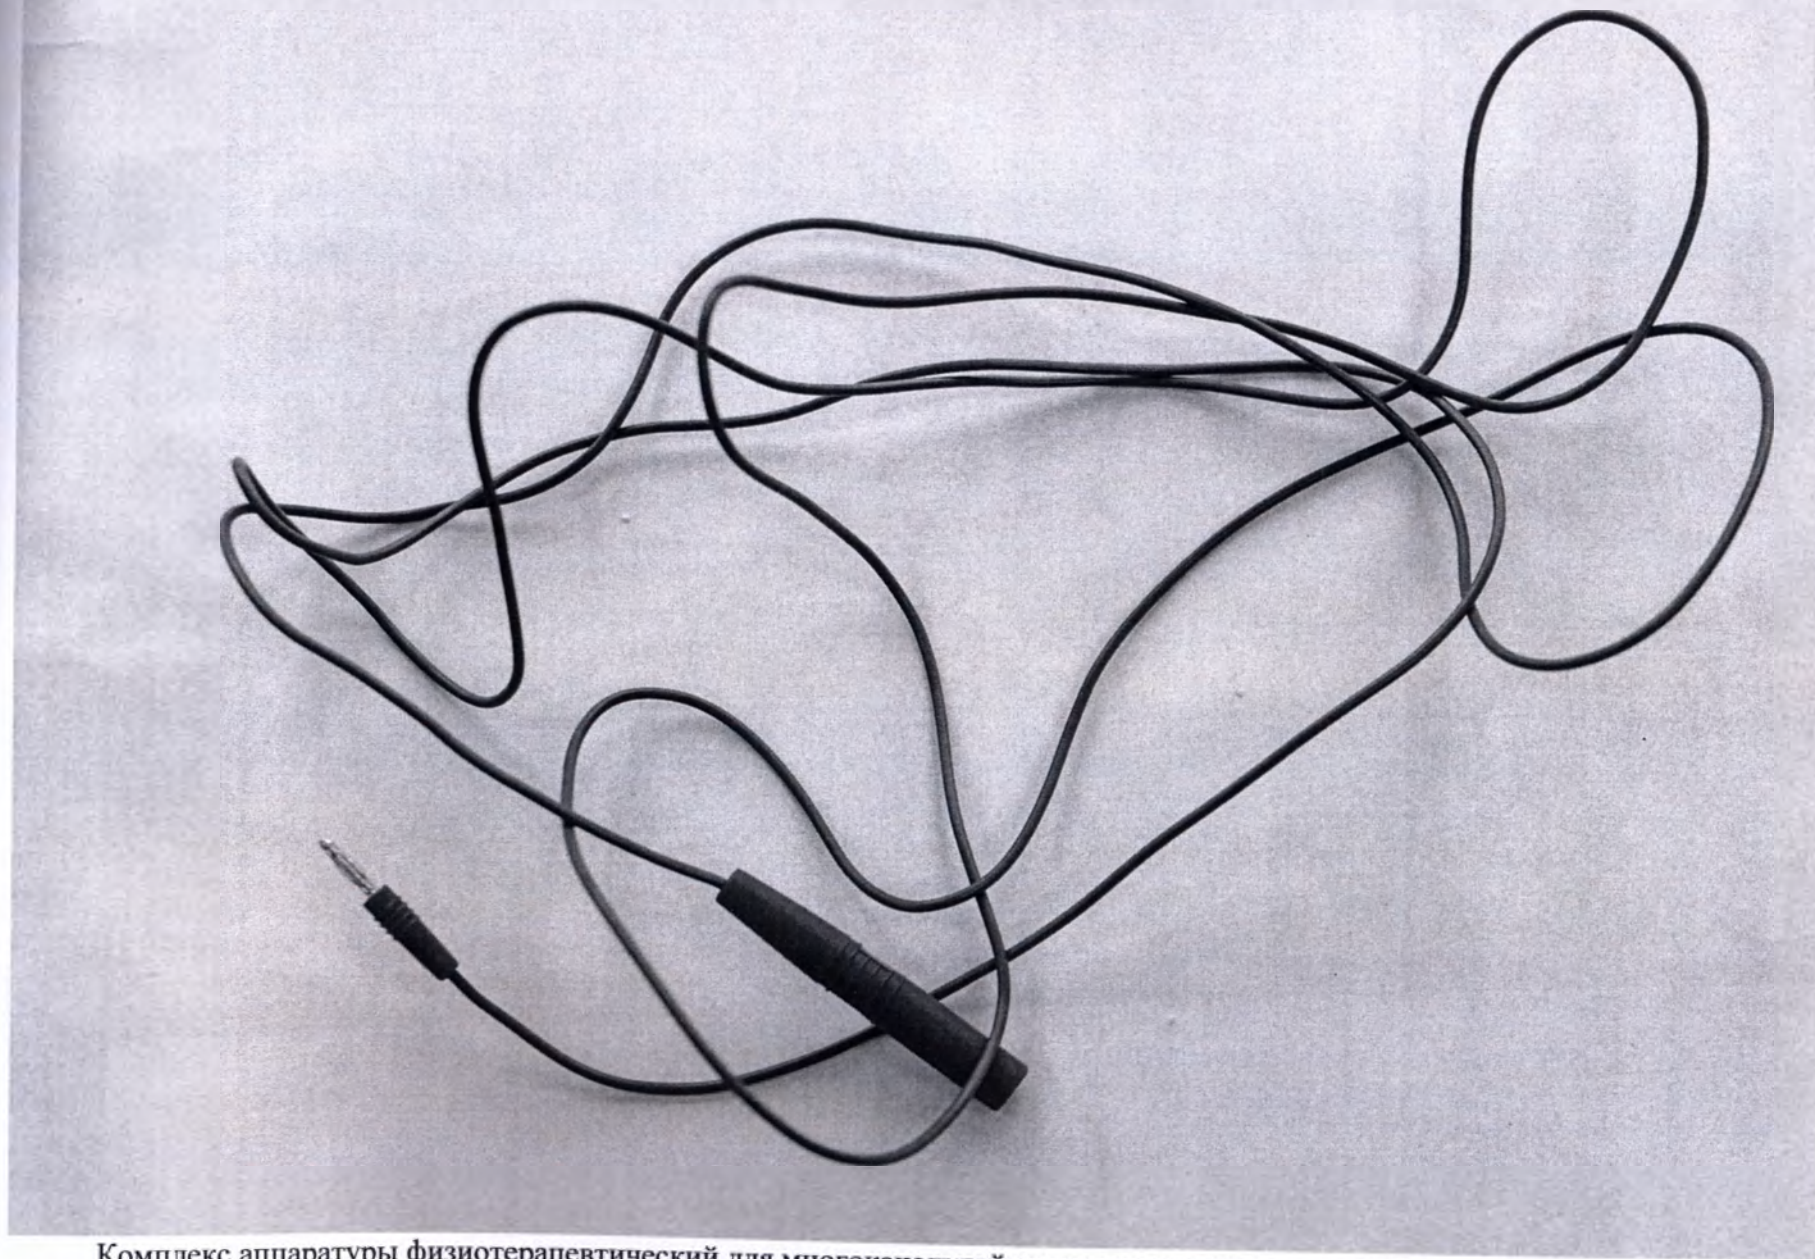


Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Кабель одноконтактный ПХВ красный, 2 м со штекером диам. 2 мм для аппарата «PHYSIOMED» 5.580

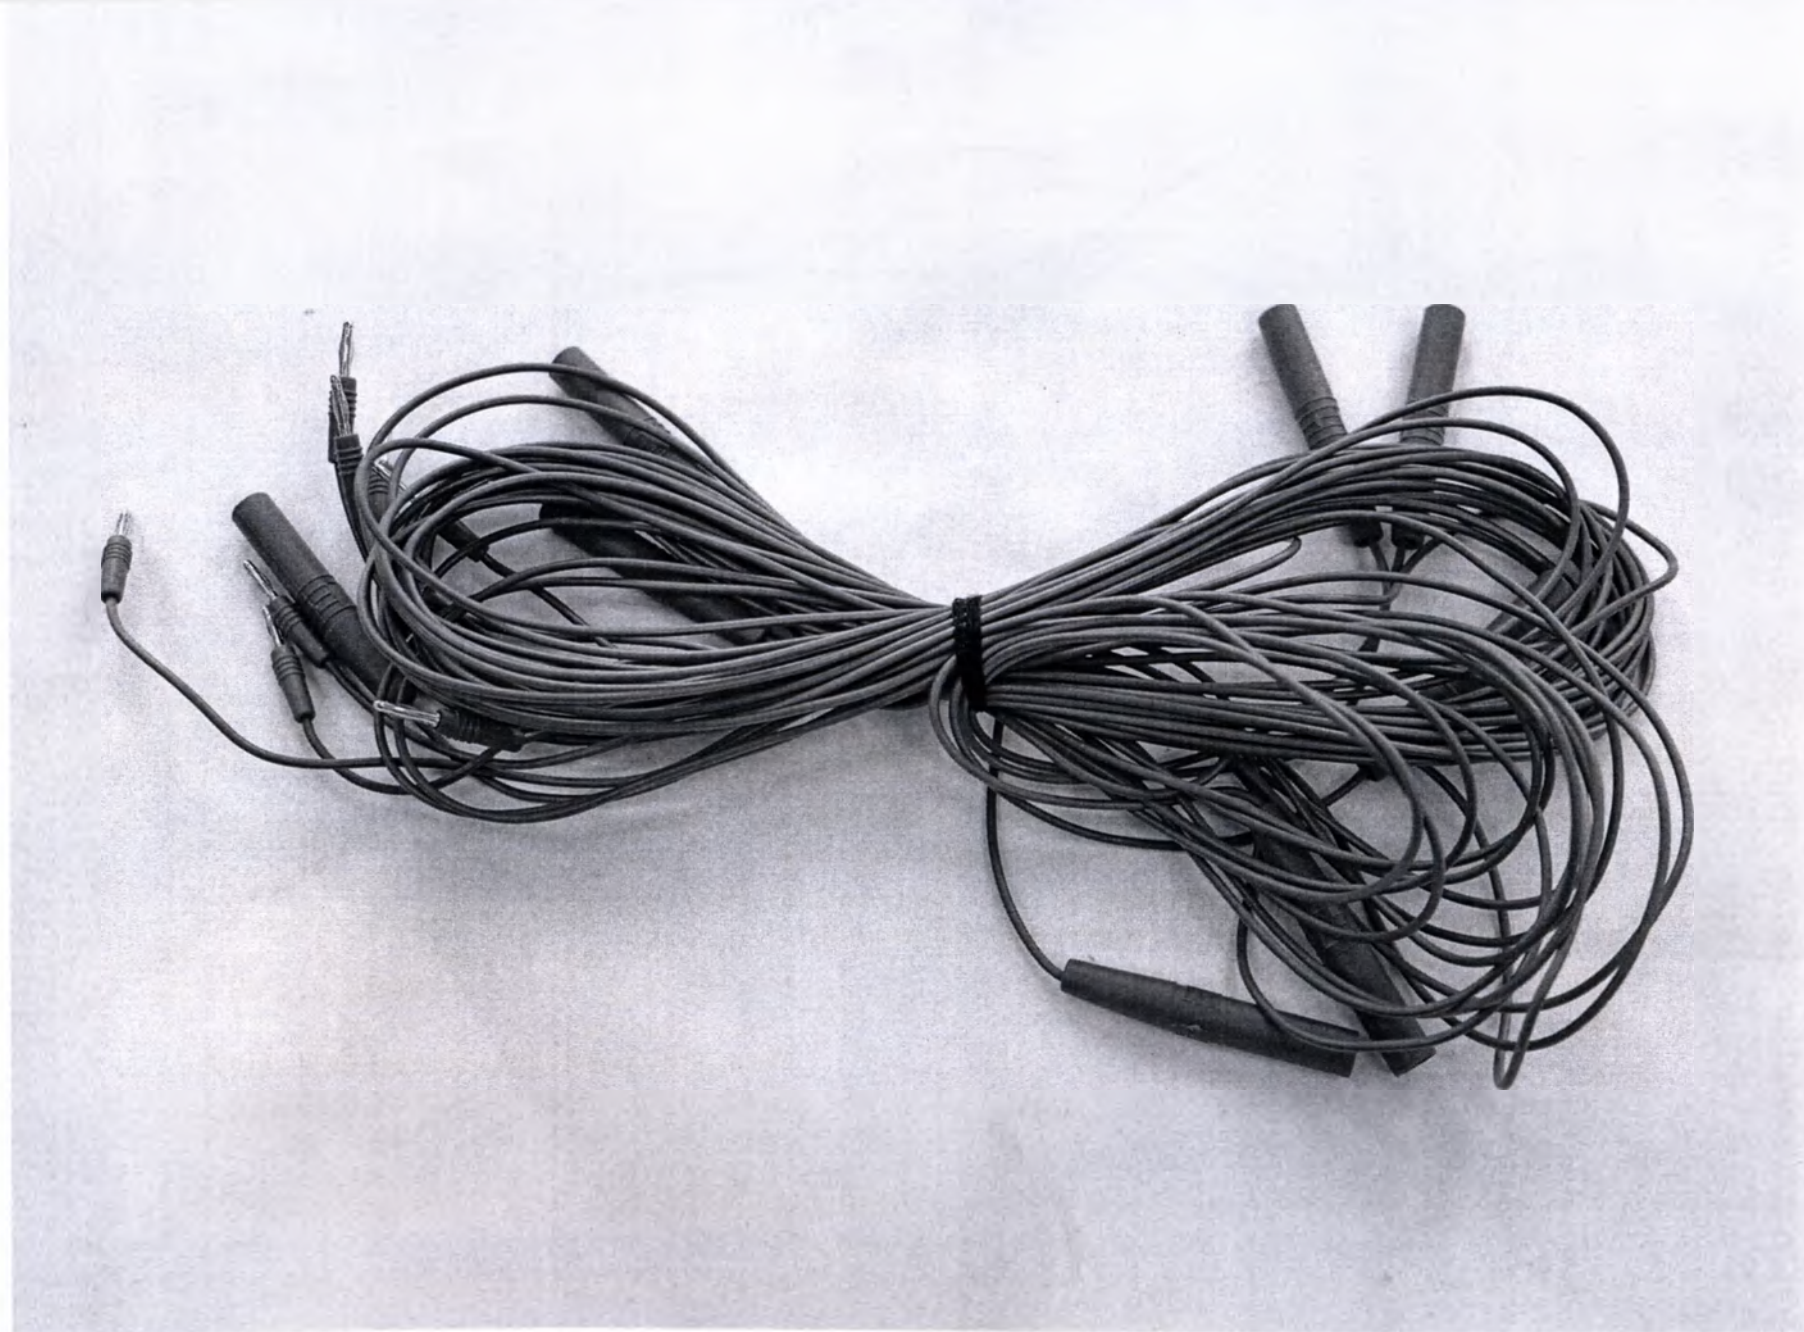


Комплекс аппаратуры физиотерапевтической для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Кабель одноконтактный ПХВ красный, 2 м со штекером диам. 2 мм для аппарата «PHYSIOMED» 5.580 – 8 шт.

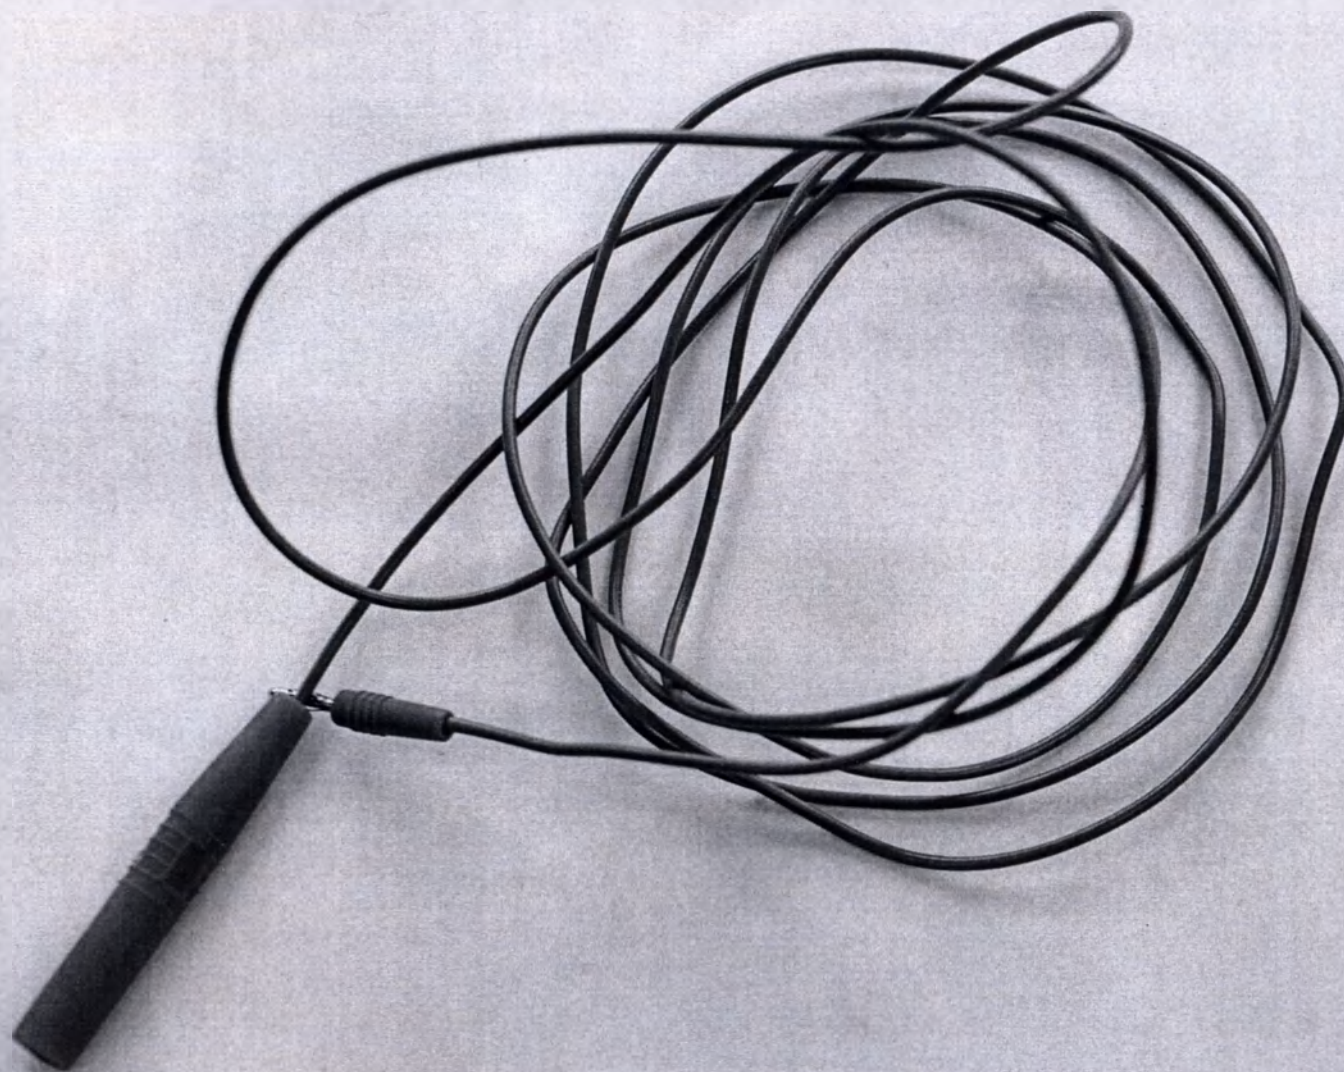


Комплекс аппаратуры физиотерапевтической для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Кабель одноконтактный ПХВ синий, 2 м со штекером диам. 2 мм для аппарата «PHYSIOMED» 5.580

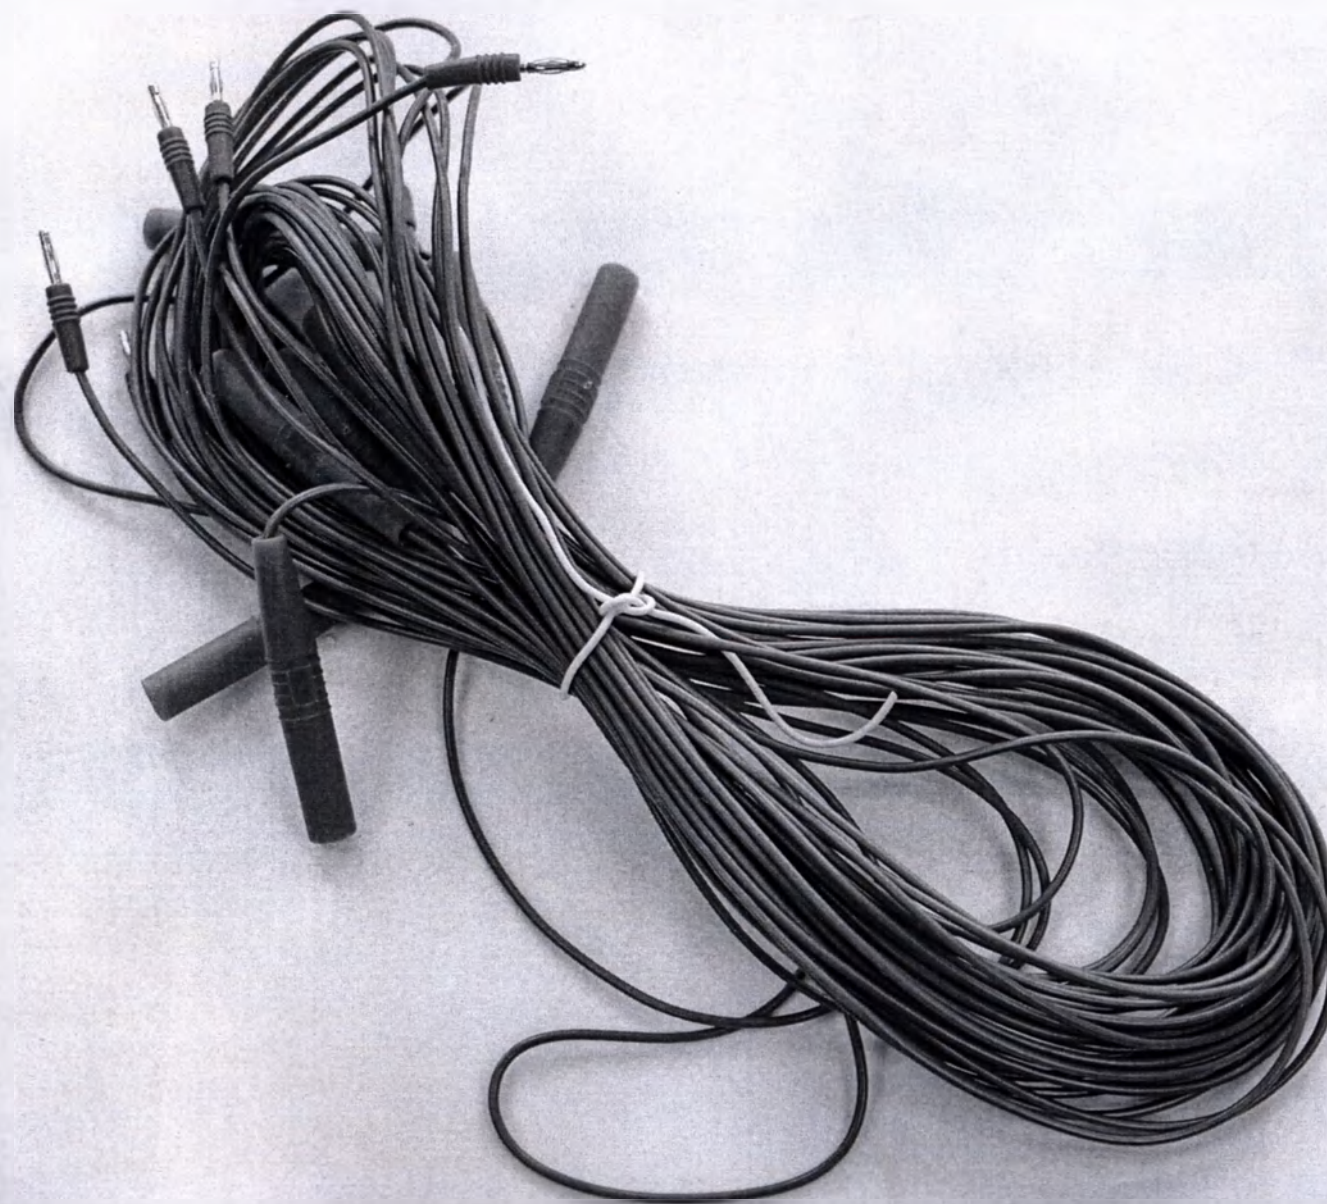


Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М» ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Кабель одноконтактный ПХВ синий, 2 м со штекером диам. 2 мм для аппарата «PHYSIOMED» 5.580 – 8 шт.

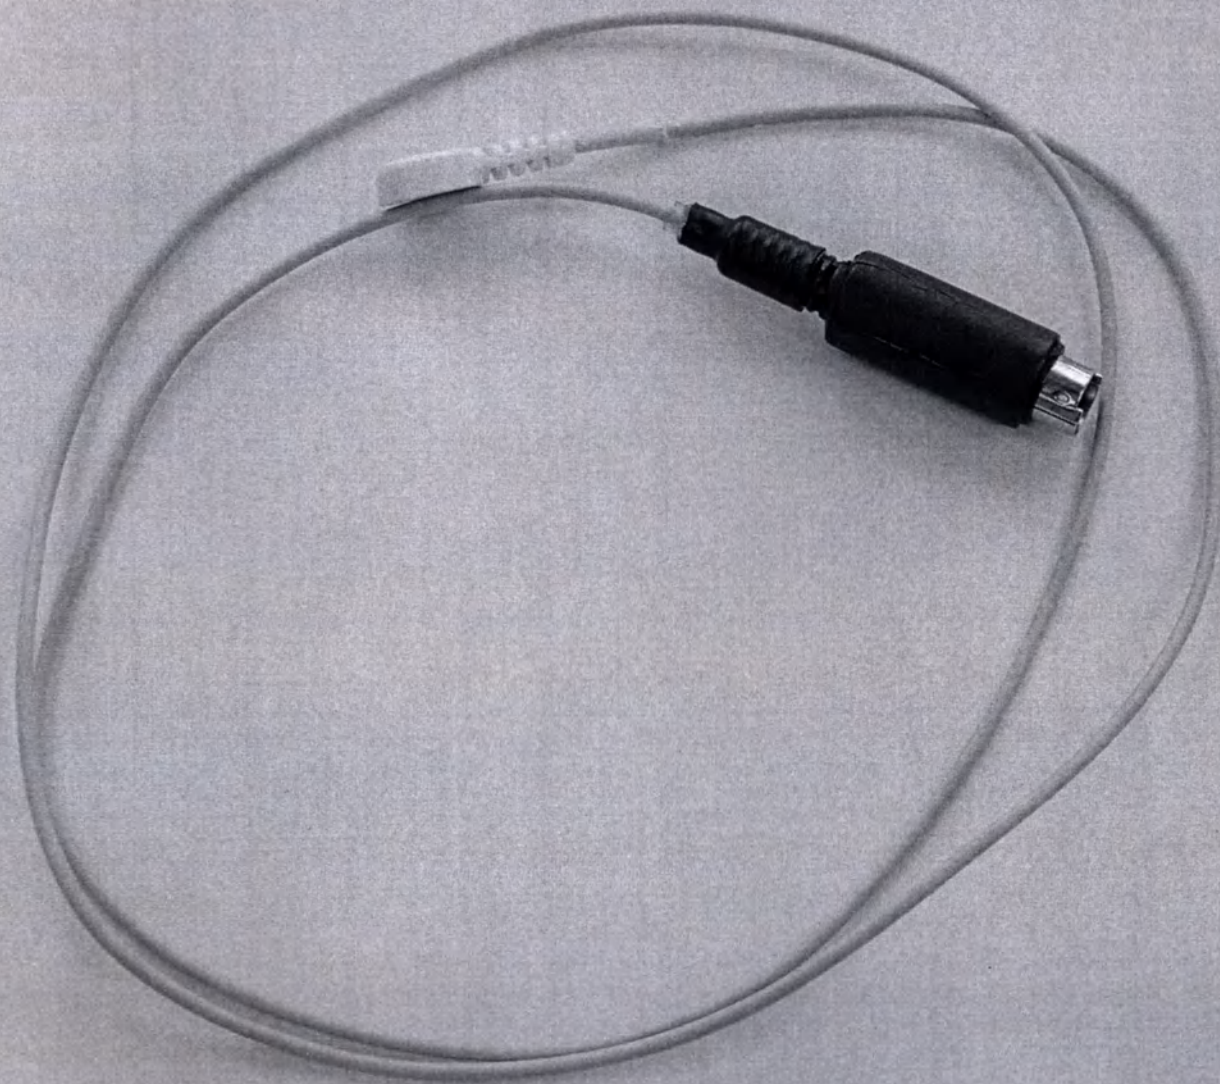


Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М» ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Кабель донора (общий)

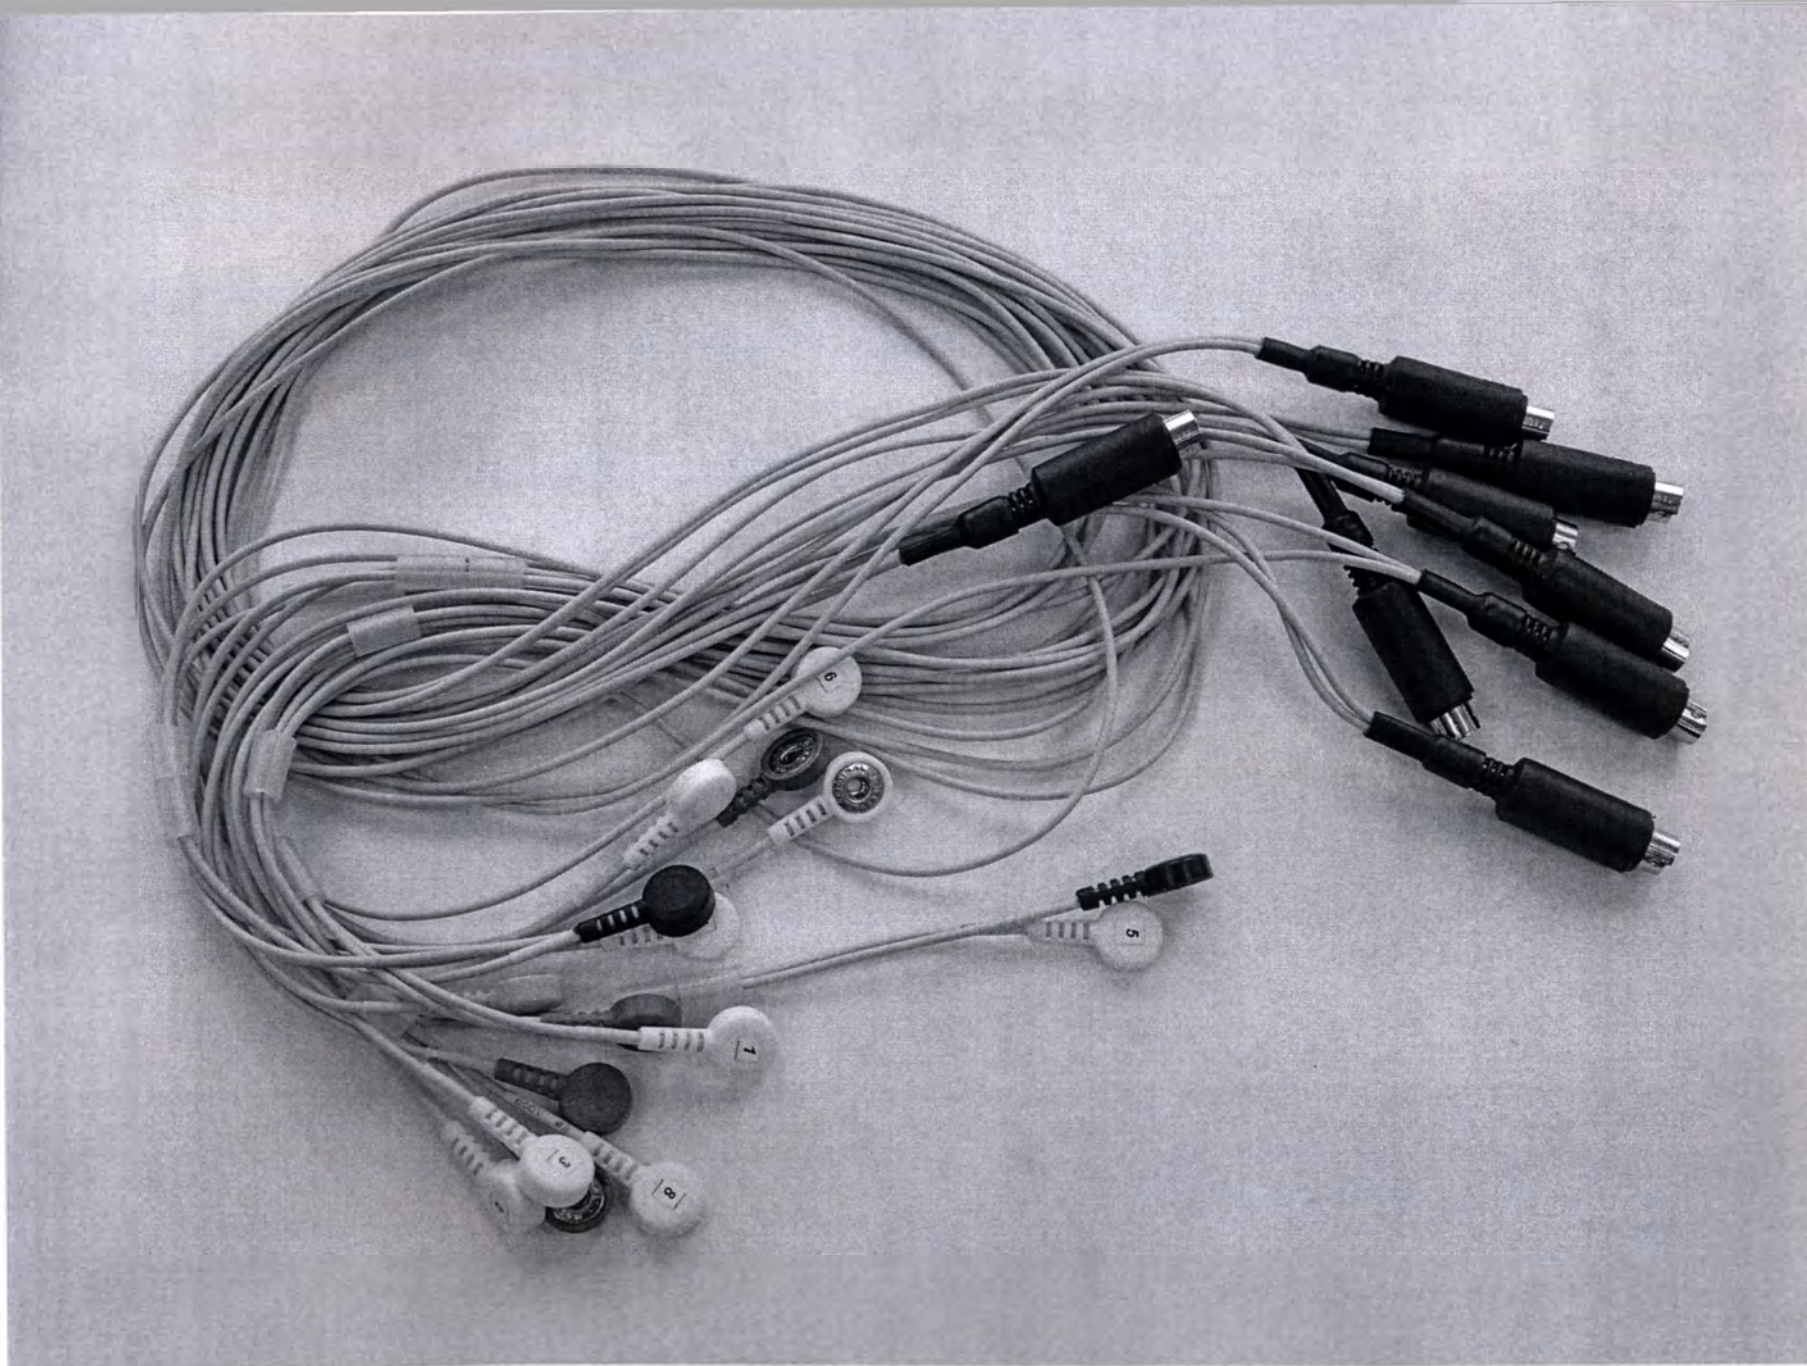


Комплекс аппаратуры физиотерапевтической для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Кабель донора (для снятия сигнала) – 8 шт.

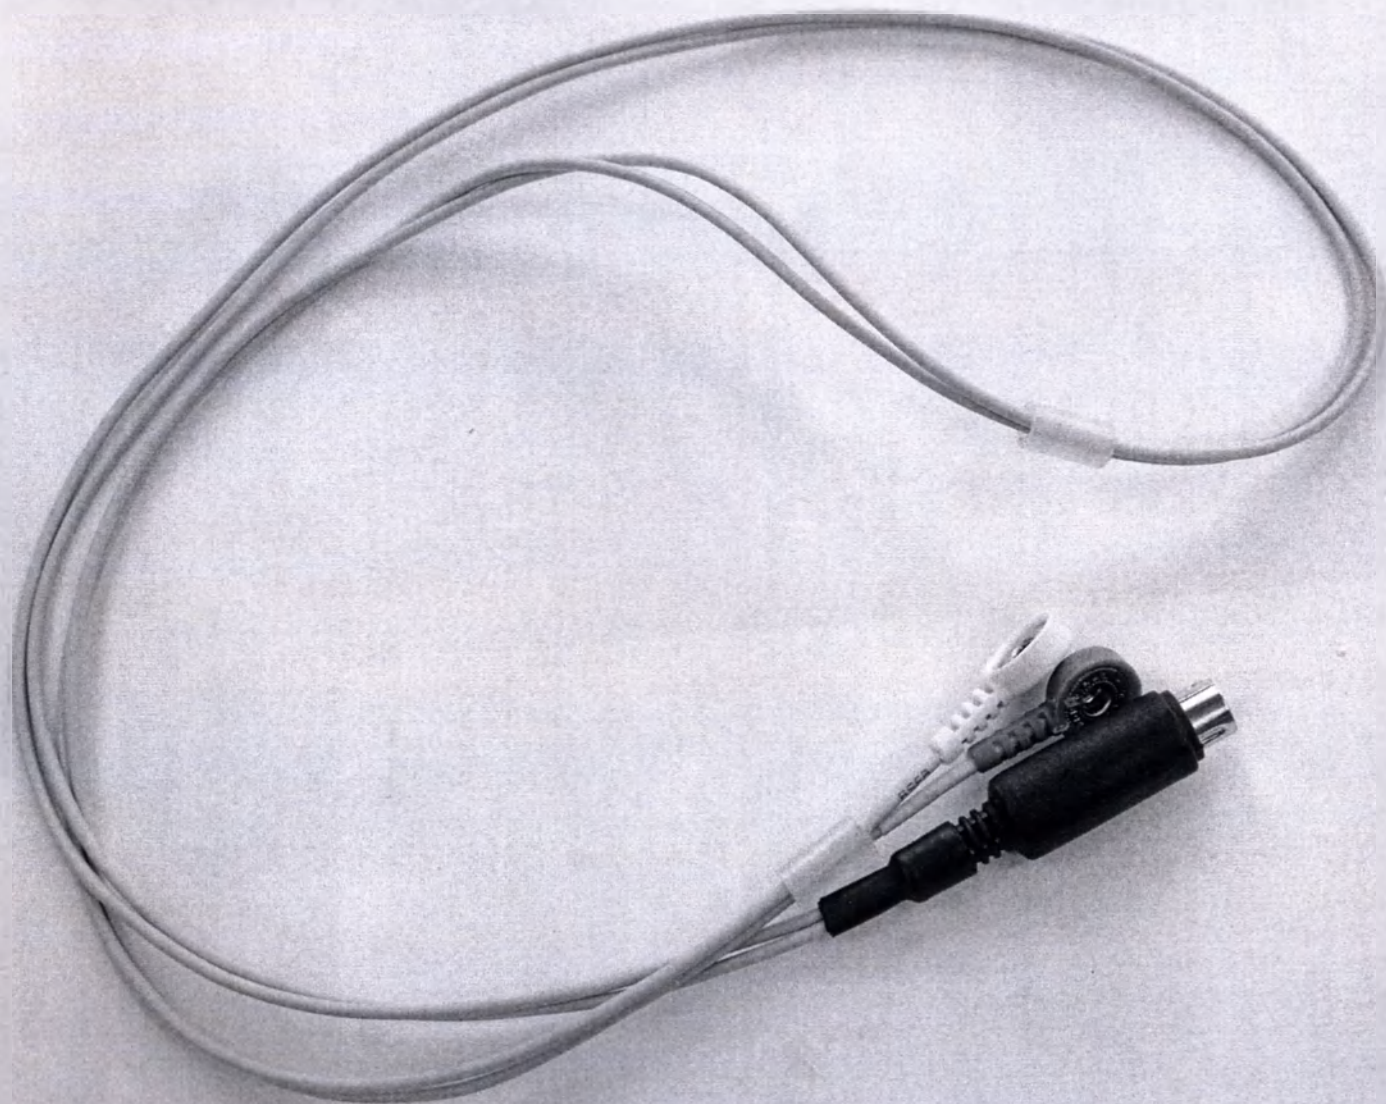


Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Кабель донора (для снятия сигнала)

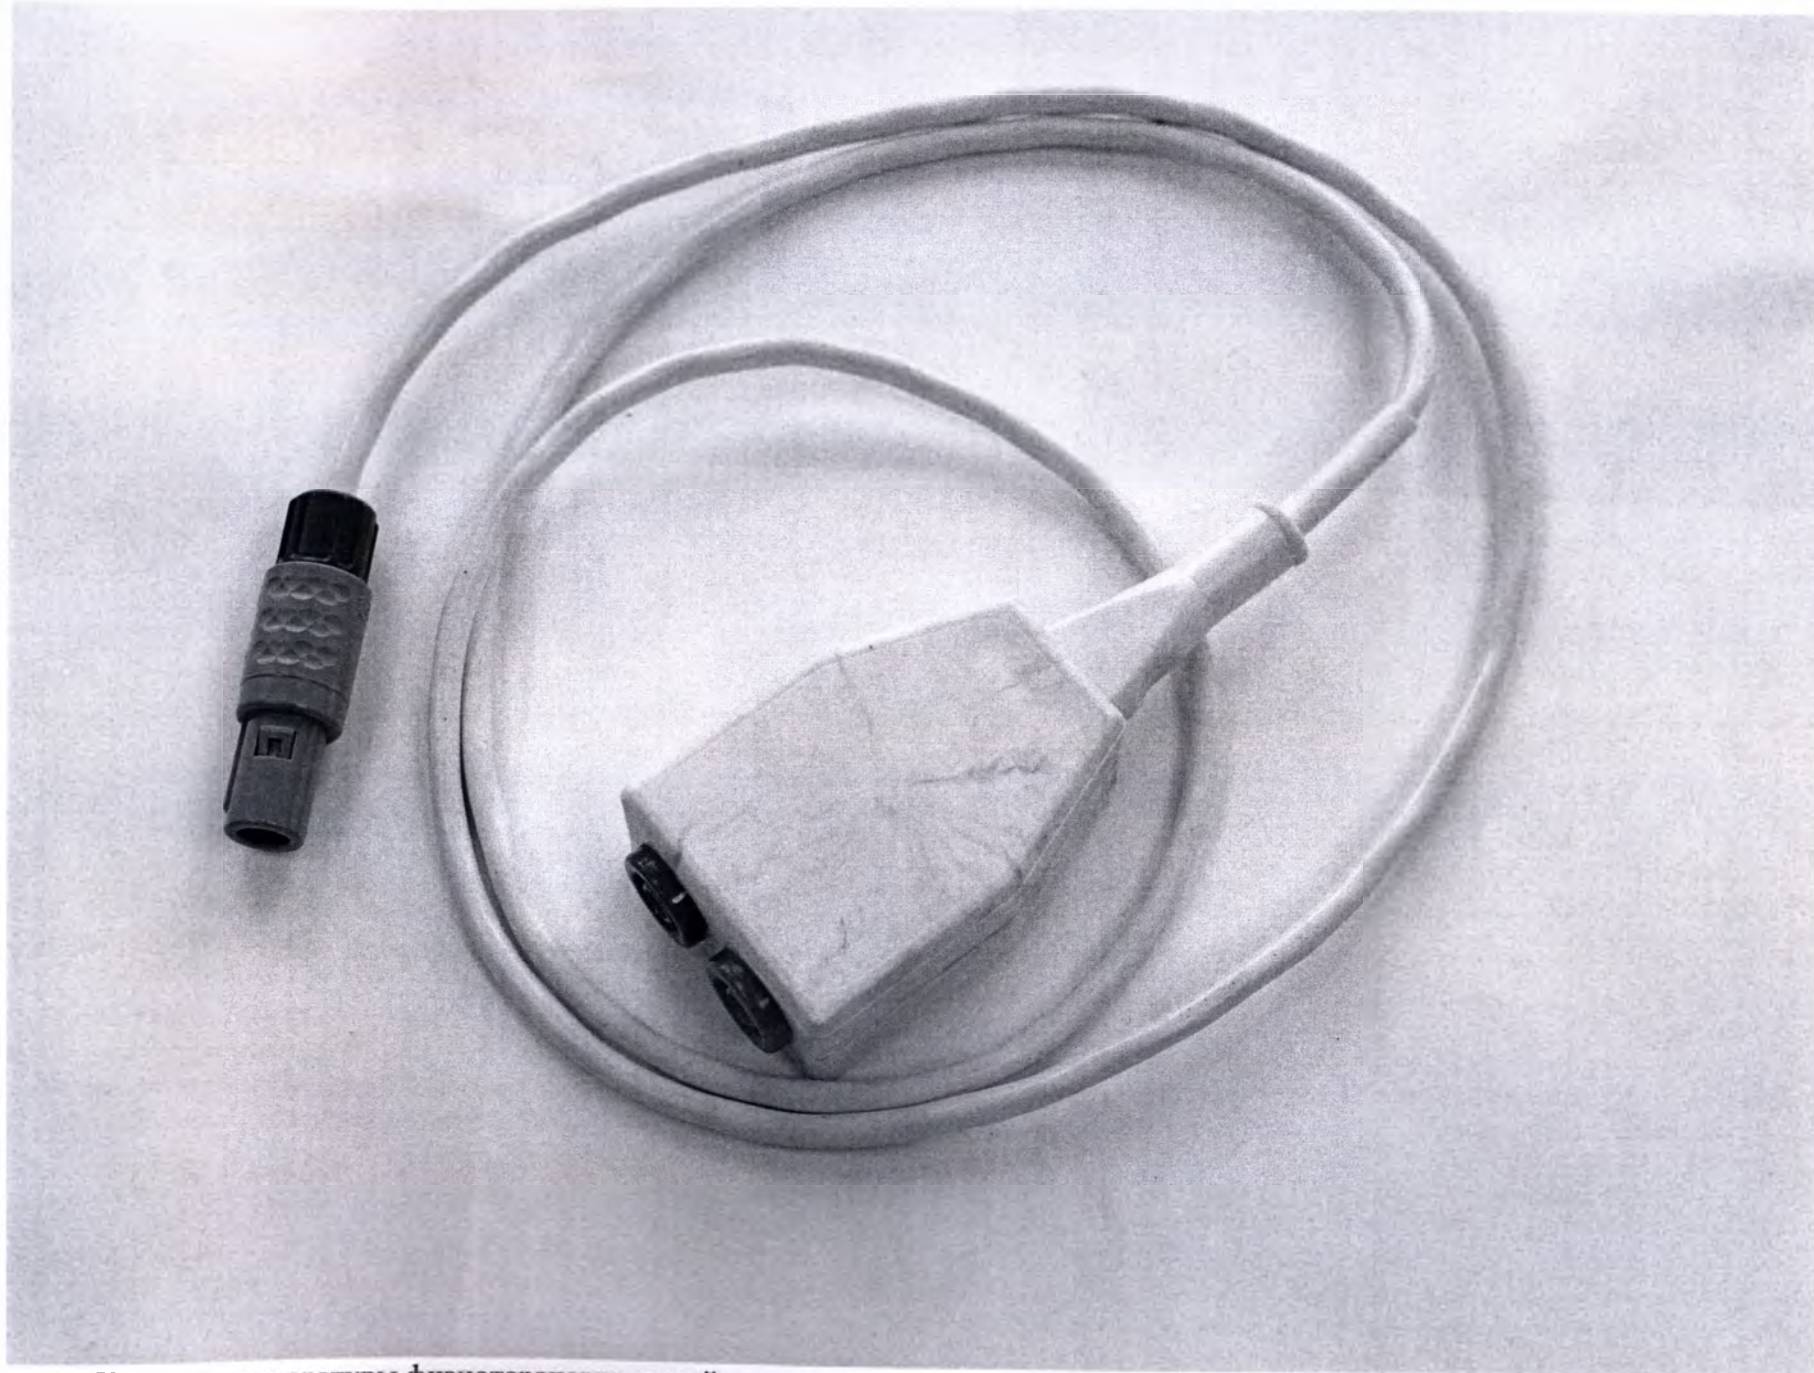


Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 003-07513518-2016: Кабель магистральный биполярный 1 м с распределительной колодкой

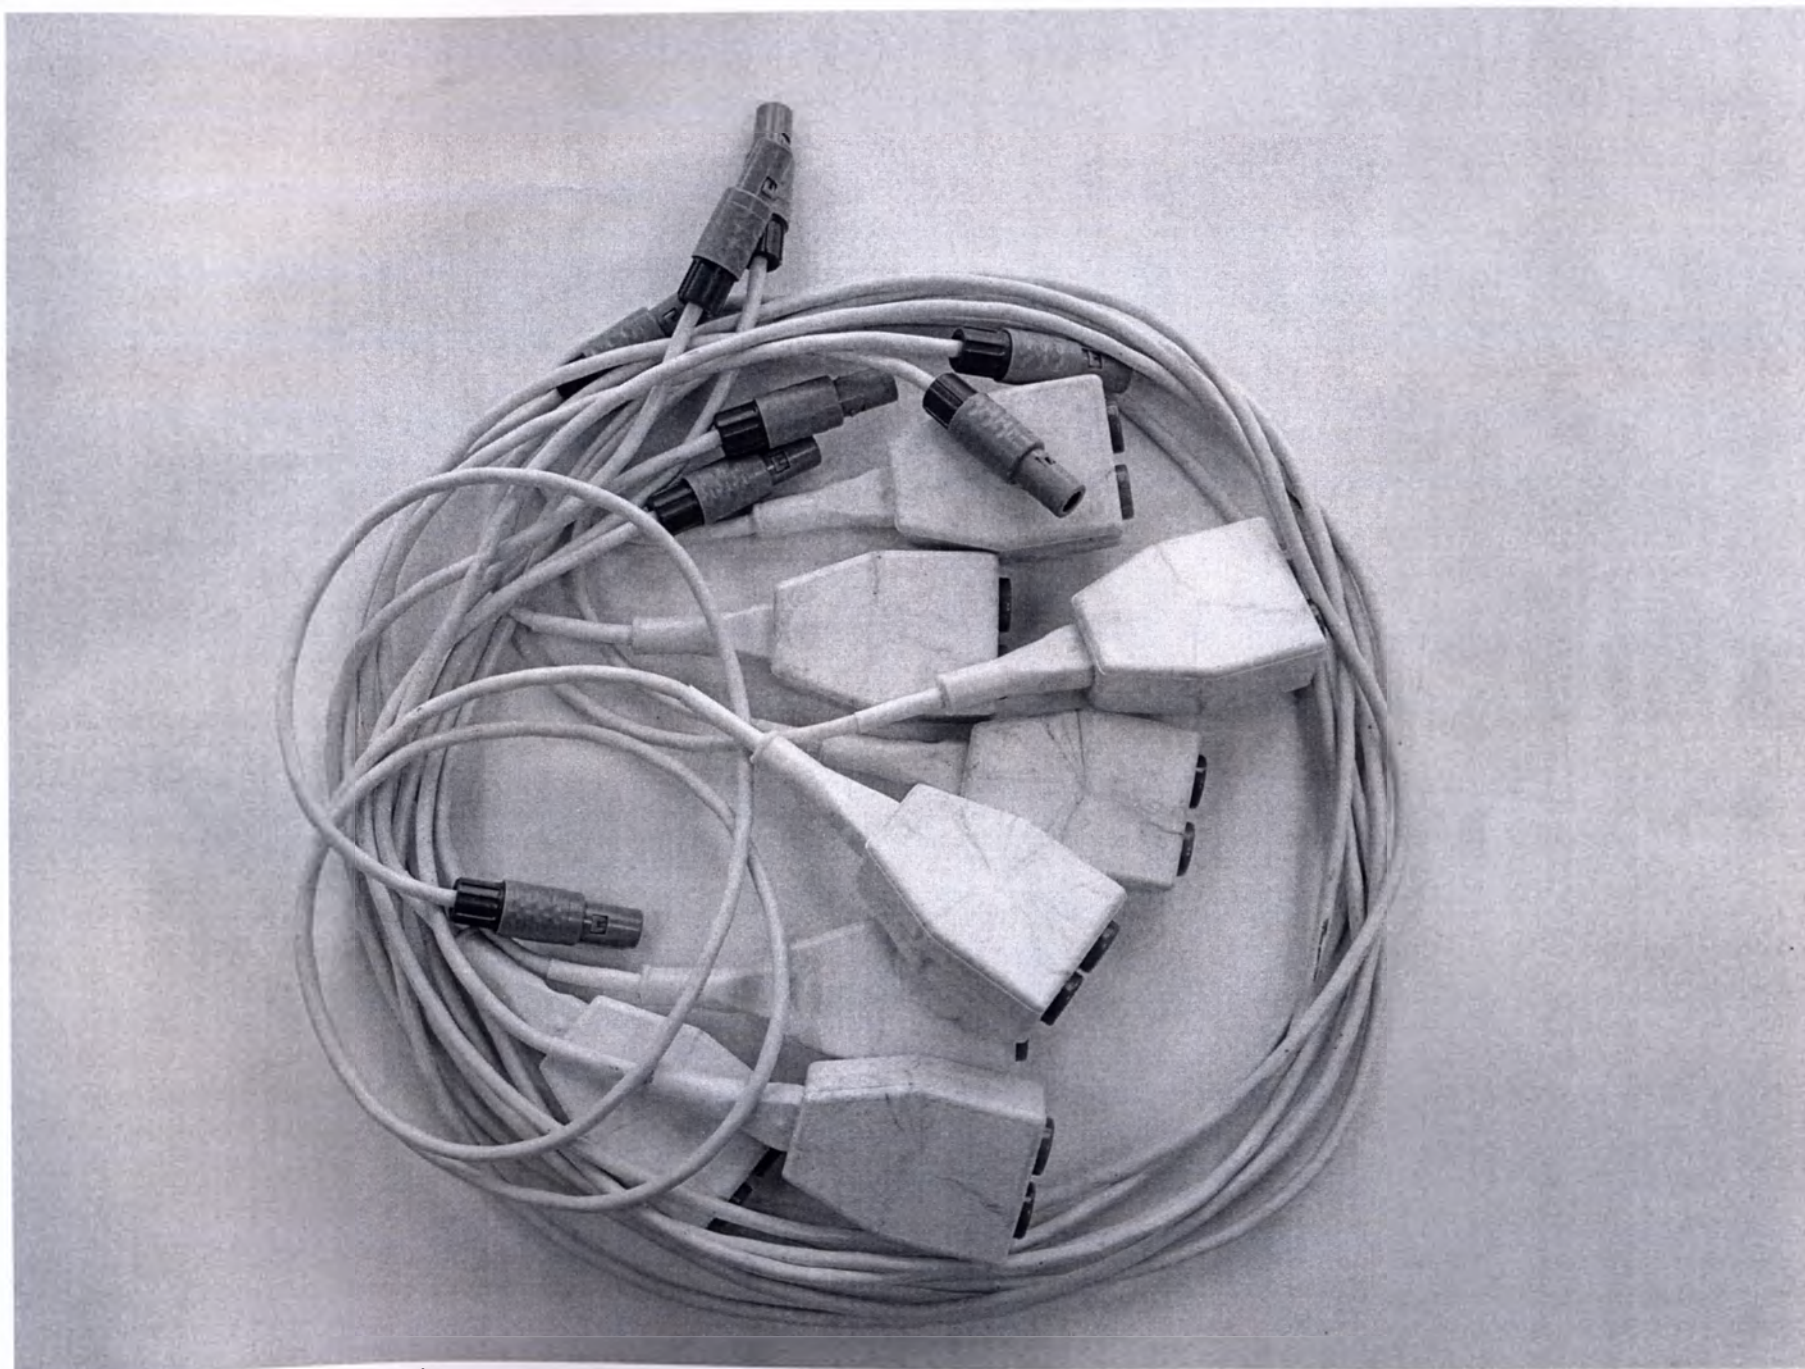

Комплекс аппаратуры физиотерапевтической для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Кабель магистральный биполярный 1 м с распределительной колодкой – 8 шт.

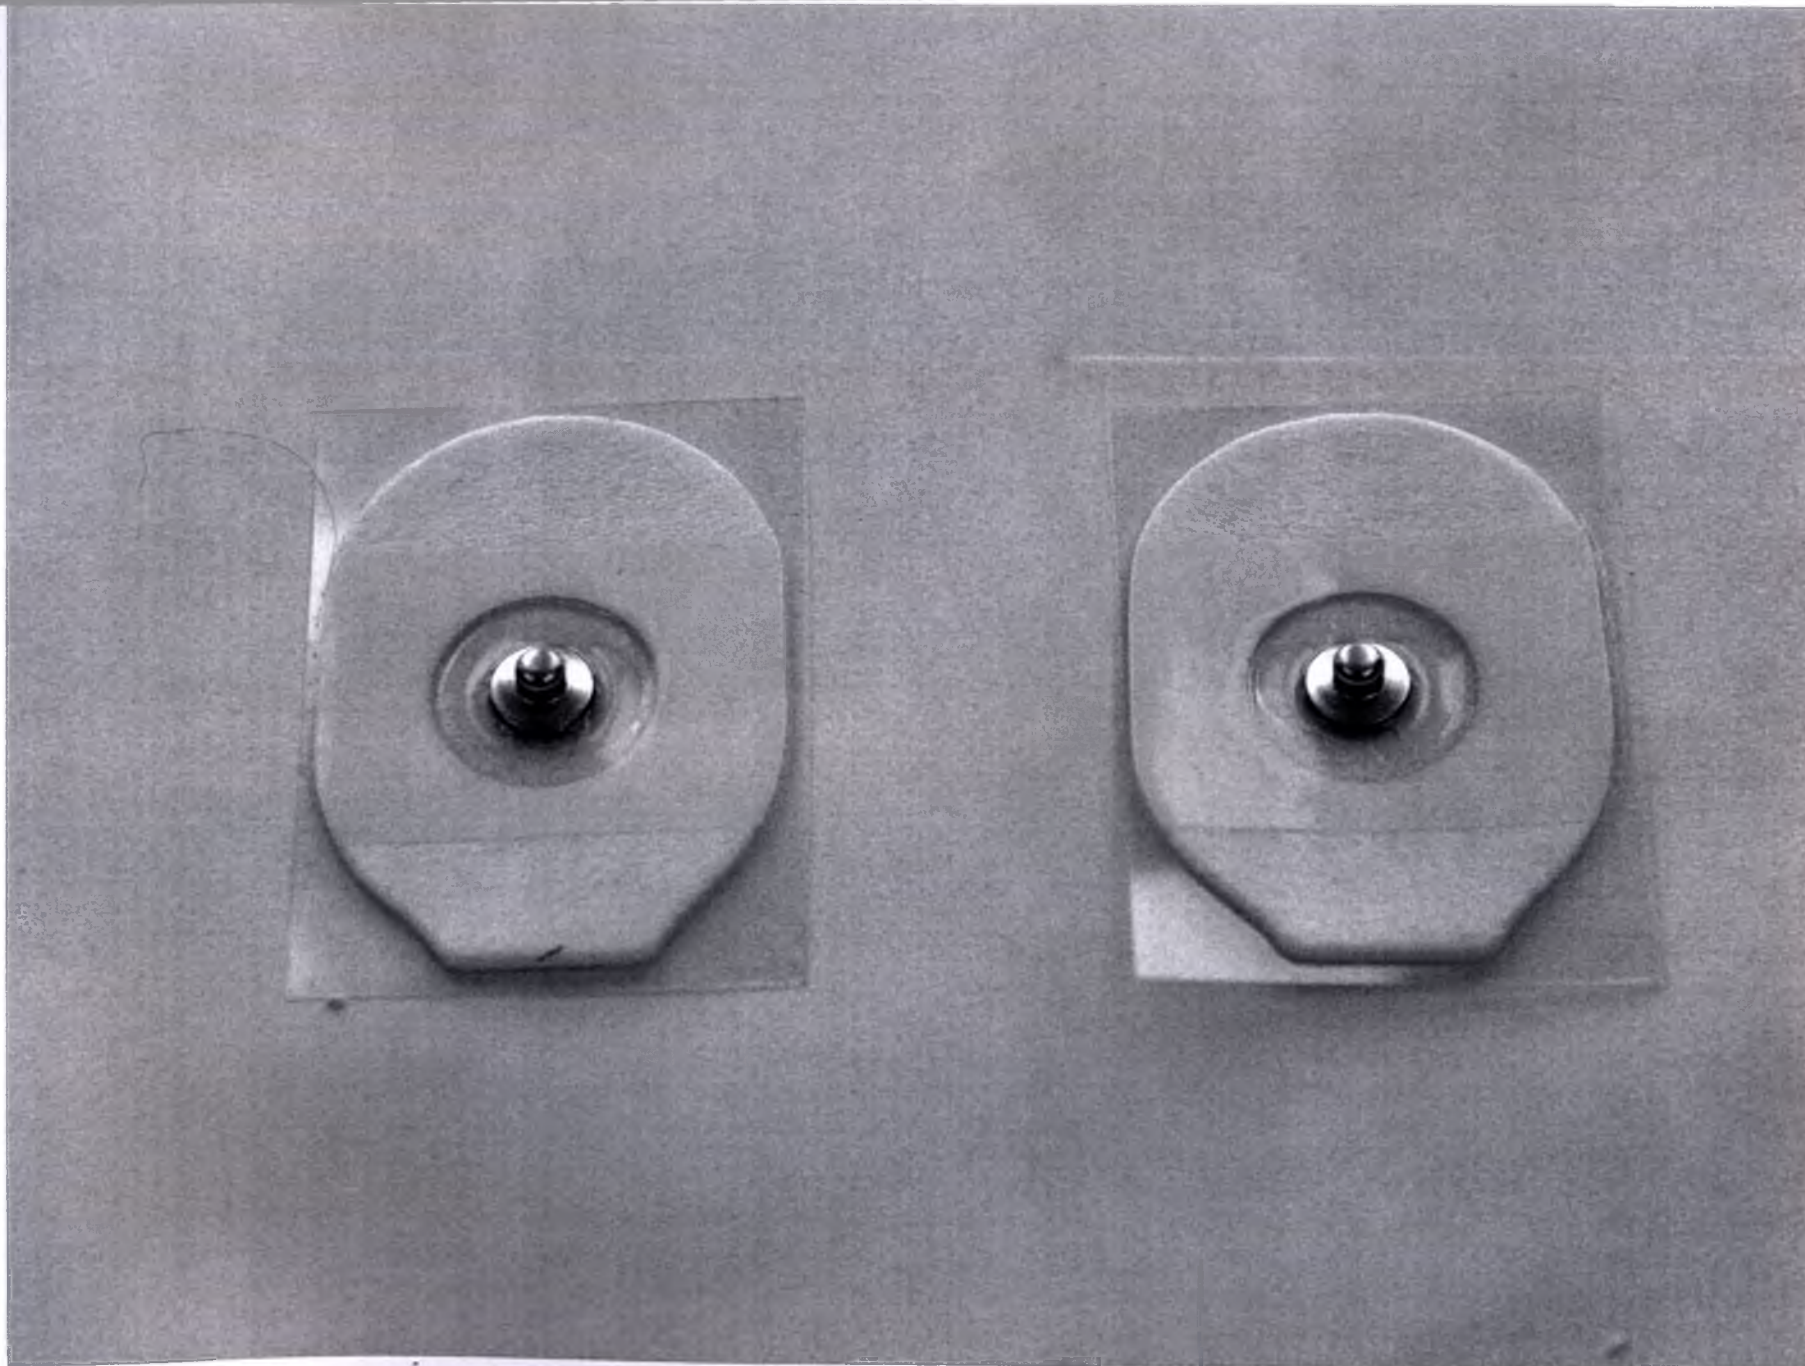

Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: Одноразовый электрод F9049/RU

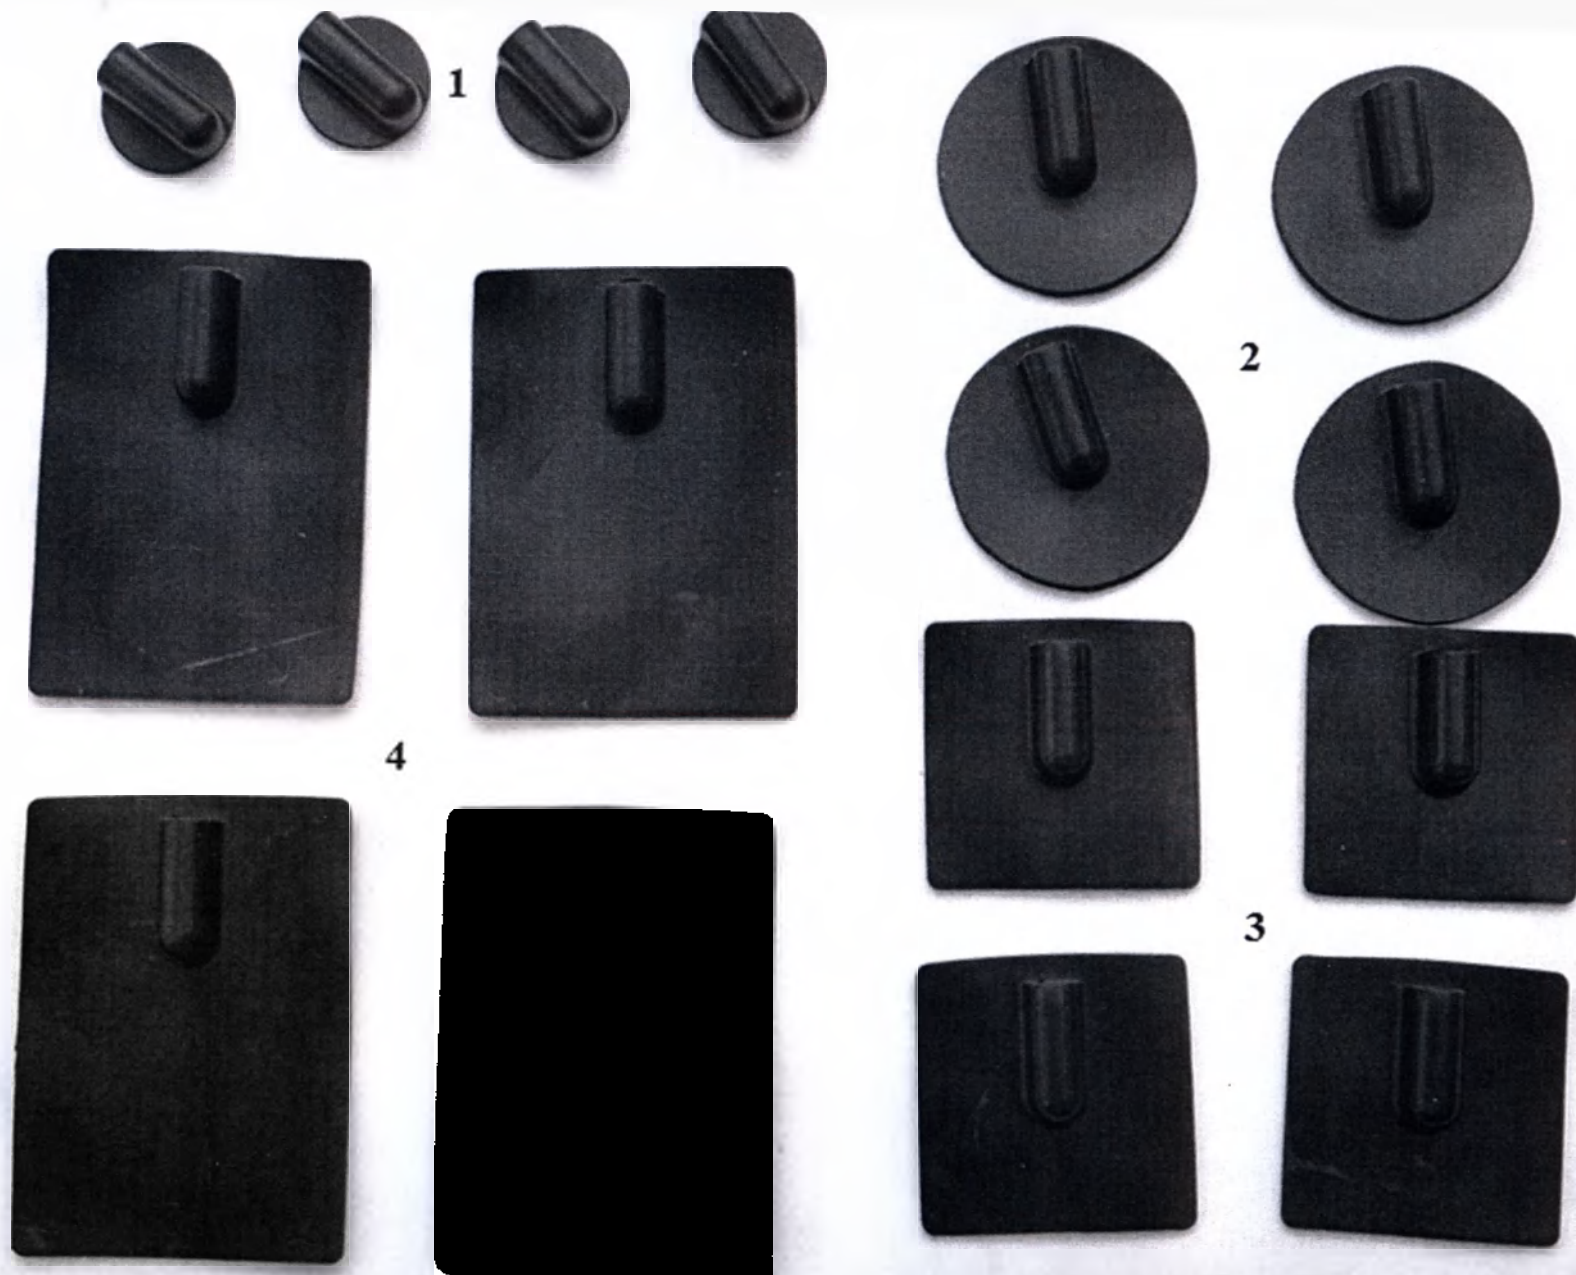

Комплекс аппаратуры физиотерапевтической для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М»
 ТУ 32.50.21-003-07513518-2016: 1 – Электрод круглый PG-925/2 диам. 25 мм с гнездом диам. 2 мм – 4 шт.; 2 – Электрод круглый PG-950/2
 диам. 50 мм с гнездом диам. 2 мм – 4 шт.; 3 – Электрод силиконовый прямоугольный PG-970/2 размером 50 x 50 мм с гнездом диам. 2 мм – 4
 шт.; 4 – Электрод силиконовый прямоугольный PG-980/2 размером 60 x 85 мм с гнездом диам. 2 мм – 4 шт.

Пролито и пронумеровано и скреплено
печатью 19 листа(ов).

Должность,

ФИО Директор по производству и
продажам гражданской продукции

В.Р. Былькин

(подпись)

М.П.

« 15 » мая 20 18 года