

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «АктюбРентген»

Н. А. Морозов

« 10 » 09 2017 г




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ
ИЗДЕЛИЕ:**


Аппарат рентгенофлюорографический цифровой малодозовый "РЕНАР"
по ТУ 9442-002-14580254-2016

Аппарат рентгенографический цифровой малодозовый «РЕНАР-К» по ТУ 9442-002-14580254-2016 в составе:


1 Рентгенозащитная кабина НАПЕ 305127.001 ООО «АктюбРентген», или ТУКЕ 305127.001 ЗАО «ПОНИ», или ВАРЛ 943300.000 ООО НПО «Инвариант»

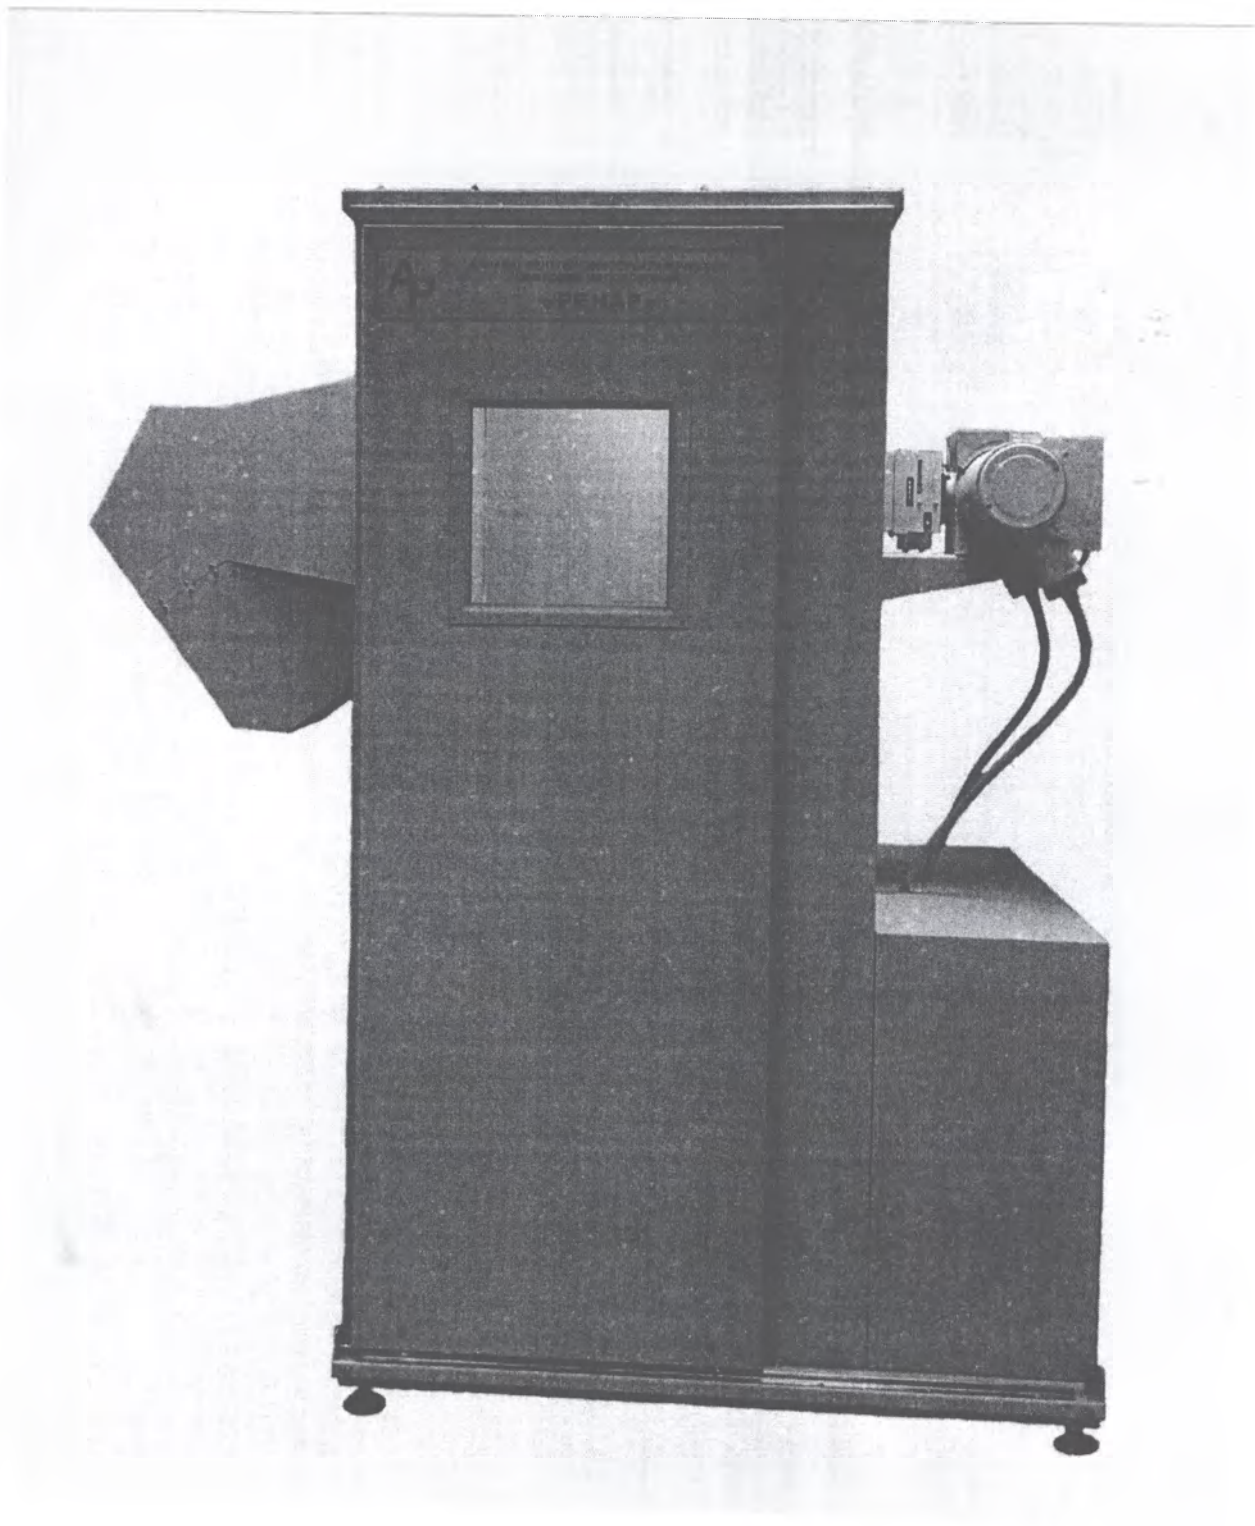


2. Рентгеновское питающее устройство по ТУ 9442-002-75249059-2007 в исполнениях - РПУ ВЧ/1, РПУ ВЧ/2, РПУ ВЧ/3 ООО «НПП ВЭЛИТ» или РПУ «Sedecal» Модель SHF Sedecal S.R.L.

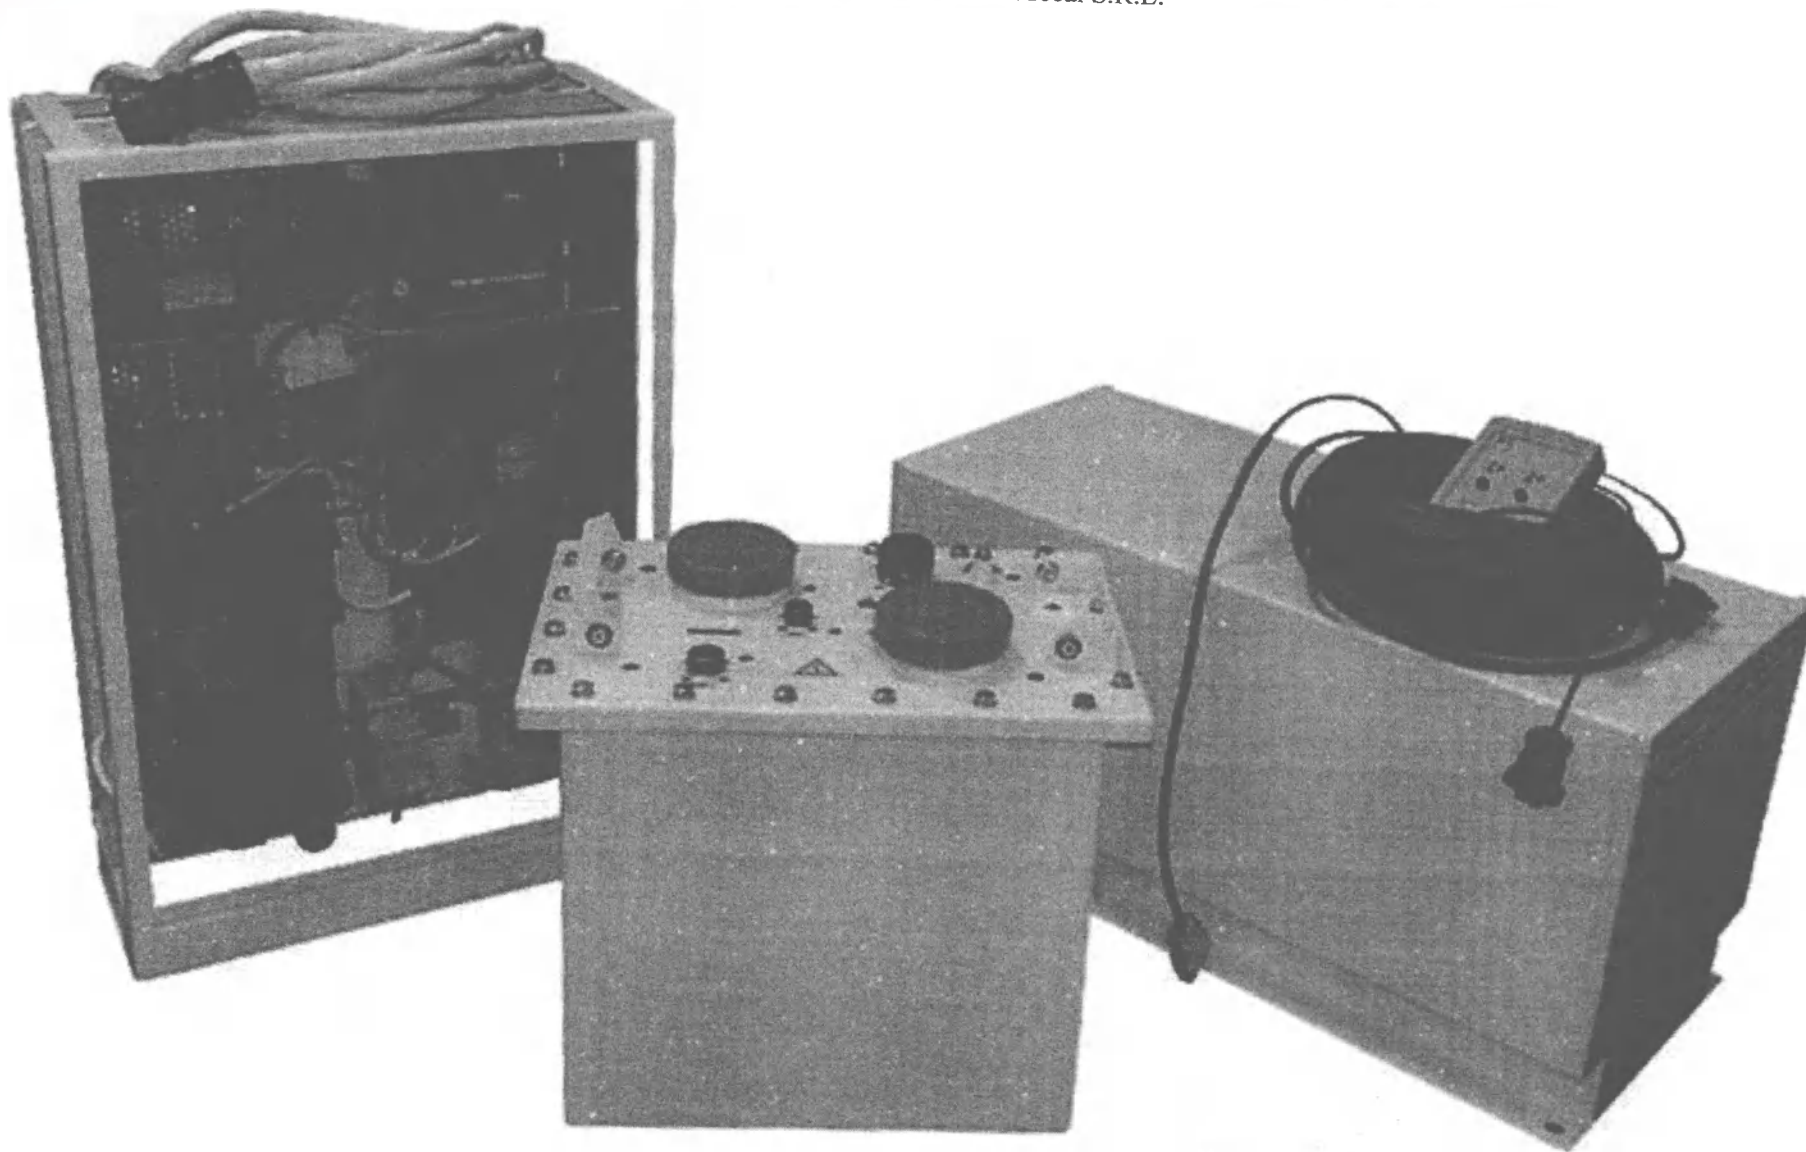


3. Излучатель рентгеновский РИД-1 ООО «АктюбРентген» или РИД-2 ЗАО «АМИКО»,
или излучатель рентгеновский, серии E72XX Toshiba, Electron TUBES & DEVICE Co., Ltd, Япония,
или излучатель C52 I.A.E.S.p.A., Италия, или излучатель рентгеновский серии RAY14 SiemensAG, Китай.

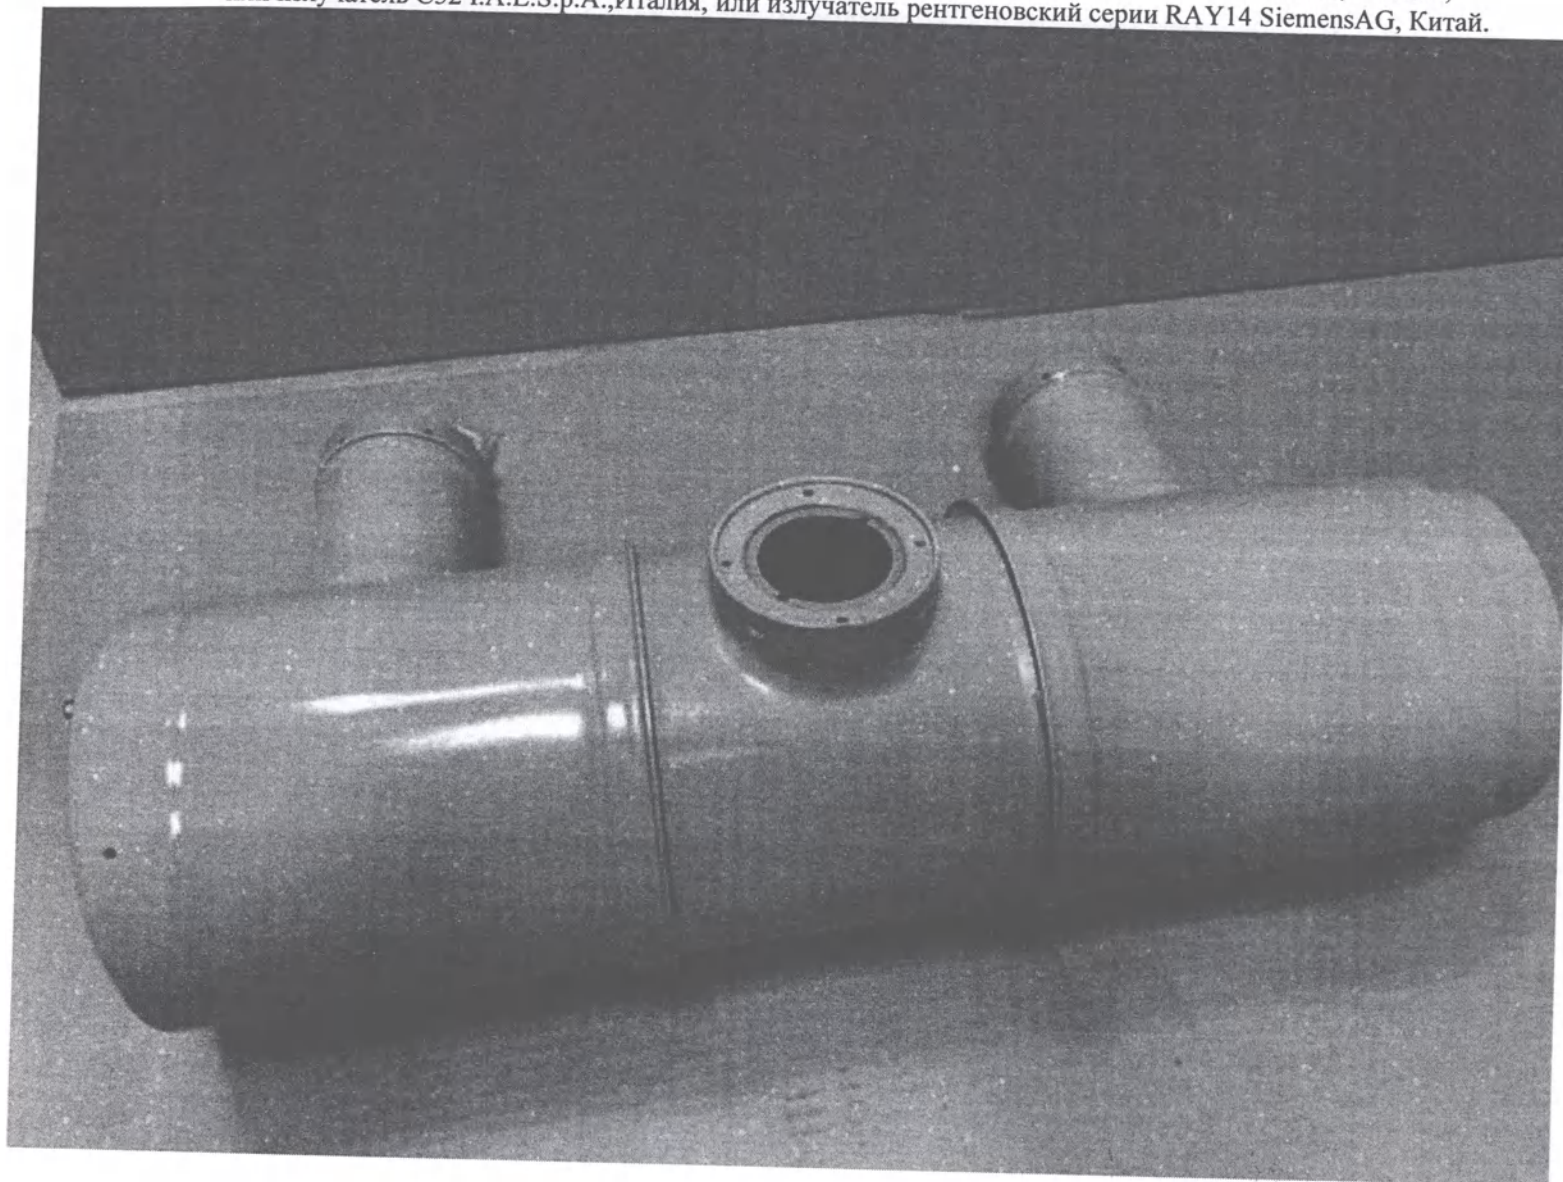


4. Диафрагма ДРФ-1717 ООО НПО «Инвариант» или ООО «Деси», или MC-101, MC-201, MC-202 DOOSUNG DIGITAL, Корея или Cablas S.R.L, Италия, или R302, R225 Ralco S.R.L, Испания.

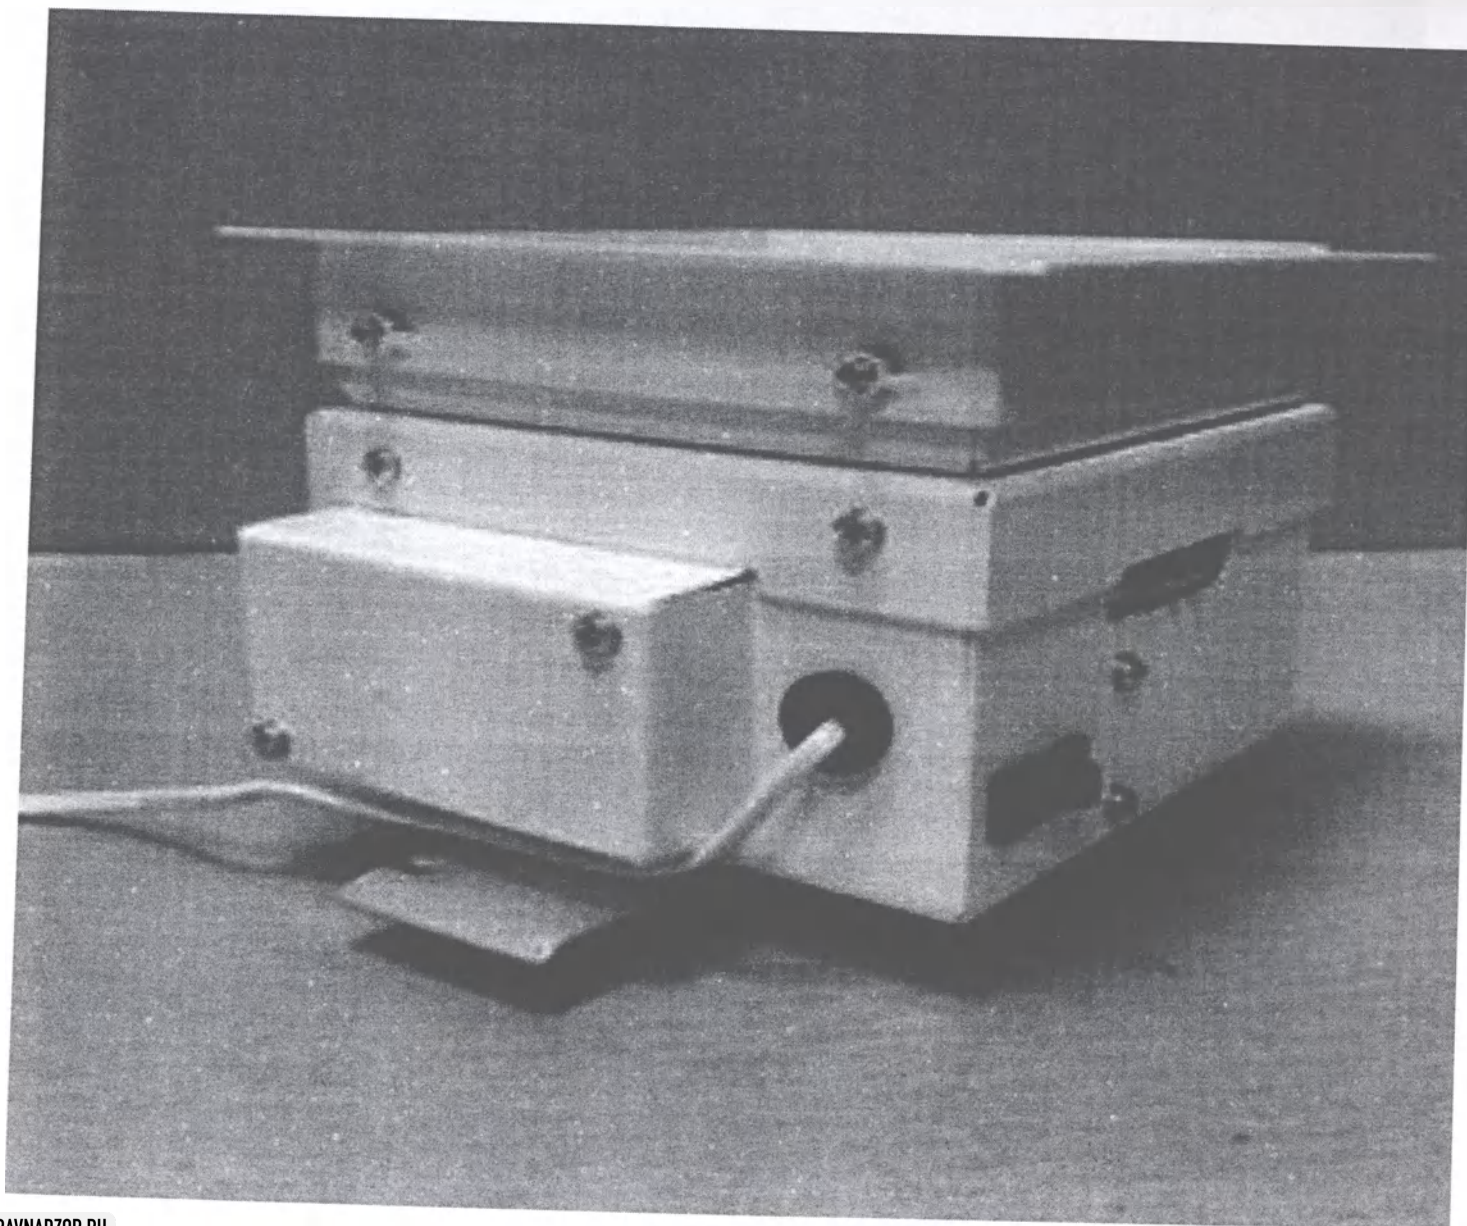


5. Кабели высоковольтные – 2шт., ООО «АктюбРентген» или ООО «ДЕСИ», или 75kV-L3-12-03 Locaflex Cable Assy, Claymount Assemblies B.V., Нидерланды.

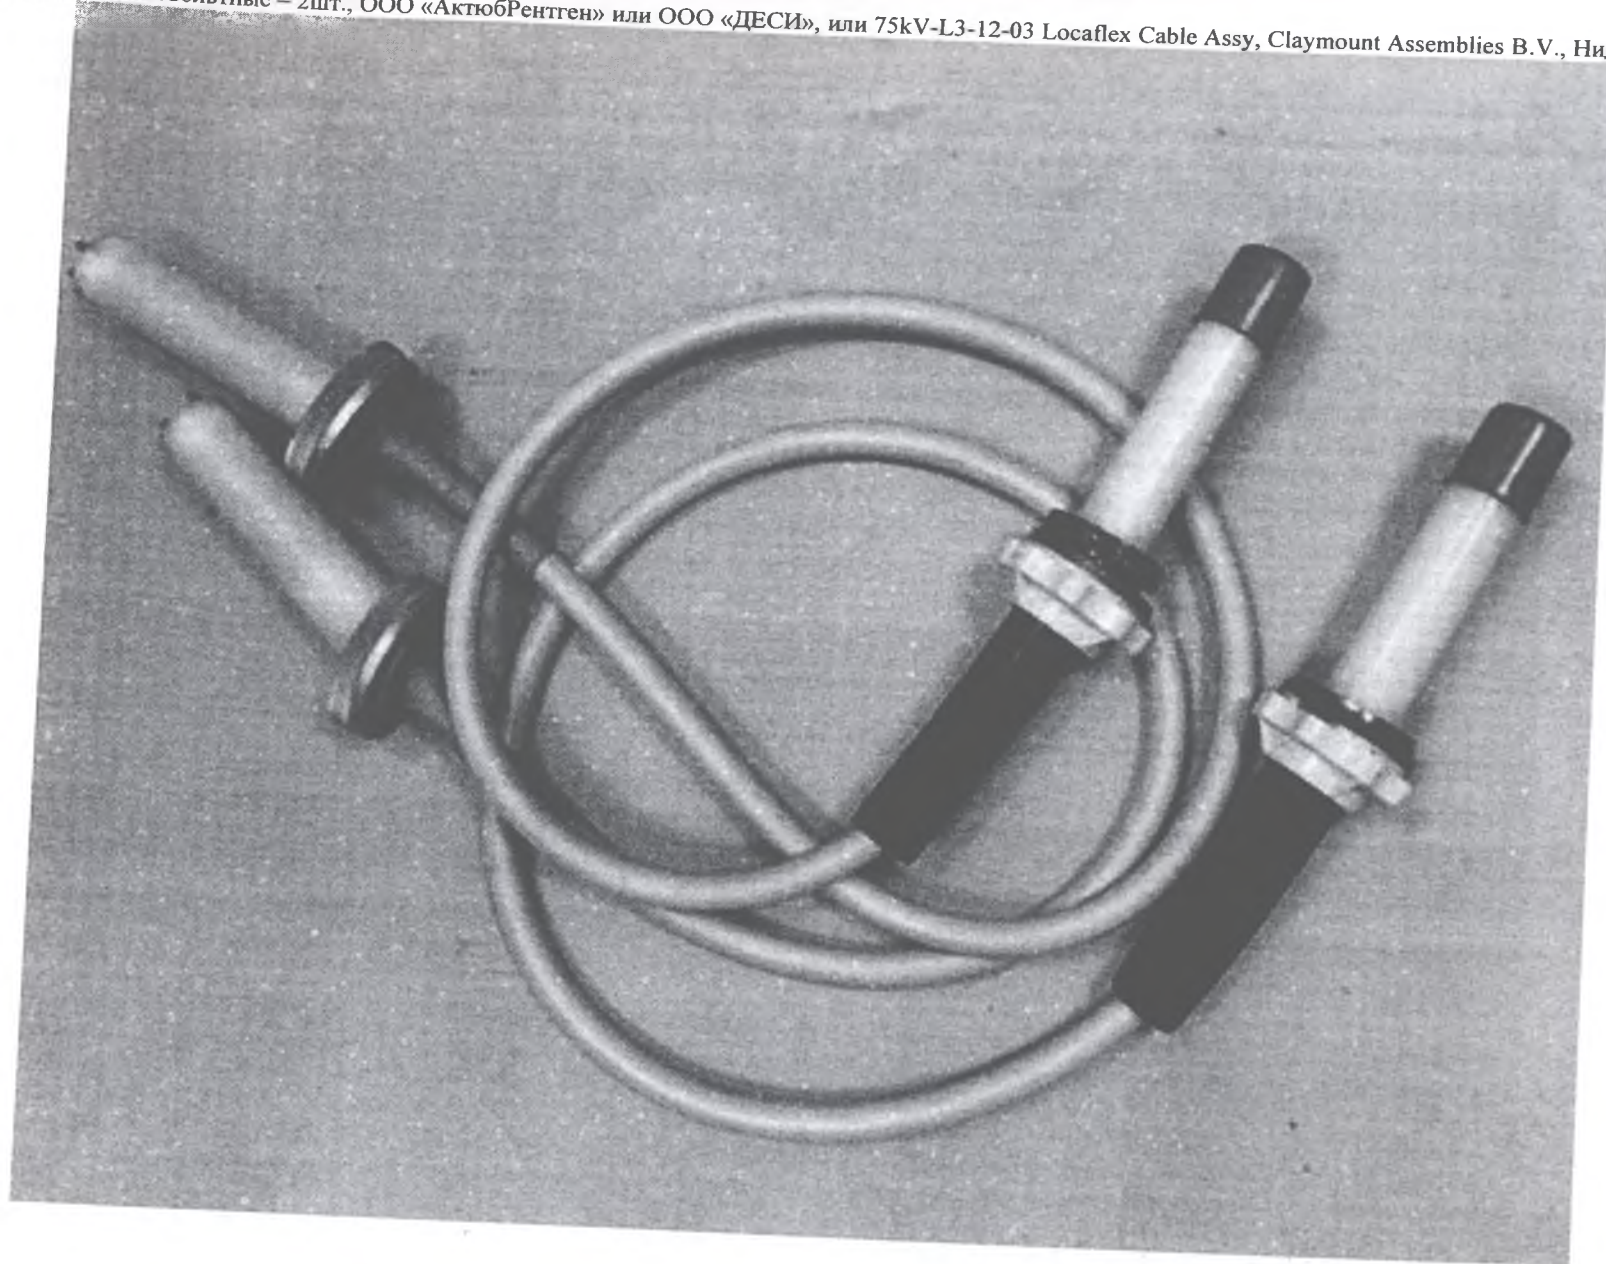


6. Приемник рентгеновского изображения: камера рентгеновская цифровая КРЦ-01 «ПОНИ», ЗАО «ПОНИ», или приемник РЦ-ФП в составе: плоскопанельный цифровой матричный детектор серии FDX4343R, Toshiba Electron Tubes&Devices Co, LTD, Япония или плоскопанельный цифровой матричный детектор модели FPD1M «Venu 1717M», Shanghai iRay Technology LTD, Китай или плоскопанельный цифровой матричный детектор ViVIX-S, моделей FXRD-1717SA, FRDX-1717SB, «ВьюворксКо., Лтд», Корея или плоскопанельный цифровой матричный детектор PixiumRF4343, Thales Electron Devices S.A., Франция или Приемник РЦ, ООО «АктюбРентген».

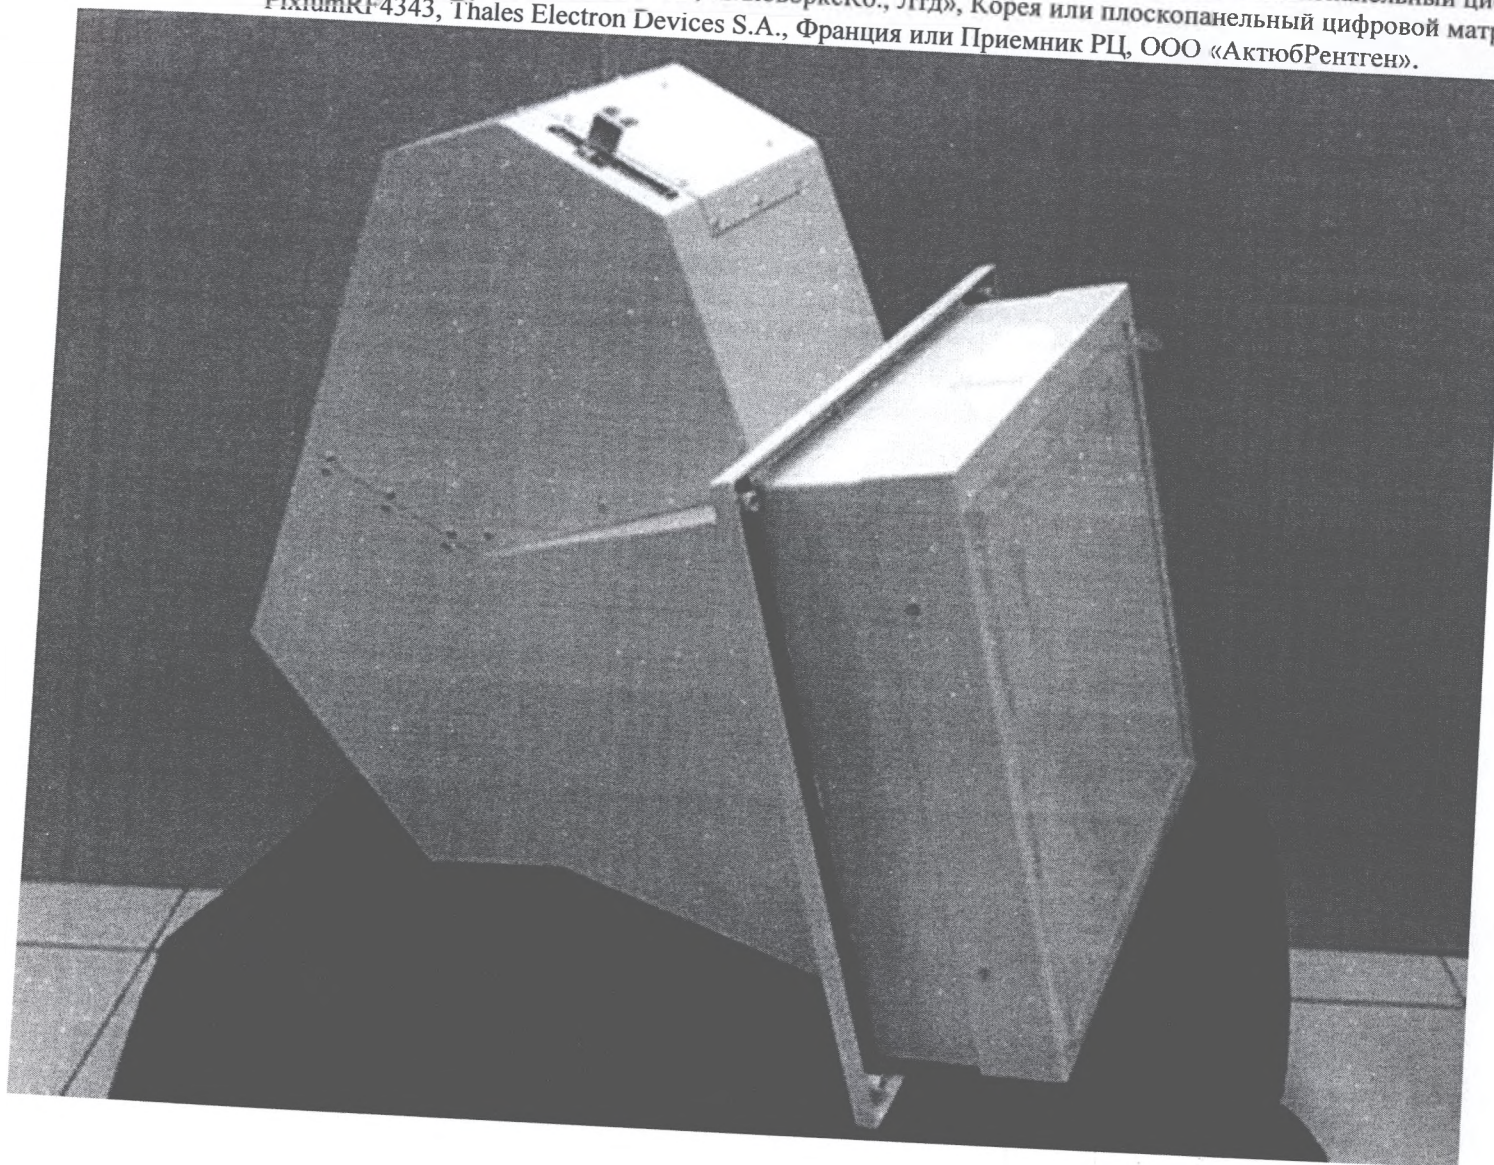


7. АРМ-1 (автоматизированное рабочее место рентген-лаборанта), производства ООО «АктюбРентген» в составе: монитор с диагональю экрана не менее 19 дюймов, системный блок или ноутбук (поставляется при необходимости), источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь, принтер, камера видеонаблюдения (поставляется при необходимости), переговорное устройство, пакет специального программного обеспечения «Альфа» ШУАТ90.000 или «Пони-Флюоро-Альфа» RUS TYKE.0002-01 ЗАО «ПОНИ», или НАПЕ 941215.ПО «РЕНАР» ООО «АктюбРентген».

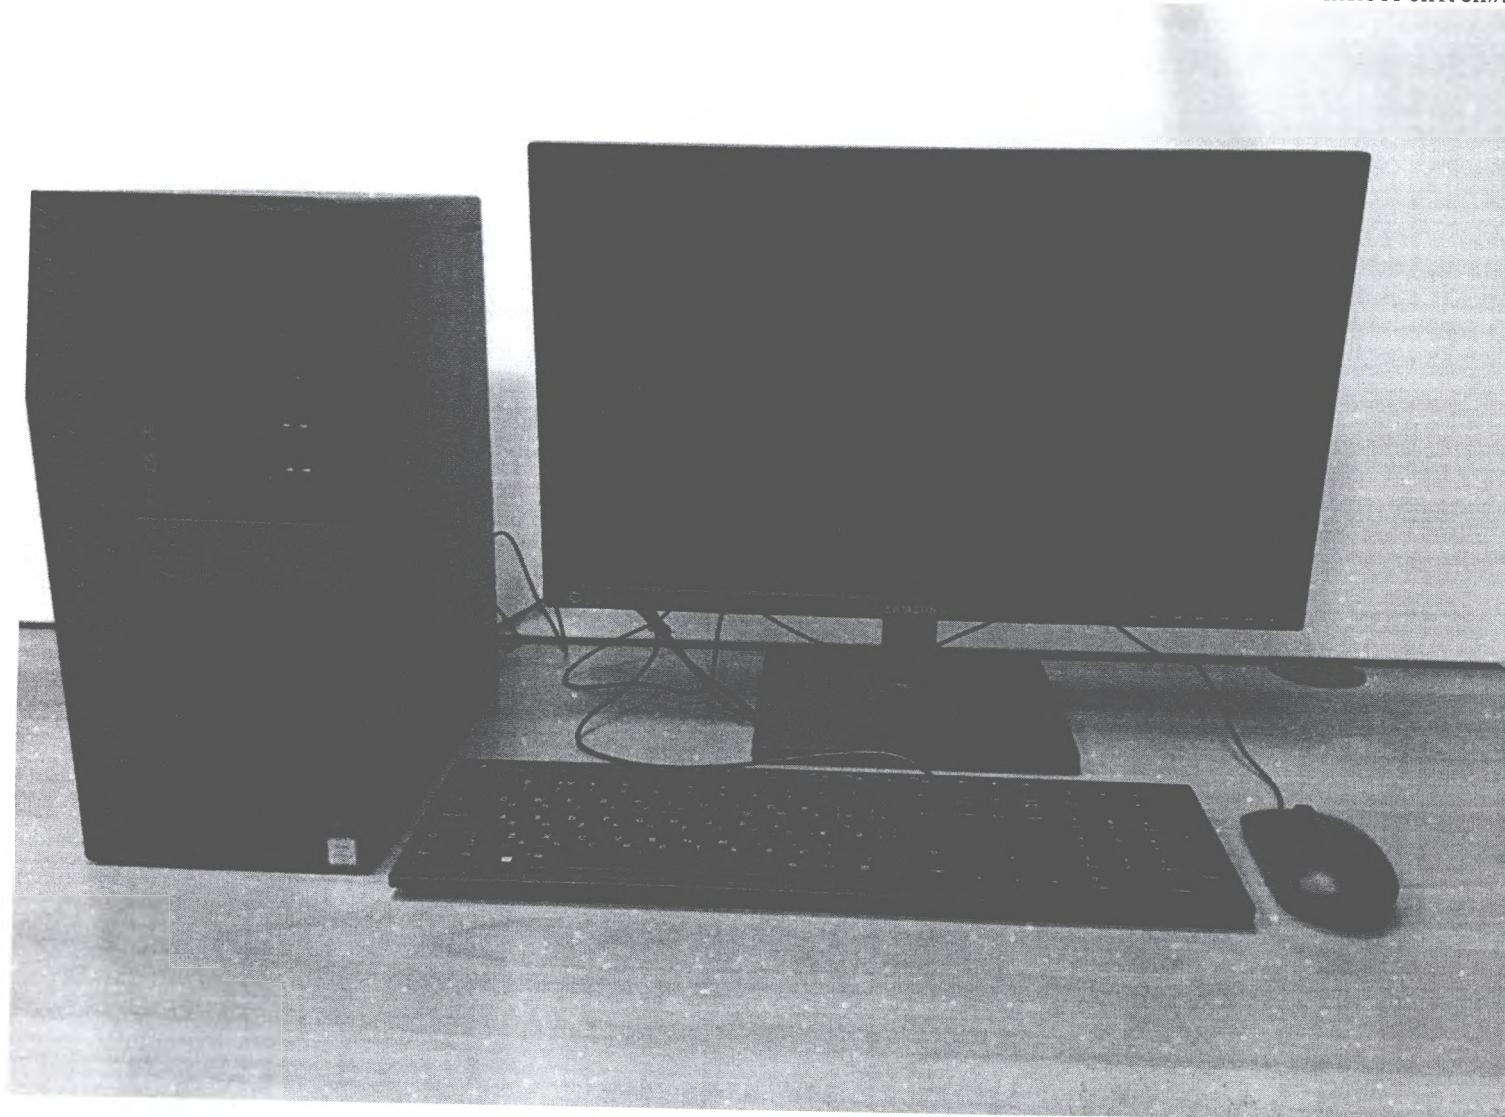


8. АРМ-2 (автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога), производства ООО «АктюбРентген» в составе: монитор с диагональю экрана не менее 19 дюймов, системный блок, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь, принтер, термопринтер (поставляется при необходимости), монохромный монитор (поставляется при необходимости), внешнее сетевое хранилище (поставляется при необходимости), пакет специального программного обеспечения «Альфа» ШУАТ90.000 или «Пони-Флюоро-Альфа» RUS TYKE.0002-01 ЗАО «ПОНИ», или НАПЕ 941215.ПО «РЕНАР» ООО «АктюбРентген».

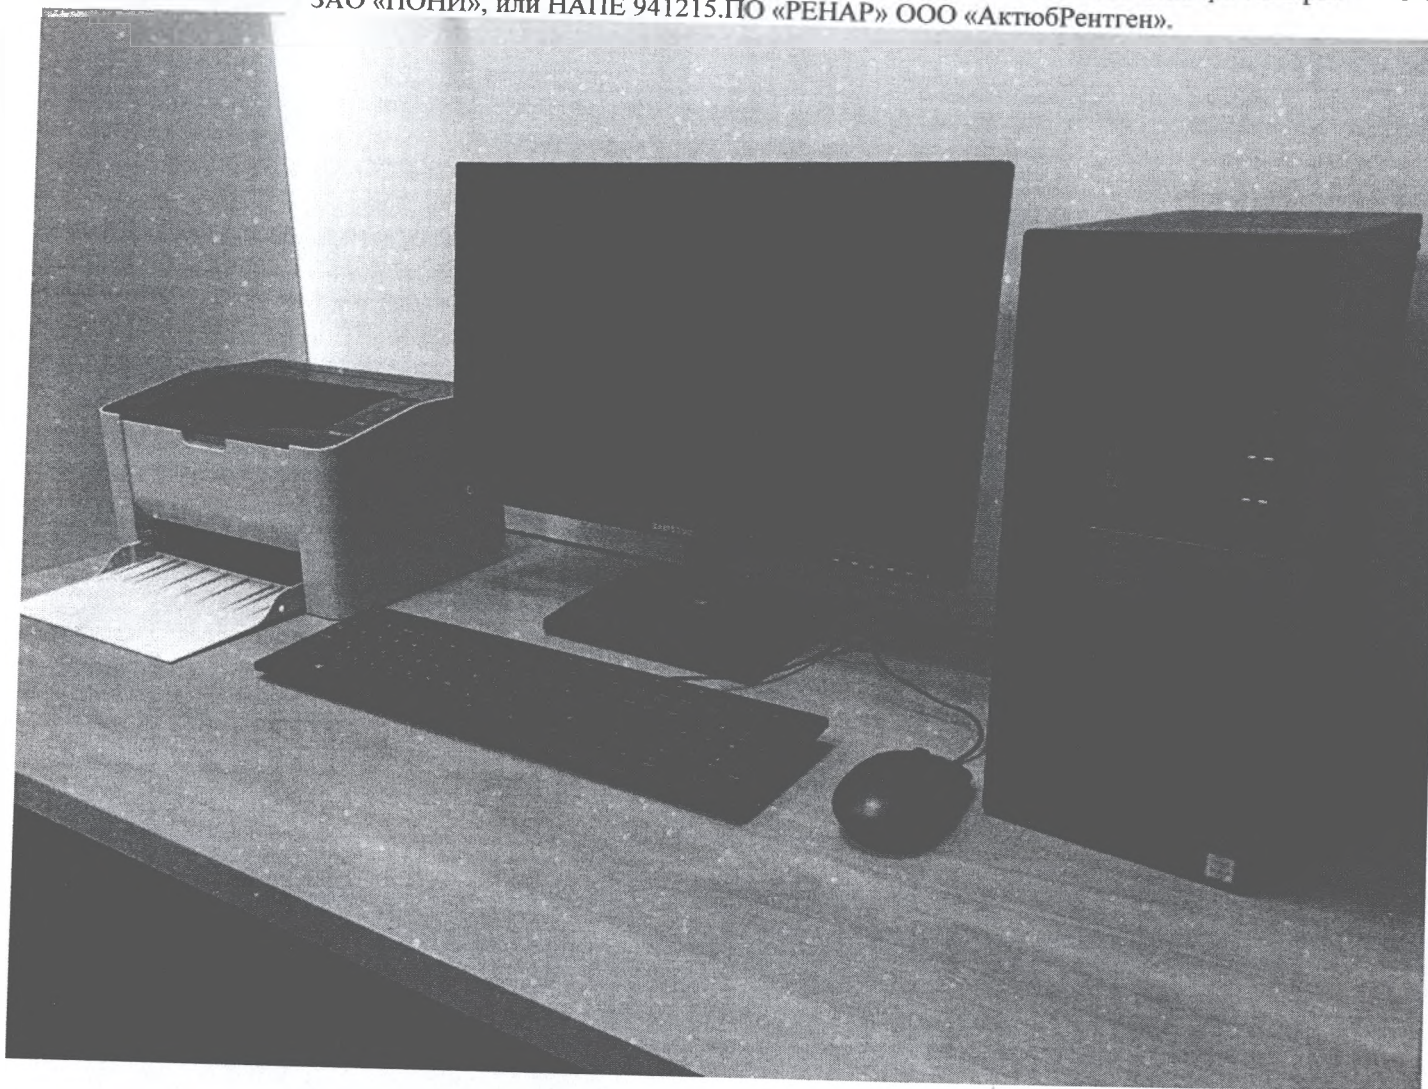

9. Рентгенозащитные фартуки, большой, малый (комплект), ЗАО «ПОНИ» или ООО «АктюбРентген»

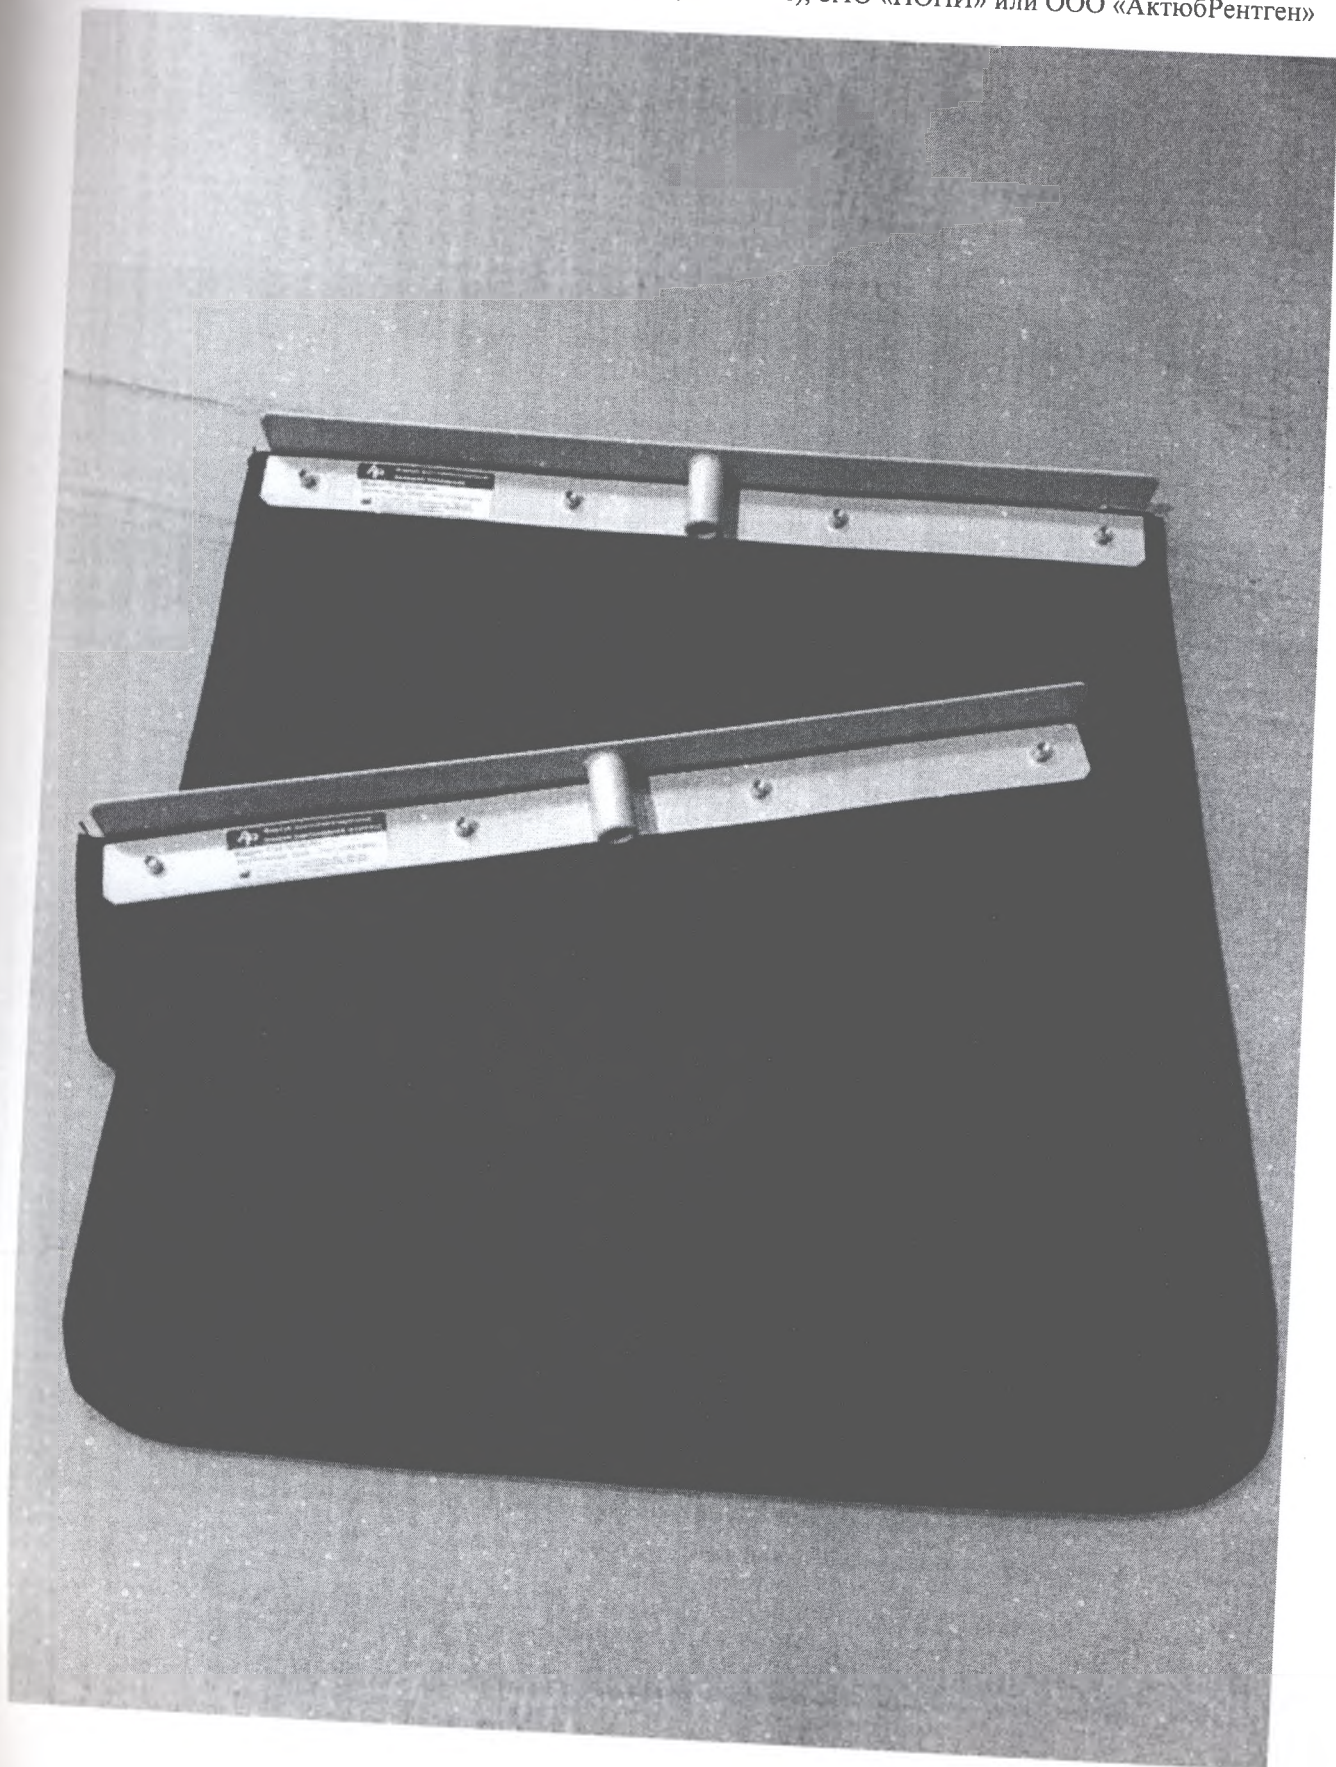

10. Растр рентгеновский (поставляется при необходимости) JPI или SOYEE, Корея.

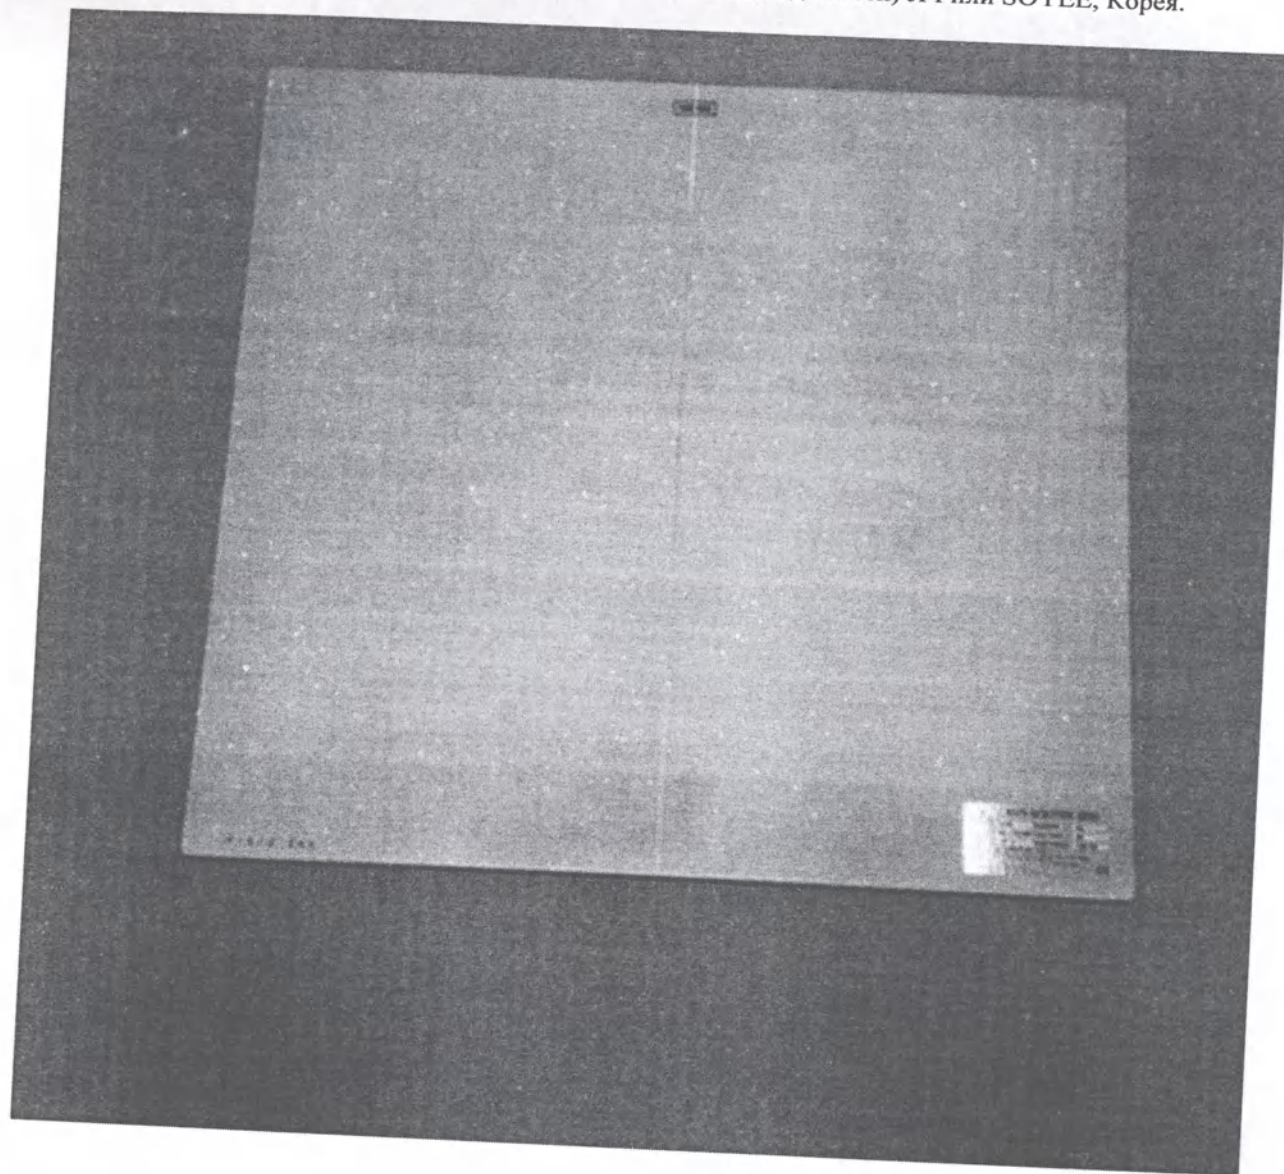


11 Комплект эксплуатационных документов

ОКЗ 194 4220
ОКЗ 202 26.09.11.111


Аппарат рентгеноаппаратический цифровой
малодозовый "РЕНАР-К"

ФОРМУЛЯР
НАПЕ 941215.001 ФО


12. Принадлежности
Рентгенэкспонетр (поставляется при необходимости) ООО «АктюбРентген»

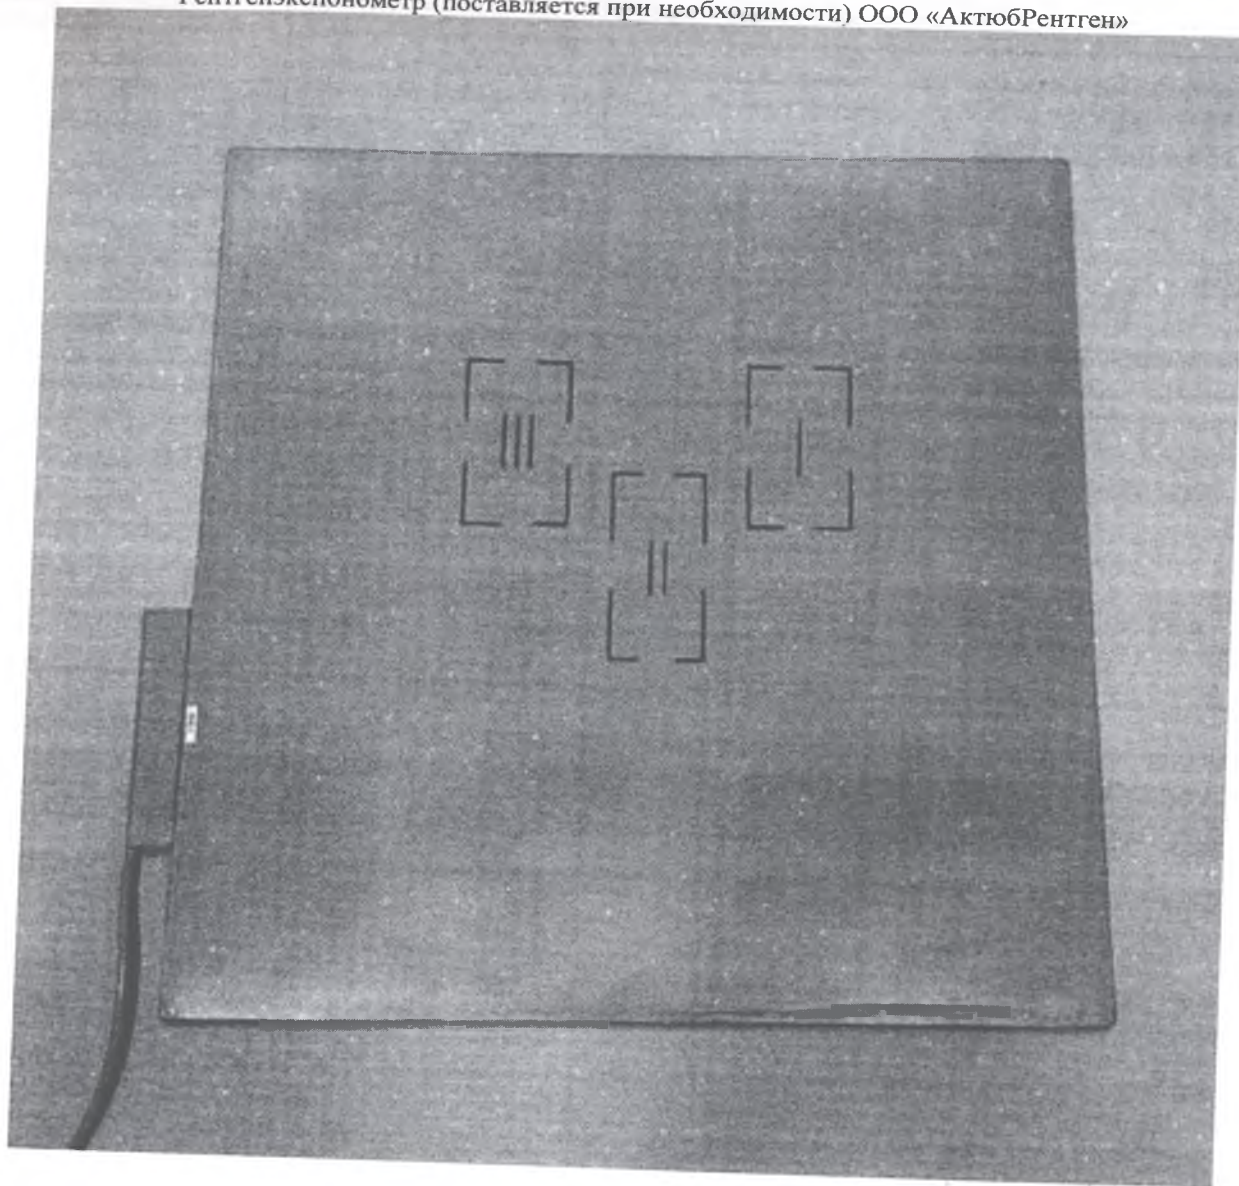


Аппарат рентгенографический цифровой малодозовый «РЕНАР-Ш» по ТУ 9442-002-14580254-2016 в составе:
1. Штатив-стойка с горизонтальной траверсой НАПЕ 305127.002 ООО «АктюбРентген», или ТУКЕ 305127.002 ЗАО «ПОНИ», или АРЦУ 410.001 ООО НПО «Инвариант».

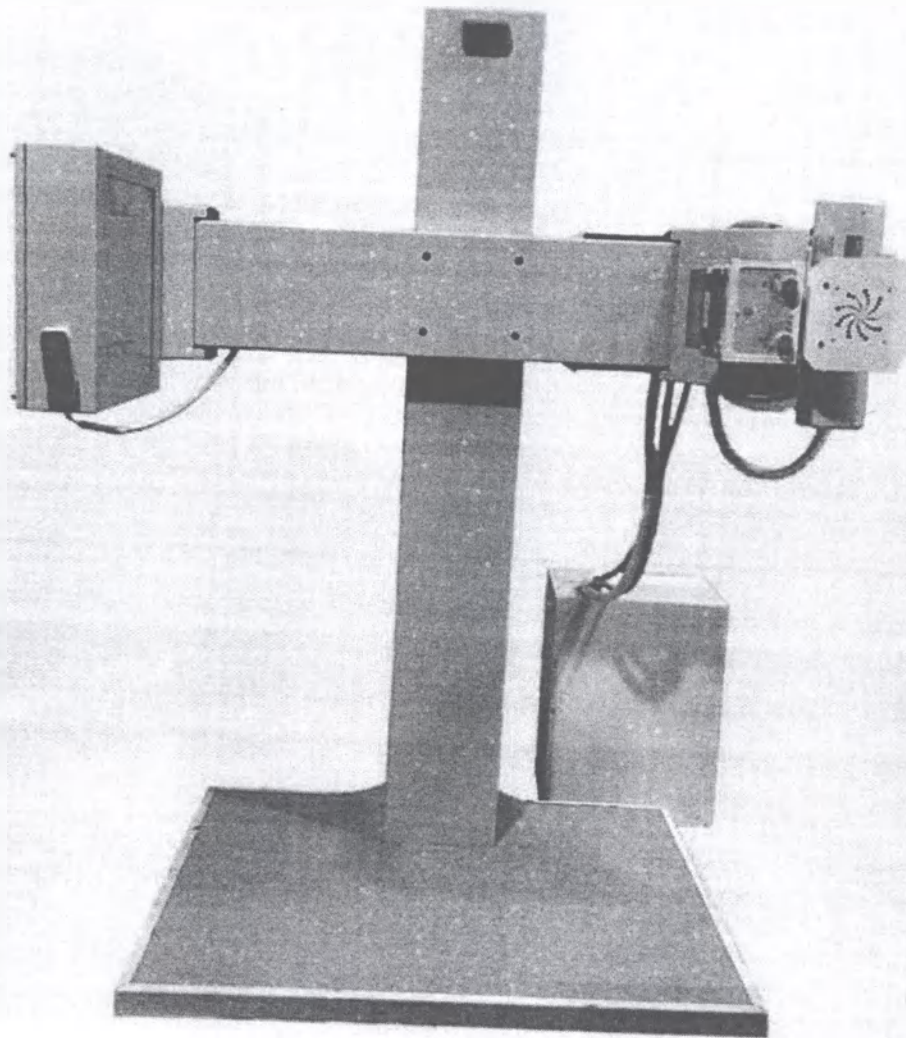


2. Рентгеновское питающее устройство по ТУ9442-002-75249059-2007 в исполнениях - РПУ ВЧ/1, РПУ ВЧ/2, РПУ ВЧ/3 ООО «НПП «ВЭЛИТ» или РПУ «Sedecal» Модель SHF Sedecal S.R.L.

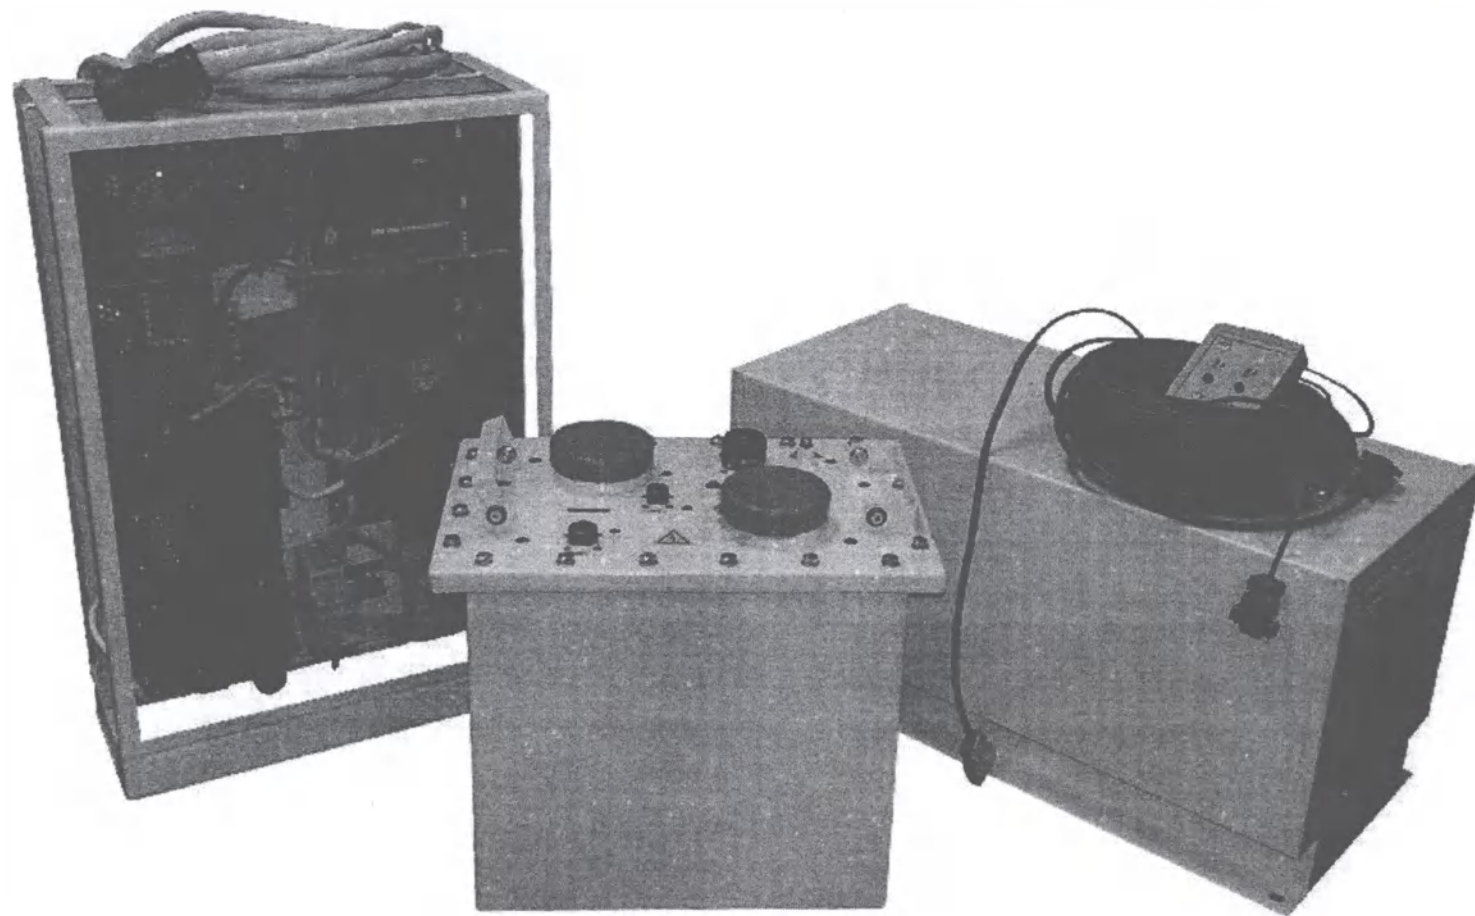


3. Излучатель рентгеновский РИД-1 ООО «АктюбРентген» или РИД-2 ЗАО «АМИКО», или излучатель рентгеновский, серии E72XX Toshiba, Electron TUBES & DEVICE Co., Ltd, Япония, или излучатель C52 I.A.E.S.p.A., Италия, или излучатель рентгеновский серии RAY14 Siemens AG, Китай.

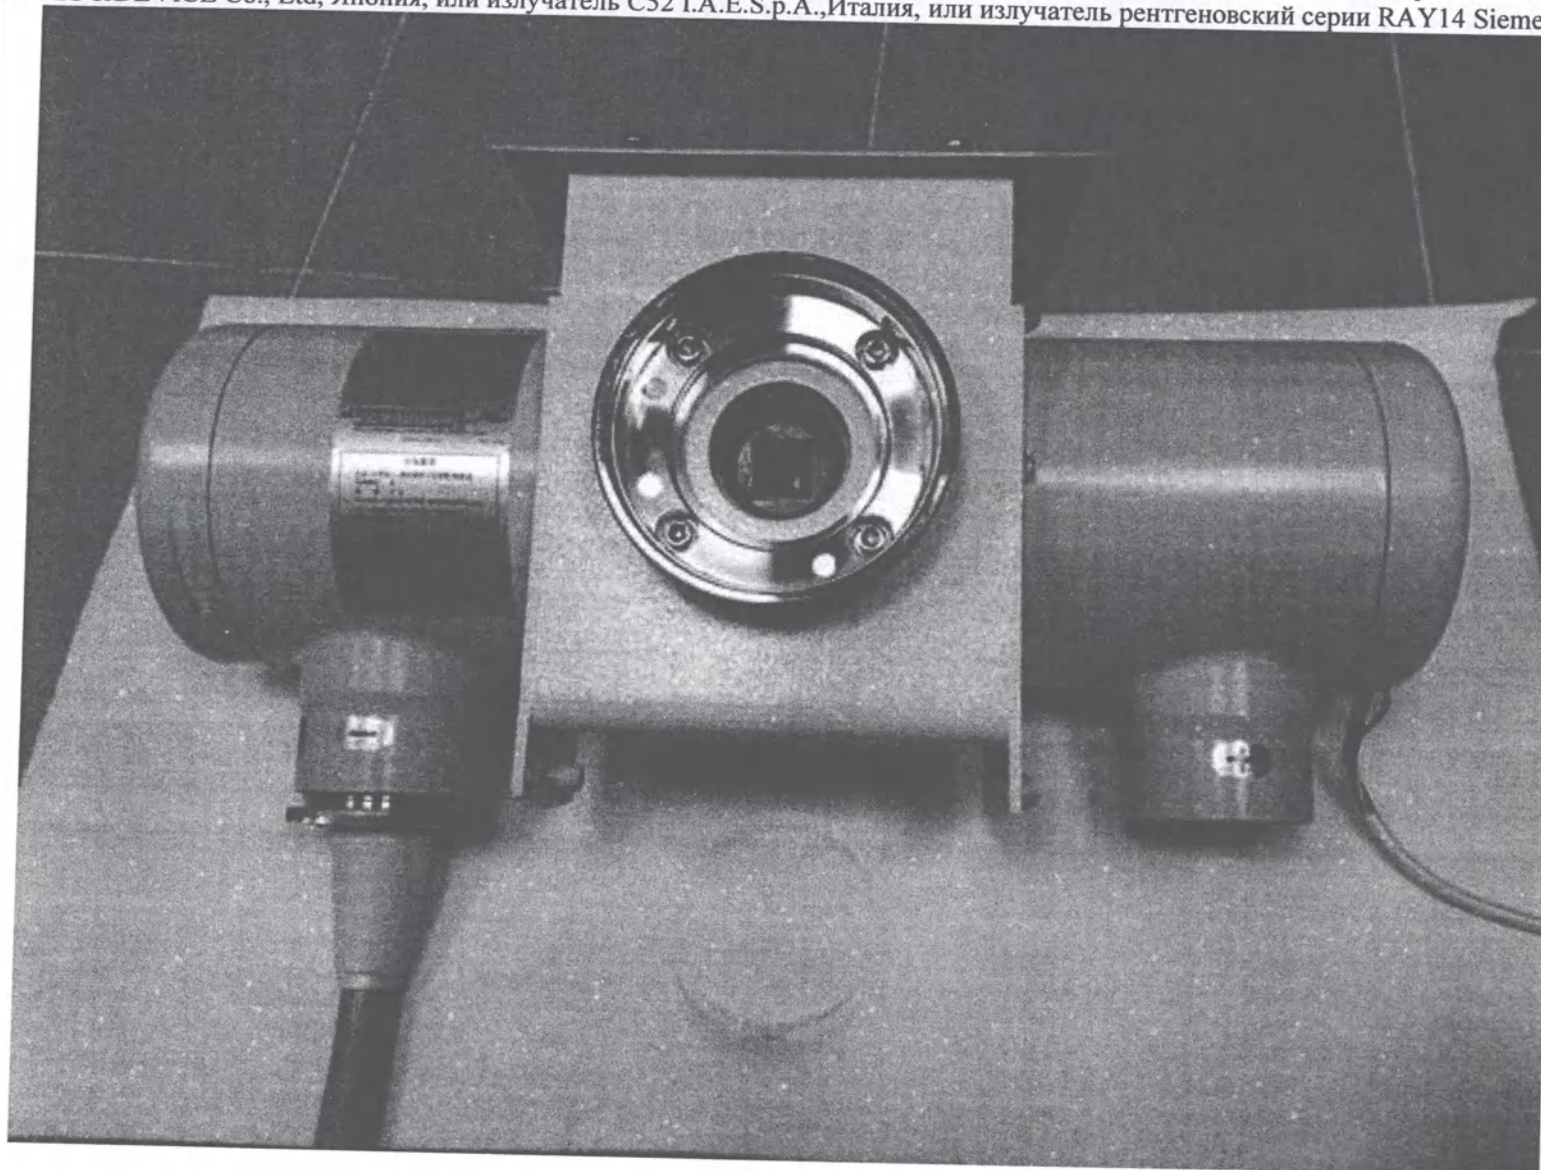


4. Диафрагма MC-101, MC-201, MC-202 DOOSUNG DIGITAL, Корея или Cablas S.R.L, Италия, или R302, R225 Ralco S.R.L, Испания.

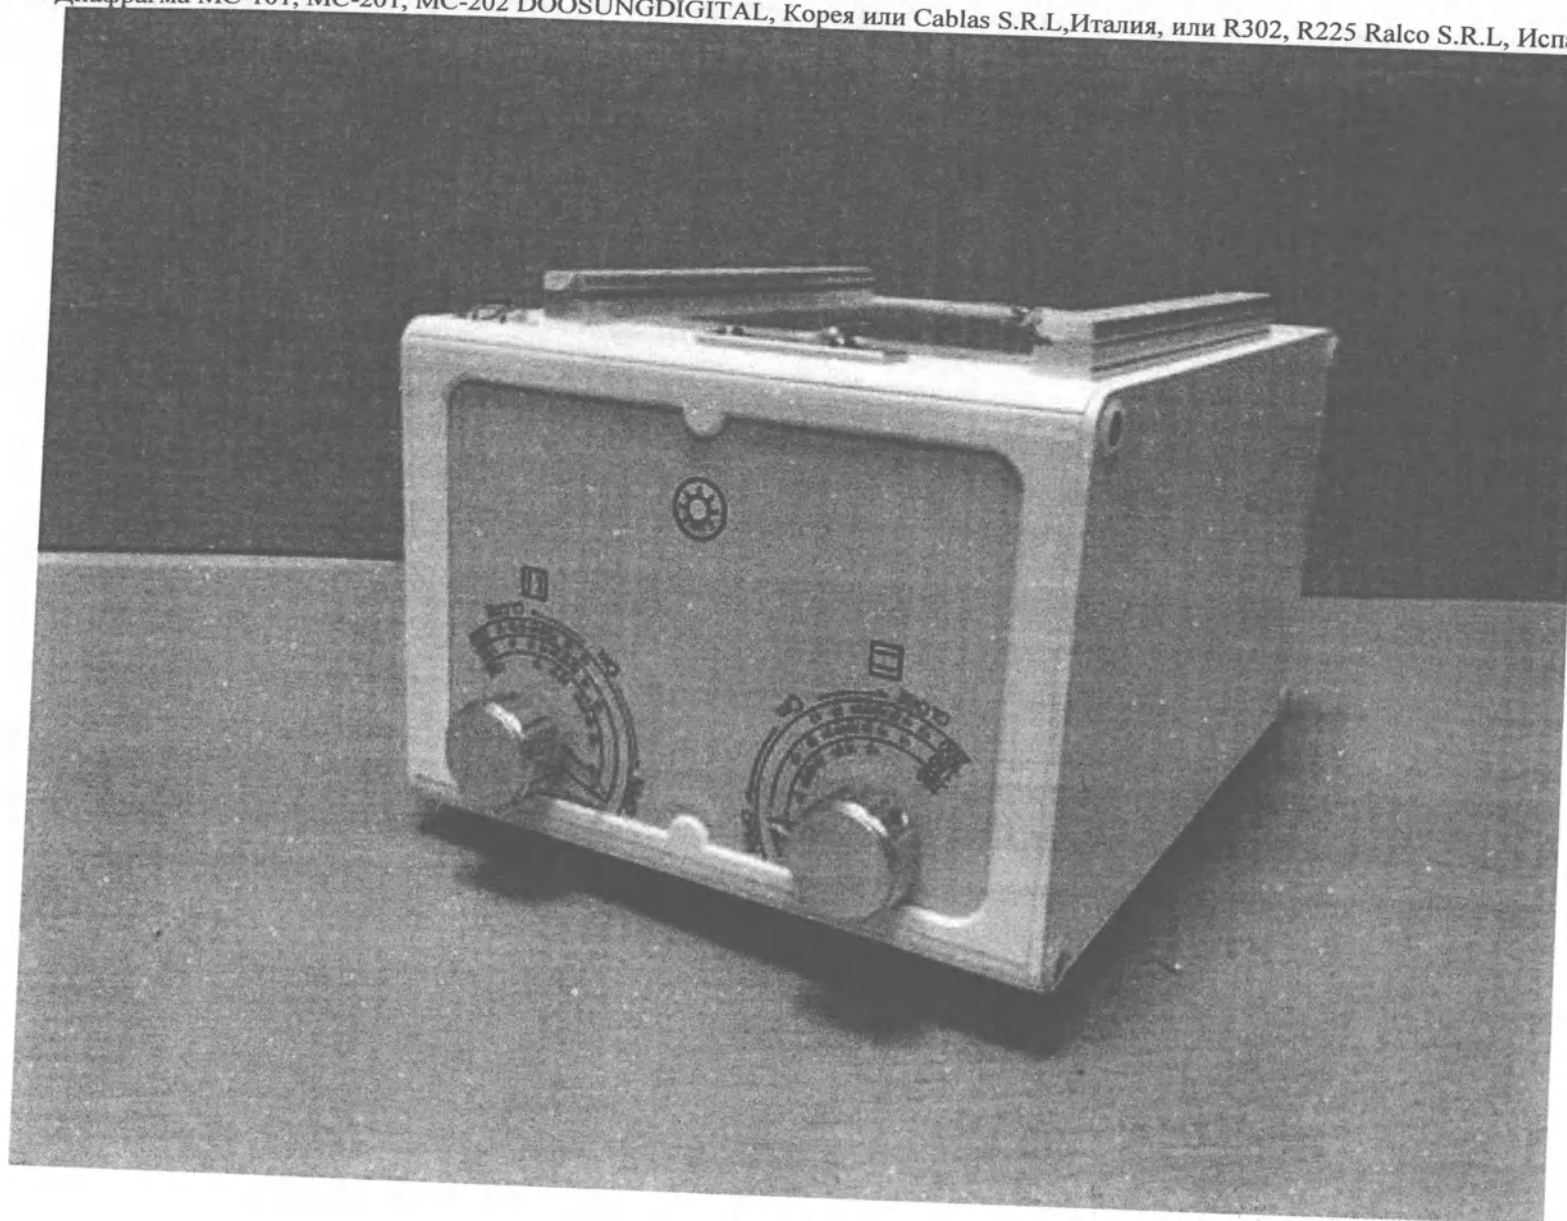


5. Кабели высоковольтные – 2 шт., ООО «АктюбРентген» или ООО «ДЕСИ», или 75kV-L3-12-03 Locaflex Cable Assy, Claymount Assemblies B.V., Нидерланды.

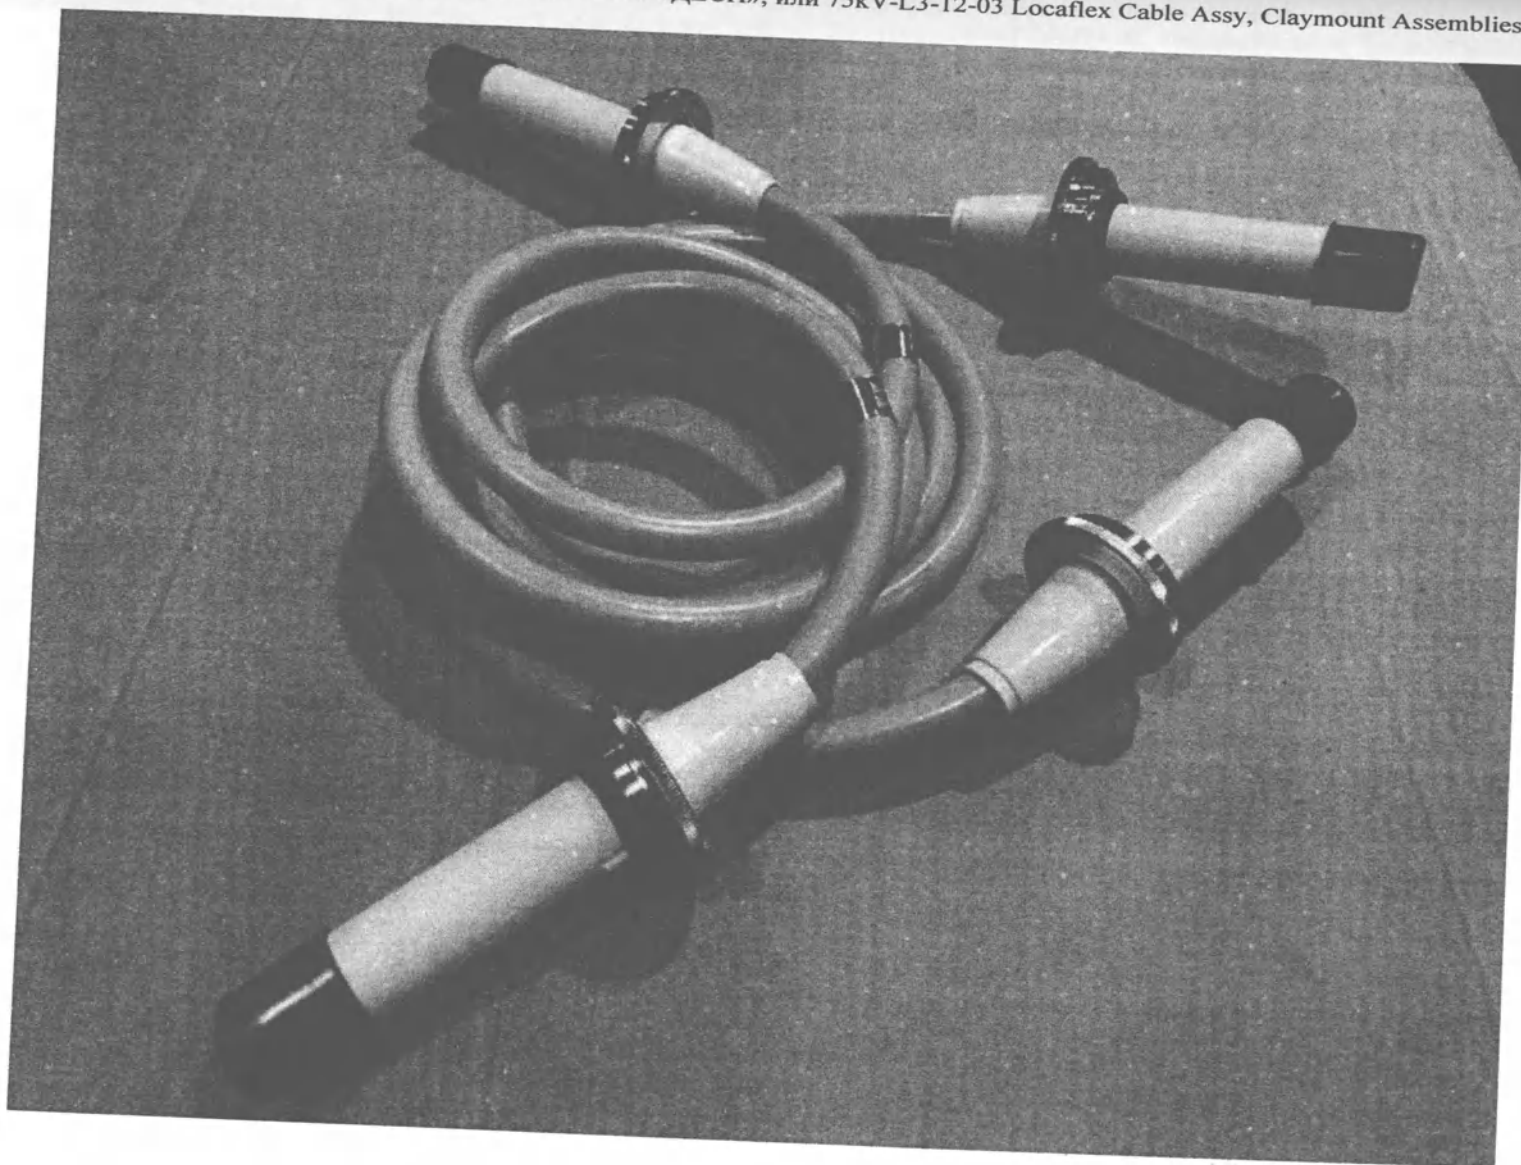

6. Приемник рентгеновского изображения: камера рентгеновская цифровая КРЦ-01 «ПОНИ», ЗАО «ПОНИ», или приемник РЦ-ФП в составе: плоскостанельный цифровой матричный детектор серии FDX4343R, Toshiba Electron Tubes&Devices Co, LTD, Япония или плоскостанельный цифровой матричный детектор модели FPD1M «Venu 1717M», Shanghai iRay Technology LTD, Китай или плоскостанельный цифровой матричный детектор ViVIX-S, моделей FXRD-1717SA, FRDX-1717SB, «ВьюворксКо., Лтд», Корея или плоскостанельный цифровой матричный детектор PixiumRF4343, Thales Electron Devices S.A., Франция или Приемник РЦ, ООО «АктюбРентген».

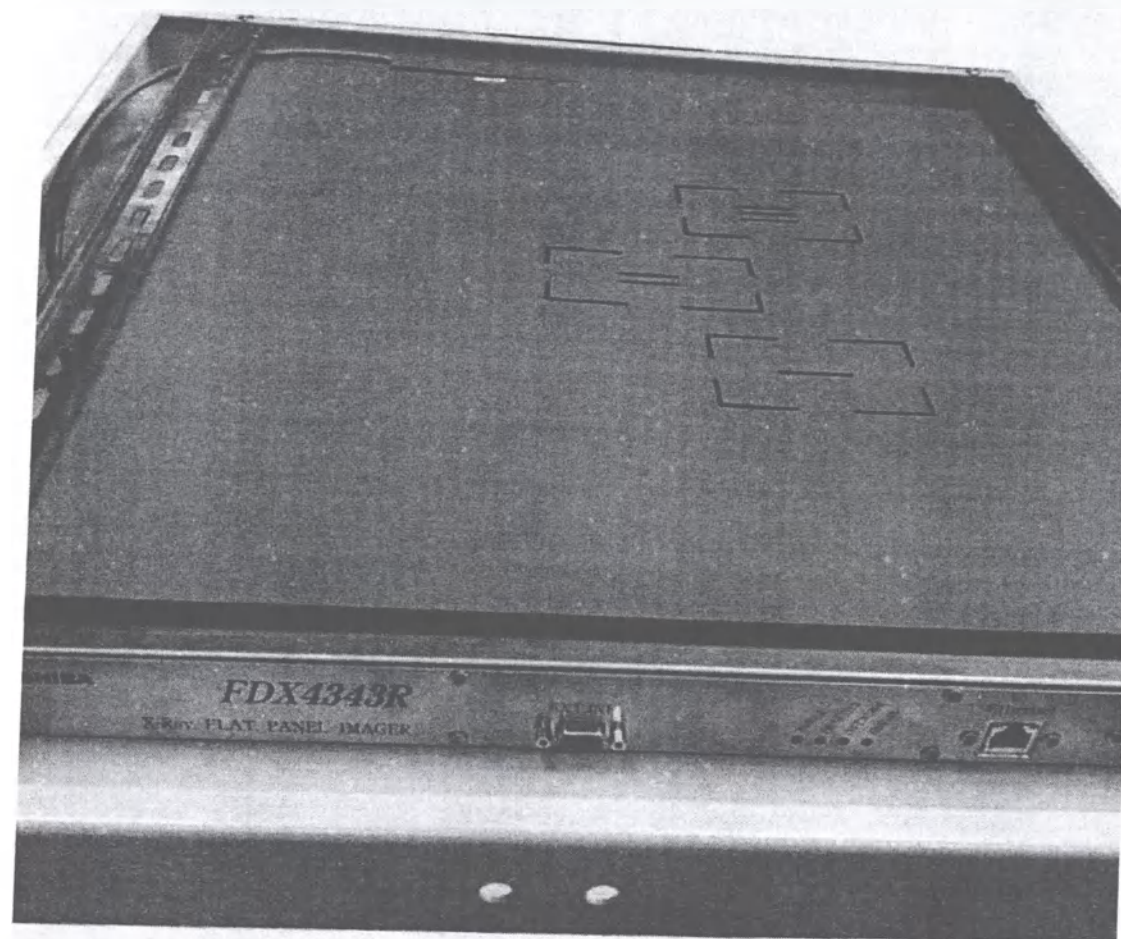


7. Дозиметр ДРК-1М ООО НПП «ДОЗА»,или DIAMENTORM4 Physikalische-TechnischeWerkstättenDr. RychlauGmB.H. Германия или Vacu DAP 2004 OEM VacuTecMeBtechnikGmB.H Германия

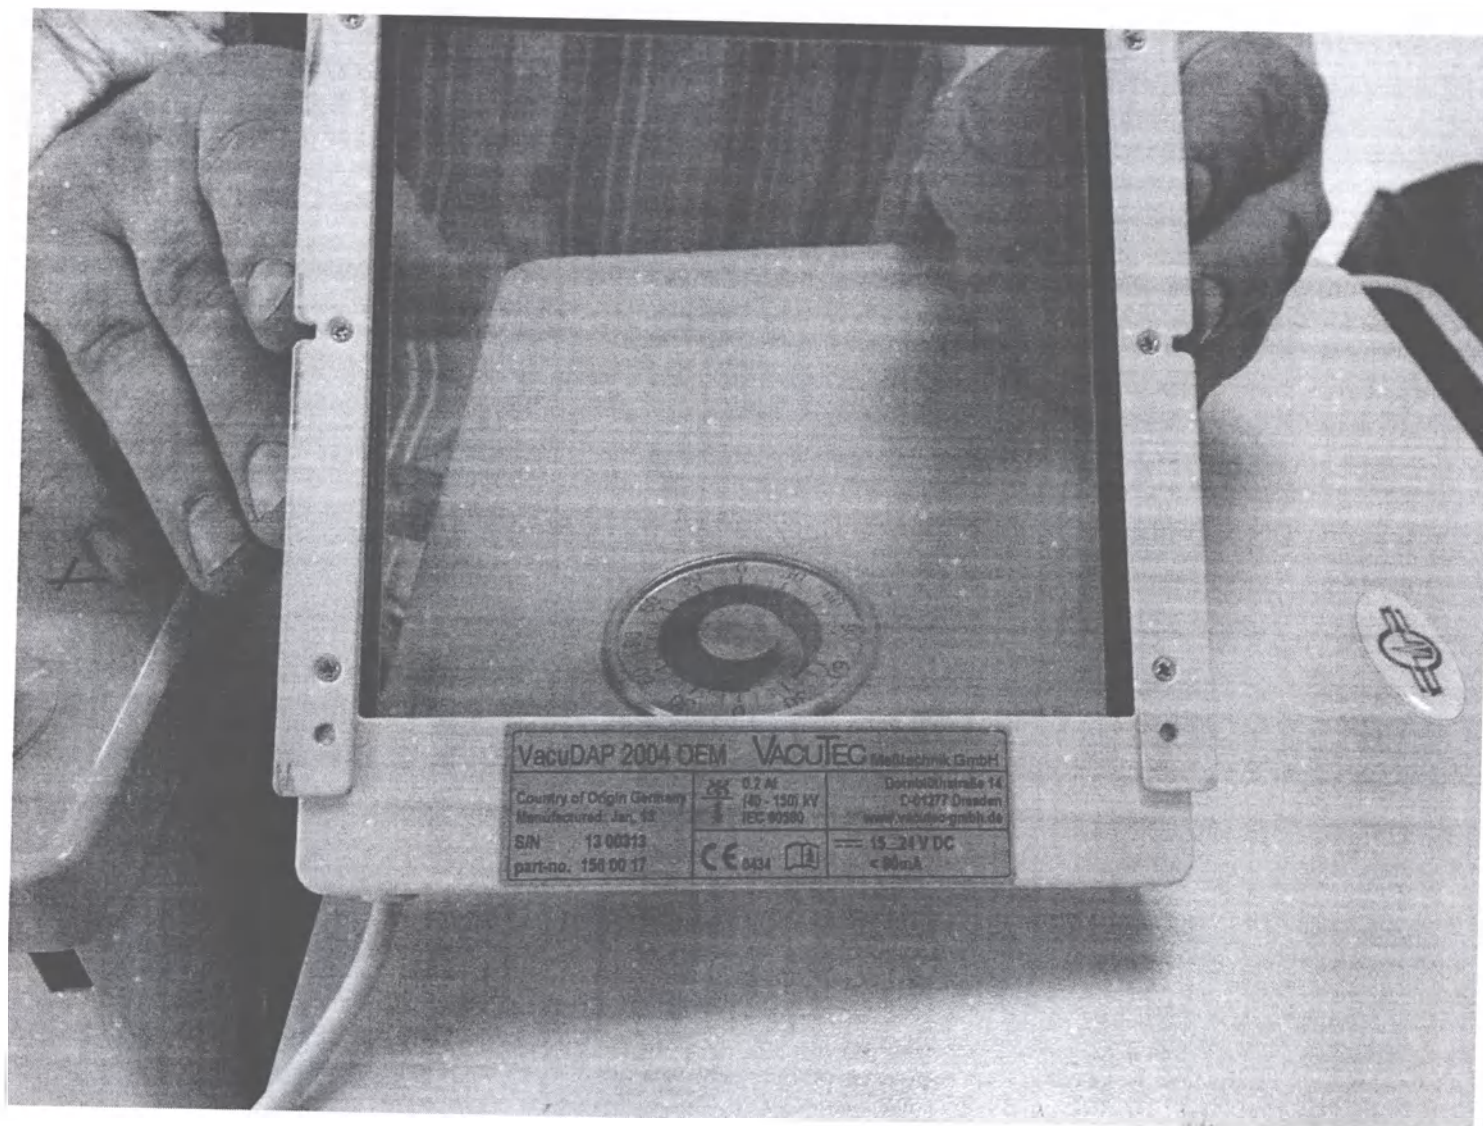

8. АРМ-1 (автоматизированное рабочее место рентген-лаборанта), производства ООО «АктюбРентген» в составе: монитор с диагональю экрана не менее 19 дюймов, источник бесперебойного питания, системный блок, клавиатура, мышь, принтер, камера видеонаблюдения (поставляется при необходимости), переговорное устройство, пакет специального программного обеспечения «Альфа» ШУАТ90.000 или «Пони-Флюоро-Альфа» RUS TYKE.0002-01 ЗАО «ПОНИ», или НАПЕ 941215.ПО «РЕНАР» ООО «АктюбРентген».




9. АРМ-2 (автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога), производства ООО «АктюбРентген» в составе: монитор с диагональю экрана не менее 19 дюймов, источник бесперебойного питания, системный блок, клавиатура, мышь, принтер, термопринтер (поставляется при необходимости), монохромный монитор (поставляется при необходимости), внешнее сетевое хранилище (поставляется при необходимости), пакет специального программного обеспечения «Альфа» ШУАТ90.000 или «Пони-Флюоро-Альфа» RUS TYKE.0002-01 ЗАО «ПОНИ» или НАПЕ 941215.ПО «РЕНАР» ООО «АктюбРентген».

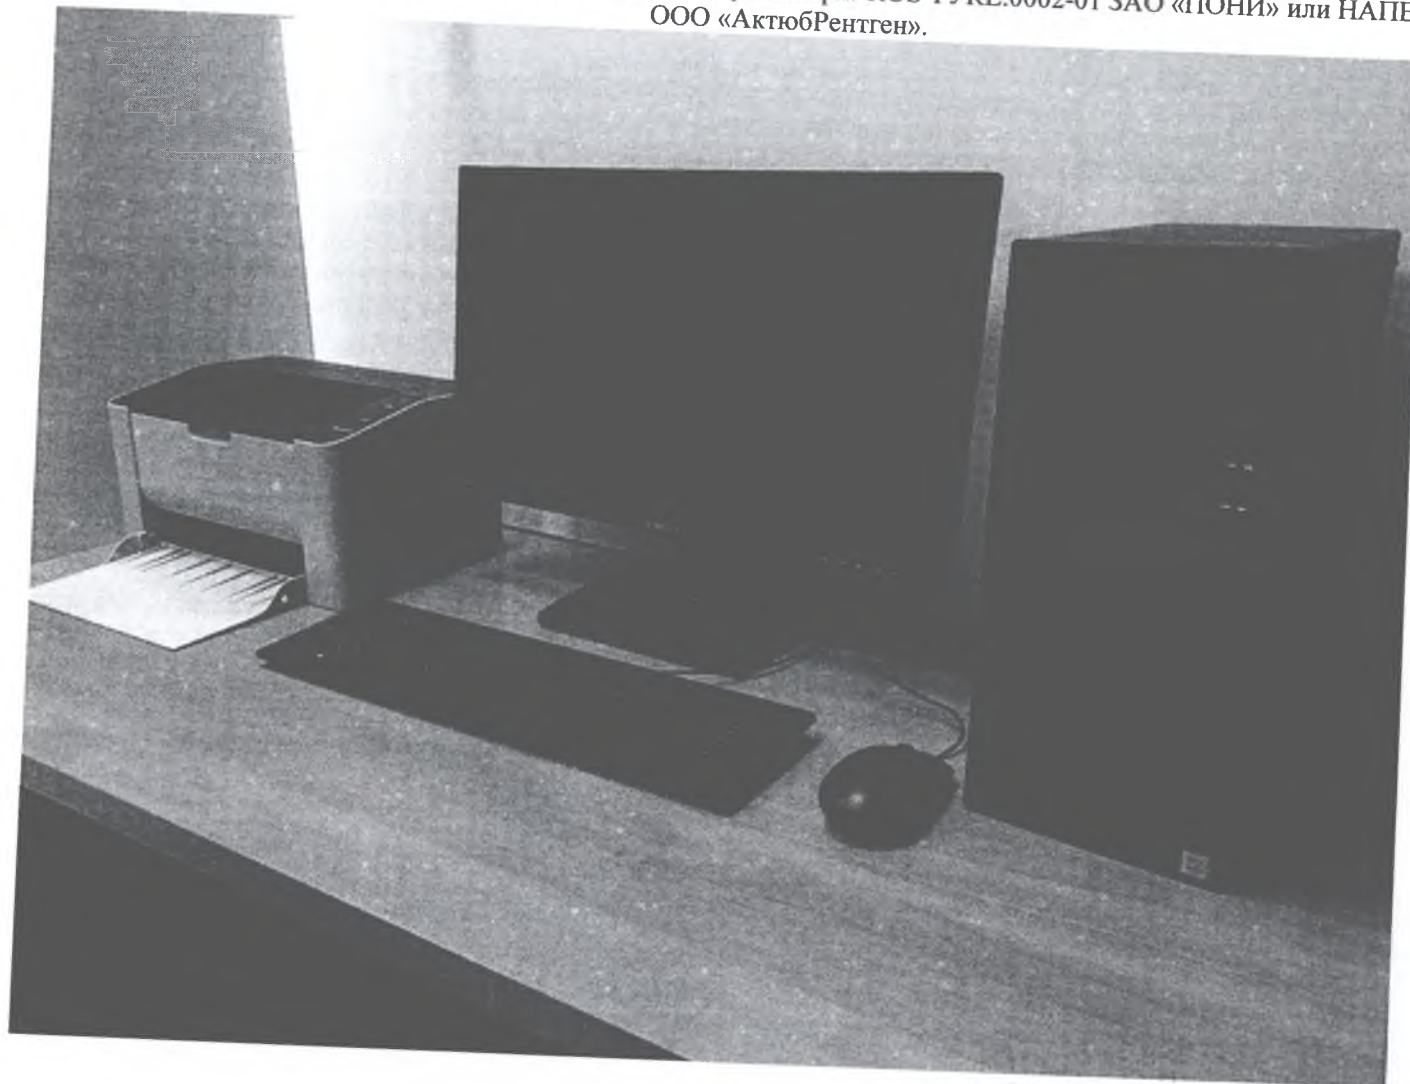


10. Комплект индивидуальных средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения (поставляется при необходимости): комплект изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» ООО «Рентгенкомплект», или комплект средств индивидуальной радиационной защиты - воротник защитный (0,5Pb), шапочка защитная (0,35Pb), очки защитные (0,15Pb), перчатки защитные ЗАО «РЕНЕКС».




11. Рентгенозащитные фартуки, большой, малый (комплект), ООО «МП НПФ «Гаммамед-П».Рентгеновские фартуки (комплект)

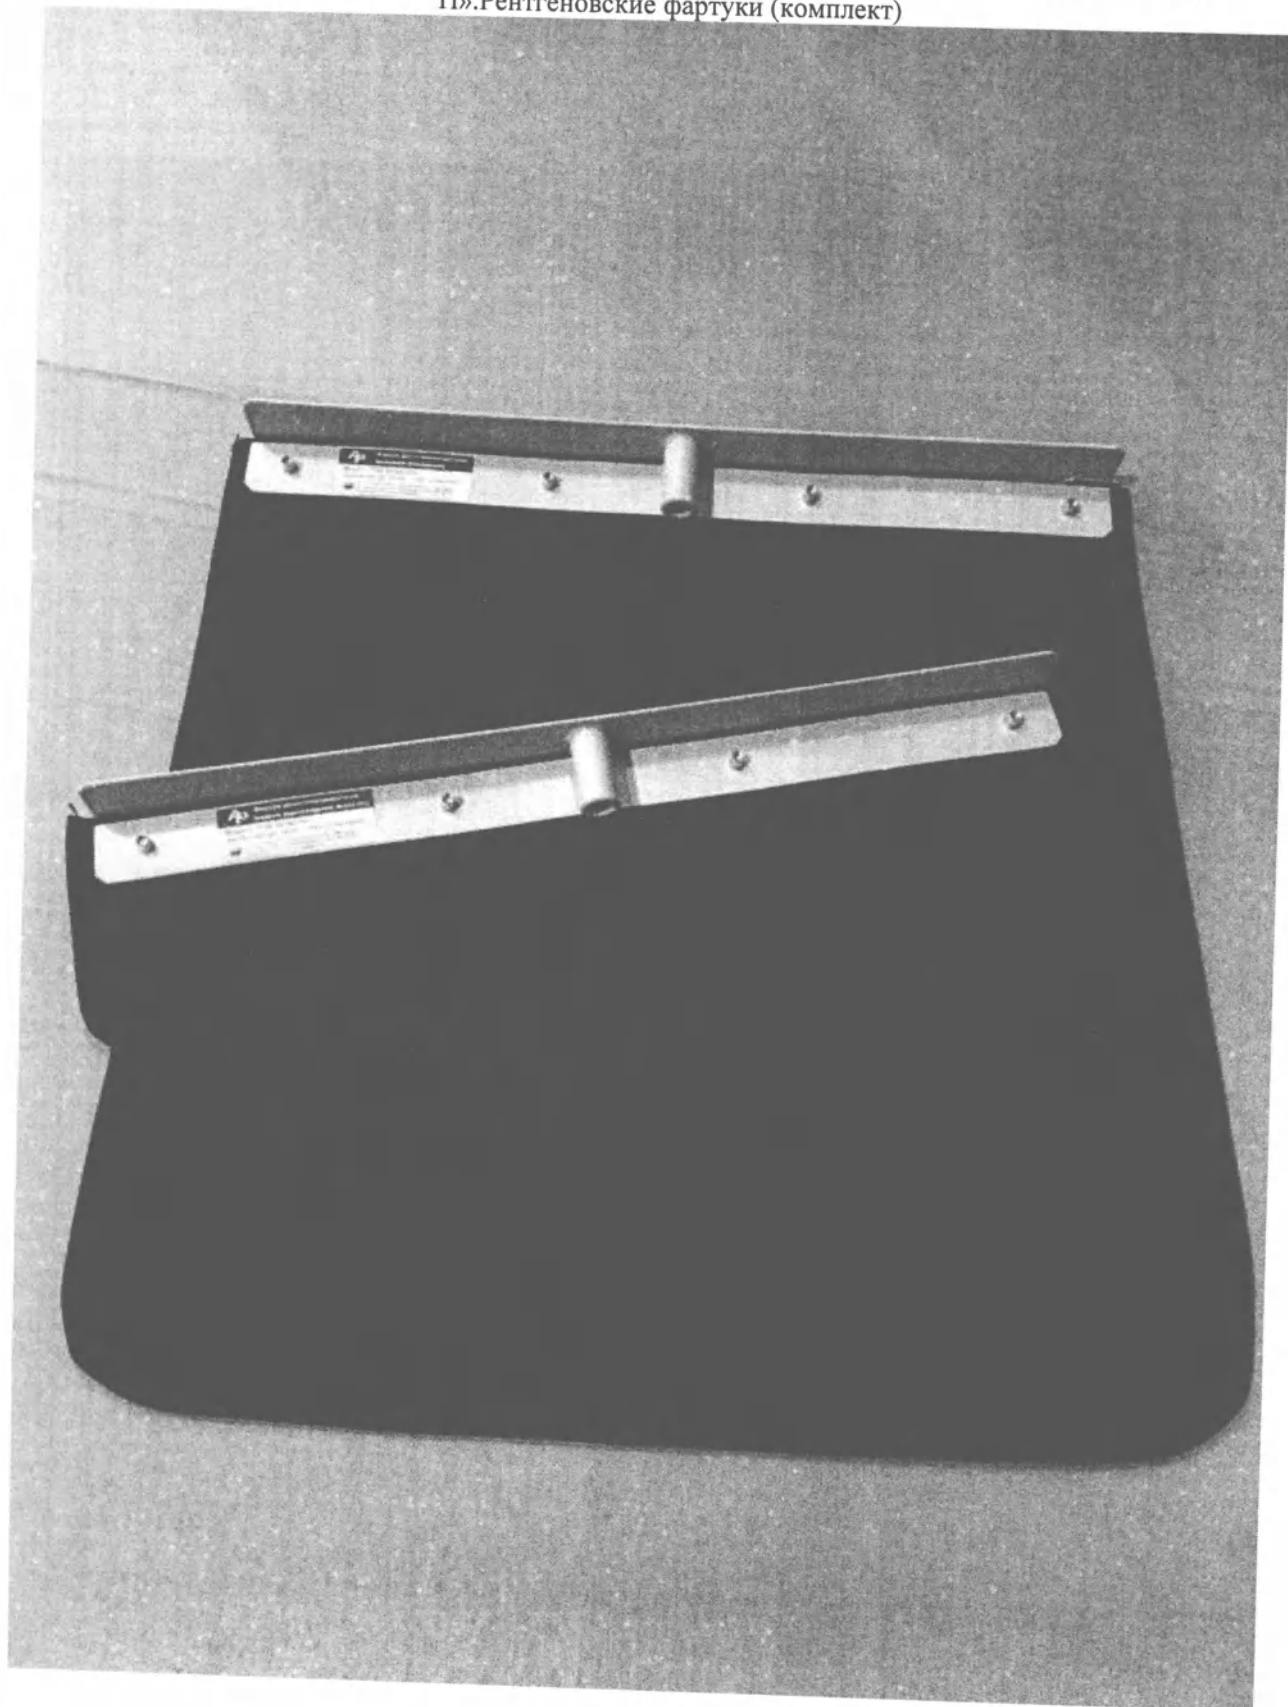


12. Растр рентгеновский (поставляется при необходимости) JPI или SOYEE, Корея.

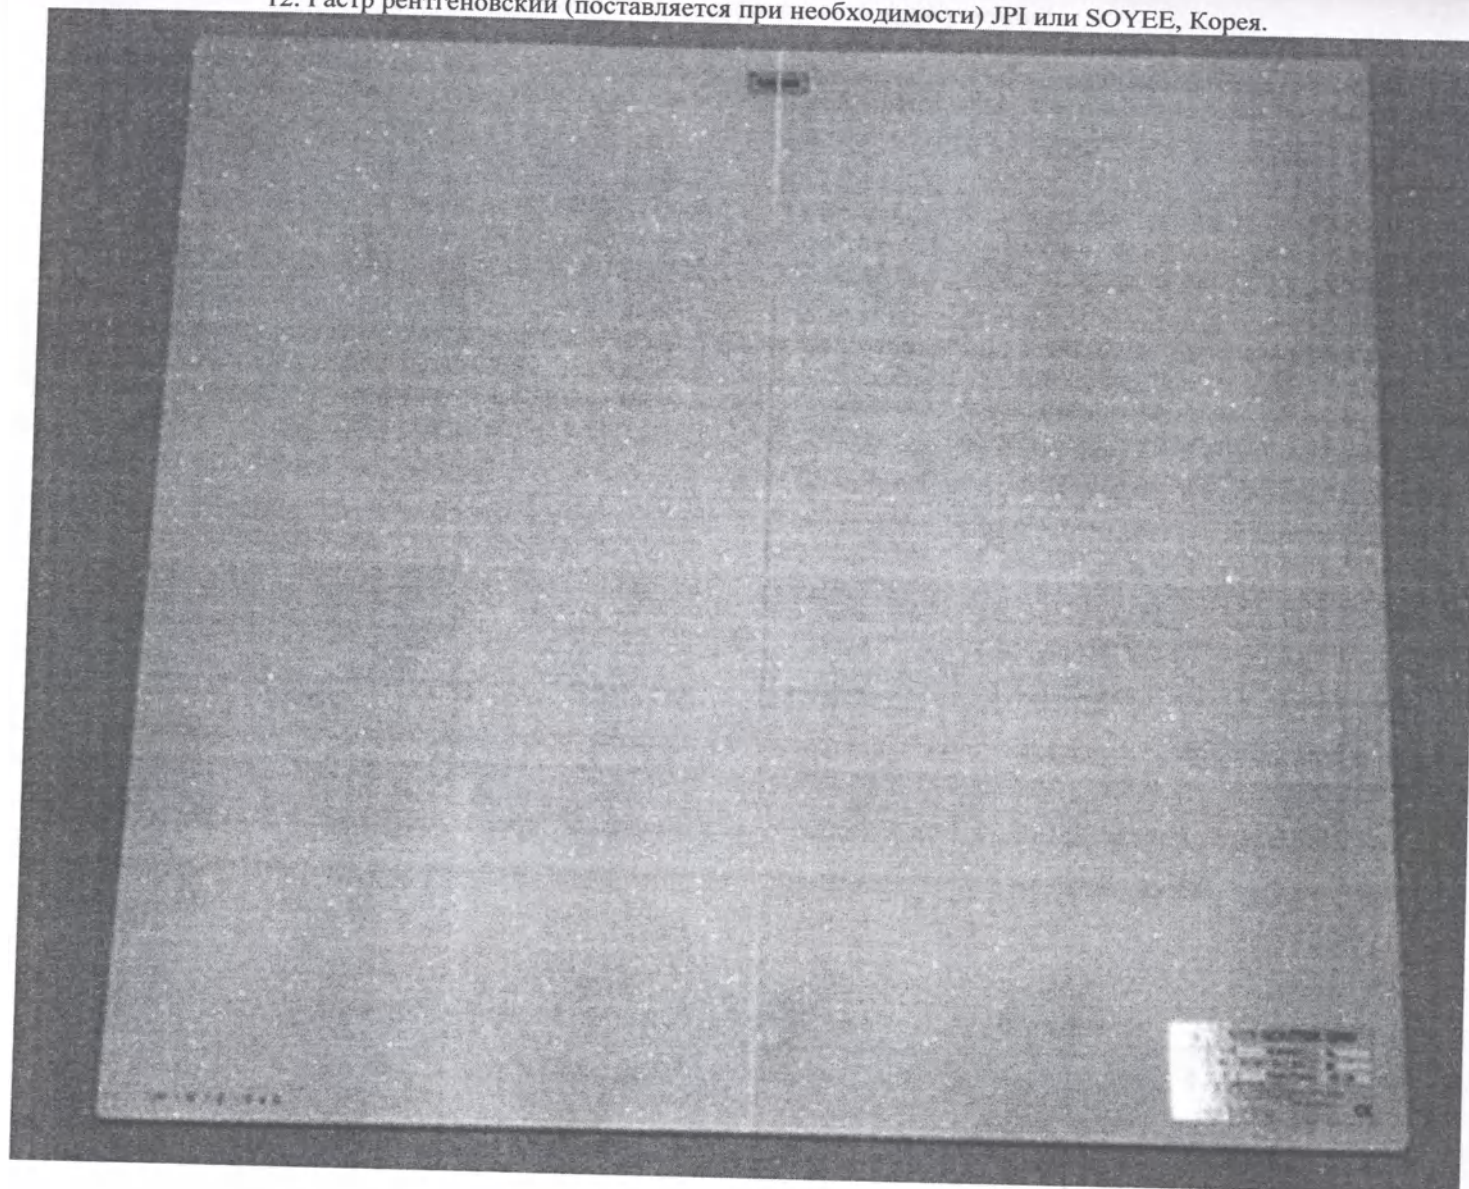

13. Комплект эксплуатационных документов

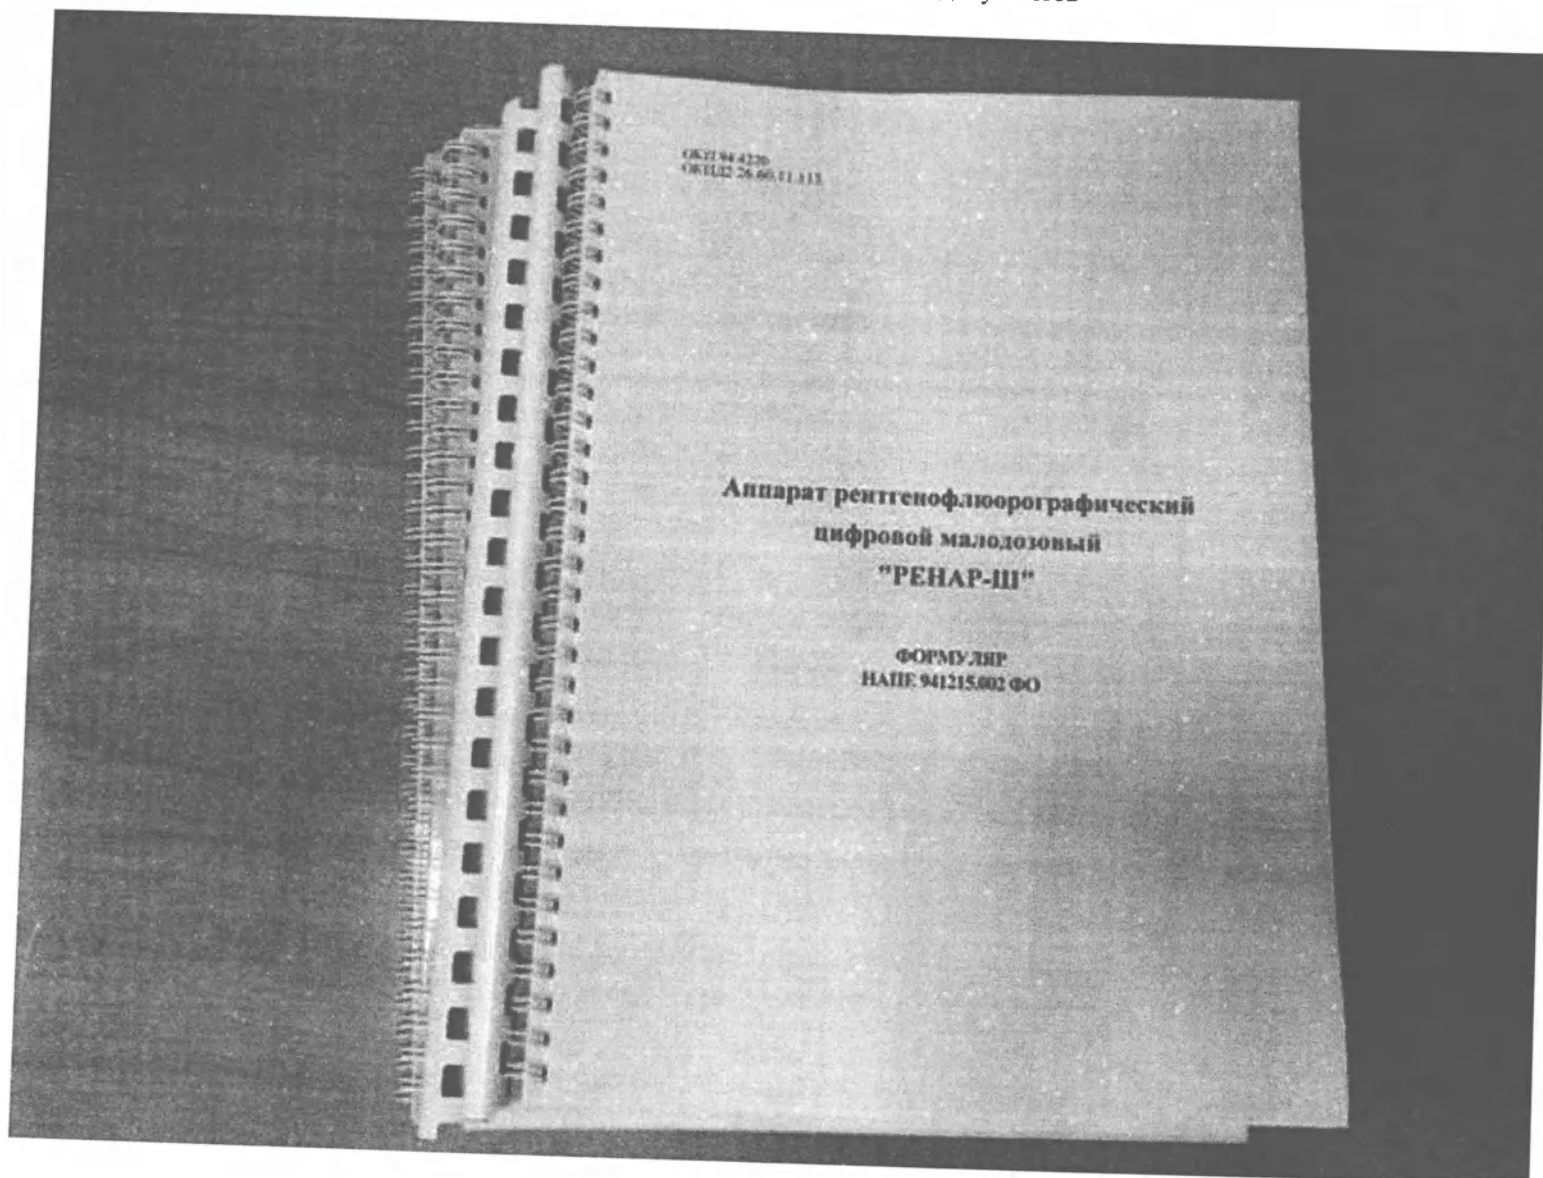


14. Принадлежности
Рентгенэкспонетр (поставляется при необходимости) ООО «АктюбРентген».

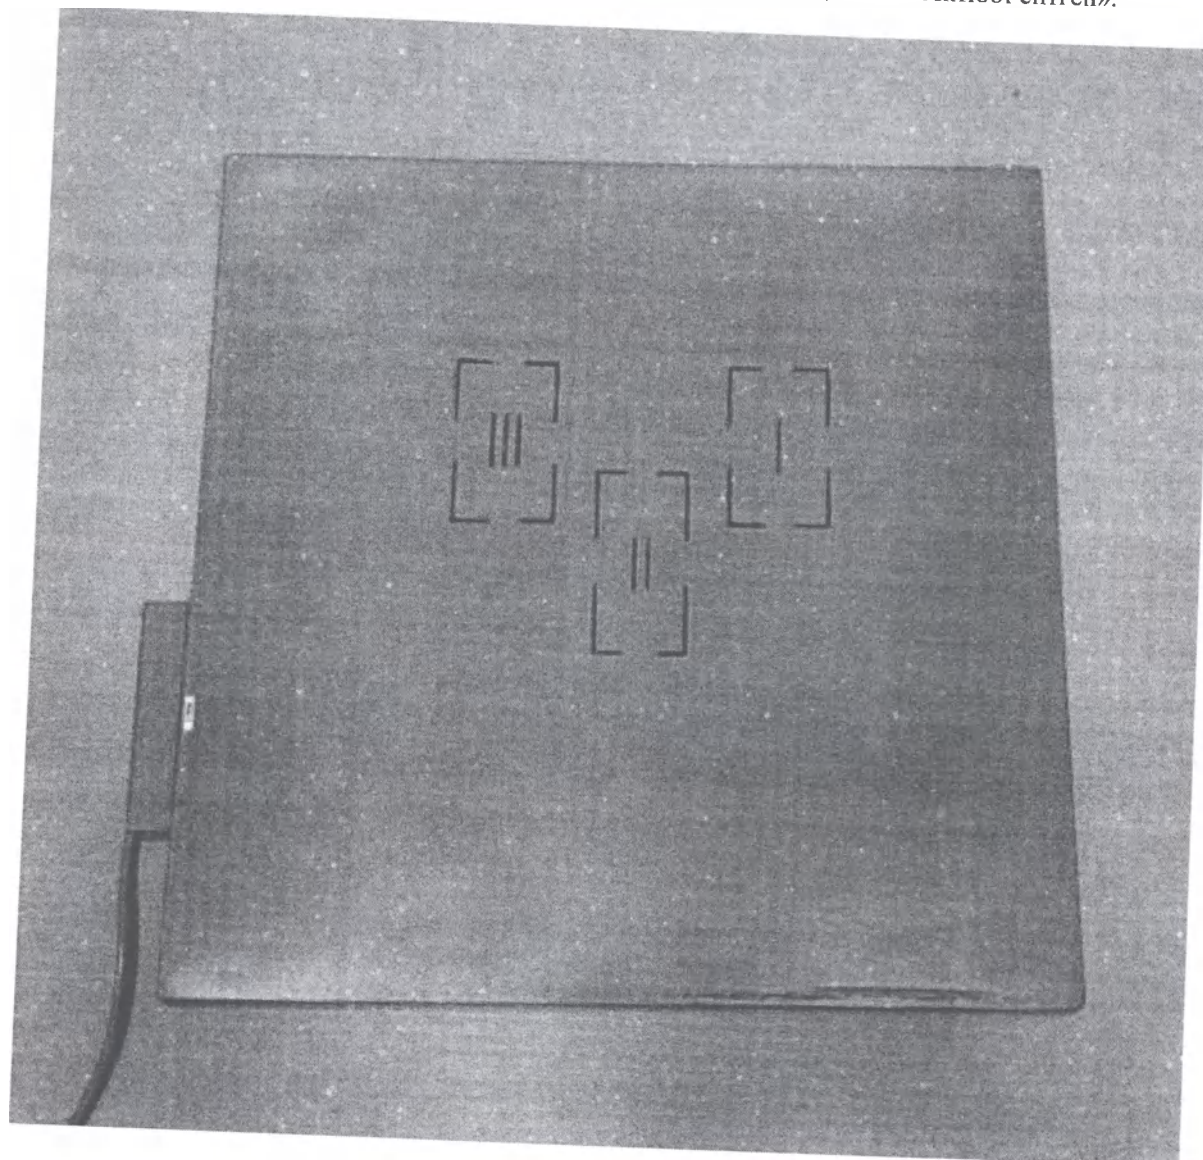


Аппарат рентгенографический цифровой малодозовый «РЕНАР-ШП» по ТУ 9442-002-14580254-2016 в составе:


1. Штатив-стойка с поворотной траверсой НАПЕ 305127.003 ООО «АктюбРентген», или АРЦУ 410.000 ООО НПО «Инвариант».

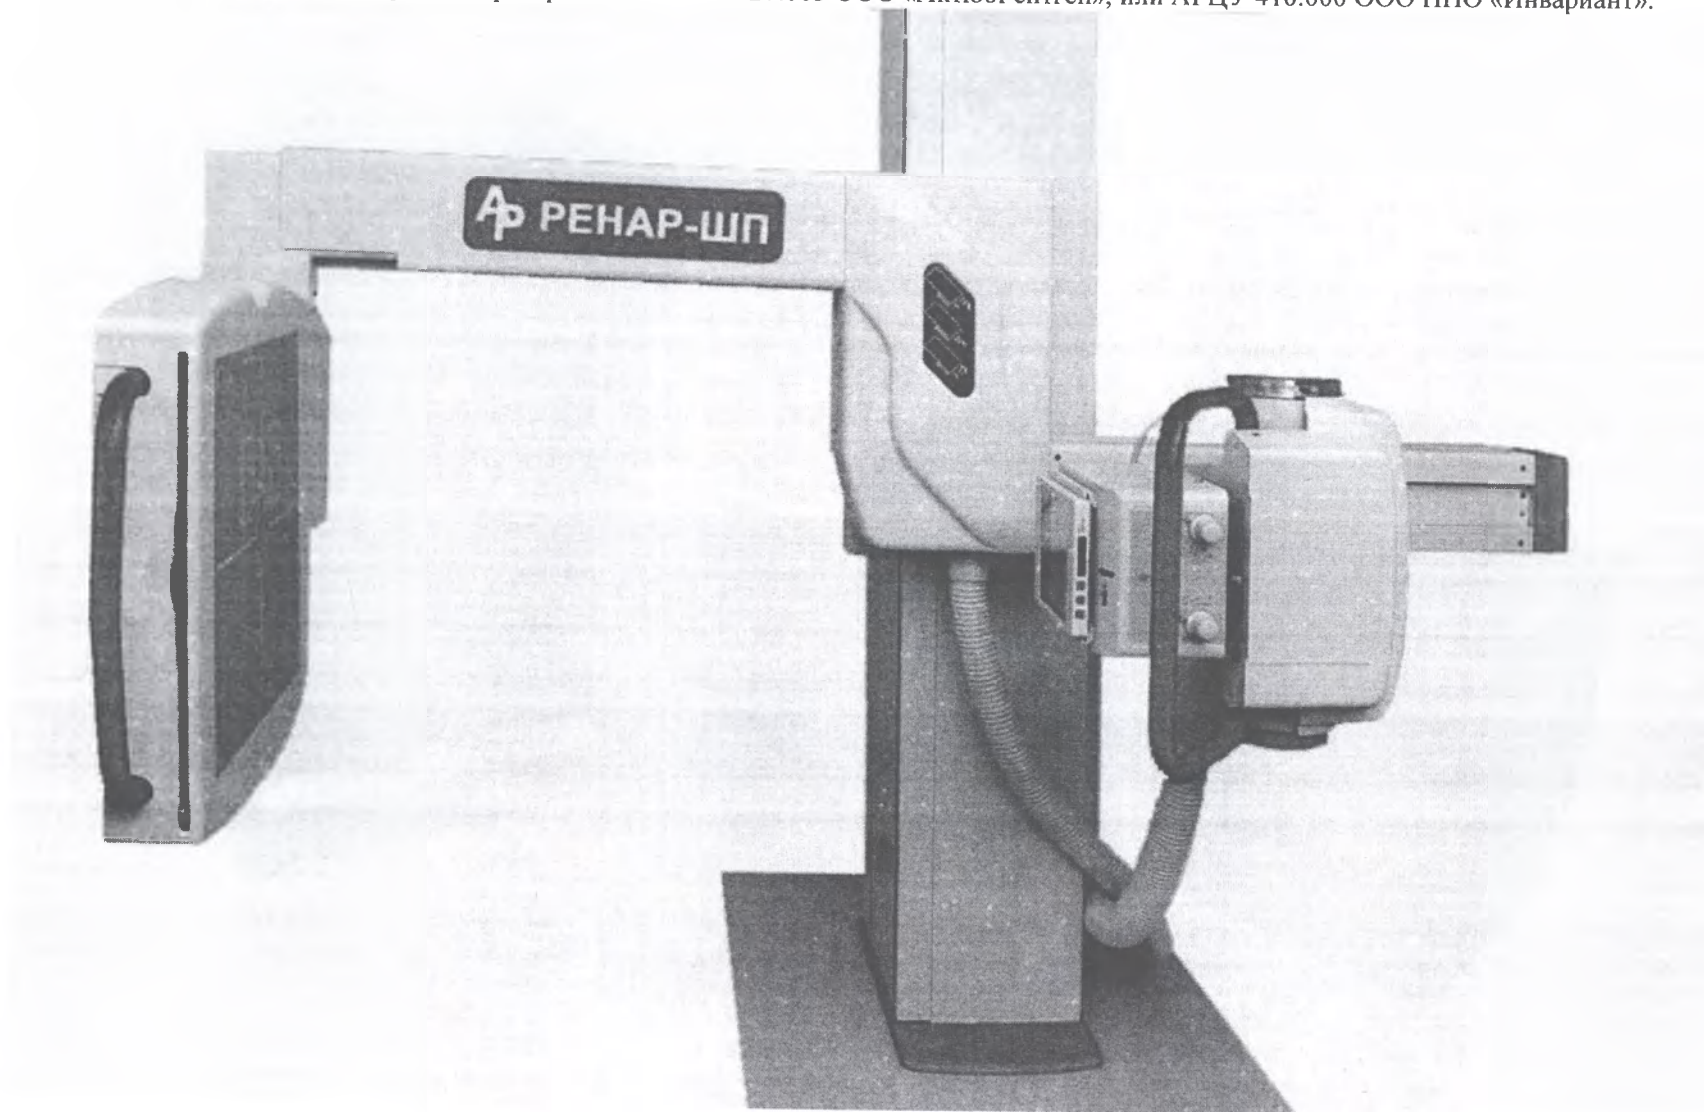


2.Рентгеновское питающее устройство по ТУ9442-002-75249059-2007 в исполнениях - РПУ ВЧ/1, РПУ ВЧ/2, РПУ ВЧ/3 ООО «НПП «ВЭЛИТ»
или РПУ «Sedecal» Модель SHF Sedecal S.R.L.

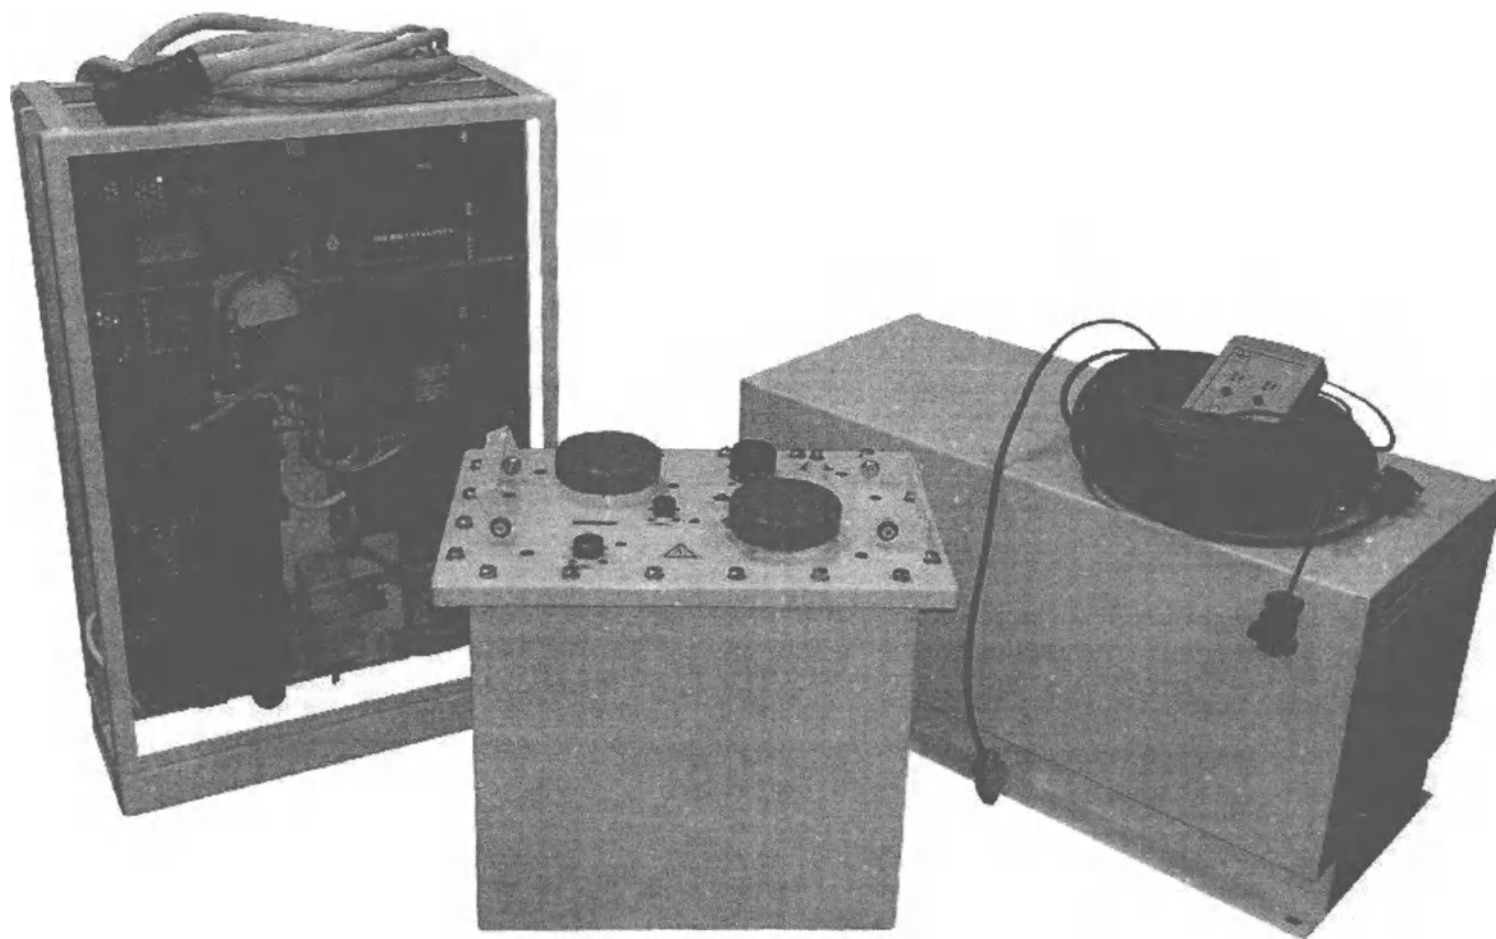


3.Излучатель рентгеновский РИД-1 ООО «АктюбРентген» или РИД-2 ЗАО АМИКО», или излучатель рентгеновский, серии E72XX Toshiba, Electron TUBES &DEVICE Co., Ltd, Япония, или излучатель C52 I.A.E.S.p.A.,Италия, или излучатель рентгеновский серии RAY14 SiemensAG, Китай.

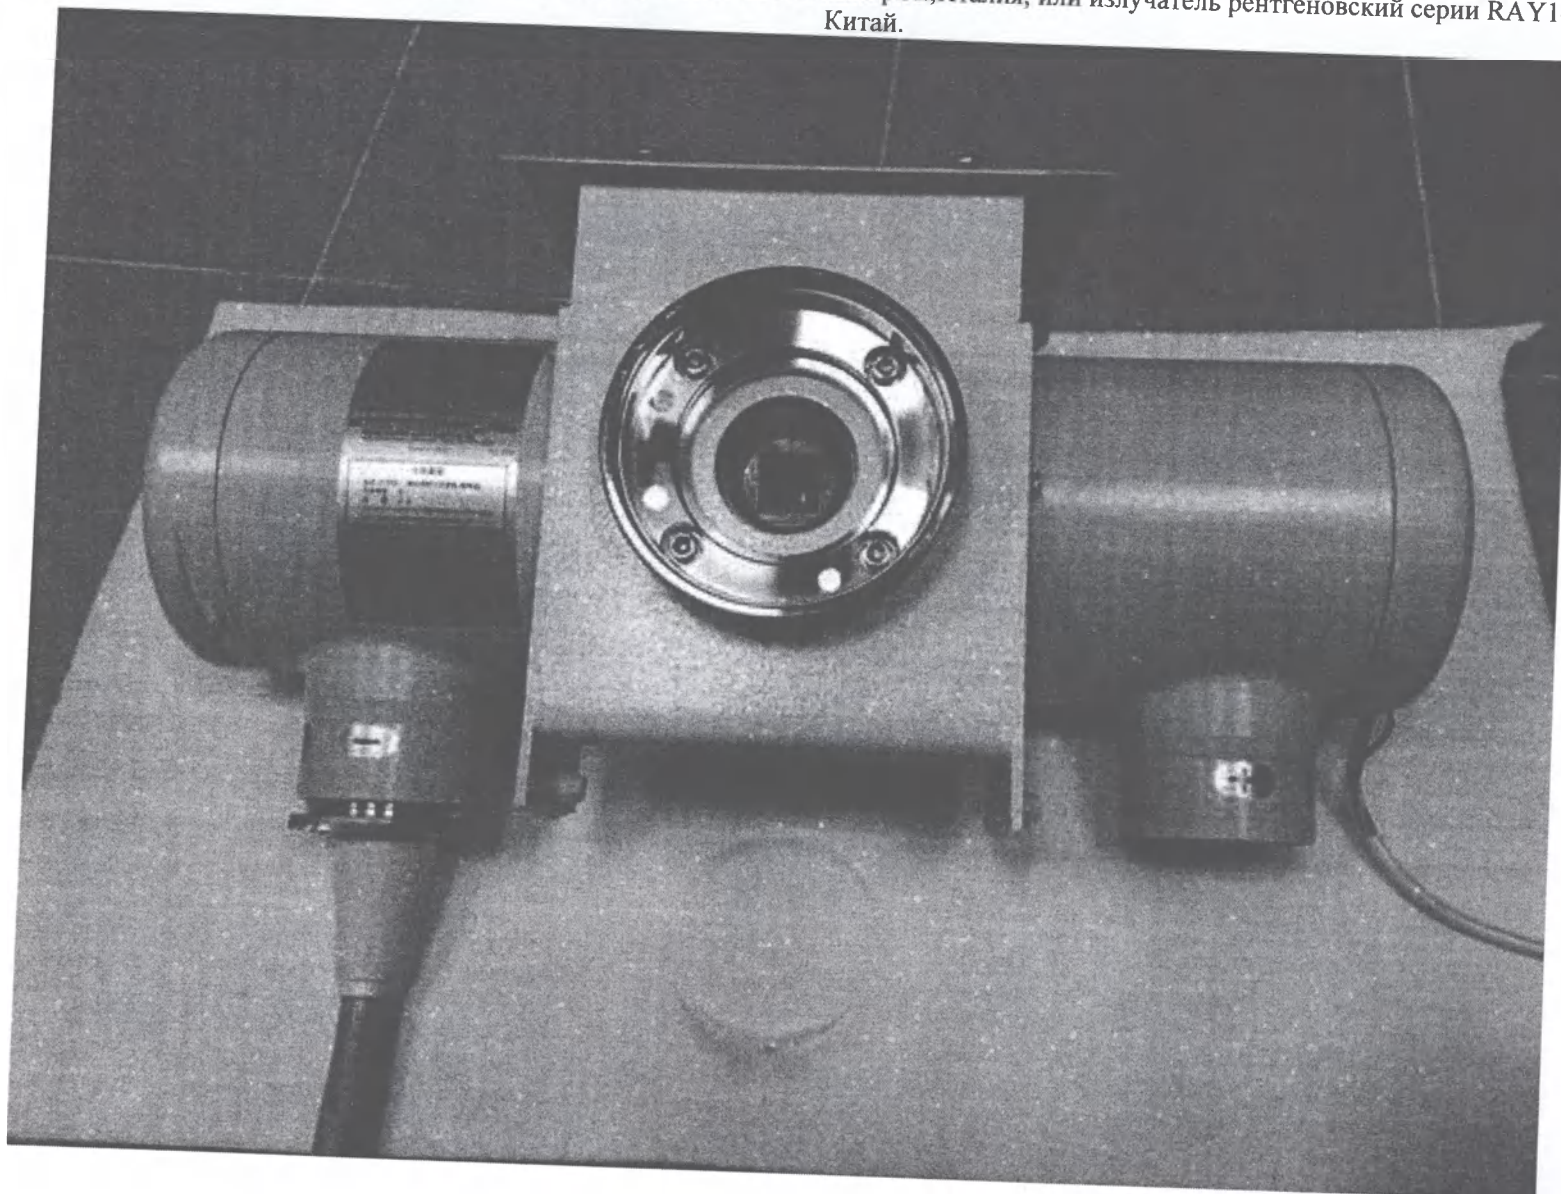


4. Диафрагма MC-101, MC-201, MC-202 DOOSUNGDIGITAL, Корея или Cablas S.R.L,Италия, или R302, R225 Ralco S.R.L, Испания.

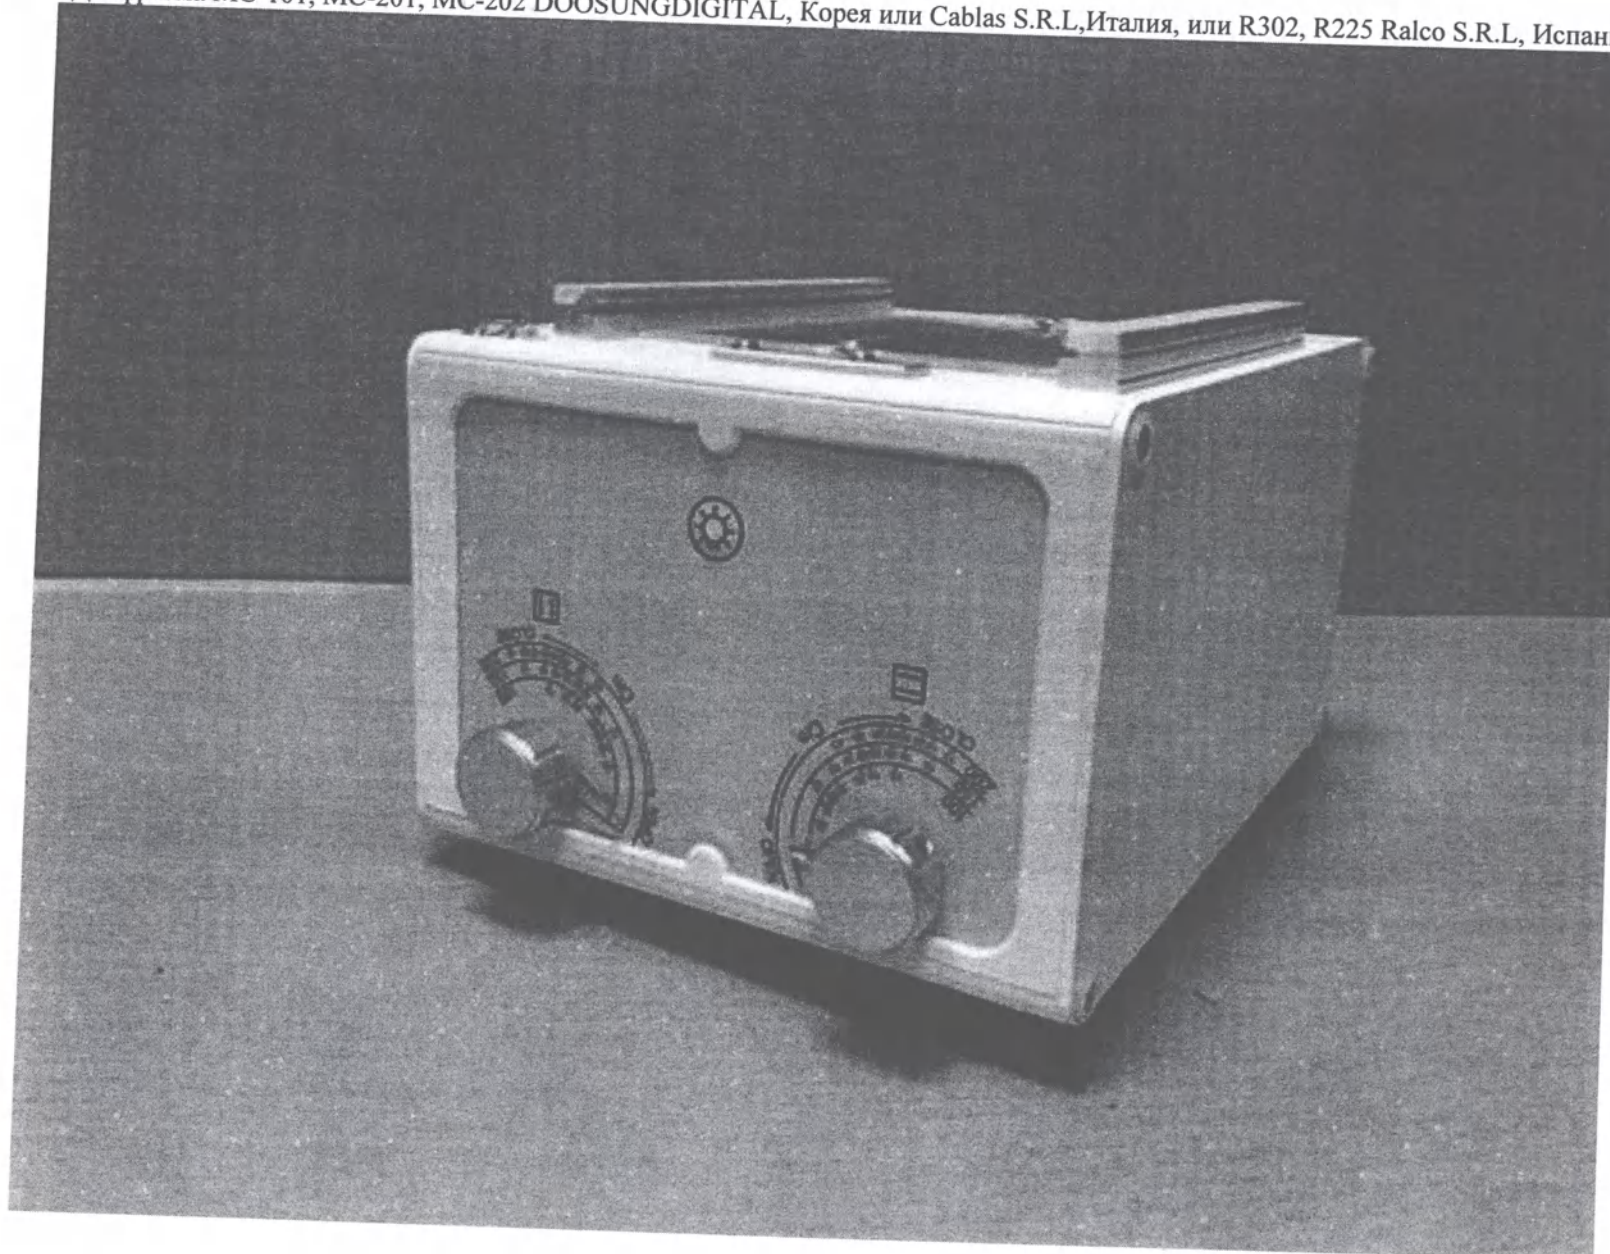


5. Кабели высоковольтные – 2шт., ООО «АктюбРентген» или ООО «ДЕСИ», или 75kV-L3-12-03 Locaflex Cable Assy, Claymount Assemblies B.V., Нидерланды.

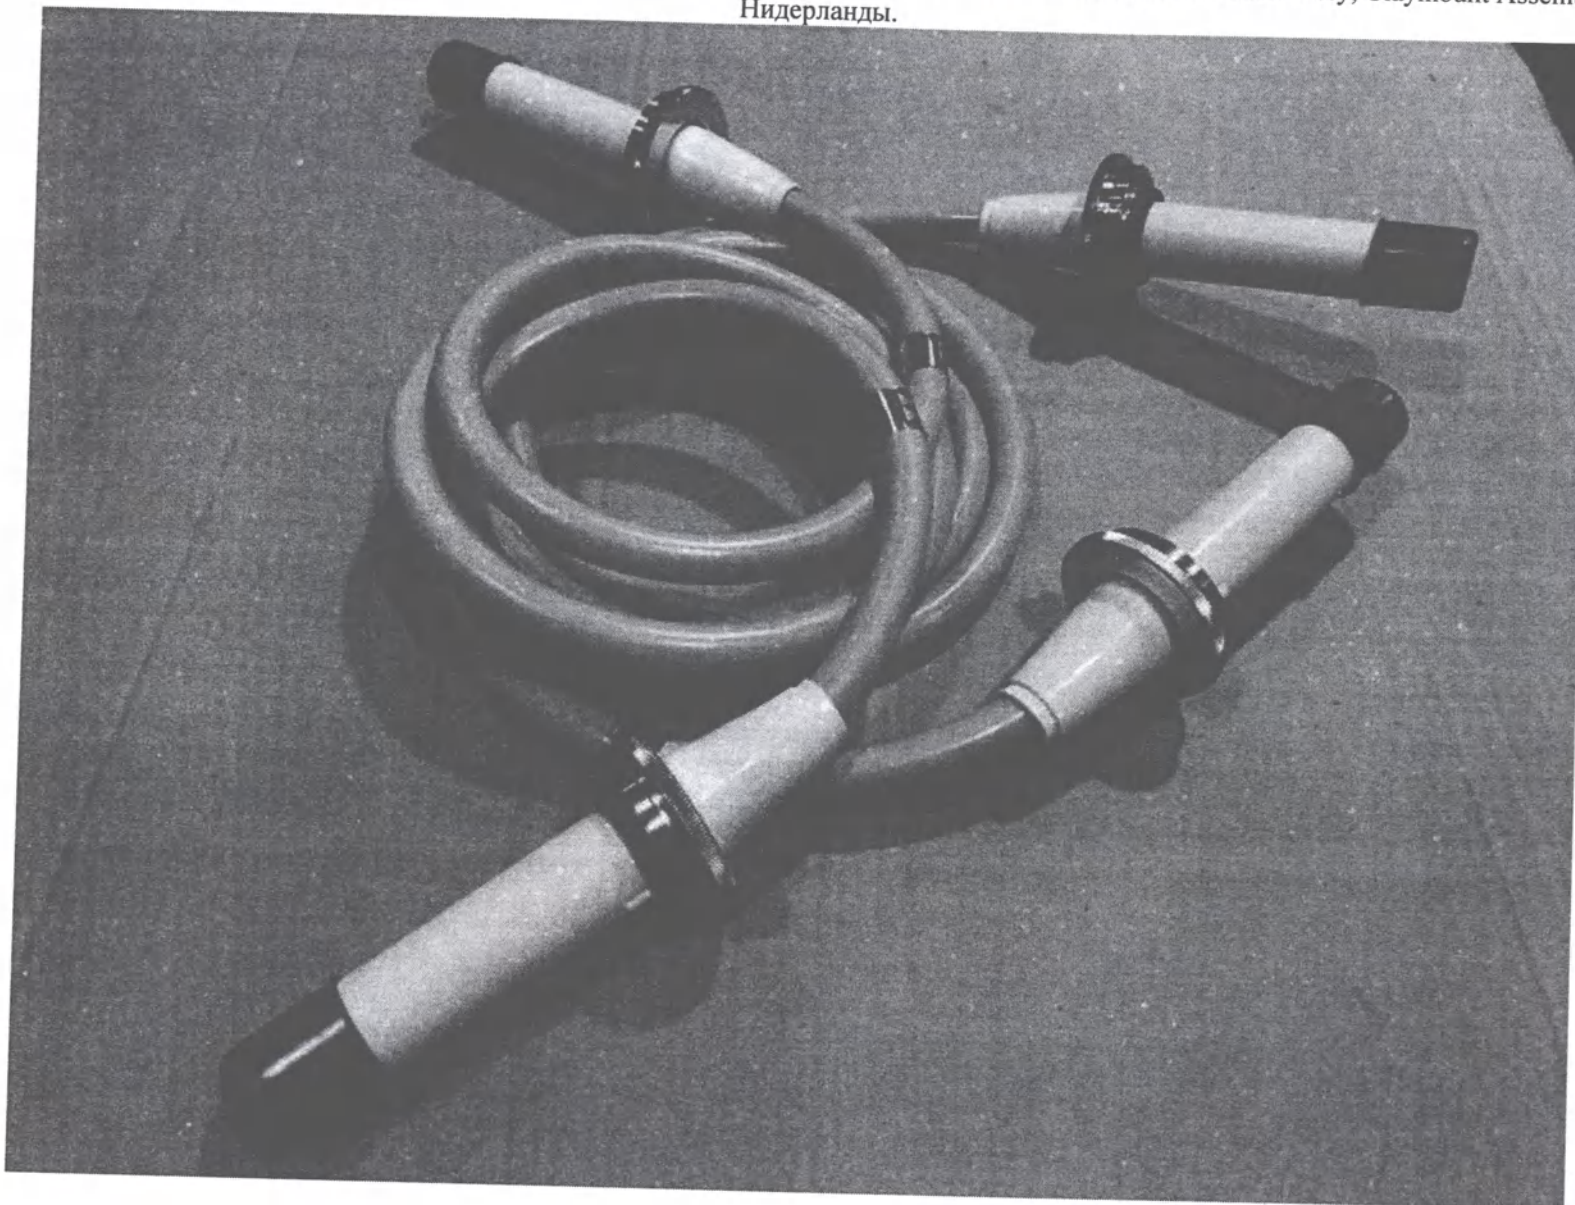

6. Приемник рентгеновского изображения: камера рентгеновская цифровая КРЦ-01 «ПОНИ», ЗАО «ПОНИ», или приемник РЦ-ФП в составе: плоскопанельный цифровой матричный детектор серии FDX4343R, Toshiba Electron Tubes&Devices Co, LTD, Япония или плоскопанельный цифровой матричный детектор модели FPD1M «Venu 1717M», Shanghai iRay Technology LTD, Китай или плоскопанельный цифровой матричный детектор ViVIX-S, моделей FXRD-1717SA, FRDX-1717SB, «ВьюворксКо., Лтд», Корея или плоскопанельный цифровой матричный детектор PixiumRF4343, Thales Electron Devices S.A., Франция или Приемник РЦ, ООО «Актюбрентген».

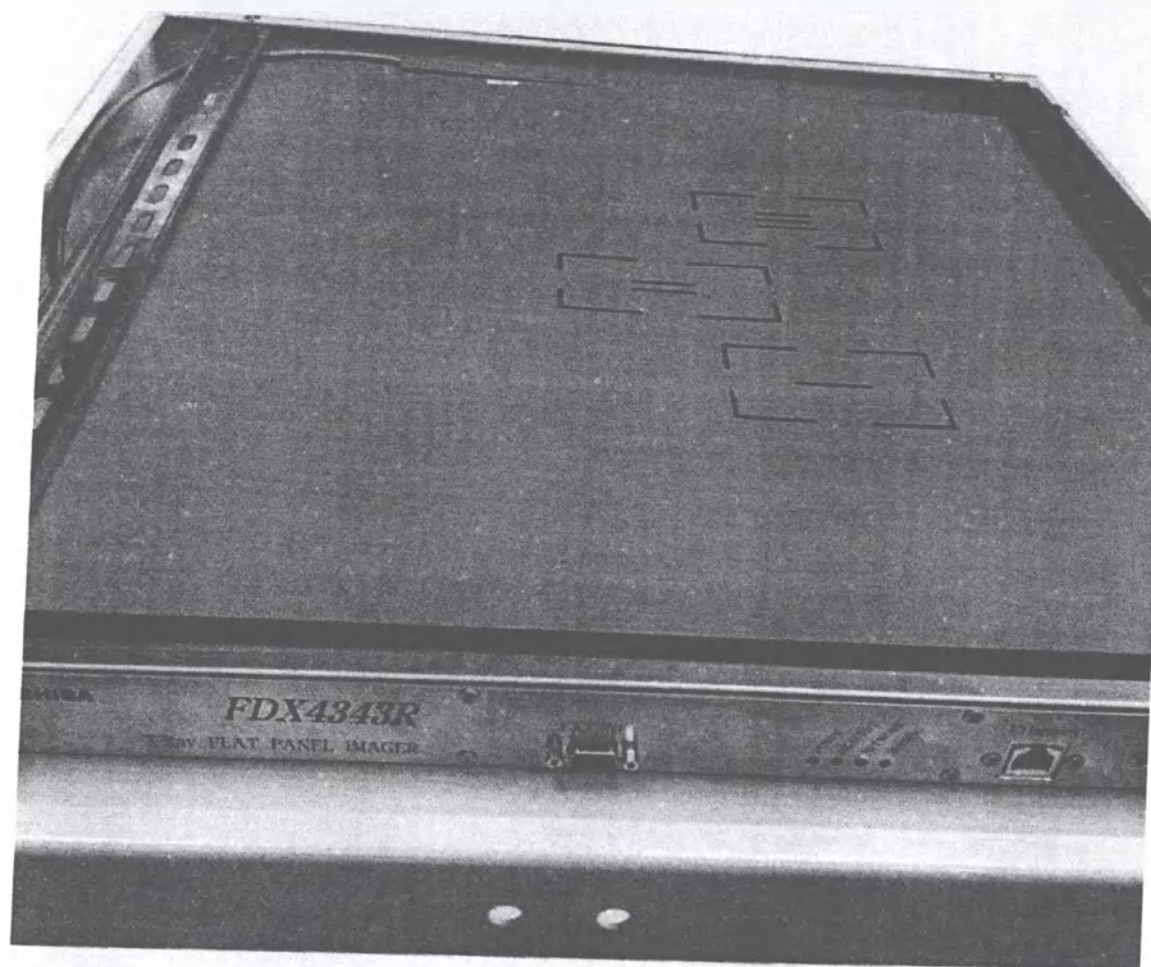


7. Дозиметр ДРК-1М ООО НПП «ДОЗА», или DIAMENTORM4 Physikalische-Technische Werkstätten Dr. Püchla GmbH, Германия или Vacu DAP 2004 OEM VacuTecMeßtechnik GmbH, Германия

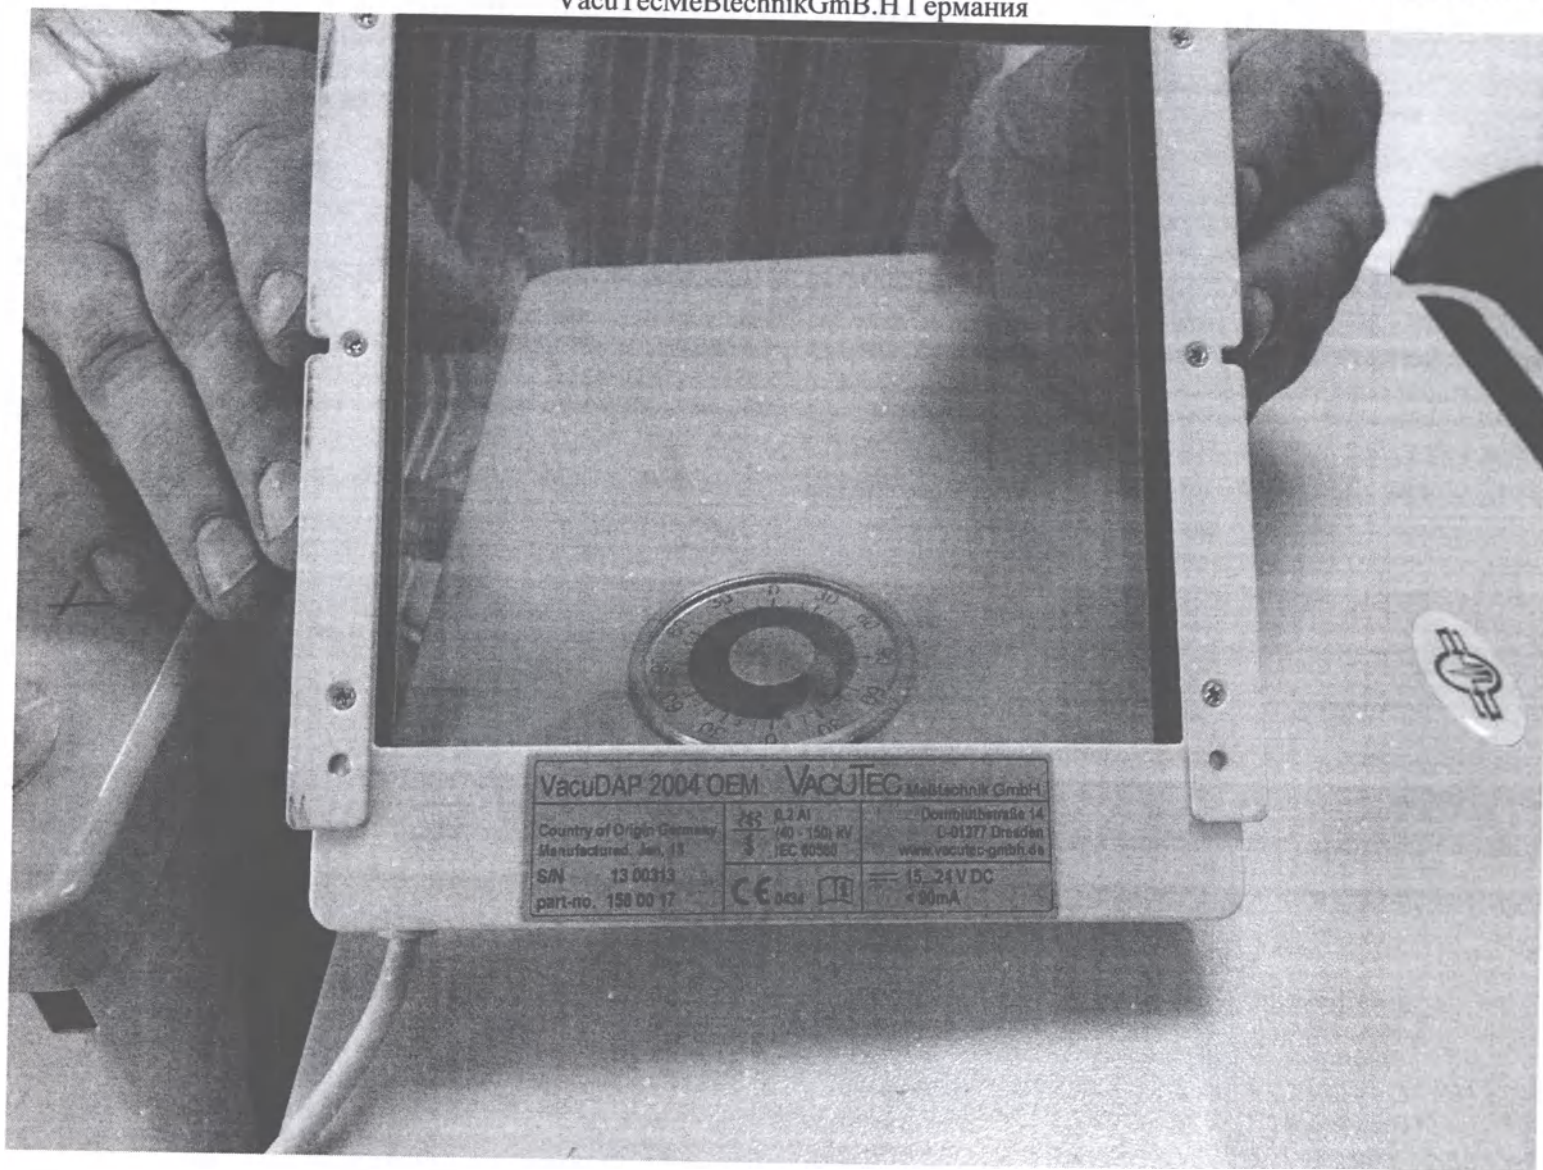


8. АРМ-1 (автоматизированное рабочее место рентген-лаборанта), производства ООО «АктюбРентген» в составе: монитор с диагональю экрана не менее 19 дюймов, системный блок, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь, принтер, камера видеонаблюдения (поставляется при необходимости), переговорное устройство, пакет специального программного обеспечения «Альфа» ШУА Т90.000 или «Пони-Флюоро-Альфа» RUS ТУКЕ.0002-01 ЗАО «ПОНИ», или НАПЕ 941215.ПО «РЕНАР» ООО «АктюбРентген».



9. АРМ-2 (автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога), производства ООО «АктюбРентген» в составе: монитор с диагональю экрана не менее 19 дюймов, системный блок, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь, принтер, термопринтер (поставляется при необходимости), пакет специального монохромный монитор (поставляется при необходимости), внешнее сетевое хранилище (поставляется при необходимости), пакет специального программного обеспечения «Альфа» ШУАТ90.000 или «Пони-Флюоро-Альфа» RUS ТУКЕ.0002-01 ЗАО «ПОНИ», или НАПЕ 941215.ПО «РЕНАР» ООО «АктюбРентген».

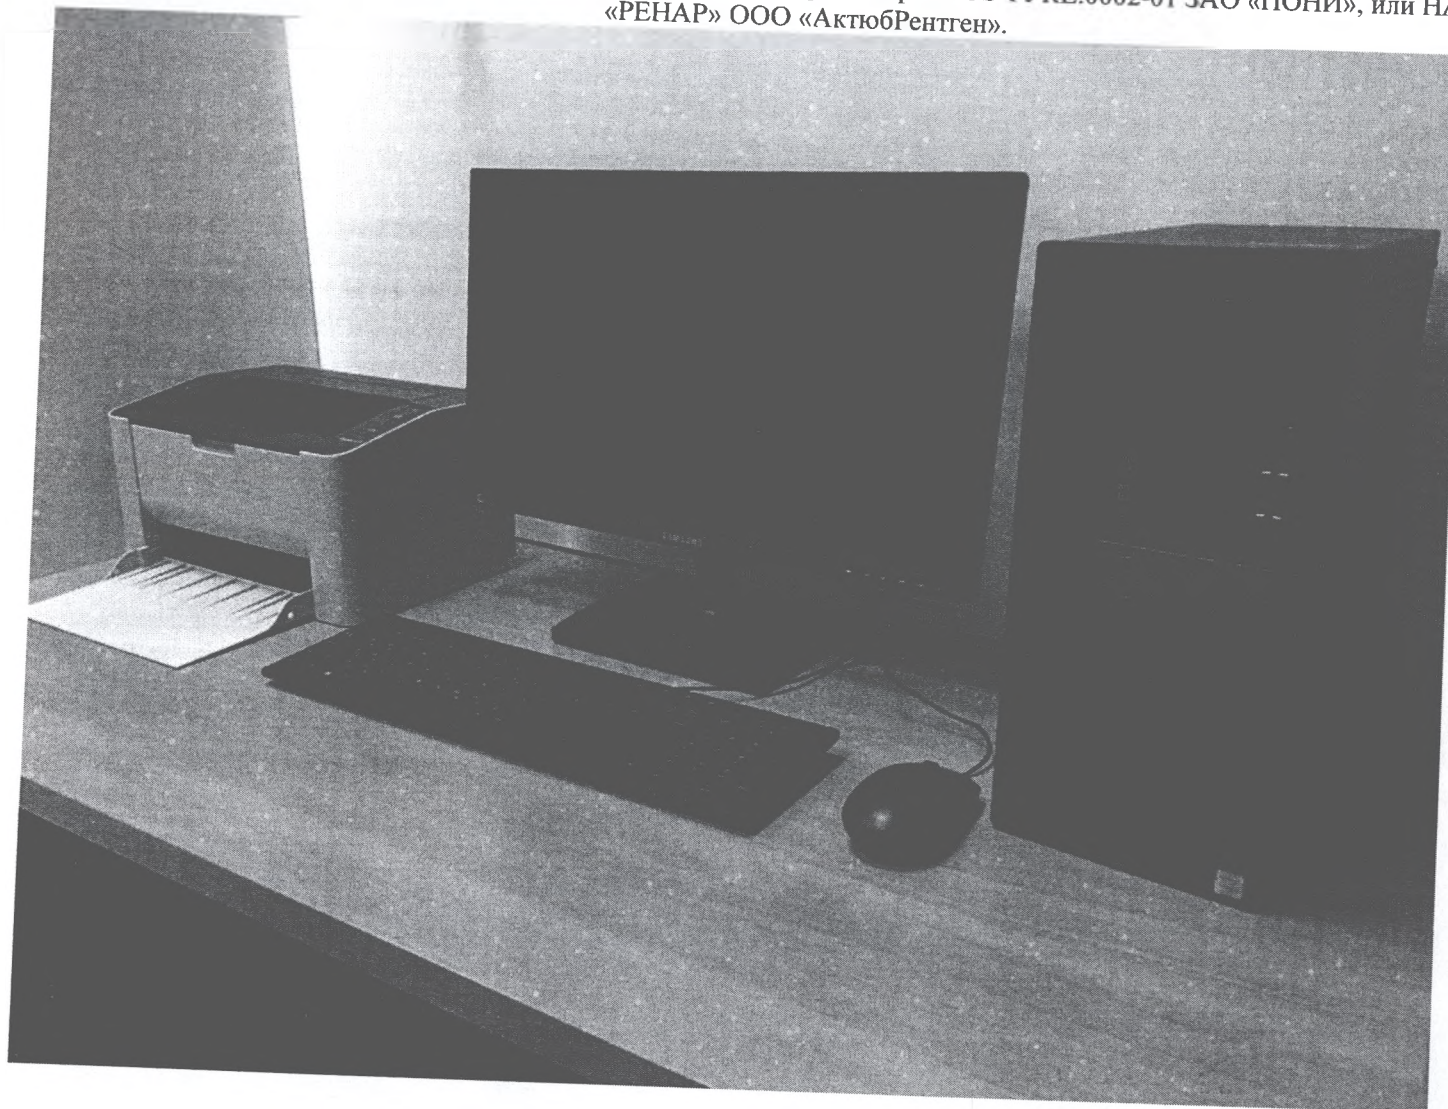


10. Комплект индивидуальных средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения (поставляется при необходимости): комплект изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» ООО «Рентгенкомплект» или комплект средств индивидуальной радиационной защиты - воротник защитный (0,5Pb), шапочка защитная (0,35Pb), очки защитные (0,15Pb), перчатки защитные ЗАО «РЕНЕКС».

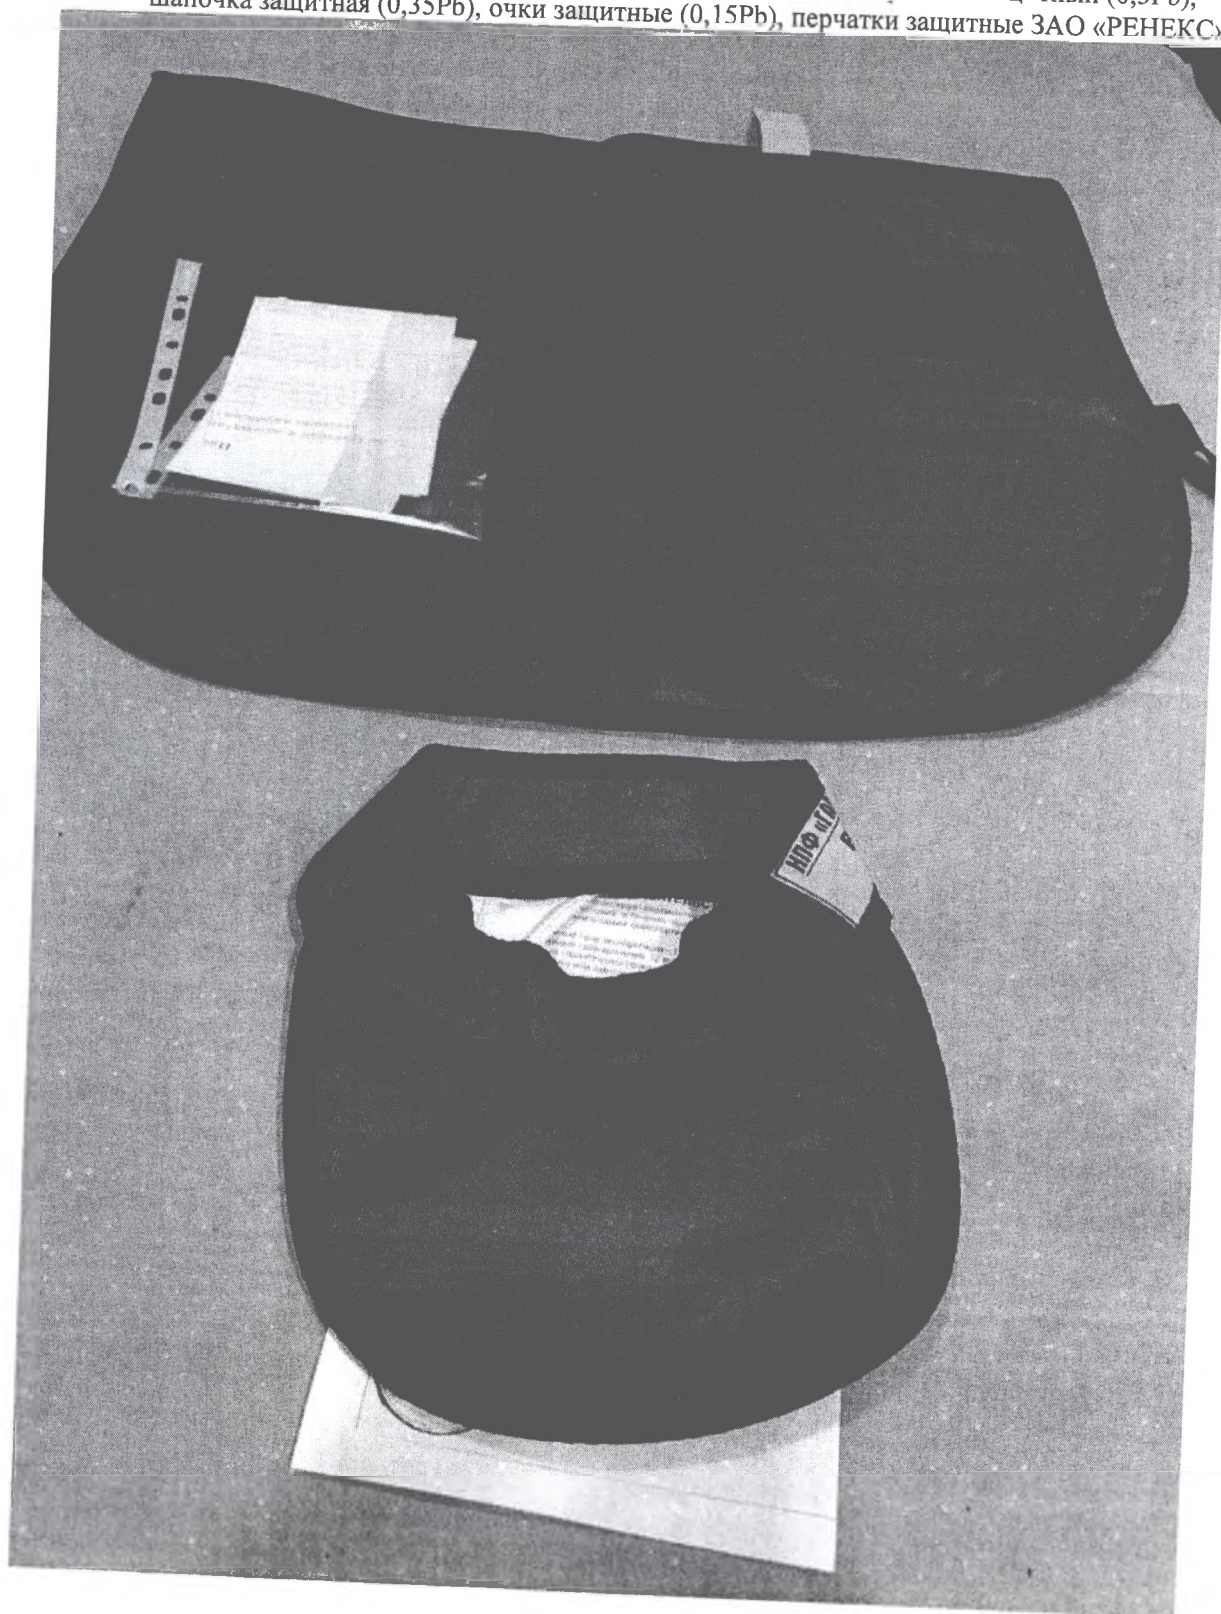


11. Стол-каталка рентгенографическая (поставляется при необходимости) ООО «ПМП «Протон», или каталка рентгенографическая (поставляется при необходимости) ЗАО «АЗРТ».



12. Растр рентгеновский (поставляется при необходимости) JPI или SOYEE, Корея.

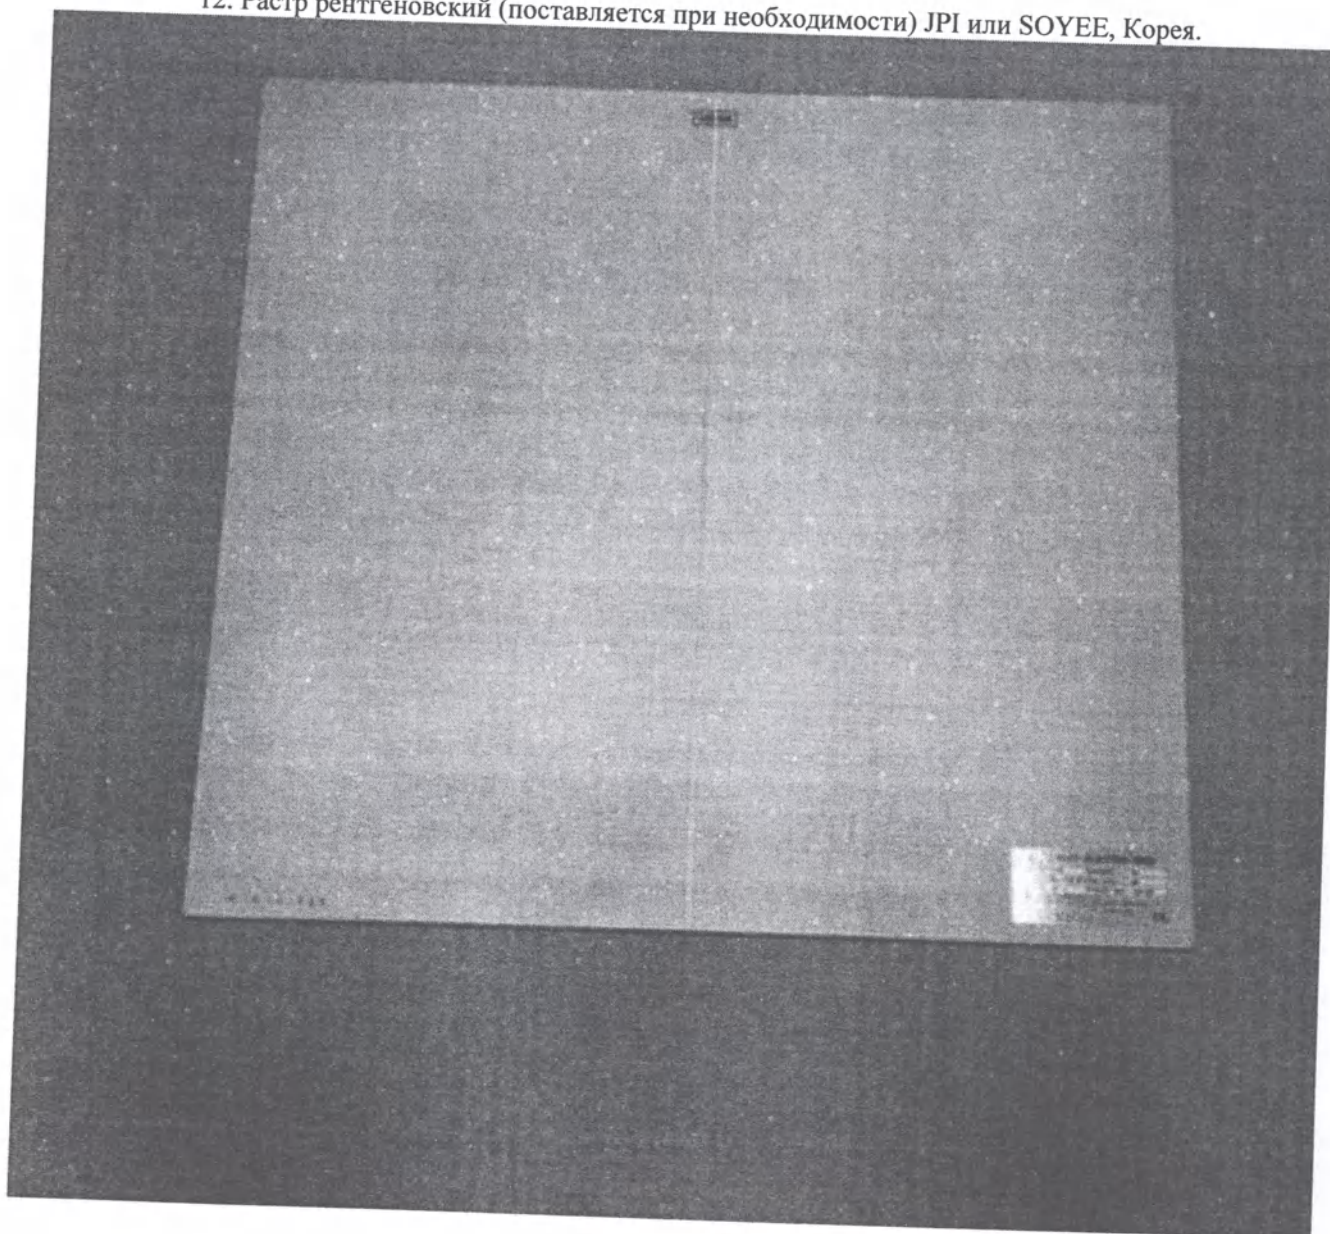

13. Комплект эксплуатационных документов

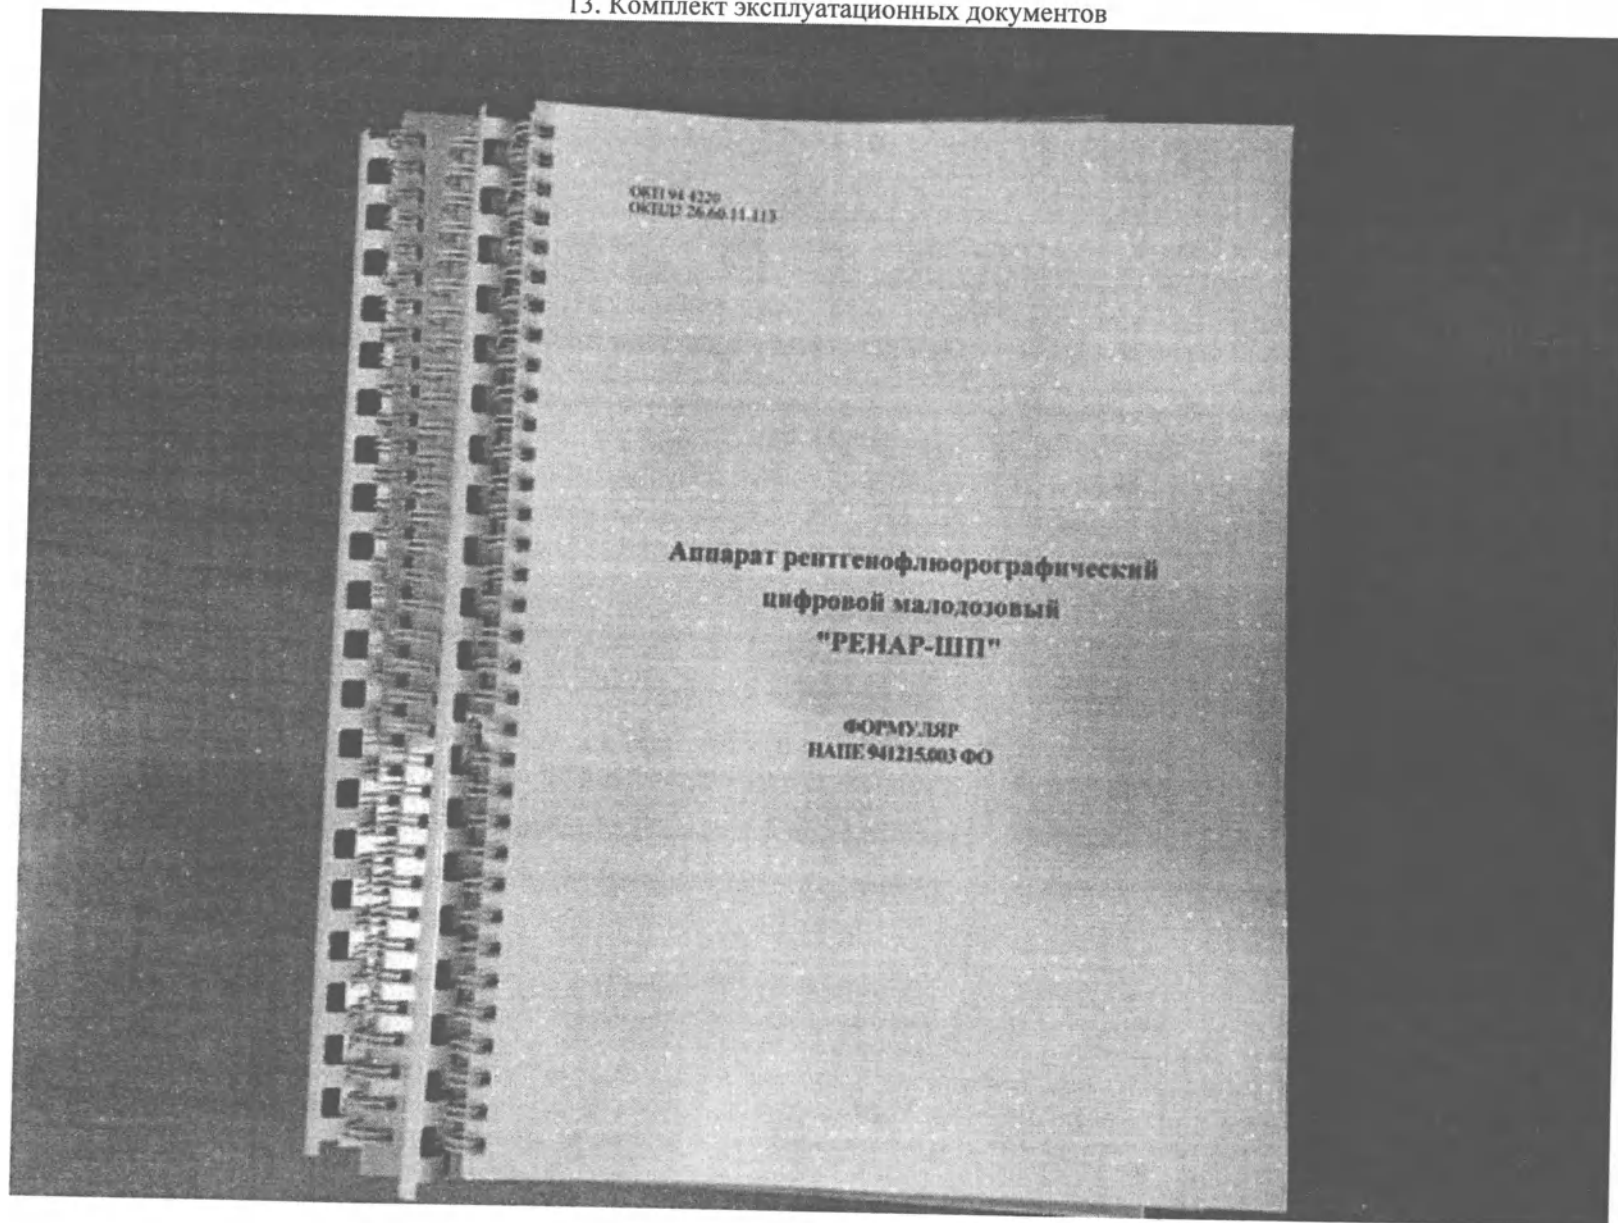

14. Принадлежности
Рентгенэкспонетр (поставляется при необходимости) ООО «АктюбРентген».

