

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ЗАО НПП «МедИнж»



С. В. Евдокимов

« 23 » марта 2018 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия:

«Протез сосуда «МЕДИНЖ-СО» с протезом клапана сердца по МЛЦК.942241.017 ТУ»,

Производства компании ЗАО НПП «МедИнж»

2018 год

Протез сосуда "МЕДИНЖ-СО" с протезом клапана сердца
гофрированный тканый синтетический

МЛЦК.942511.017ТУ Рег. ул. N°

от

REF SB.28-BIO.25-R.1.1

2018-01

Диаметр 28 мм




SN 2231

2023-01

Длина 125 мм min

Size 25

STERILE EO



STRAIGHT



ЗАО НПП "МедИнж"

Россия, Пенза, ул. Центральная, д.1, а/я 2913,
тел/факс (8412) 38-09-68, 38-09-59, 93-47-63
E-mail: meng@sura.ru http://www.medeng.ru

Протез сосуда "МЕДИНЖ-СО" с протезом клапана сердца
гофрированный тканый синтетический

МЛЦК.942511.017ТУ

Рег. уд. №

от

REF ST.24-STW.21-C.1.1

2018-01



Диаметр 24 мм

SN 2229

2023-01

Длина 125 мм min

Size 21



STRAIGHT



ЗАО НПП "МедИнж"

Россия, Пенза, ул. Центральная, д.1, а/я 2913,
тел/факс (8412) 38-09-68, 38-09-59, 93-47-63
E-mail: meng@sum.ru http://www.modeng.ru

Протез сосуда "МЕДИНЖ-СО" с протезом клапана сердца
гофрированный тканый синтетический

МЛЦК.942511.017ТУ Рег. уд. № от

REF SV.28-ECV.25-F.1.1

2018-01 

Диаметр 28 мм



SN 2233

 2023-01

Длина 125 мм min

Size 25

STERILE EO




VALSALVA




ЗАО НПП "МедИнж"


Россия, Пенза, ул. Центральная, д.1, а/я 2913,
тел/факс (8412) 38-09-68, 38-09-59, 93-47-63
E-mail: meng@sura.ru <http://www.medeng.ru>

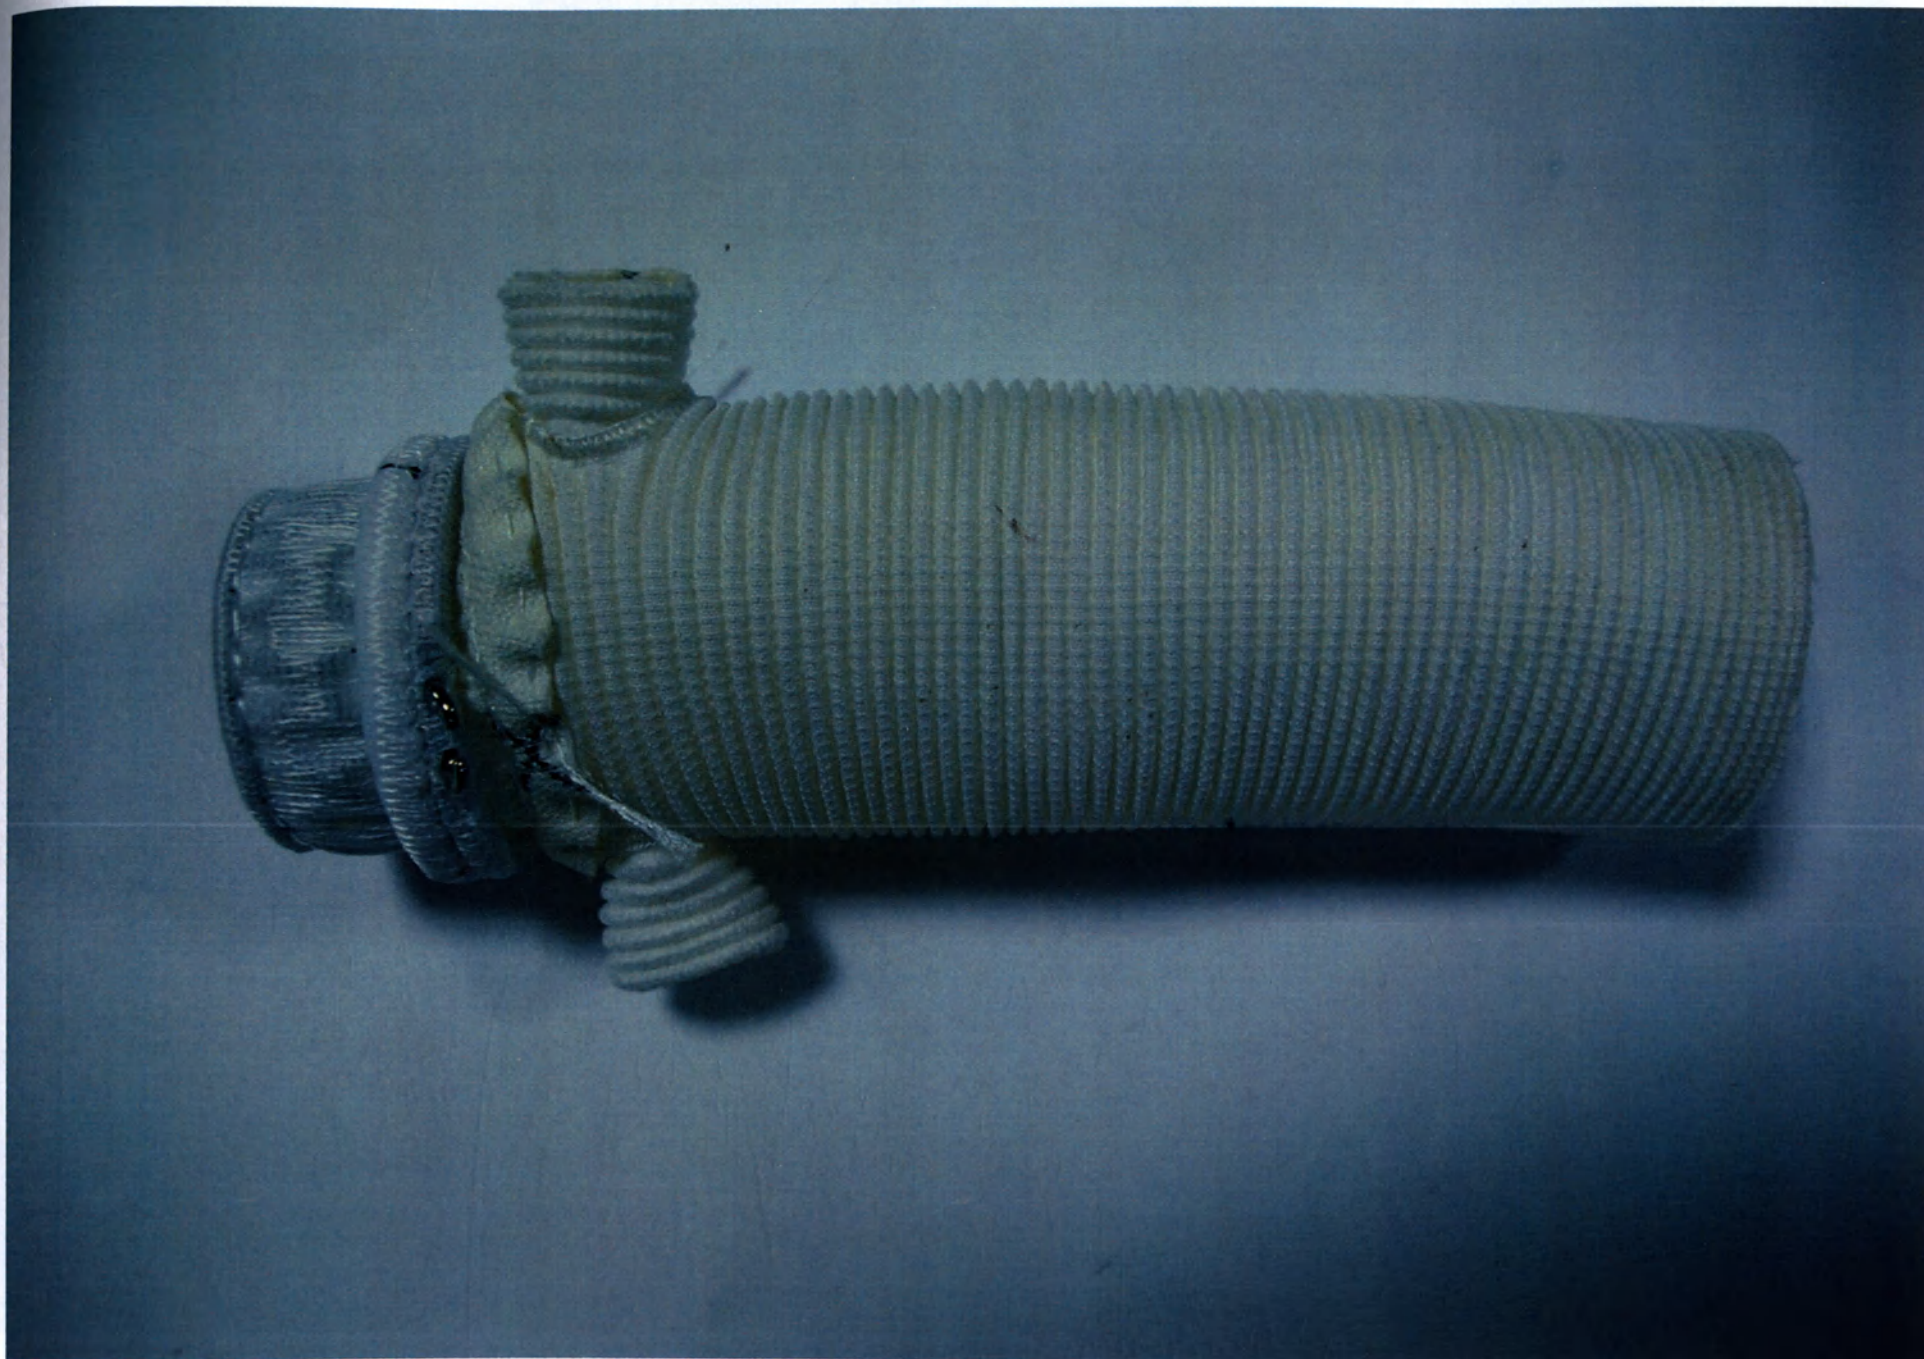


Вариант исполнения медицинского изделия «Протез сосуда «МЕДИНЖ-СО» с протезом клапана сердца по МЛЦК.942241.017 ТУ: Протез аорты с коронарными ответвлениями с присоединяемой манжетой с бесшовной фиксацией (SB.X-XXX.XX-R.X.X)

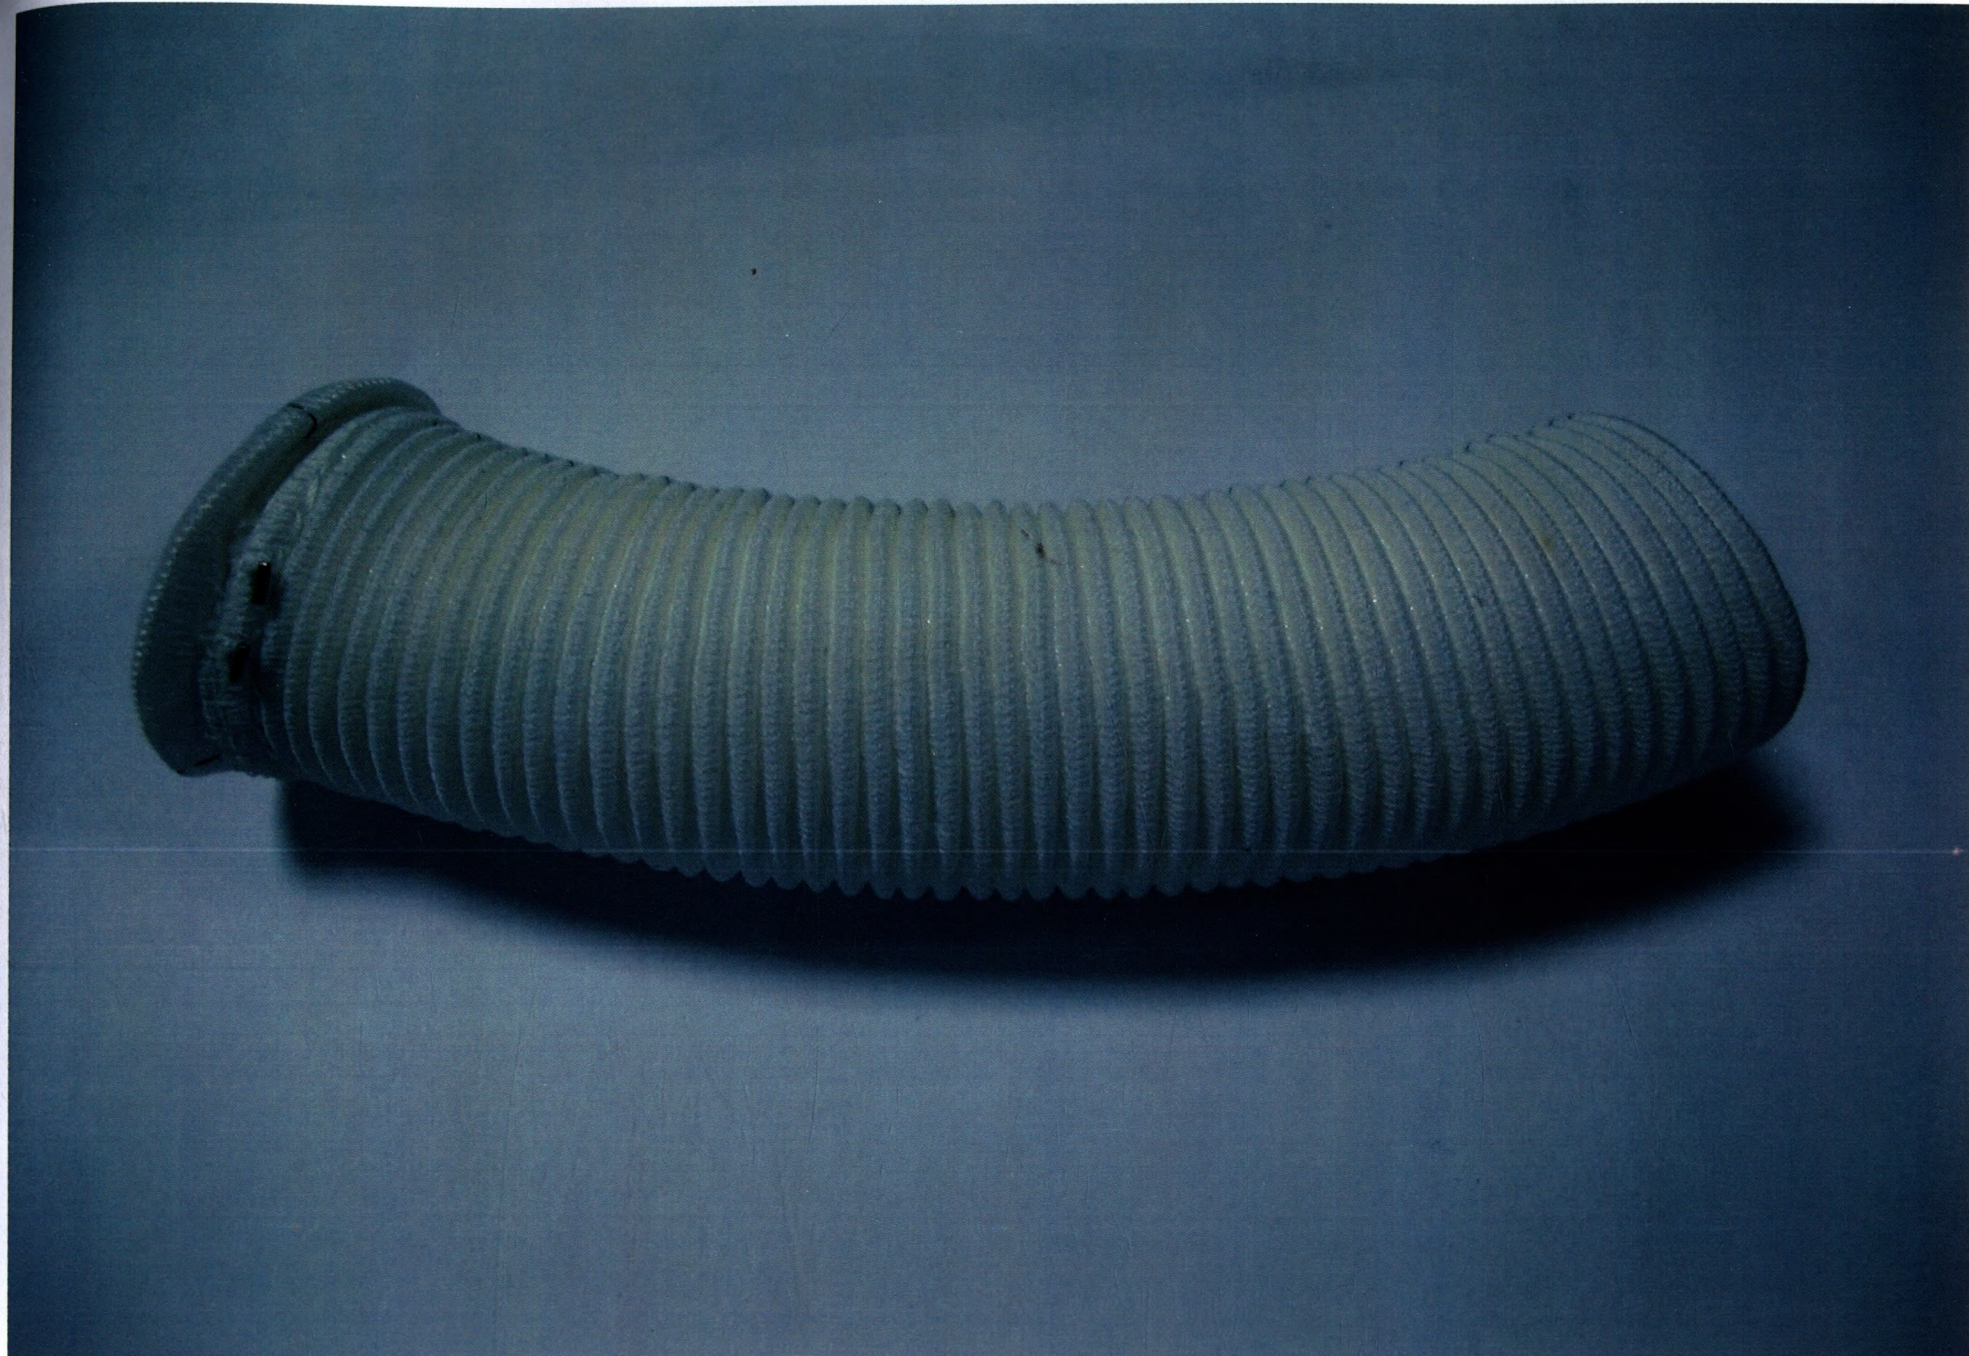

Вариант исполнения медицинского изделия «Протез сосуда «МЕДИНЖ-СО» с протезом клапана сердца по МЛЦК.942241.017 ТУ: Протез аорты с присоединяемой манжетой (ST.X-XXX.XX-C.X.X)

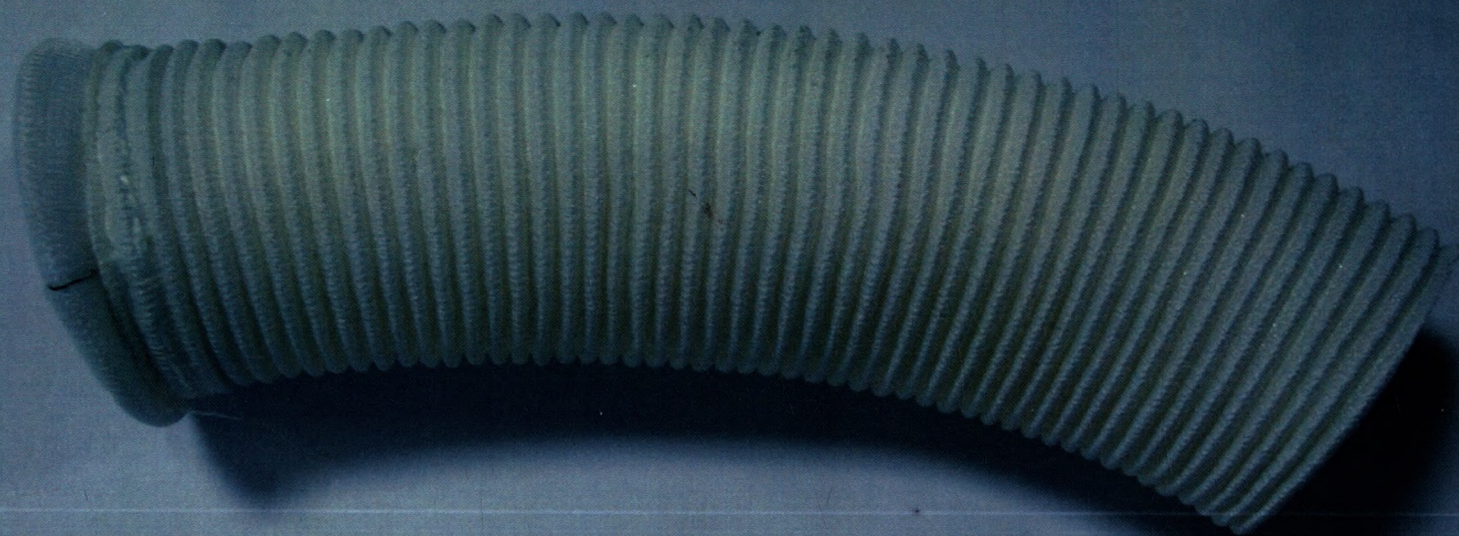


Вариант исполнения медицинского изделия «Протез сосуда «МЕДИНЖ-СО» с протезом клапана сердца по МЛЦК.942241.017 ТУ: Протез аорты с фиксированной манжетой (ST.X-XXX.XX-F.X.X)

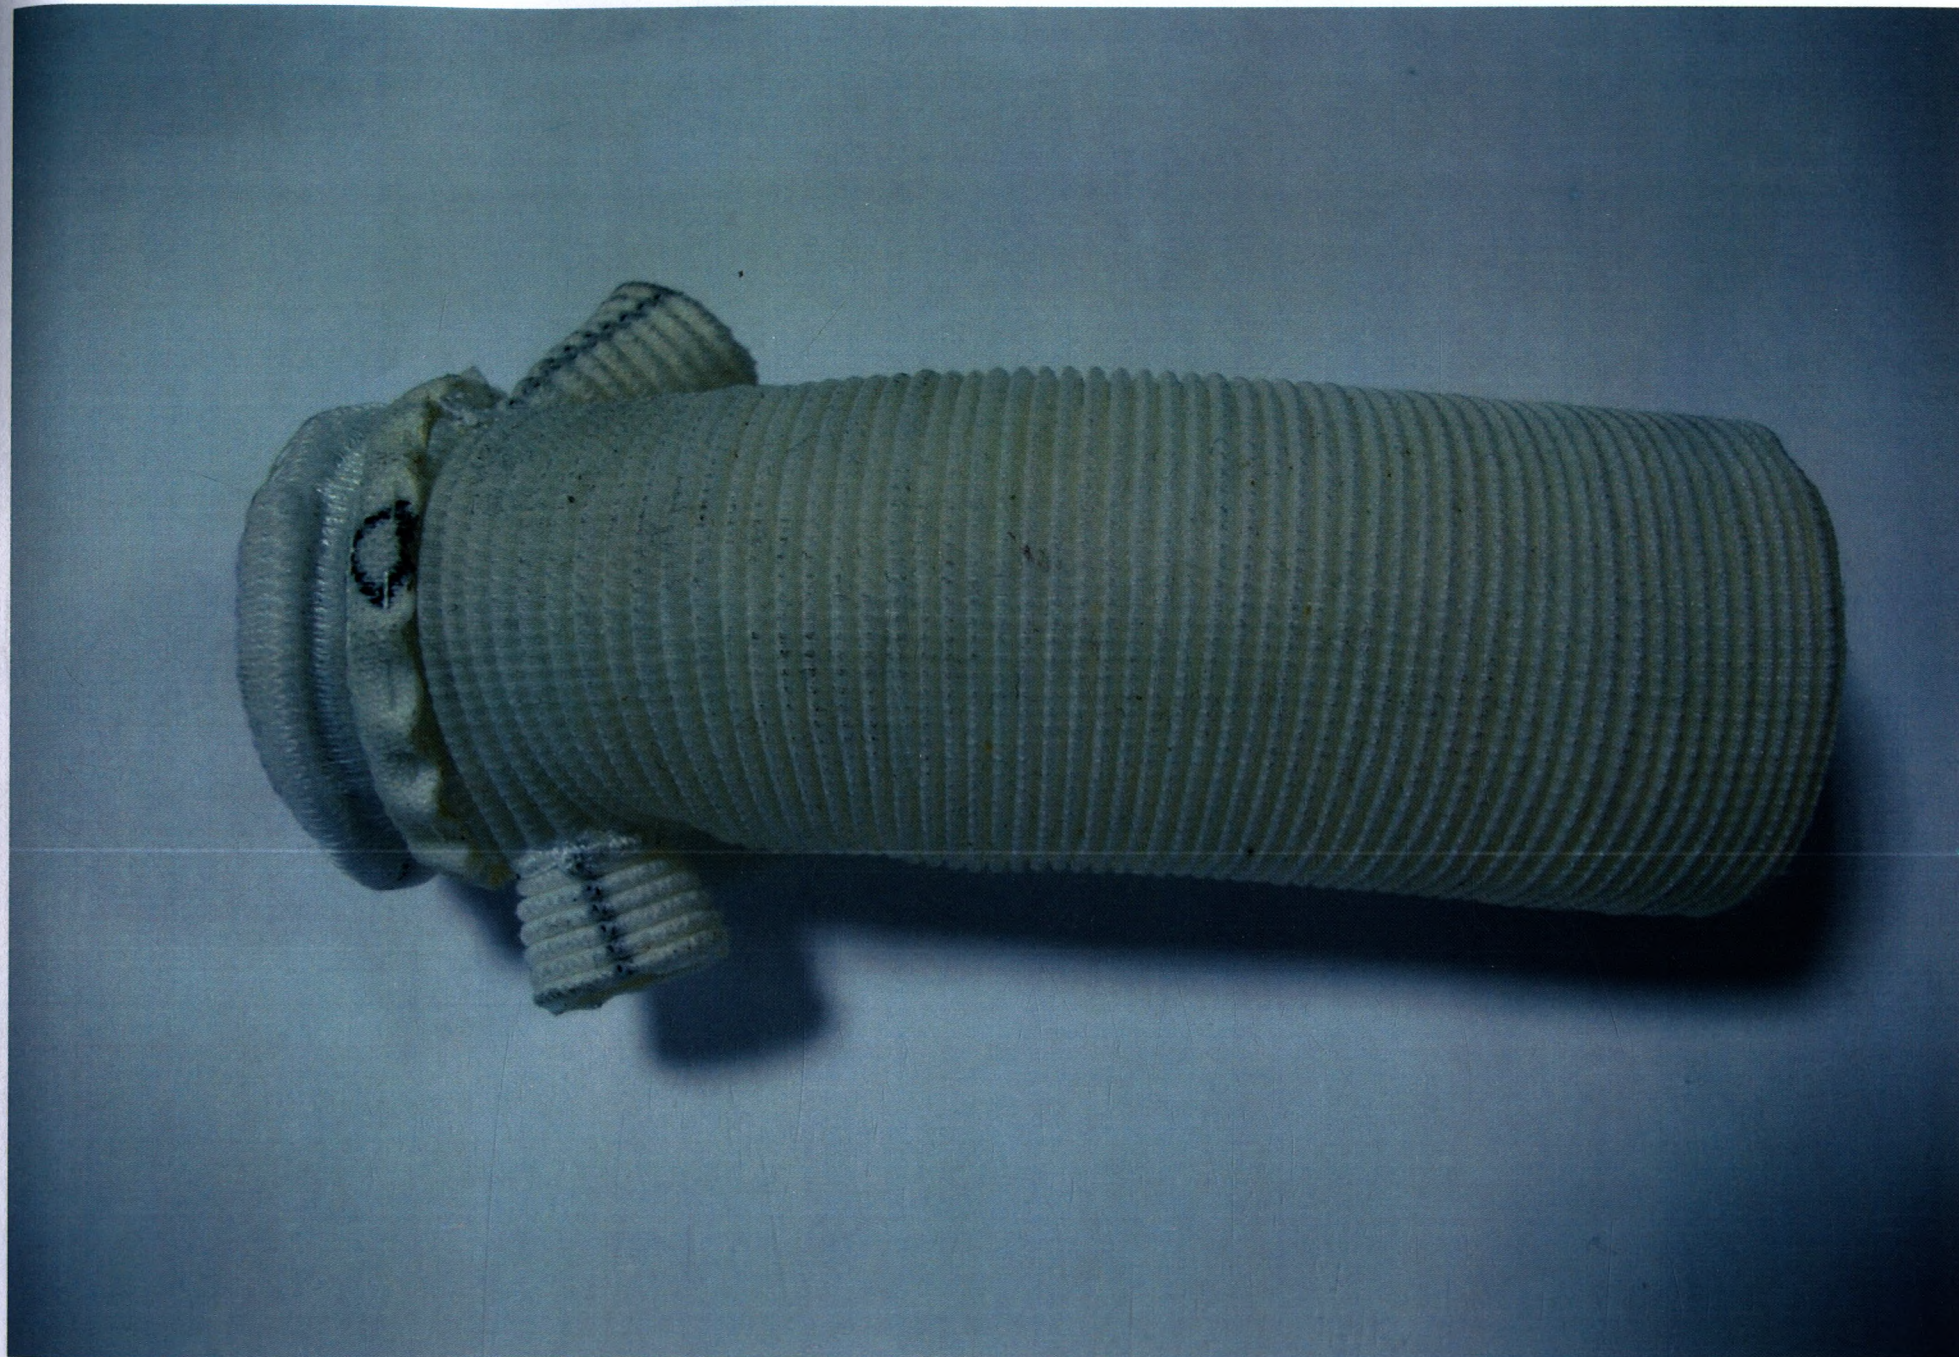


Вариант исполнения медицинского изделия «Протез сосуда «МЕДИНЖ-СО» с протезом клапана сердца по МЛЦК.942241.017 ТУ: Протез аорты с коронарными ответвлениями с фиксированной манжетой (SB.X-XXX.XX-F.X.X)




Вариант исполнения медицинского изделия «Протез сосуда «МЕДИНЖ-СО» с протезом клапана сердца по МЛЦК.942241.017 ТУ: Протез аорты с синусом Вальсальва с фиксированной манжетой (SV.X-XXX.XX-F.X.X)

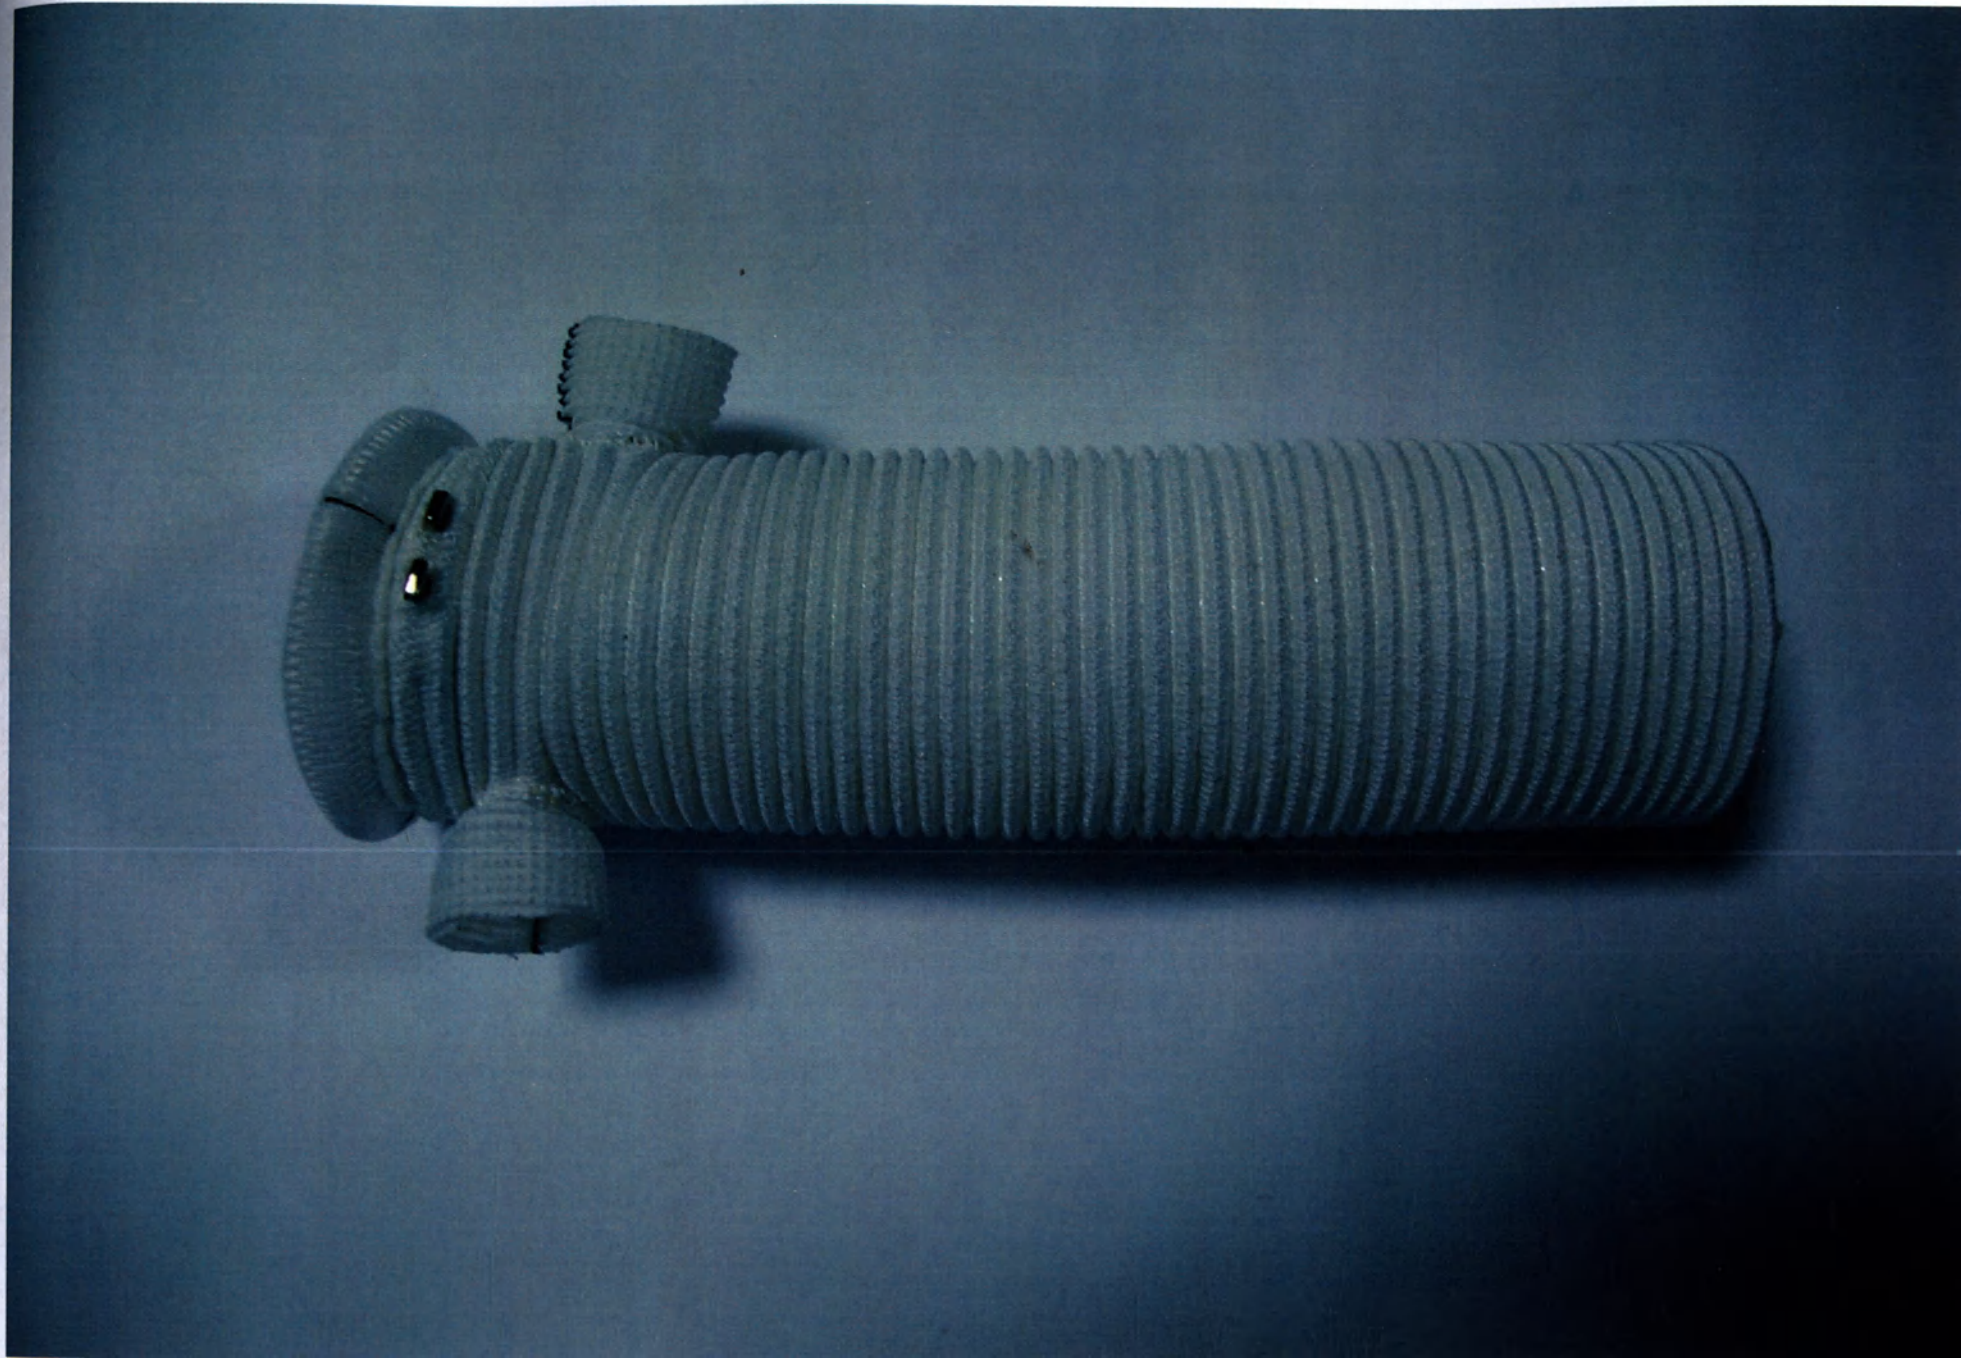


Вариант исполнения медицинского изделия «Протез сосуда «МЕДИНЖ-СО» с протезом клапана сердца по МЛЦК.942241.017 ТУ: Протез аорты с коронарными ответвлениями с присоединяемой манжетой (SB.X-XXX.XX-C.X.X)

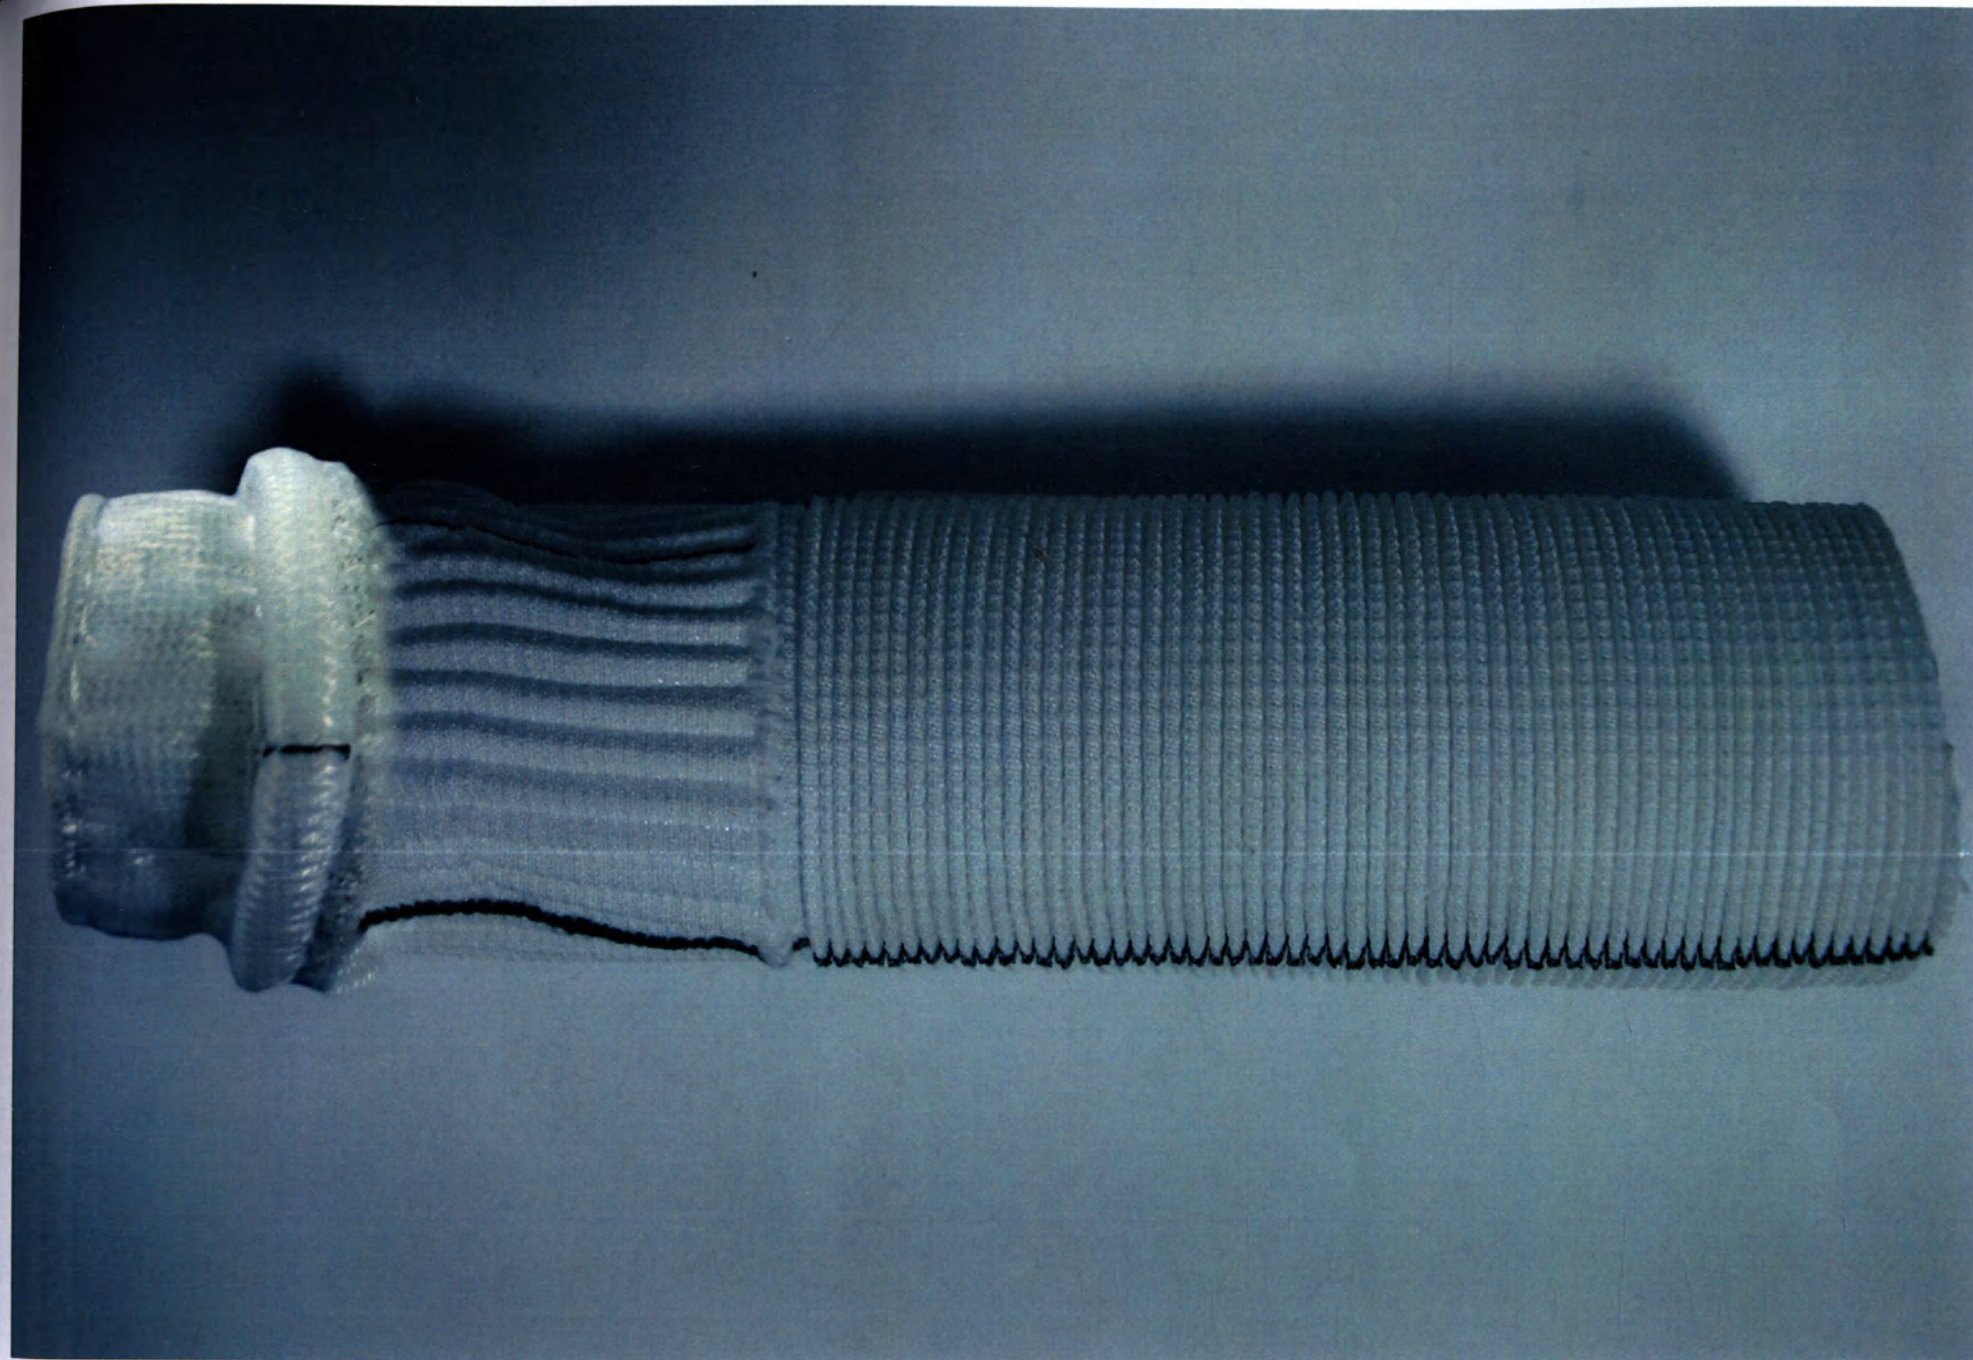

7
Вариант исполнения медицинского изделия «Протез сосуда «МЕДИНЖ-СО» с протезом клапана сердца по МЛЦК.942241.017 ТУ: Протез аорты с синусом Вальсальва с присоединяемой манжетой с бесшовной фиксацией (SV.X-XXX.XX-R.X.X)

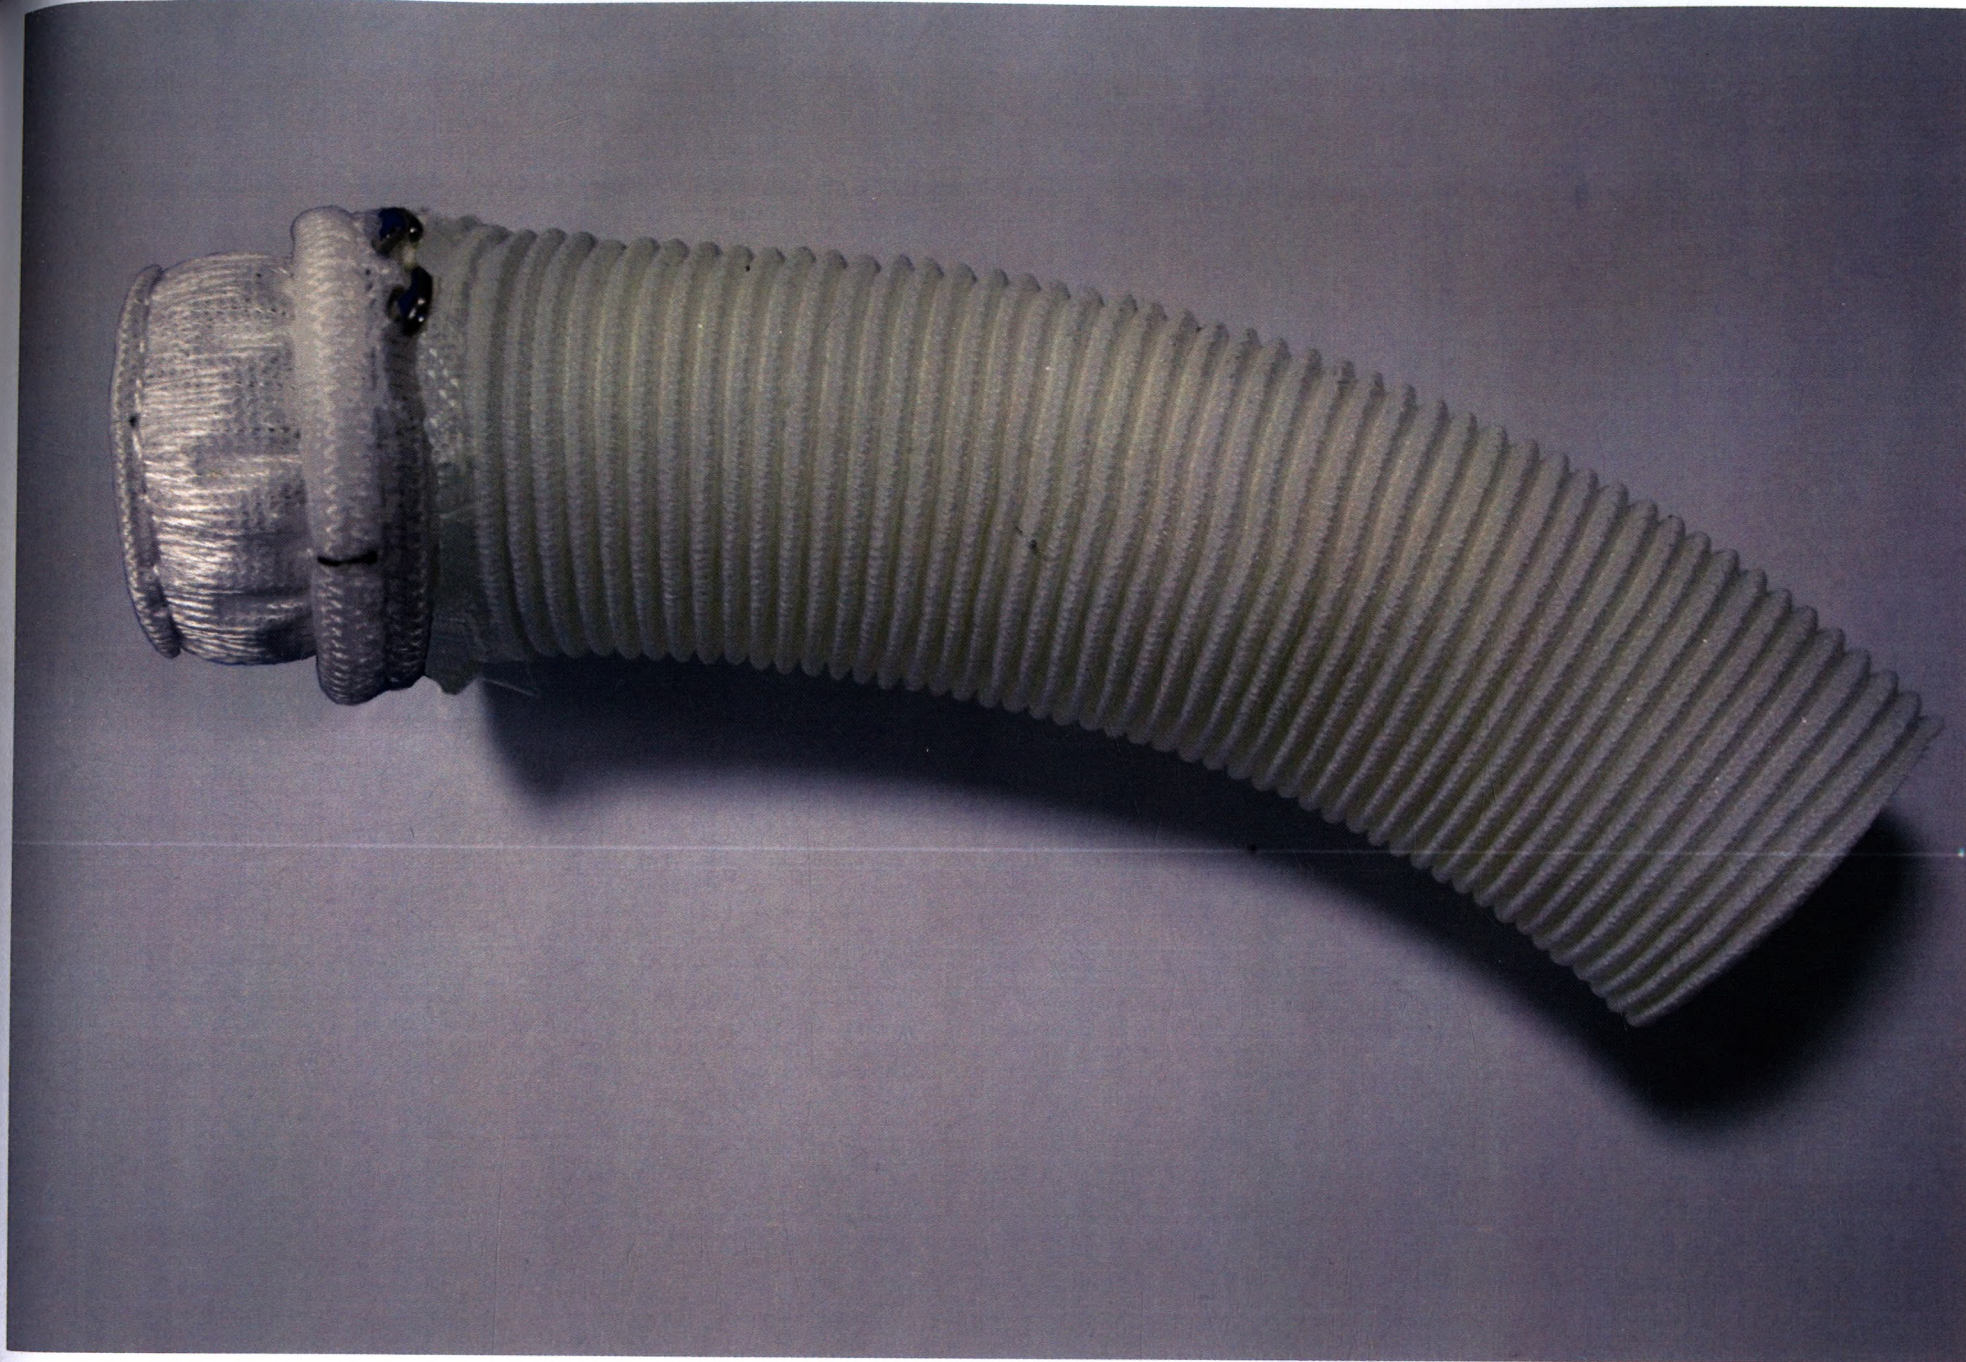

Вариант исполнения медицинского изделия «Протез сосуда «МЕДИНЖ-СО» с протезом клапана сердца по МЛЦК.942241.017 ТУ: Протез аорты с присоединяемой манжетой с бесшовной фиксацией (ST.X-XXX.XX-R.X.X)

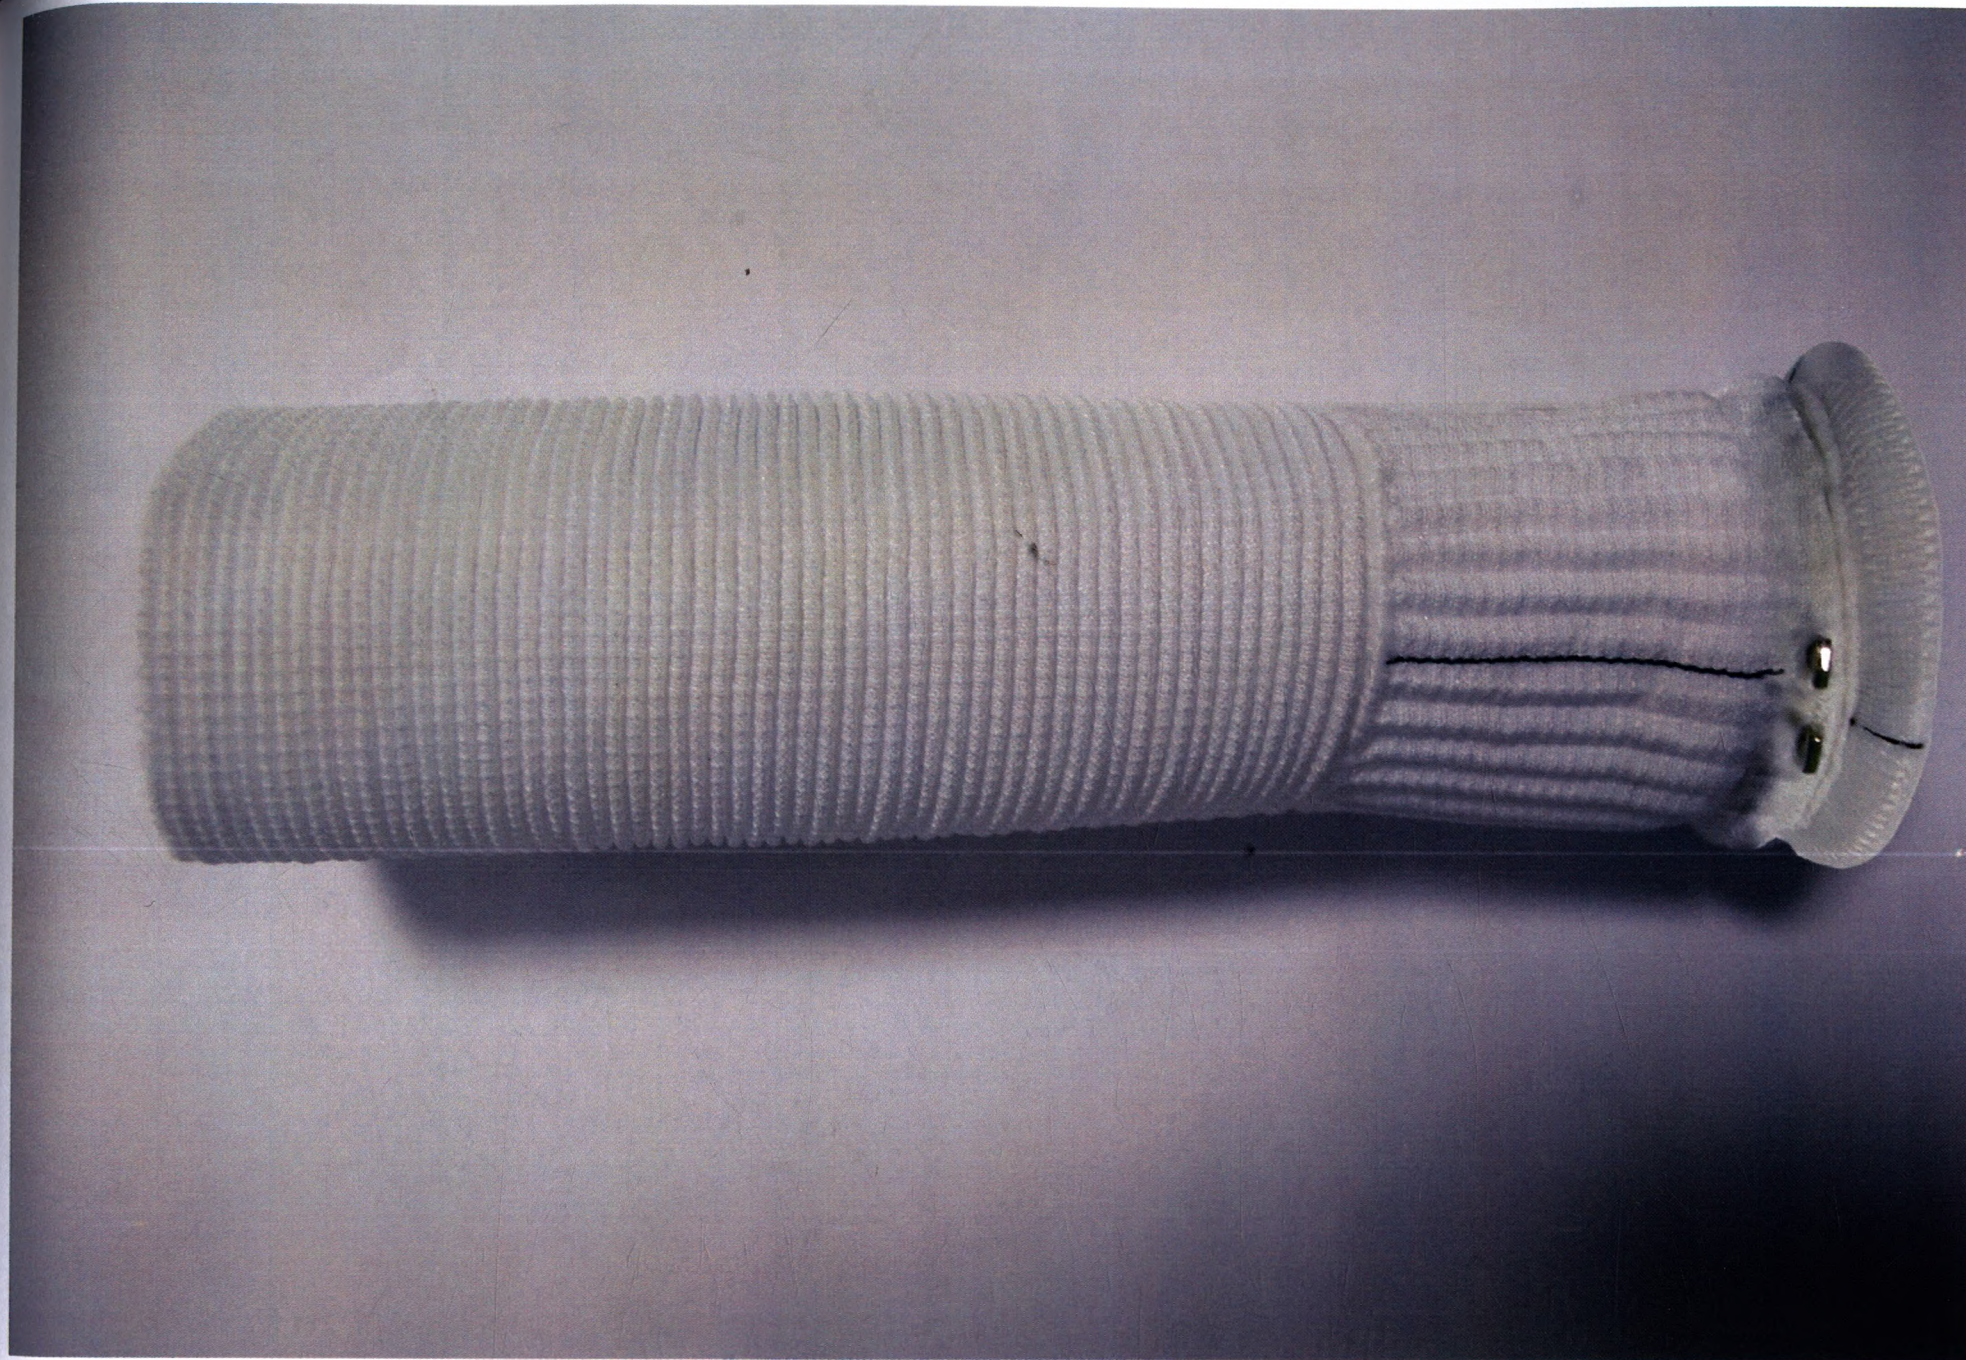

Вариант исполнения медицинского изделия «Протез сосуда «МЕДИНЖ-СО» с протезом клапана сердца по МЛЦК.942241.017 ТУ: Протез аорты с синусом Вальсальва с присоединяемой манжетой (SV.X-XXX.XX-C.X.X)

Протез сосуда "МЕДИНЖ-СО" с протезом клапана сердца

МЛЦК.942511.017ТУ

Рег. уд. №

от

ПРОТЕЗ СОСУДА
гофрированный тканый синтетический


КОРПУС СО СТОРКАМИ
ПОЛНОПРОТОЧНОГО
ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА
МЕДИНЖ-СТ

REF ST.24-STW.21-C.1.1

Диаметр 24 мм
Длина 125 мм min

SN 2229

Size 21



STRAIGHT

ТУ 9444-015-27771122-2012
Рег. уд. № РЗН 2014/1590 от 17.04.2014

Model Code АДМ 21-In-W-C.1.1

Посадочный диаметр 21

SN 6857

ИЗДЕЛИЕ УКОМПЛЕКТОВАНО:

- Картой идентификации пациента;
- Наклейками с данными сосудистого протеза (3 шт.);
- Инструкцией по применению;
- Ручкой-держателем стерильной в упаковке (рег.уд.№РЗН 2014/1590 от 17.04.2014 г.)

Each Vase Once
Sterilized

Single Use

See Instructions
for use

STERILE EO



Стерилизовано
оксиэтиленом

Не стерилизовать
повторно

Запрет на
повторное применение

Апирогенно

Осторожно! Обратитесь
к инструкции по применению

0%

+5°C

+40°C

Store at
Условия хранения



ЗАО НПП "МедИнж" Россия, Пенза, ул. Центральная, д.1, а/я 2913,

тел/факс (8412) 38-09-68, 38-09-59, 93-47-63

E-mail: meng@sura.ru http://www.medeng.ru

Протез сосуда "МЕДИНЖ-СО" с протезом клапана сердца

МЛЦК.942511.017ТУ

Per уд №

от

ПРОТЕЗ СОСУДА

гофрированный тканый синтетический

Диаметр 26 мм

Длина 125 мм min

SB.26-ECV.23-C.1.

2230

Size 23

2018-01 2023-01

Single Use

STERILE BOX

Стерилизовано
оказано этикетки

Не стерилизовать
повторно

Запрет на
повторное применение

Апирогенно

Осторожно! Обращаться
к инструкции по применению

See Instructions
for use

STRAIGHT

КОРПУС СО СТОРКАМИ

ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА
МЕДИНЖ-ЕС

ТУ 9444-011-27771123-2009


Per. уд № ФСР

от 17.03.2010

Model Code АДМ.23.1n

Посадочный диаметр 23

ISN 103922



Store at
Условия хранения

ИЗДЕЛИЕ УКОМПЛЕКТОВАНО:

- Картой идентификации лангета.
- Наклейками с данными сосудистого протеза (3 шт.);
- Инструкцией по применению;
- Ручкой-держателем стерильной в упаковке (per. уд №РЭН 2014/1590 от 17.04.2014 г.)

ЗАО НПП "МедИнж" Россия, Пенза, ул. Центральная, д 1, а/я 2913,

тел/факс (8412) 38-09-68, 38-09-59, 93-47-63
E-mail: meng@sura.ru http://www.medeng.ru

Протез сосуда "МЕДИНЖ-СО" с протезом клапана сердца

МЛЦК.942511.017ТУ

Пер. уд. N°

от

ПРОТЕЗ СОСУДА

гофрированный тканый синтетический

REF SV.28-ECV.25-F.1.1


SN 2233

Size 25

2018-01 2023-01

Диаметр 28 мм

Длина 125 мм min



VALSALVA

КОРПУС СО СТОРКАМИ

ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА

МЕДИНЖ-ЕС

TU 9444-011-27771122-2009

Пер. уд. N° ФСР 2010/06382 от 17.03.2010

Model Code АДМ 25.1n

Посадочный диаметр 25

SN 101637

ИЗДЕЛИЕ УКОМПЛЕКТОВАНО:

- Картой идентификации пациента.
- Наклейками с данными сосудистого протеза (3 шт.);
- Инструкцией по применению.
- Ручкой-держателем стерильной в упаковке (пер.уд.№РЗН 2014/1590 от 17.04.2014 г.)

Etylene Oxide Sterilized

STERILE EO

Стерилизовано окисью этилена

Single Use



Не стерилизовать повторно



Запрет на повторное применение




Аварогенно

See Instructions for use



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению



Store at
Условия хранения



ЗАО НПП "МедИнж" Россия, Пенза, ул. Центральная, д.1, а/я 2913,

тел/факс (8412) 38-09-68, 38-09-59, 93-47-63

E-mail: meng@sura.ru http://www.medeng.ru

Вариант маркировки картонной коробки медицинского изделия «Протез сосуда «МЕДИНЖ-СО» с протезом клапана сердца по МЛЦК.942241.017 ТУ

КОРПУС СО СТВОРКАМИ
ПОЛНОПРОТОЧНОГО ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА
МЕДИНЖ-СТ
ТУ 9444-015-27771122-2012 Рег. уд. № РЗН 2014/1590 от 17.04.2014
для протеза сосуда МЕДИНЖ-СО
МЛЦК.942511.017ТУ Рег. уд. № от

Открывать
здесь

A O R T I C

Model Code АДМ.27-In-V-C.1.1

Tissue Annulus/посадочный диаметр/
Anneau tissulaire/ Anillo de tejido/ Gewebering

27

SN

6972

2018-01



2023-01

Non-pyrogenic


Do not use if package
is damaged!

Do not reuse

See instruction for use

Storage conditions

STERILE EO



Стерилизовано
окисью этилена

Апирогенно

Не использовать
при поврежденной
упаковке

Повторно
не использовать
и не стерилизовать

Осторожно! Обратитесь
к сопроводительной
документации

Условия хранения



МедИнж

Россия, г. Пенза, 440004, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913
тел/факс (8412) 38-09-68, 38-09-59, 93-47-63
E-mail: meng@sura.ru; http: //www.medeng.ru

КОРПУС СО СТВОРКАМИ
ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА
МЕДИНЖ-ЕС

ТУ 9444-011-27771122-2009 Рег. уд. № ФСР 2010/06882 от 17.03.2010

для протеза сосуда МЕДИНЖ-СО

МЛЦК.942511.017ТУ Рег. уд. № от

Открывать
здесь

А О Р Т И С

Model Code АДМ23.In

Tissue Annulus/посадочный диаметр/
Anneau tissulaire/ Anillo de tejido/ Gewebering 23

SN

103922

2018-01



2023-01

Non-pyrogenic


Do not use if package
is damaged!

Do not reuse

See instruction for use

Storage conditions

STERILE EO



Стерилизовано
окисью этилена

Апирогенно

Не использовать
при поврежденной
упаковке

Повторно
не использовать
и не стерилизовать

Осторожно! Обратитесь
к сопроводительной
документации

Условия хранения



МедИнж

Россия, г. Пенза, 440004, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913
тел/факс (8412) 38-09-68, 38-09-59, 93-47-63
E-mail: meng@sura.ru; http: //www.medeng.ru

КОРПУС С ЗАПИРАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА БИОЛОГИЧЕСКОГО
МЕДИНЖ-БИО

ТУ 9444-018-27771122-2014 Рег. уд. № РЗН 2015/3303 от 12.11.2015

для протеза сосуда МЕДИНЖ-СО

МЛЦК.942511.017ТУ Рег. уд. № от

Открывать
здесь

А О Р Т И С

Model АЛБ

Tissue Annulus/посадочный диаметр/
Anneau tissulaire/ Anillo de tejido/ Gewebering 25

[SN] 0379-18

2018-01



2019-01

Non-pyrogenic


Do not use if package
is damaged!

Do not reuse

See instruction for use

Storage conditions

STERILE EO



Стерилизовано
окисью этилена

Апирогенно

Не использовать
при поврежденной
упаковке

Повторно
не использовать
и не стерилизовать

Осторожно! Обратитесь
к сопроводительной
документации

Условия хранения



МедИнж

Россия, г. Пенза, 440004, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913

тел/факс (8412) 38-09-68, 38-09-59, 93-47-63

E-mail: meng@sura.ru; http: //www.medeng.ru



Внешний вид корпуса протеза клапана сердца «МЕДИНЖ-БИО»



Внешний вид корпуса протеза клапана сердца «МЕДИНЖ-СТ» двухстворчатого





Внешний вид корпуса протеза клапана сердца «МЕДИНЖ-ЕС»

протипуковано и

скреплено печатью

23 листа

И. В. Кудрявцев

