

Заместитель директора
Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский
институт эпидемиологии»
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (ФБУН
ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора)





В.Г. Акимкин
2017 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для диагностики in vitro АмплиСенс® ДНК-чип ООИ-1


Фотография общего вида набора реагентов АмплиСенс® ДНК-чип ООИ-1
формы комплектации 1, до вскрытия упаковки.

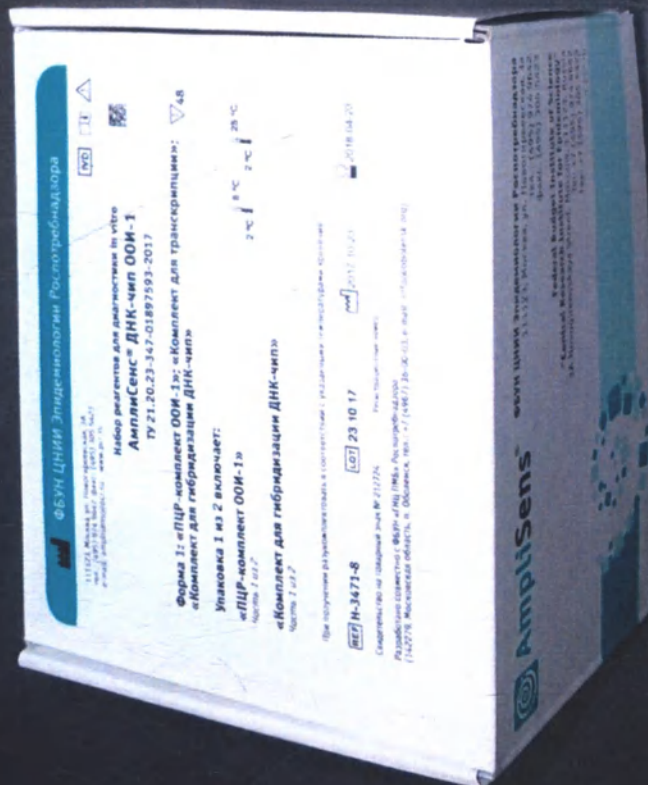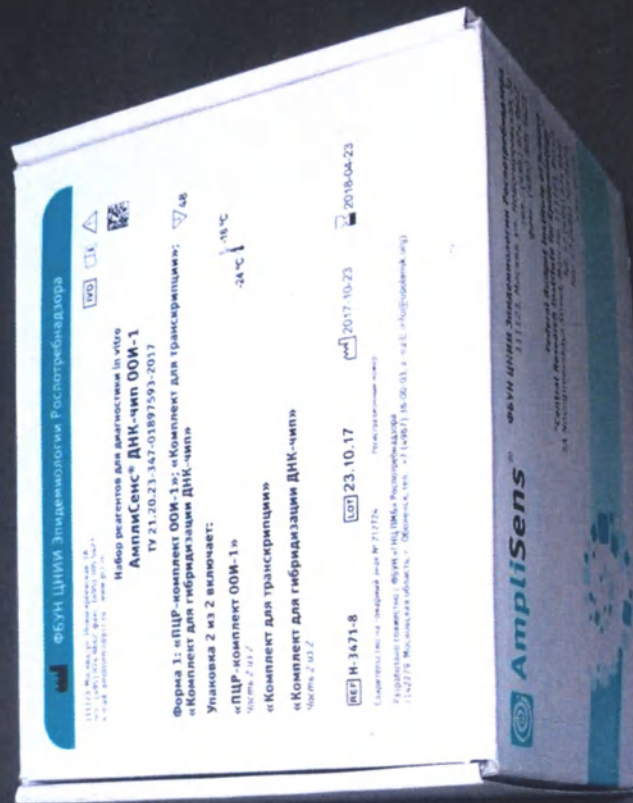


**Фотография набора реагентов АмплиСенс® ДНК-чип ООИ-1
формы комплектации 1 (Упаковка 1 из 2), после вскрытия упаковки.**



Фотография реагентов, входящих в набор АмплиСенс® ДНК-чип ООИ-1 формы комплекта 1 (Упаковка 1 из 2), после вскрытия упаковки.

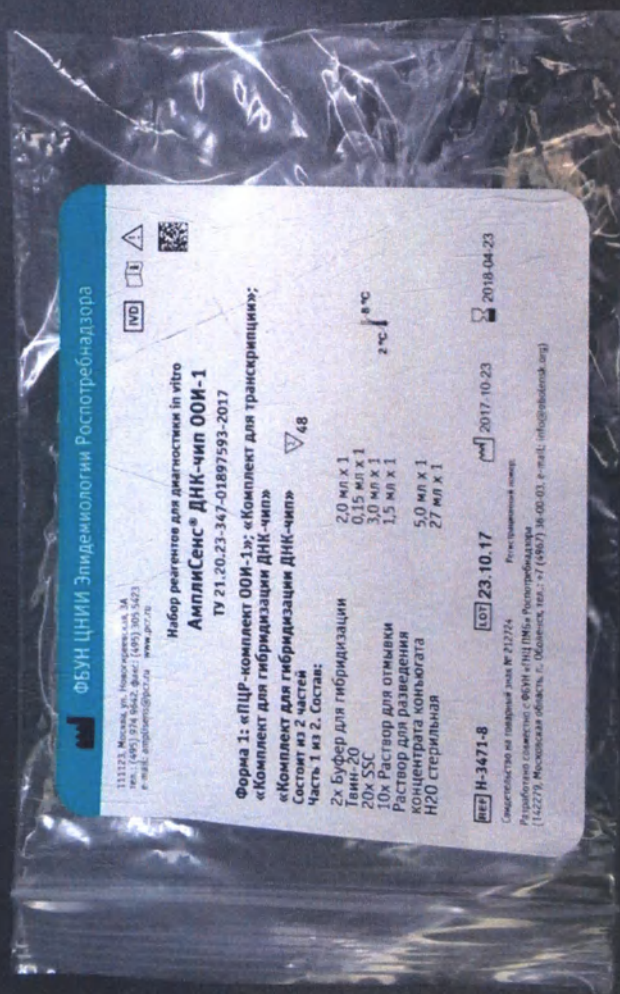


Фотография реагентов, входящих в набор АмплиСенс® ДНК-чип ООИ-1 формы комплекта 1 (Упаковка 1 из 2), после вскрытия упаковки.

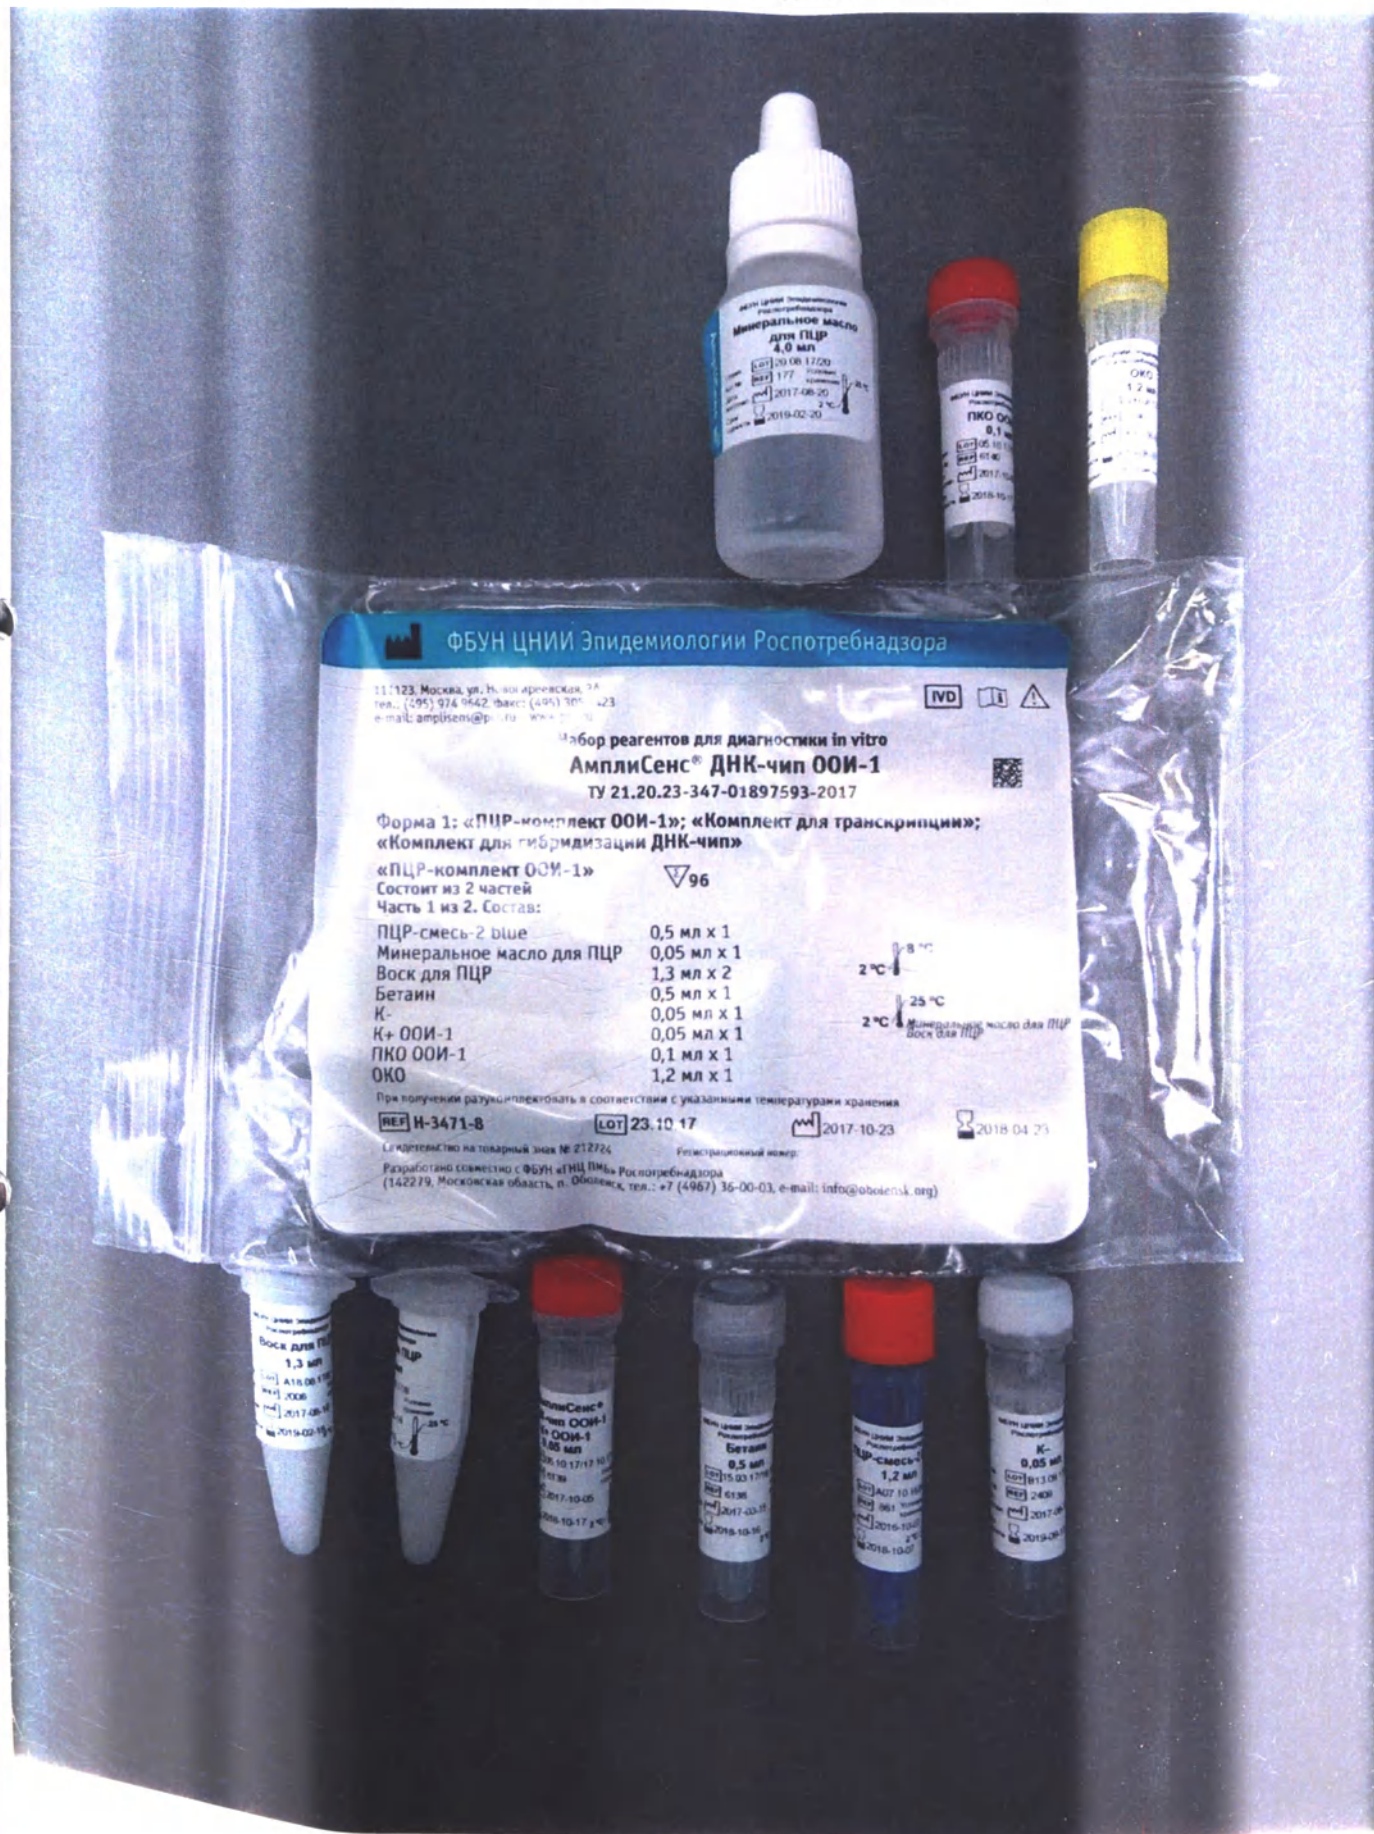


**Фотография набора реагентов АмплиСенс® ДНК-чип ООИ-1
формы комплектации 1 (Упаковка 2 из 2), после вскрытия упаковки.**



Фотография реагента, входящего в набор АмплиСенс® ДНК-чип ООИ-1 формы комплектации 1 (Упаковка 2 из 2), после вскрытия упаковки.

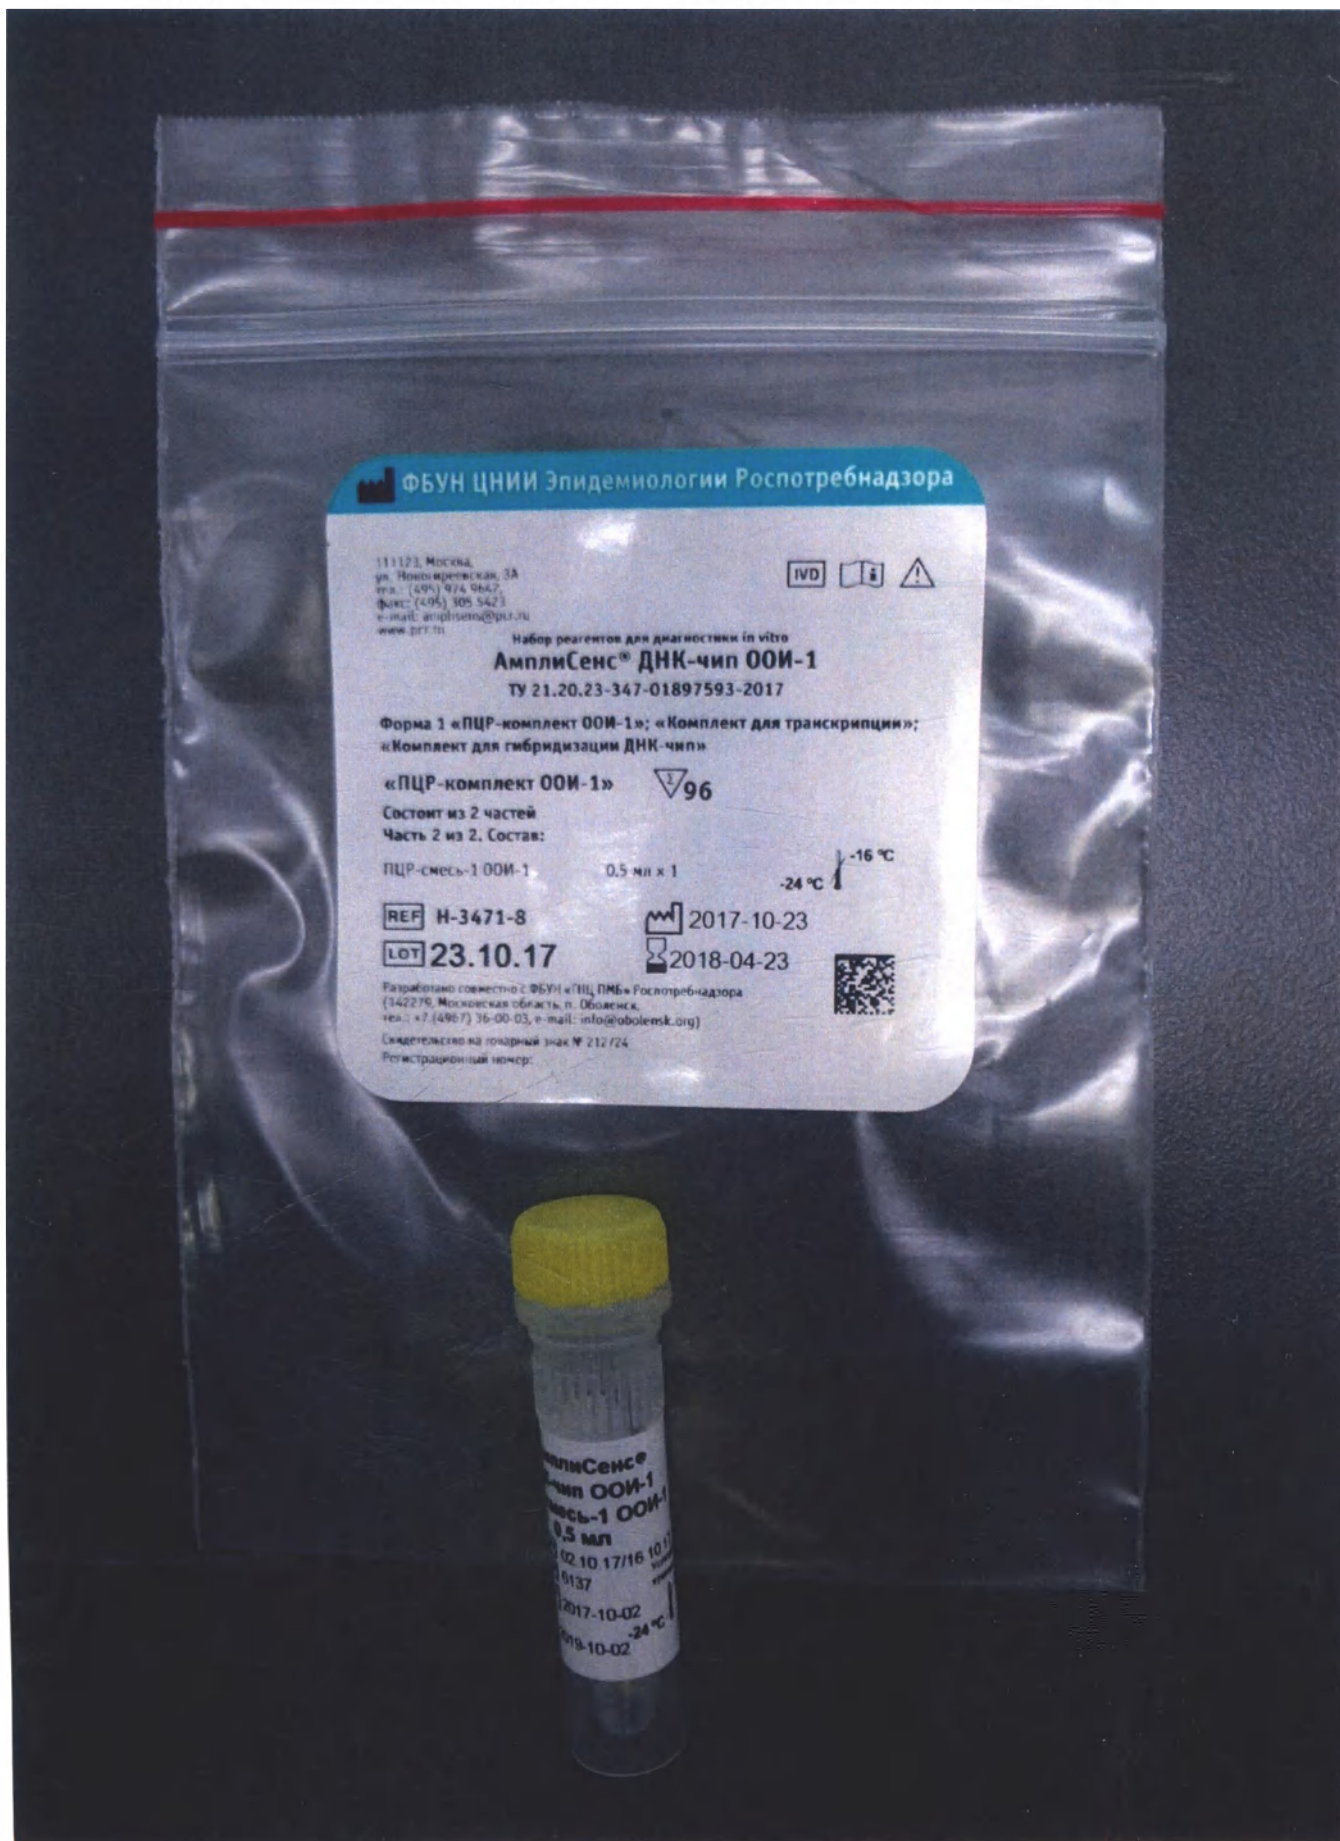

Фотография реагентов, входящих в набор АмплиСенс® ДНК-чип ООИ-1 формы комплектации 1 (Упаковка 2 из 2), после вскрытия упаковки.

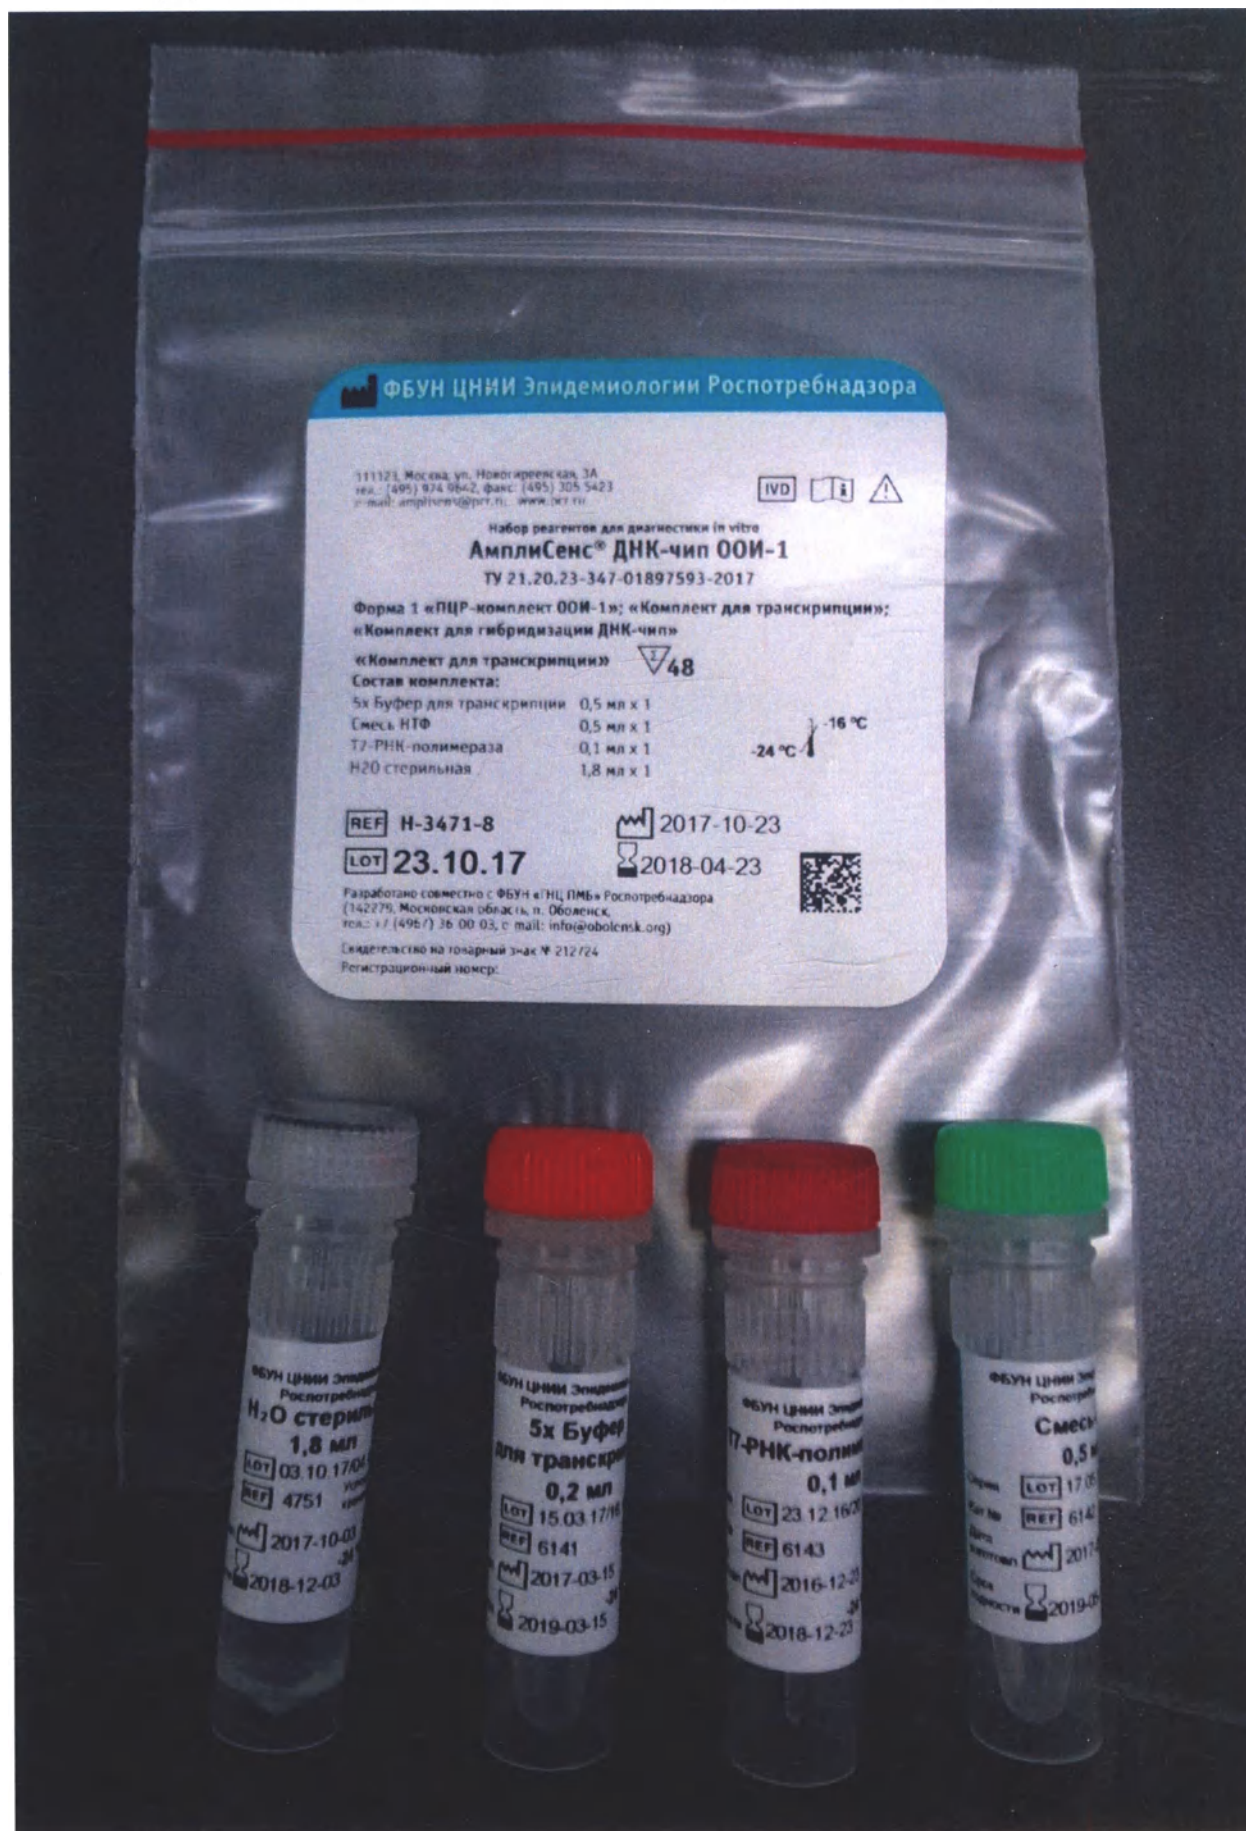


Фотография реагента и слайдов ДНК-чип ООИ-1, входящих в набор АмплиСенс® ДНК-чип ООИ-1 формы комплекта 1 (Упаковка 2 из 2), после вскрытия упаковки.



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

119123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.pcr.ru



Набор реагентов для диагностики in vitro
АмплиСенс® ДНК-чип ООИ-1
ТУ 21.20.23-347-01897593-2017




Форма 1: «ПЦР-комплект ООИ-1»; «Комплект для транскрипции»;
«Комплект для гибридизации ДНК-чип»

«Комплект для гибридизации ДНК-чип»
Состоит из 2 частей
Часть 2 из 2. Состав:



Концентрат конъюгата 0,05 мл x 1
ДНК-чип ООИ-1 -- x 4 слайда

-24 °C -16 °C



REF H-3471-8

LOT 23.10.17

2017-10-23


2018-04-23

Свидетельство на товарный знак № 712724

Регистрационный номер:

Разработано совместно с ФБУН «ГНЦ ИМБ» Роспотребнадзора

12279, Московская область, п. Оболенск, тел.: +7 (4967) 36-00-03, e-mail: info@obolensk.org



АмплиСенс® ДНК-чип ООИ-1
ДНК-чип ООИ-1
4 слайда

Серия: LOT 10.10.17
Кат. №: 6144
Дата изготовления: 2017-10-10
Срок годности: 2019-10-10


Условия хранения: -24 °C -16 °C

Фотография слайдов ДНК-чип ООИ-1, входящих в набор АмплиСенс® ДНК-чип ООИ-1 формы комплектации 1 (Упаковка 2 из 2), после вскрытия упаковки.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью _____ 10 _____ лист _____

Зам. директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора


В.Г. Алимкин

