

Заместитель директора
Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский
институт эпидемиологии»
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (ФБУН
ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора)



В.Е. Акимкин
« 20 » 2017 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для диагностики in vitro АмплиСенс® ИммуноЧип ООИ-1



**Фотография общего вида набора реагентов АмплиСенс® ИммуноЧип ООИ-1
формы комплектации 1, до вскрытия упаковки.**

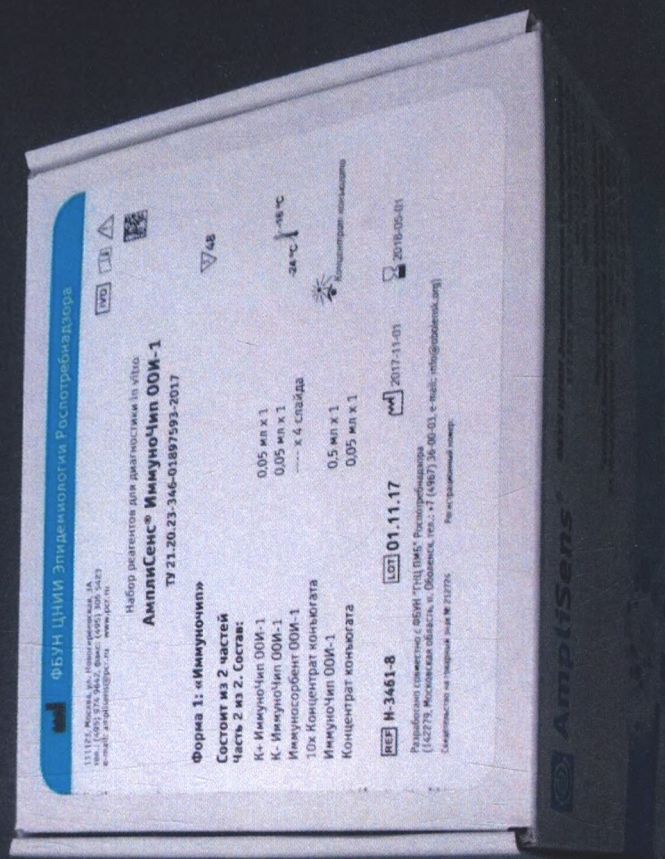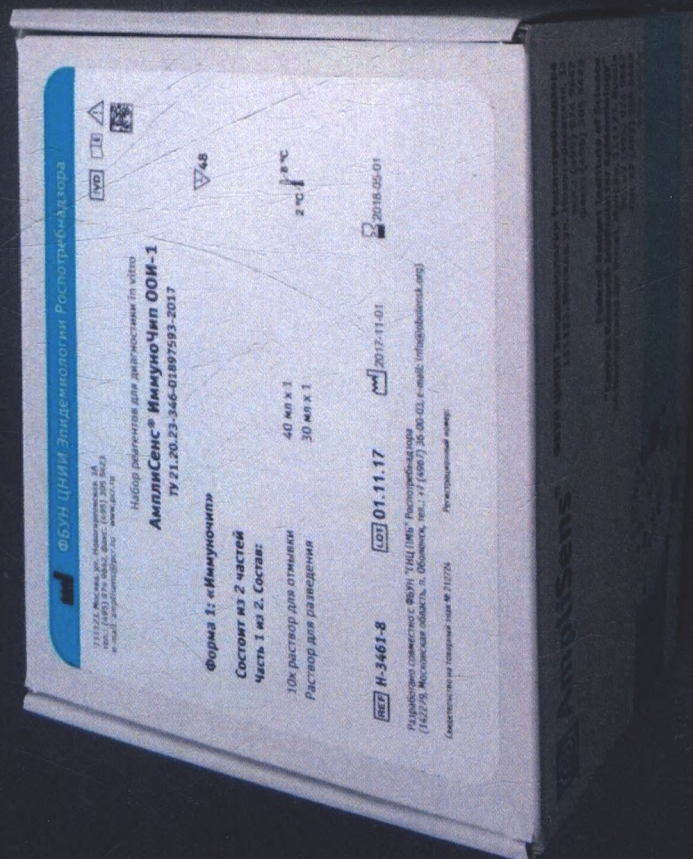


Фотография реагентов, входящих в набор АмплиСенс® ИммуноЧип ООИ-1 формы комплектации 1 (Часть 1 из 2), после вскрытия упаковки.




**Фотография набора реагентов АмплиСенс® ИммуноЧип ООИ-1
формы комплектации 1 (Часть 2 из 2), после вскрытия упаковки.**

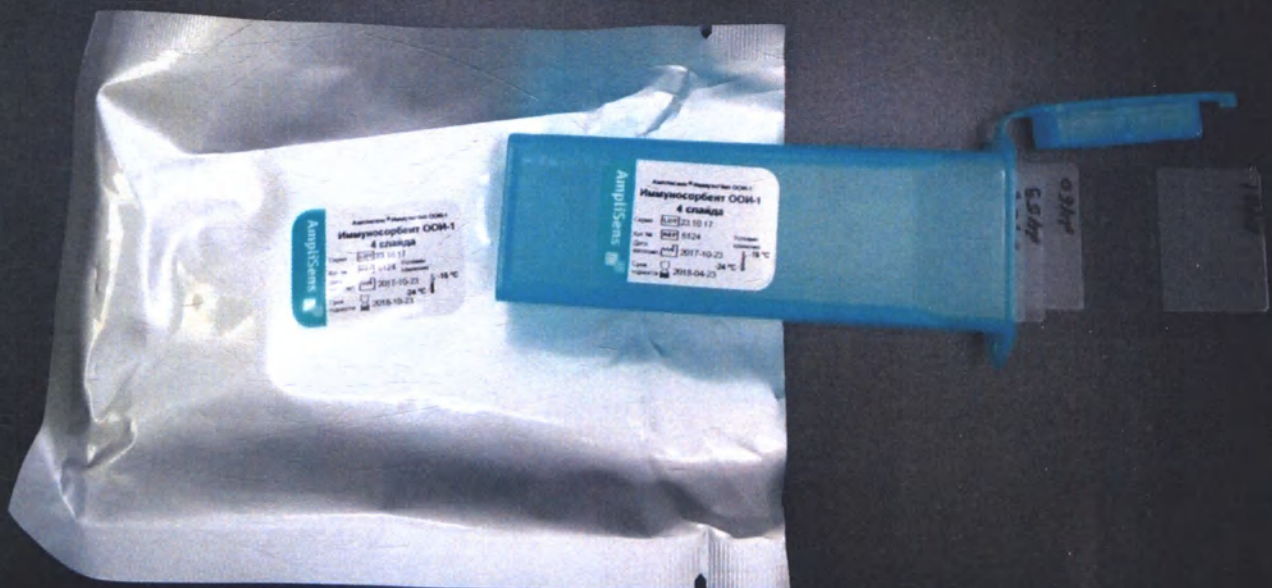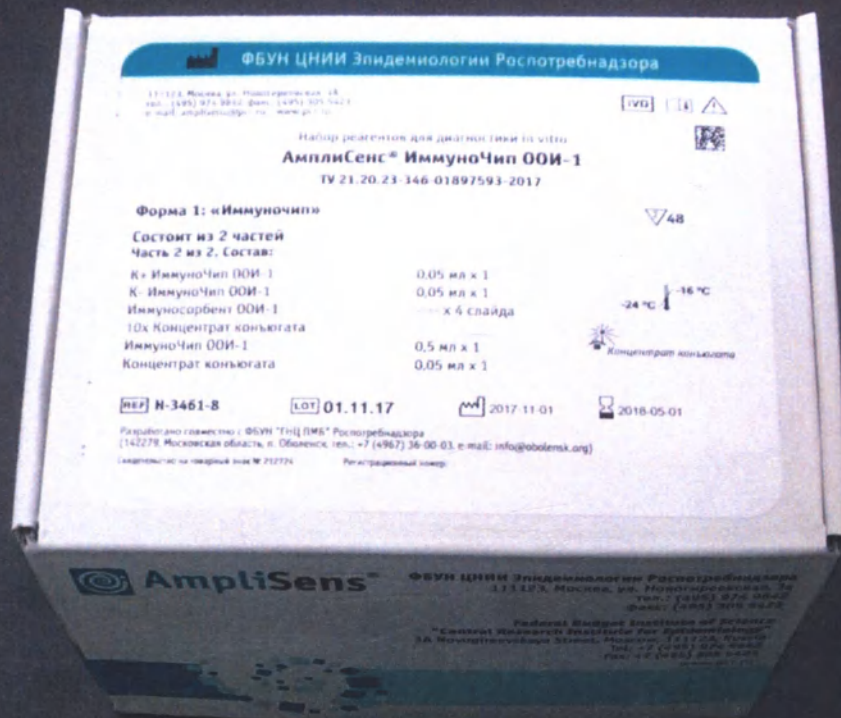

Фотография реагентов и слайдов Иммуносorbента ООИ-1, входящих в набор АмплиСенс® ИммуноЧип ООИ-1 формы комплектации 1 (Часть 2 из 2), после вскрытия упаковки.

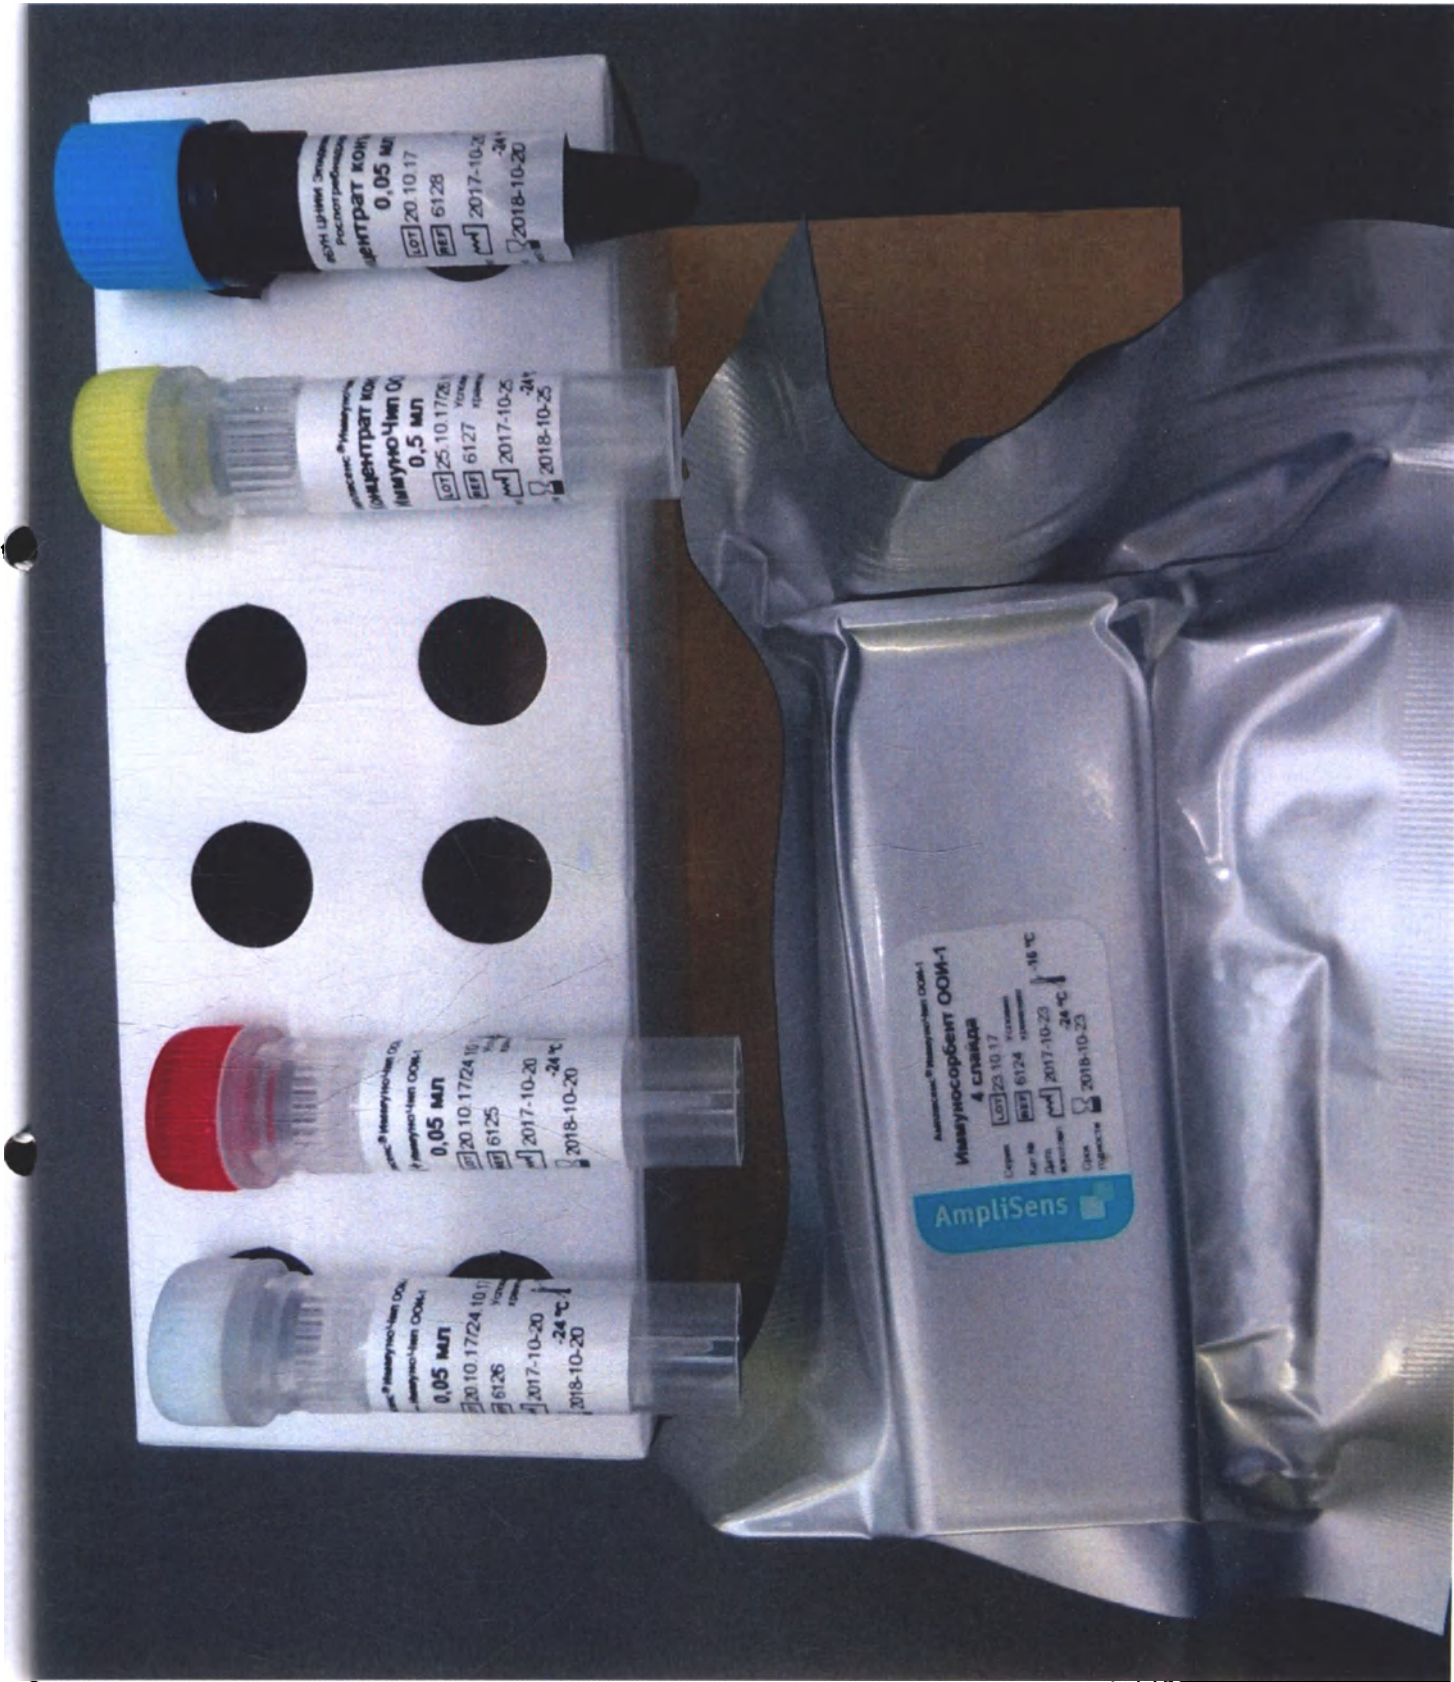

Фотография слайдов Иммуносорбента ООИ-1, входящих в набор АмплиСенс® ИммуноЧип ООИ-1 формы комплектации 1 (Часть 2 из 2), после вскрытия упаковки.

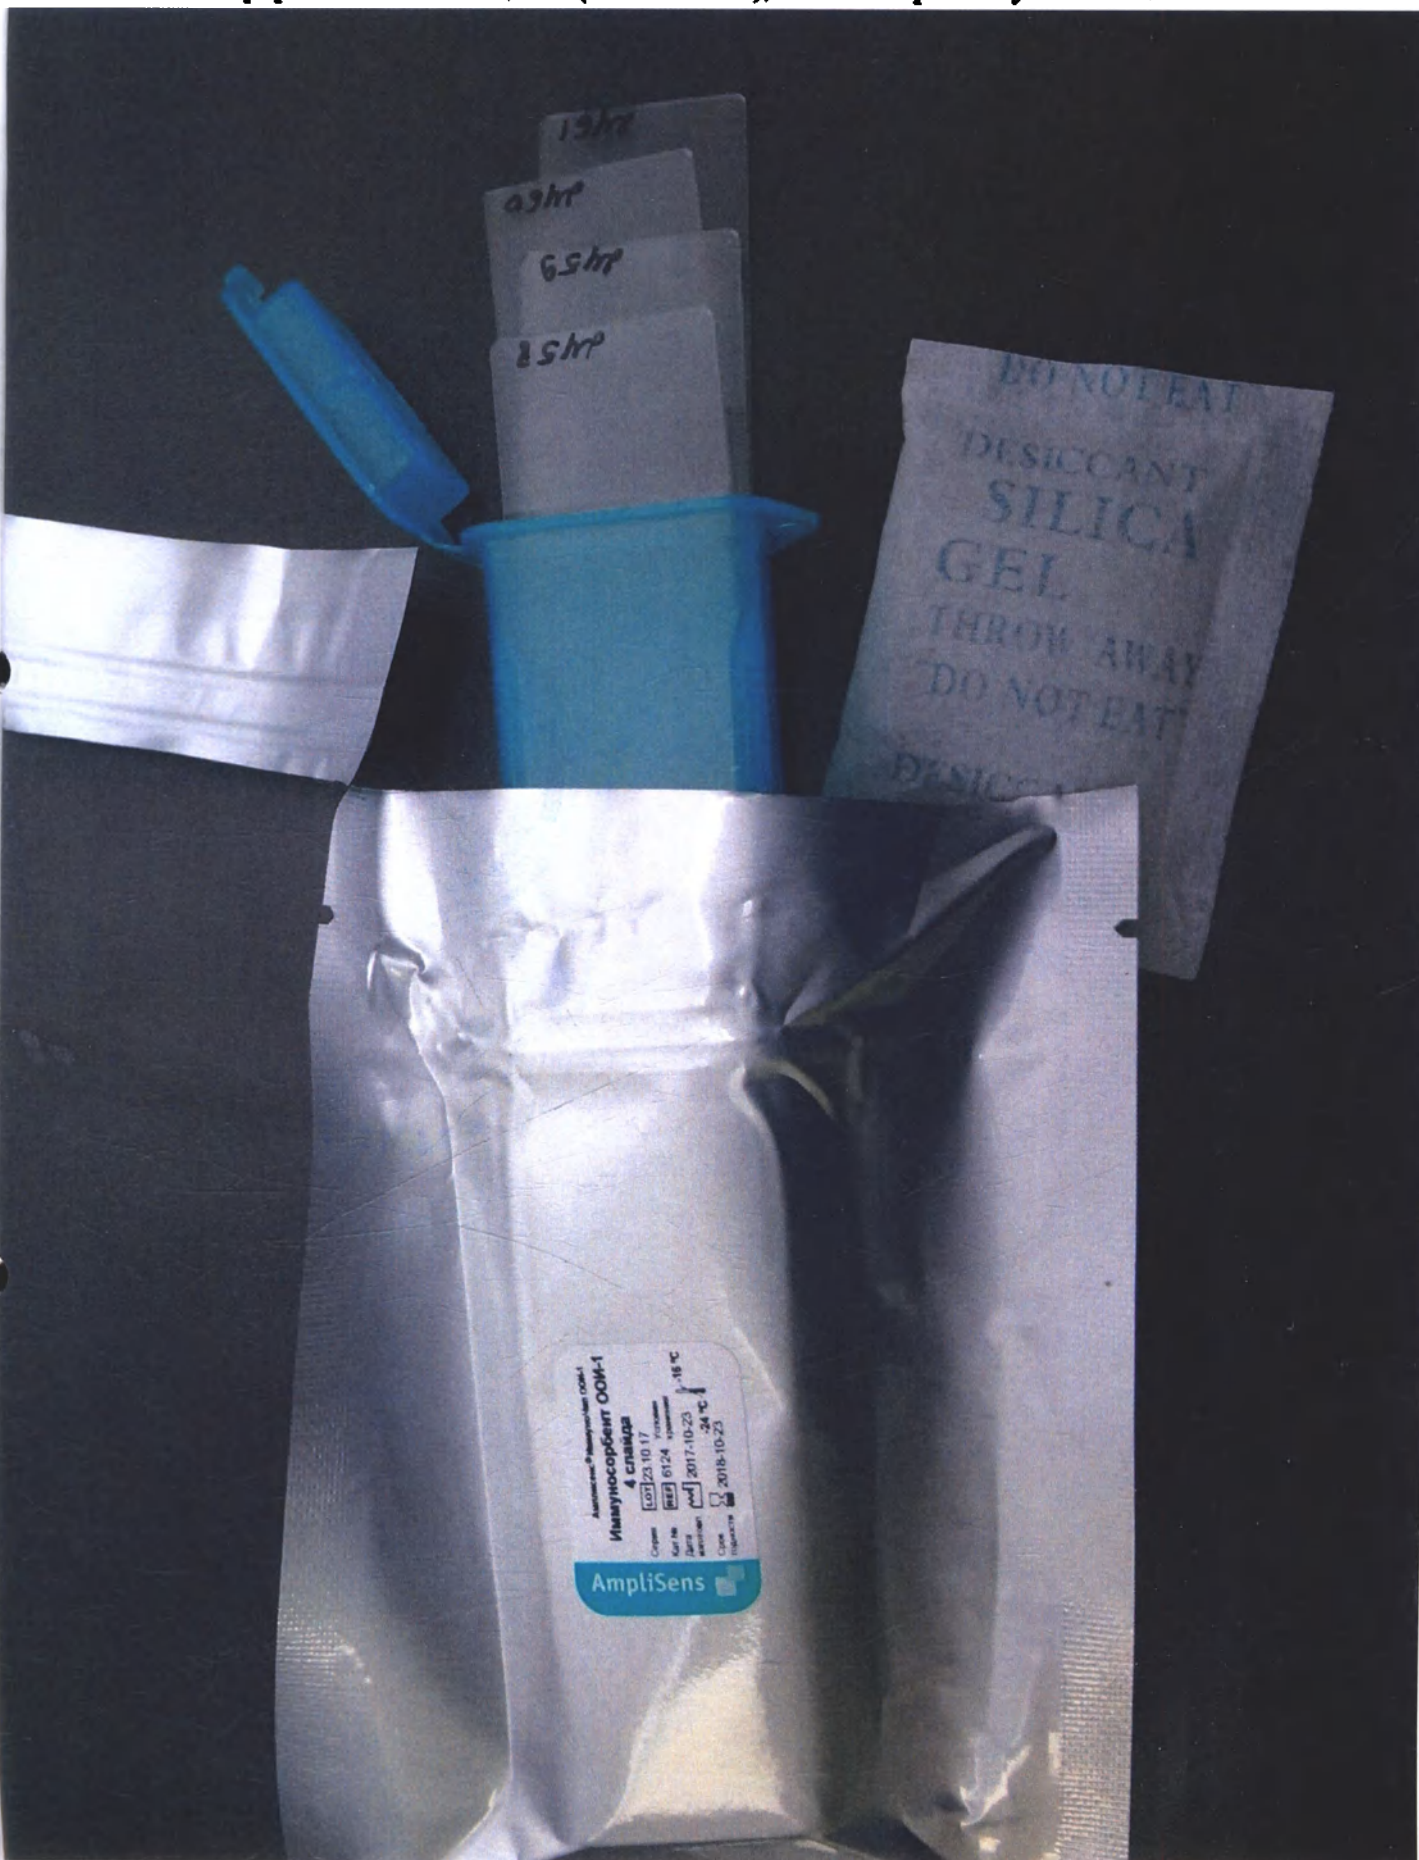

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 7 лист 08

Зам. директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора



В.Г. Акимкин