

PHILIPS

Руководитель

Отдела по управлению качеством ООО «ФИЛИПС»


Бахвалова О.В.

«27» апреля 2018 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Система компьютерной томографии Access CT с принадлежностями.

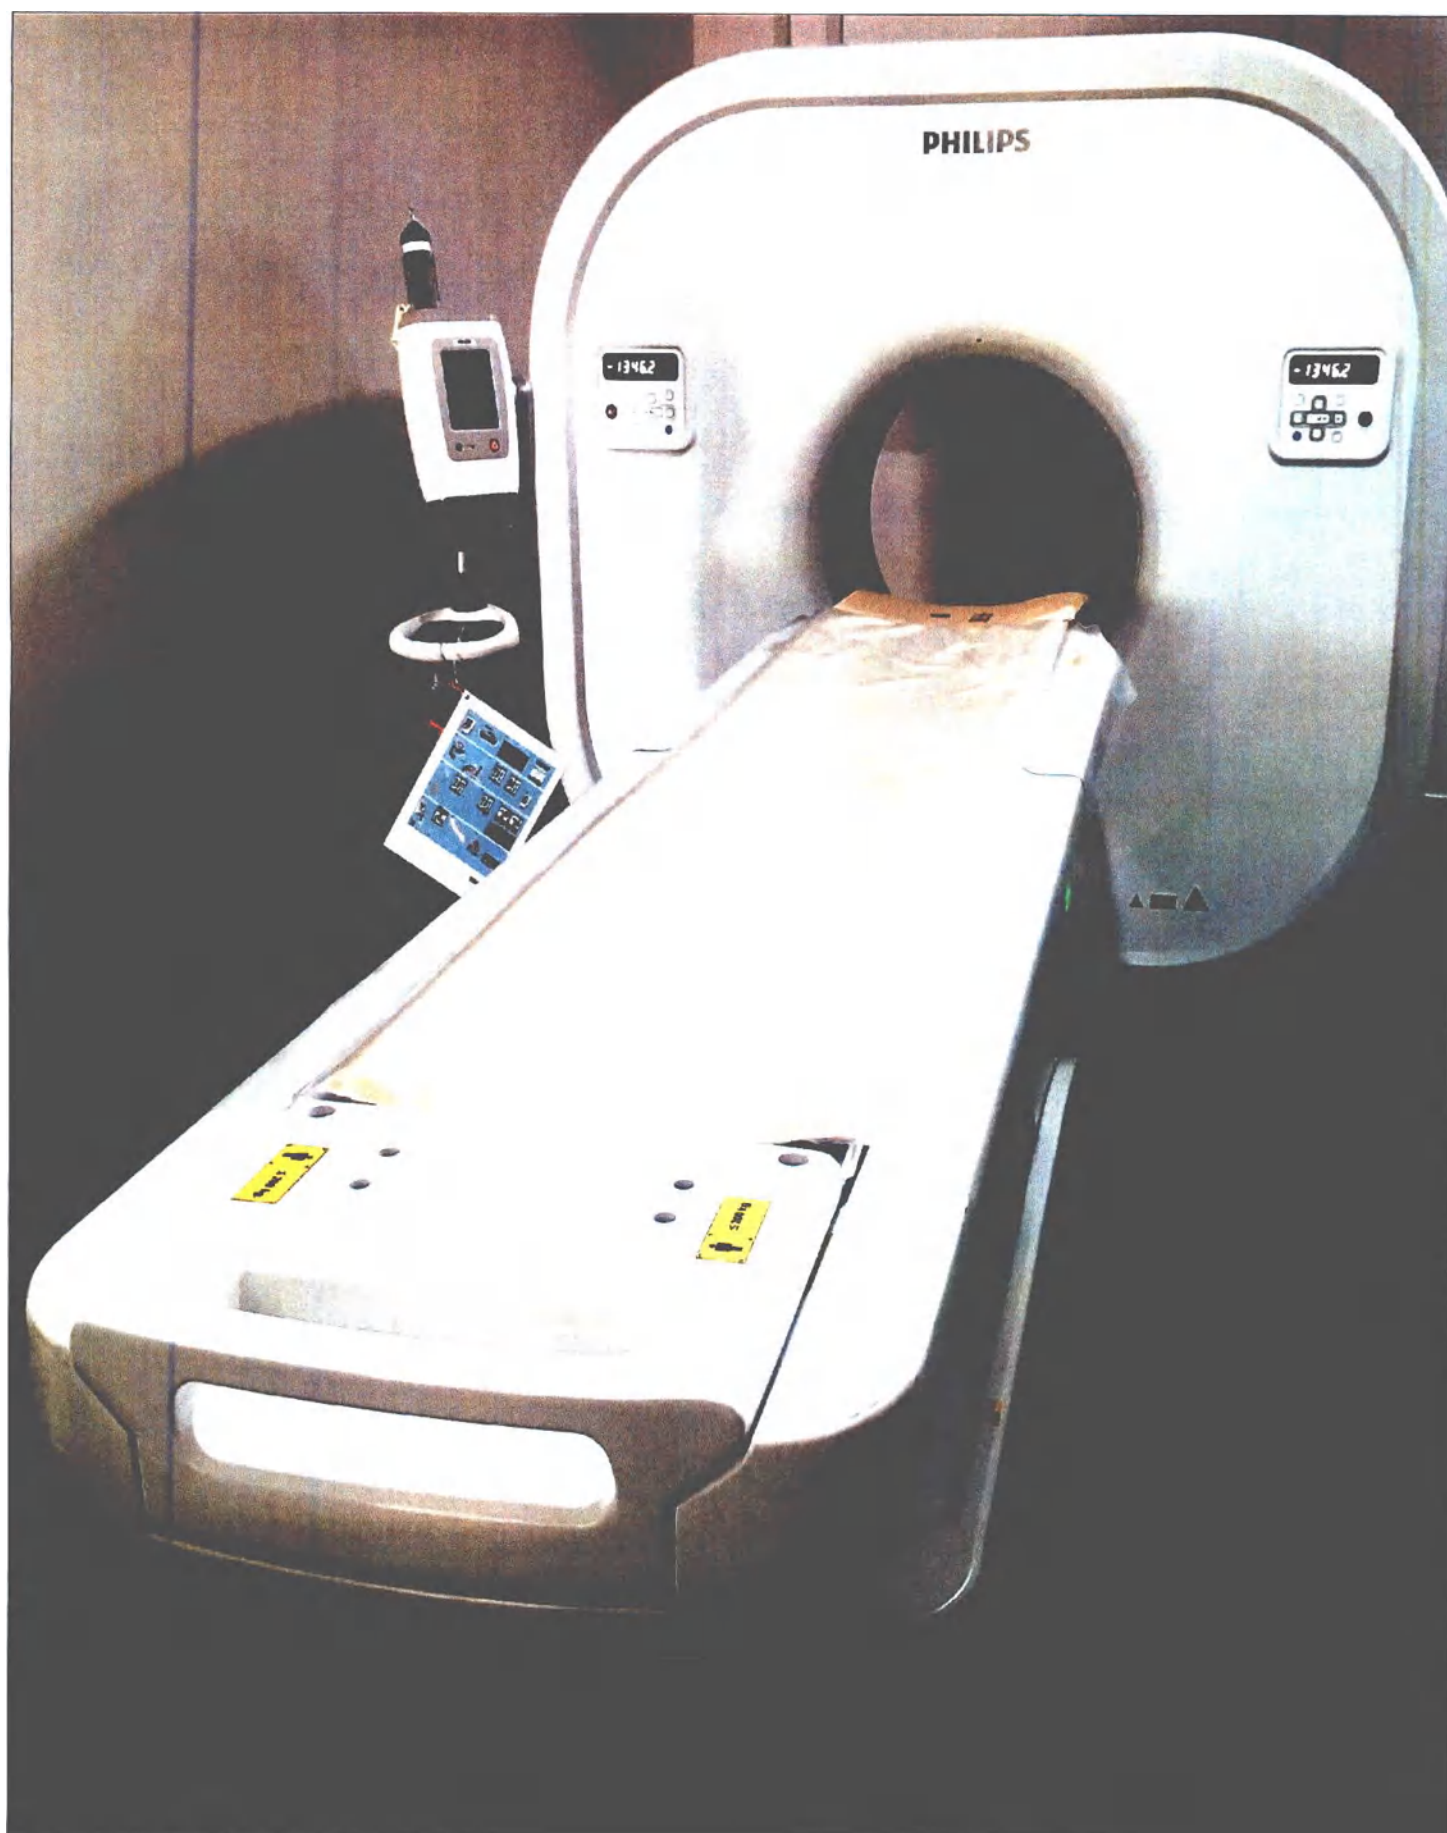


Общий вид медицинского изделия (Ракурс 1).




Общий вид медицинского изделия (Ракурс 2).




Общий вид медицинского изделия (Ракурс 3).

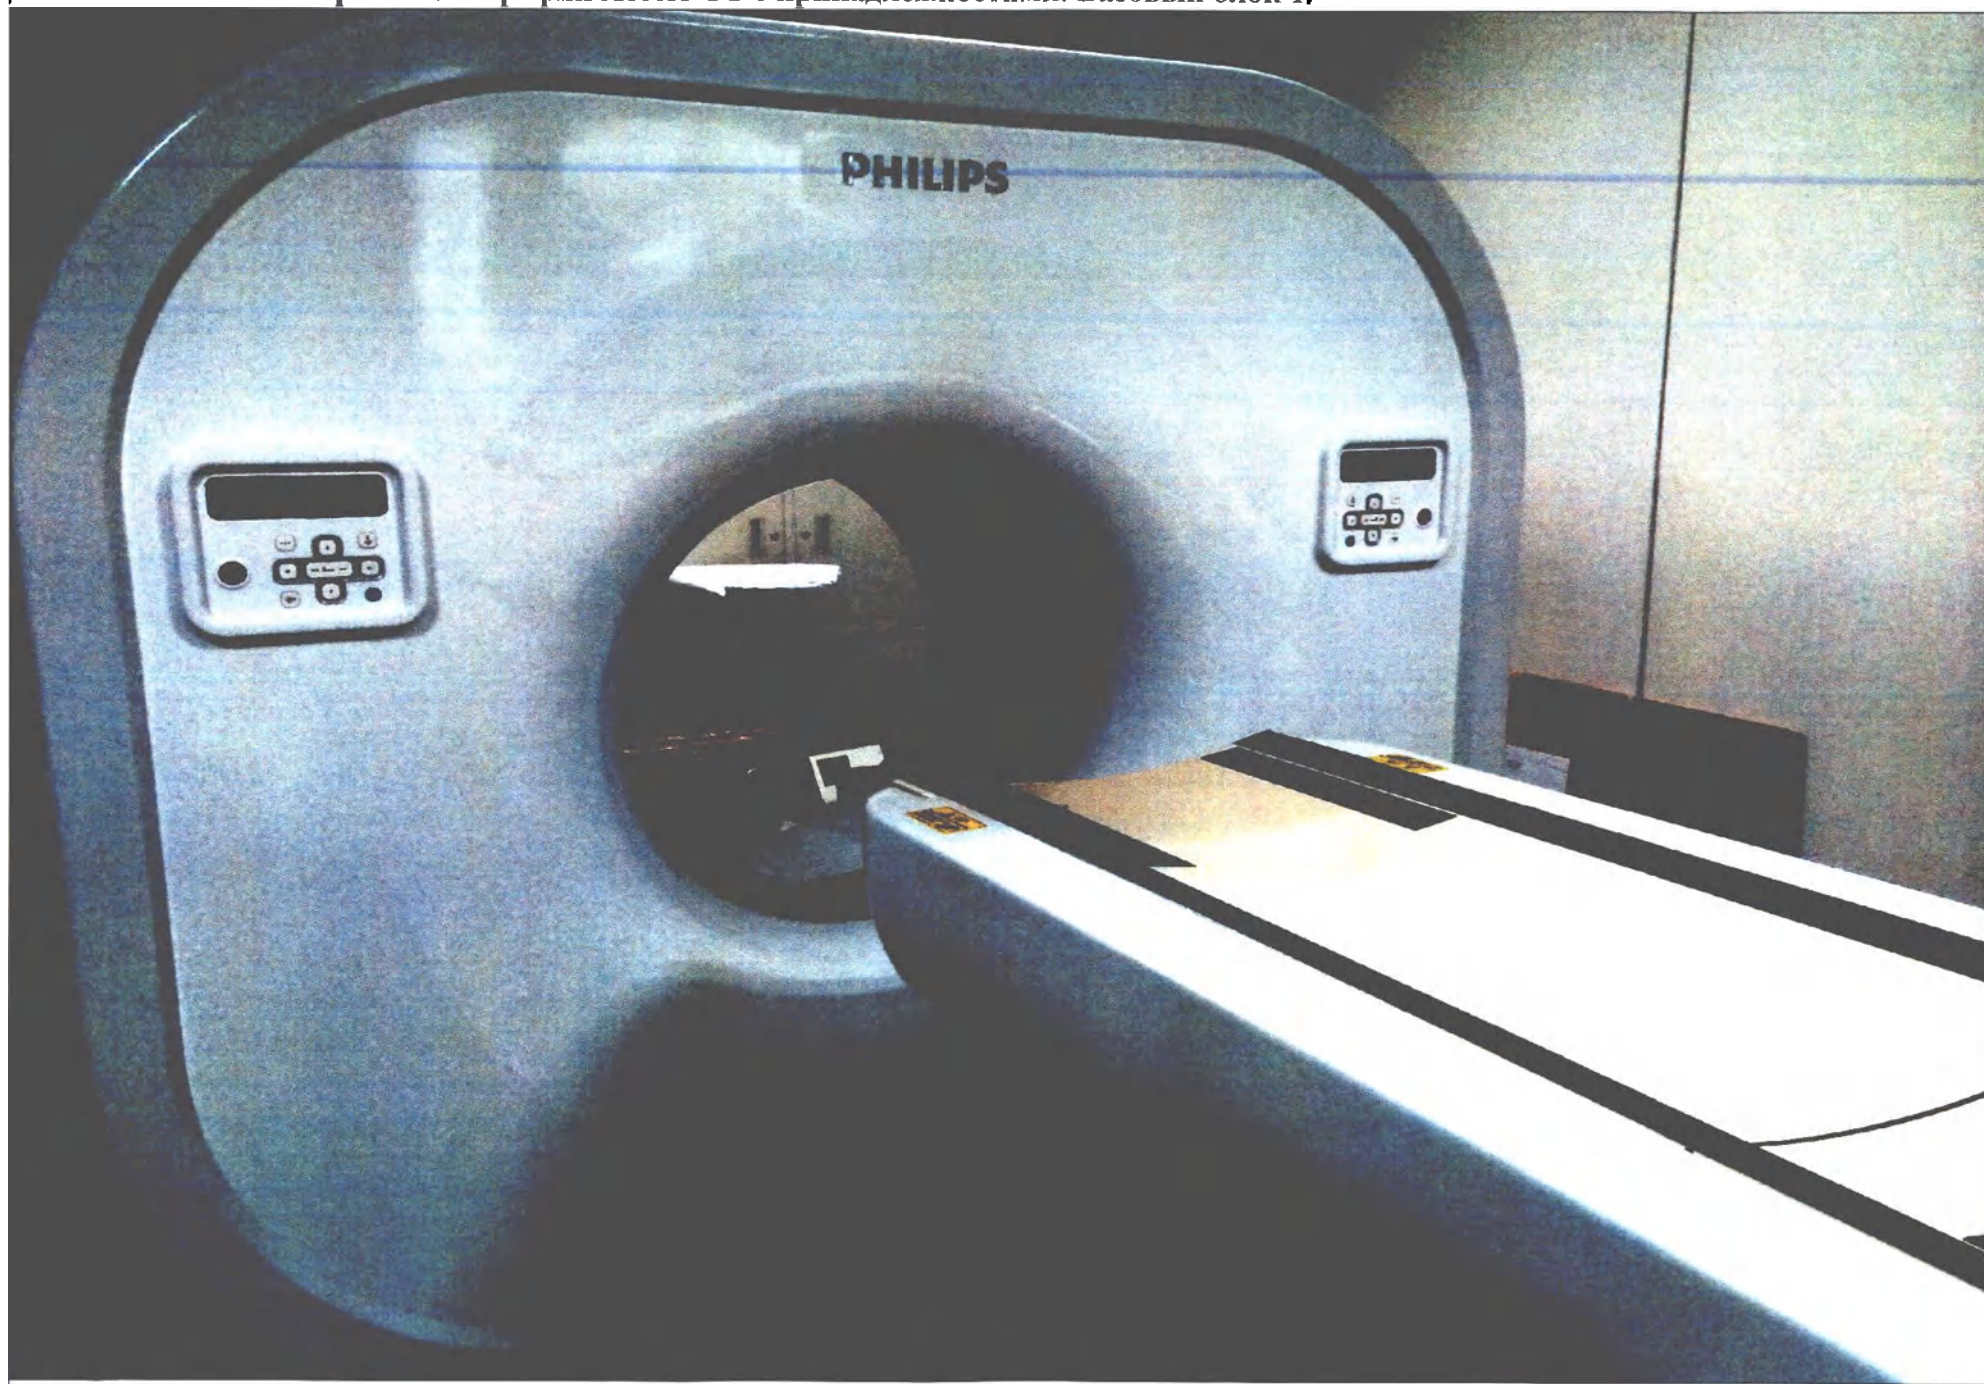


1. Устройство гентри.

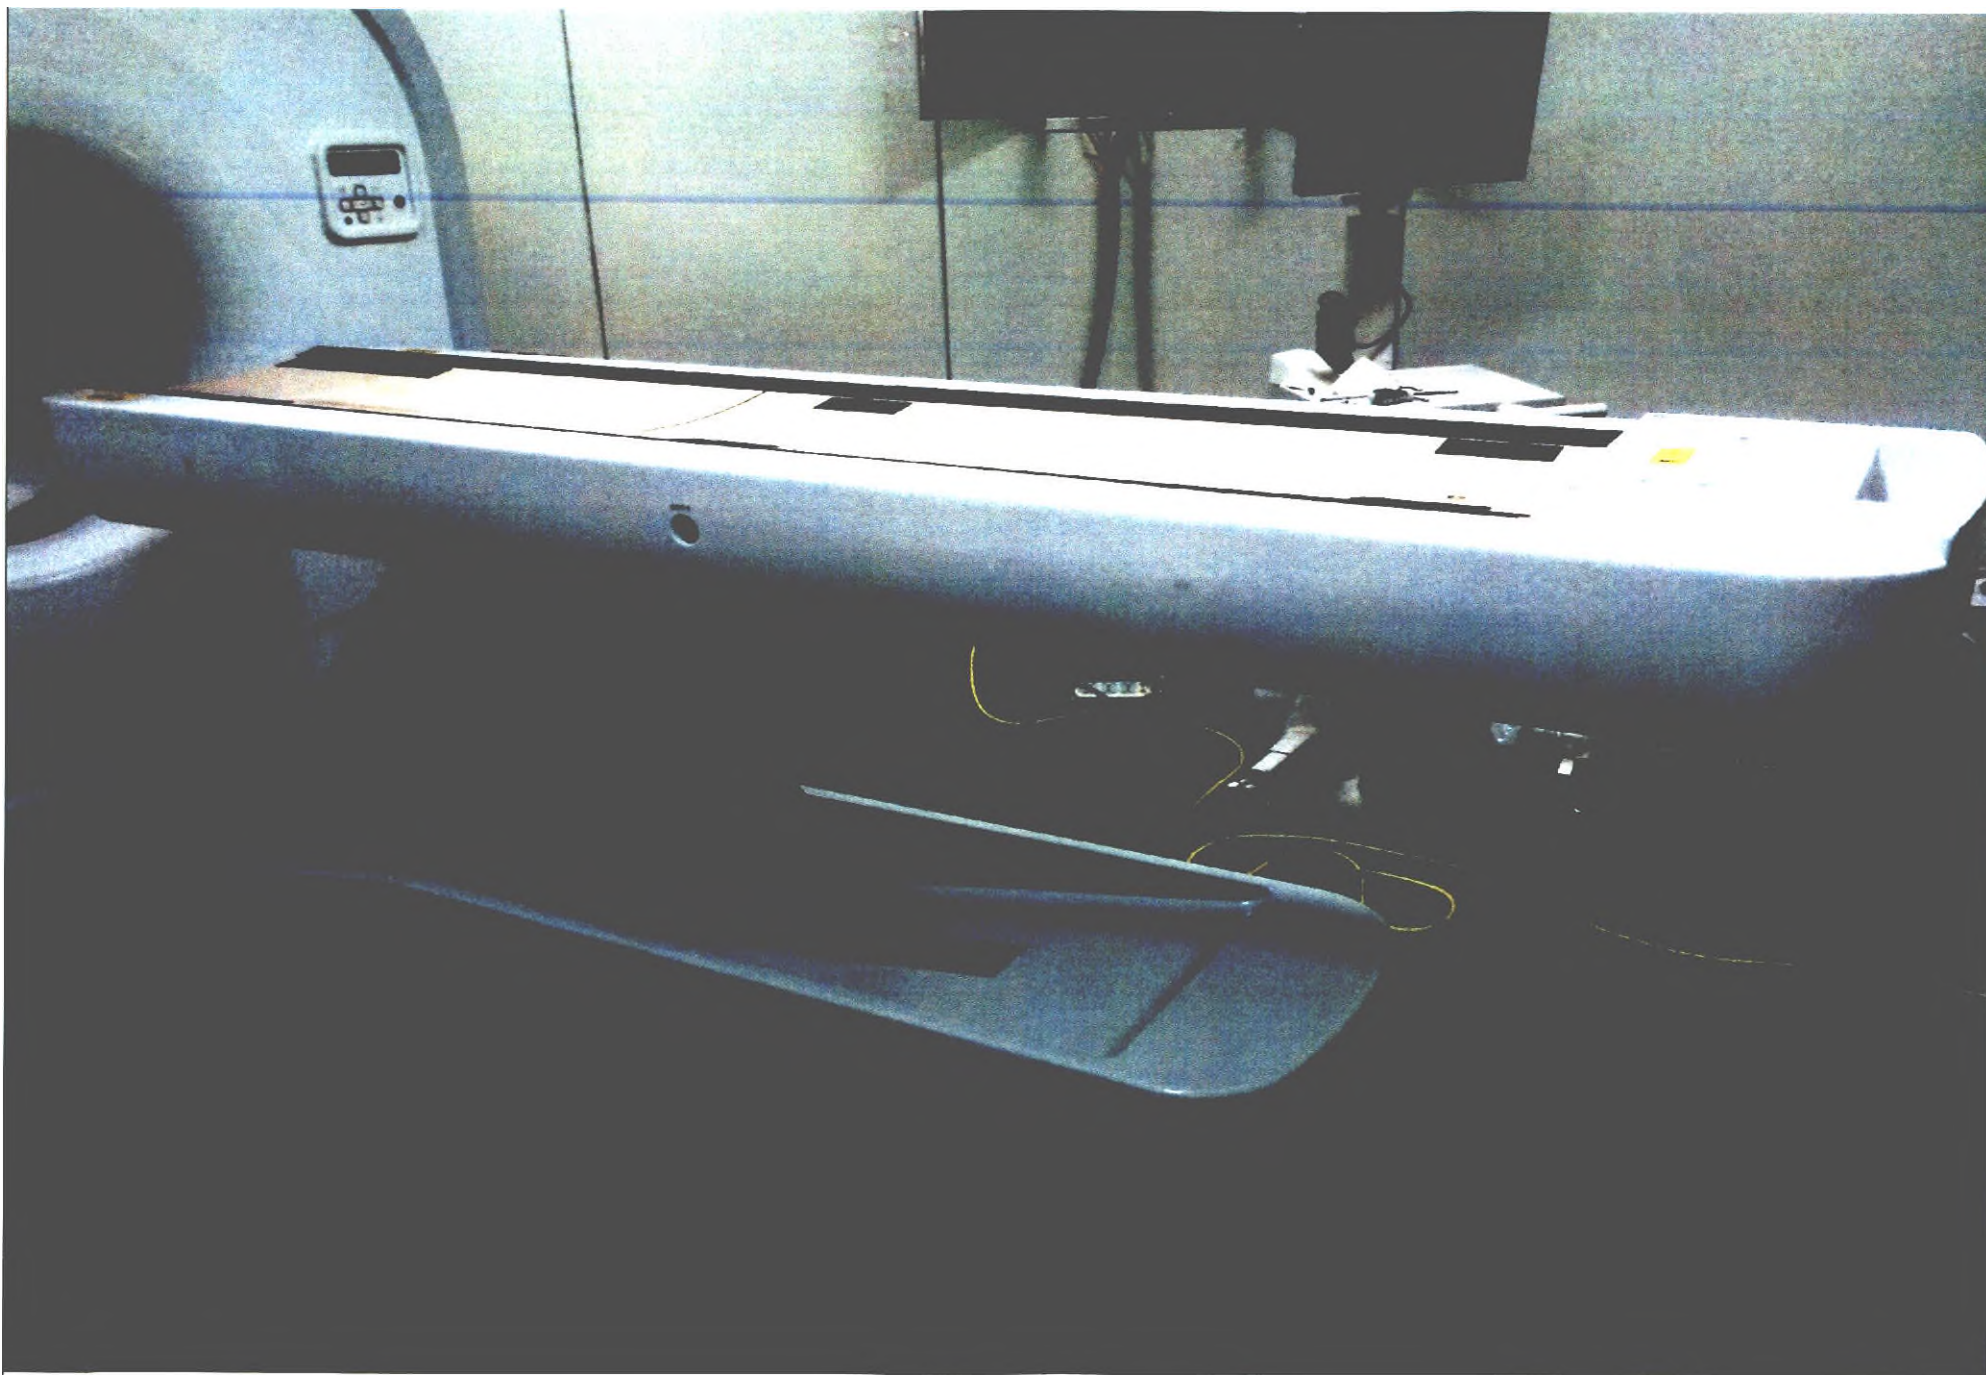

2а. Стол пациента.

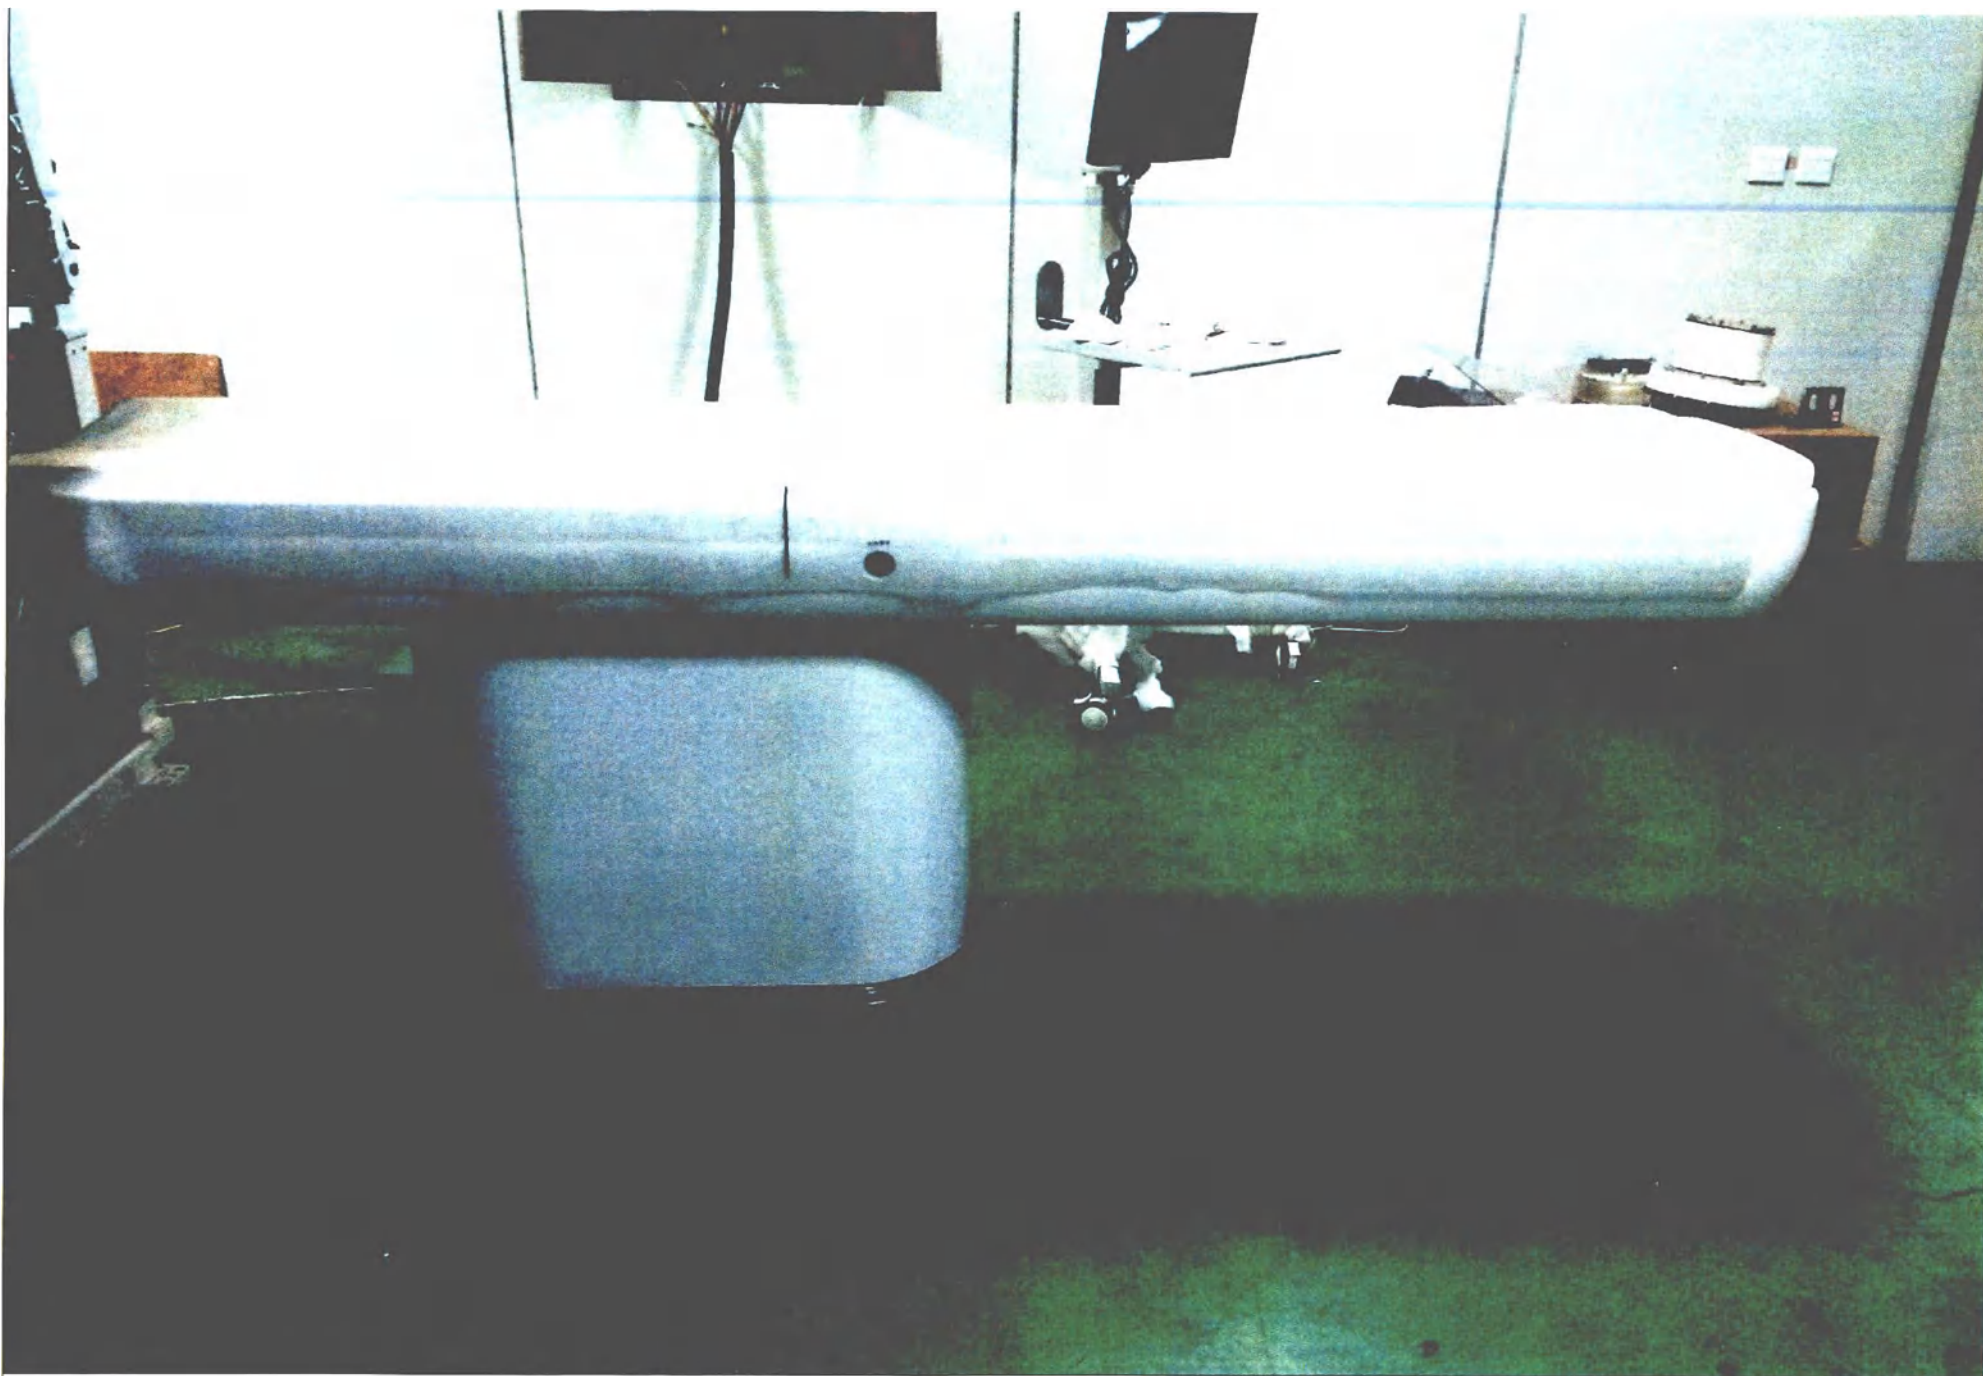

26. Стол пациента.

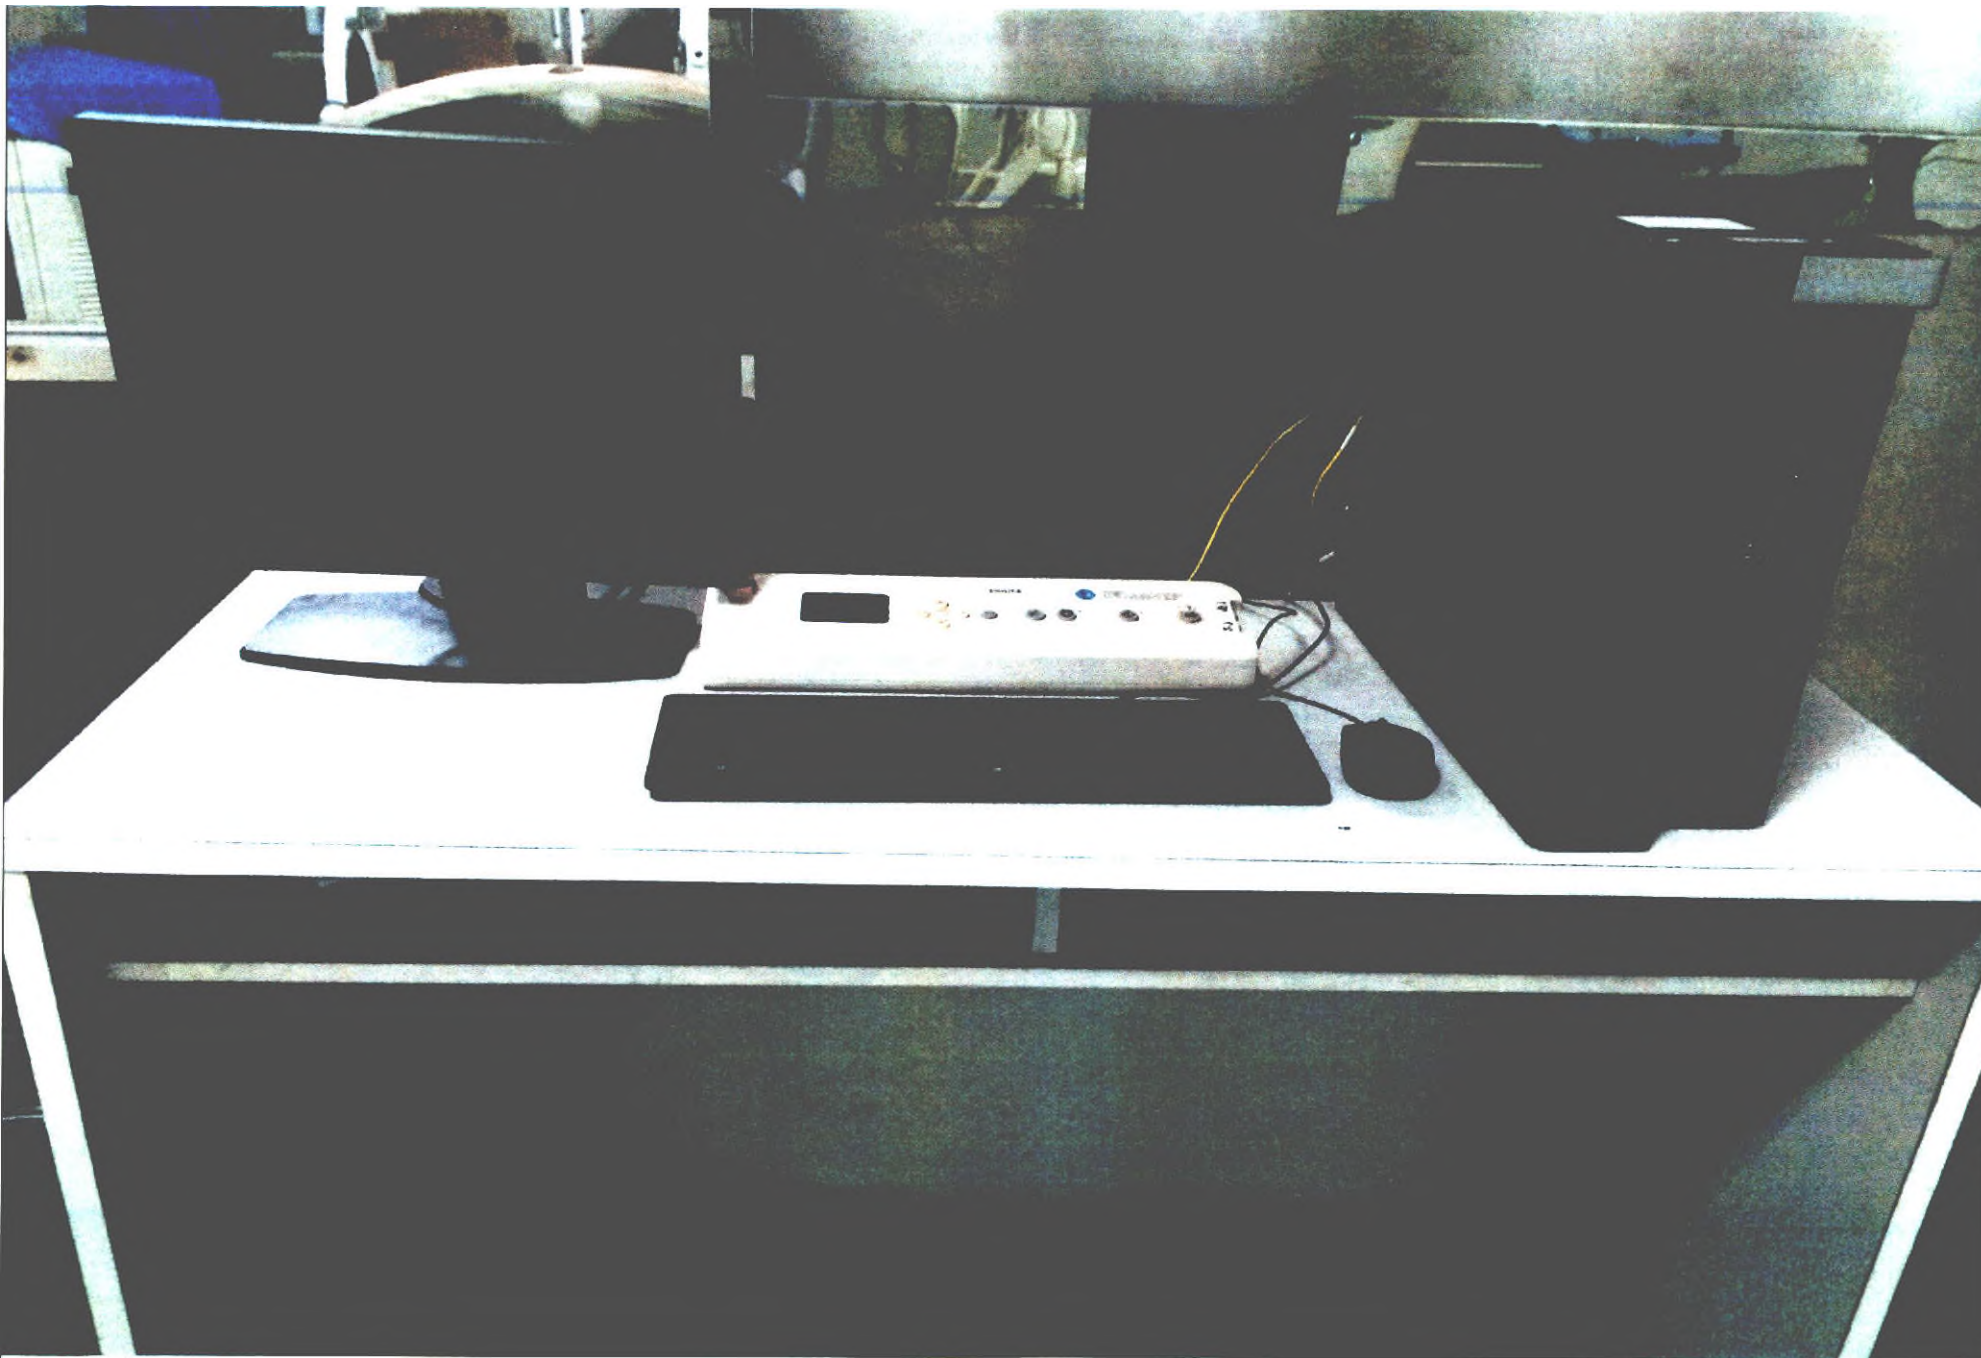

За. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: вычислительная система; пульт управления сканированием; монитор; клавиатура; мышь; базовое программное обеспечение версии V2.0 и выше.




36. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: вычислительная система; пульт управления сканированием; монитор; клавиатура; мышь; базовое программное обеспечение версии V2.0 и выше.



Зв. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: вычислительная система; пульт управления сканированием, **монитор**; клавиатура; мышь; базовое программное обеспечение версии V2.0 и выше.



3г. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: **вычислительная система**; пульт управления сканированием; монитор; клавиатура; мышь; базовое программное обеспечение версии V2.0 и выше.

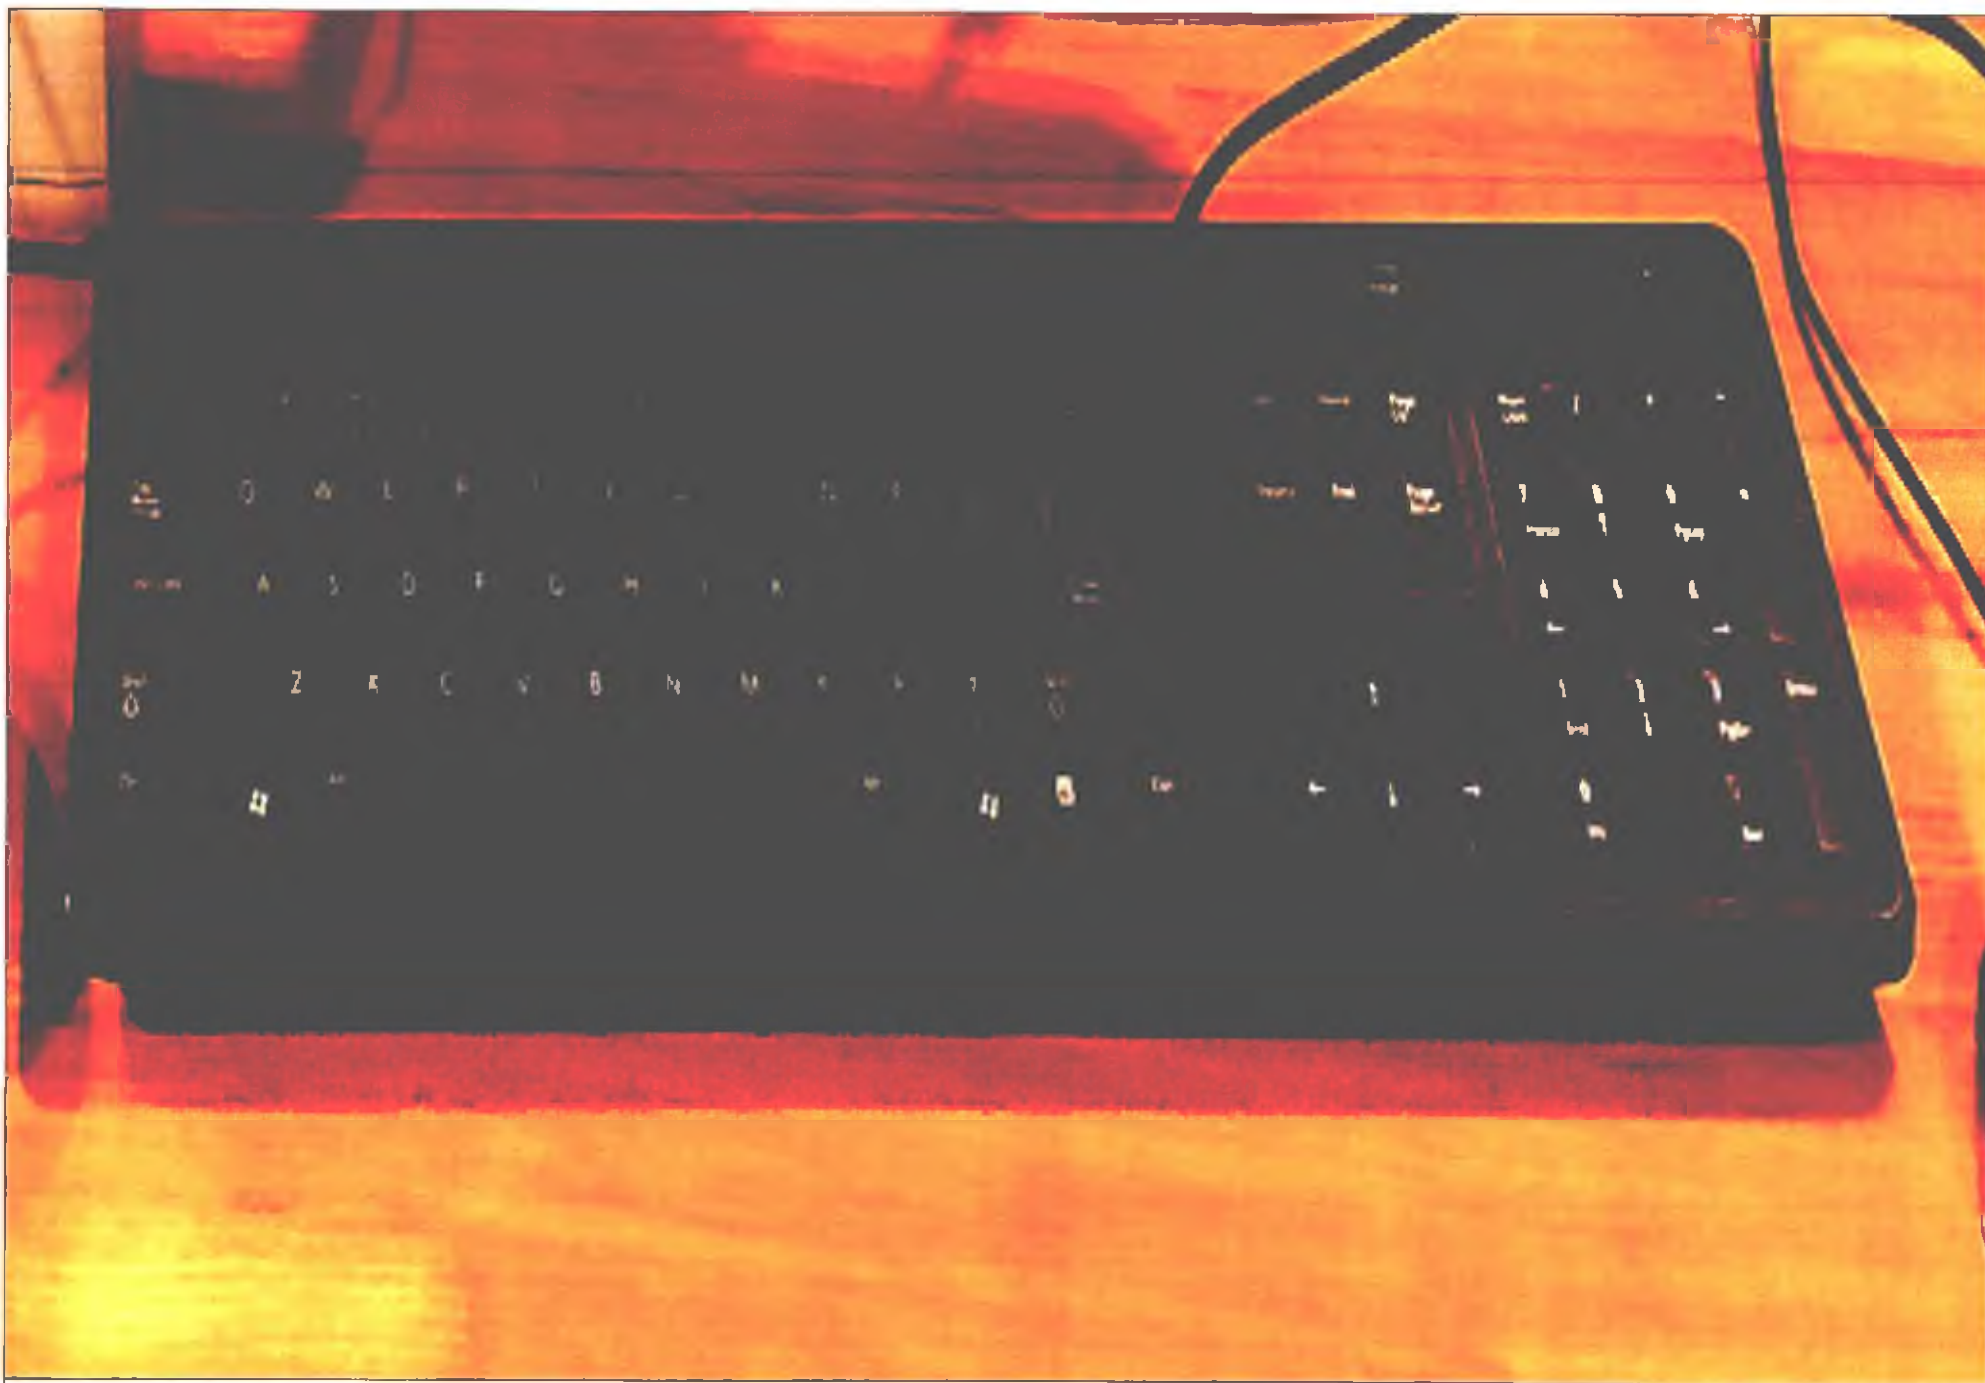

3д. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: вычислительная система; пульт управления сканированием; монитор; **клавиатура**; мышь; базовое программное обеспечение версии V2.0 и выше.



3е. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: вычислительная система; пульт управления сканированием; монитор; клавиатура; **мышь**; базовое программное обеспечение версии V2.0 и выше.

Russian




Access CT


459800751441_C

PHILIPS


4. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.

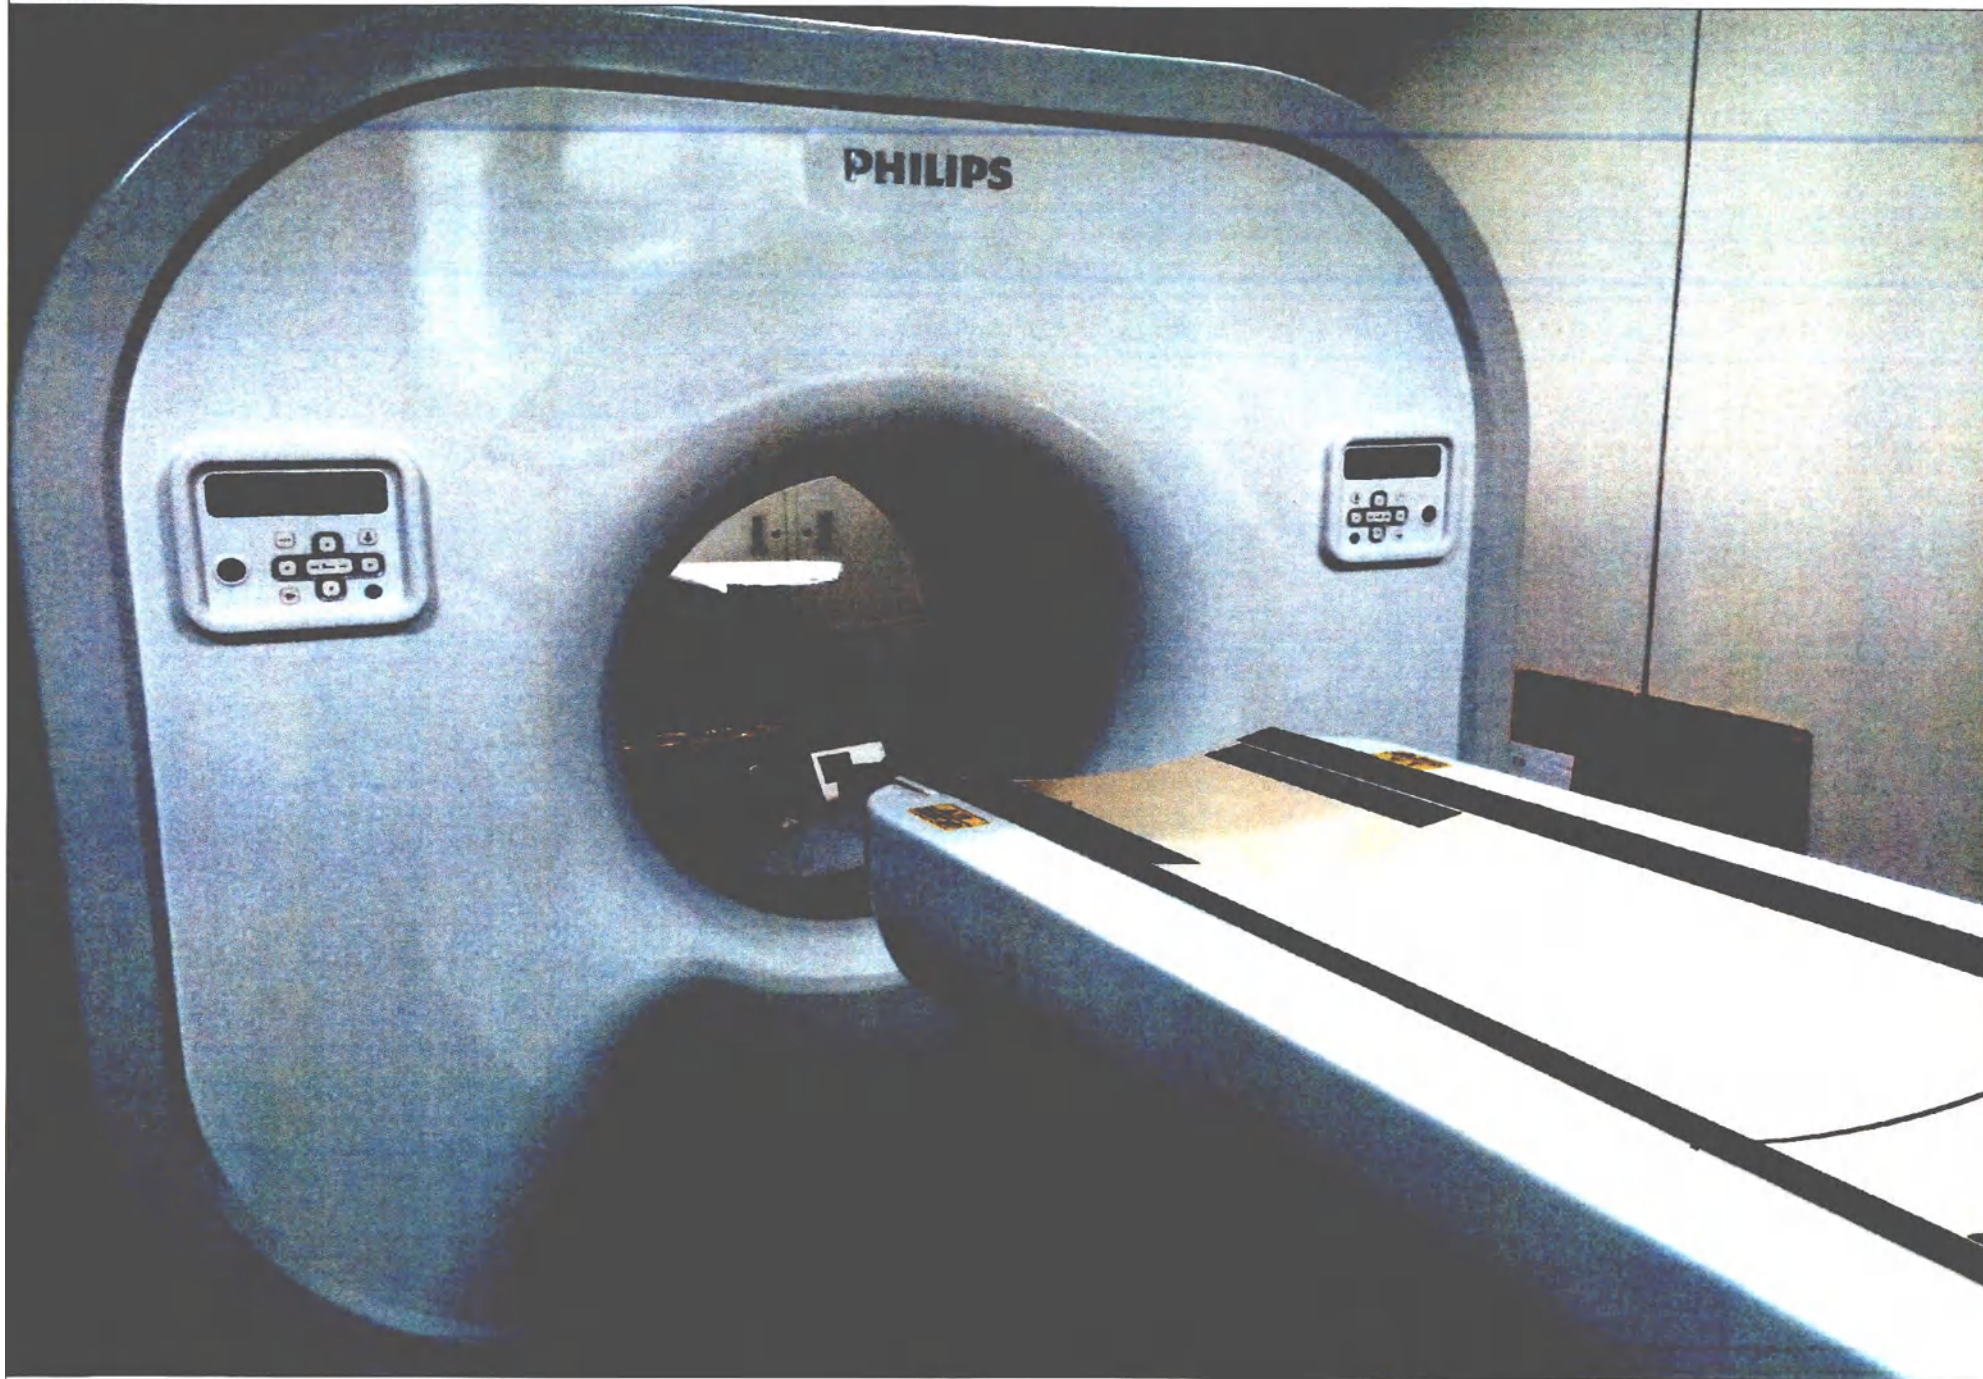


1. Устройство гентри

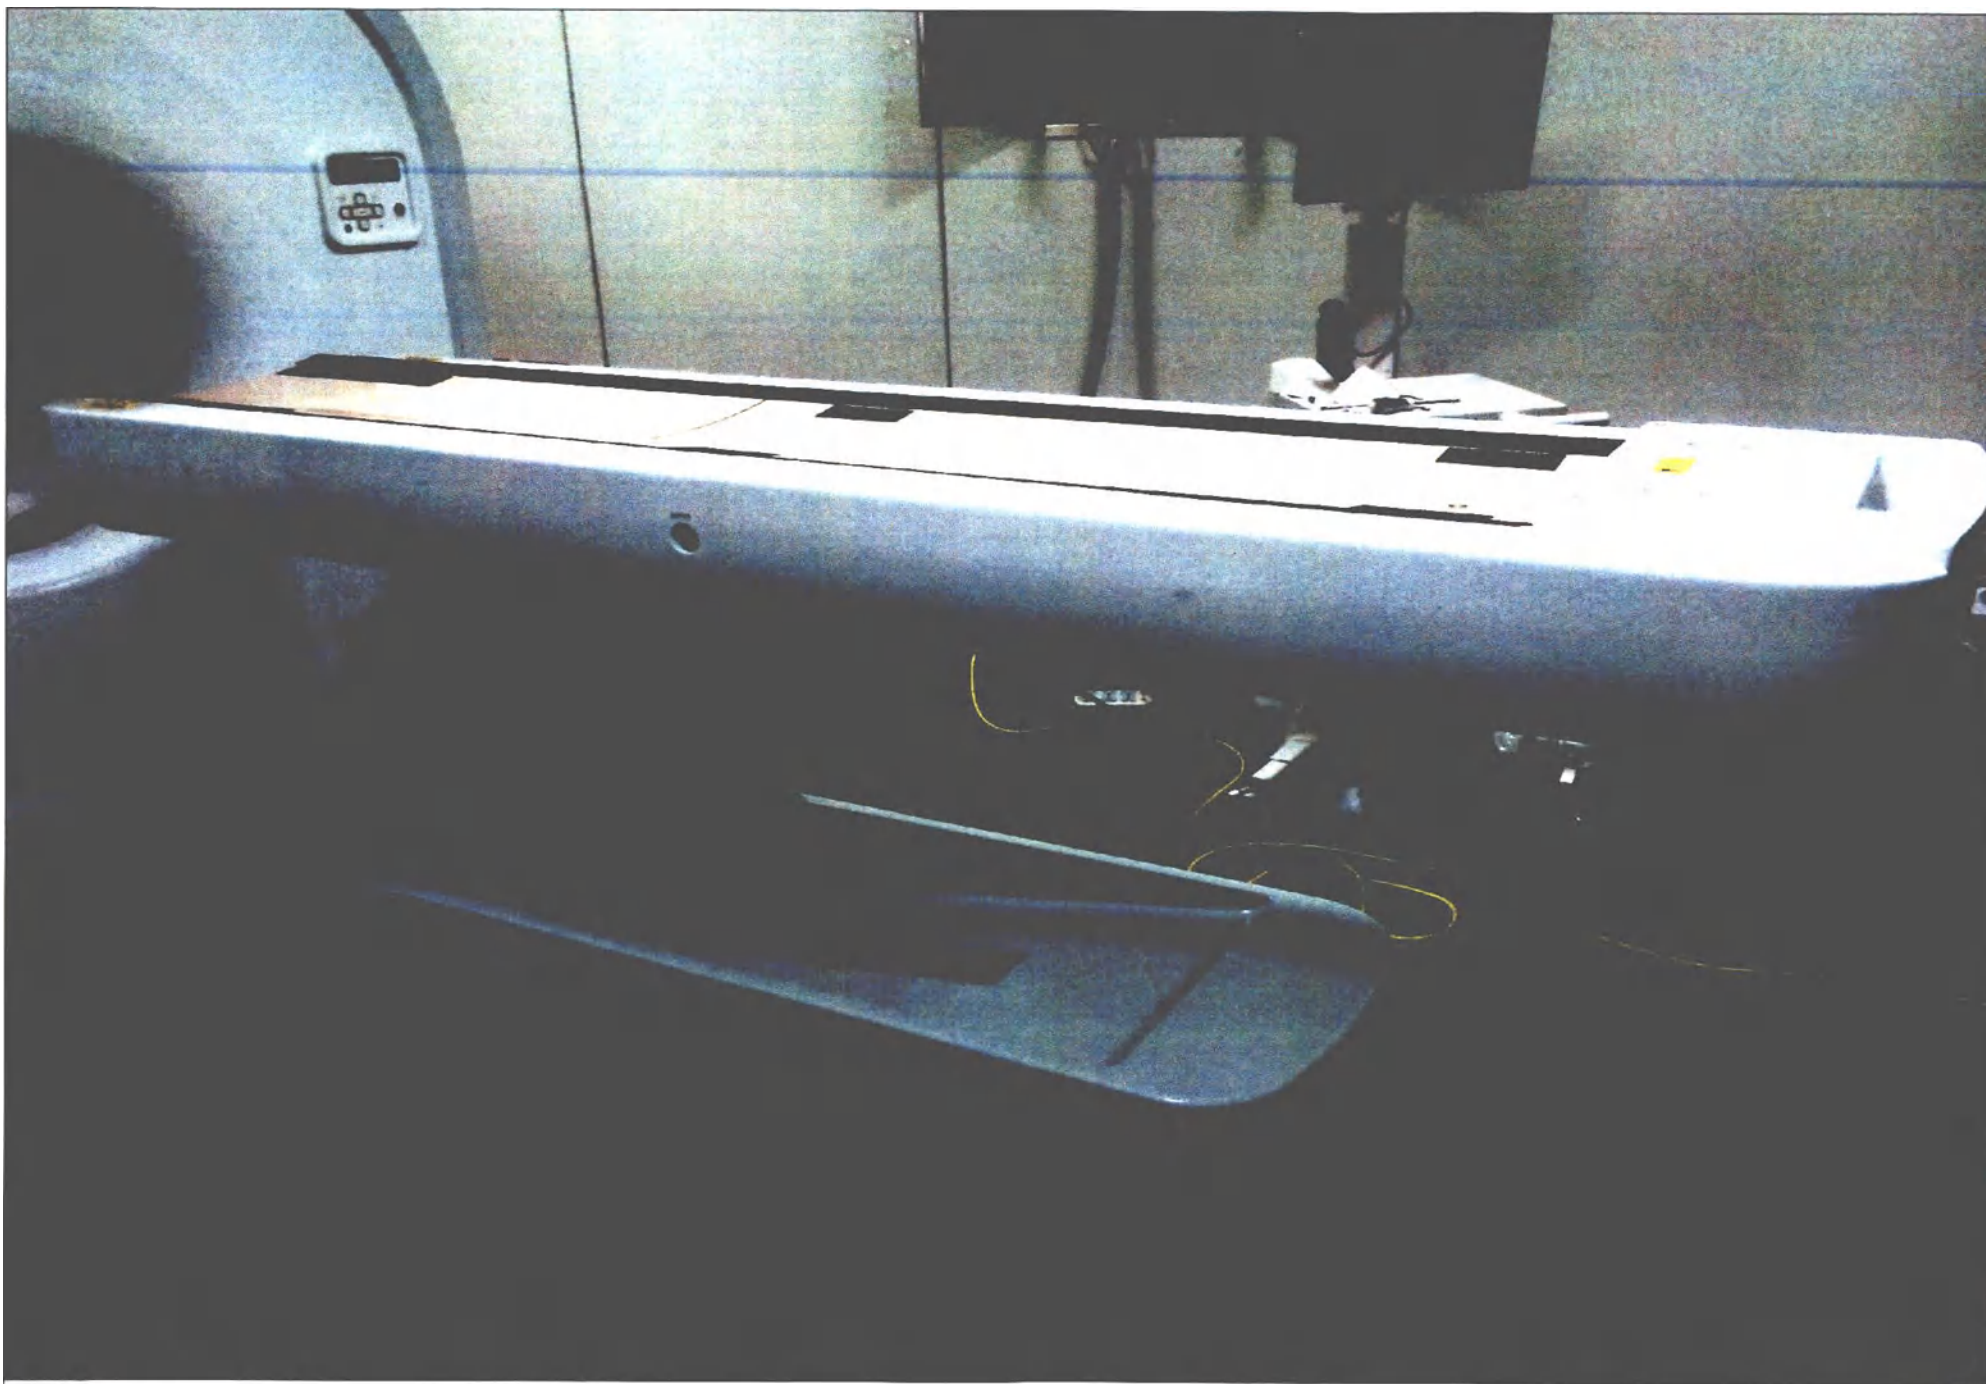

2. Стол пациента.

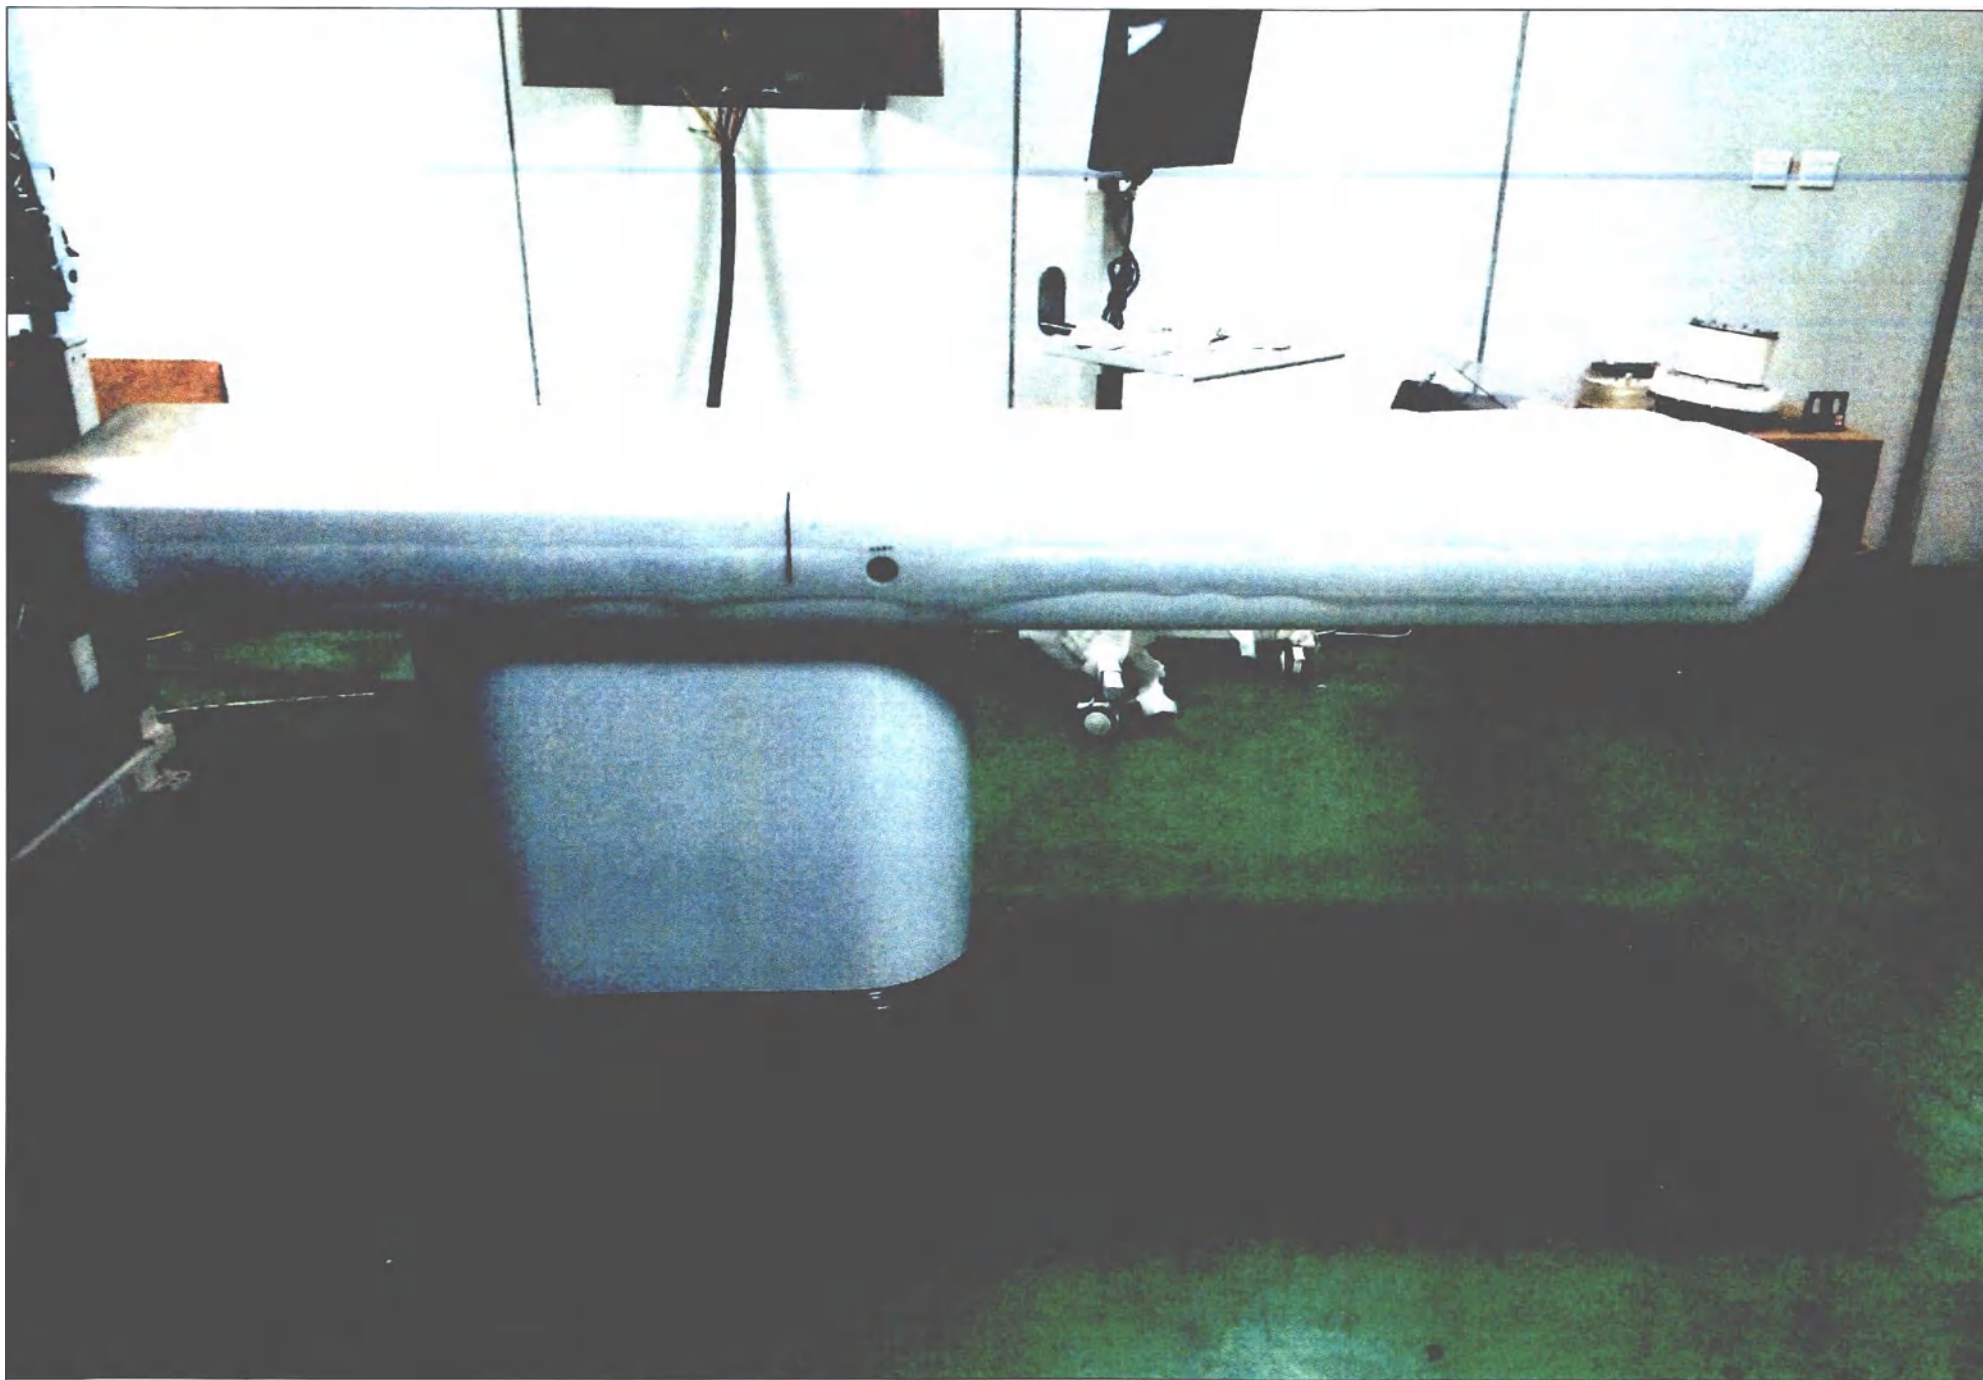

26. Стол пациента.

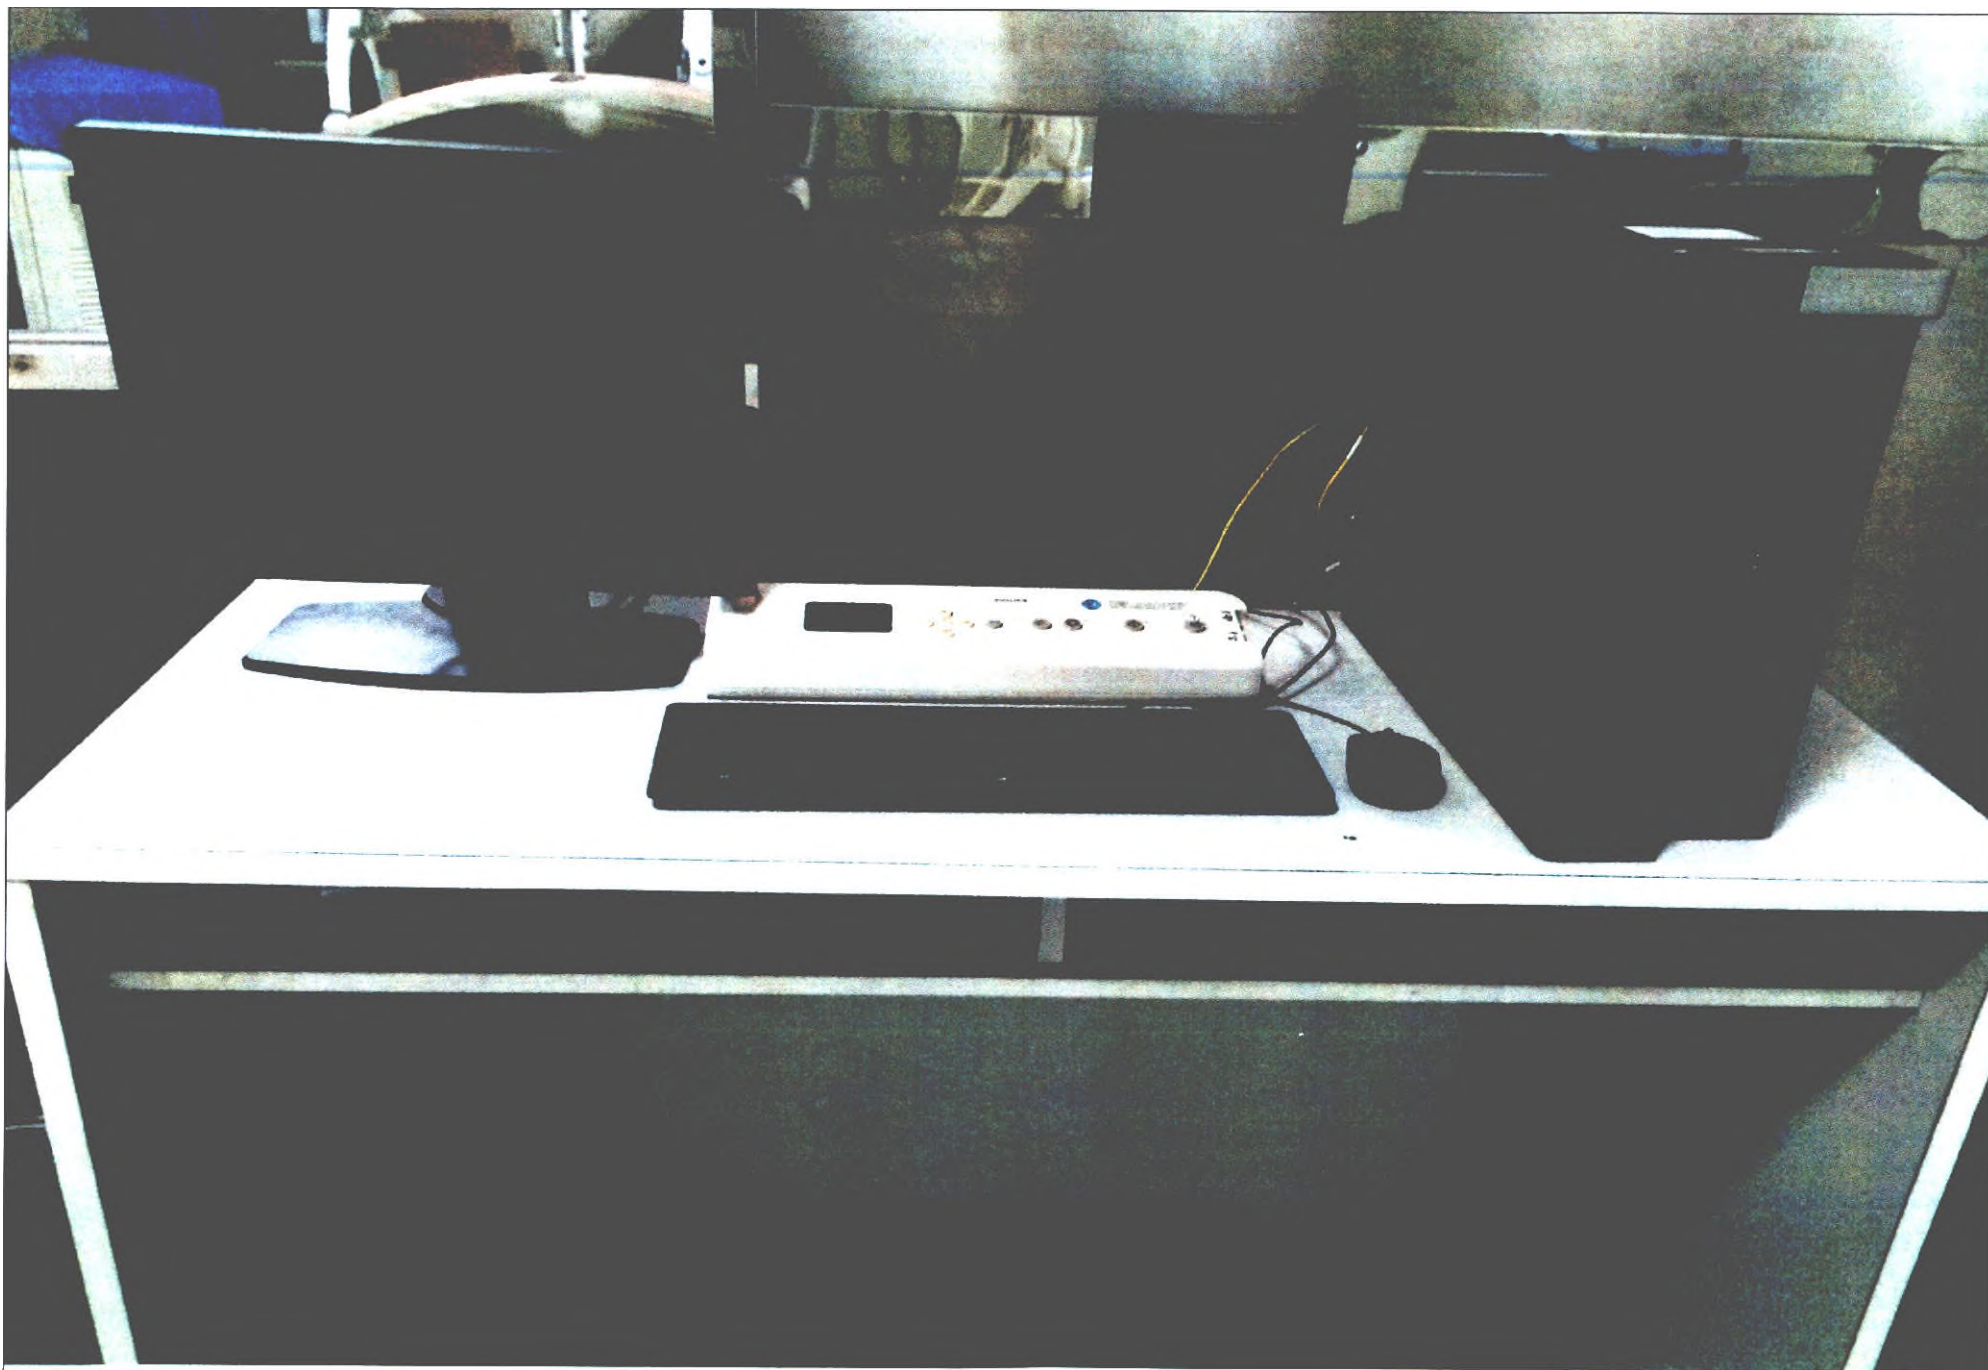

За. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: вычислительная система; пульт управления сканированием; монитор; клавиатура; мышь; базовое программное обеспечение версии V2.0 и выше.




36. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: вычислительная система; пульт управления сканированием; монитор; клавиатура; мышь; базовое программное обеспечение версии V2.0 и выше.



Зв. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: вычислительная система; пульт управления сканированием; **монитор**; клавиатура; мышь; базовое программное обеспечение версии V2.0 и выше.



3г. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: **вычислительная система**; пульт управления сканированием; монитор; клавиатура; мышь; базовое программное обеспечение версии V2.0 и выше.

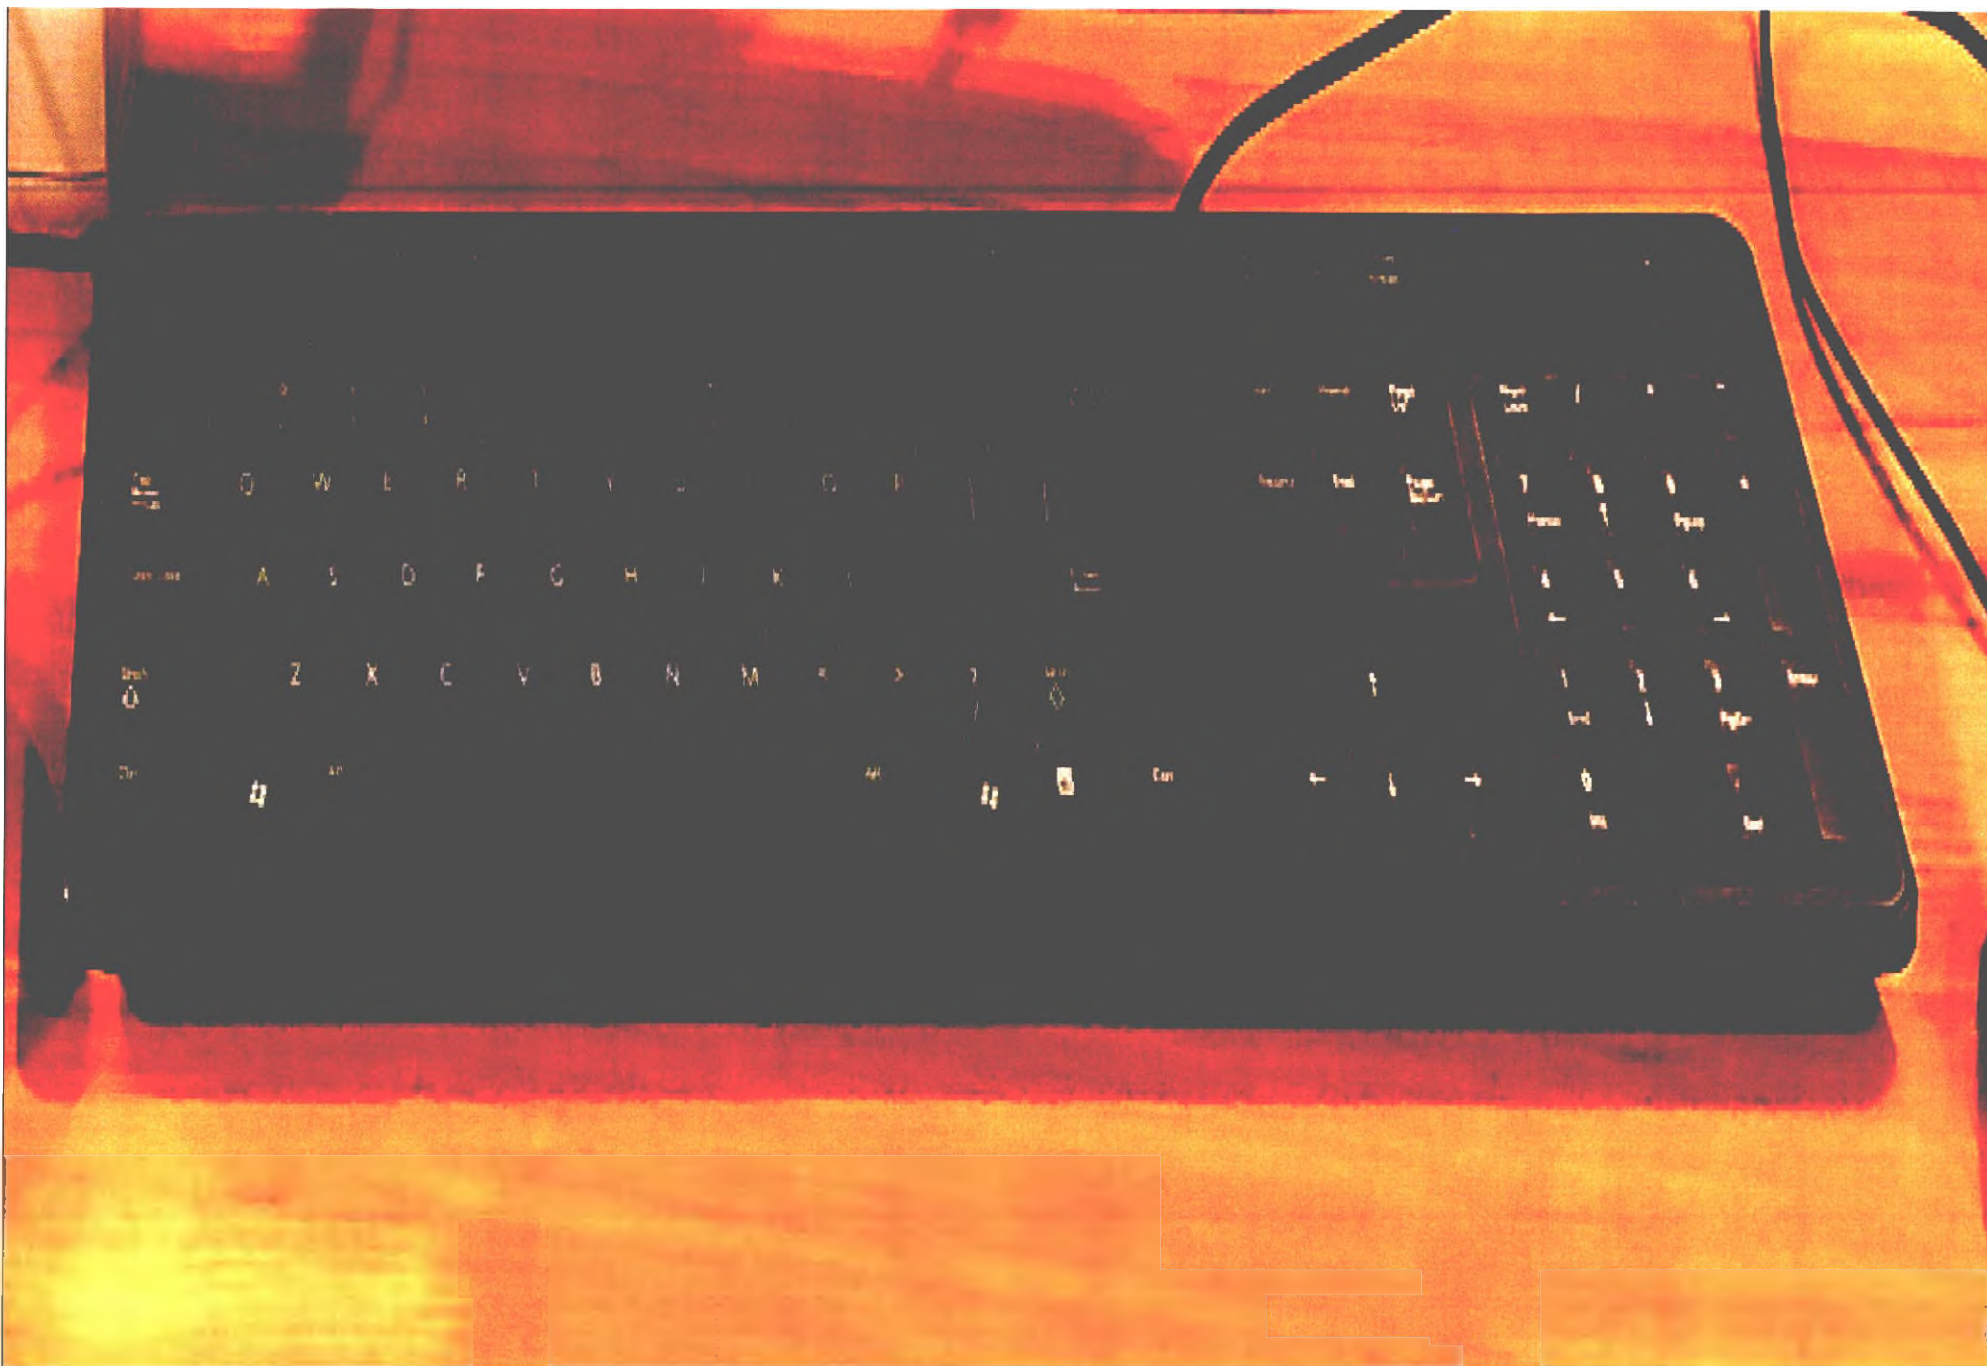


3д. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: вычислительная система; пульт управления сканированием; монитор; **клавиатура**; мышь; базовое программное обеспечение версии V2.0 и выше.




3е. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования: вычислительная система; пульт управления сканированием; монитор; клавиатура; **мышь**; базовое программное обеспечение версии V2.0 и выше.



4а. Дополнительная рабочая станция EViewer для обработки изображений в составе: блок компьютерный, программное обеспечение EViewer, монитор, мышь, клавиатура, (на фотографическом изображении слева - А).

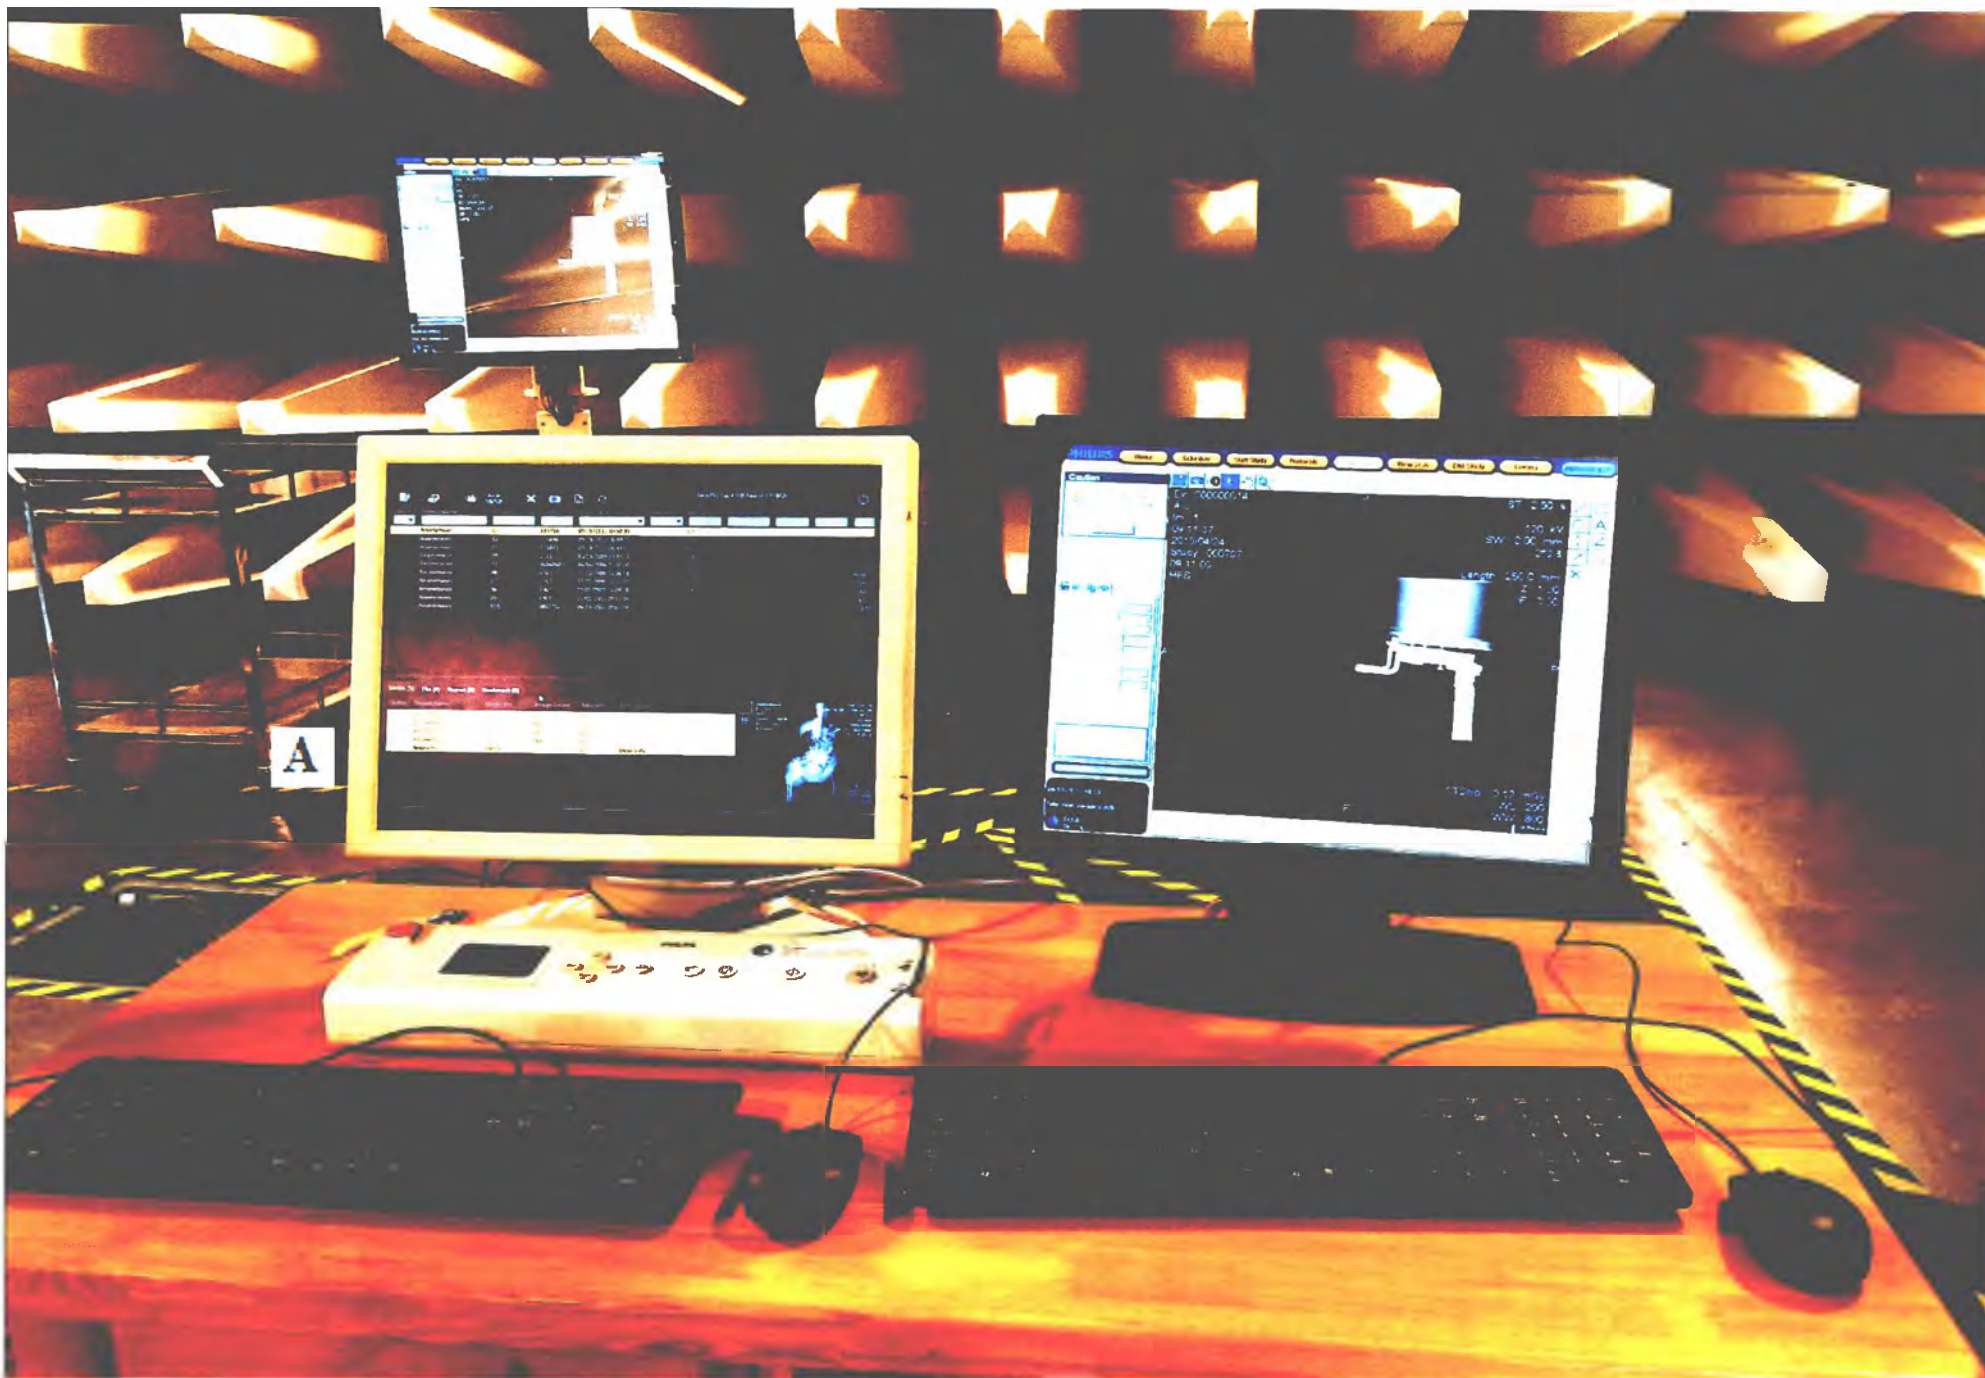


46. Дополнительная рабочая станция EViewer для обработки изображений в составе: блок компьютерный, программное обеспечение EViewer, монитор (A), мышь, клавиатура.

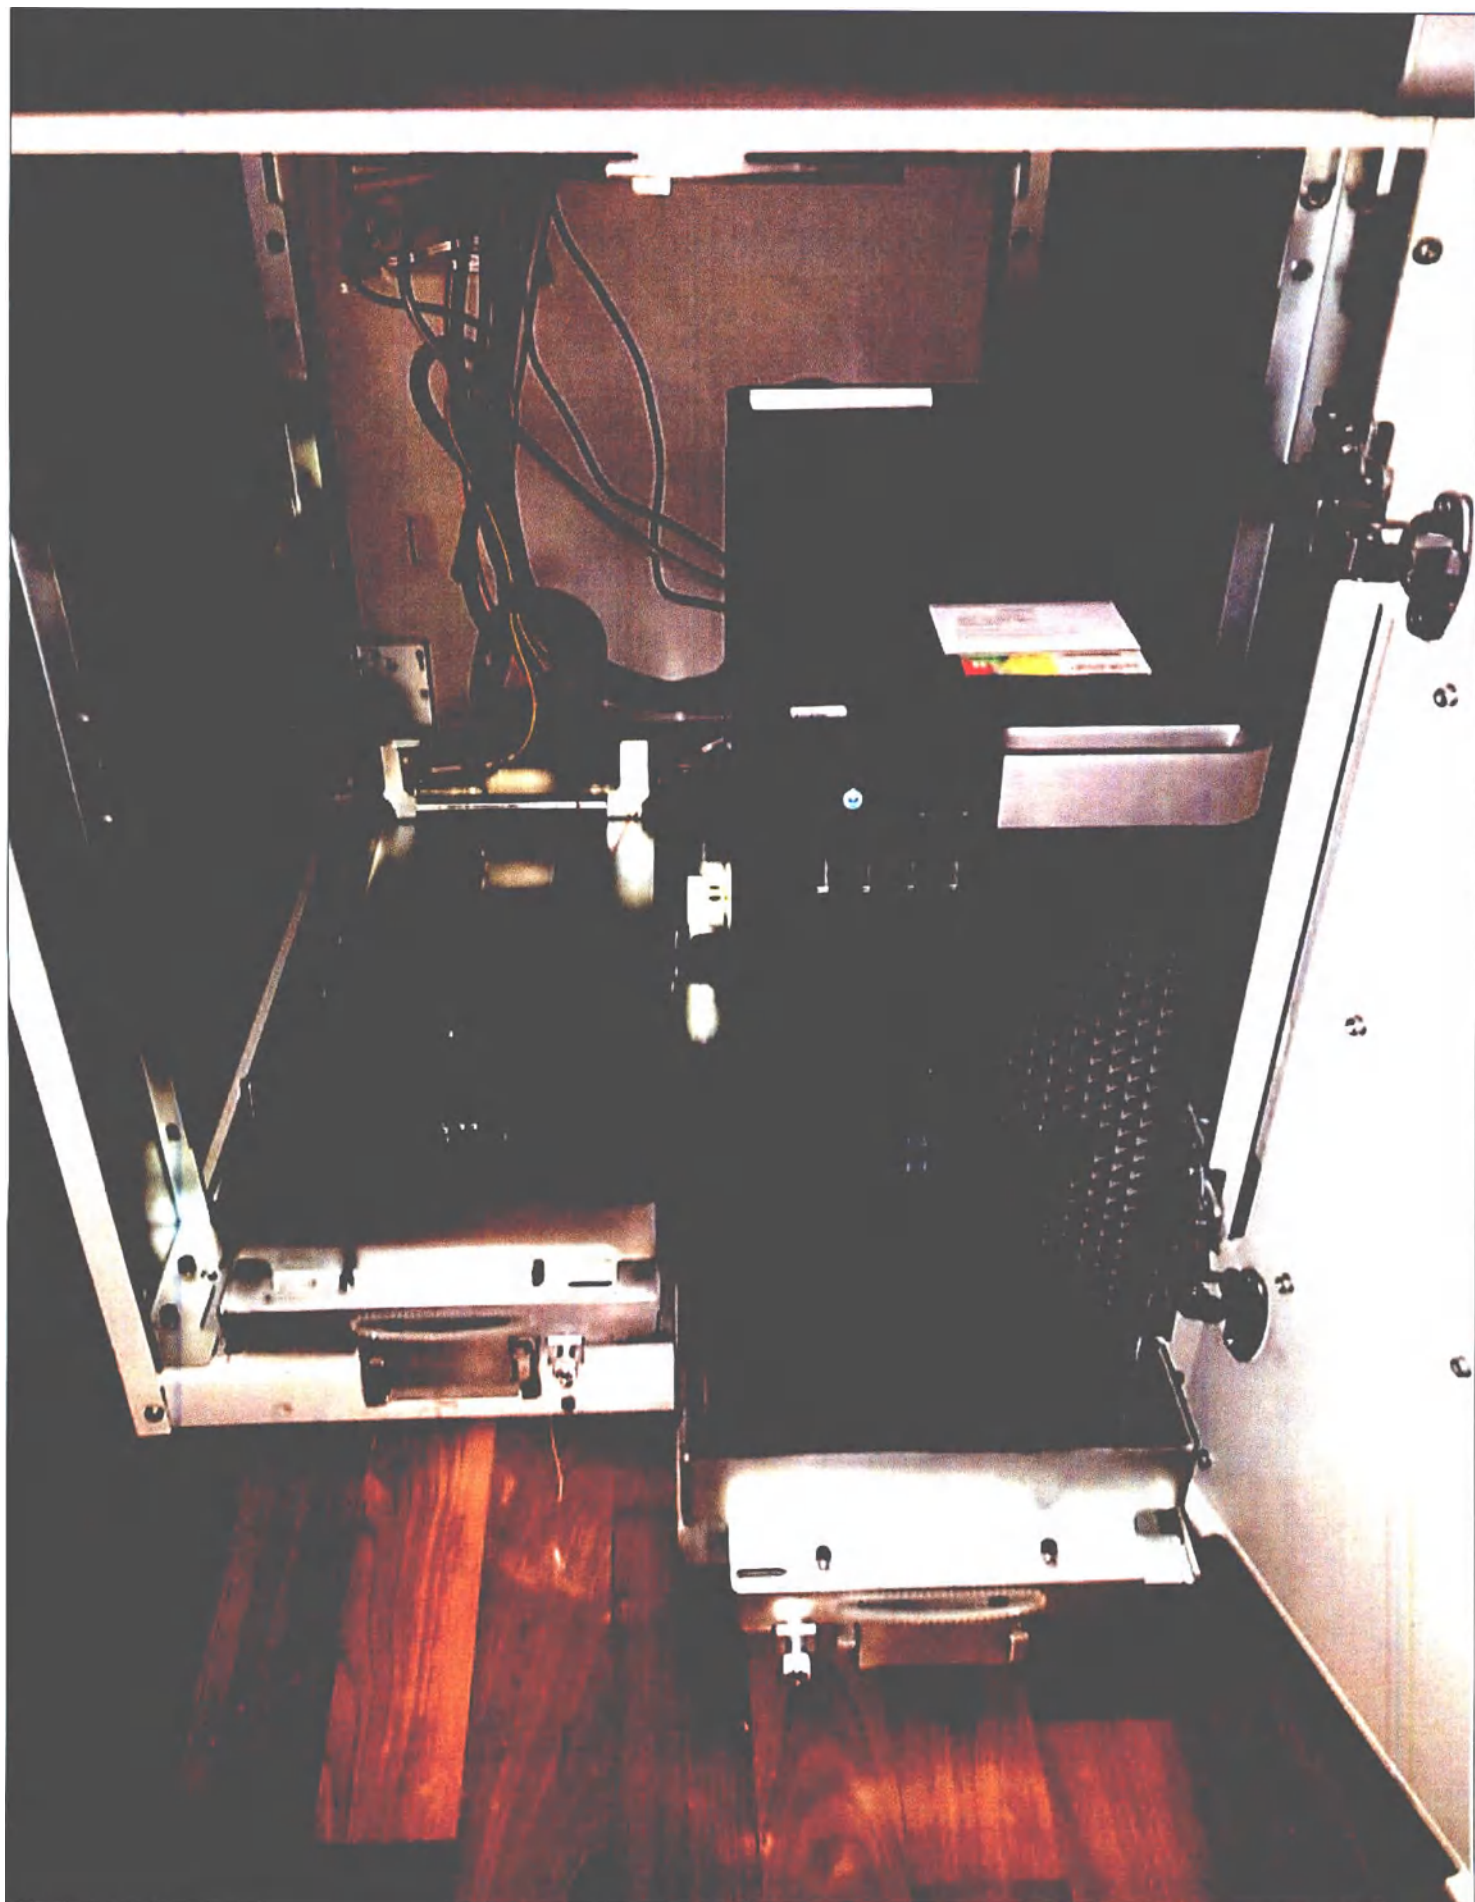

46. Дополнительная рабочая станция EViewer для обработки изображений в составе: блок компьютерный, программное обеспечение EViewer, монитор, мышь, клавиатура.



4г. Дополнительная рабочая станция EViewer для обработки изображений в составе: блок компьютерный, программное обеспечение EViewer, монитор, **мышь**, клавиатура.

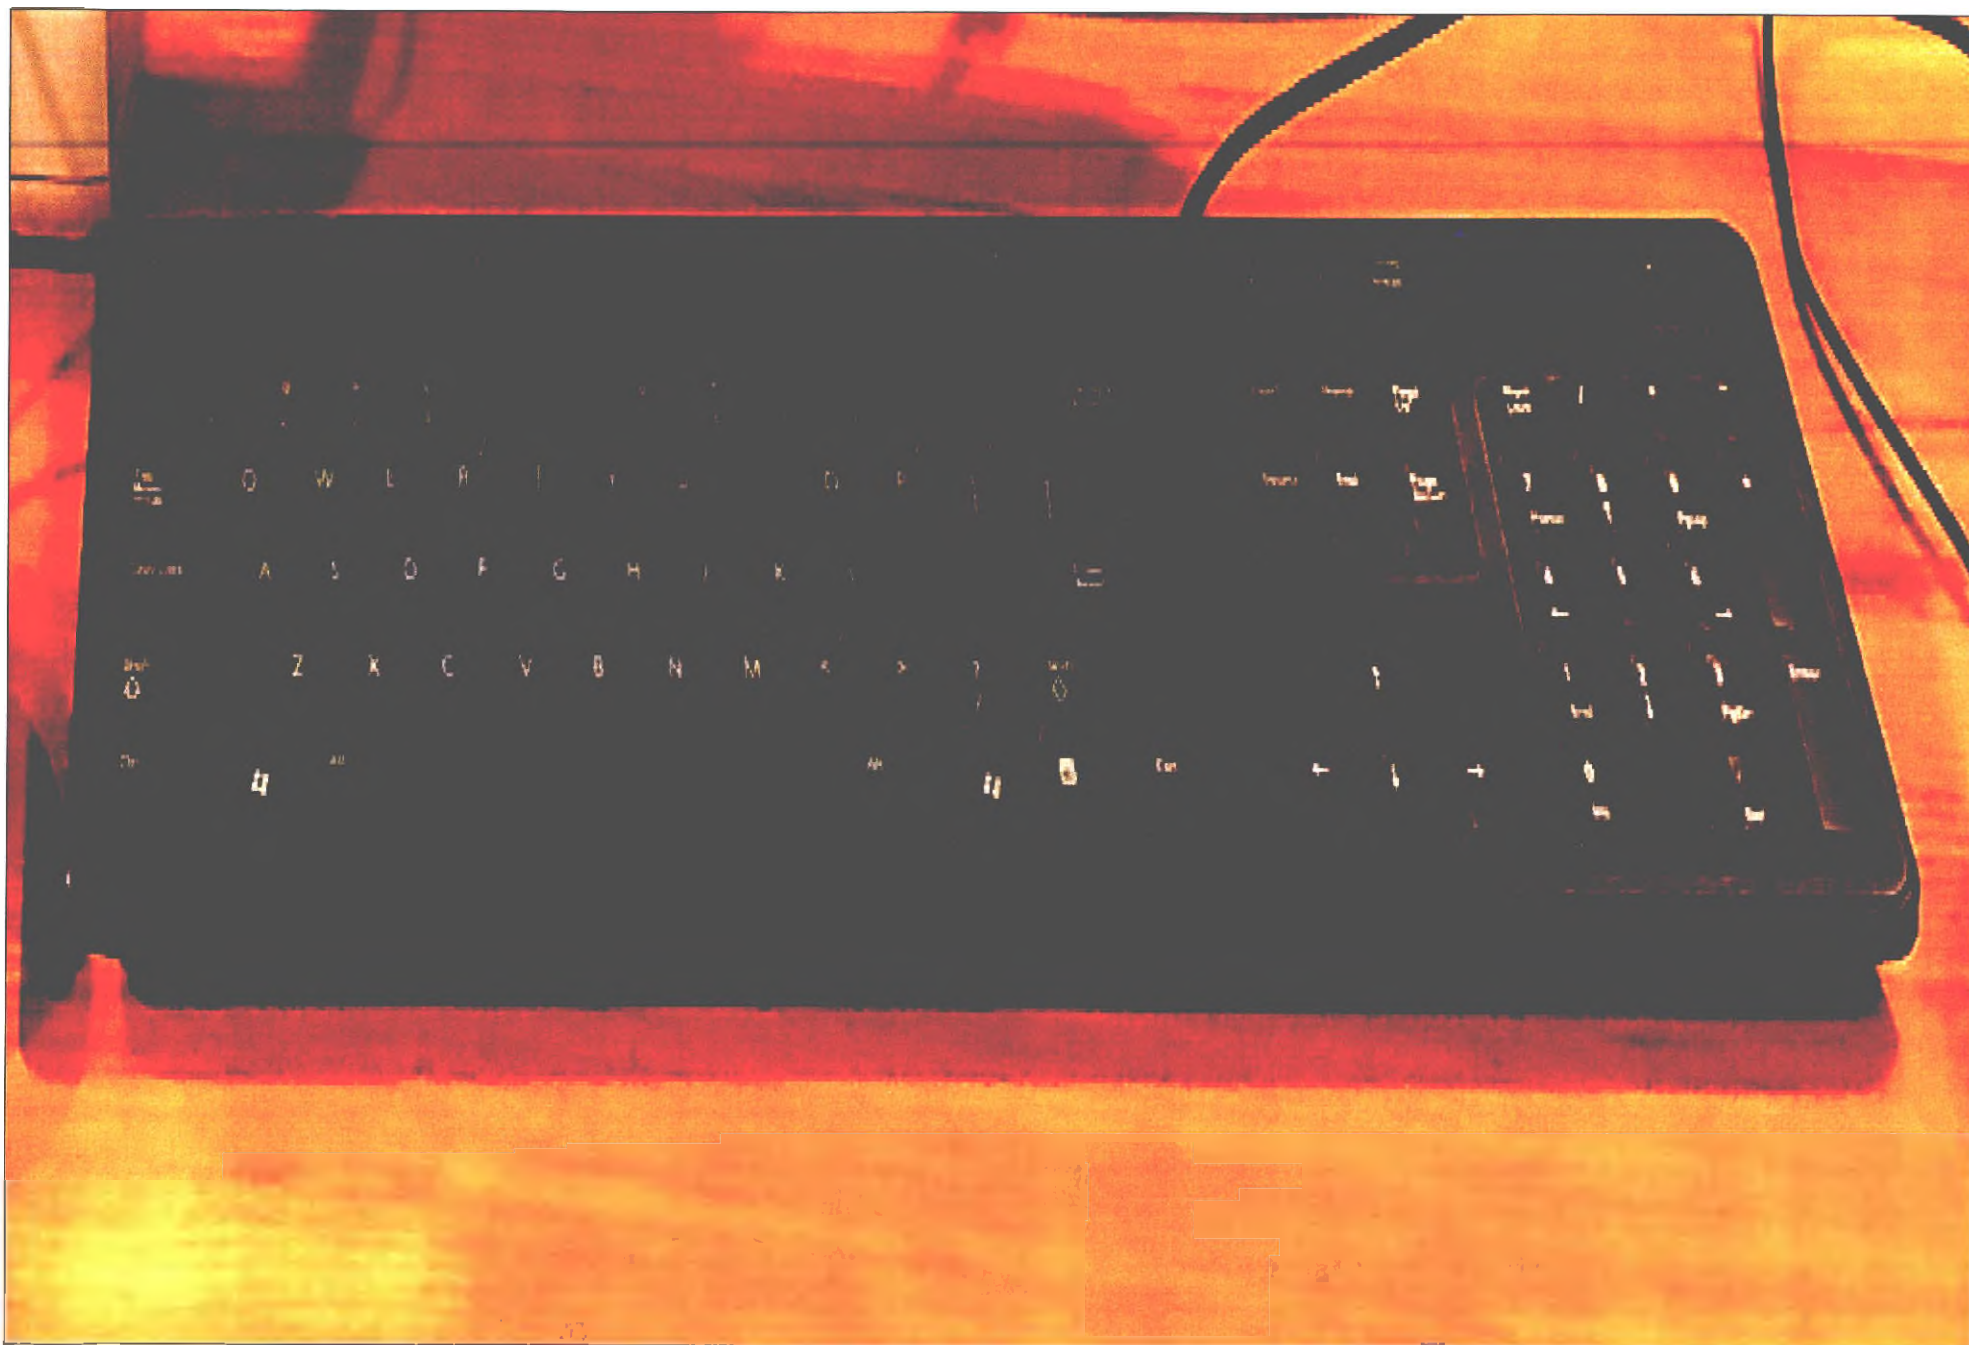

4д. Дополнительная рабочая станция EViewer для обработки изображений в составе: блок компьютерный, программное обеспечение EViewer, монитор, мышь, **клавиатура**.

5. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.

Russian




Access CT

459800751441_C

PHILIPS

II. Принадлежности

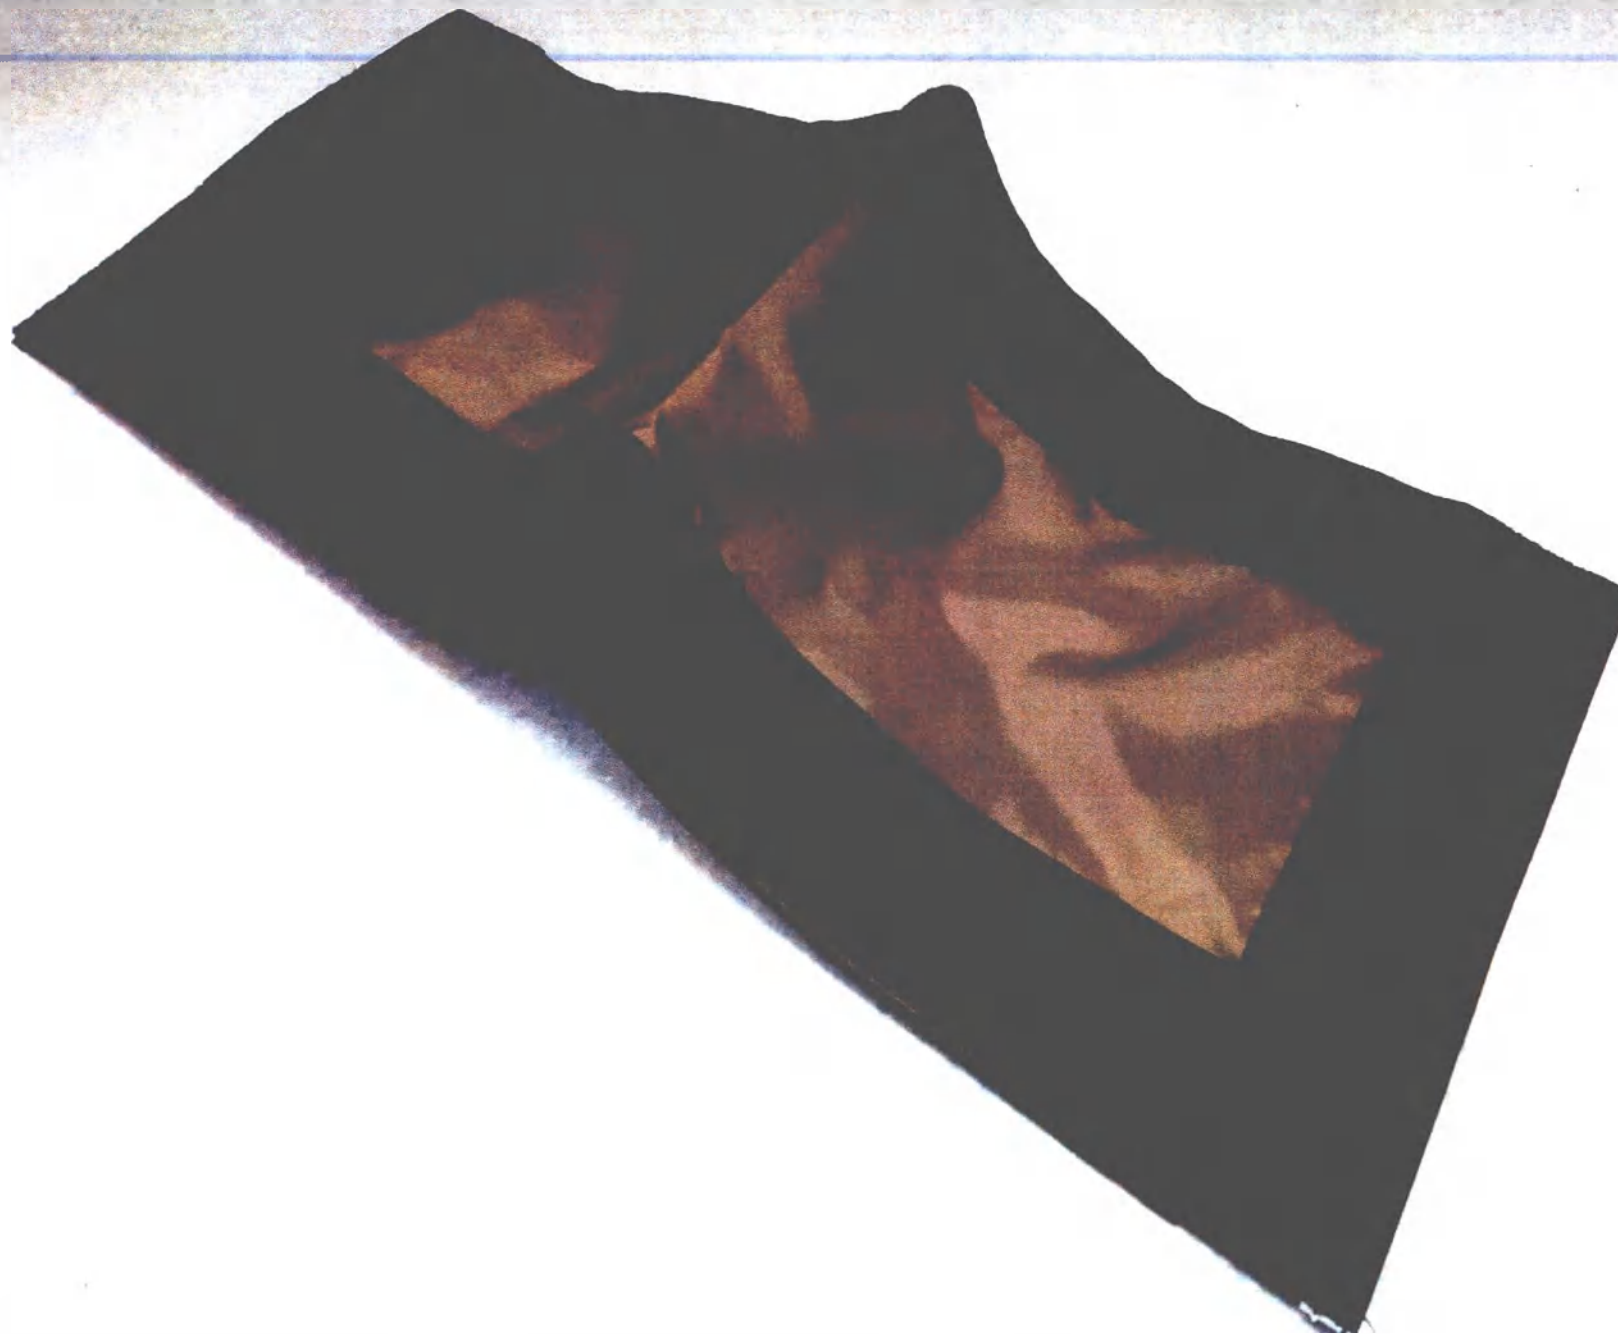


1а. Ремни пациента (не более 5 шт.).



16. Ремни пациента (не более 5 шт.).



1в. Ремни пациента (не более 5 шт.).

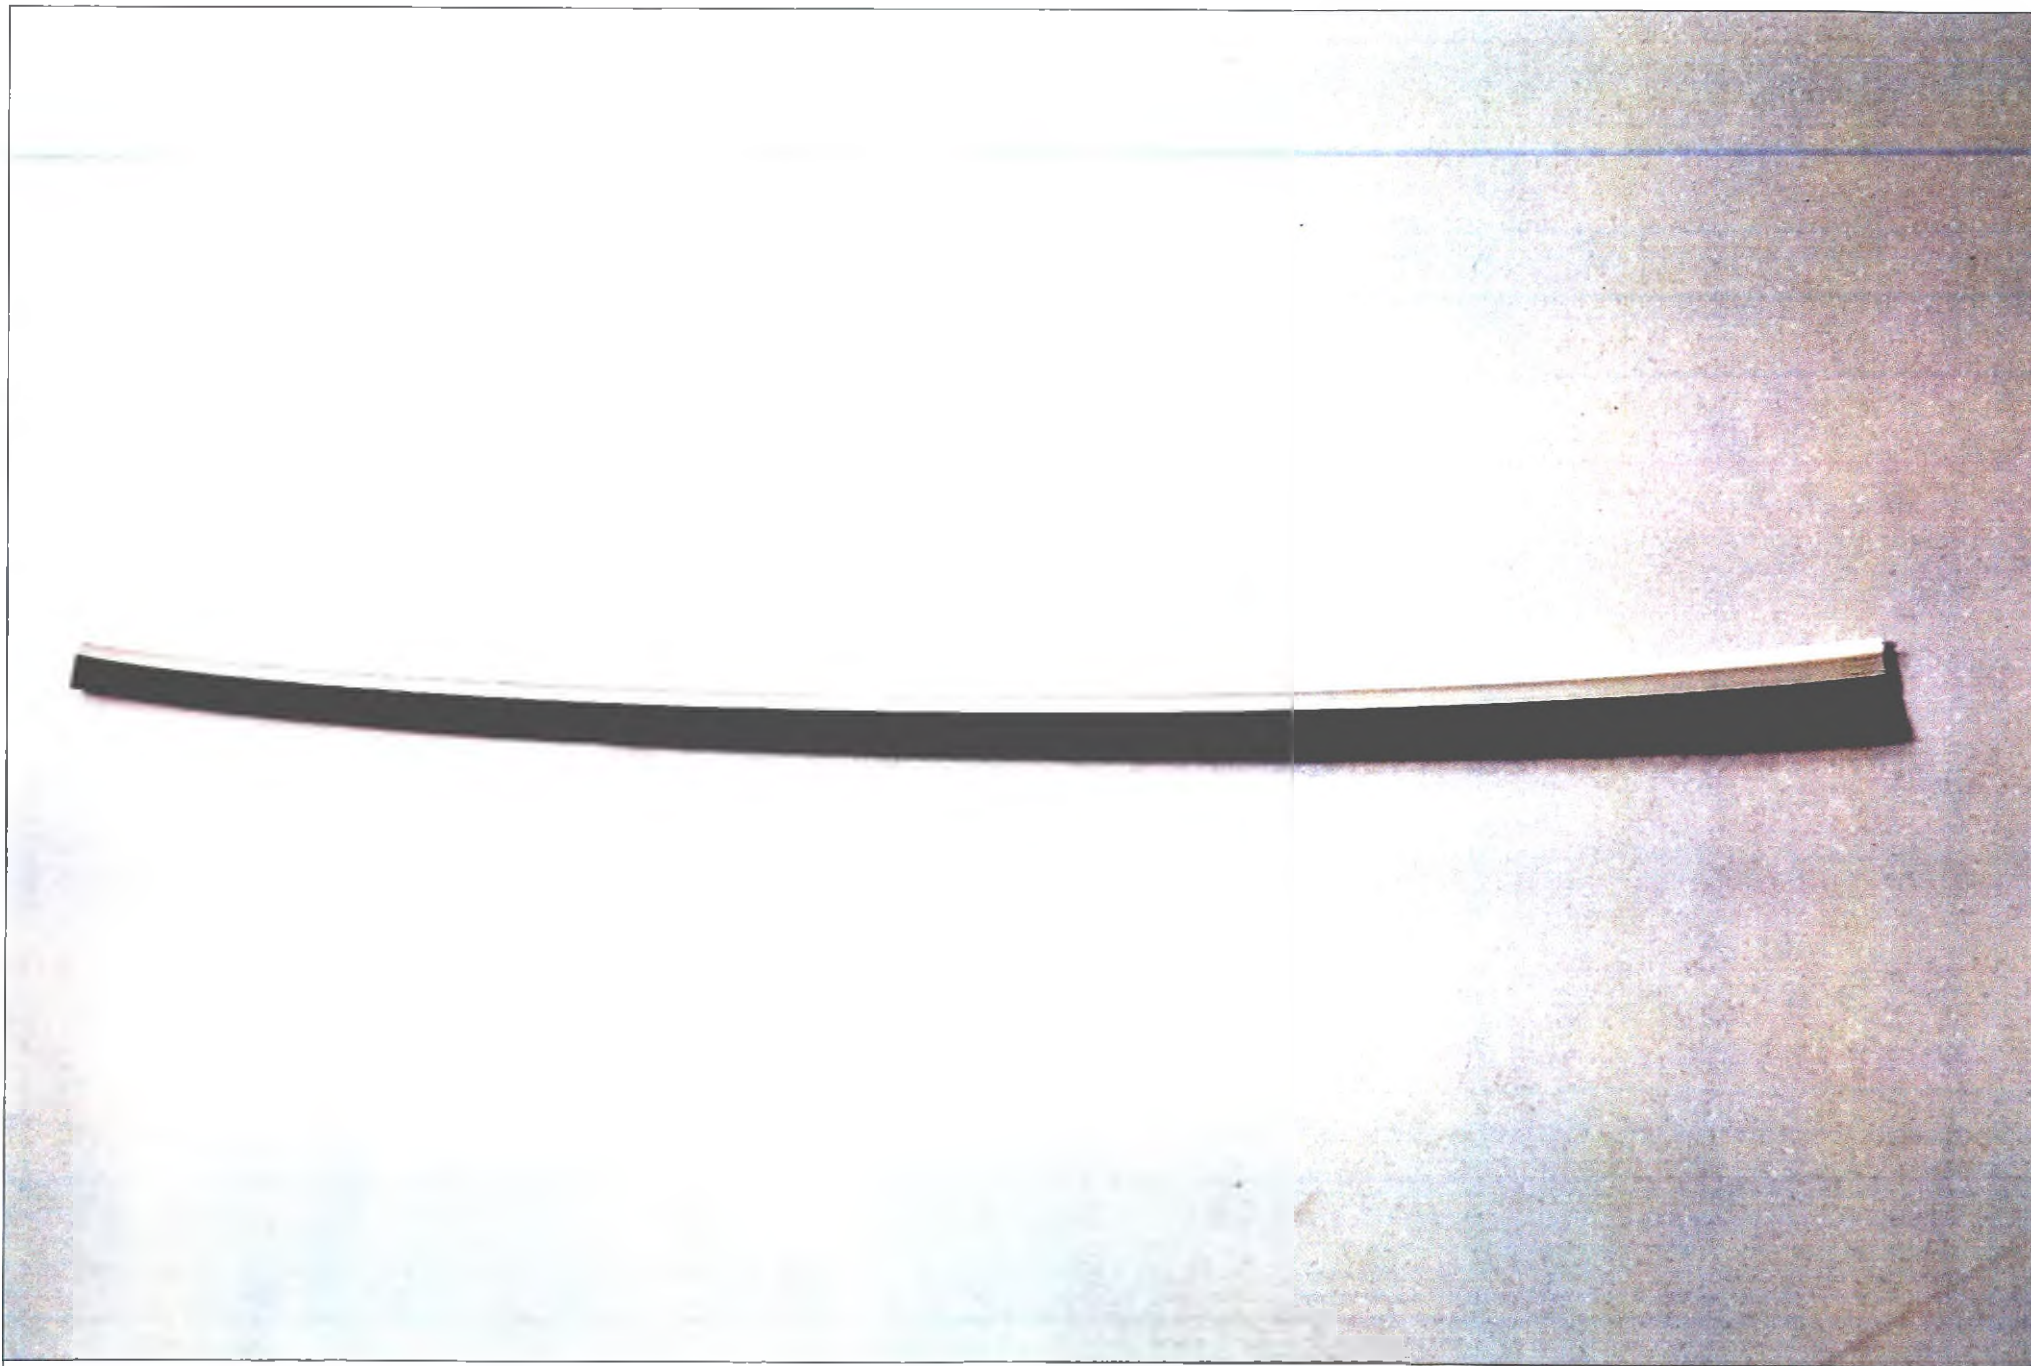


2. Модуль направляющих (не более 2 шт.).



За. Подголовники (не более 3 шт.).




36. Подголовники (не более 3 шт.).

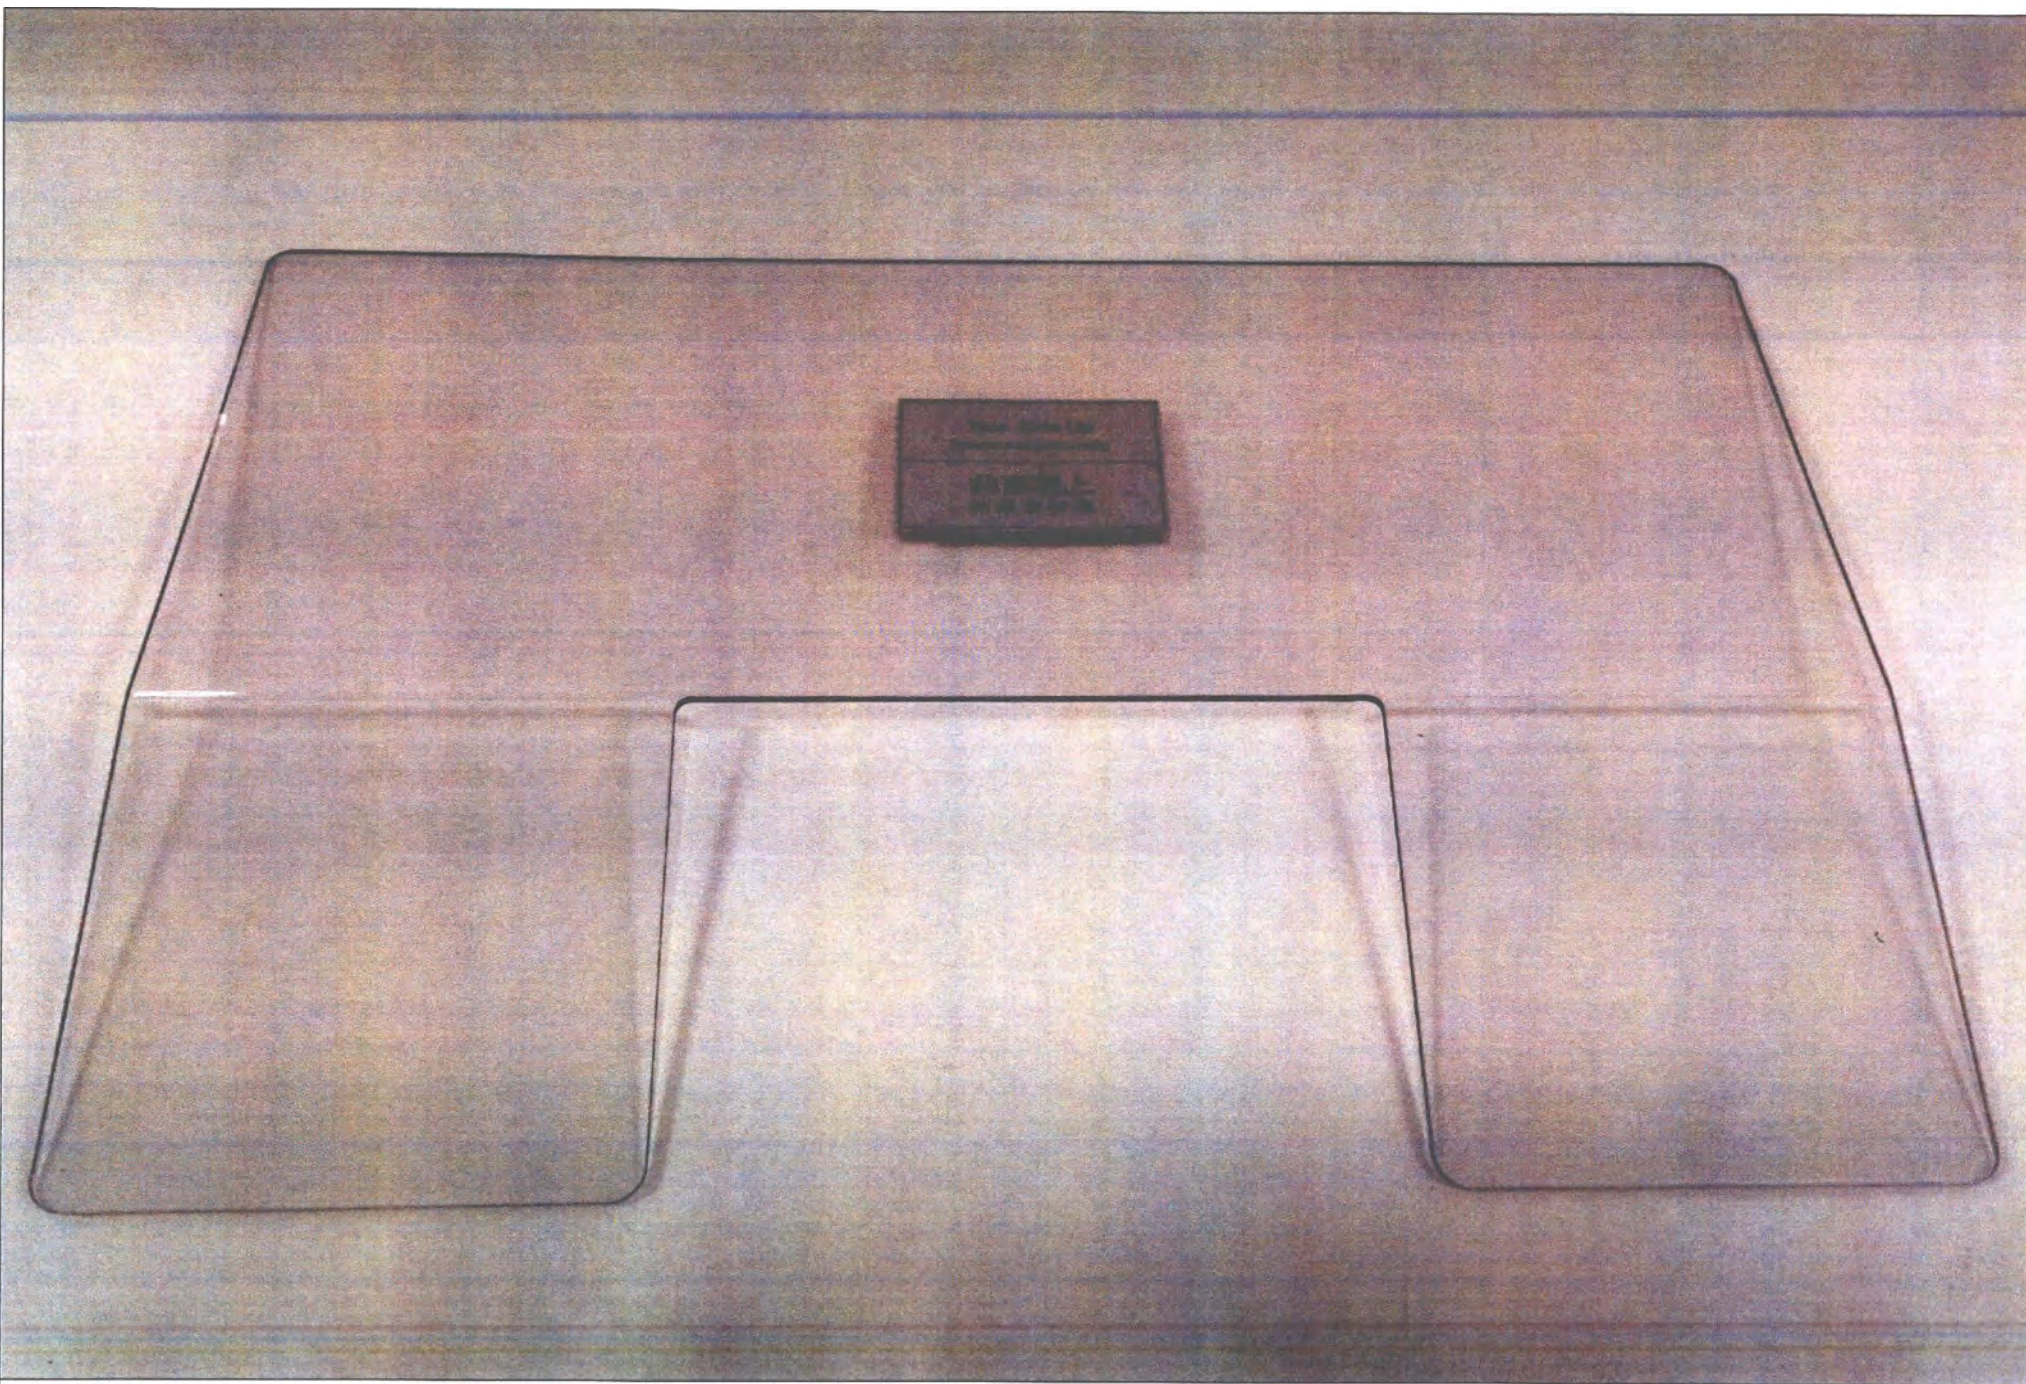


4. Подлокотники (не более 2 шт.).



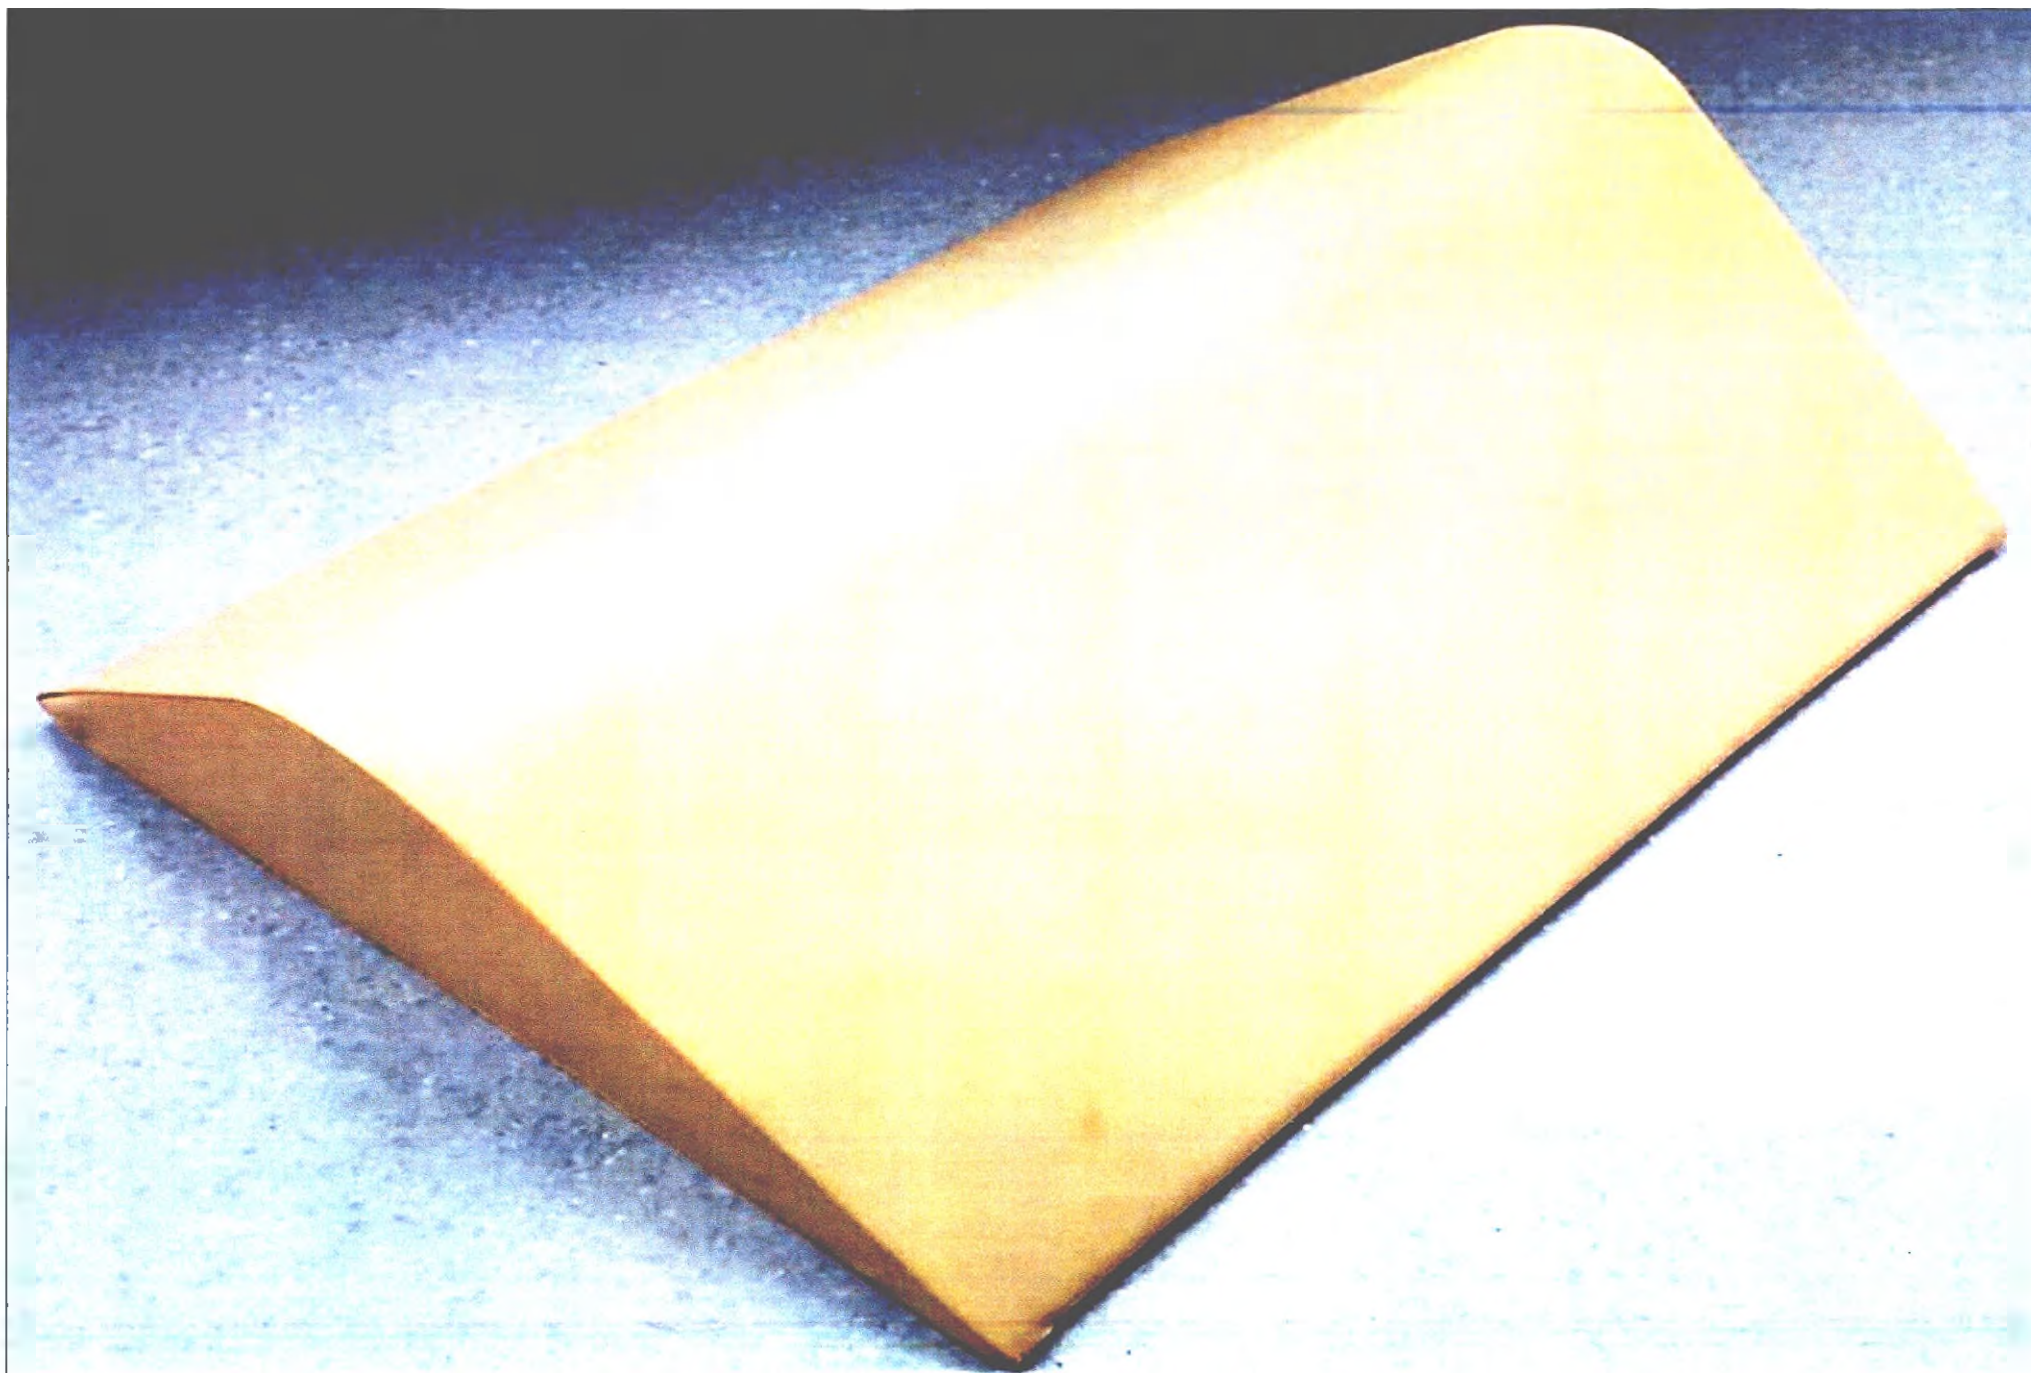


6. Коленная подушка

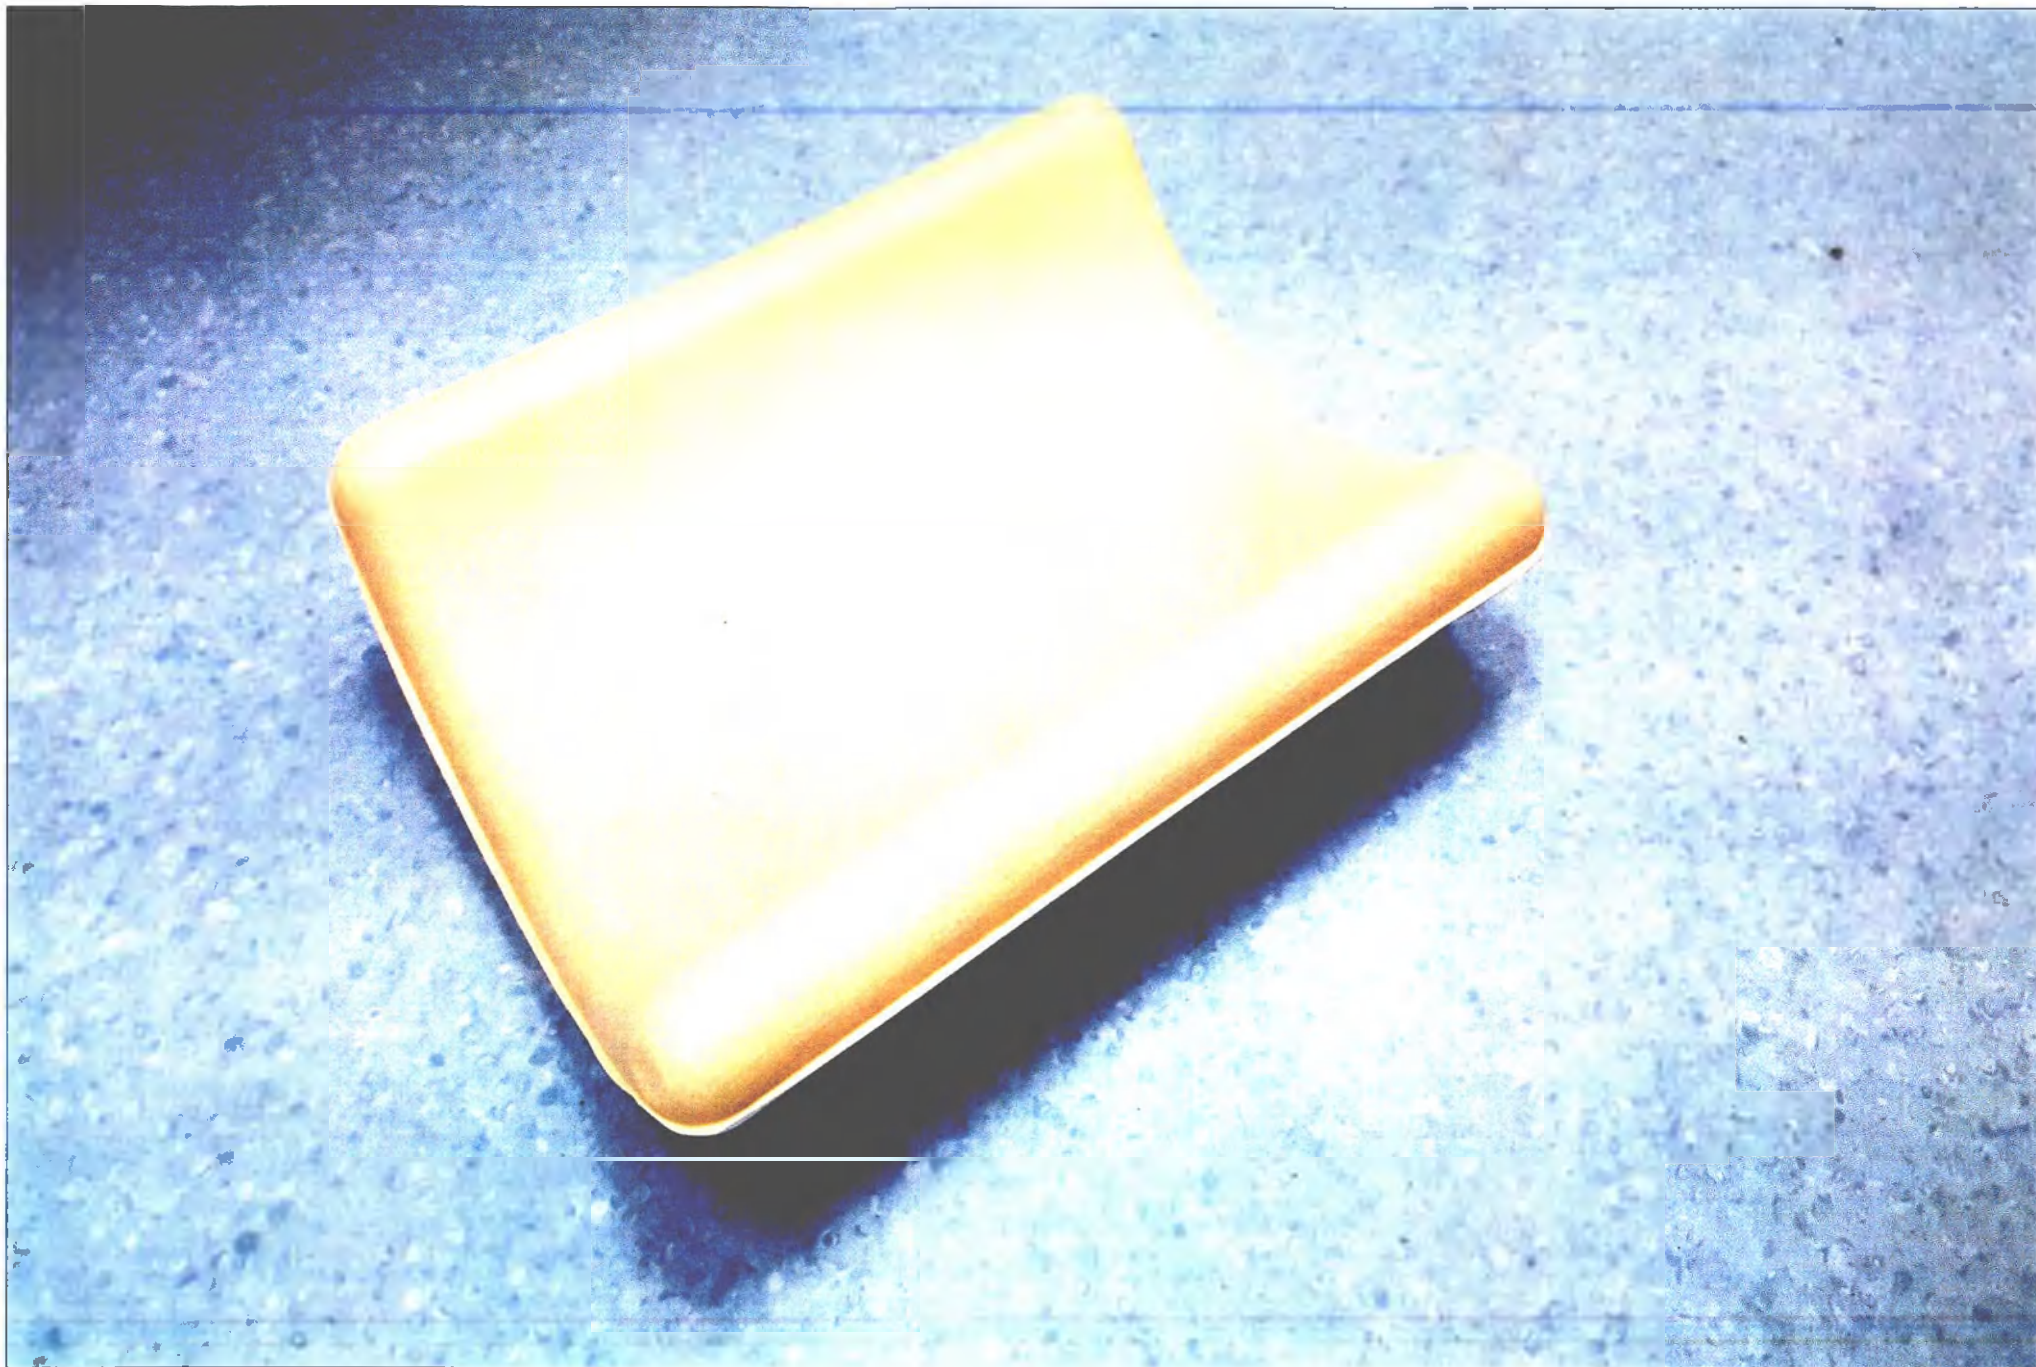


7. Шейная подушка.



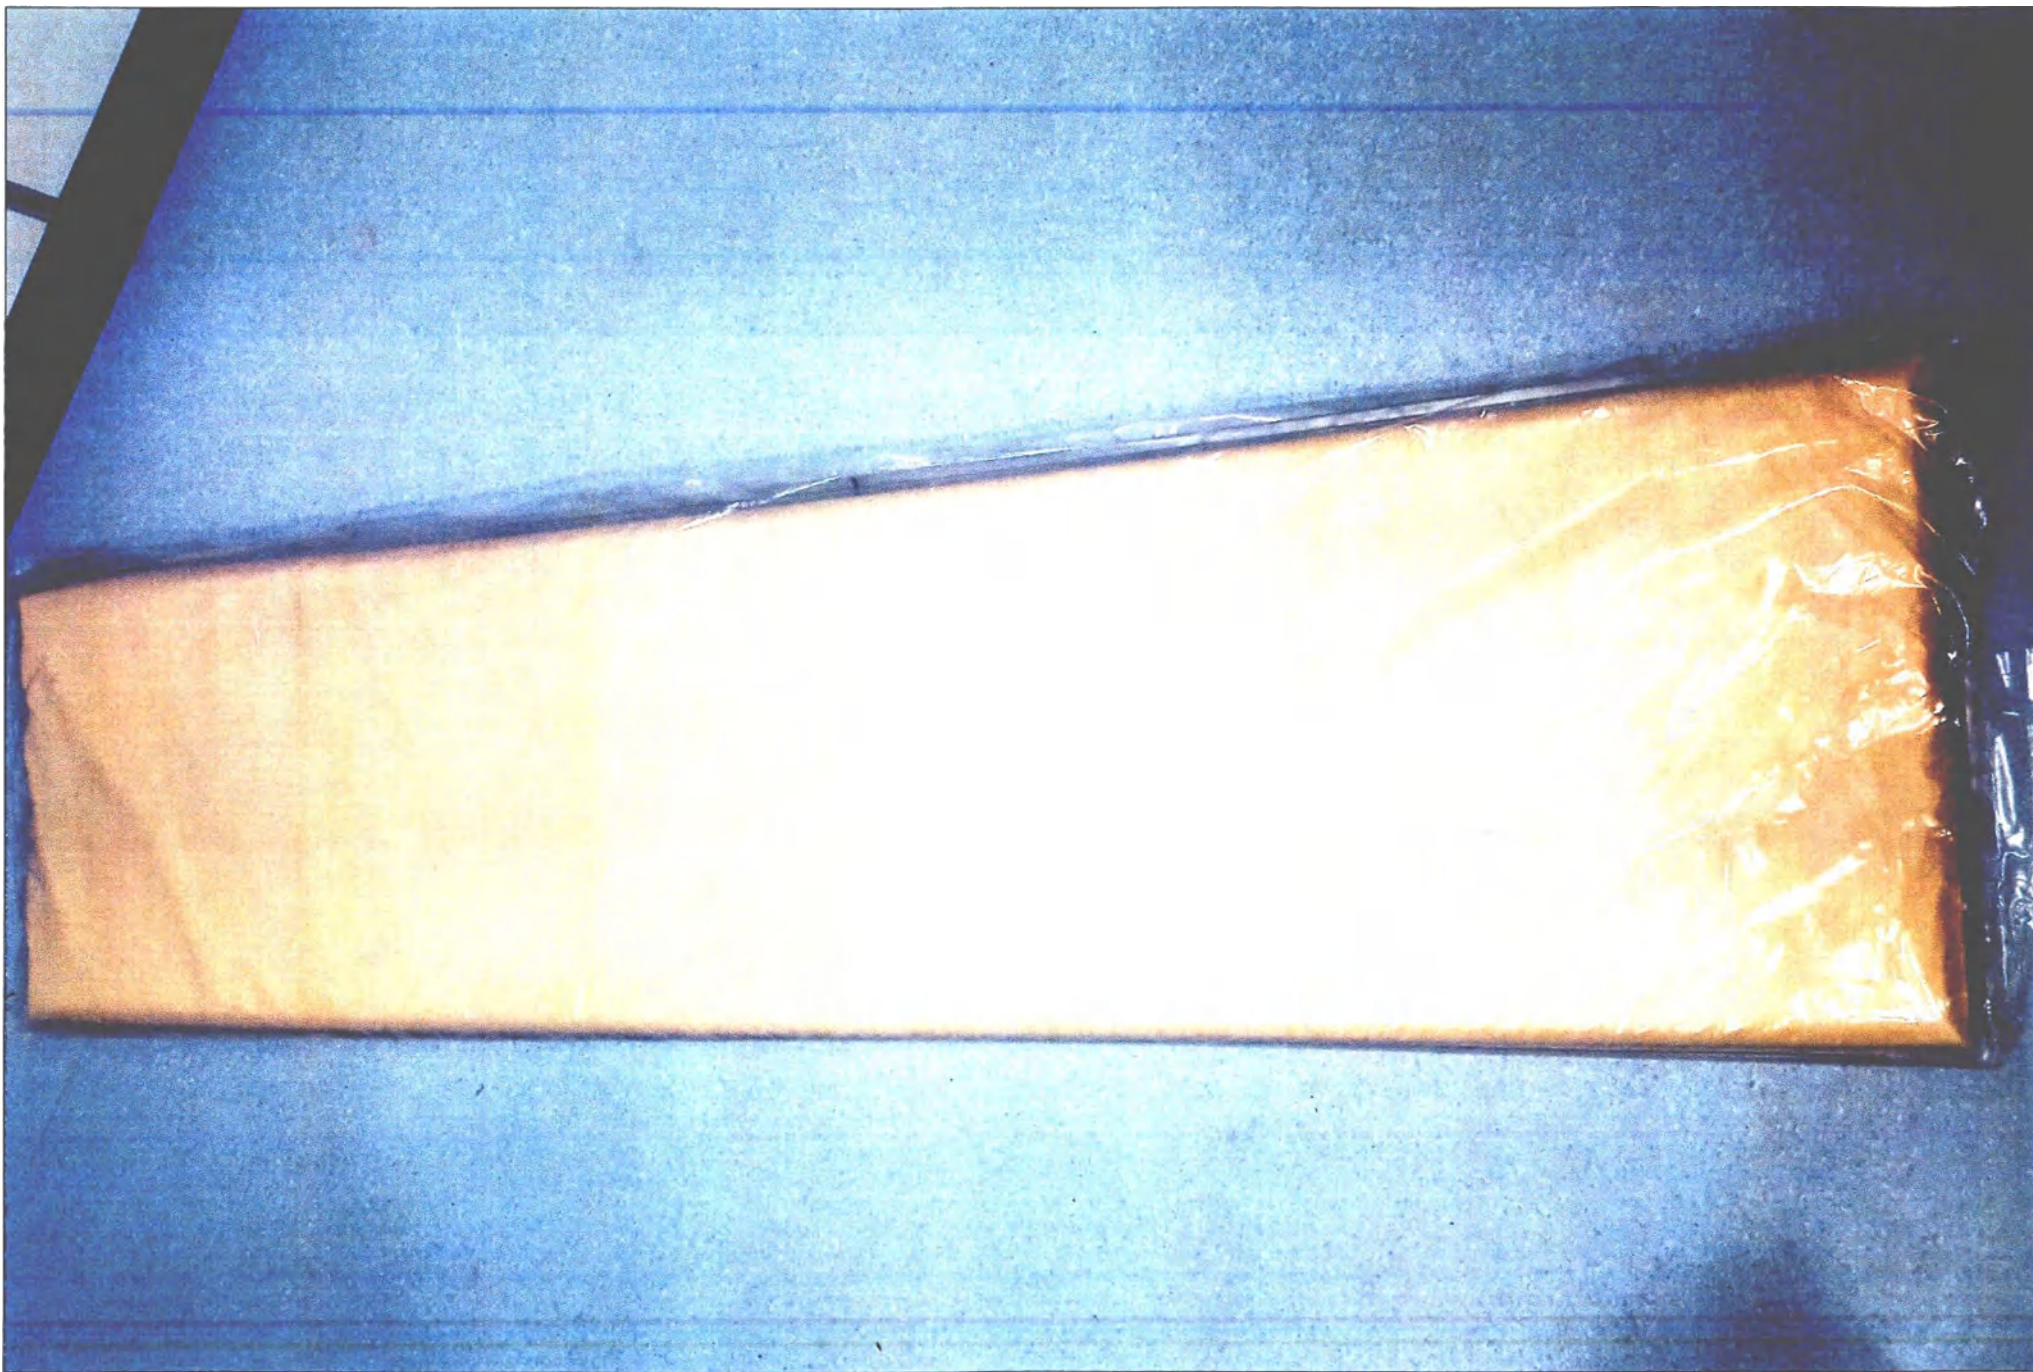


9. Подушка стола.

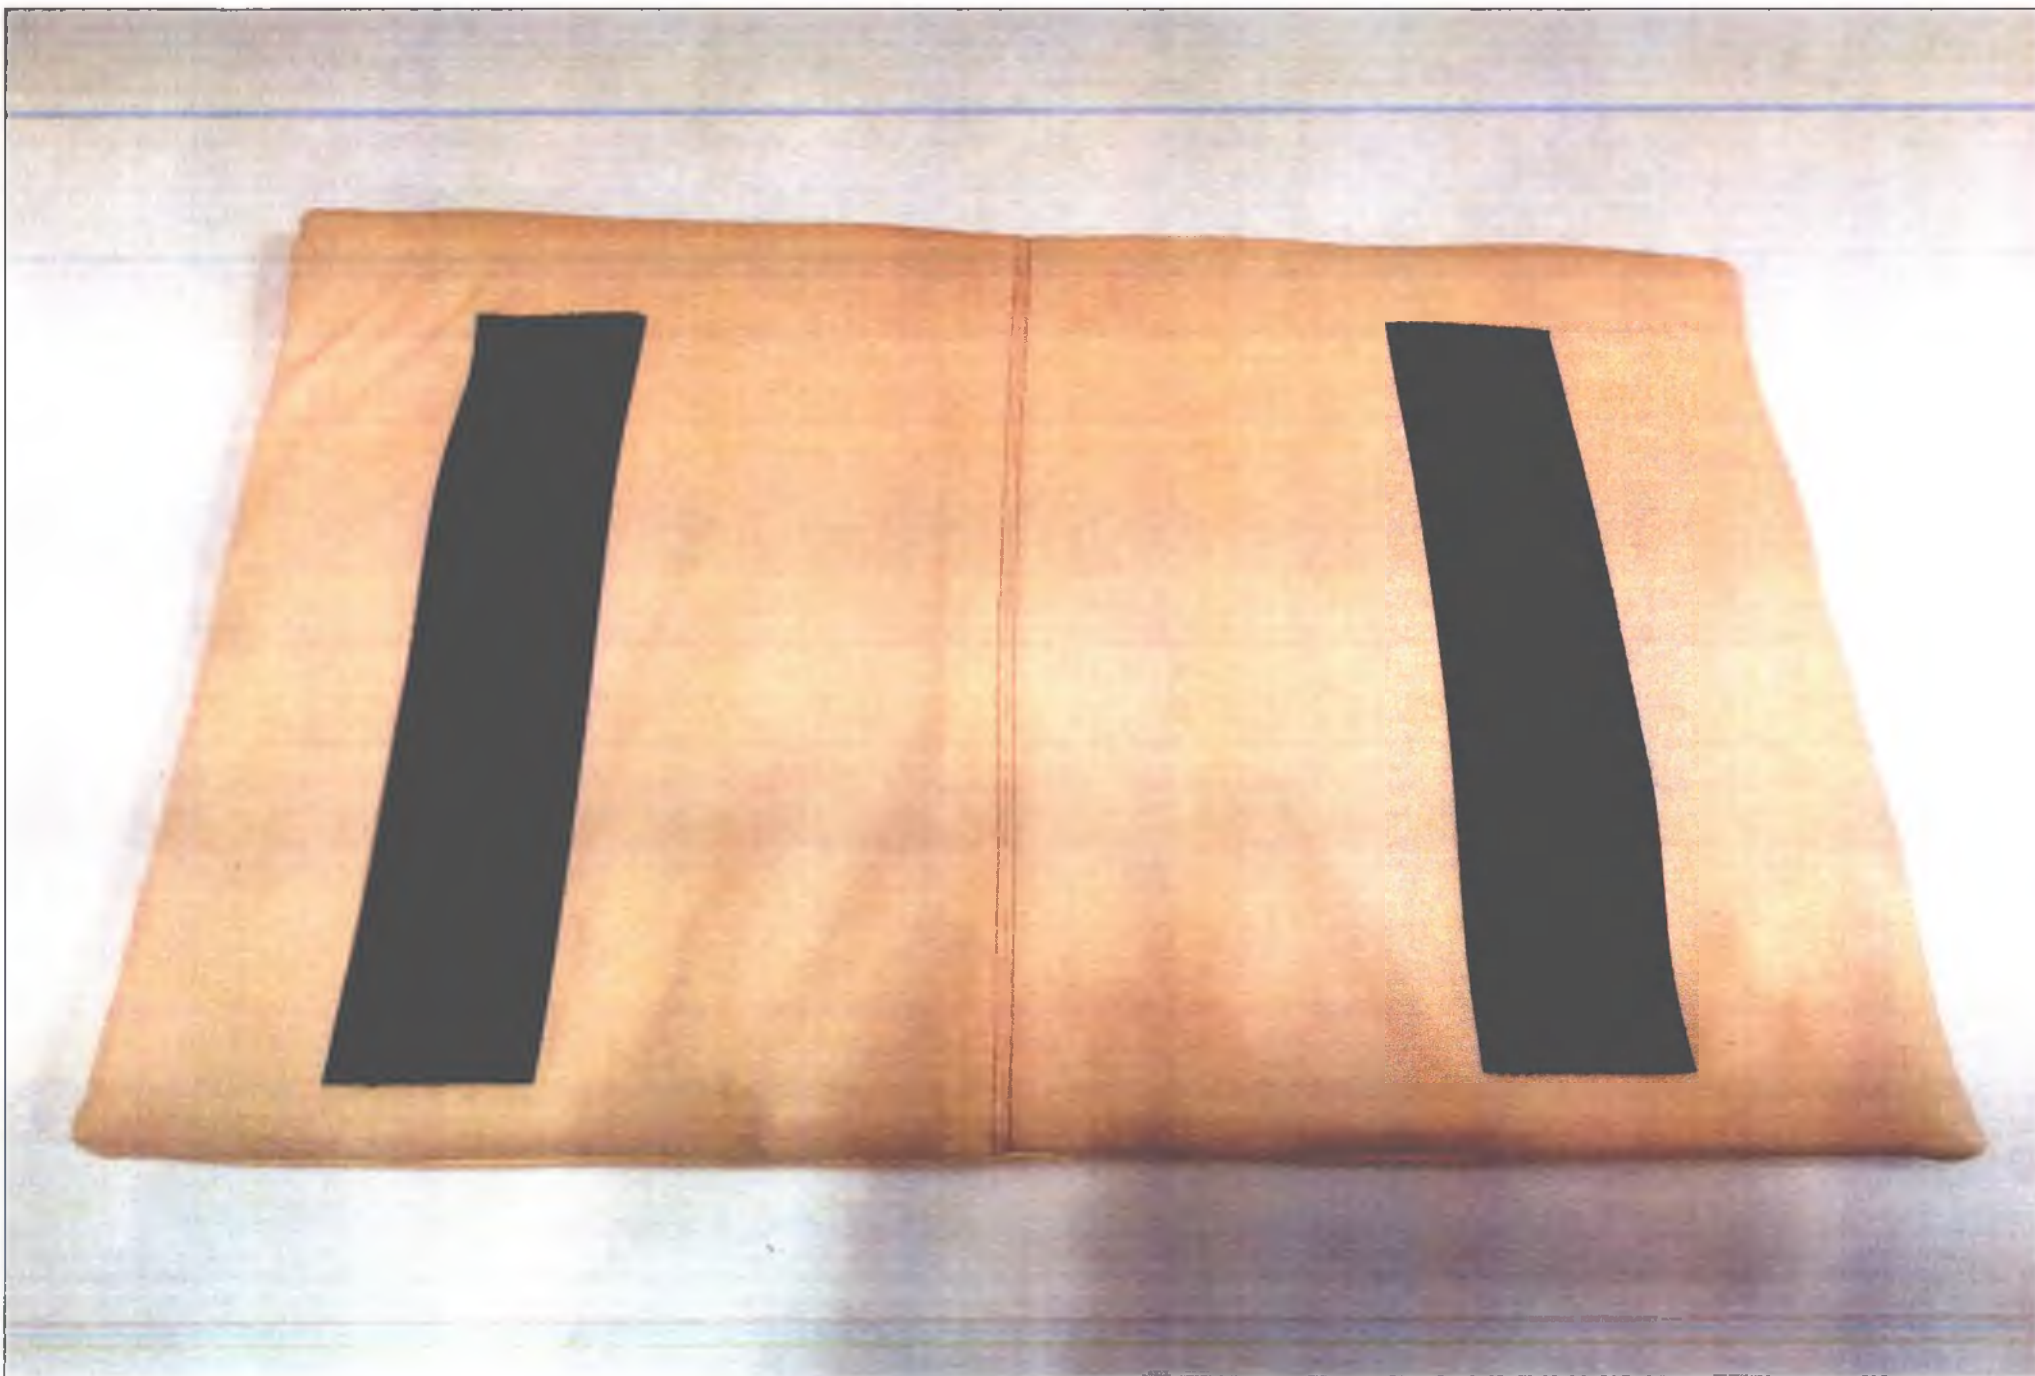




11 Опора для ног

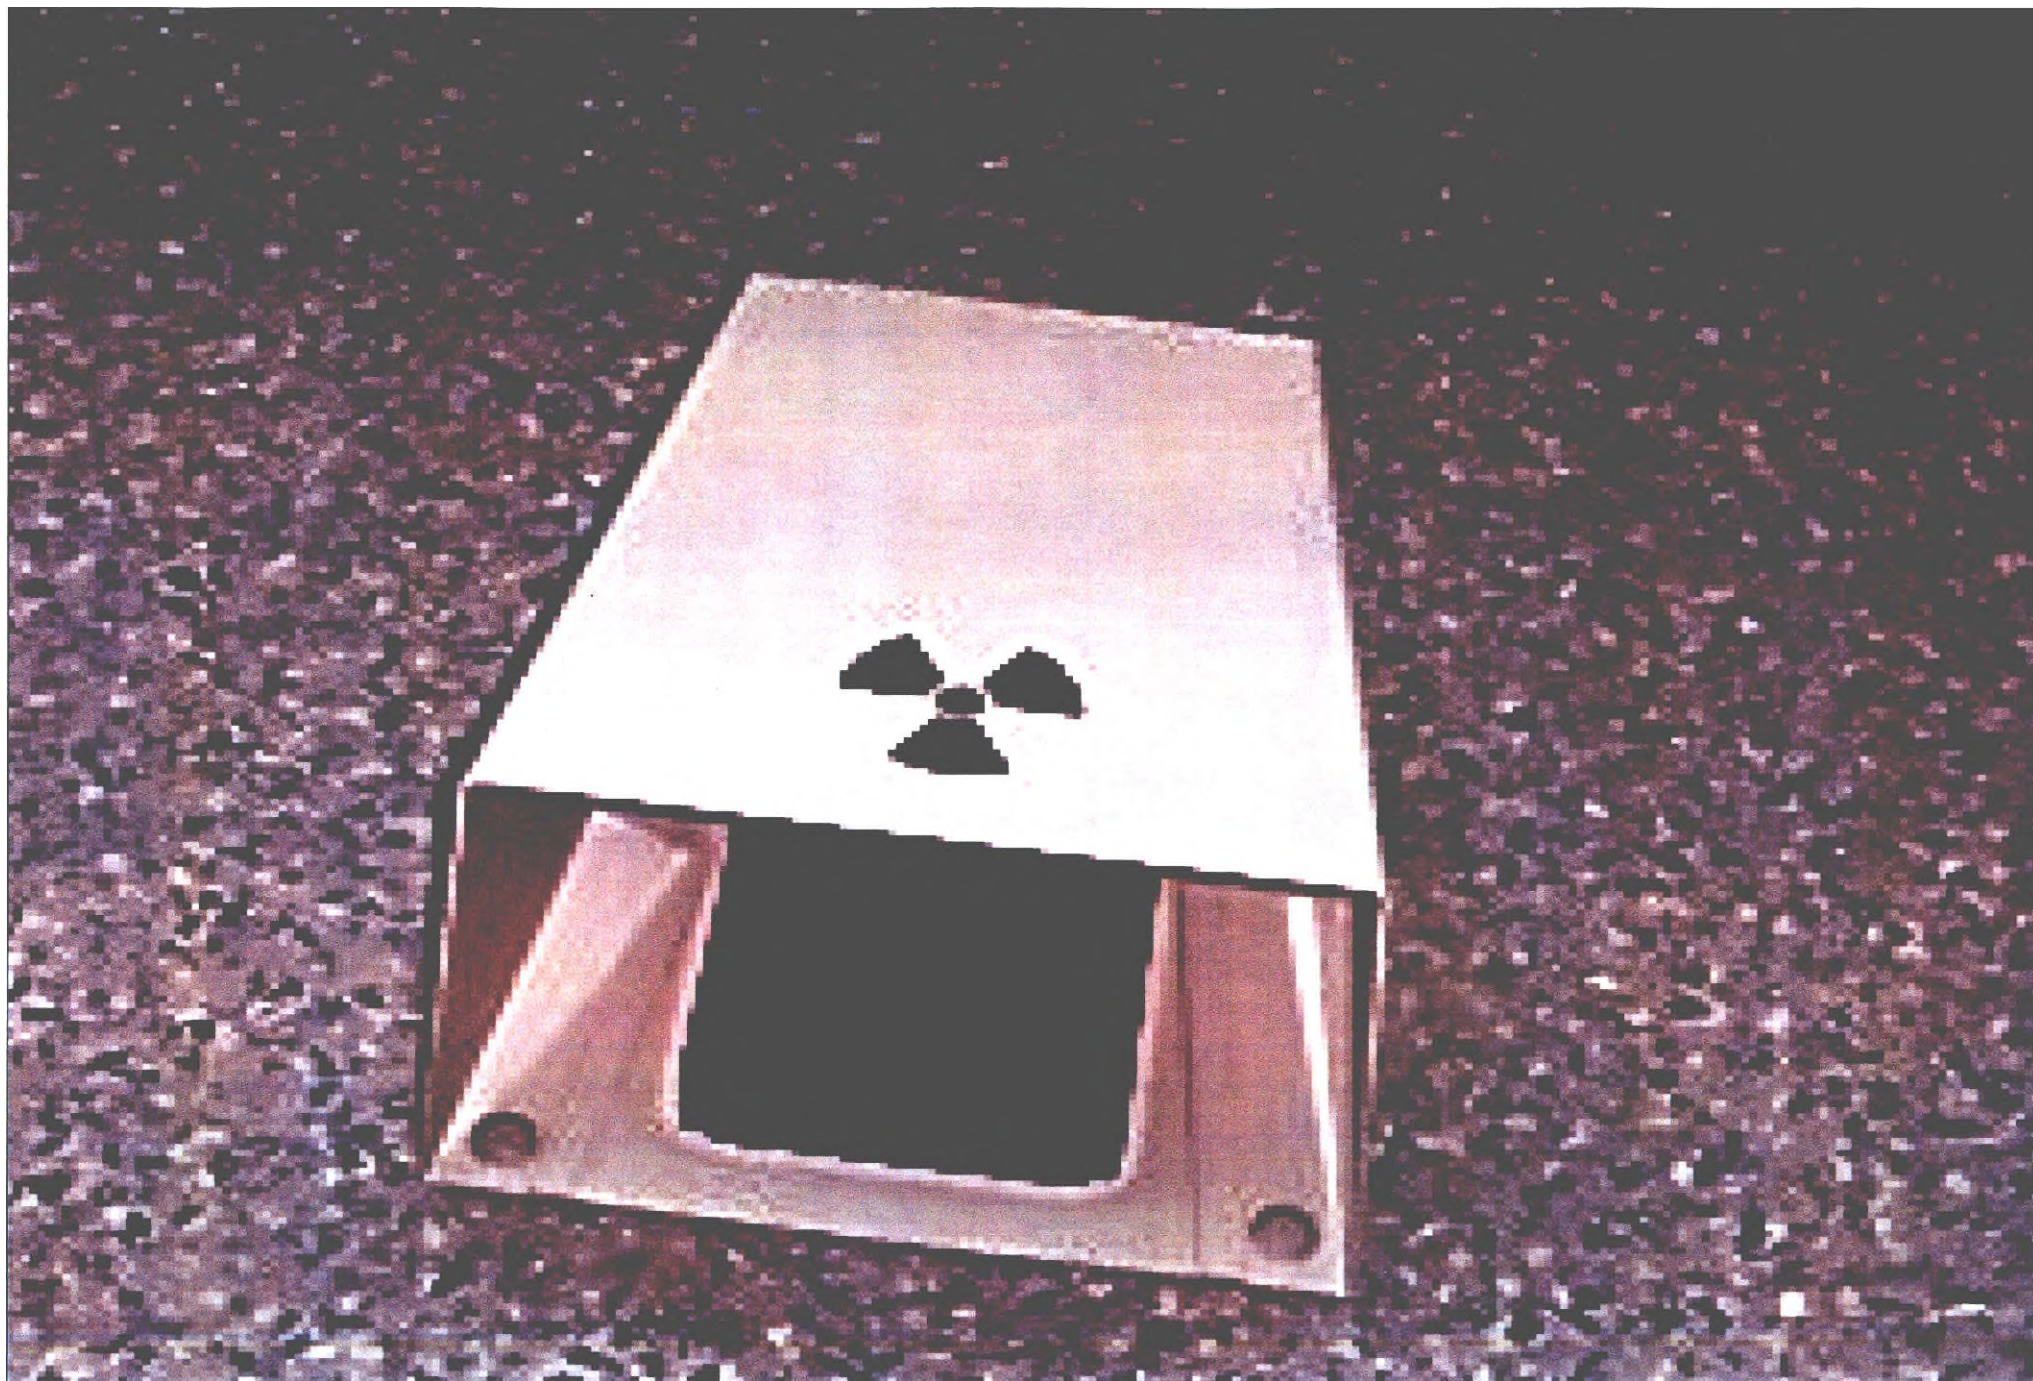

12 Ноженная педаль для непрерывной КТ.

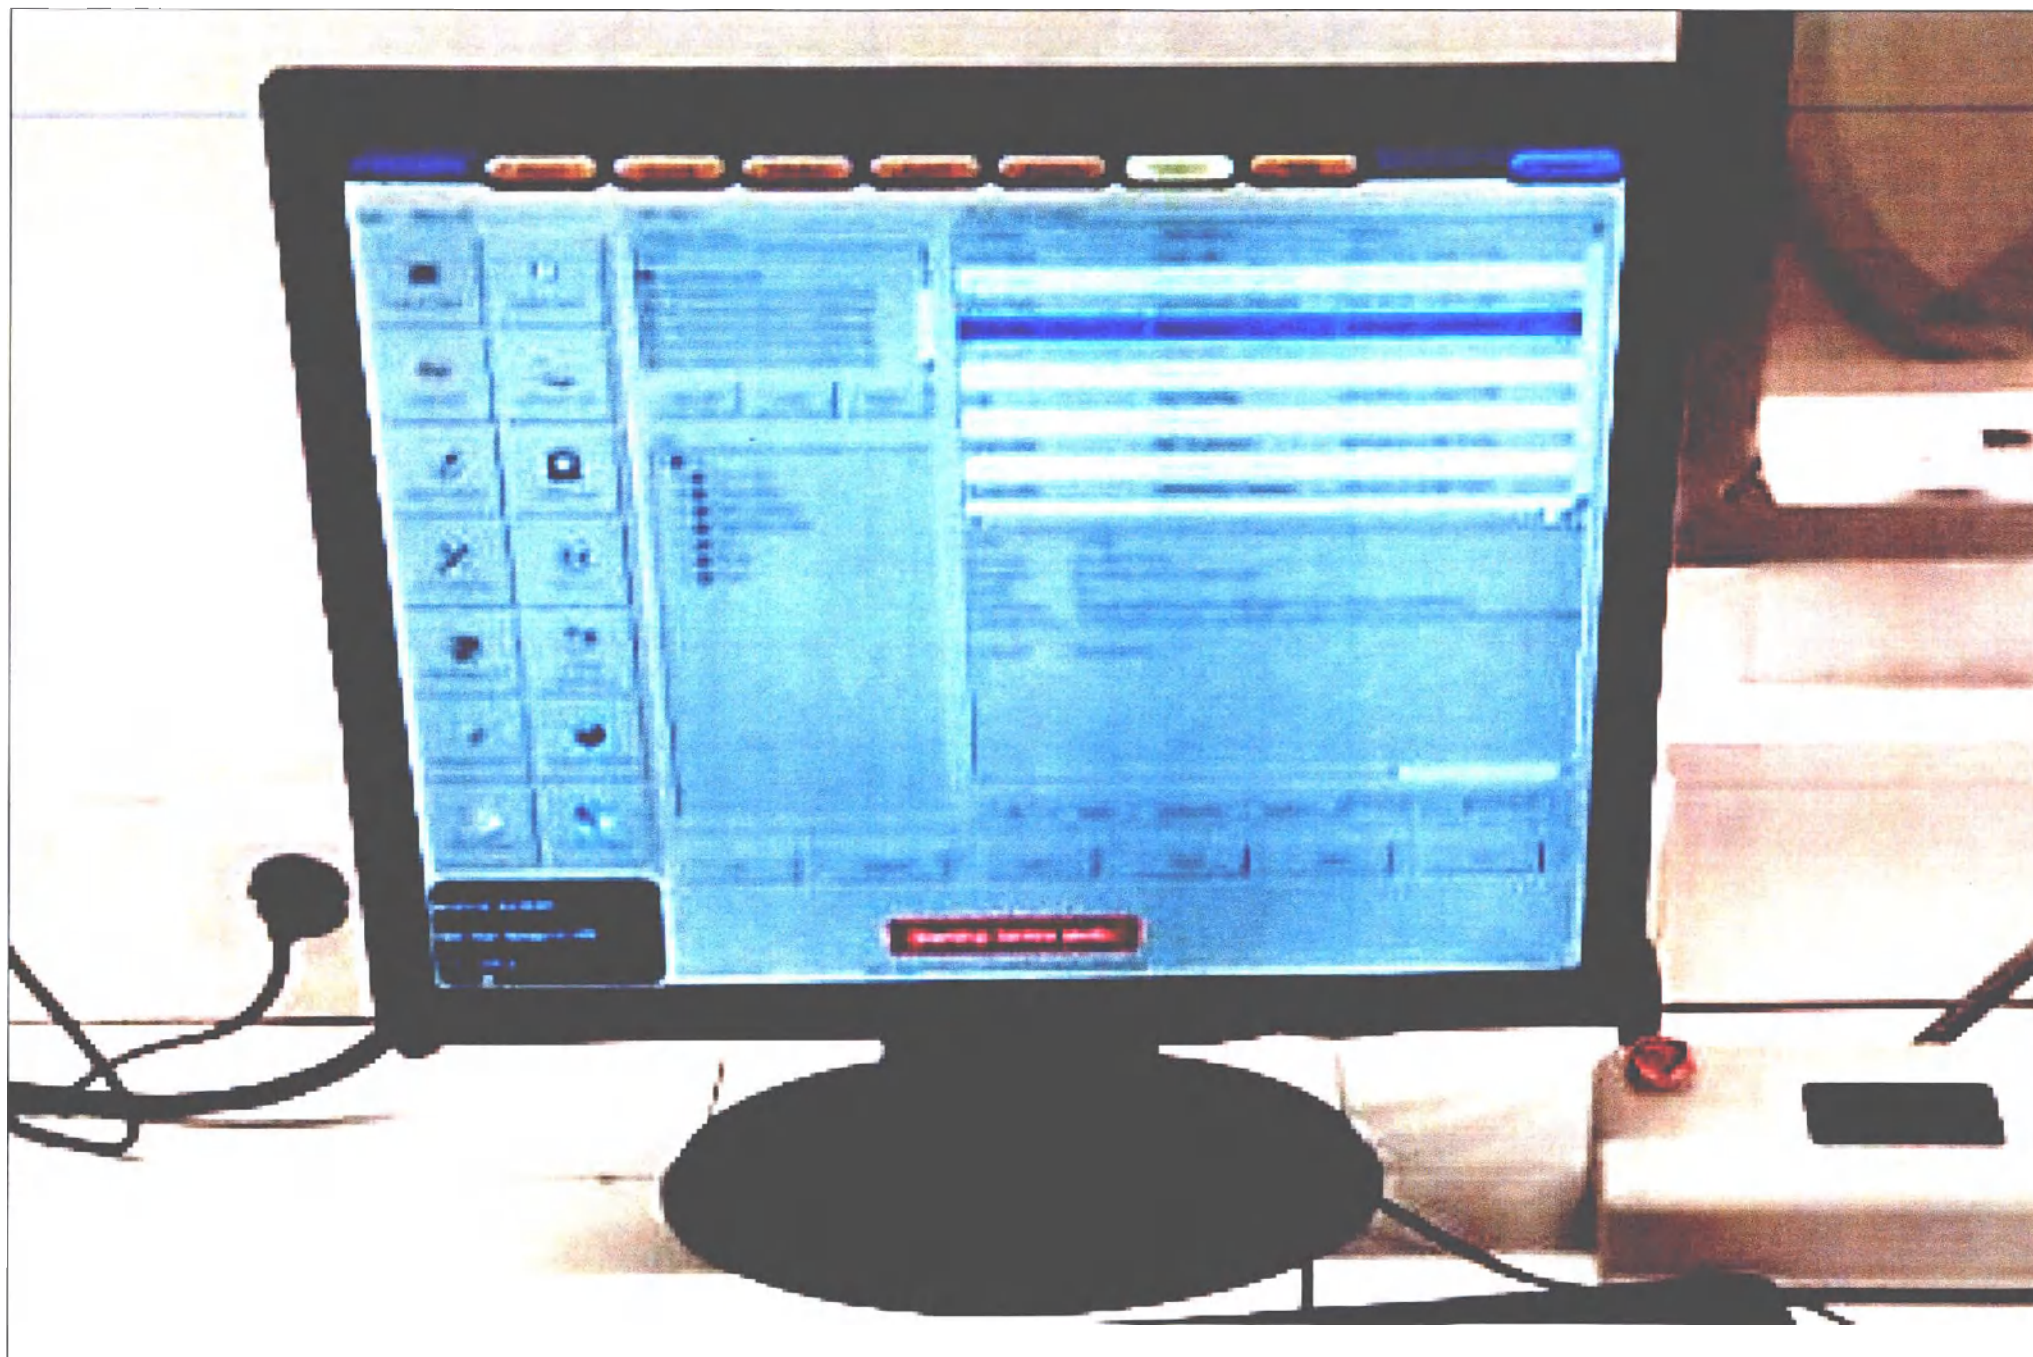


13а. Монитор дополнительный (не более 3 шт.).




136. Монитор дополнительный (не более 3 шт.), на фотографическом изображении представлен совместно с тележкой для монитора.



14. Тележка для монитора (на фотографическом изображении представлена совместно с монитором дополнительным).

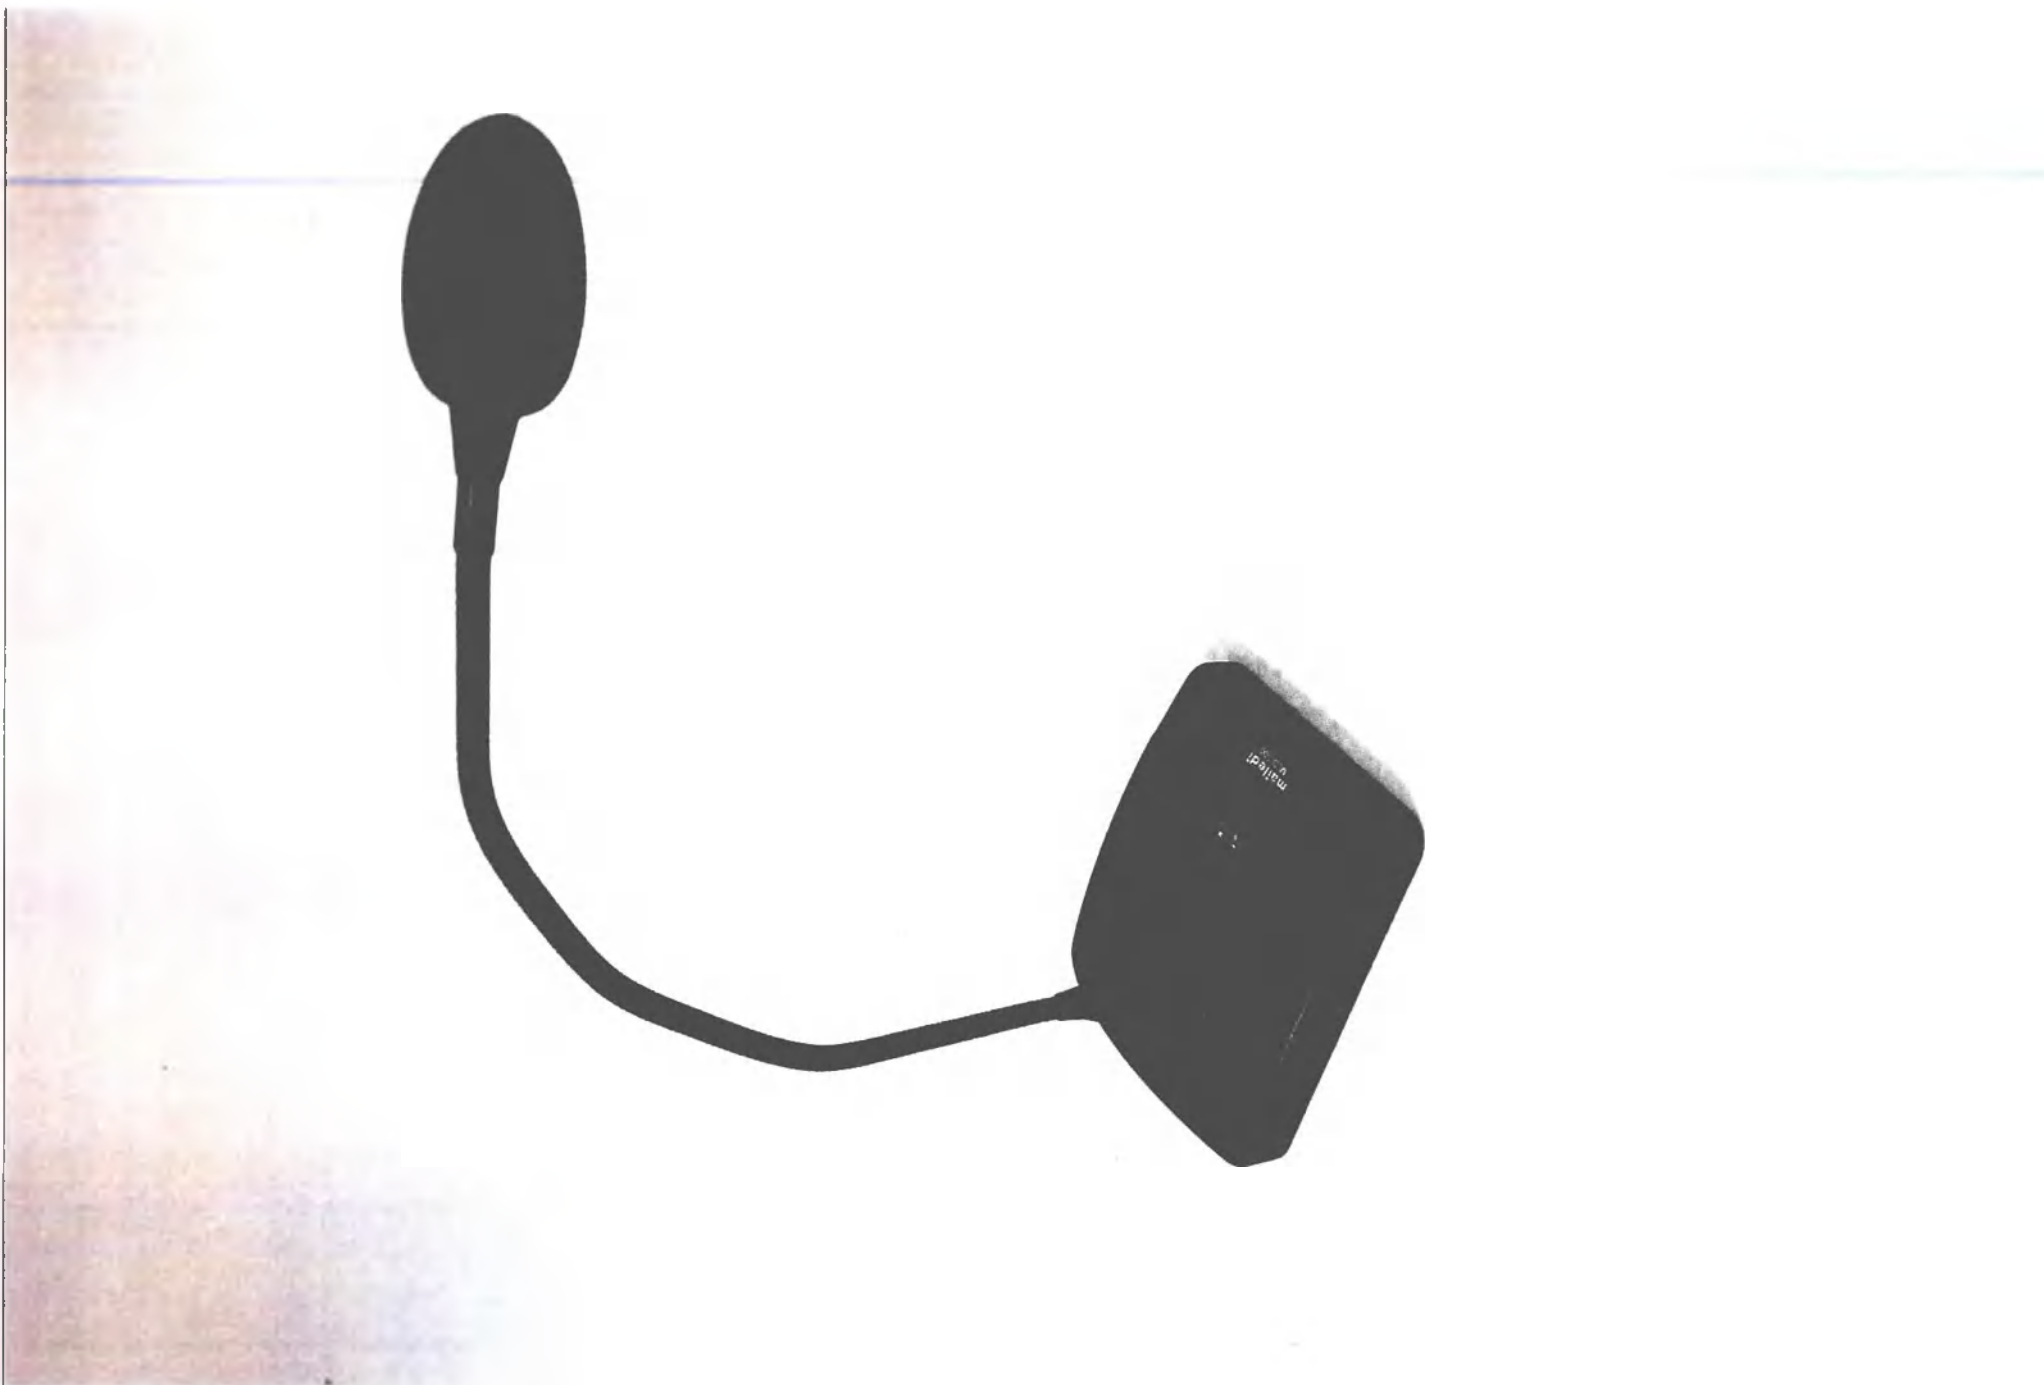


15. Записывающий микрофон.

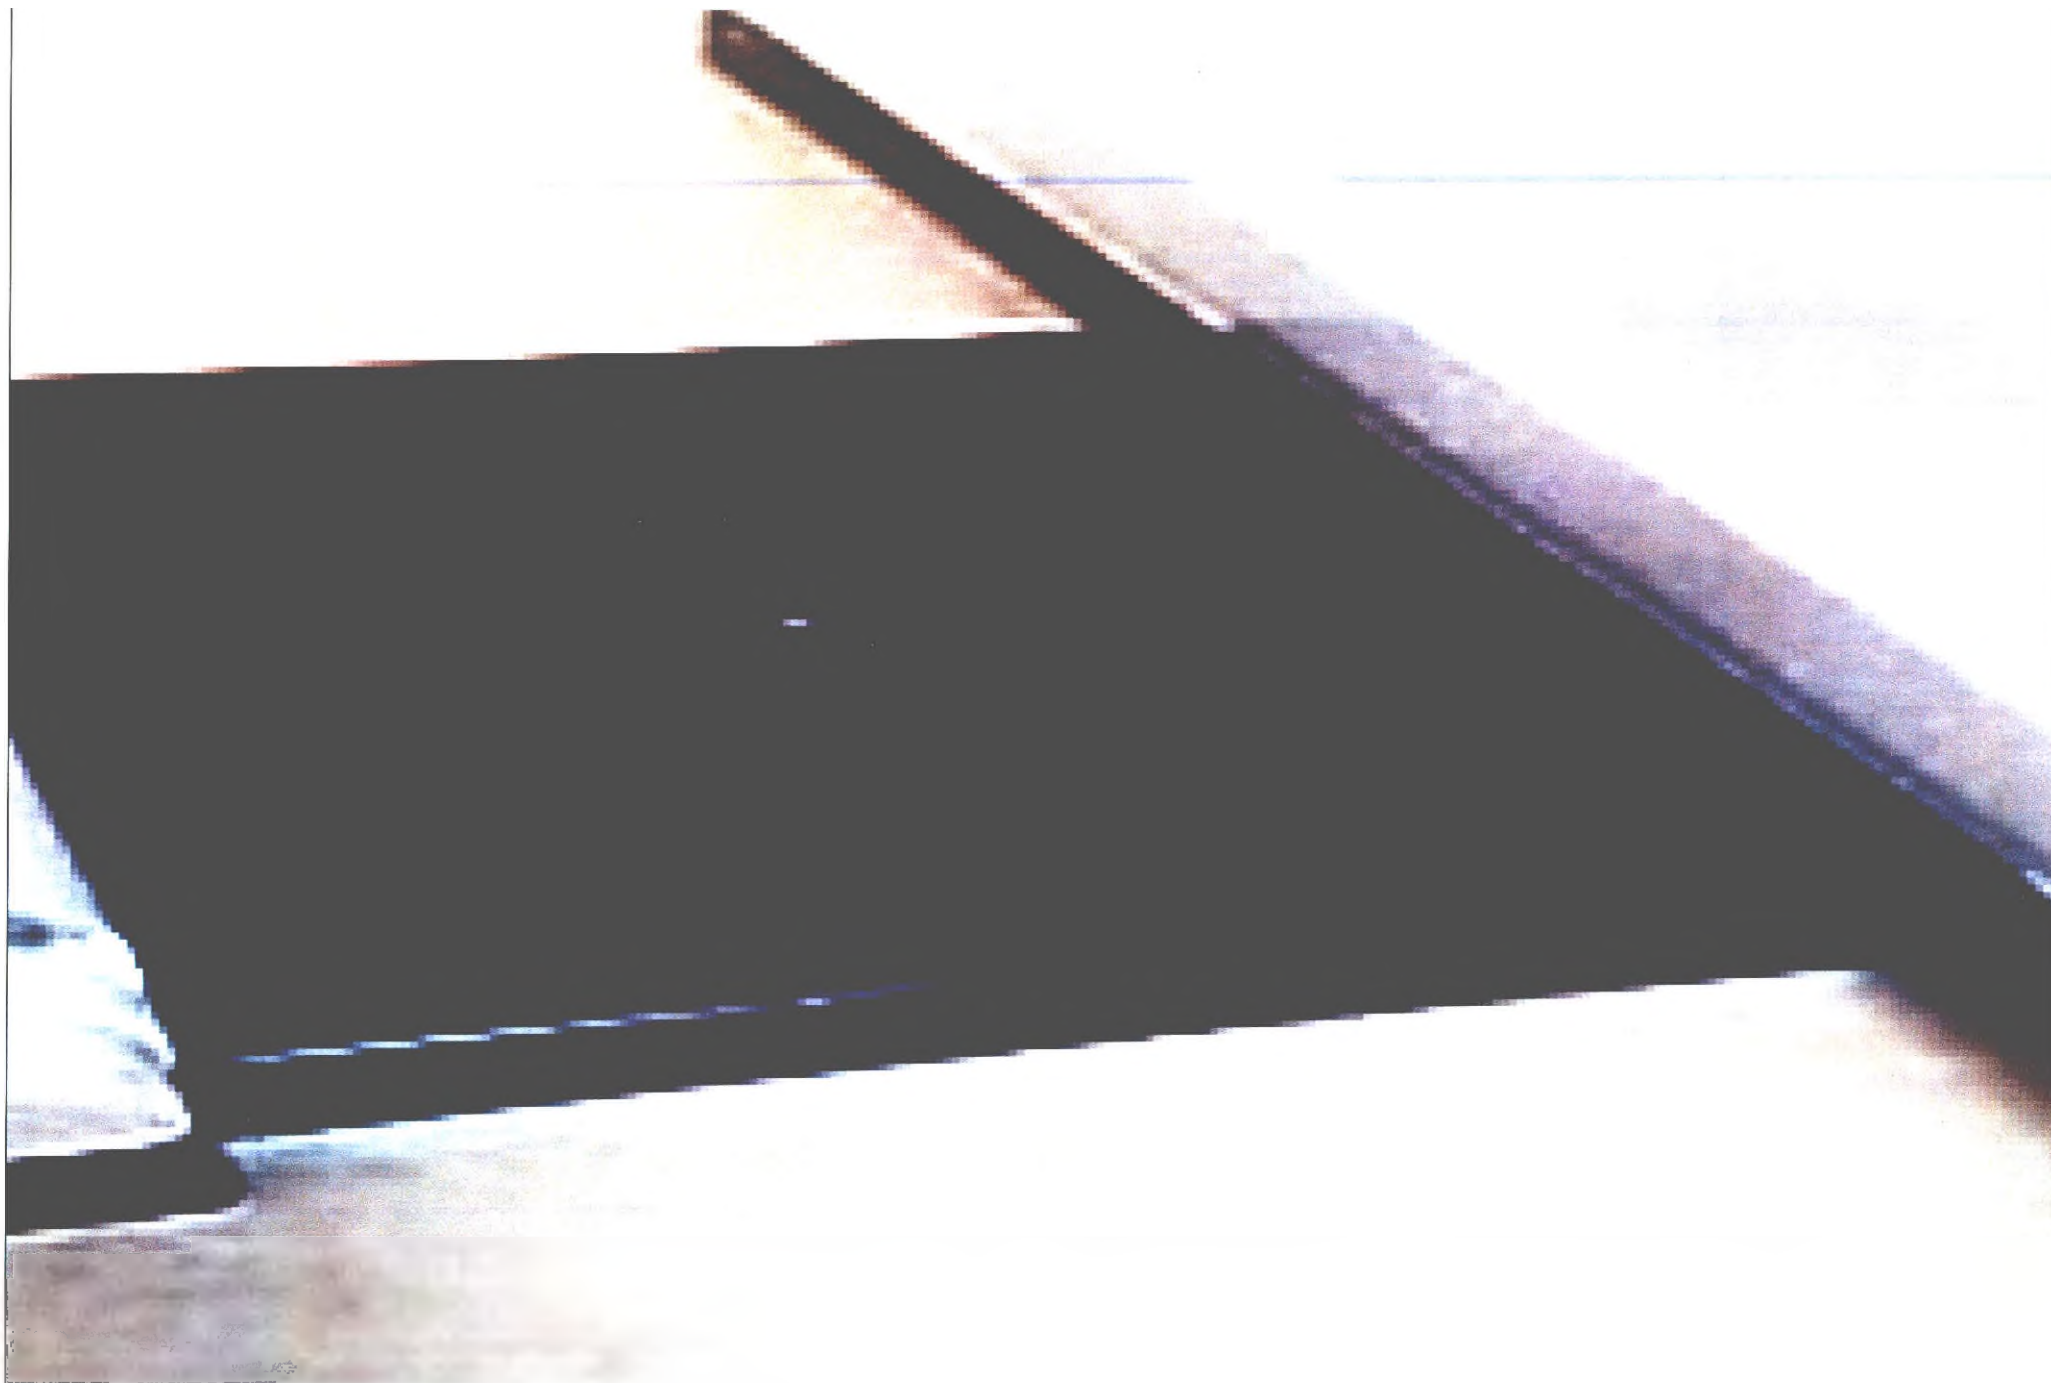

16. Педаль для управления столом пациента.




17. Фантом головы и тела для проверки качества изображения.

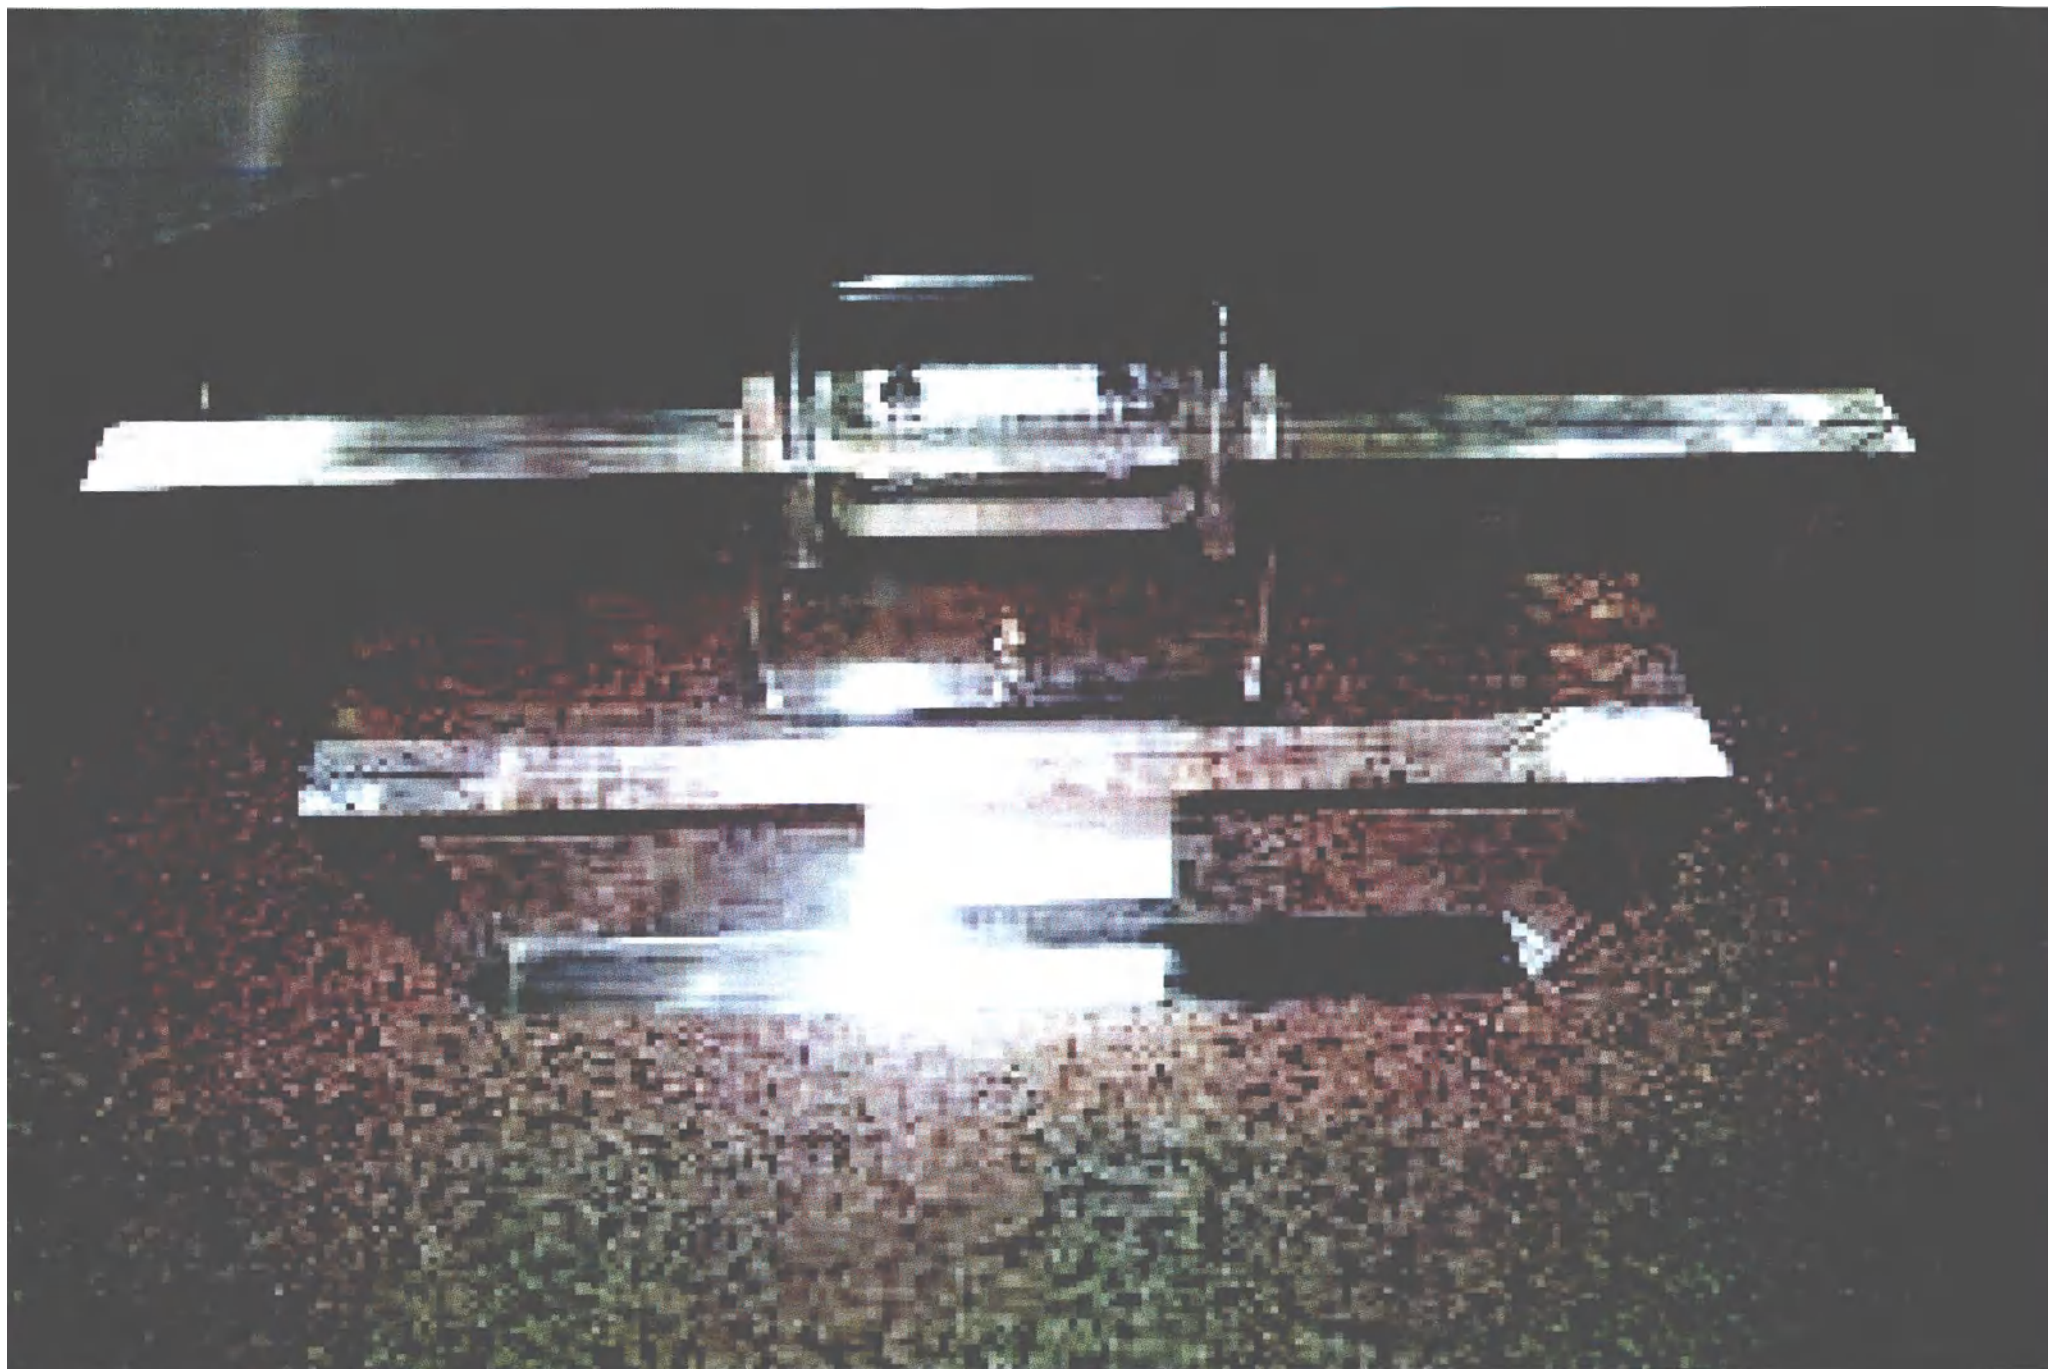


18. Ступенчатый калибровочный фантом.



19. Водяной калибровочный фантом.

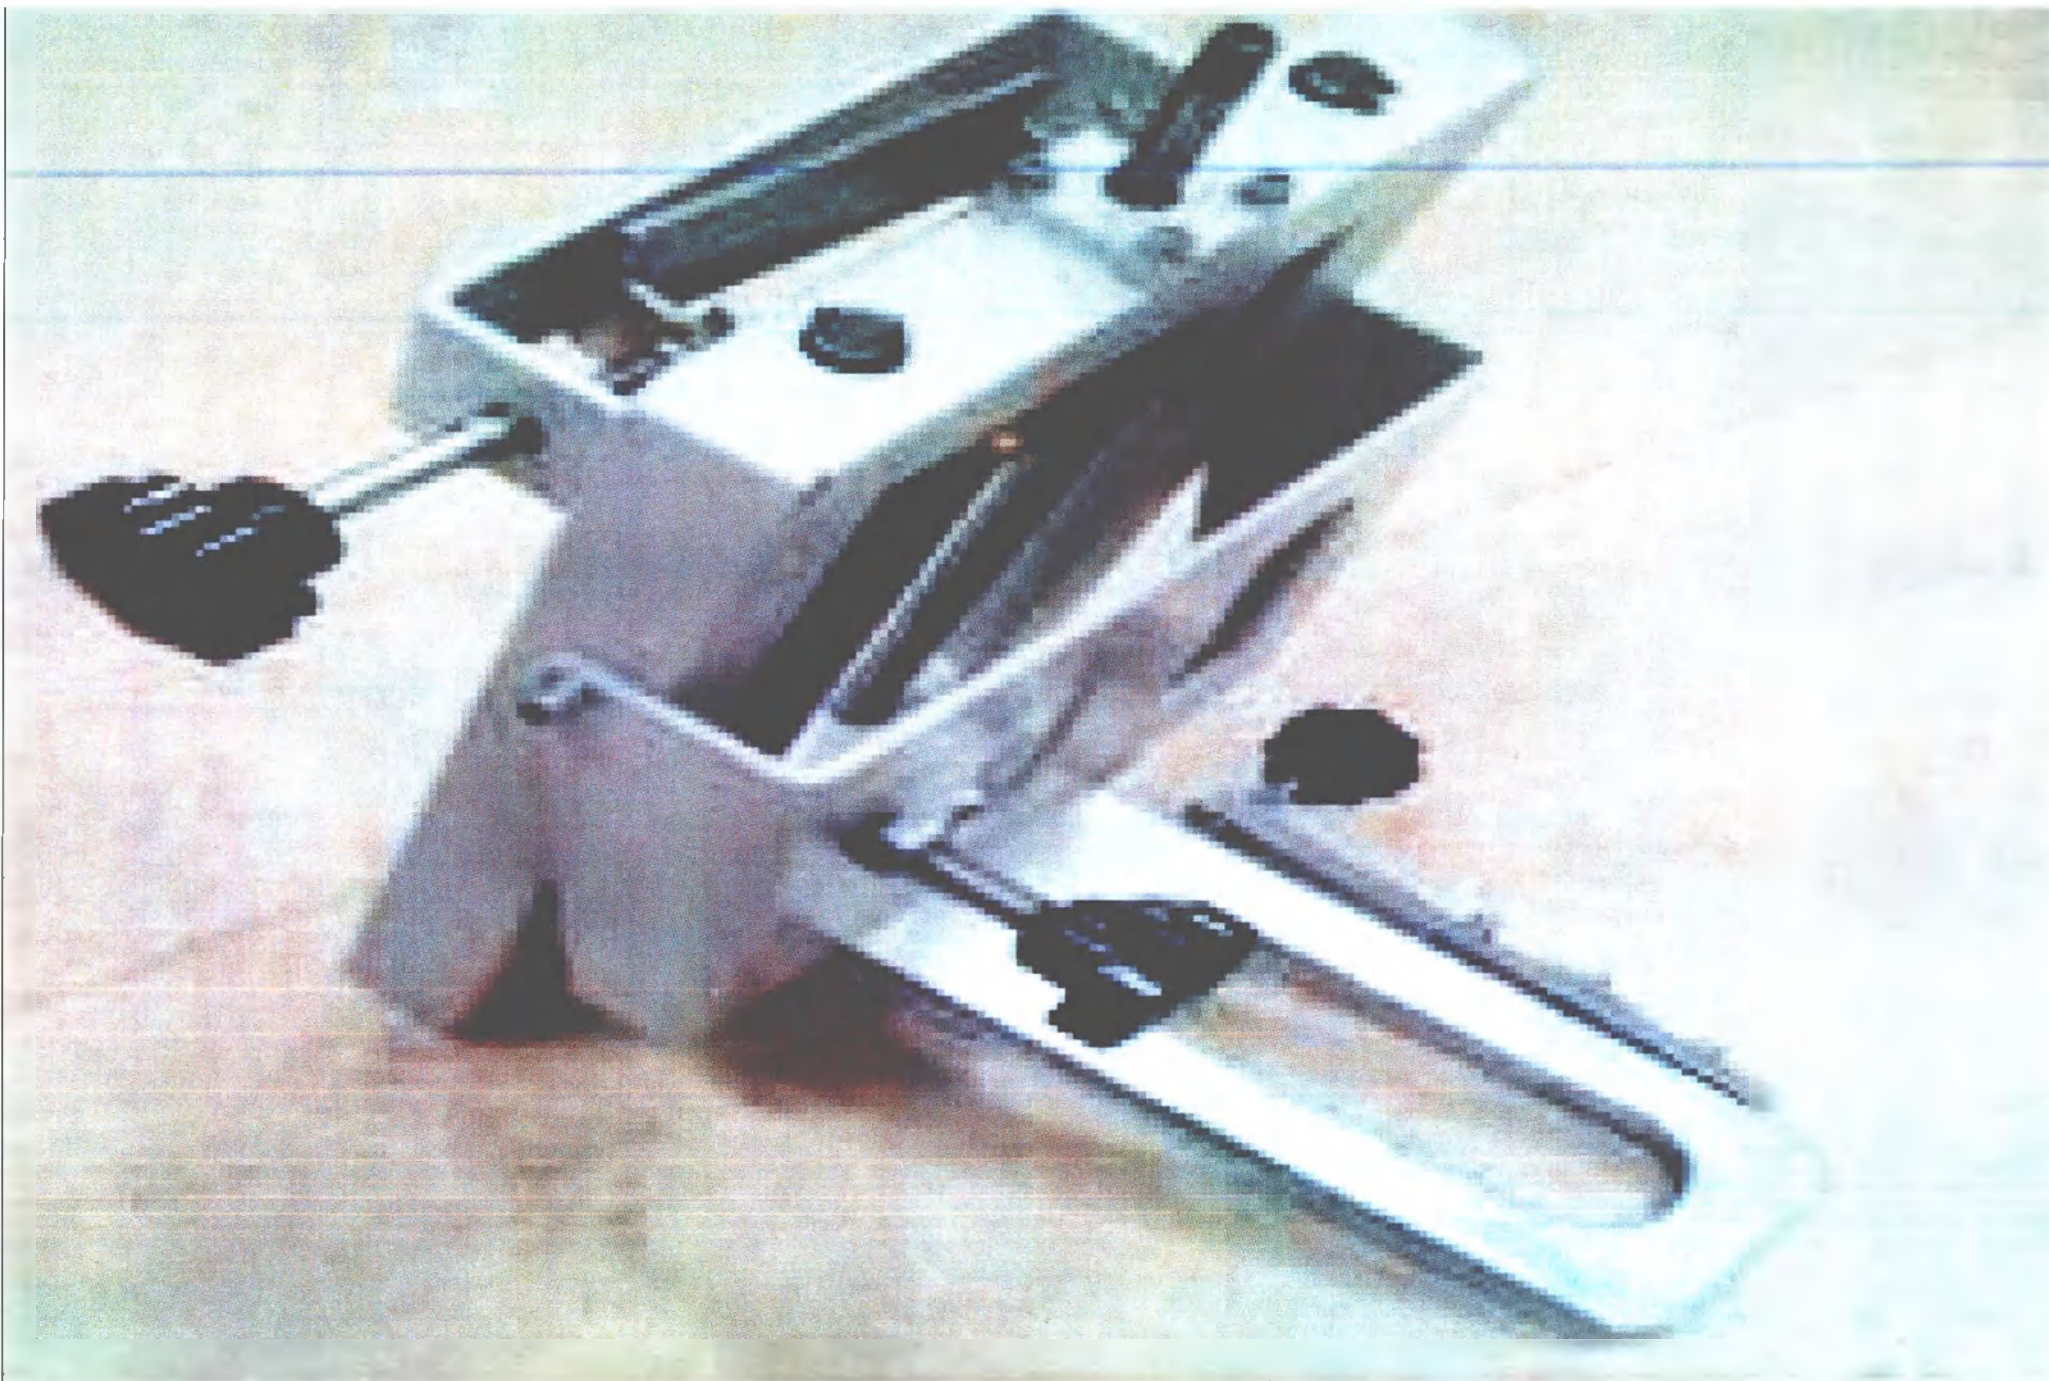


20а. Держатель для фантома.

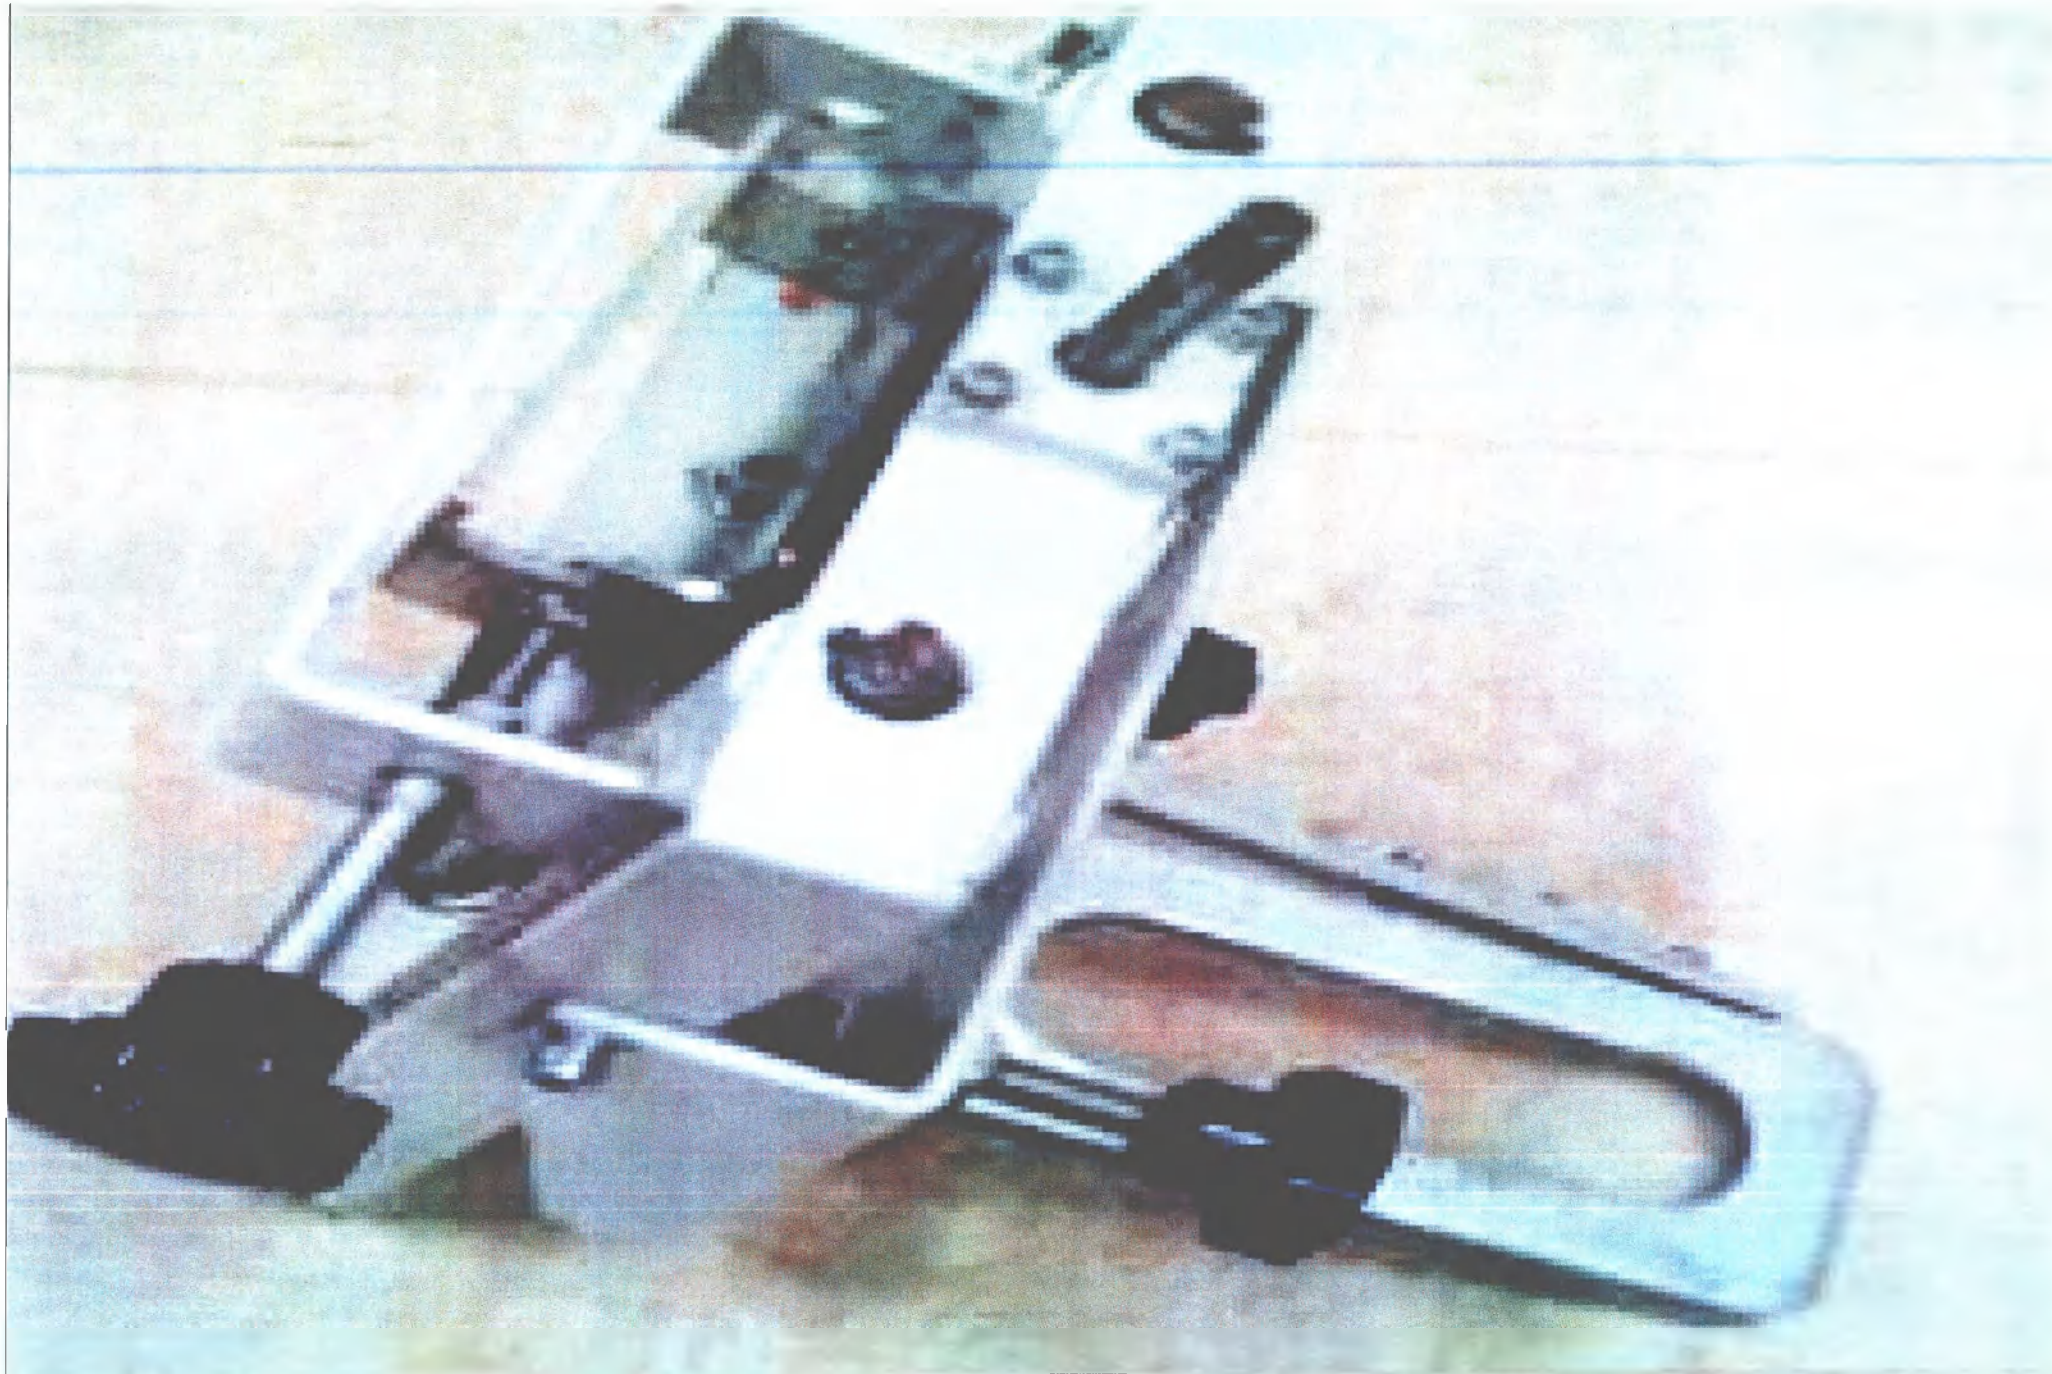

206. Держатель для фантома.



21. Сервисная панель управления томографом.

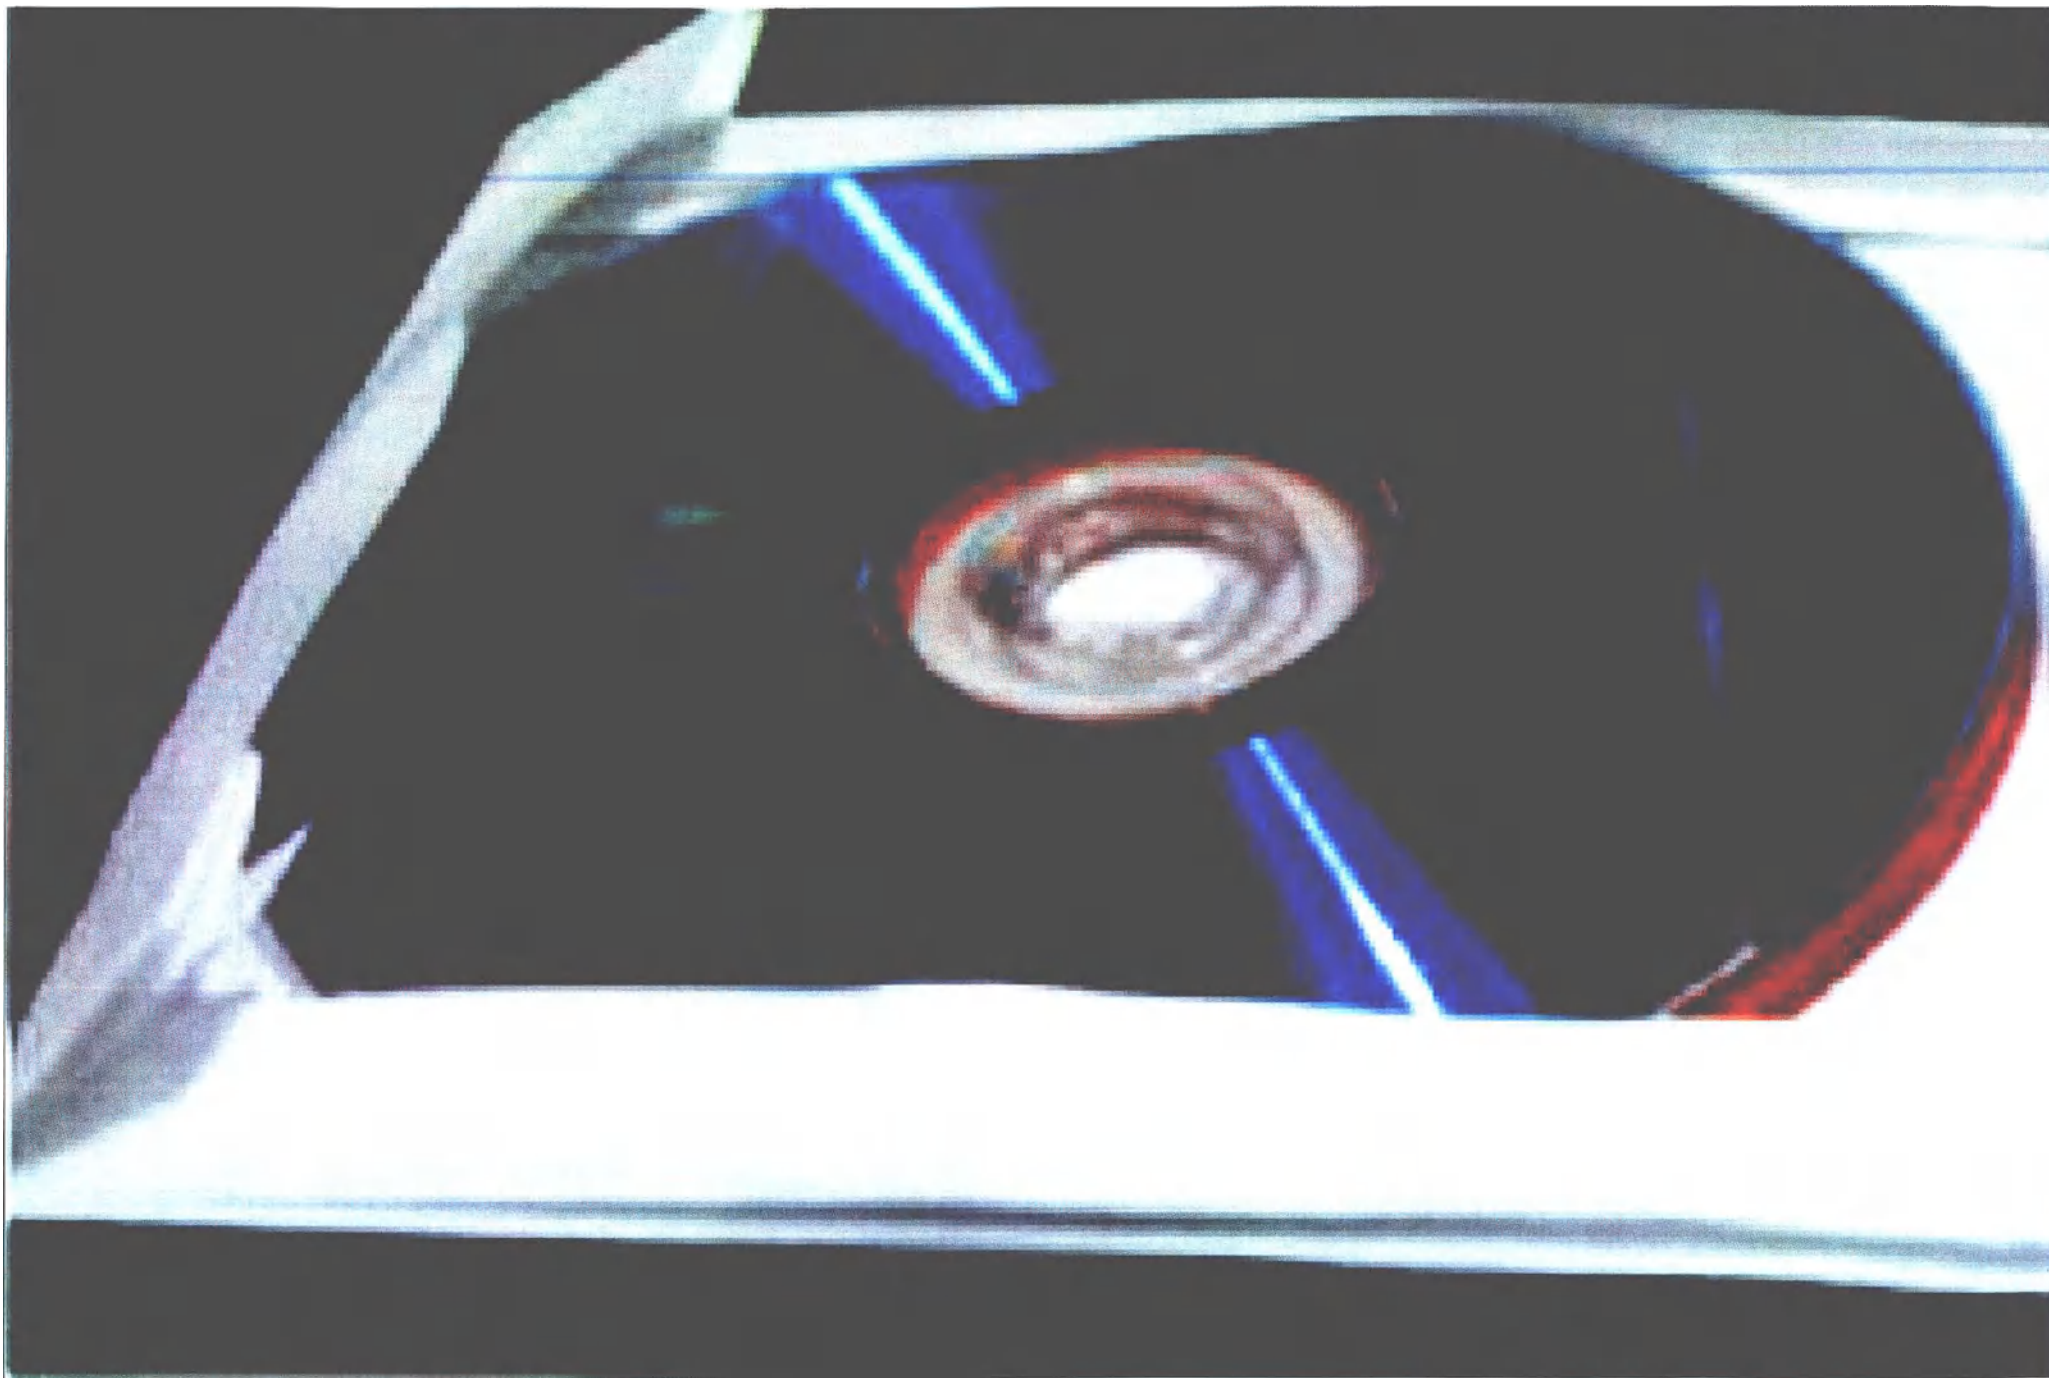

22. Программное приложение для реконструкции 32 срезов на электронном носителе.



23. Источник бесперебойного питания.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
57 листа (св)

