



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЭЛАНСКИН»
_____ Д.Б. Ключиков
« 05 » декабря 2017 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**Нить рассасывающаяся Biosun,
стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения (см. Приложение на 9 листе)**

**DONGWON MEDICAL CO., LTD.,
6F-601, 79-1, Mongnyeon-ro 153beon-gil, Gwangsan-gu, Gwangju, Korea**

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе
– Алюминиевый пакет (упаковка)



Sterile absorbable polydioxanone suture with needle

(Intended use)

The device is intended to make sub dermal tissue in an elevated position in plastic and reconstructive surgery. Polydioxanone suture provides wound support by longer period as compared to other synthetic absorbable suture. It also promotes the stimulation of the tissue for faster the treatment effect on the body.

(Things to do before use)

- Before the administration of medicine, the condition of patient must be stable and then must be operated.
- Prepare for the single use.
- Prepare for the single use. Sterile absorbable polydioxanone suture with needle must be packed by sterilization.
- Check the "expiry" model.
- Check the validity period.
- Check whether the packaging is damaged.
- Use after understanding completely how to use the product.

(How to use and operation order)

- Confirm the content and packaging condition of the product.
- Know the instructions for use thoroughly.
- Use sterilization-packed products.
- Remove packaging of the product and take out. Sterile absorbable polydioxanone suture with needle carefully.
- Confirm if there is transformation, leak or cracks in the product.

1) The product must be used by doctor.

2) The point to insert Sterile absorbable polydioxanone suture with needle must be sterilized by alcohol cottons.

3) Insert the Sterile absorbable polydioxanone suture with needle into the skin or muscles you need to treat correctly.

4) Don't insert it more than two times of a needle.

5) Remove the Sterile absorbable polydioxanone suture with needle slowly and softly.

6) Don't reuse it, because the product is single use.

(How to manage after use)

- Discard the product that was once opened.
- Because this product is a single use product, it must not be reused.
- Discard the used product into an appointed safe place.

(Precautions)

- This product must be used only by doctors.
- Do not use the product that the expiration period is expired.
- Do not use the product that packaging is damaged.
- This product is not used for any purposes except the intended use.
- This product should be used only by medical professional doctor.

1) If there is a transformation, leak or cracks in the product, it is not to use.

(Preservation method)

- Save it in the clean and dry room.
- Avoid direct sunlight and high moisture.

(Contraindication)

- If your medical history contains cardiac disorder, high blood, diabetes, panic disorder, depression, etc, get an advice with a doctor.

Sterile

absorbable polydioxanone suture with needle

BIOSUN Model: SC-29G66-50

LOT: 170325

29G 50mm MFG: 2017.03.25

EXP: 2018.03.24



STERILE

Dongwon Medical Co., Ltd.

6F-601, 79-1, Manghyeon-ro 153beon-gil, Gwangju, Korea

Tel: +82-42-430-6621 Fax: +82-42-430-6620


Intermunder-Lemon Europe GmbH

Blackstr. 47 D-44787 Bochum Germany


Tel: +49-234-8801-773 Fax: +49-234-8801-774

EC REP

Блистерная упаковка

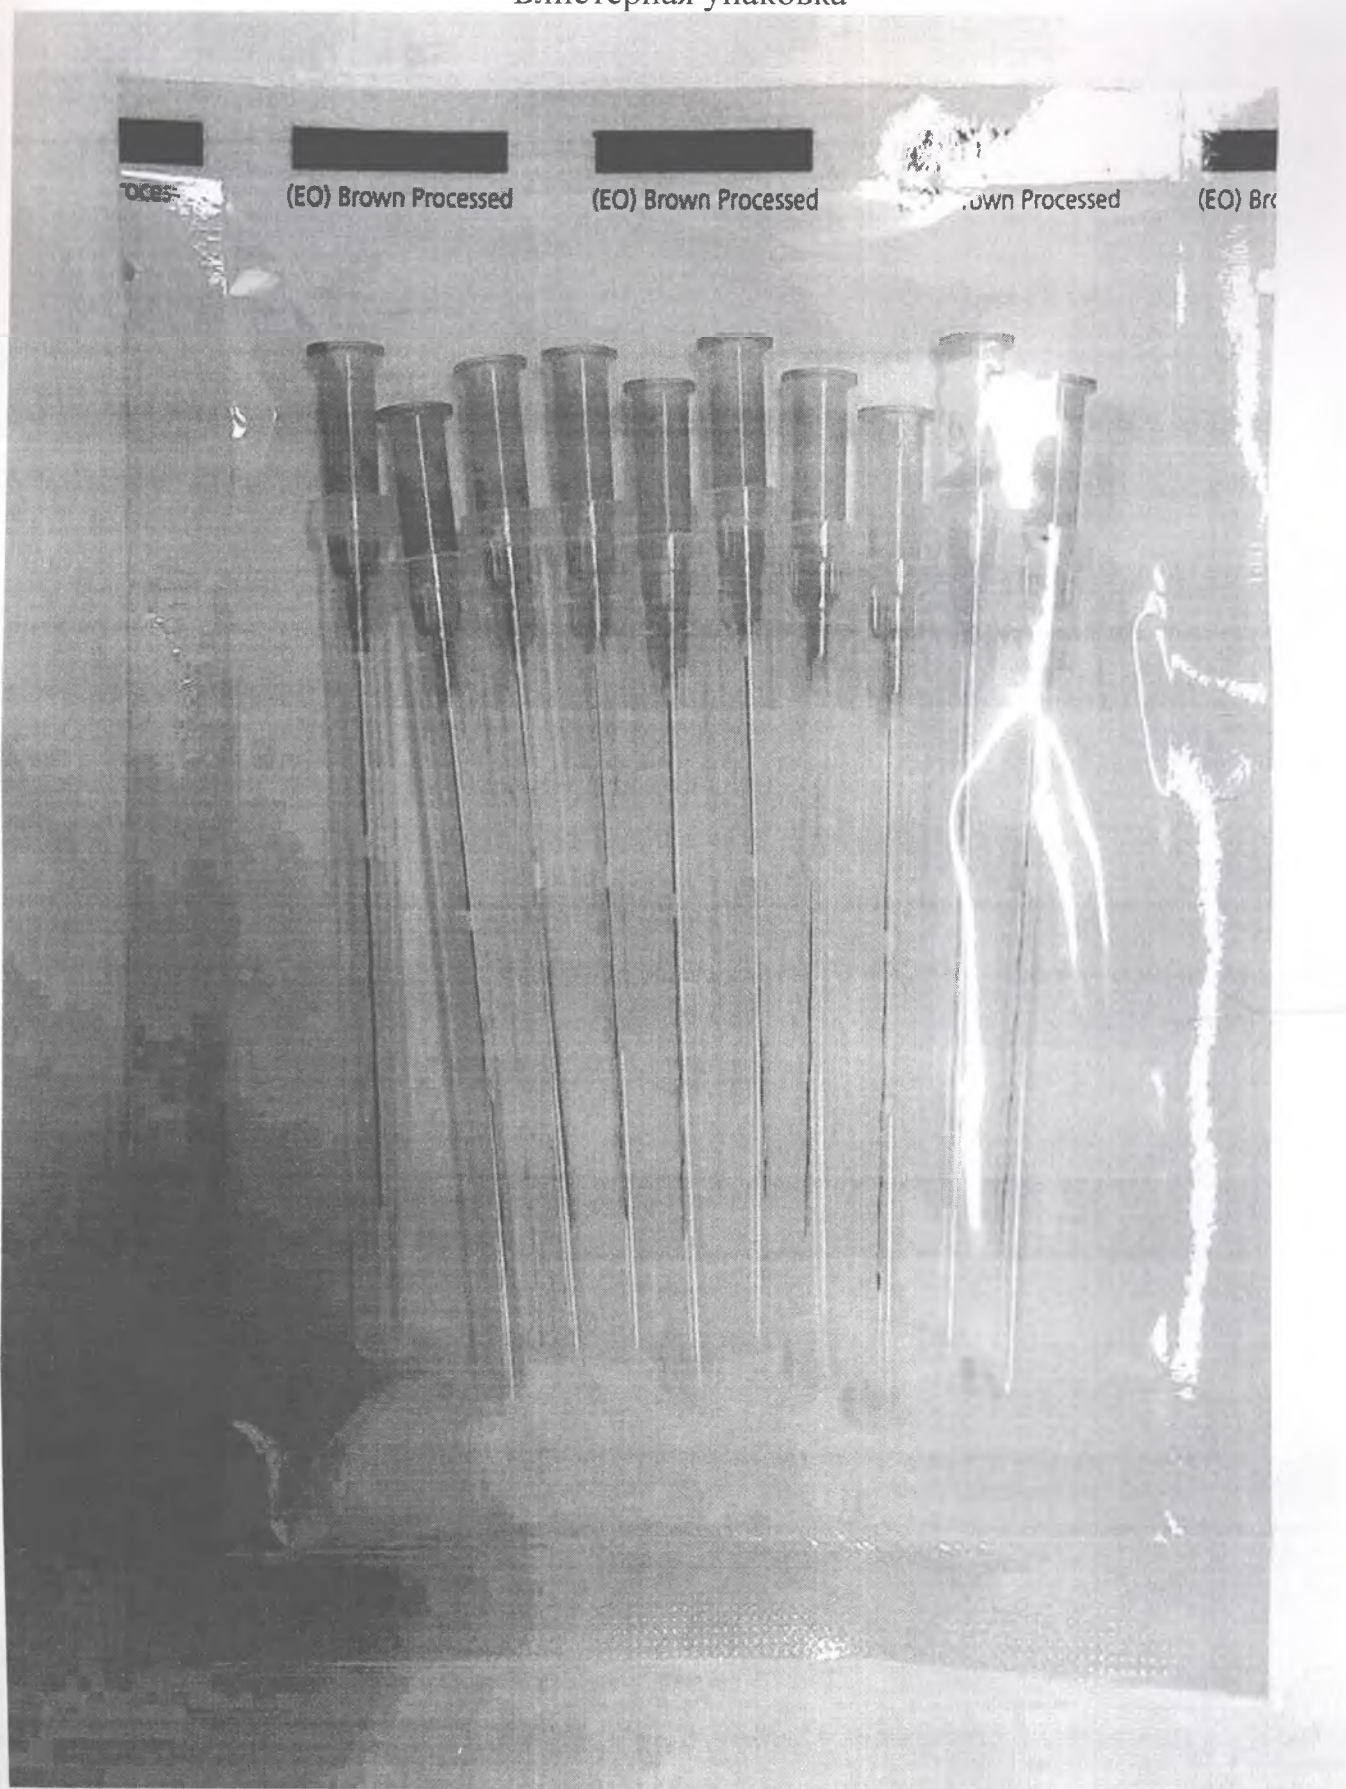

Блистерная упаковка

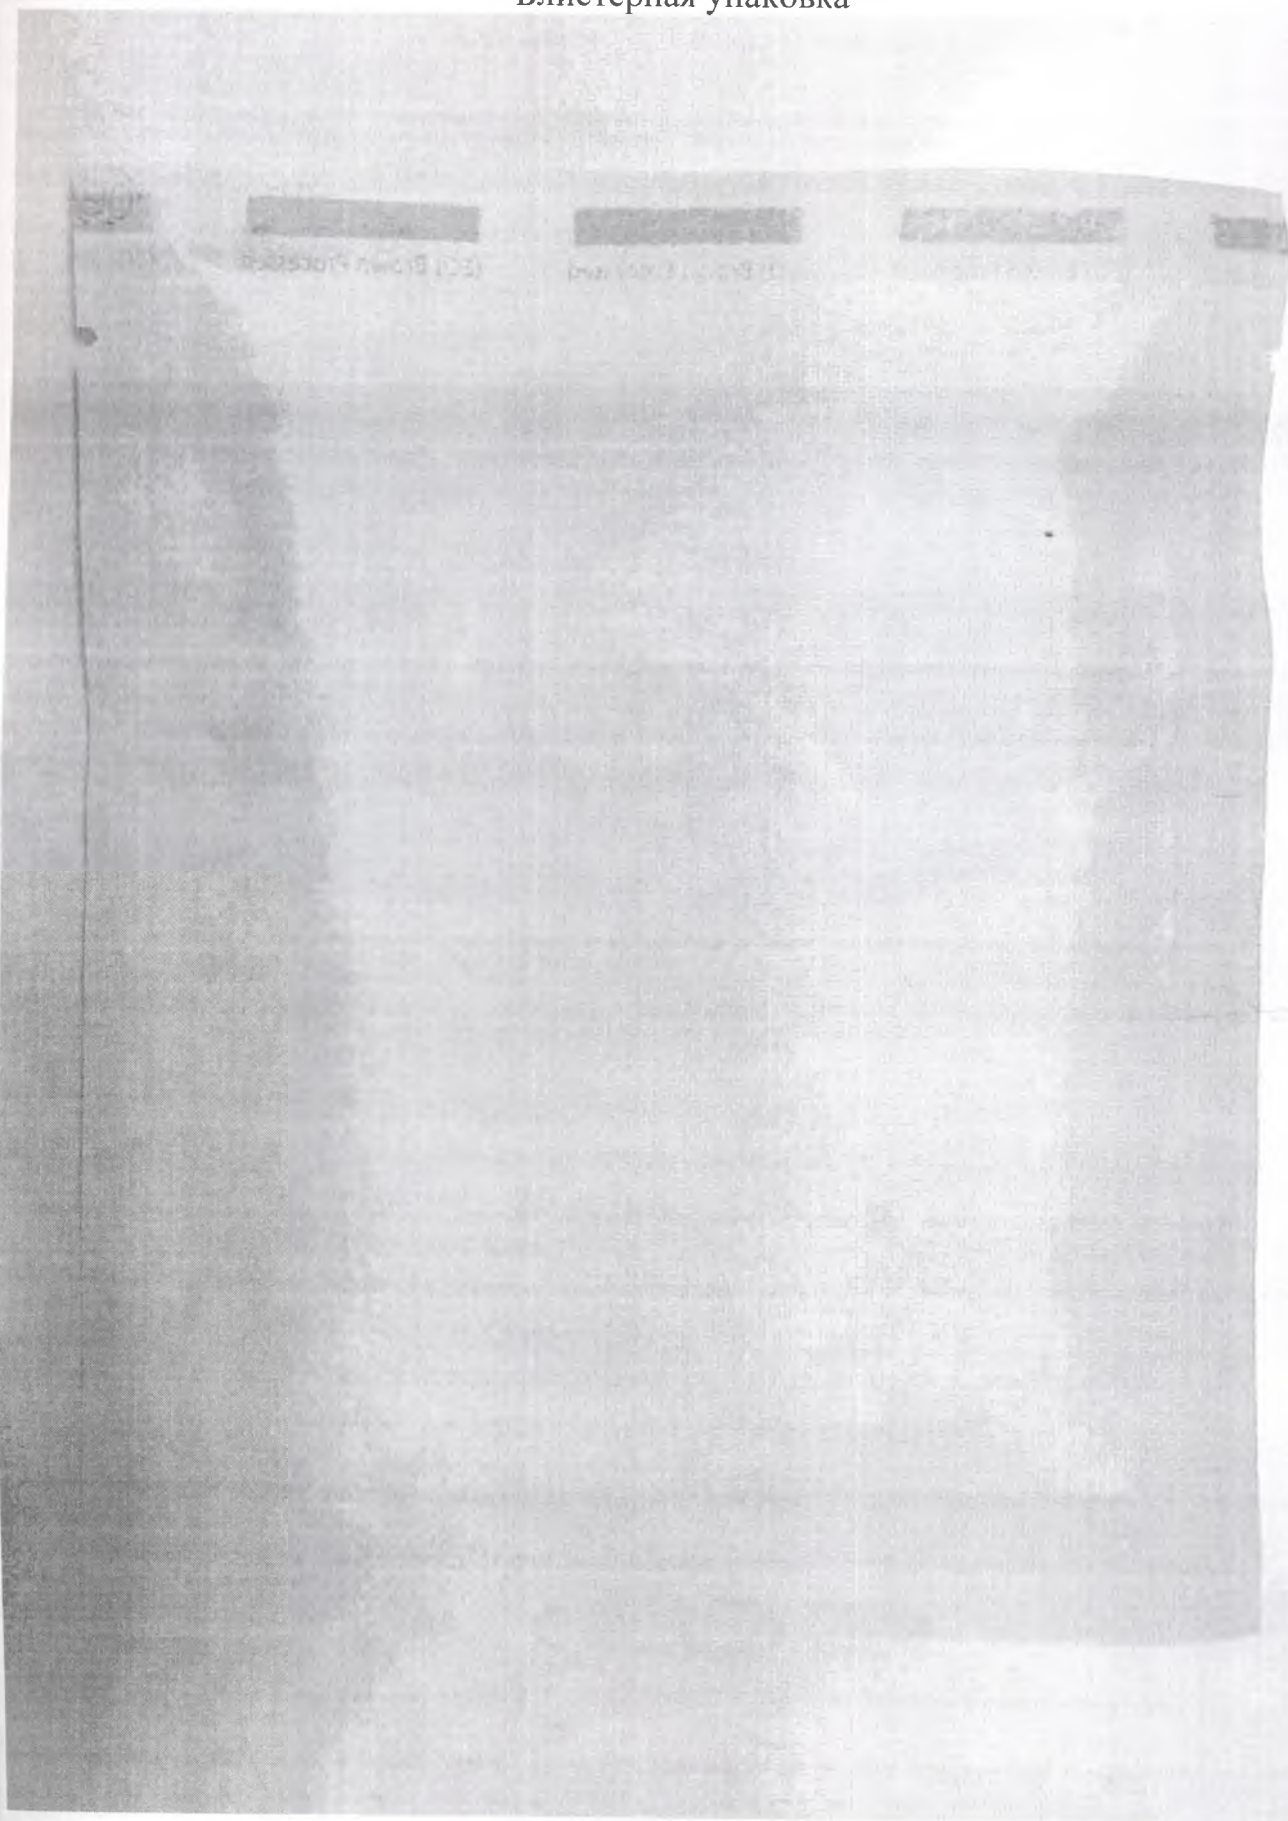

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе
– Алюминиевый пакет (упаковка)

Authorized Manufacturer No : 4716
Authorized Product permit No : 14-1935

**BIO
SUN**

Item name: Sterile Absorbable polydioxanone suture with needle

Performance, purpose, how to use/ precautions
for use : Refer the instruction manual

Package measure : 20 ea/pack

Manufacture number :

Manufactured date :

Sterile method : E.O gas sterile

This Products is a disposable sterile appliance applicants

Period for use : 1 year from the Manufactured date

Manufacturer : Dong won Medical co., Ltd.

6F-601, 79-1, Mongnyeong-ro 153beon-gil, Gwangsan-gu, Gwangju, Korea

KFDA CE 2292



Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе
– Алюминиевый пакет (упаковка)

(Intended use)
This device is intended to hold an suture tissue in an abscess, incision, laceration, and reconstructive surgery. Absorbable suture provides wound support for longer period as compared to other synthetic absorbable suture. It also promotes the stimulation for the formation of new connective tissue in the body.

(Things to do before use)
a) Before the administration of medicine, the condition of patient must be stable and then must be operated by means of suture of choice.
b) Prepare for the suture use. Sterile absorbable polydioxanone suture with needle that is provided by sterilization in the package must be used.
c) Check the expiry date.
d) Check the lot number.
e) Check the suture type.
f) Check the suture size.
g) Use after understanding carefully how to use the product.

(How to use and operation order)
a) Confirm the correct and necessary condition of the product.
b) Prepare the suture for use thoroughly.
c) Use the suture in the correct order.
d) Before the use of the product, the suture must be checked for the quality of the product and the suture must be checked for the quality of the product.
e) Confirm the suture is the correct type, size, and color of the product.
f) The product must be used by doctor.
g) The use of the suture must be checked for the quality of the product.
h) The use of the suture must be checked for the quality of the product.
i) The use of the suture must be checked for the quality of the product.
j) The use of the suture must be checked for the quality of the product.

(How to use and operation order)
a) Confirm the correct and necessary condition of the product.
b) Prepare the suture for use thoroughly.
c) Use the suture in the correct order.
d) Before the use of the product, the suture must be checked for the quality of the product and the suture must be checked for the quality of the product.
e) Confirm the suture is the correct type, size, and color of the product.
f) The product must be used by doctor.
g) The use of the suture must be checked for the quality of the product.
h) The use of the suture must be checked for the quality of the product.
i) The use of the suture must be checked for the quality of the product.
j) The use of the suture must be checked for the quality of the product.

Sterile

absorbable polydioxanone suture with needle

BIOSUN

19G 100mm

Model: DWCS-19-07
LOT: 170102
MFG: 2017 01 02
EXP: 2018 01 01

(Preservation method)
a) Store in the clean and dry room.
b) Avoid direct sunlight and high moisture.

(Contraindication)
a) If your medical history contains cardiac, disorder, high blood pressure, severe disorder, depression, etc, get an advice with a doctor.

STERILE


BIOSUN

19G 100mm

Model: DWCS-19-07
LOT: 170102
MFG: 2017 01 02
EXP: 2018 01 01

Dongwon Medical Co., Ltd.
85-801, 79-1, Monghyun-ro, Gyeonggi-do, Gwangju, Korea
Tel: +82-2-430-8521, Fax: +82-2-430-4530


Informus-Lenon Europe GmbH
Fuldastr. 47, 44781 Bochum, Germany
Tel: +49-234-800-773, Fax: +49-234-800-774

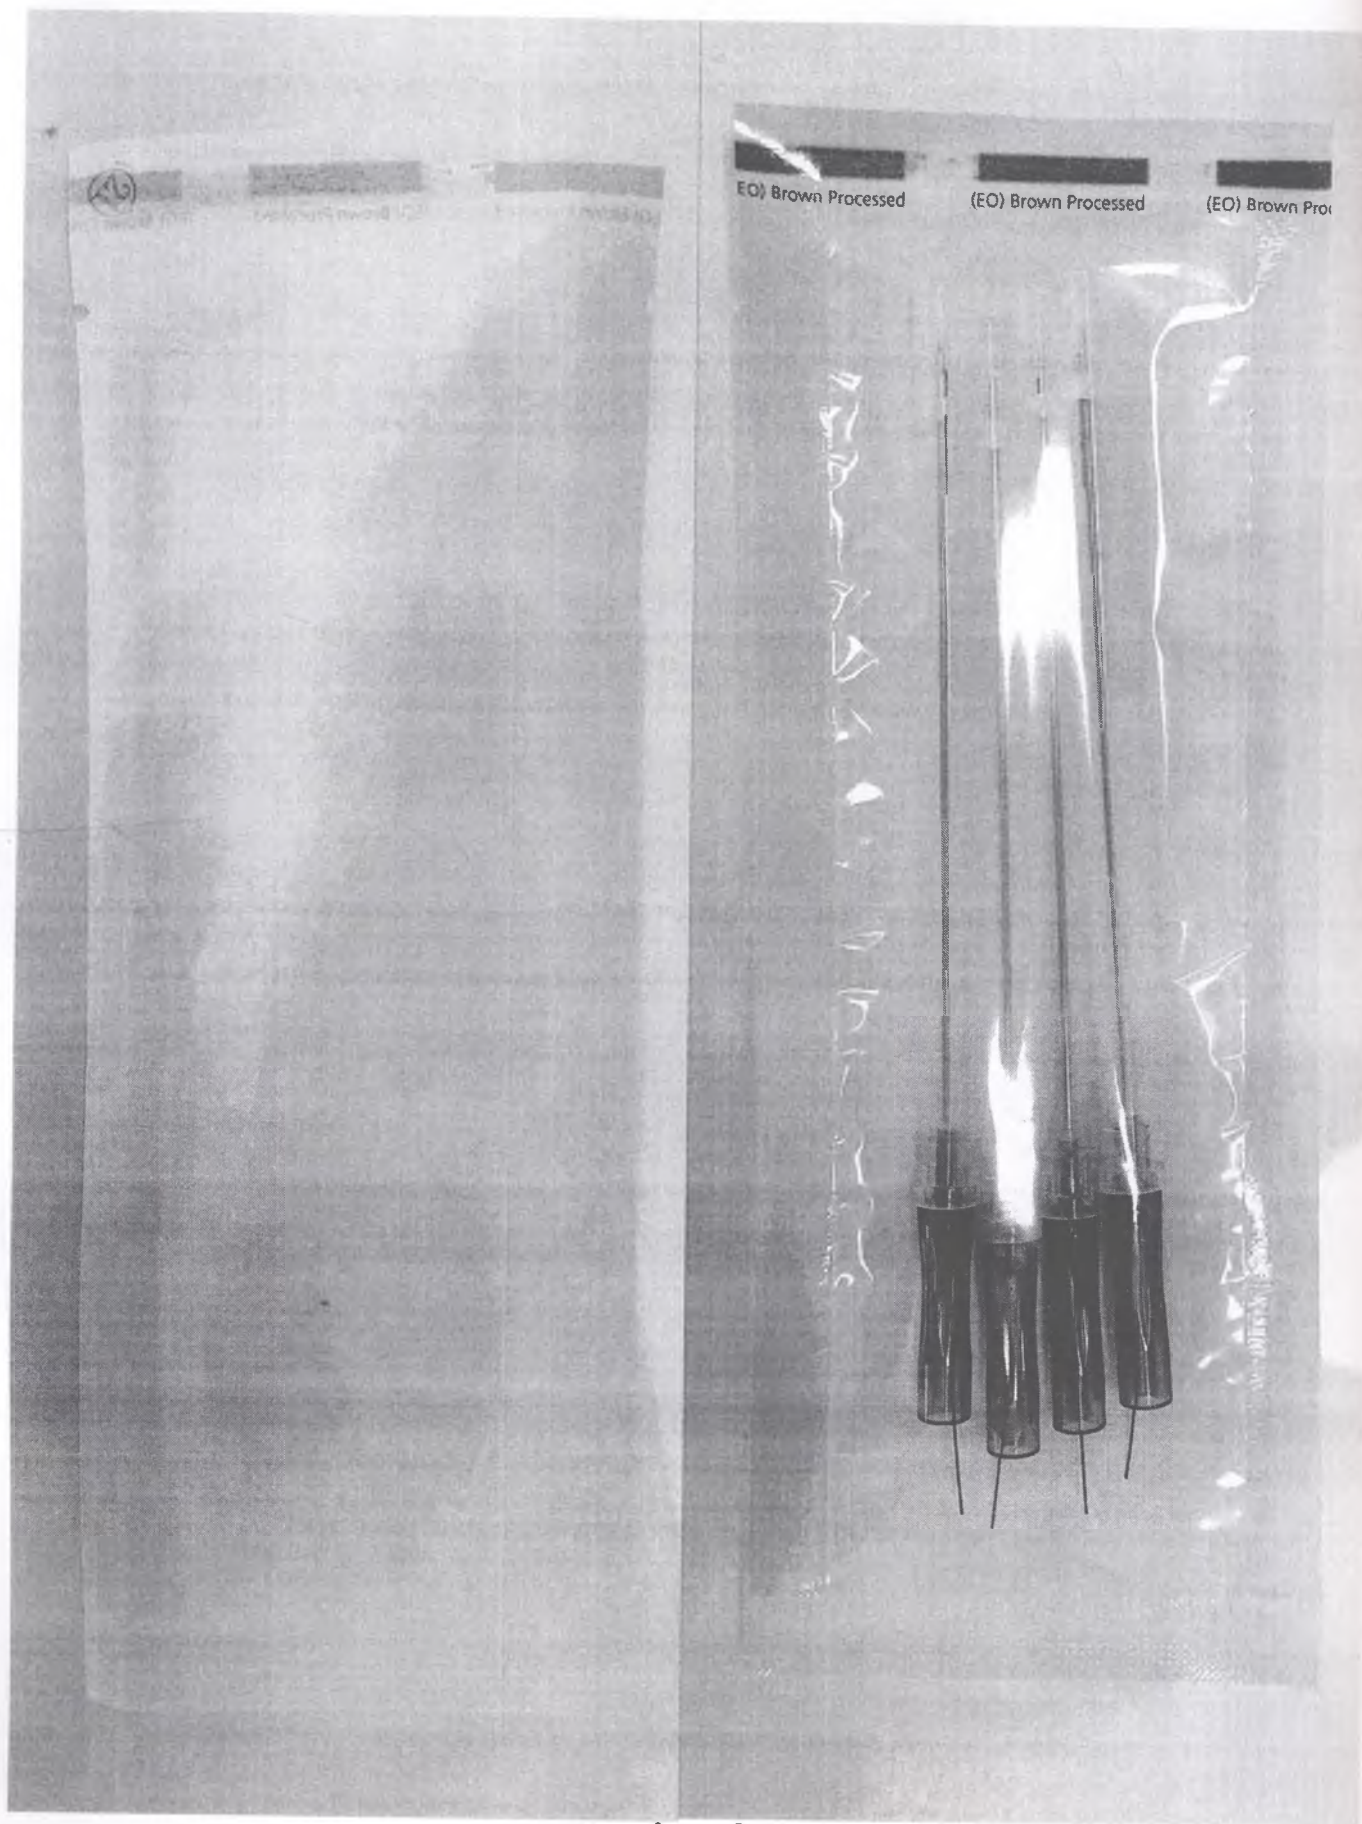

Блистерная упаковка

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Обычная нить с иглой – Нормальный тип (16 моделей)

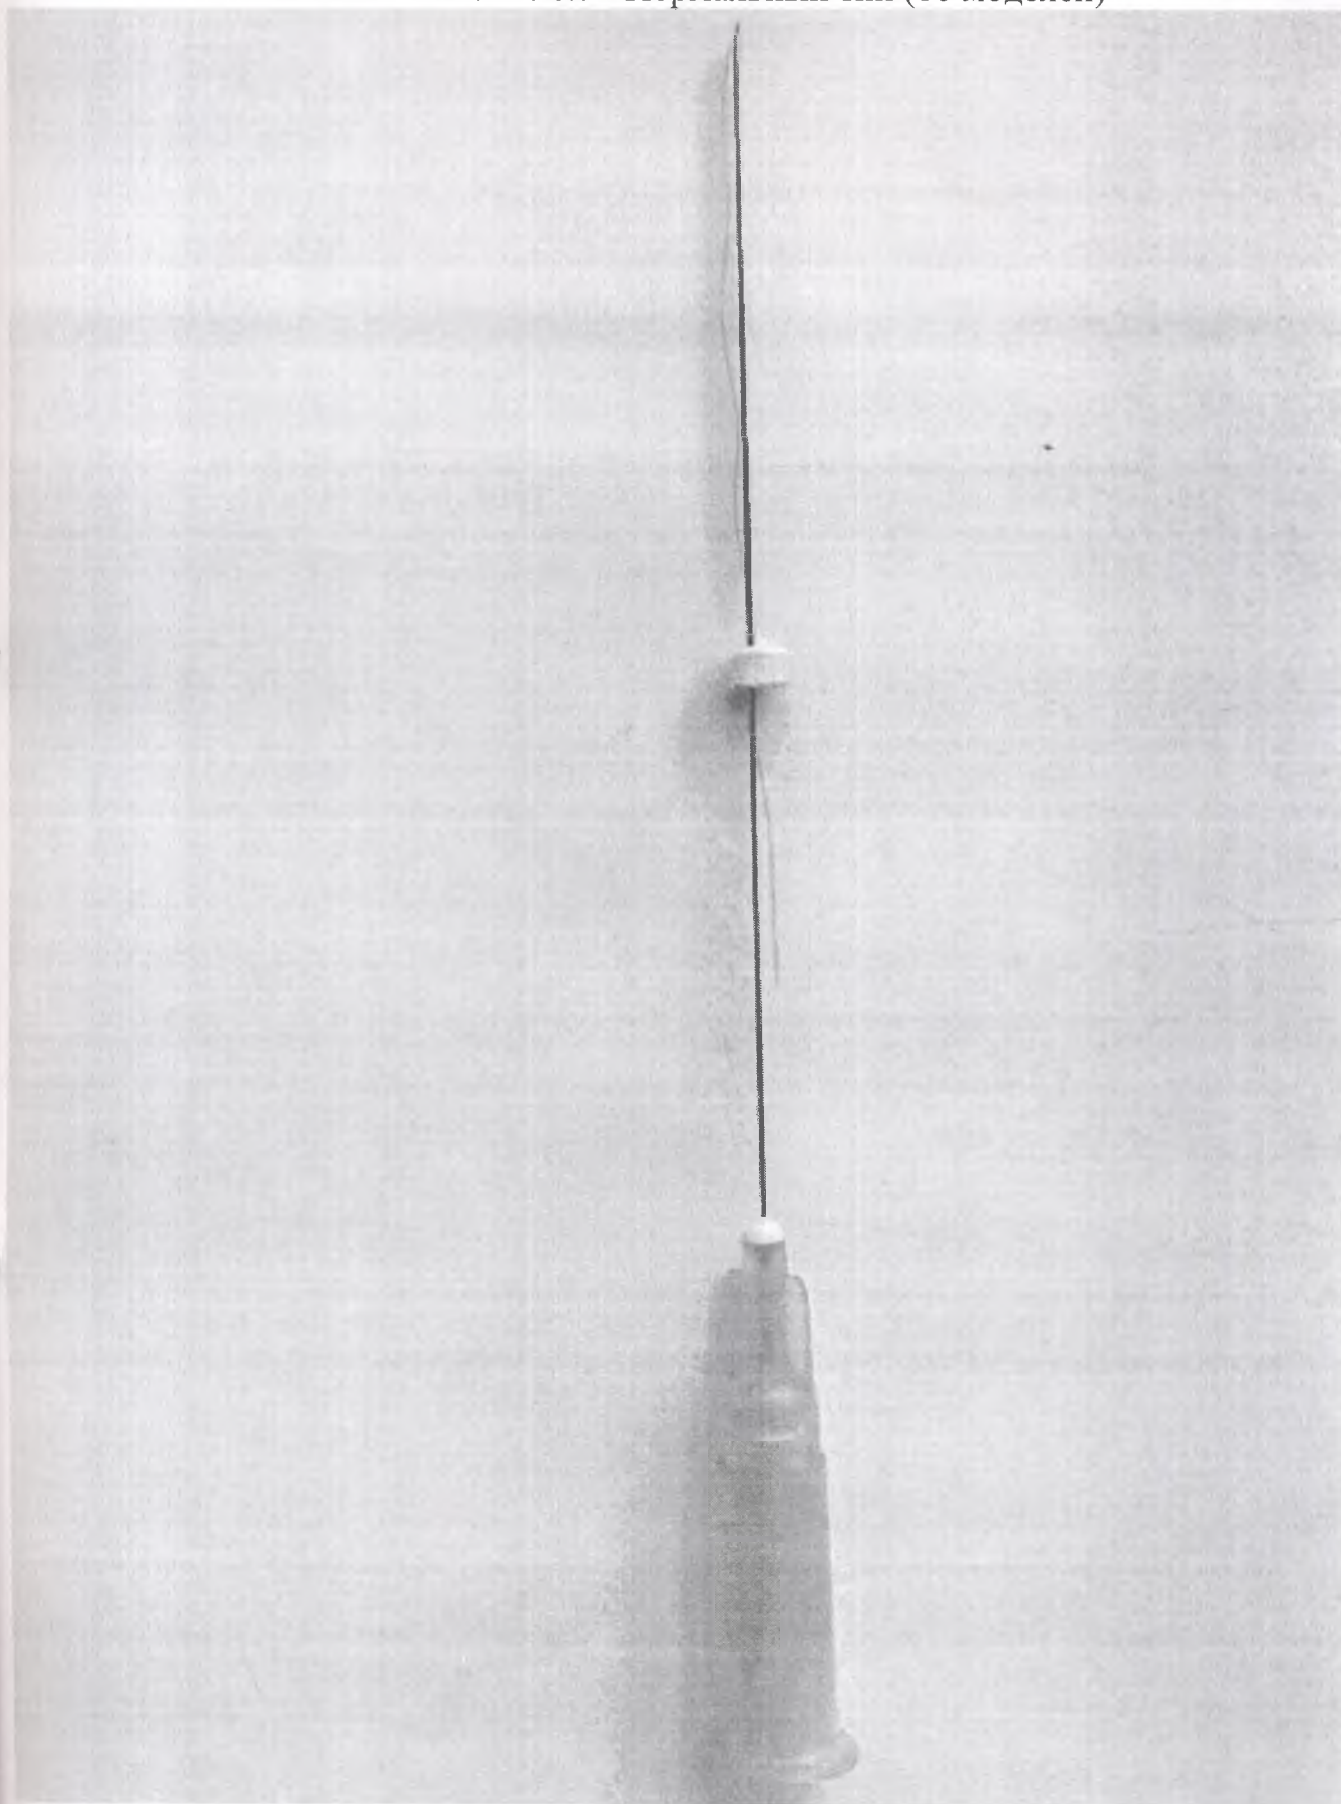

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:
Обычная нить с иглой – Сдвоенный тип (3 модели)




Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Обычная нить с иглой – Одинарно виточный тип (39 моделей)




Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Обычная нить с иглой – Одинарно пружинный тип (14 моделей)

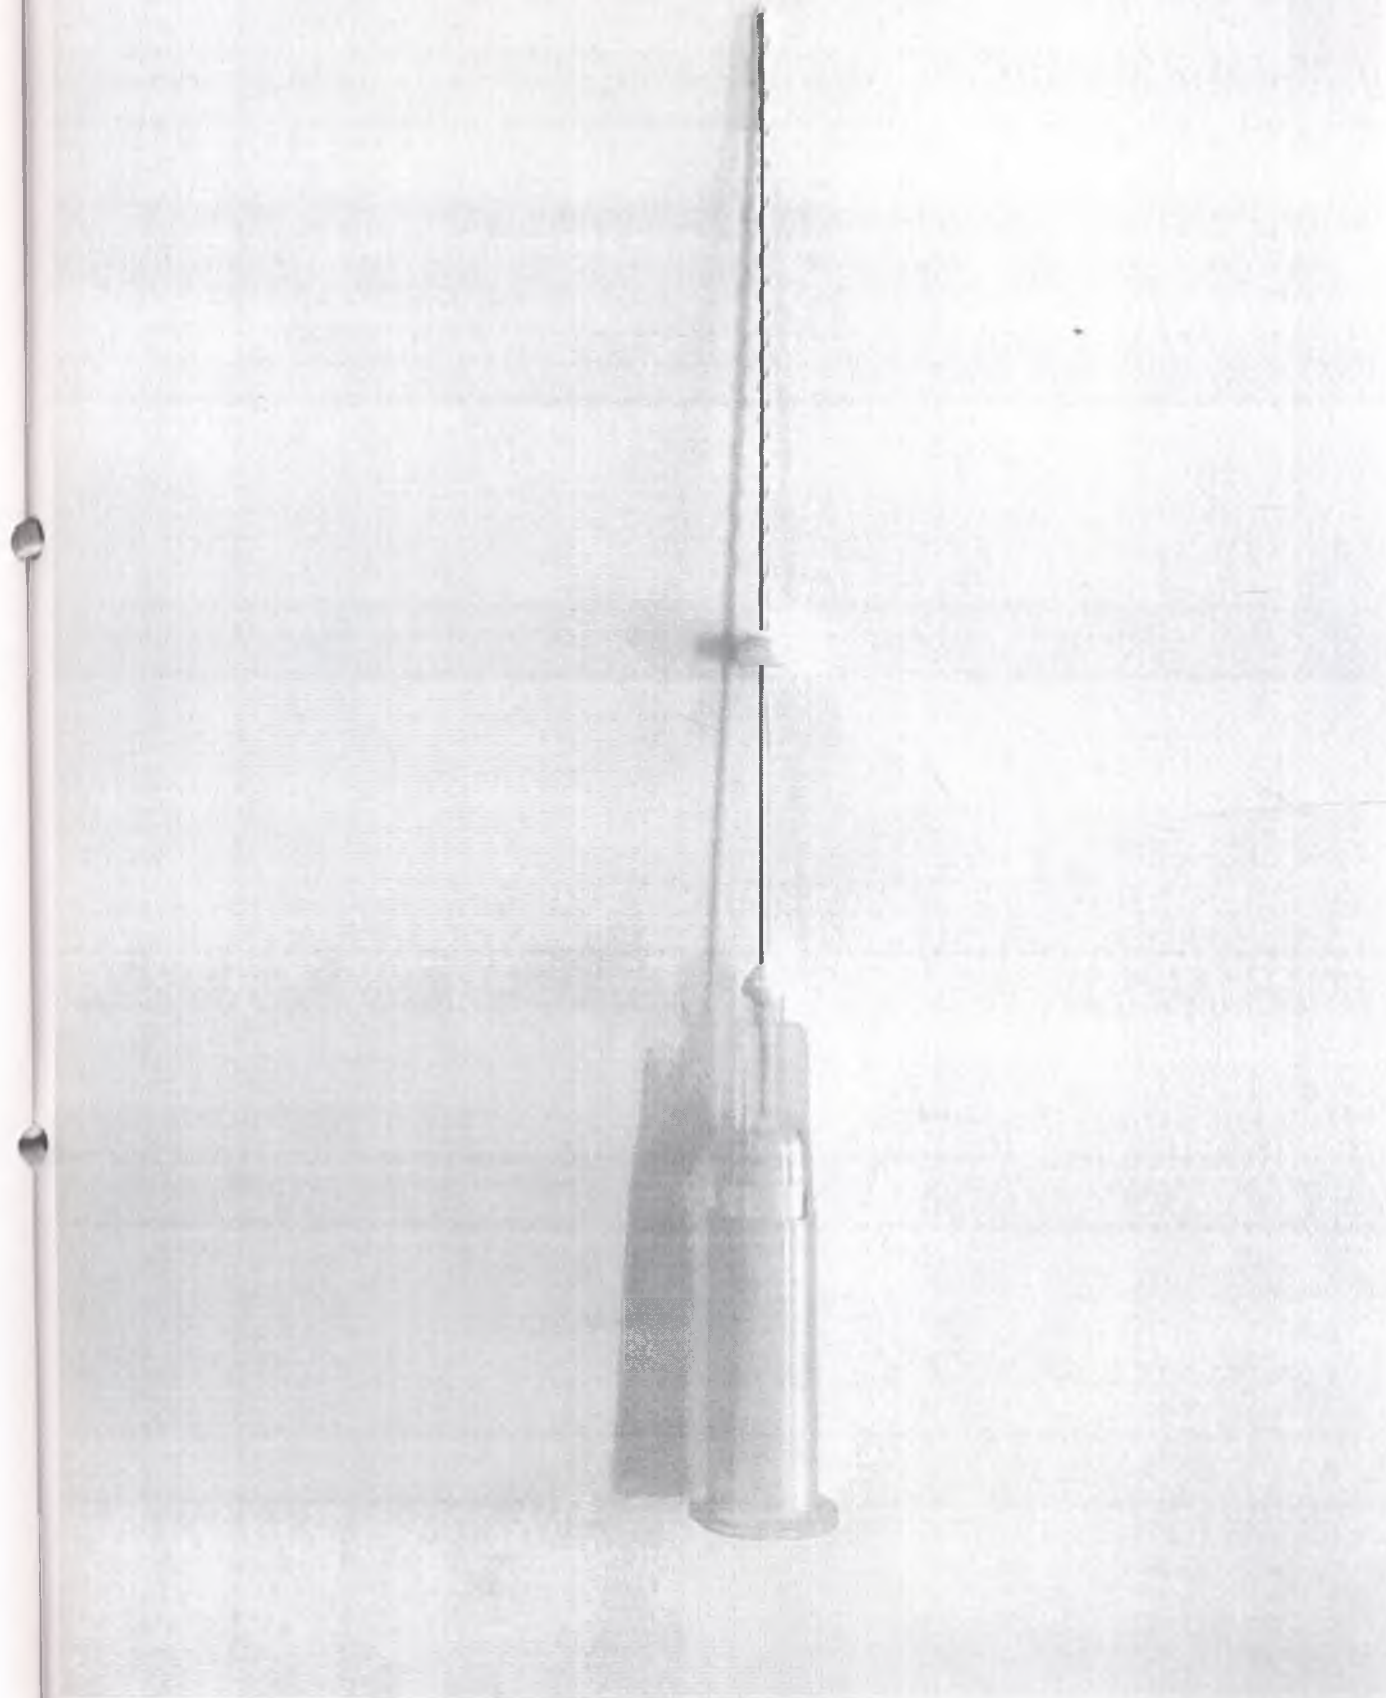


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Обычная нить с иглой – Сдвоенный виточный тип (10 моделей)

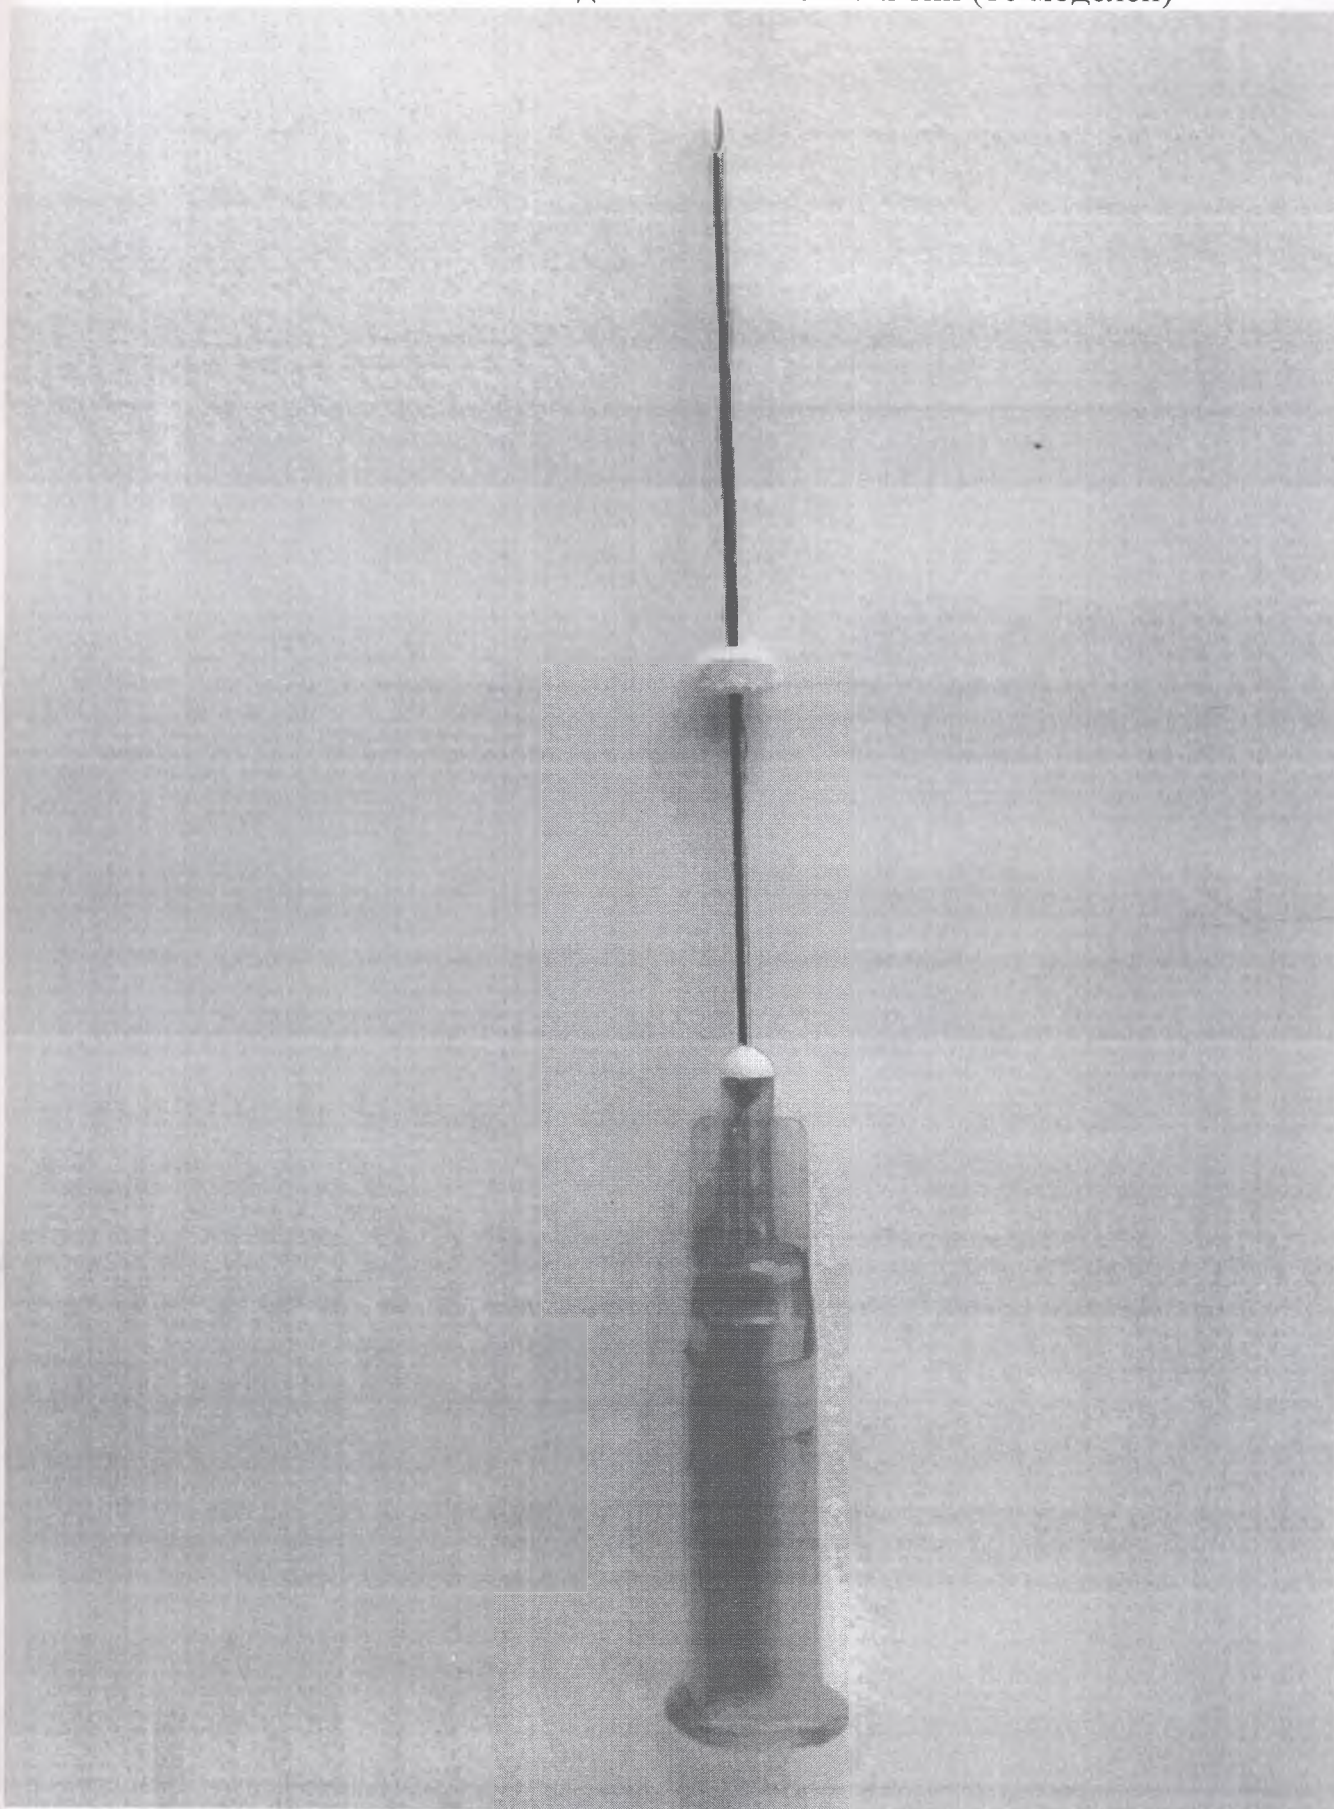


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Обычная нить с тупой иглой – Канюля N тип (6 моделей)

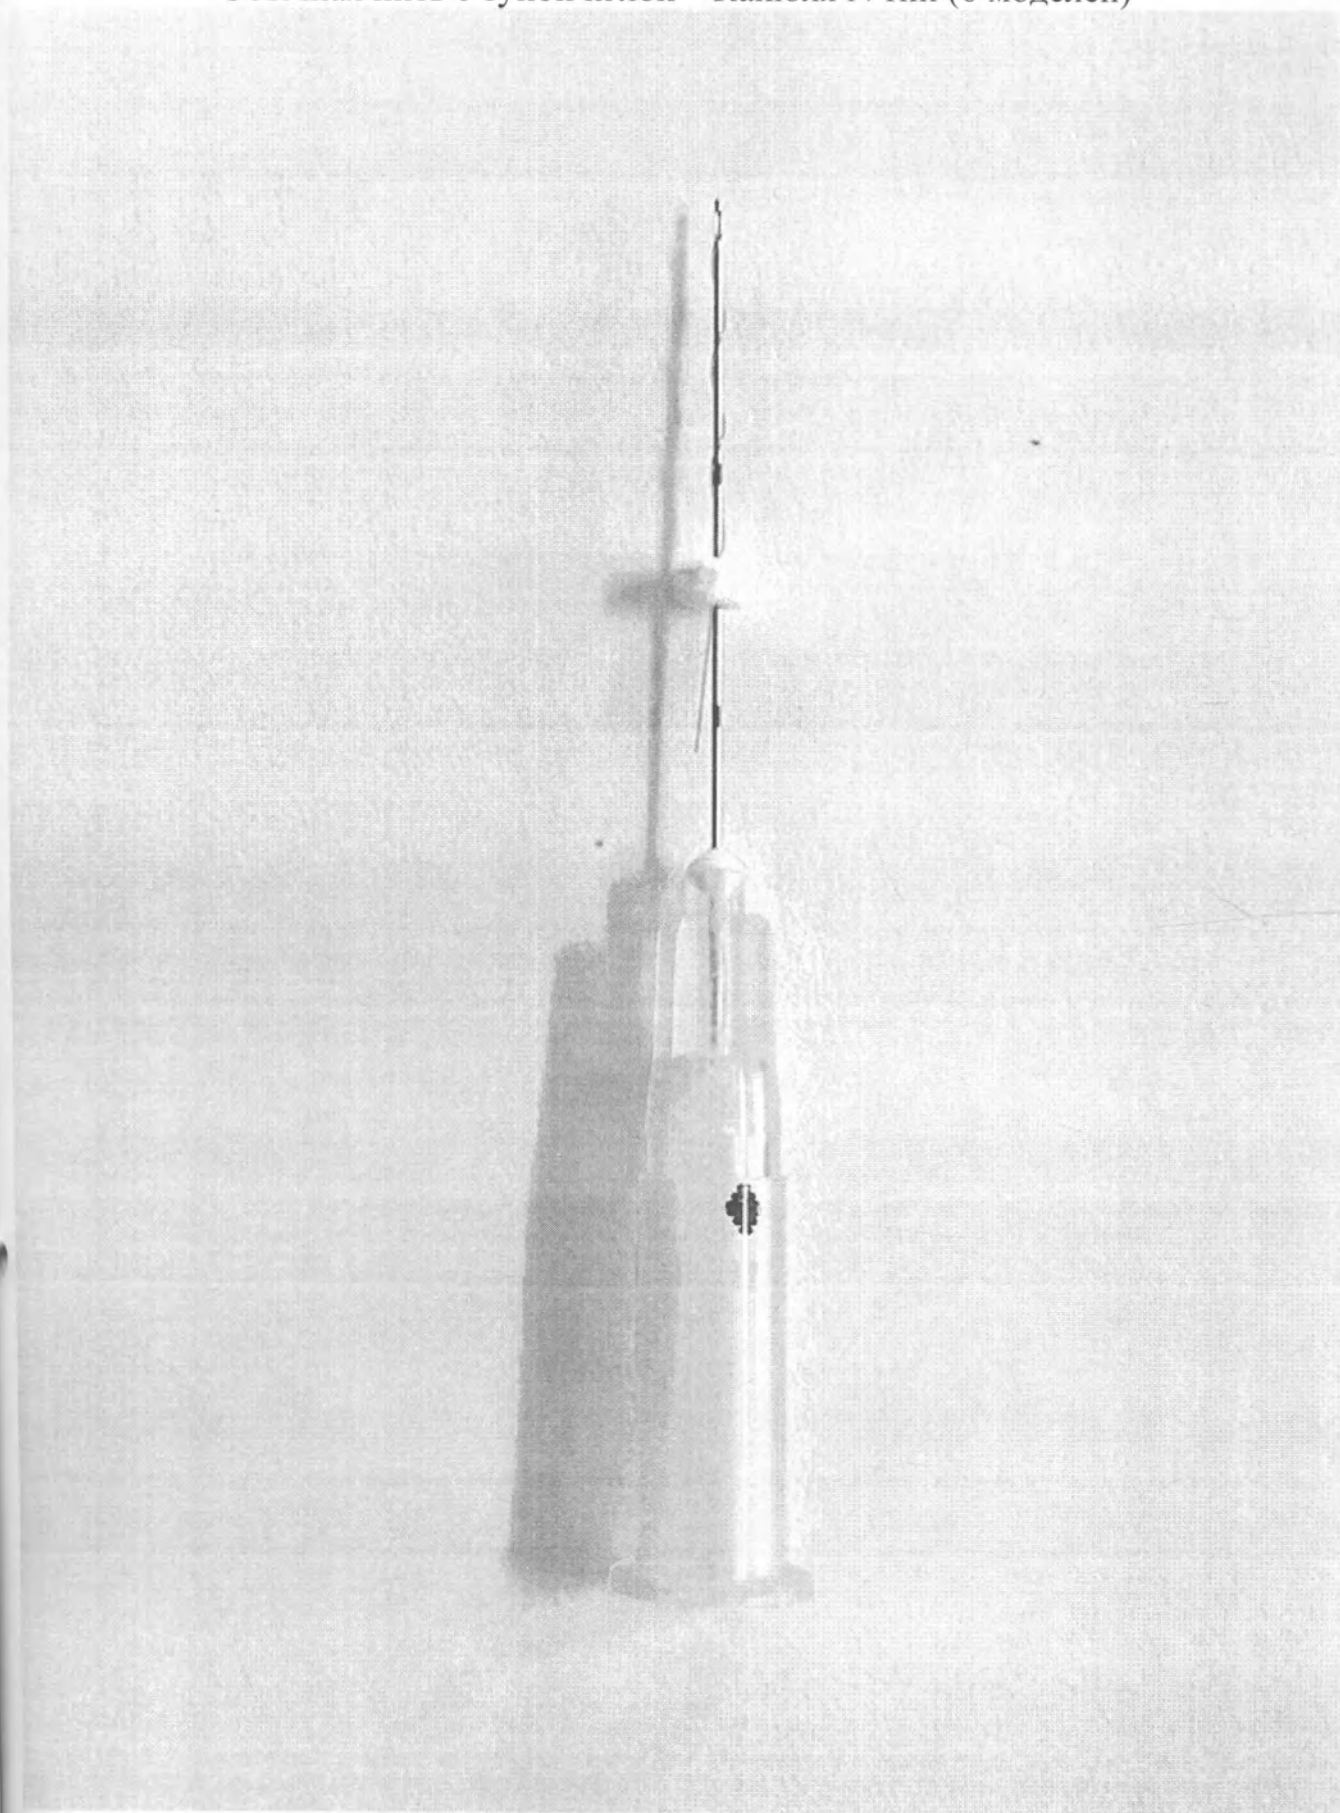


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Обычная нить с тупой иглой – Канюля О тип (4 модели)

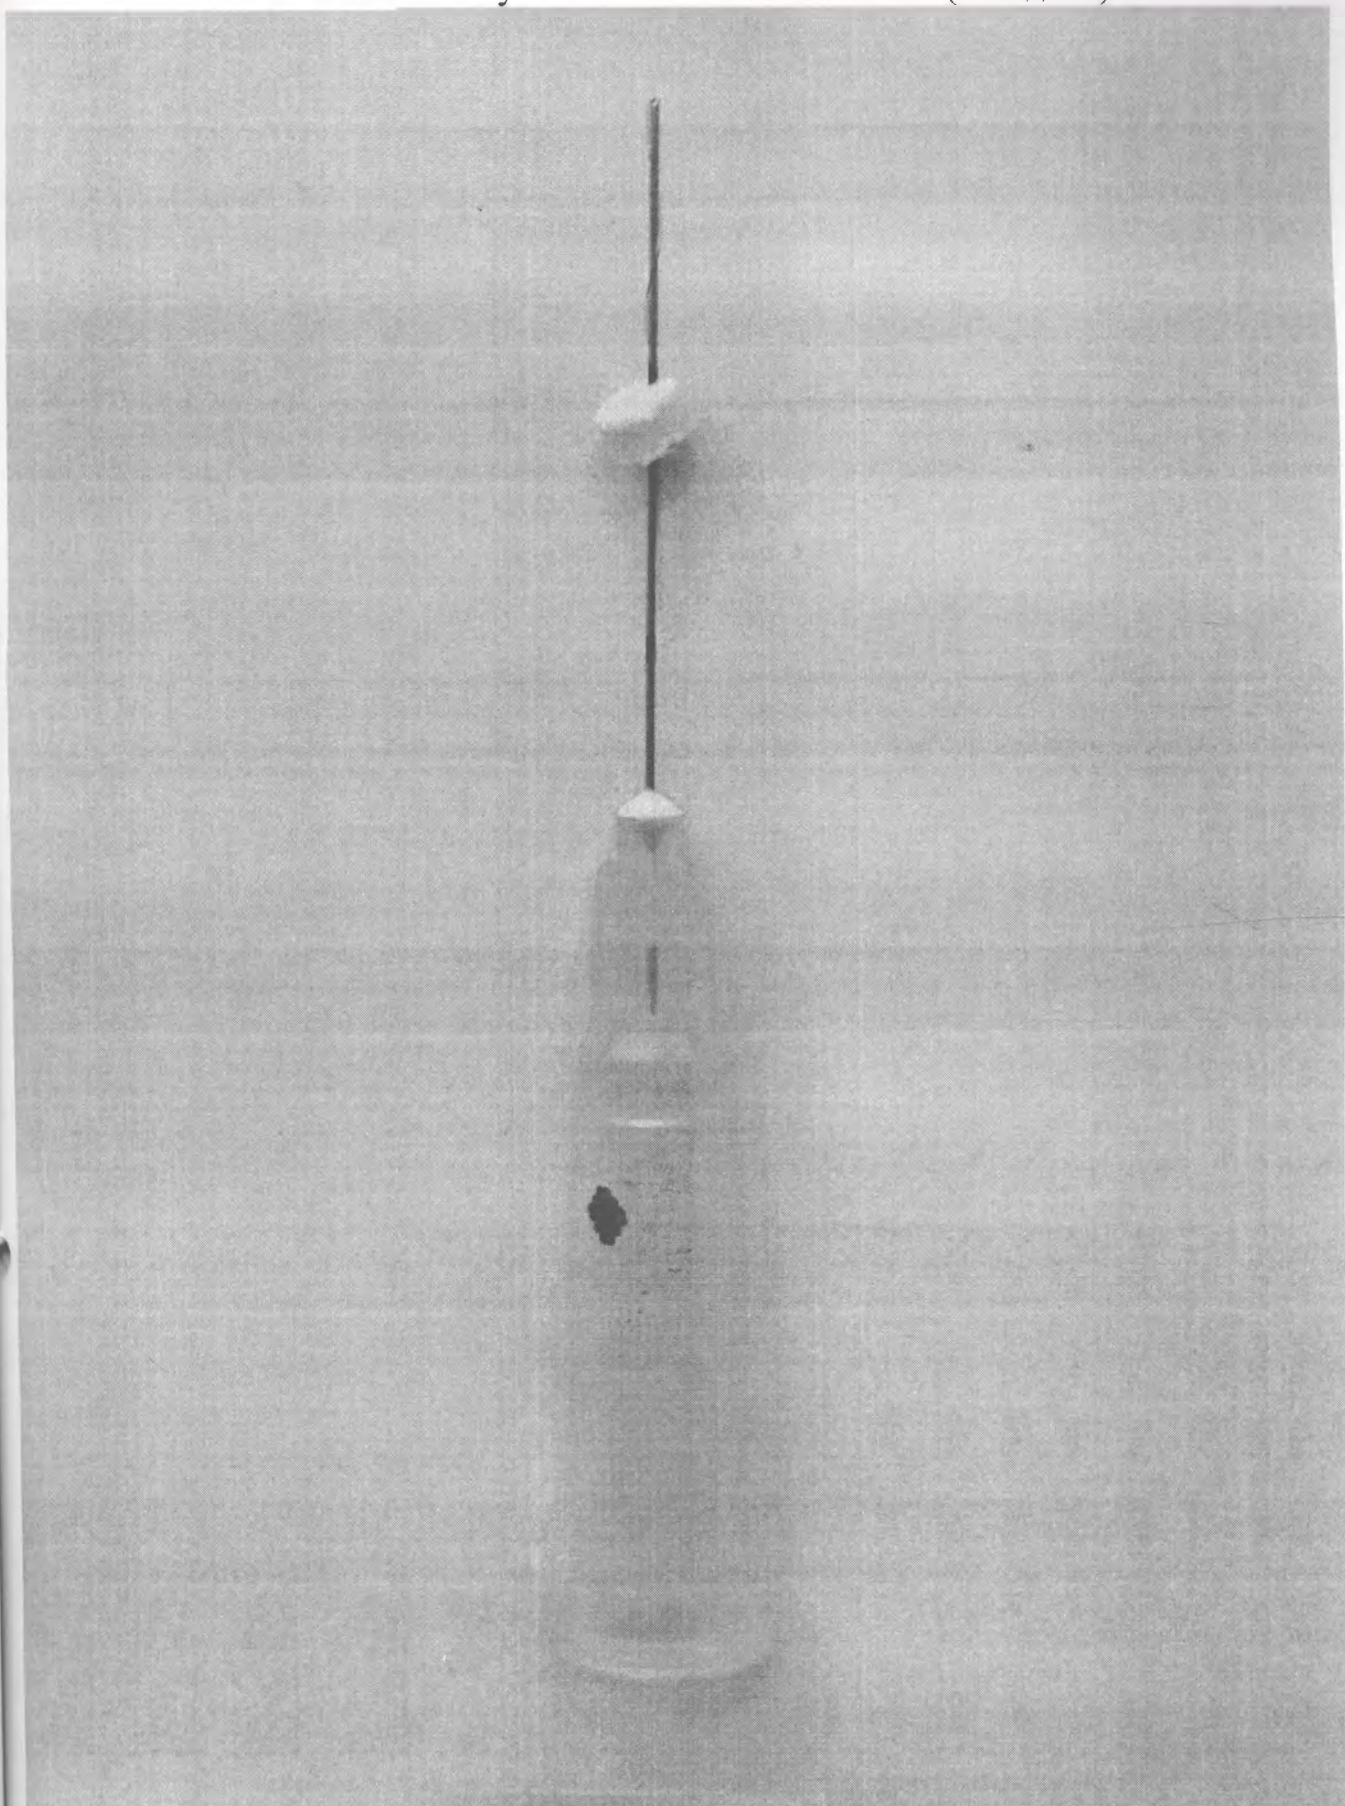


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Обычная нить с тупой иглой – Канюля L тип (4 модели)

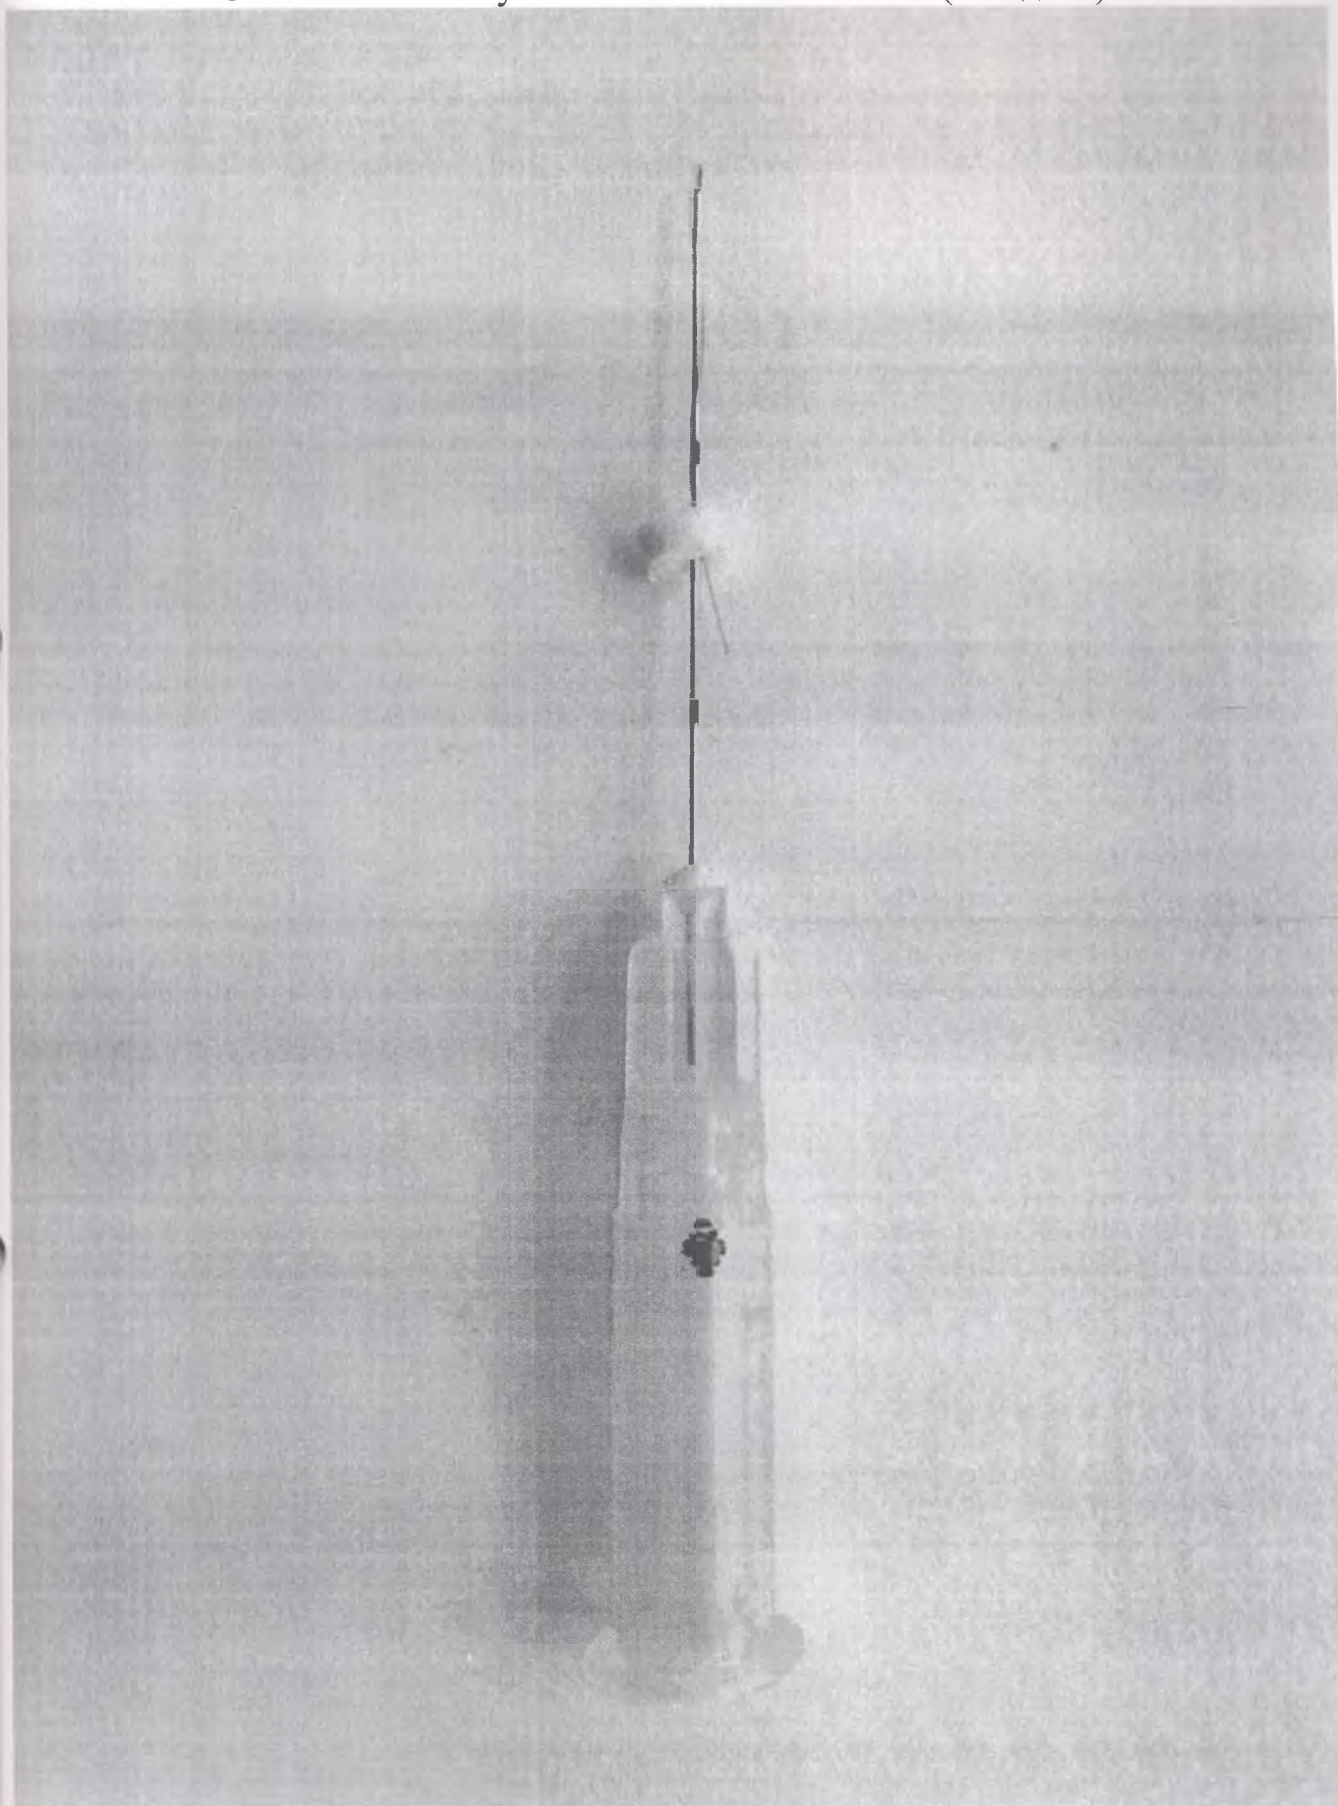


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с иглой – А тип (20 моделей)

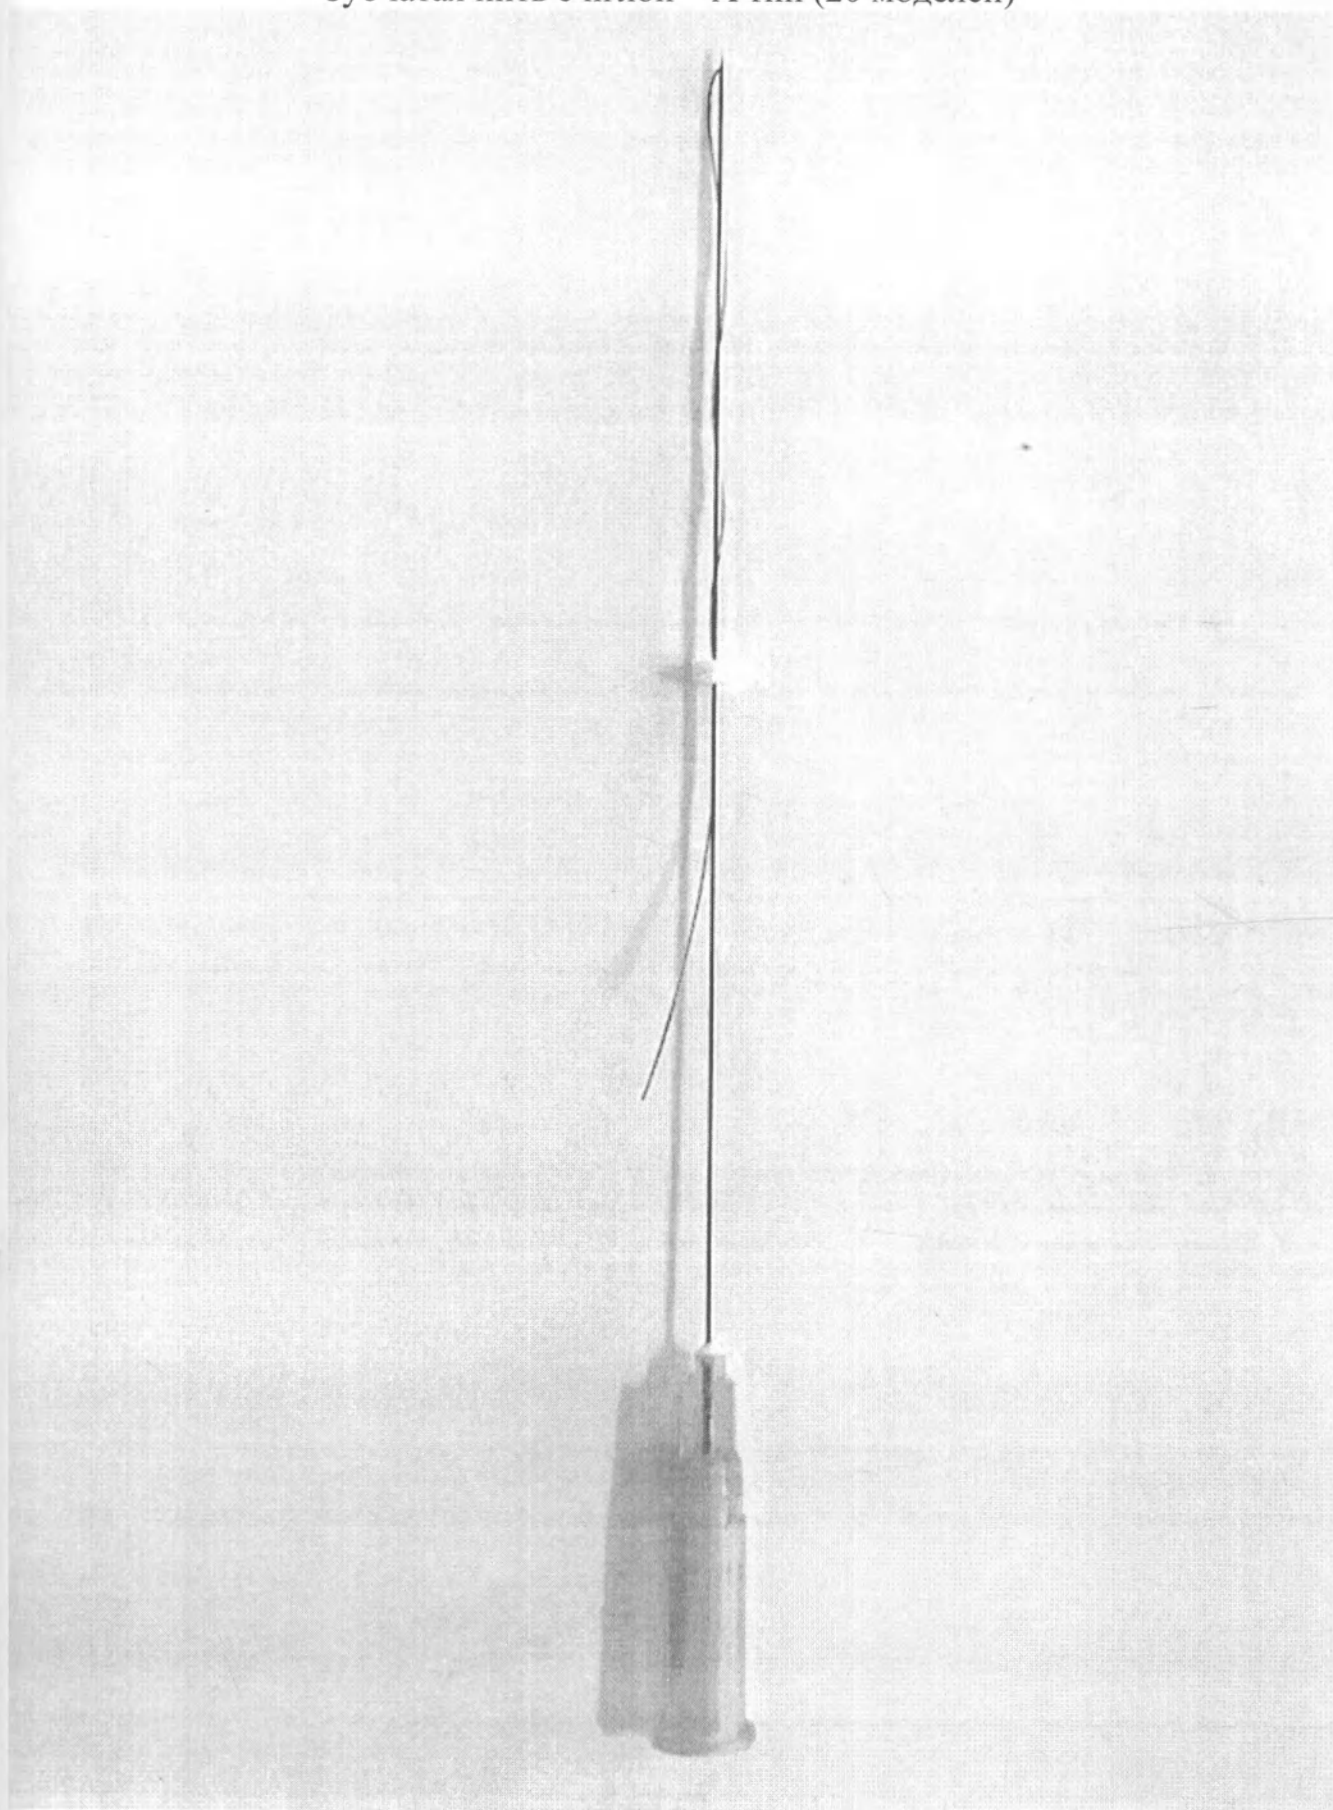


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с иглой – В тип (17 моделей)

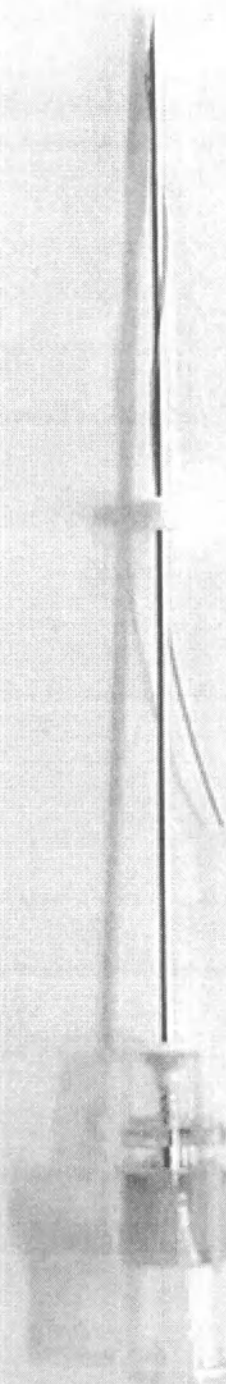


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с иглой – FA тип (17 моделей)

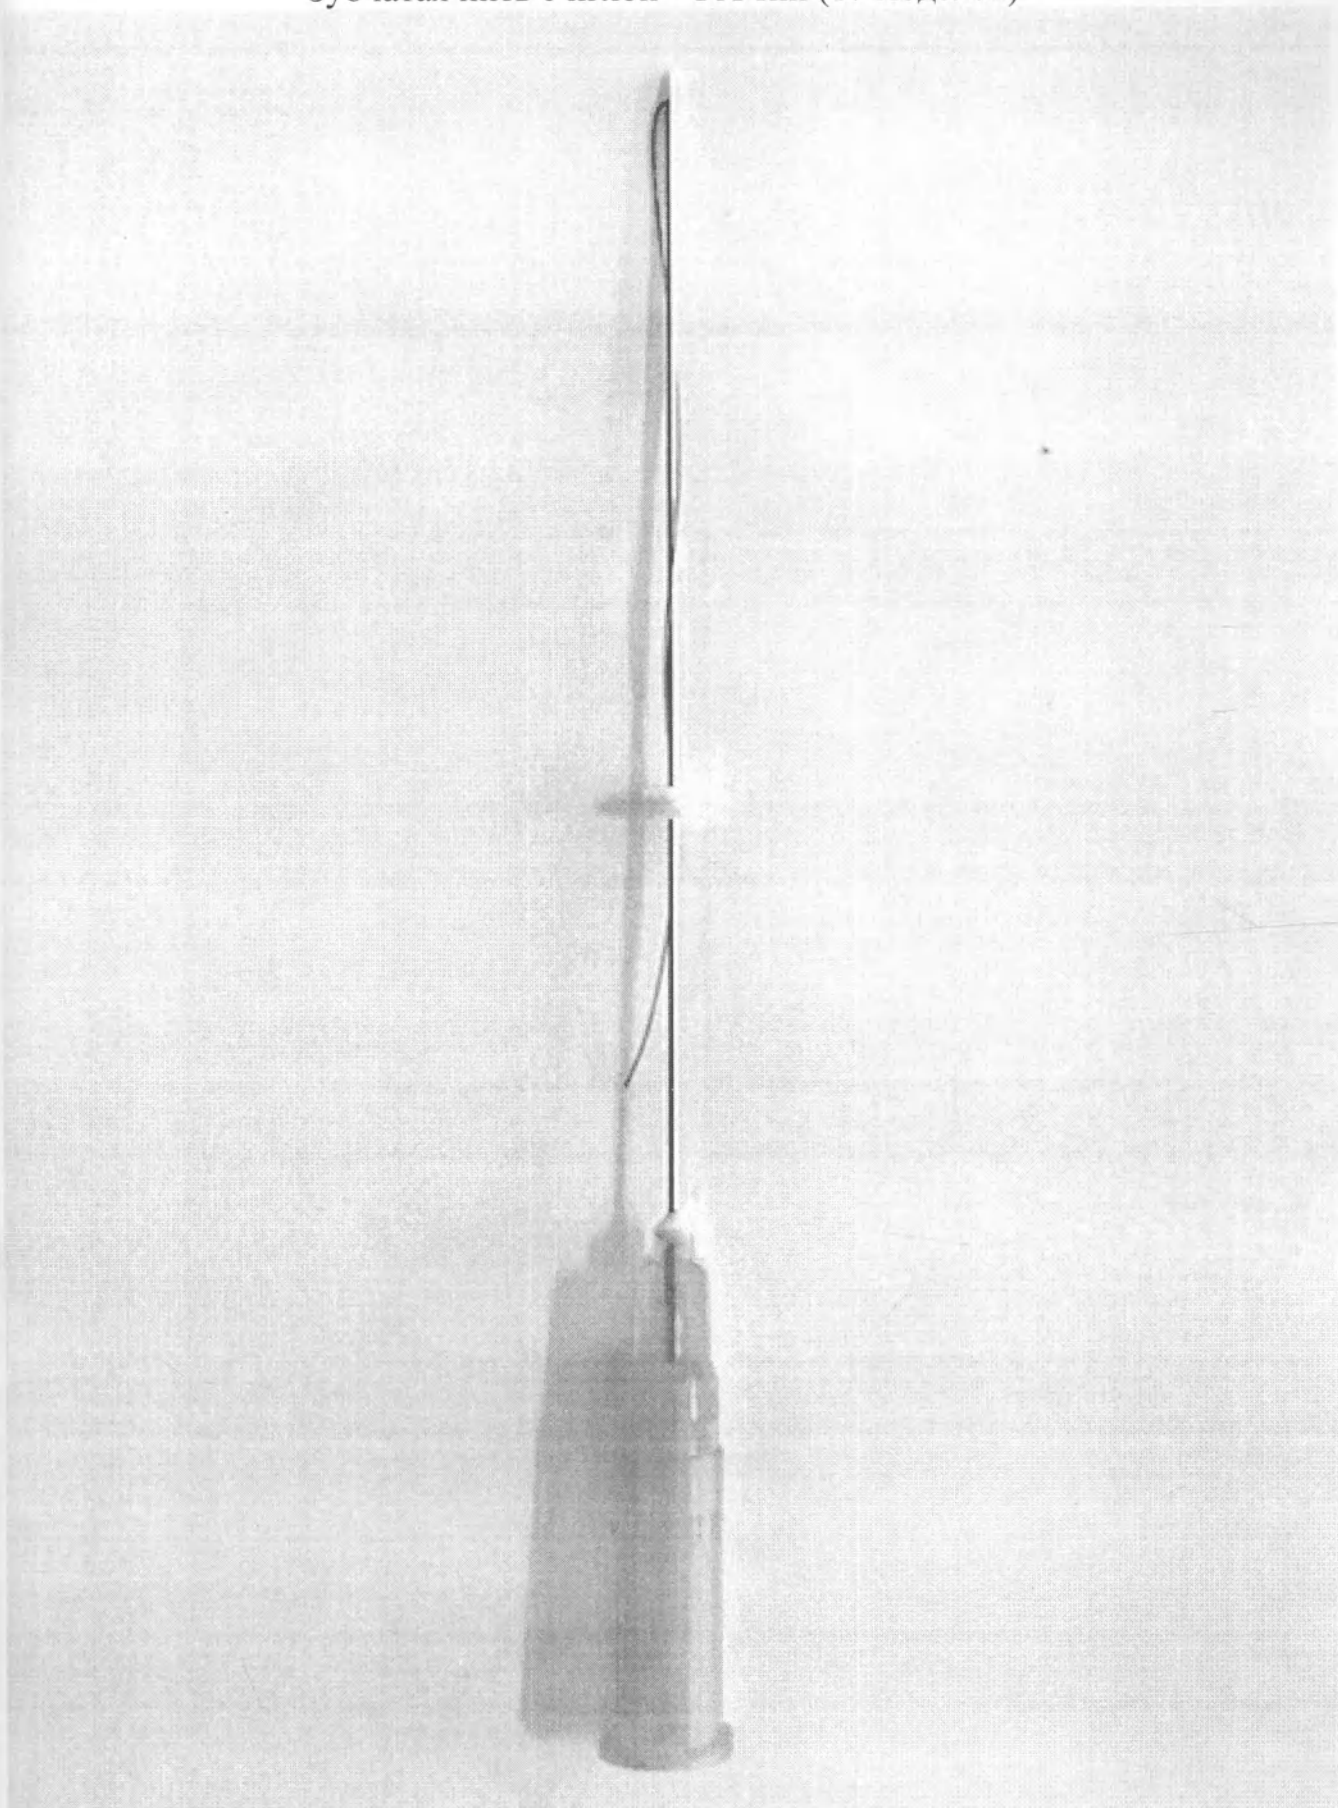


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с иглой – FB тип (17 моделей)

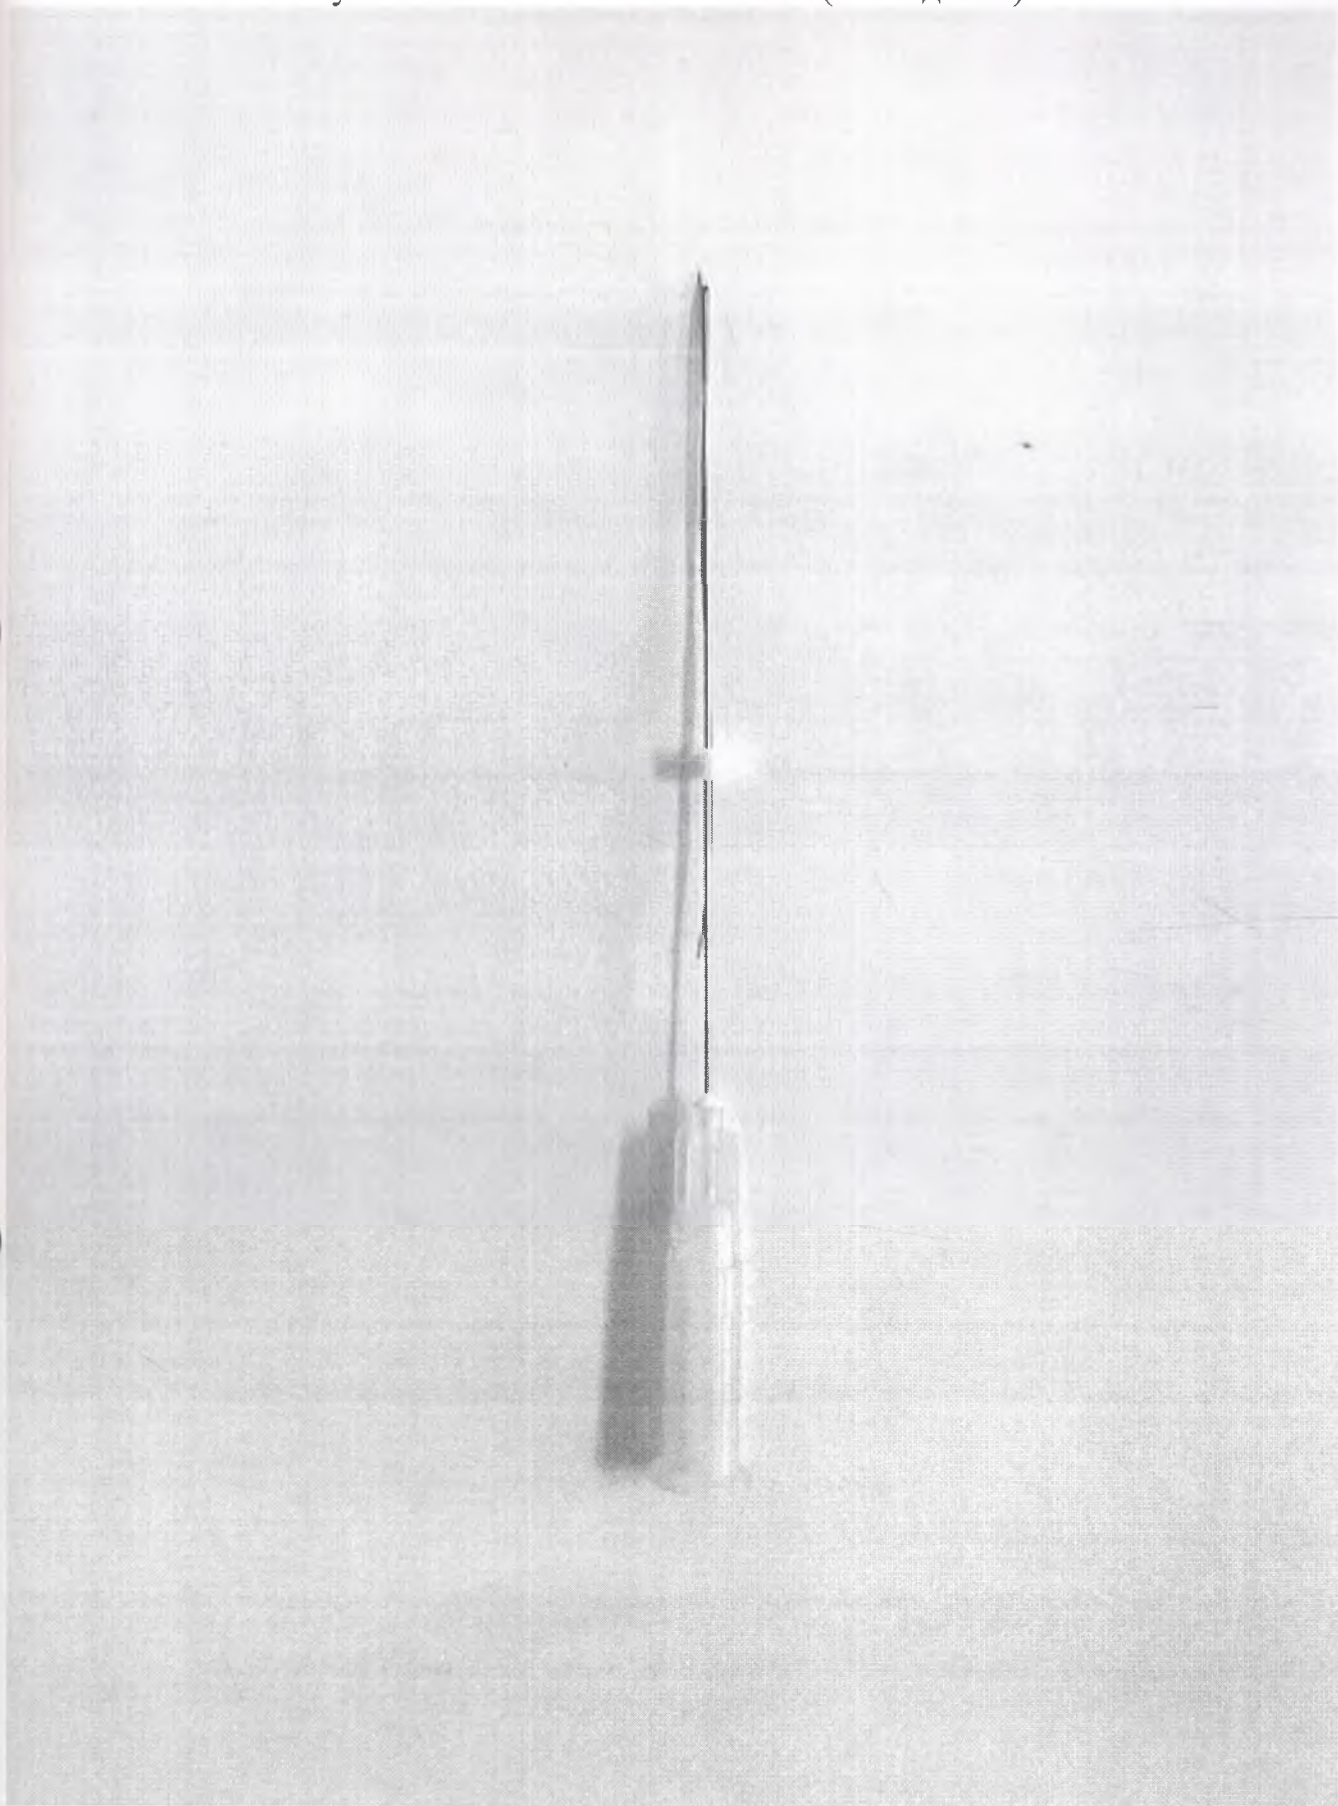


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с иглой – VL тип (15 моделей)

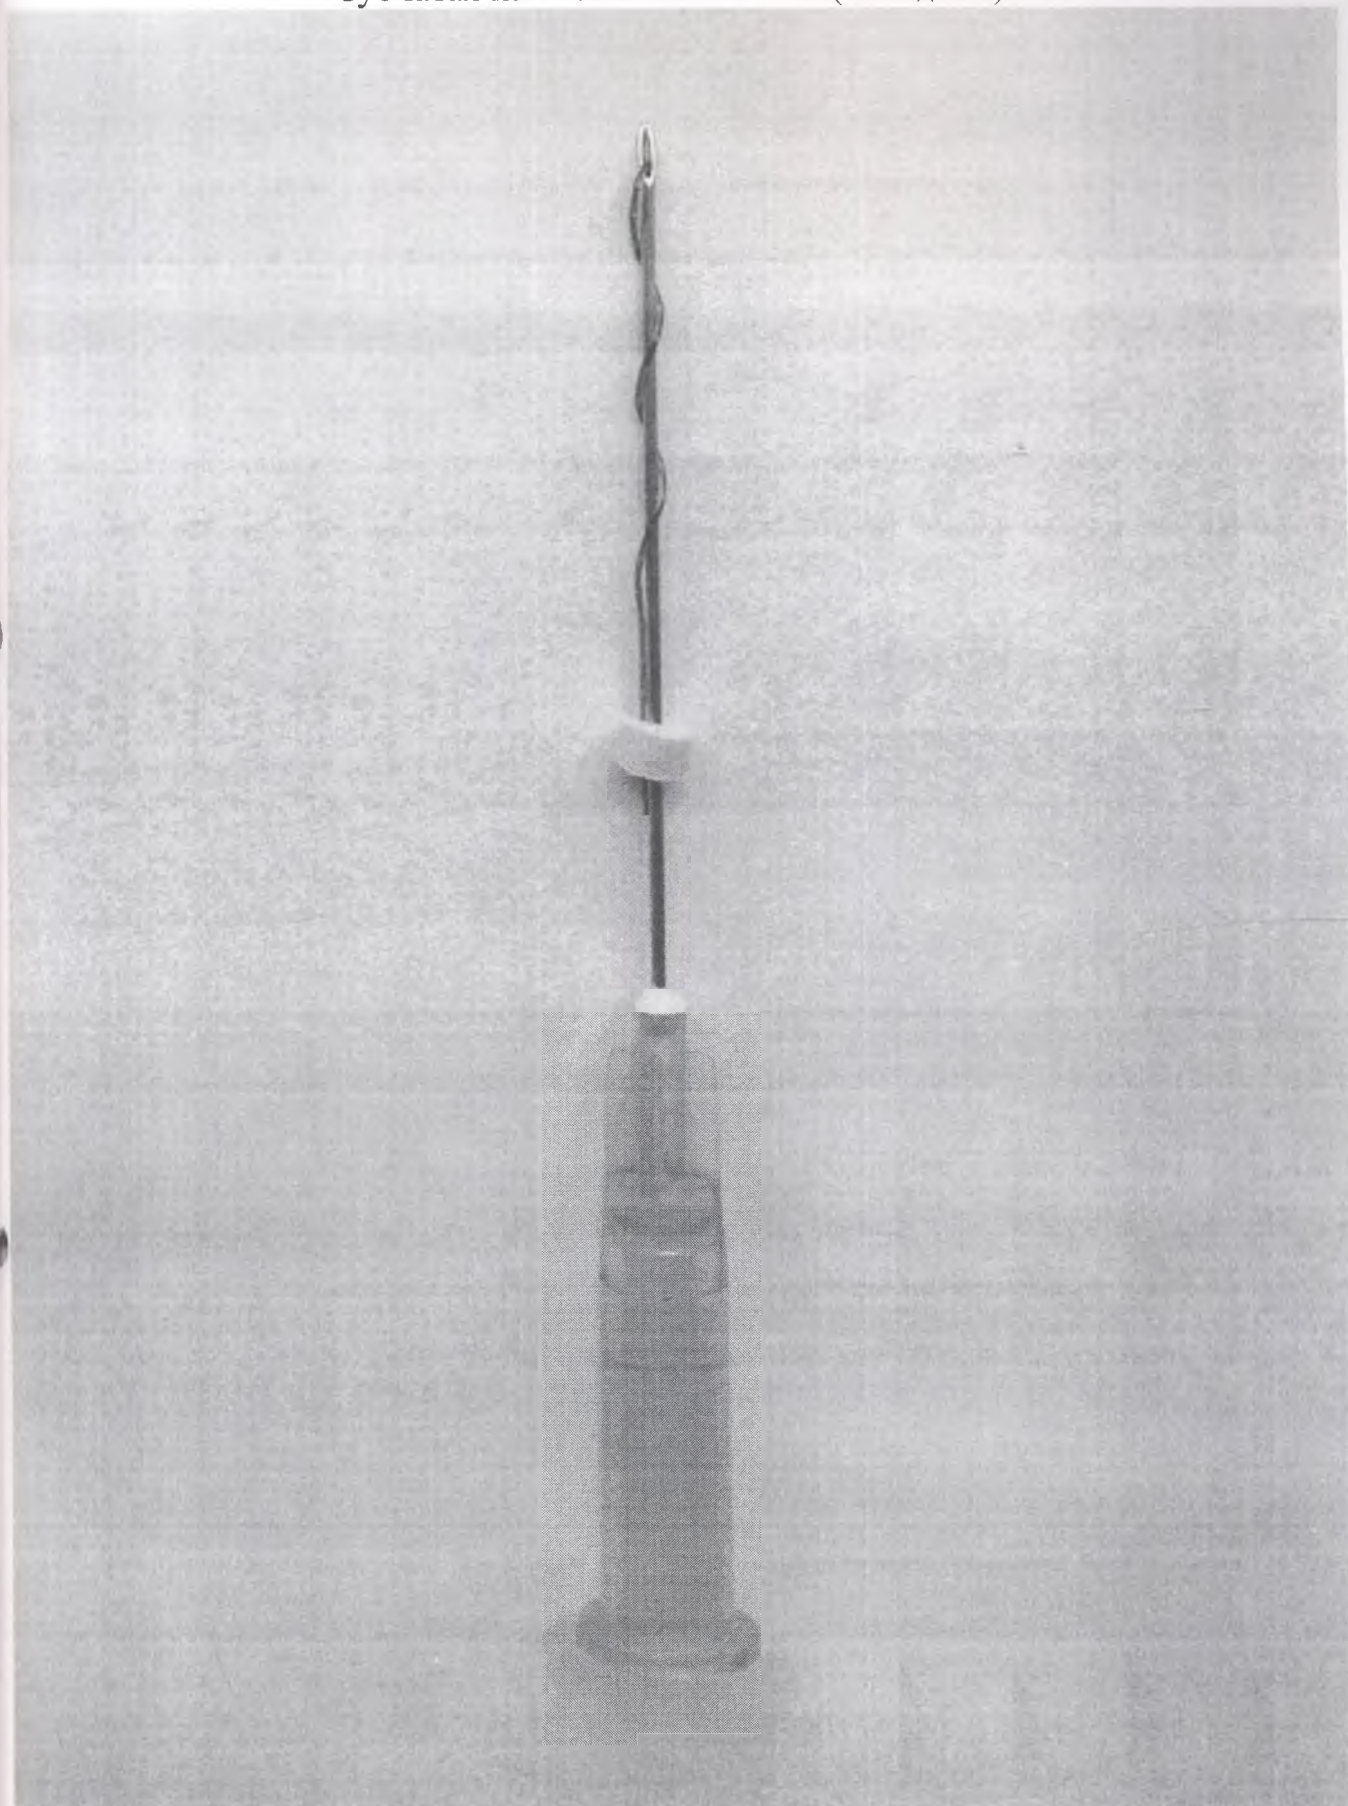


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с иглой – VLS тип (13 моделей)

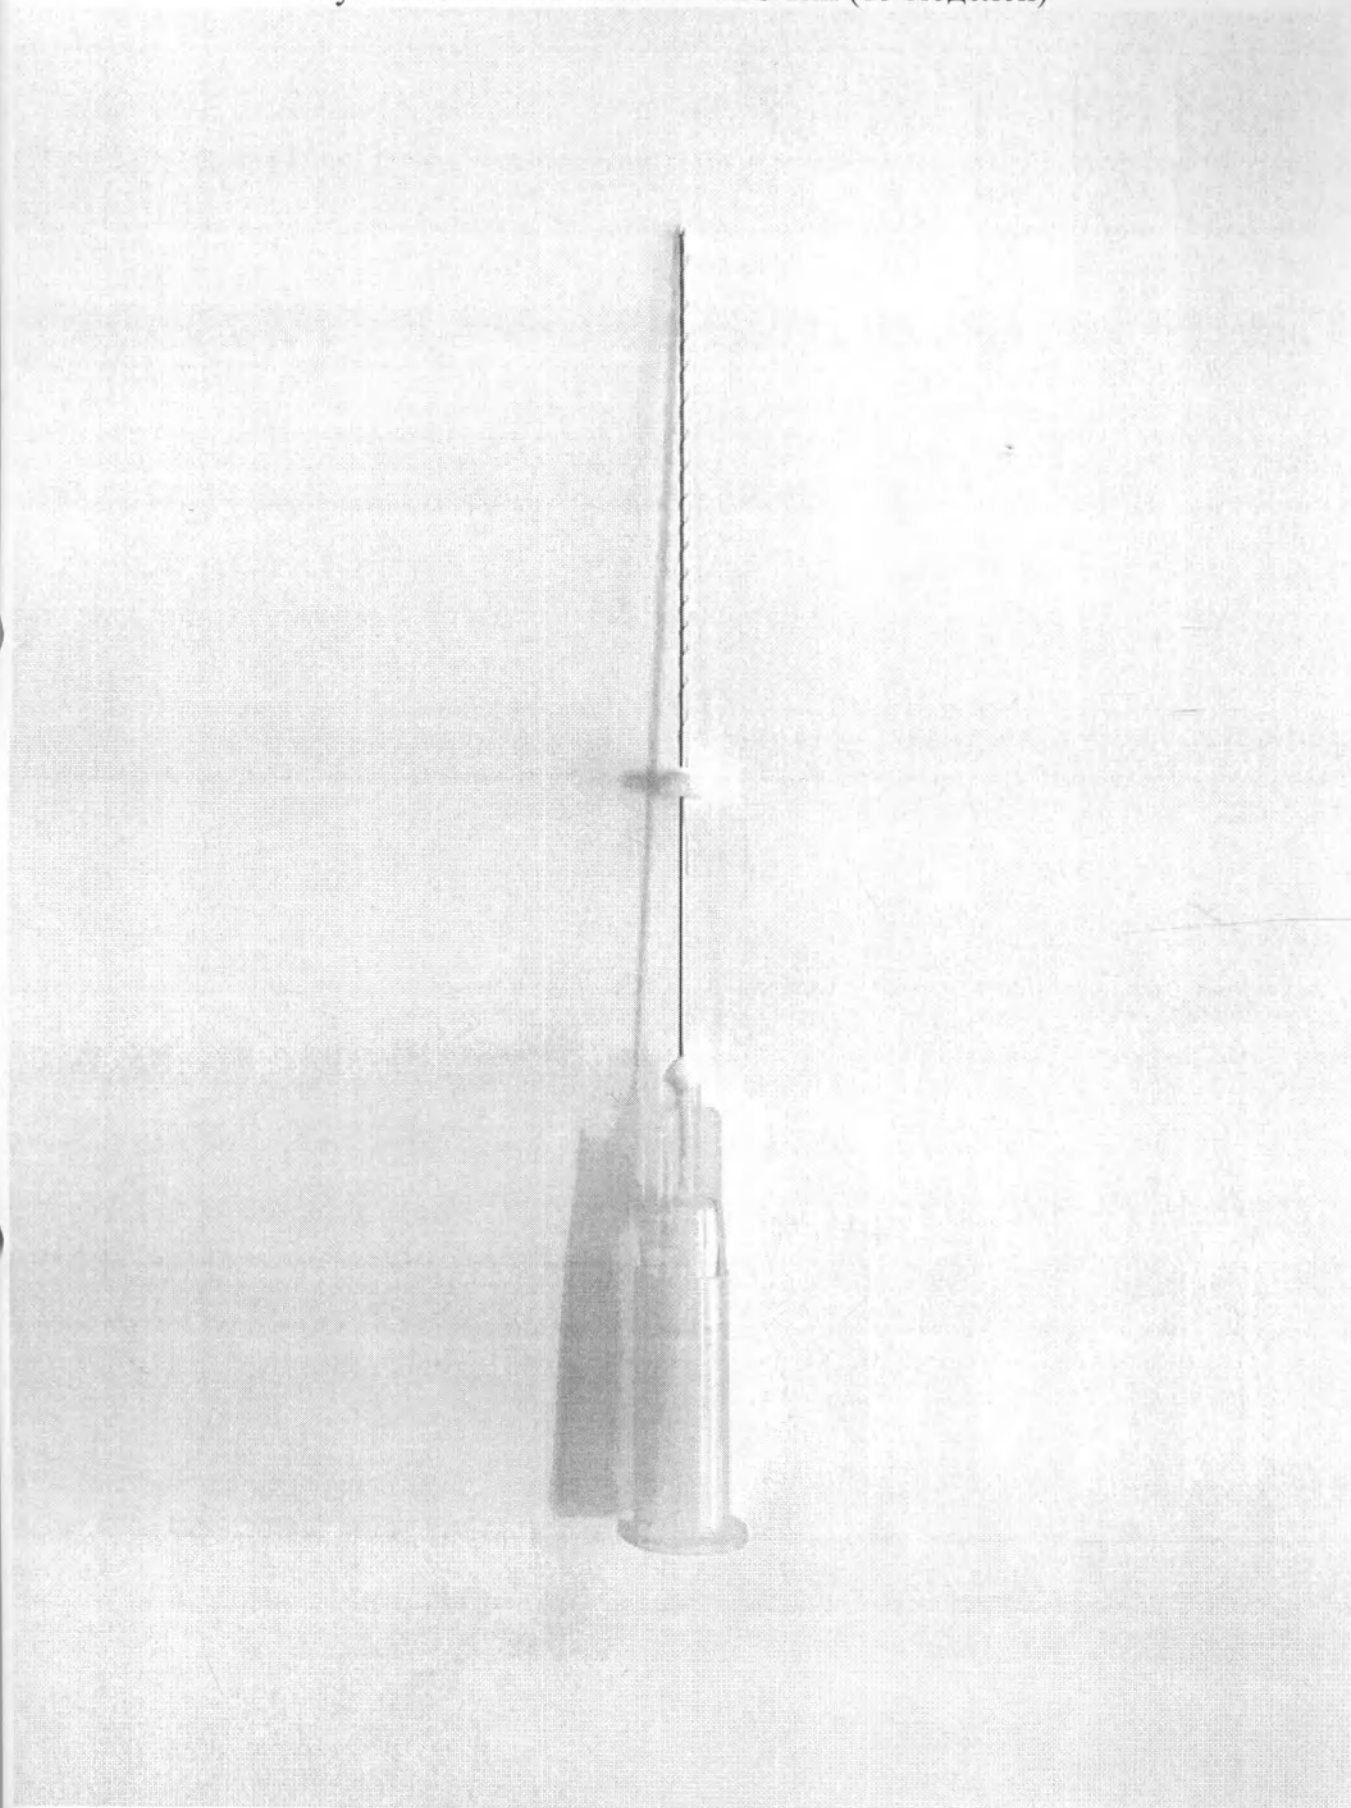

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с иглой – S тип (16 моделей)

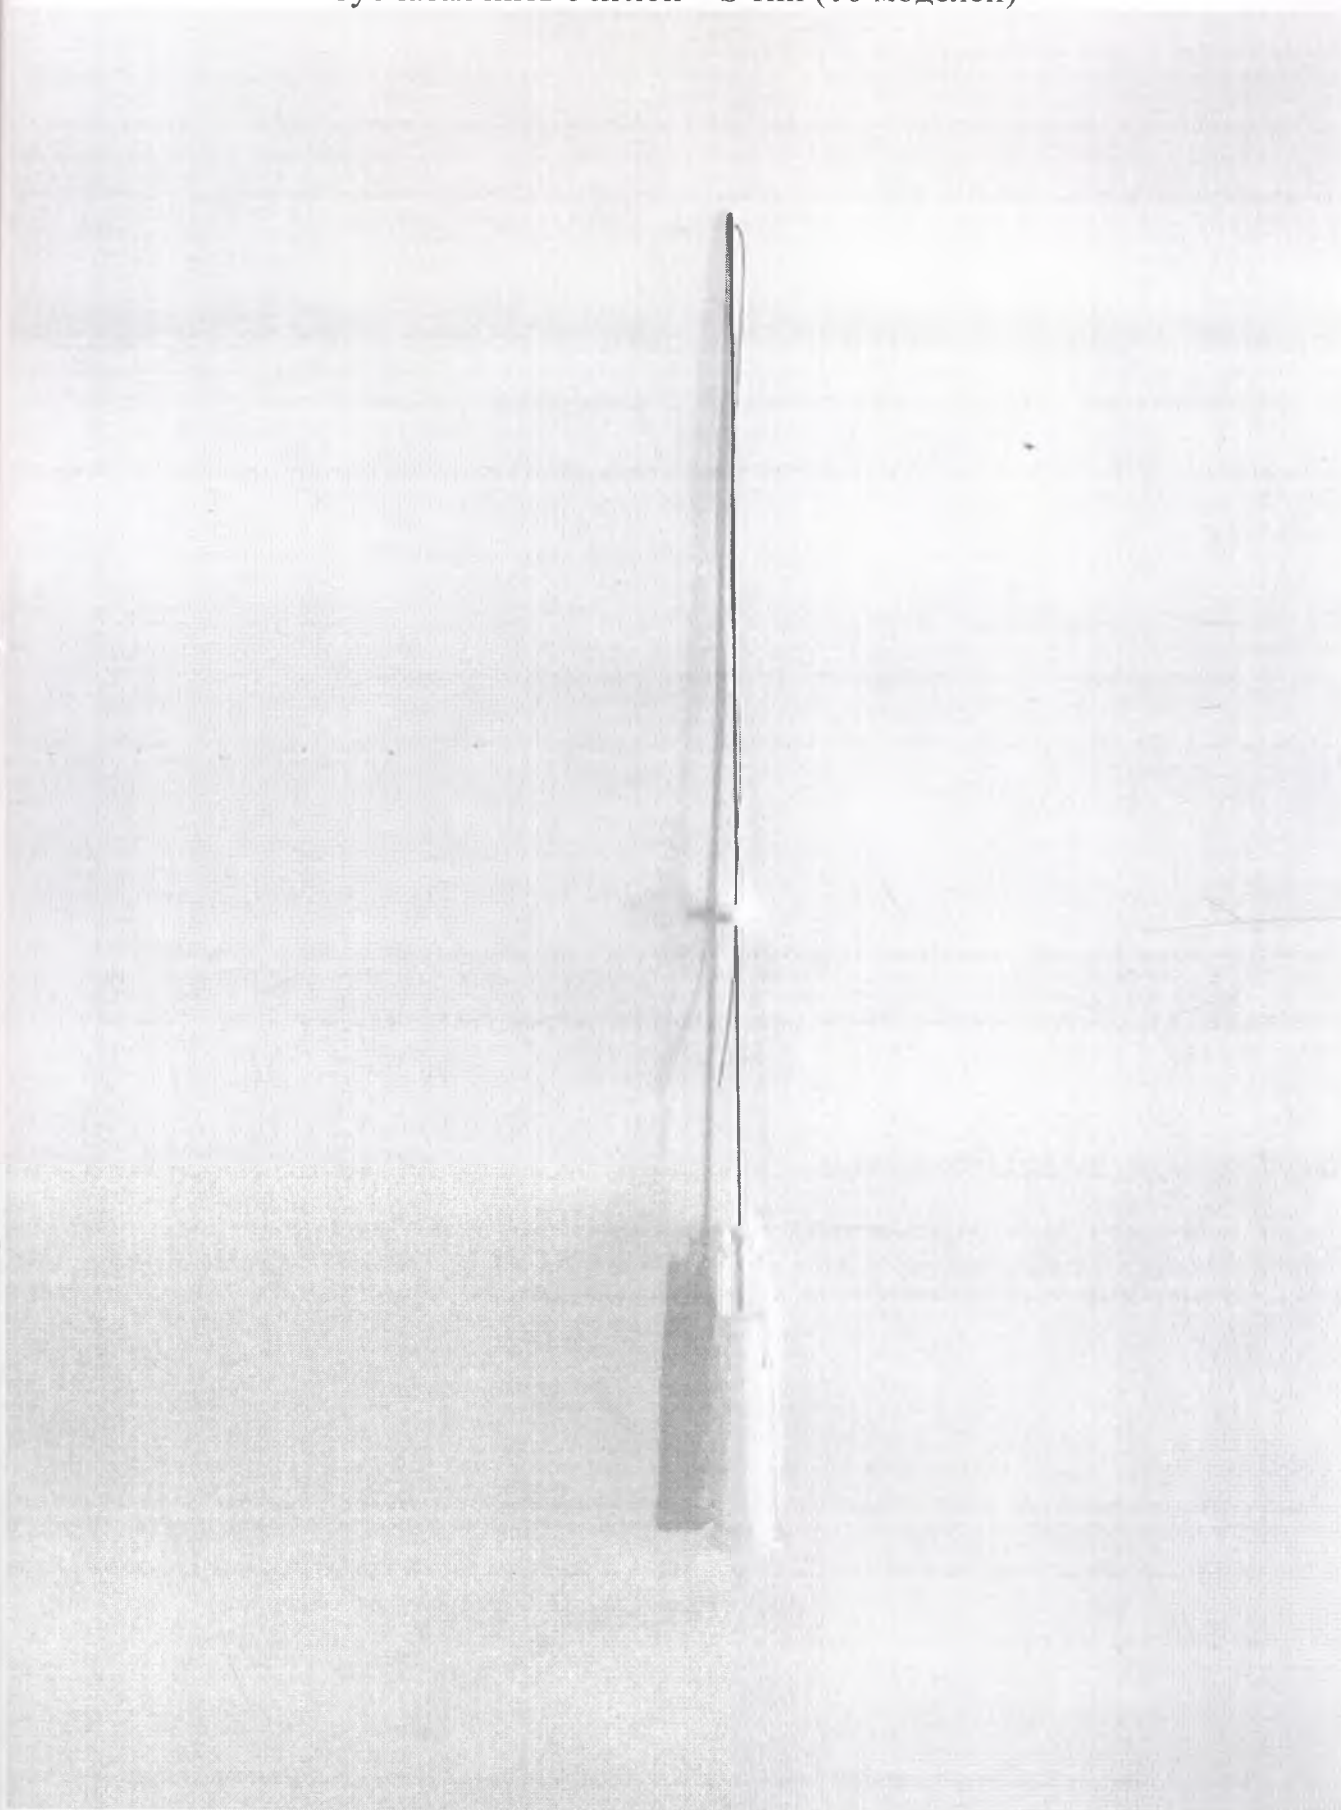

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с тупой иглой – А тип (20 моделей)




Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с тупой иглой – В тип (17 моделей)




Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с тупой иглой – FA тип (17 моделей)

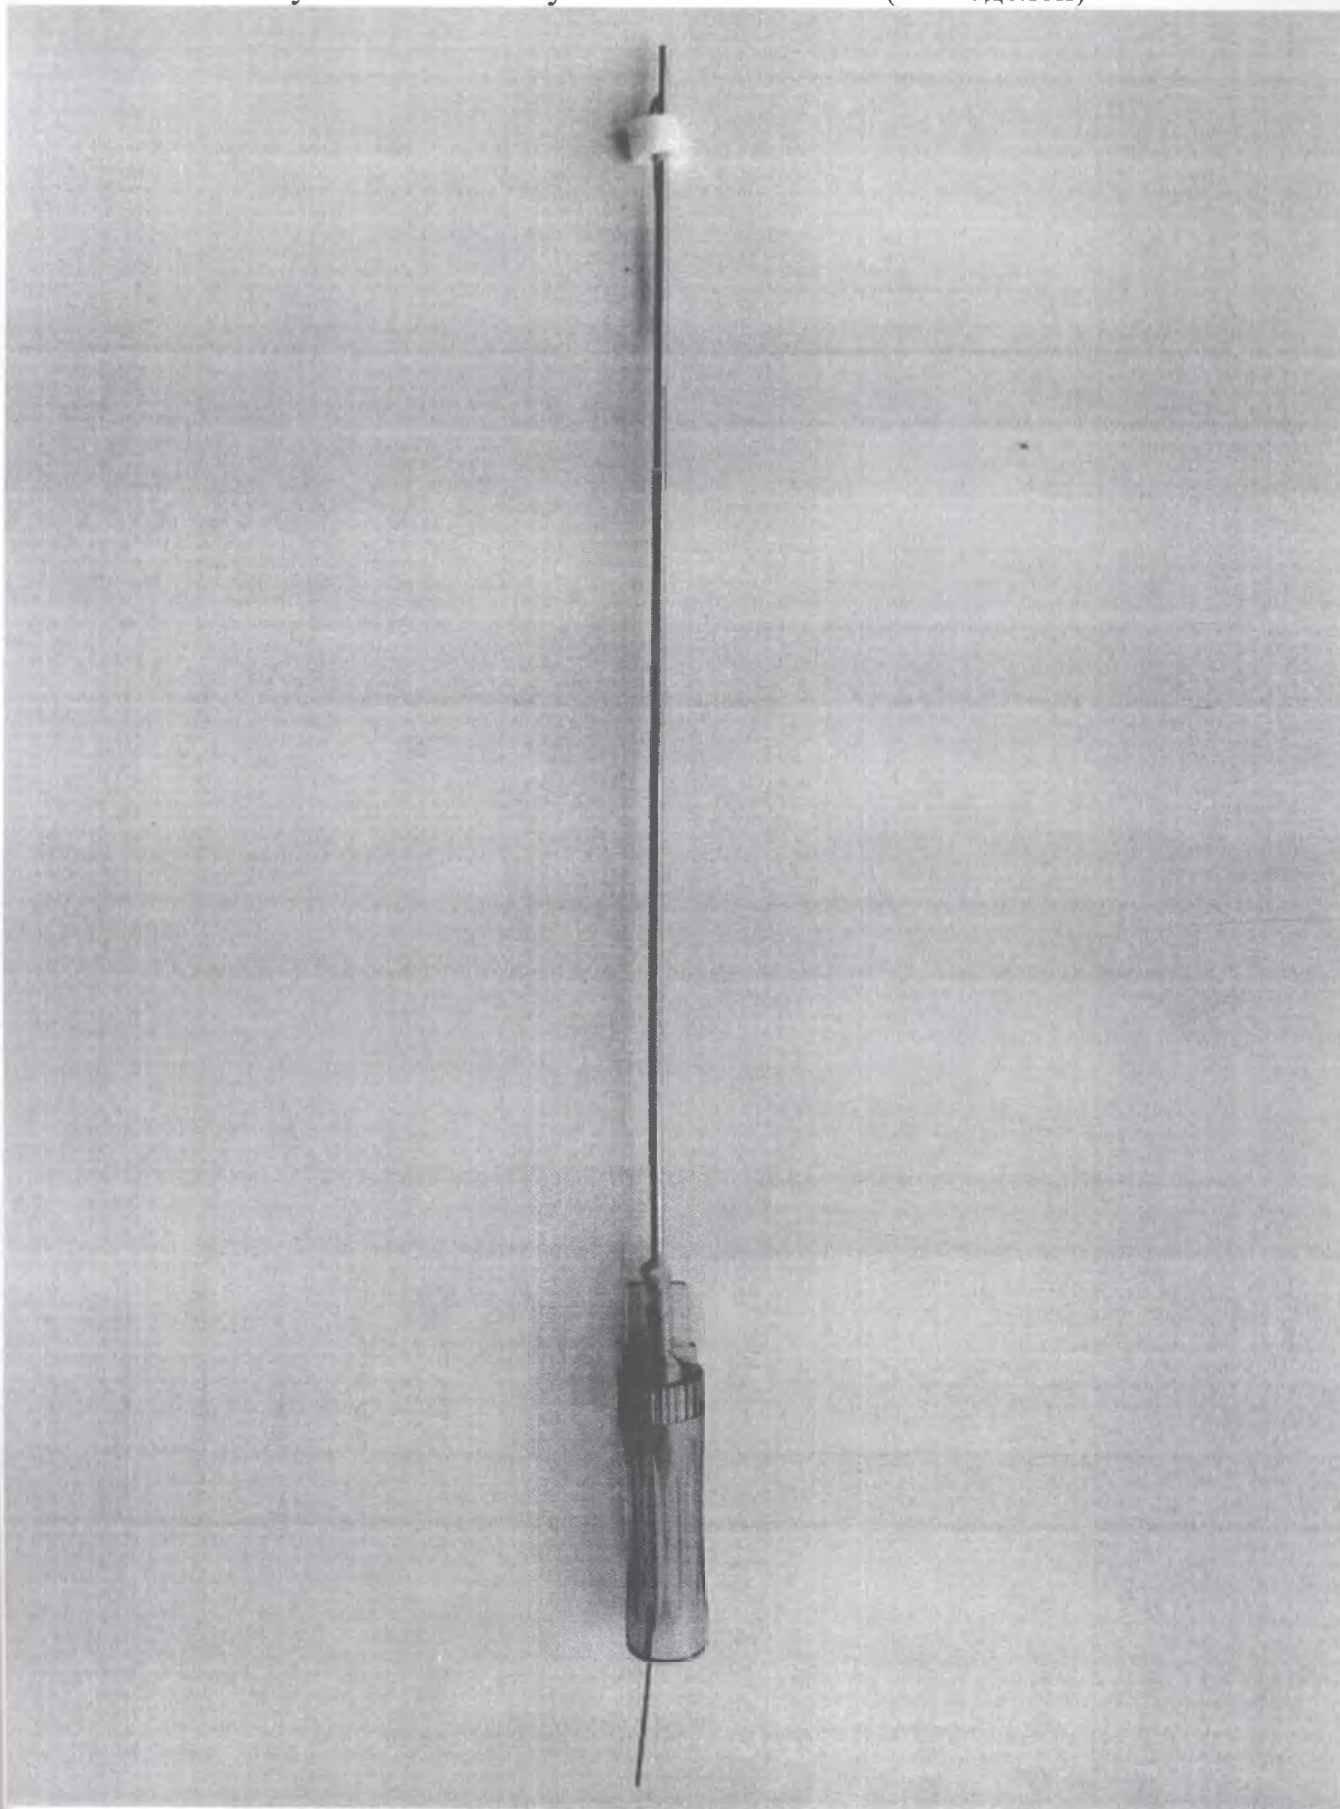


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с тупой иглой – FB тип (17 моделей)

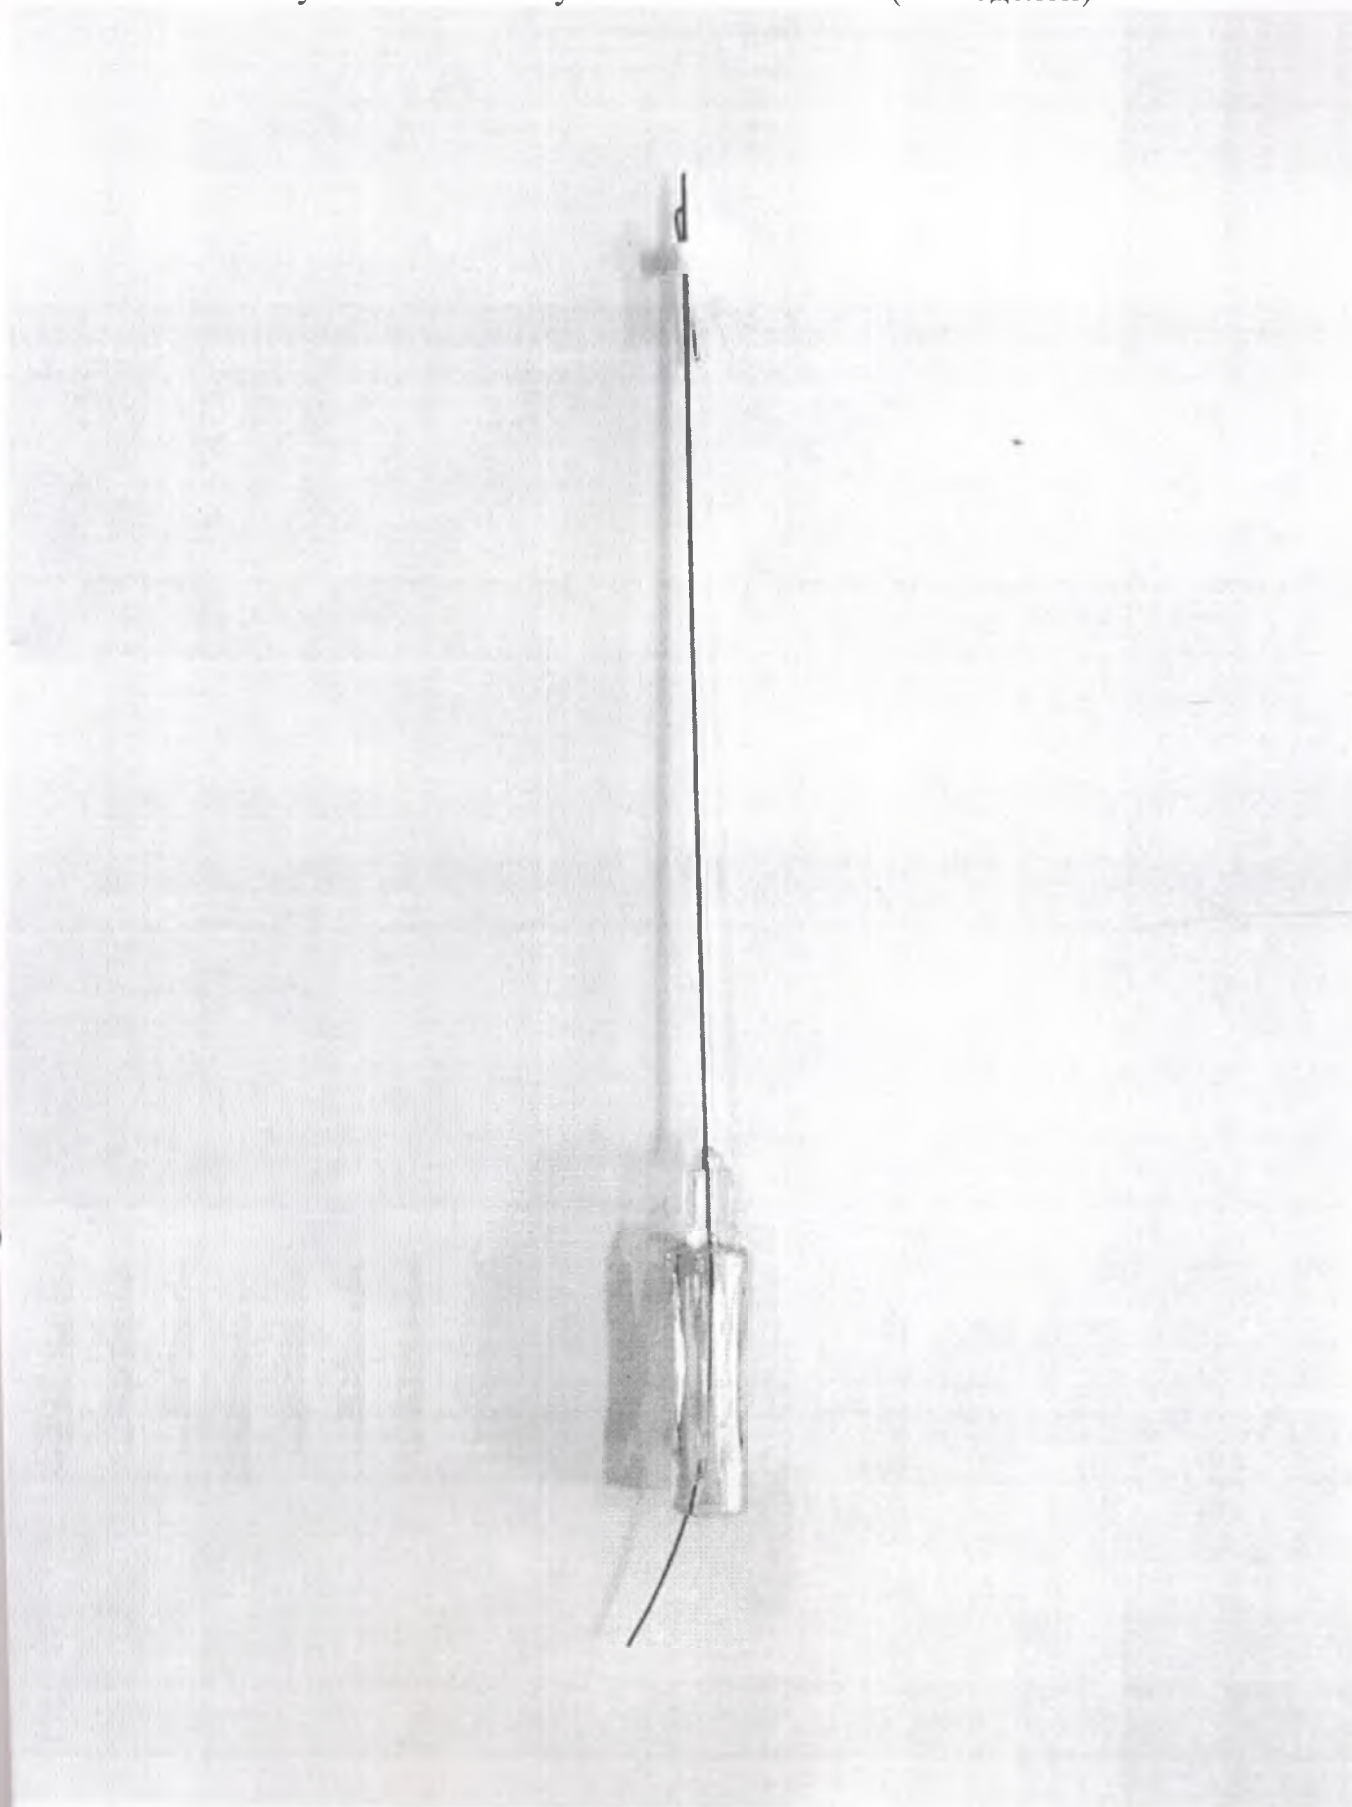


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с тупой иглой – S тип (16 моделей)

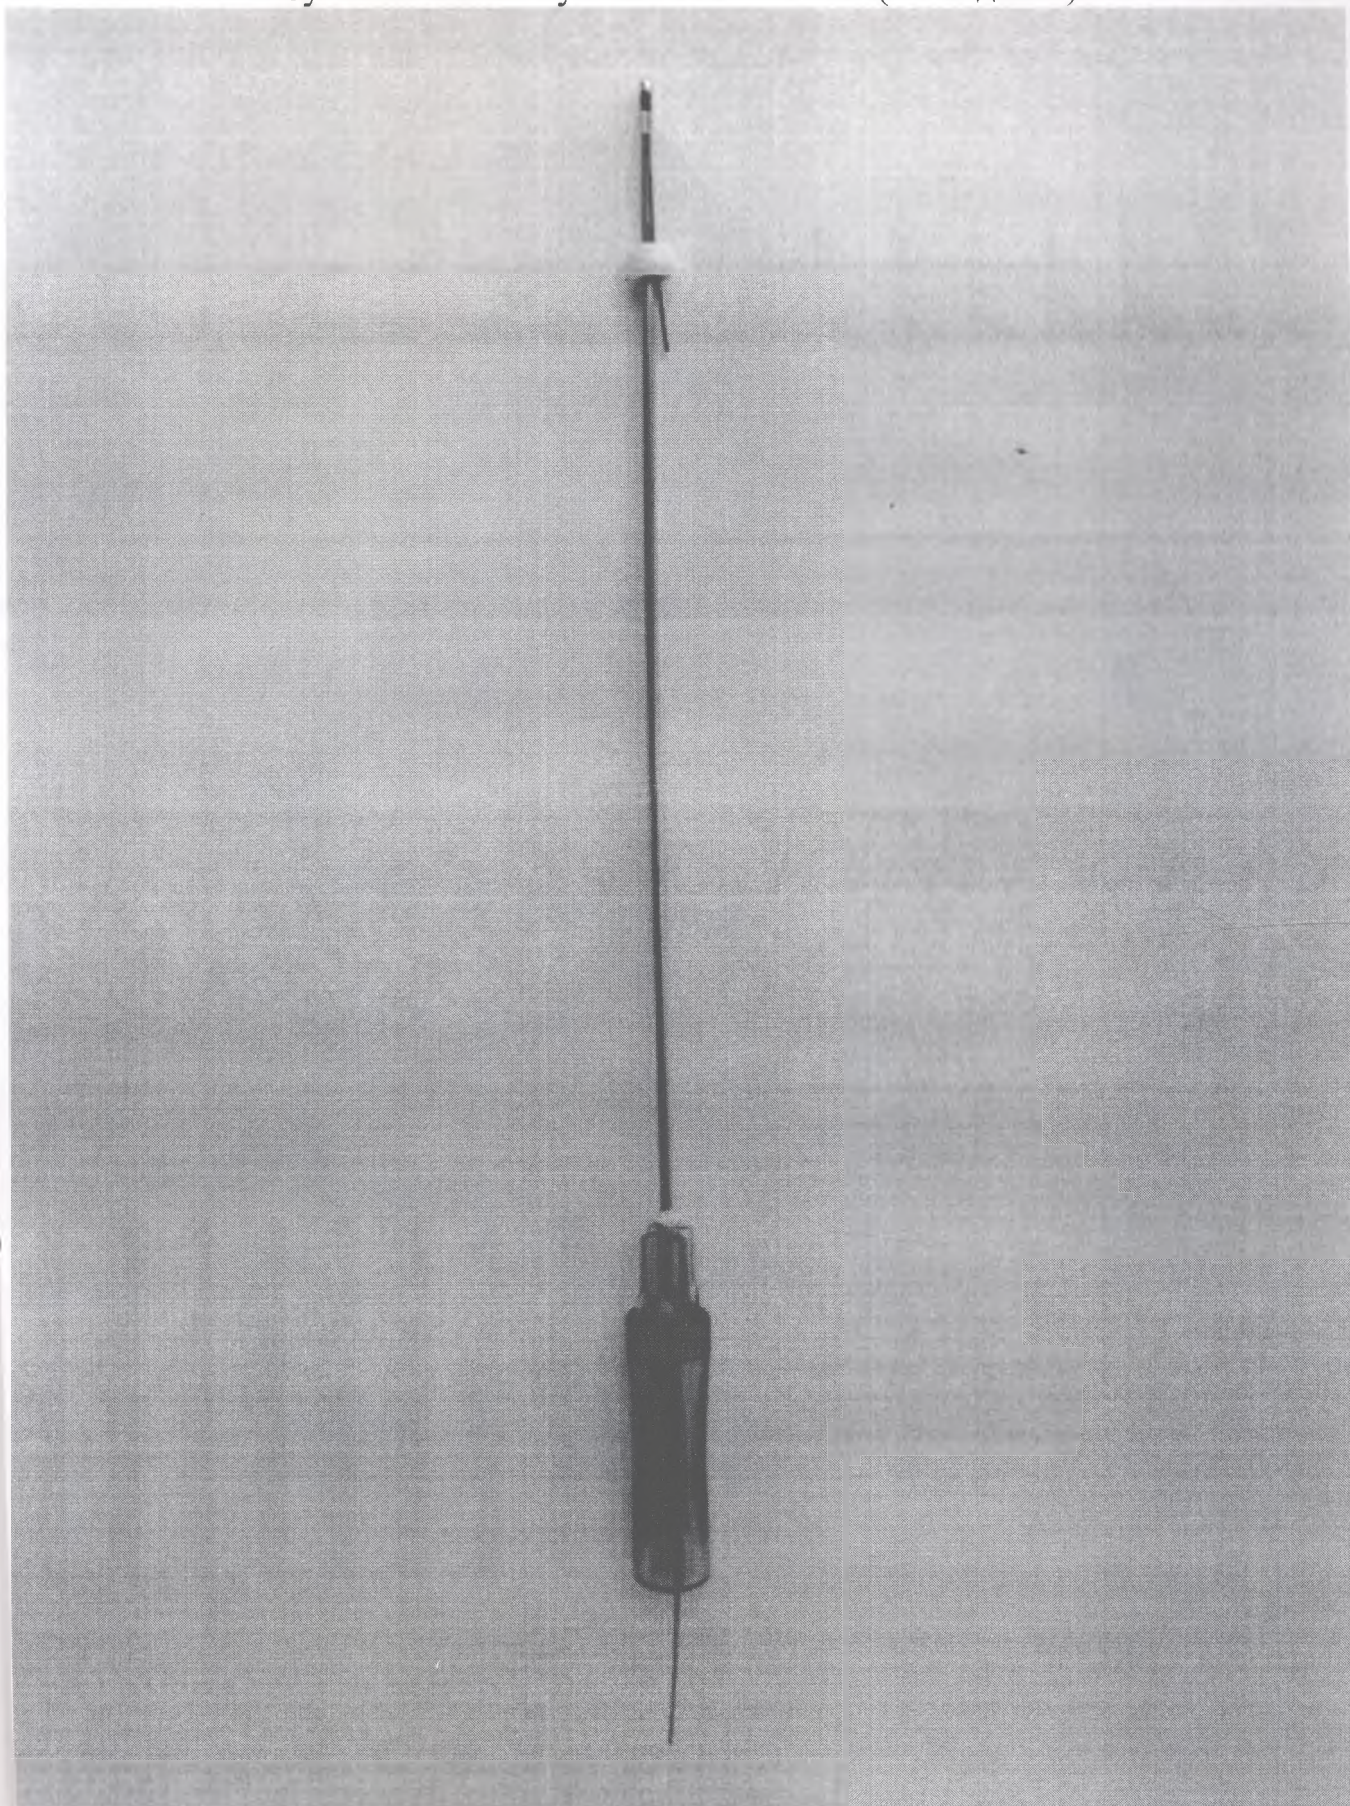

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с тупой иглой – VL тип (15 моделей)

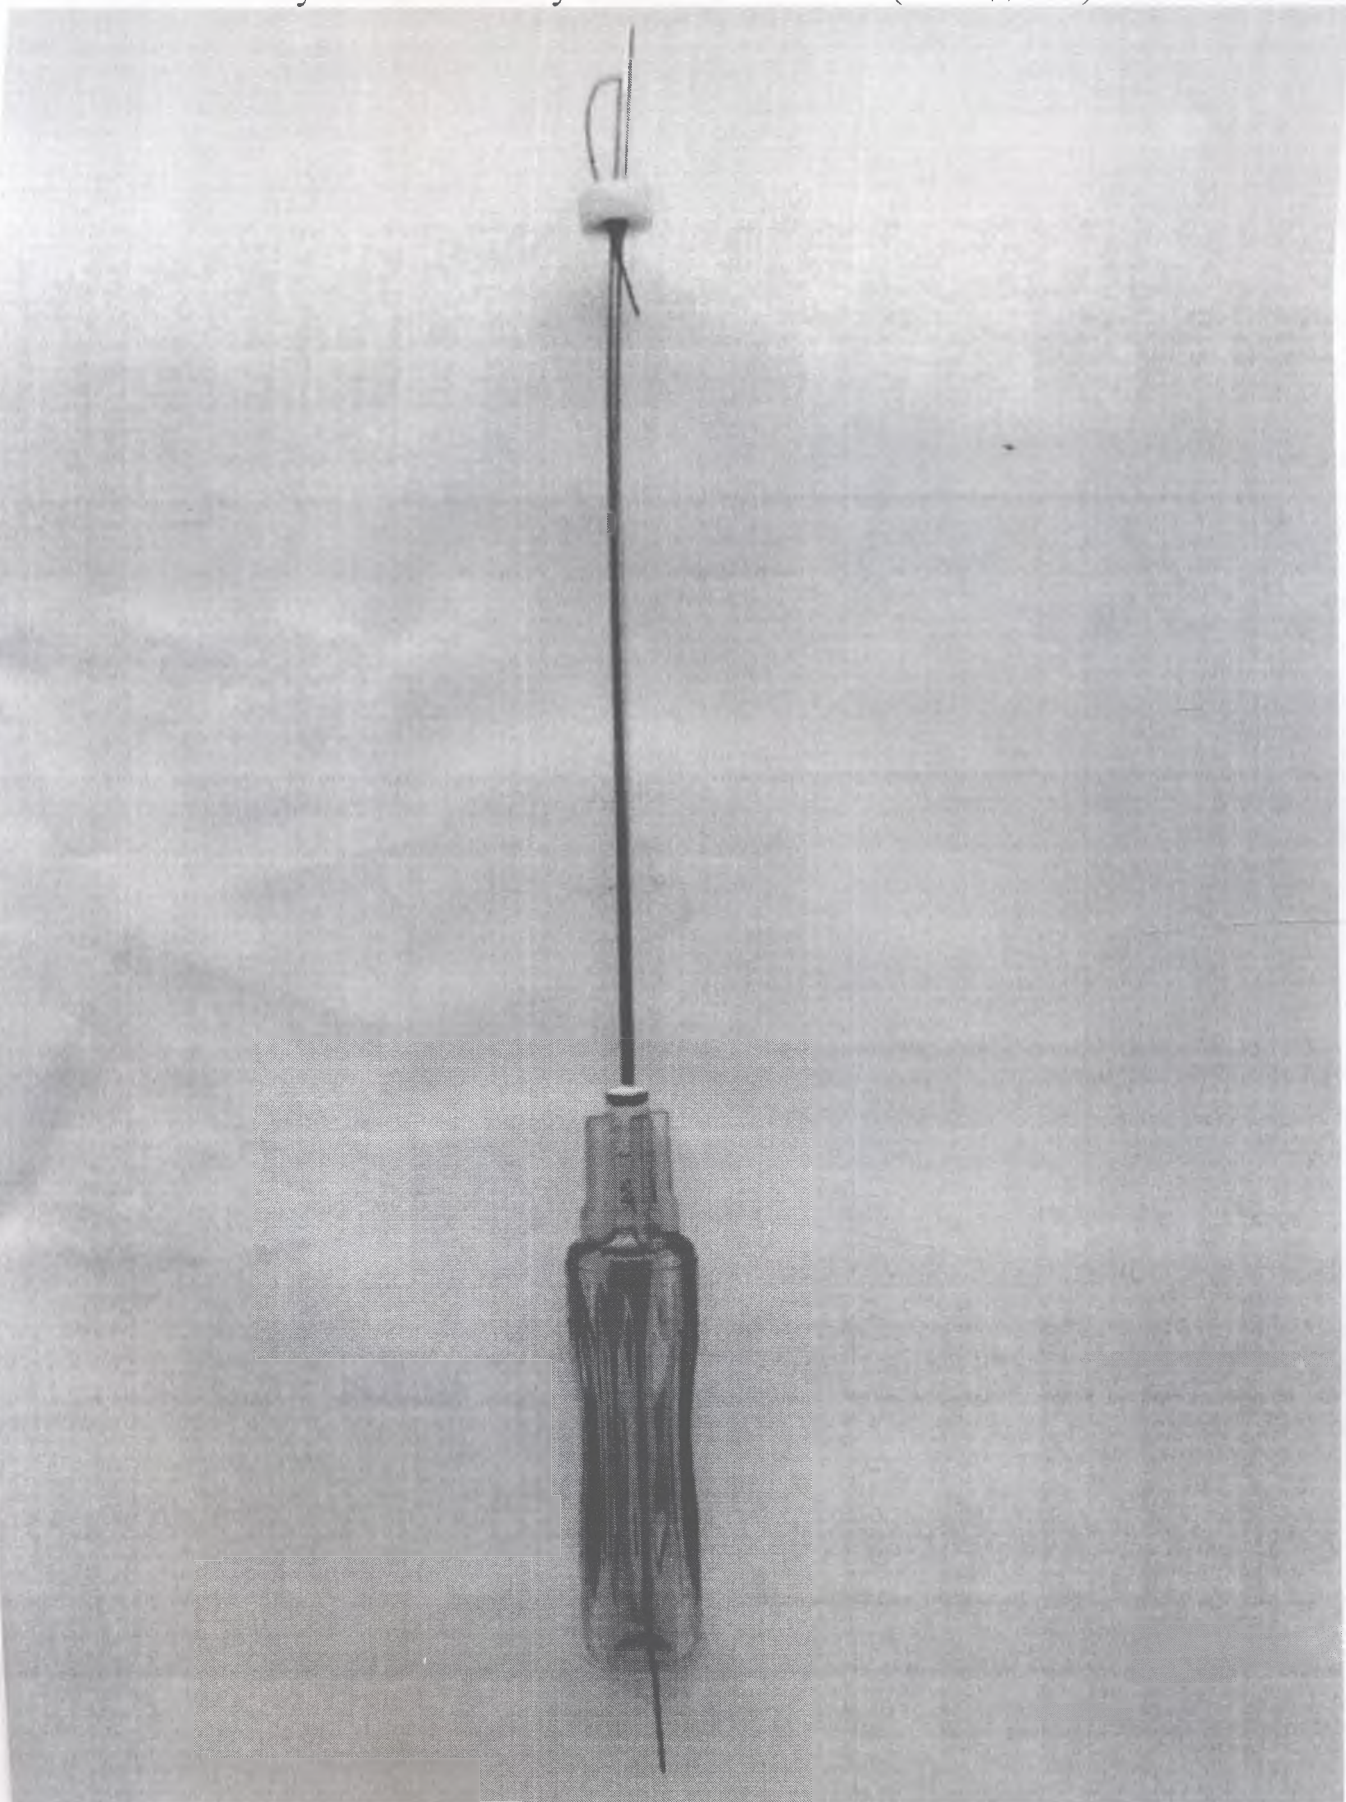

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

29 (двадцать девять) листа(ов)

Должность Генеральный директор

Подпись [подпись] / Ключиков Д.Б.

« 05 » декабря 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «ЭЛАНСКИН»
Д.Б.Клюйков
12 января 2018 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № 1
К ФОТОГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ
медицинского изделия

**Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона
(ПДО) на игле-носителе, варианты исполнения
(см. Приложение на 9 листах)**

[illegible]





bio SUN

100 штук

Удостоверение Исполнитель № 4716
Регистрация на предприятии по дате № 11-1260

KFDA CE 2292



bio SUN

100 штук



«Исследования в области биологии»
Этот документ является частью системы менеджмента качества, разработанной в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015. Документ описывает процесс контроля качества продукции, который осуществляется на всех этапах производства. Документ является частью системы менеджмента качества, разработанной в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015. Документ описывает процесс контроля качества продукции, который осуществляется на всех этапах производства.

Исследования в области биологии
1. Цель: Исследования в области биологии.
2. Область применения: Исследования в области биологии.
3. Методы: Исследования в области биологии.
4. Результаты: Исследования в области биологии.

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе
– Алюминиевый пакет (упаковка)



**BIO
SUN**

Название изделия: Нить рассасывающаяся Biosun,
стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе
**Предварительная подготовка, назначение,
использование / меры предосторожности, для
использования изделия:**

см. Руководство по эксплуатации

Количество в упаковке: 20 штук в упаковке

Номер партии производства:

Дата изготовления:

Метод стерилизации: Стерилизация газом этиленоксида


**Данные изделия являются одноразовыми
стерильными изделиями!**

Срок годности: 1 год со дня даты изготовления

Производитель: Донгвон Медикал Ко., ЛТД.

6F-601, 79-1, Корея, Кванджу, Квансан-гу, Монгён-ро

153 беон-гиль



НИТЬ РАССАКАВЫВАЮЩАЯСЯ В ИОСУМ, СТЕРИЛЬНАЯ ИЗ ПОЛИДИОКСИМАНОНА (ПДО)

«Противопоказания к использованию»

Это изделие предназначено для дисков сформированной нити в приложении к нему. Оно не должно использоваться в реконструктивной хирургии. Полидиоксиманон обладает свойствами к месту имплантации в течение более длительного периода по сравнению с другими синтетическими рассасывающимися полимерными материалами. Это позволяет проводить последующую стандартную стерилизацию изделия и его эффект на тело.

«Необходимо перед использованием»

а) До операции состояние нити должно быть стабильным, только после этого возможно использование.

б) Подготовка: спирто-содержащий антисептический раствор и чистый ватный диск, который используется для орошения нити, который упаковывается в стерилизатор.

в) Проверьте целостность упаковки выбранного изделия.

д) Проверьте срок годности изделия.

е) Проверьте упаковку на наличие повреждений.

ж) Используйте, пометку изделия, как использовать это изделие на тело.

«Как использовать в хирургии»

а) Если вы используете в хирургии изделие, убедитесь, что оно не повреждено.

б) Перед применением изделия, из упаковки выньте изделие по рекомендованной дозировке.

в) Из упаковки выньте, упакованное изделие.

г) Вспомогательное изделие вкрутите в изделие.

д) Убедитесь, что на изделие не попадают загрязнения, деформации или трещины.

е) Это изделие должно использоваться в течение 12 месяцев.

ж) Место имплантации изделия должно быть обработано спиртовым ватным диском.

з) Сочетание спирто-содержащего антисептического раствора.

и) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

к) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

л) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

м) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

н) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

о) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

п) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

р) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

с) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

т) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

у) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

ф) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

х) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

ц) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

ч) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

ш) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

щ) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

ъ) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

ы) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

ь) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

э) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

ю) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

я) Из упаковки выньте изделие в руку (субинъектный слой) в необходимом месте для доставки изделия в место имплантации.

«Меры предосторожности»

а) Это изделие должно использоваться только врачом.

б) Не используйте изделие, срок хранения которого истек.

в) Не используйте изделие, которое повреждено.

г) Это изделие не используется в нить, кроме предназначенного использования.

д) Это изделие должно использоваться медицинскими работниками, врачом.

е) Если есть в предполагаемом месте имплантации участки кожи, имеющие признаки воспаления, или пациент имеет другие инфекции, данное медицинское изделие не может быть использовано.

«Способ хранения»

а) Хранить в чистом и сухом помещении.

б) Избегать прямых солнечных лучей и высокой влажности.

«Противопоказания»

Если в истории болезни пациента есть расстройства сердечно-сосудистой системы, повышенное кровяное давление, гипертония, а также аллергия и т. д., обратитесь к врачу.

Регистрационное удостоверение №

НИТЬ РАССАКАВЫВАЮЩАЯСЯ В ИОСУМ, СТЕРИЛЬНАЯ ИЗ ПОЛИДИОКСИМАНОНА (ПДО) НА ИГЛЕ-НОСИТЕЛЕ

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР



Аккредитованная лаборатория на территории России:
ООО «СОЛДАТОВСКИЙ» Россия, 19004, Невский пр., д. 10, к. 1, 191015, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: info@soldatovskiy.ru
д. 10, к. 1, Тел.: 8 (813) 217-7777, 8 (813) 104-8478, E-mail: info@soldatovskiy.ru

Дистрибуция: ООО «Мед-Тек»
г. 401, 19-1, Космодром, Космический центр, 191015, Санкт-Петербург, Россия
Тел.: 8 (813) 45-45-5551, Факс: 8 (813) 45-45-5552

Внедрение: ООО «Вектор»
г. 401, 19-1, Космодром, Космический центр, 191015, Санкт-Петербург, Россия
Тел.: 8 (813) 45-45-5551, Факс: 8 (813) 45-45-5552



bio
SUN

KFDA CE 2292



10 штук

НИТЬ РАССАСЫВАЮЩАЯСЯ BIOSUN, СТЕРИЛЬНАЯ ИЗ ПОЛИДИОКСАНОНА (ПДО) НА НЕЖИ-НОСИТЕЛЕ

«Предполагаемое использование»

Это изделие предназначено для фиксации субкапсулярной ткани в придаточном положении в пластической и реконструктивной хирургии. Полидиоксановая нить сохраняет свои свойства в месте имплантации в течение более длительного периода по сравнению с другими синтетическими рассасывающимися шовными материалами. Это позволяет предостеречь дополнительную инфильтрацию и его эффект на тело.

«Необходимые меры использования»

- До операции состояние пациента должно быть стабильным, только после этого возможно использование.
- Подготовьте стерилизованный антисептический раствор и изопрепаратный диск.
- Подготовьте для оперативного использования изделие, которое упаковывается в герметичной упаковке.
- Проверьте целостность упаковки выбранного изделия.
- Проверьте срок годности изделия.
- Проверьте упаковку на наличие повреждений.
- Используйте, полностью погрузив, или используйте это изделие по назначению.
- Как использовать в период работы.
- Если раз убавится в выбранной модели, изделие и состояние упаковки изделия.
- Перед применением изделия, из упаковки извлеките изделие по использованию пометкам.
- Используйте изделие, упакованное стерильно.
- Вскройте упаковку изделия и аккуратно извлеките изделие.
- Убедитесь, что на изделии не присутствуют дефекты или повреждения.
- Это изделие должно использоваться врачом.
- Место имплантации изделия должно быть обработано антисептиком и накрыто диском.
- Смочивание антисептическим антисептическим раствором.
- Имплатировать изделие в кожу (субкапсулярной тканью), в свободное место, для достижения желаемого эффекта.
- На изделие в кожу более 2-3 мм, если изделие.
- Можно и можно изделие из упаковки извлекать из упаковки.
- Не используйте изделие повторно, поскольку это изделие имеет только однократное использование.

«Действия после окончания процедуры»

- На изделие после окончания процедуры.
- Так как изделие имеет однократное, его нельзя использовать повторно.
- Утилизировать изделие согласно и по использованию изделия согласно правилам утилизации или другим правилам.

«Знаки безопасности»

- Это изделие можно использовать только врачом.
- Не использовать изделие, срок годности которого истек.
- Не использовать изделие, которое повреждено.
- Это изделие не должно использоваться в воде, масле, жире, спирте, а также в других жидкостях.
- Это изделие должно использоваться только в медицинских учреждениях, врачами.
- Если есть в предполагаемом месте имплантации участок кожи, который имеет повреждения, или имеются другие инфекции, изделие нельзя использовать на этом участке.

«Способ хранения»

- Хранить в чистом и сухом помещении.
- Избегать контакта с другими жидкостями и высокой влажностью.

«Противопоказания»

Если в истории болезни пациента есть расстройства сердечно-сосудистой системы, воспалительное заболевание кишечника, аллергия, перенесенная и т.д. обратиться за консультацией к врачу.


Регистрационное удостоверение №:

НИТЬ РАССАСЫВАЮЩАЯСЯ BIOSUN, СТЕРИЛЬНАЯ ИЗ ПОЛИДИОКСАНОНА
(ПДО) НА НЕЖИ-НОСИТЕЛЕ

МОДЕЛЬ



РАЗМЕР




ОАО «ЭЛАНСКИН», Россия, 510004, Краснодарский край, с. Краснодар, ул. Коммунальная, д. 42, пом. 4. Тел.: 8 (861) 217-2777, 8 (861) 108-6578, E-mail: elansk@yandex.ru


Дателес Медицинс Ко. ЛТД, 67-601, 79-1, Корей, Хангук, Хангук-гу, Мянганг-ри 153 Бок-стп. Тел.: +82-62-430-6221, Факс: +82-62-430-6228

Регистрация: Лексис Карена ООО, Бродячий 47 д. 4711 Бокун, Германия Тел.: +49-234-5901-775, Факс: +49-234-5901-775

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Обычная нить с иглой – Нормальный тип (16 моделей)

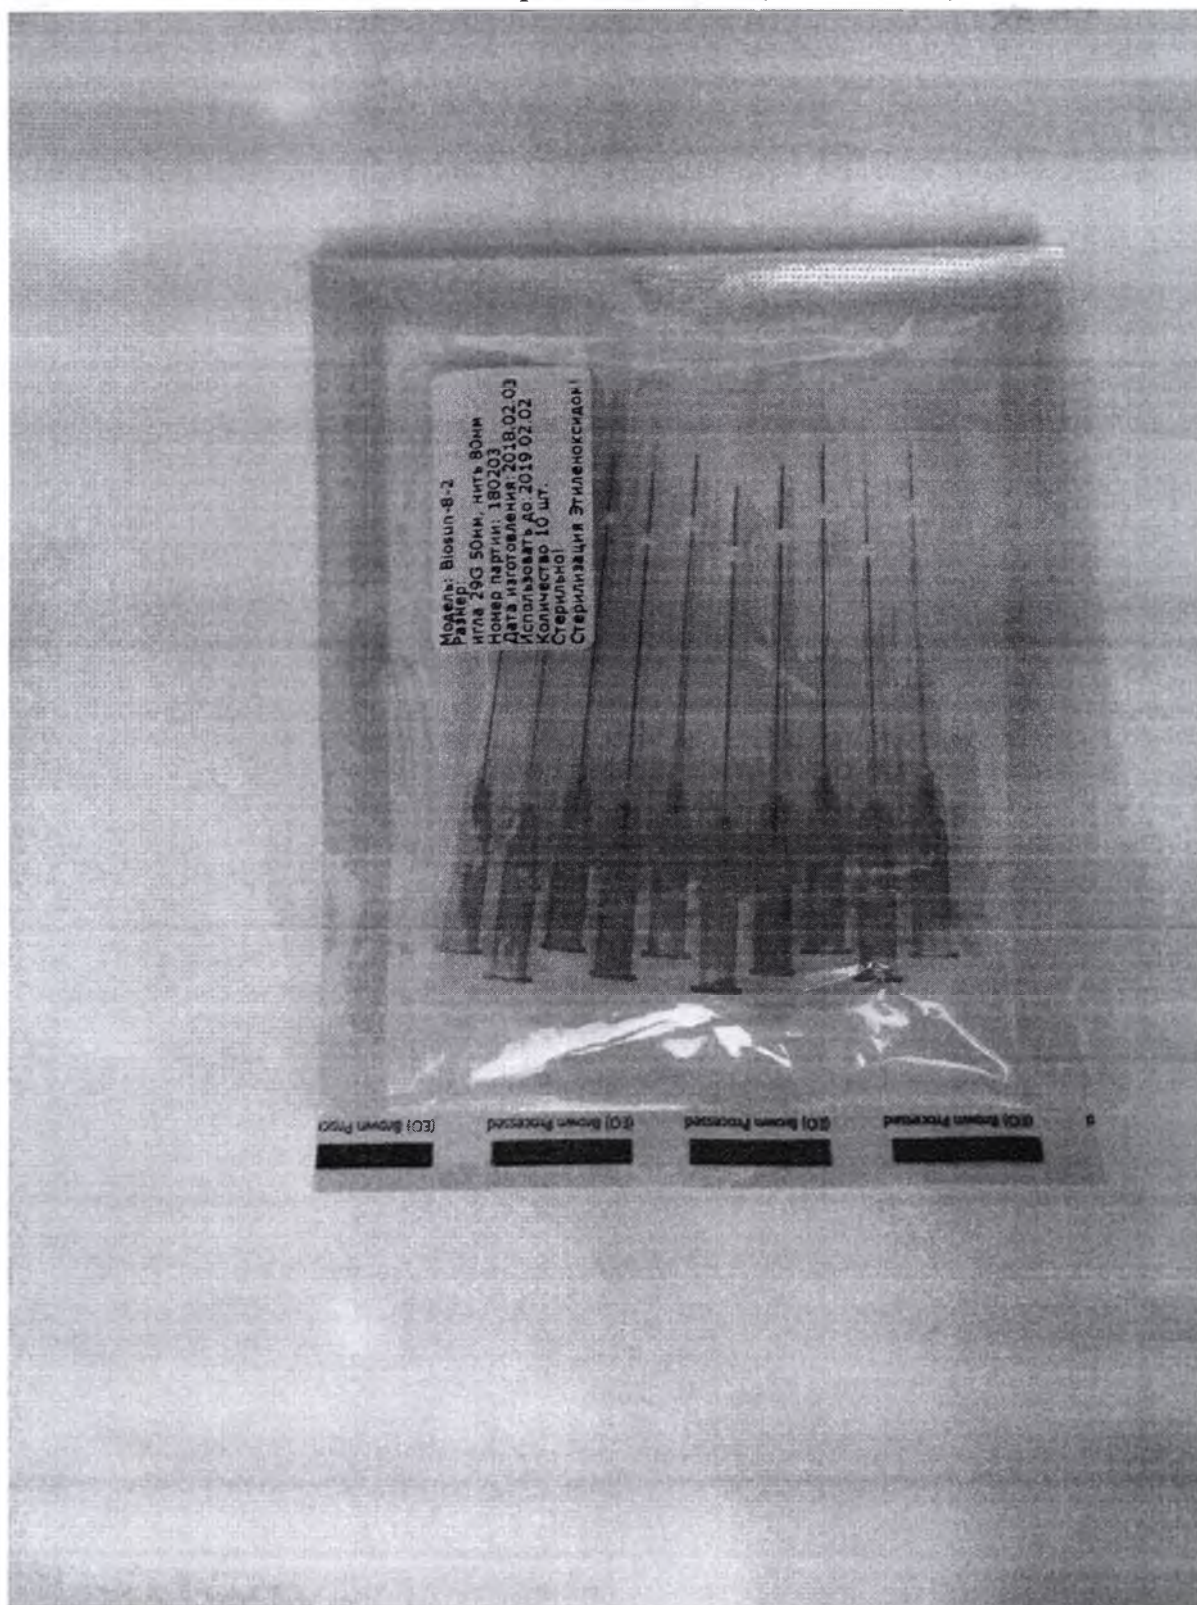


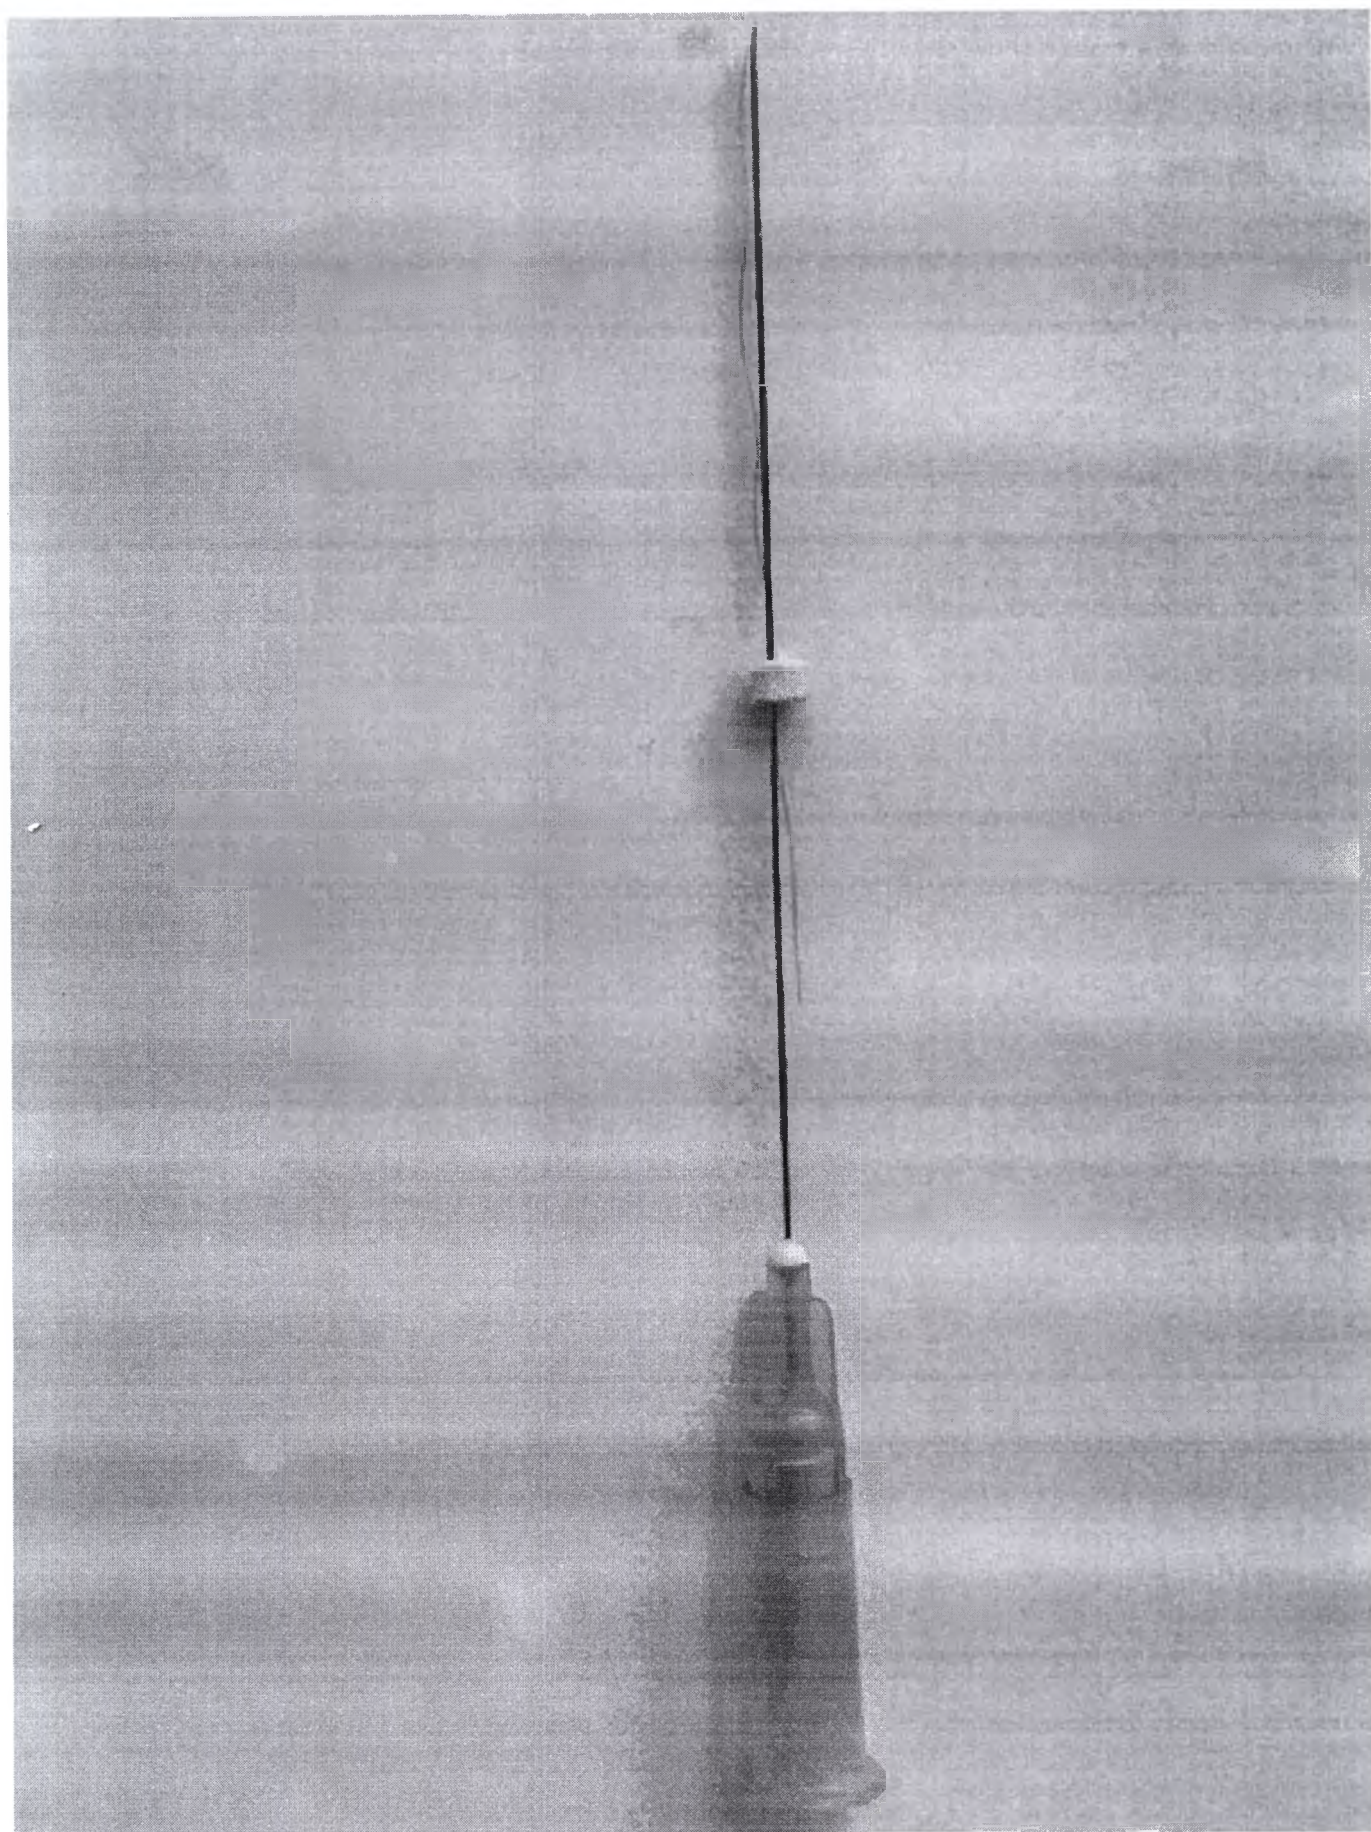

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Обычная нить с иглой – Сдвоенный тип (3 модели)

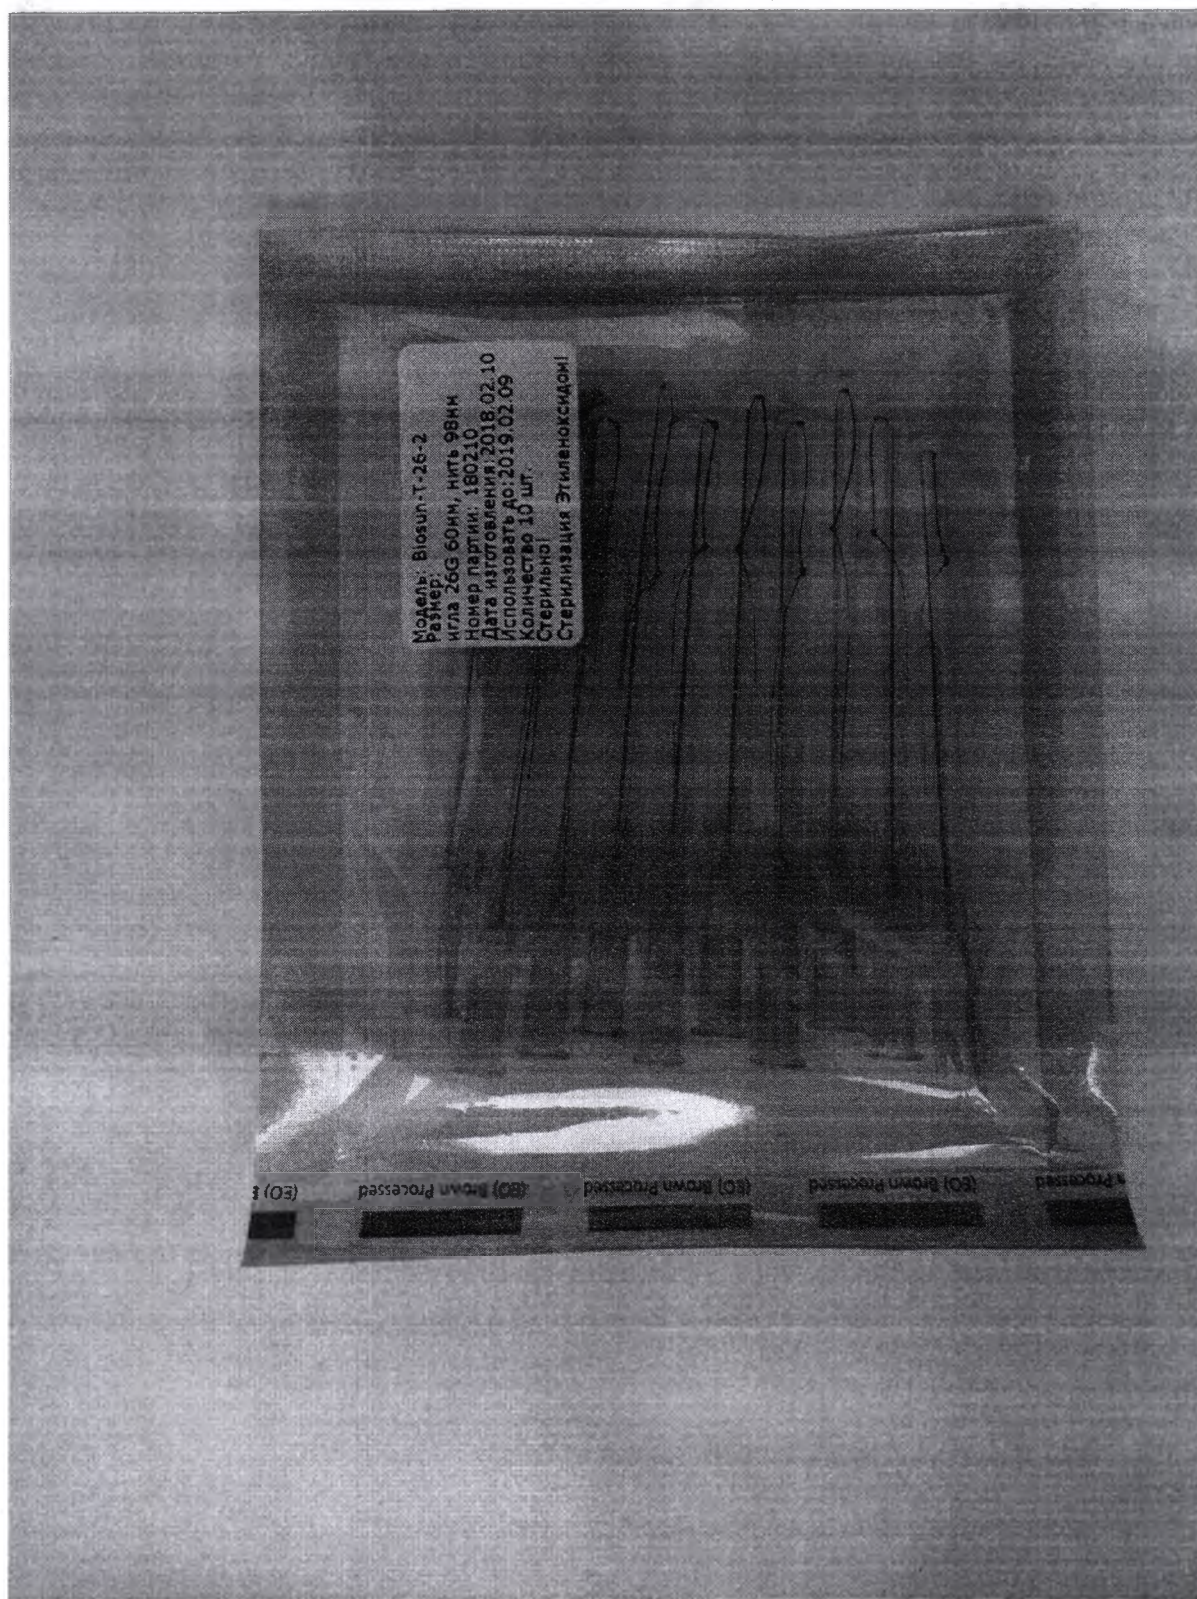


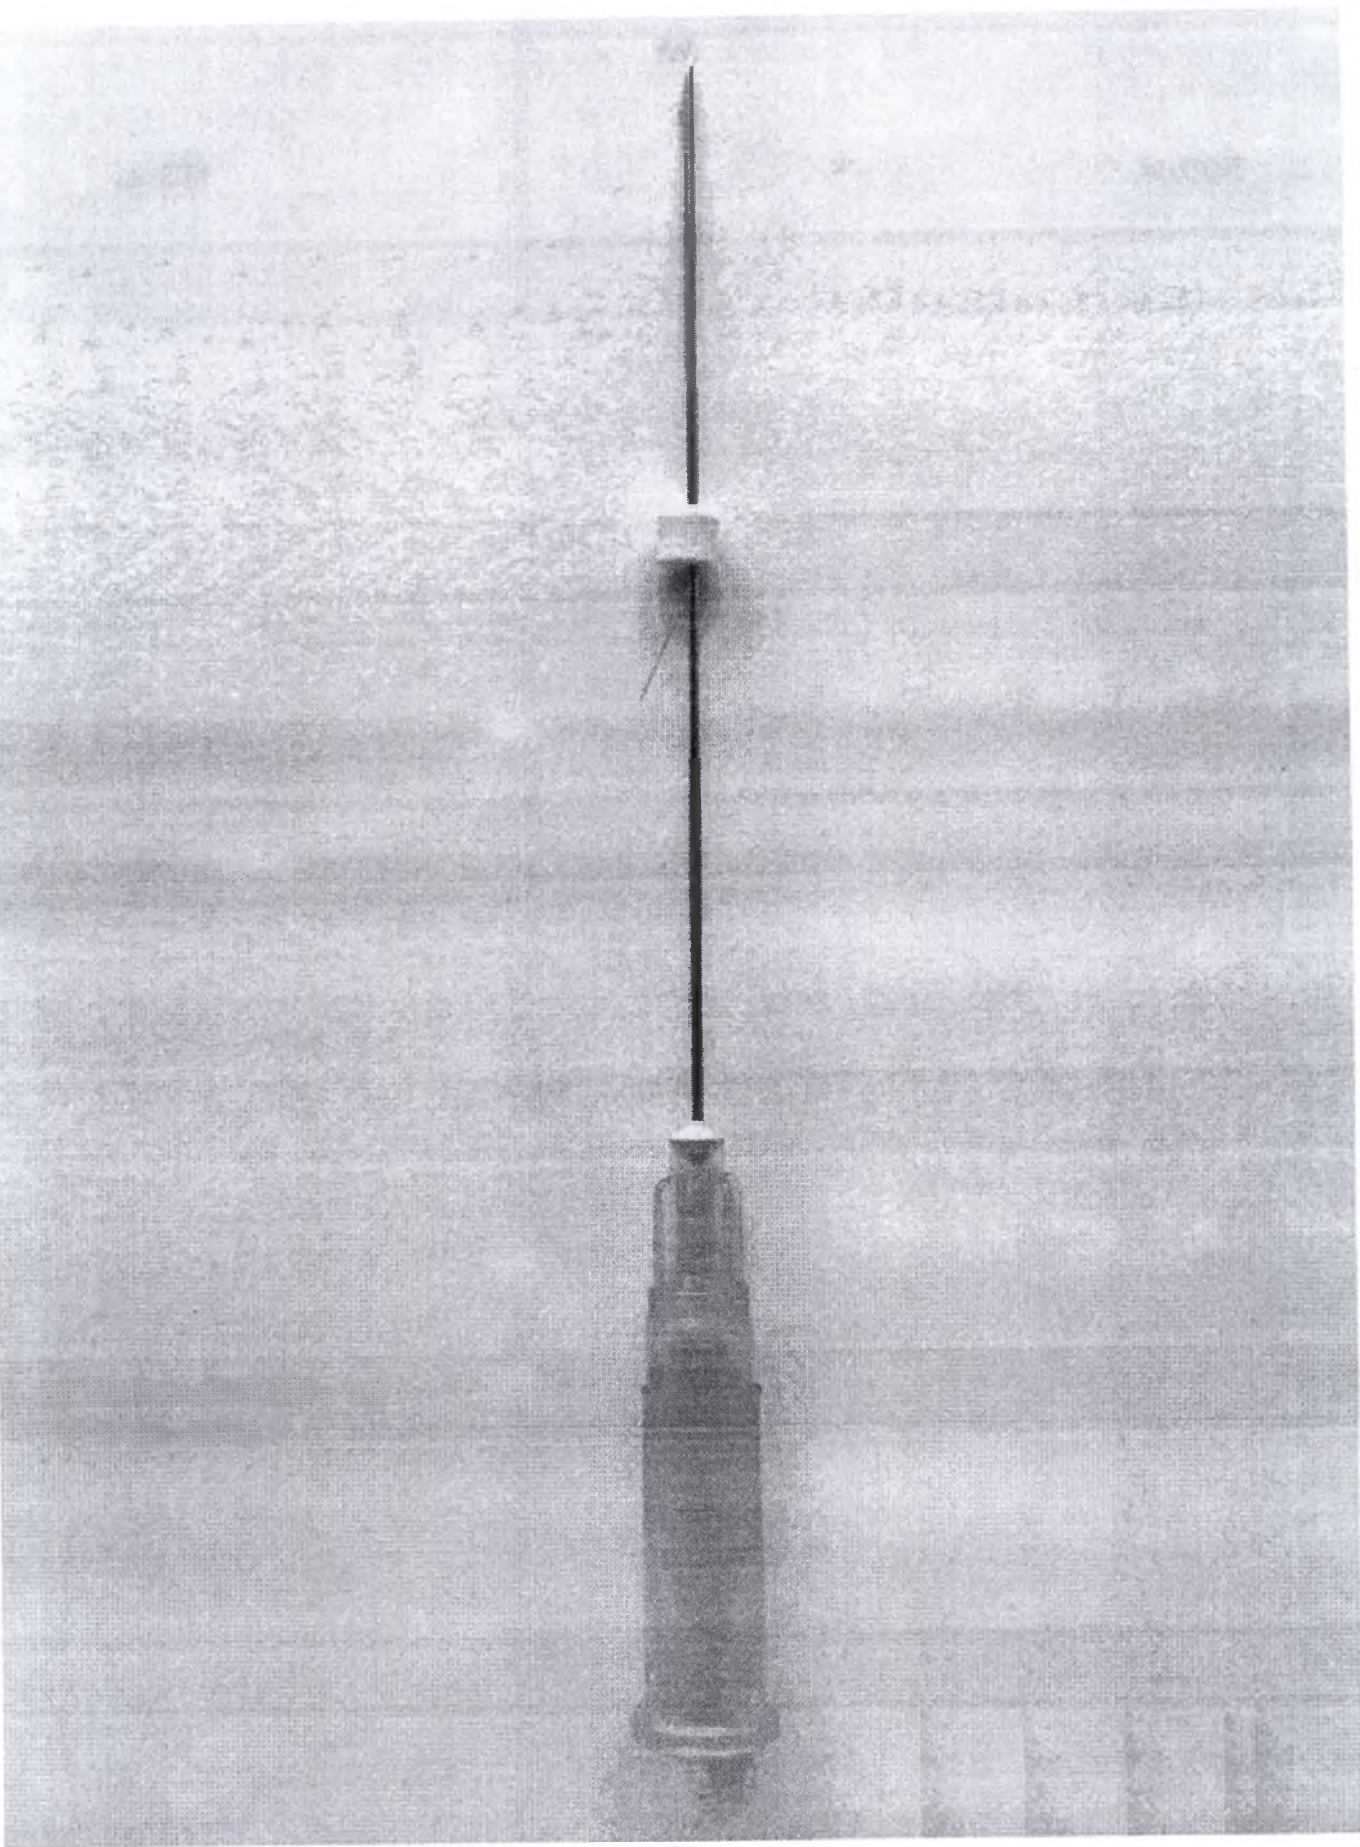

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Обычная нить с иглой – Одиарно виточный тип (39 моделей)

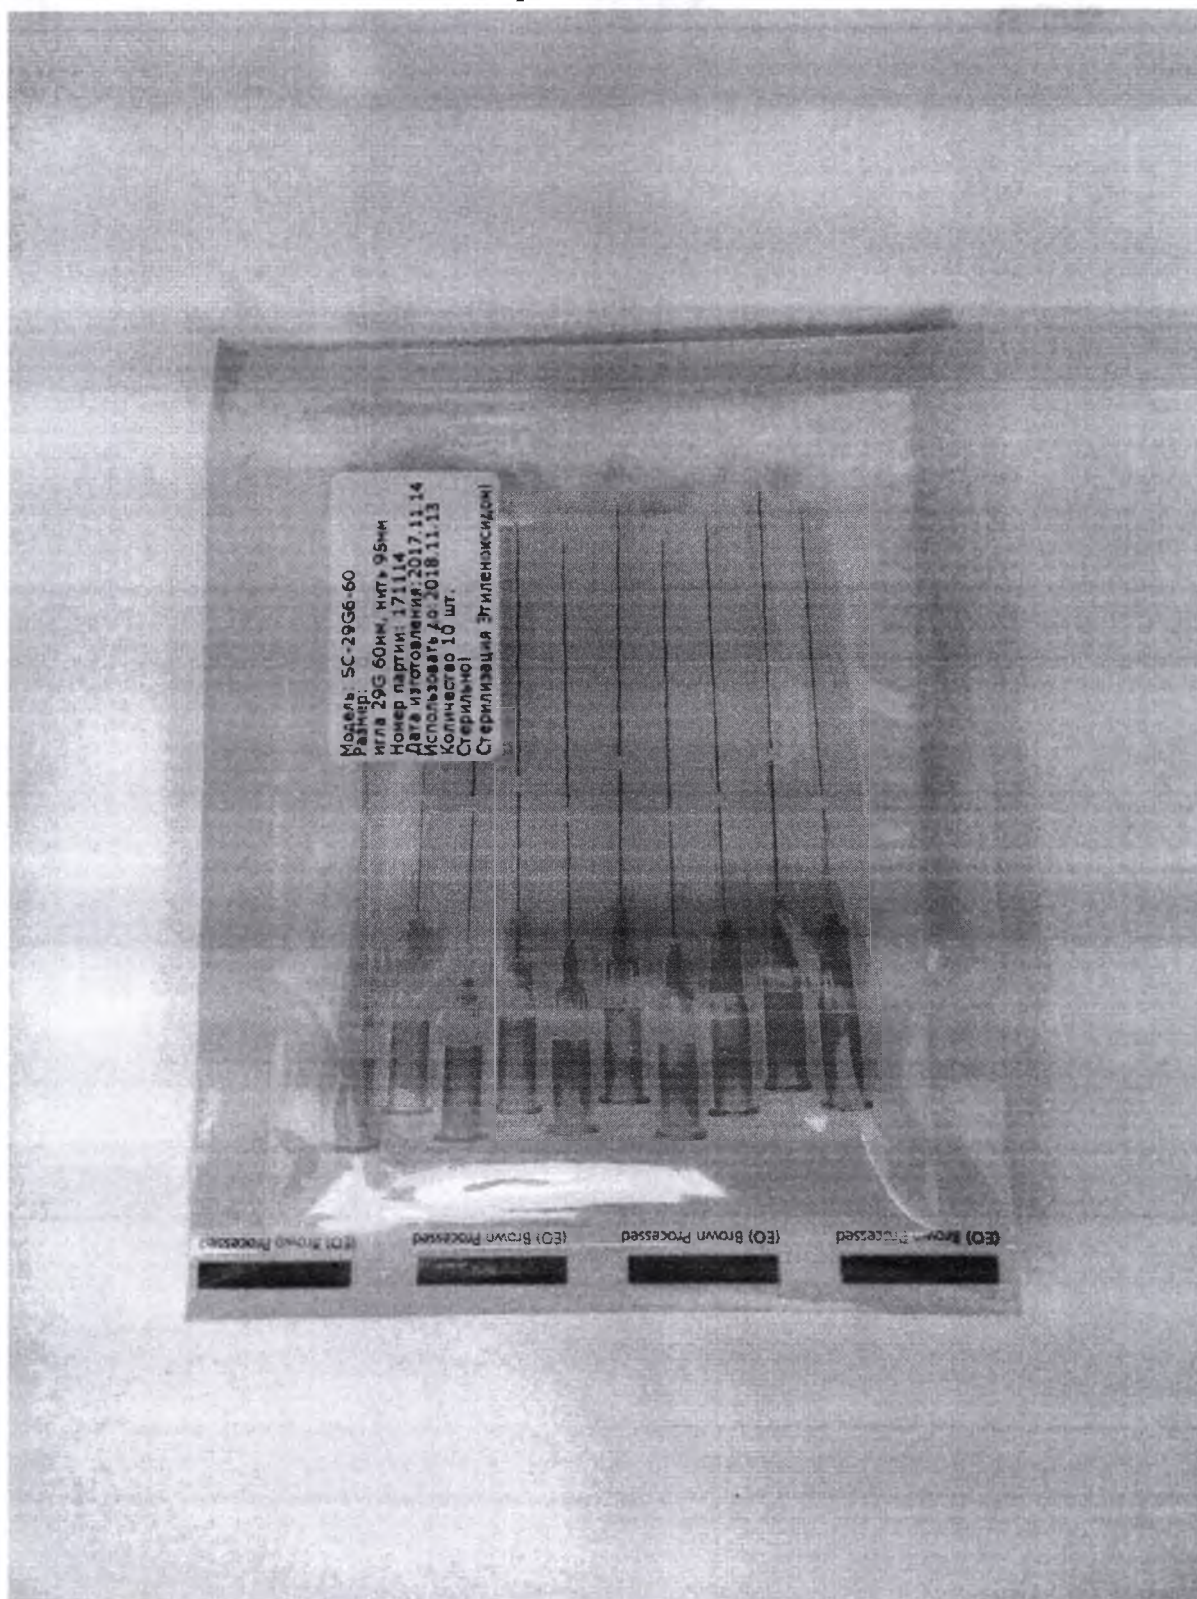


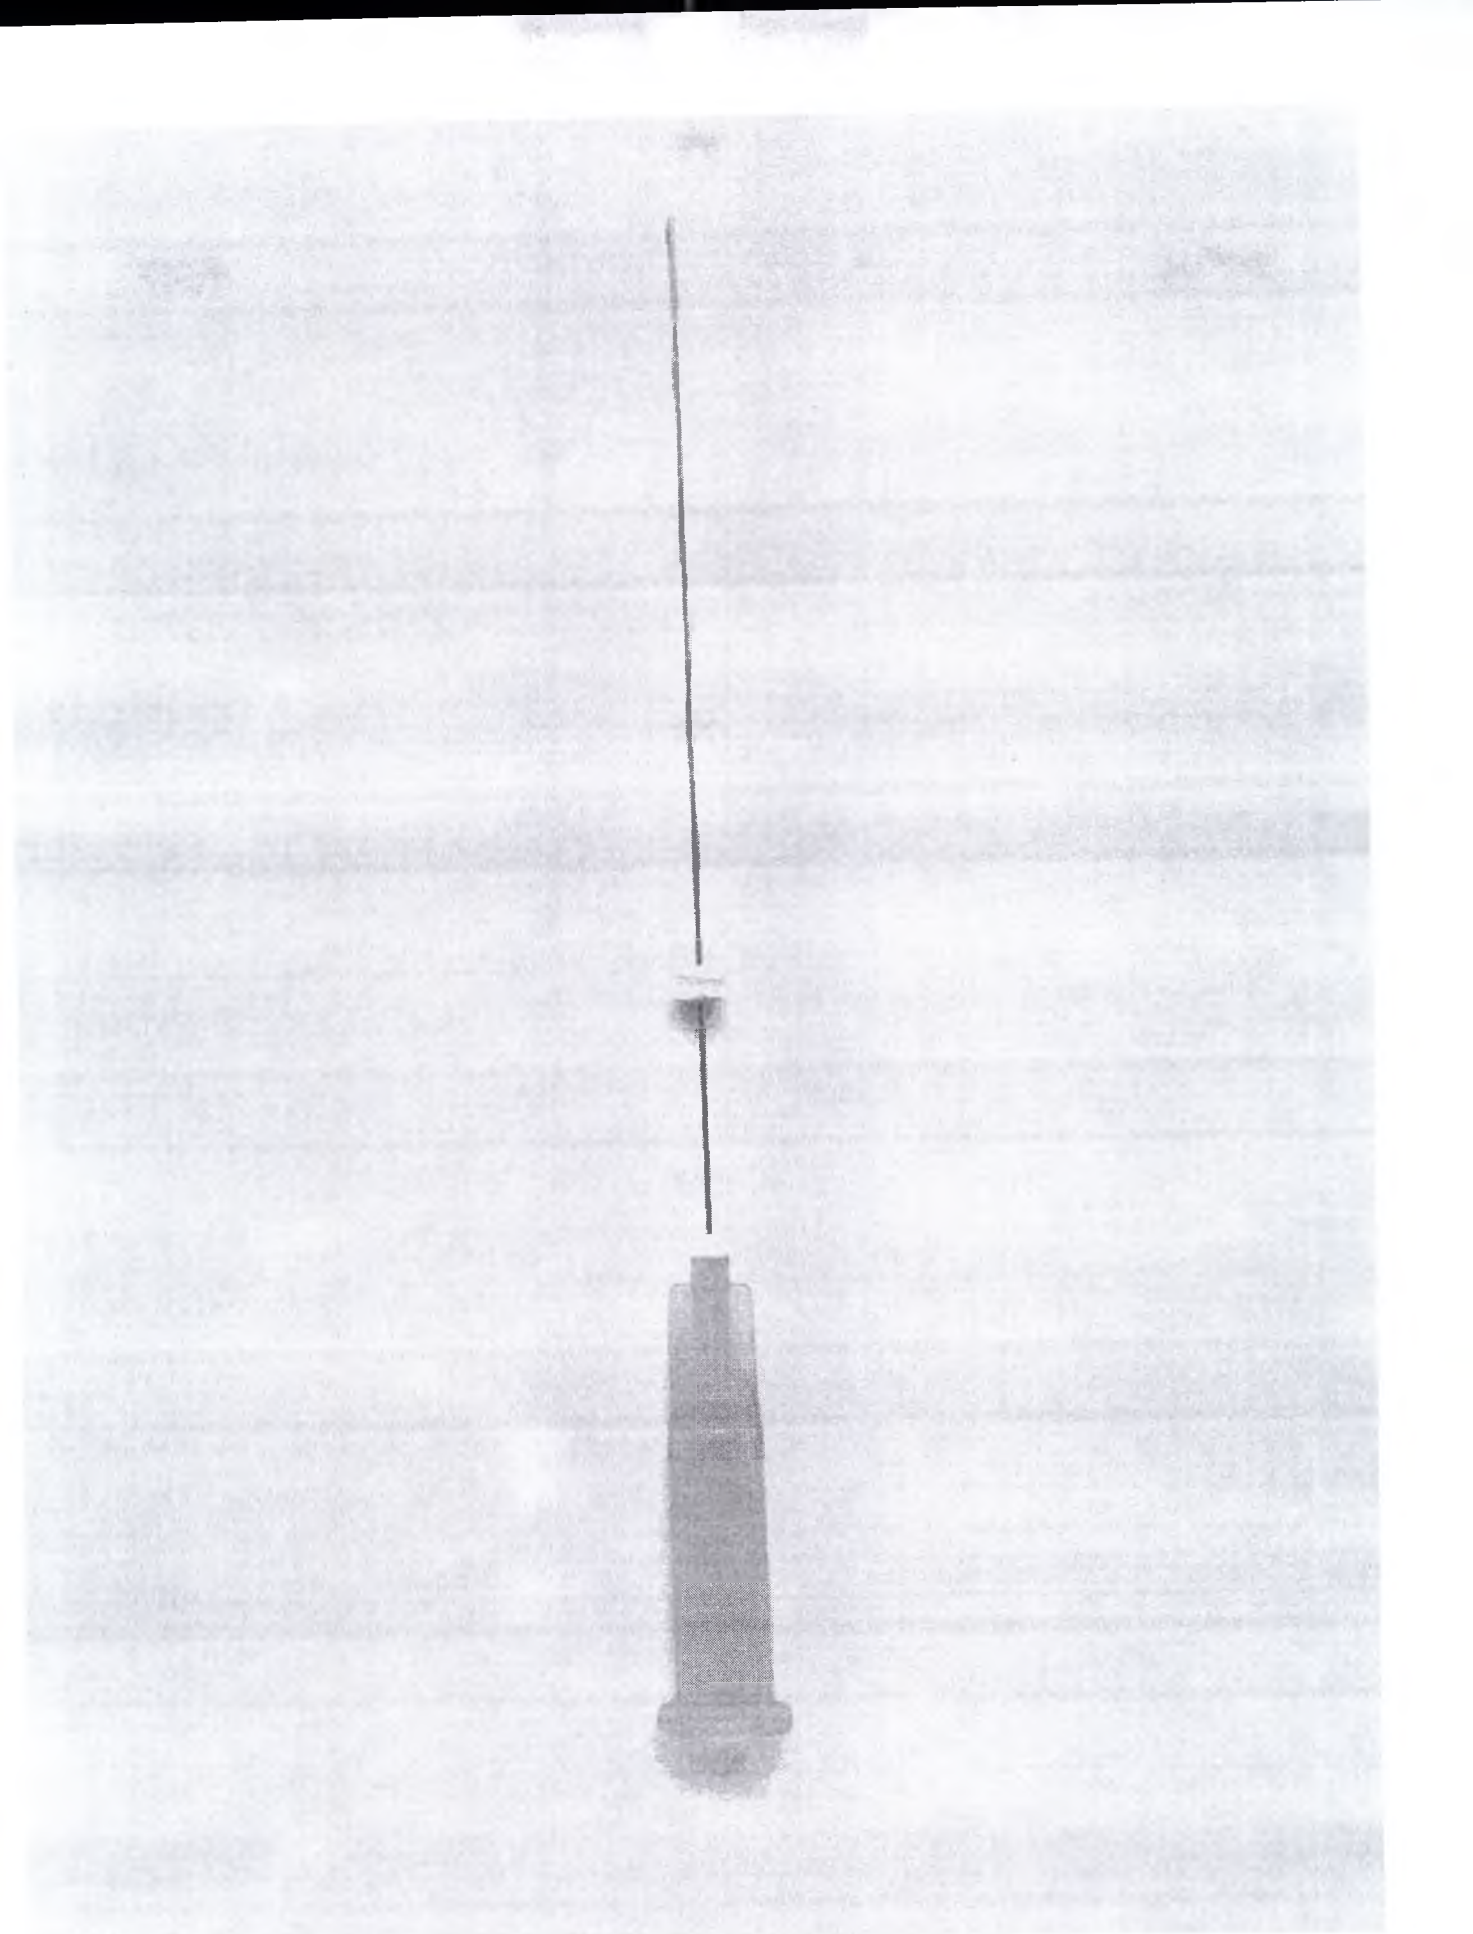


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Обычная нить с иглой – Одинарно пружинный тип (14 моделей)

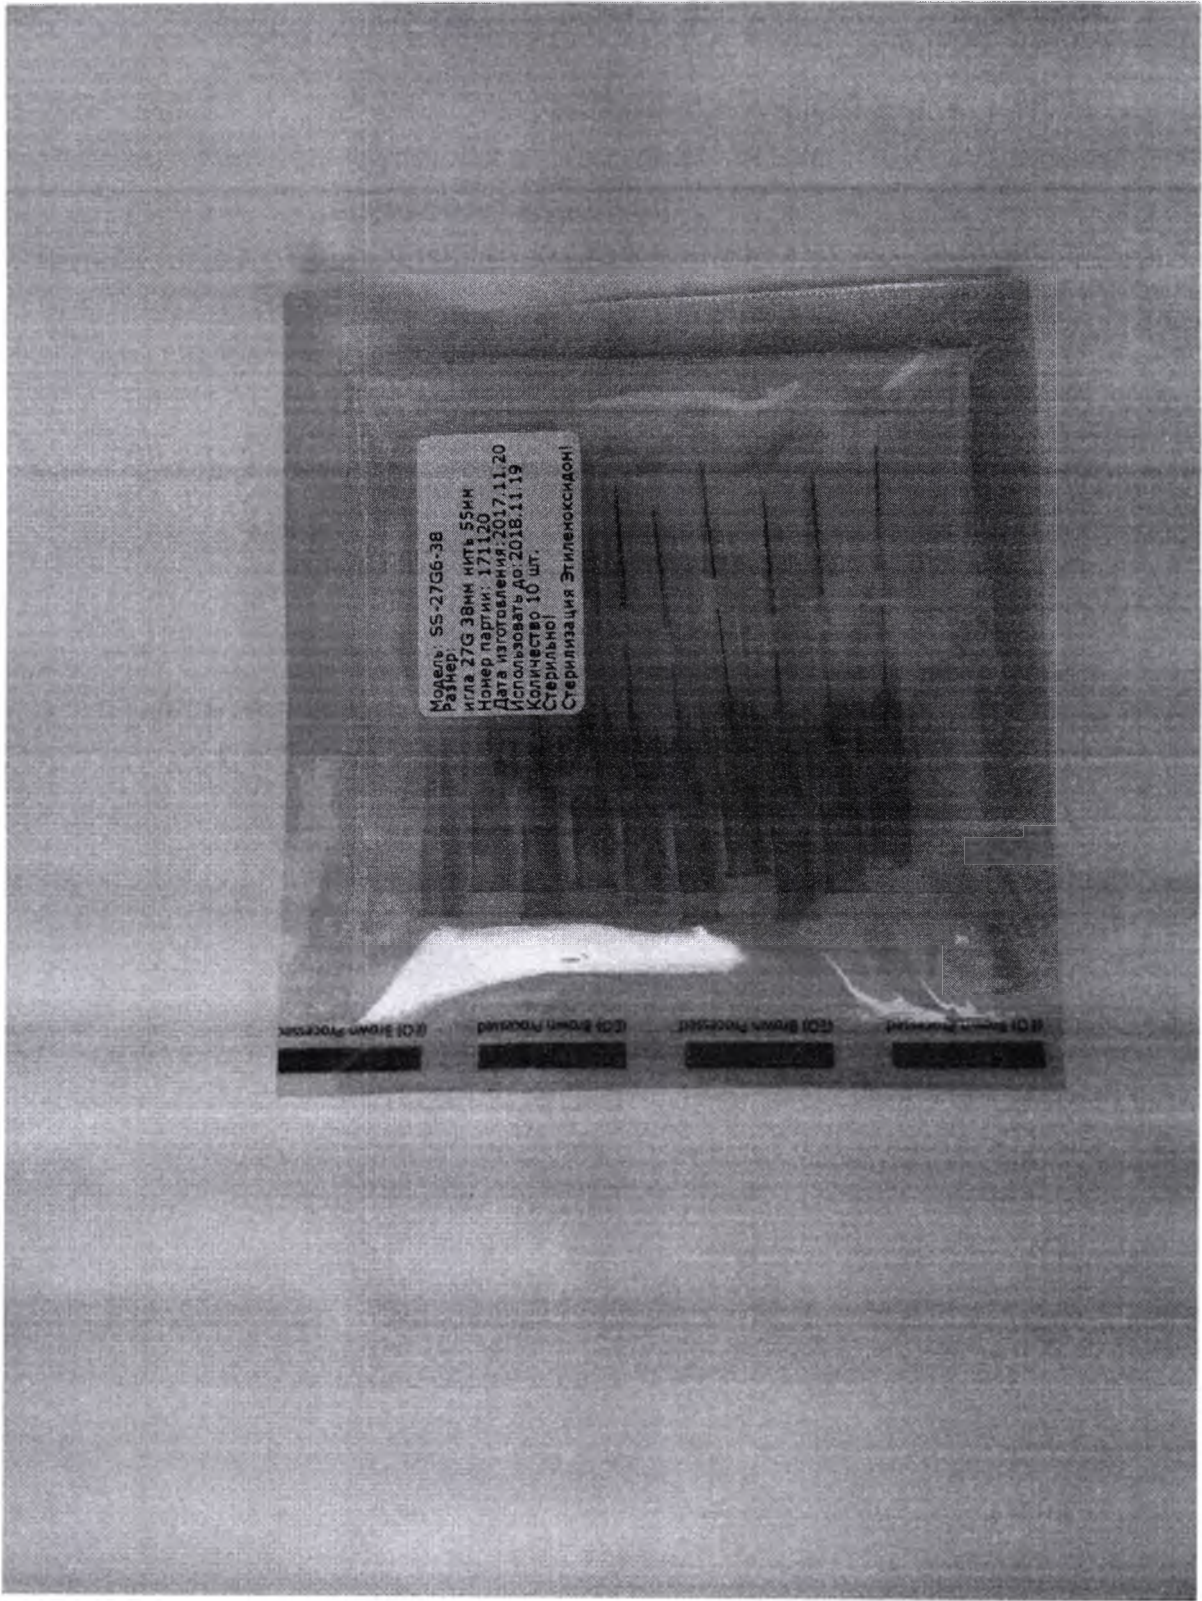

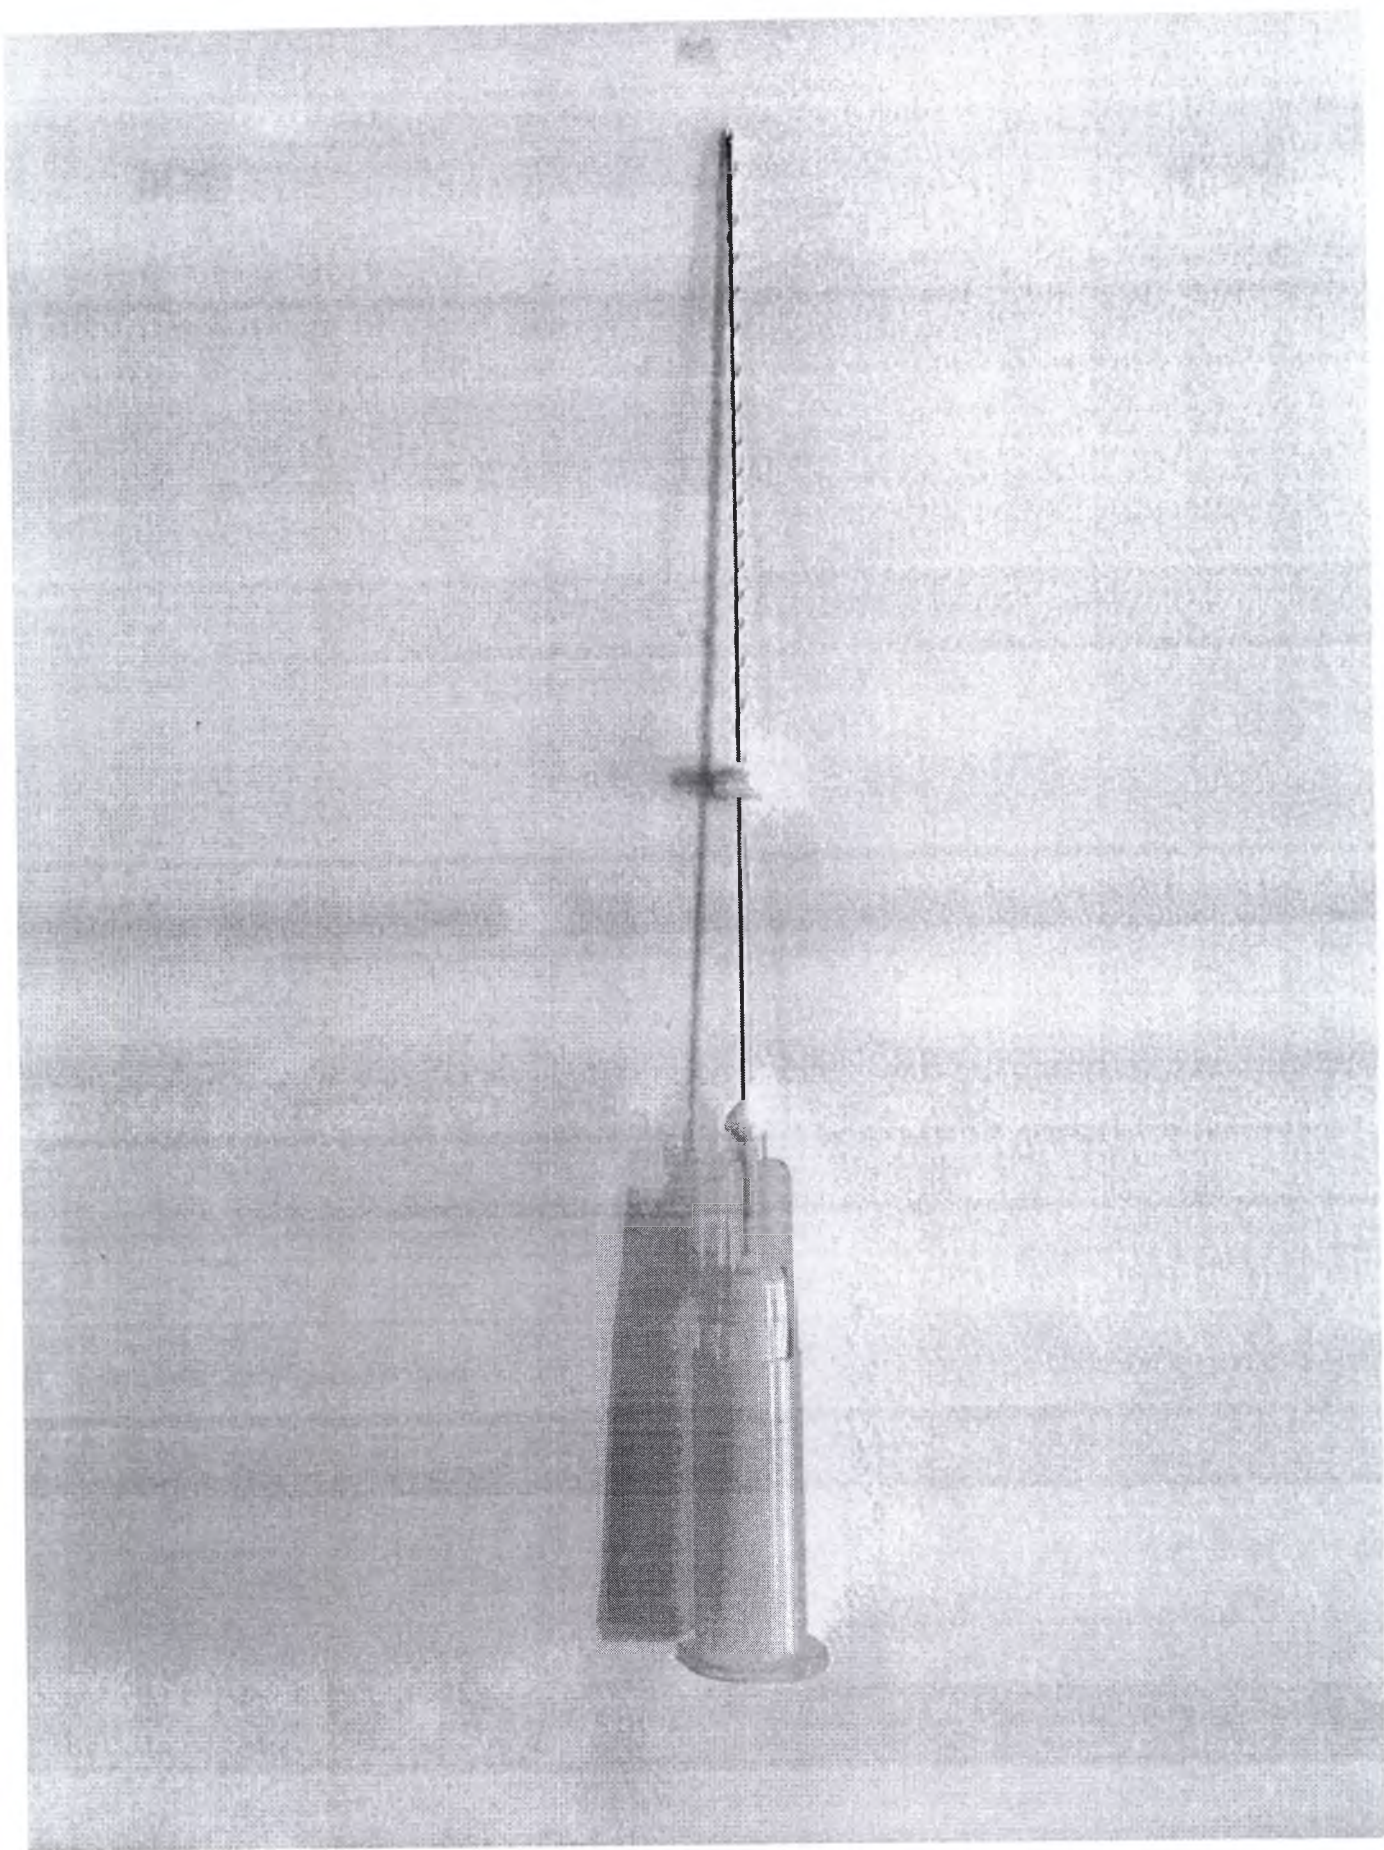


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:
Обычная нить с иглой – Сдвоенный виточный тип (10 моделей)

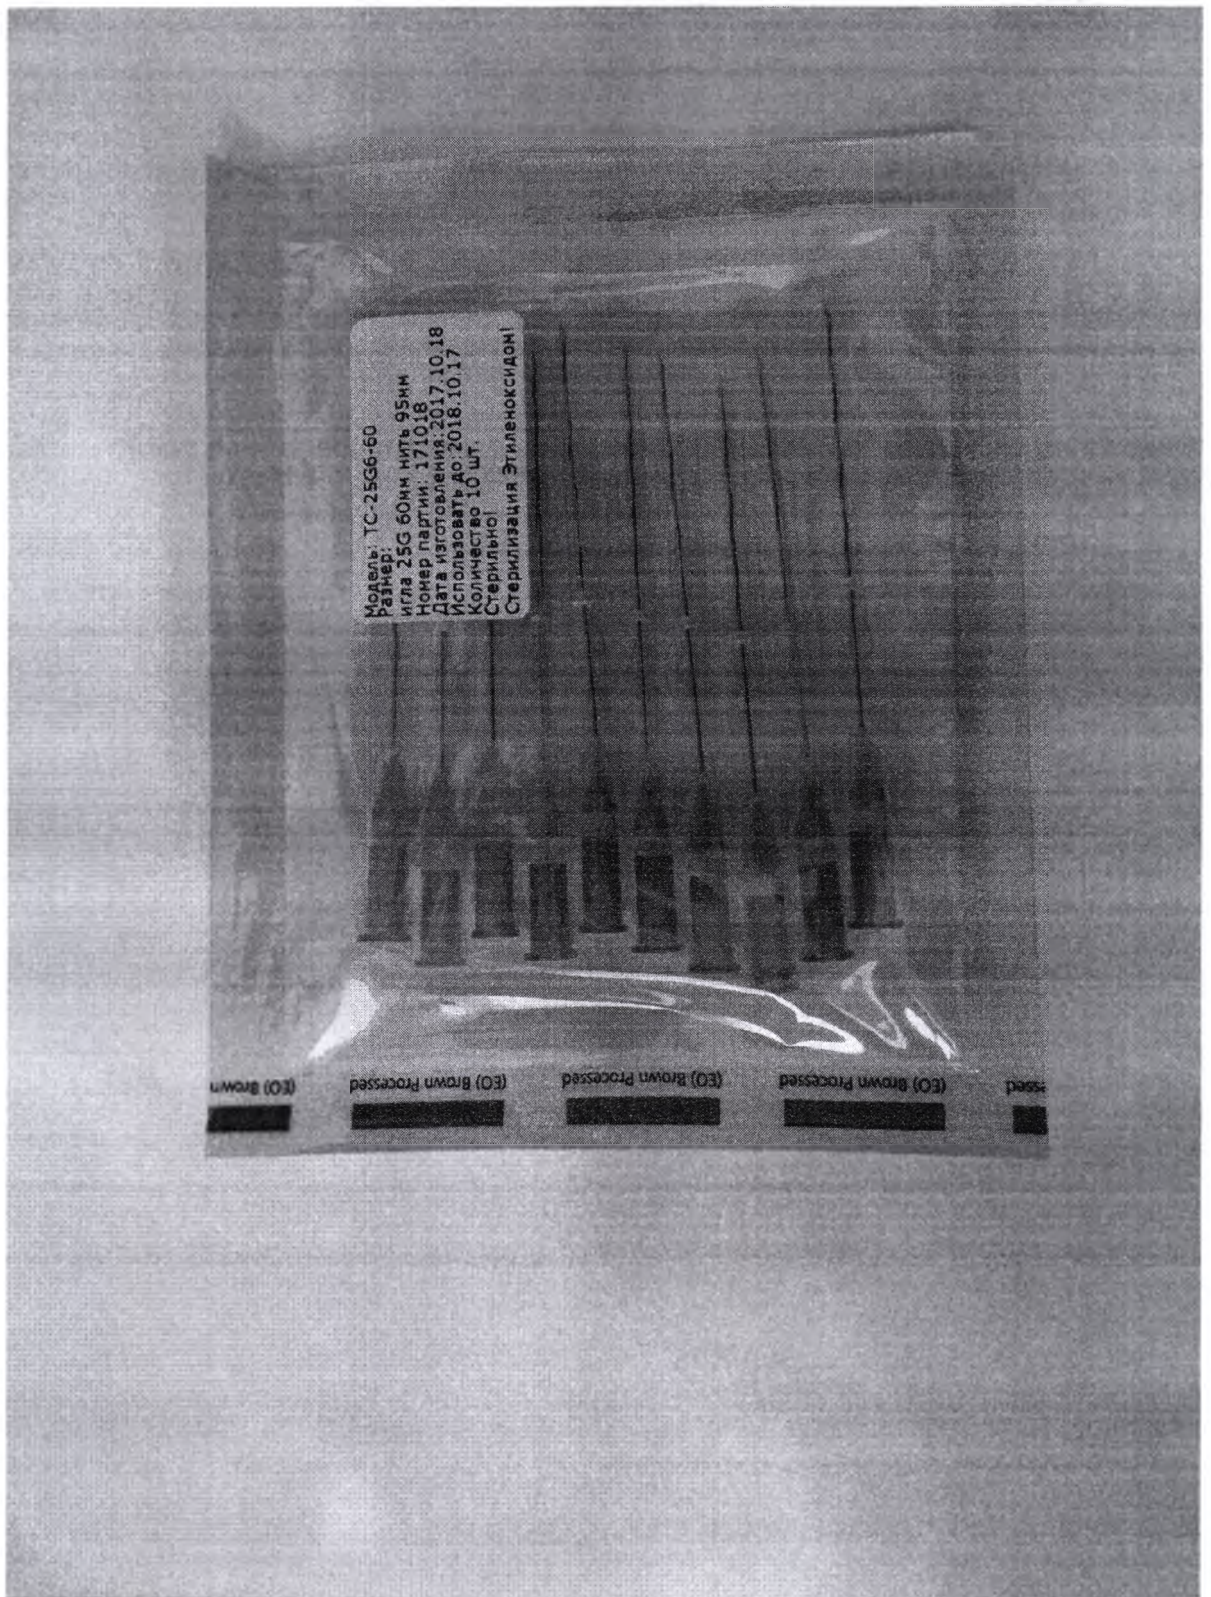


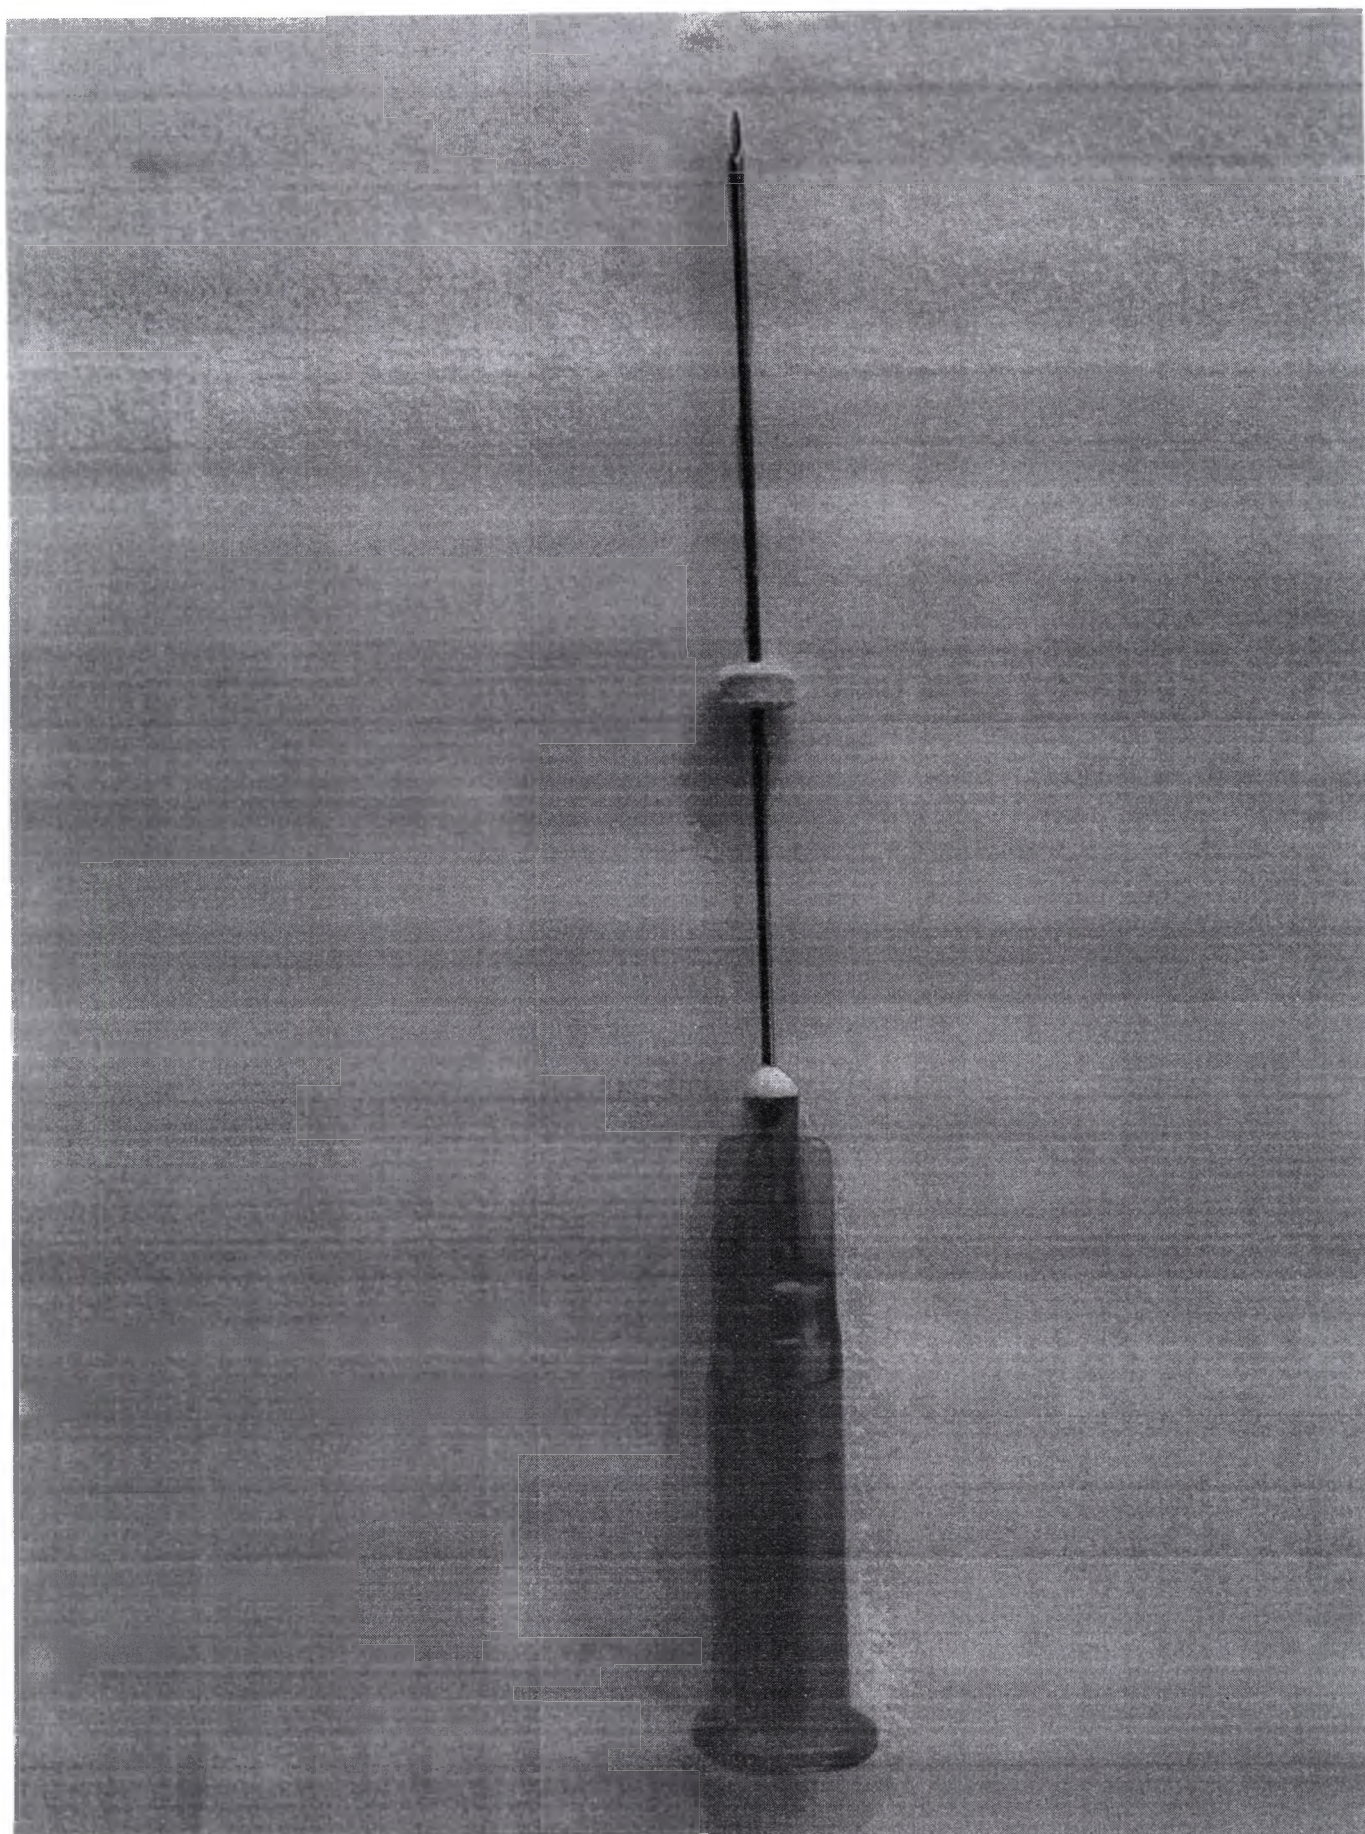

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Обычная нить с тупой иглой – Канюля N тип (6 моделей)

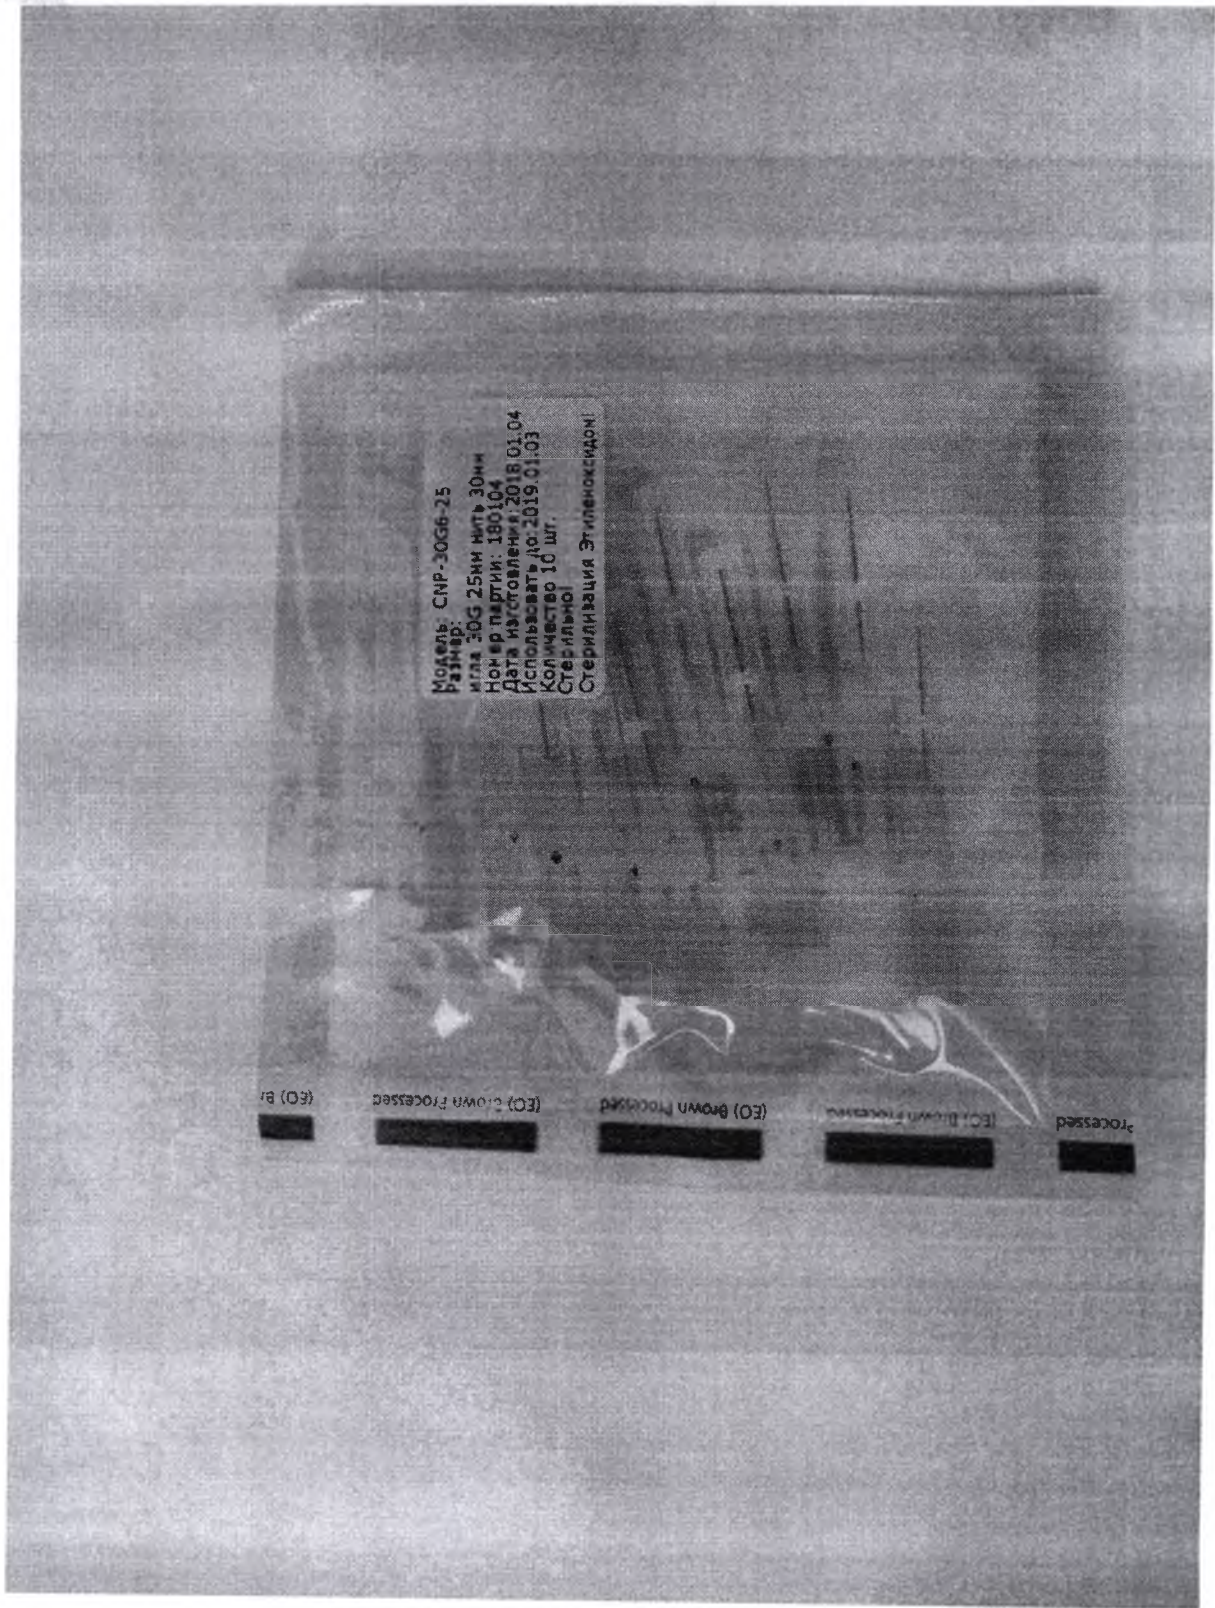


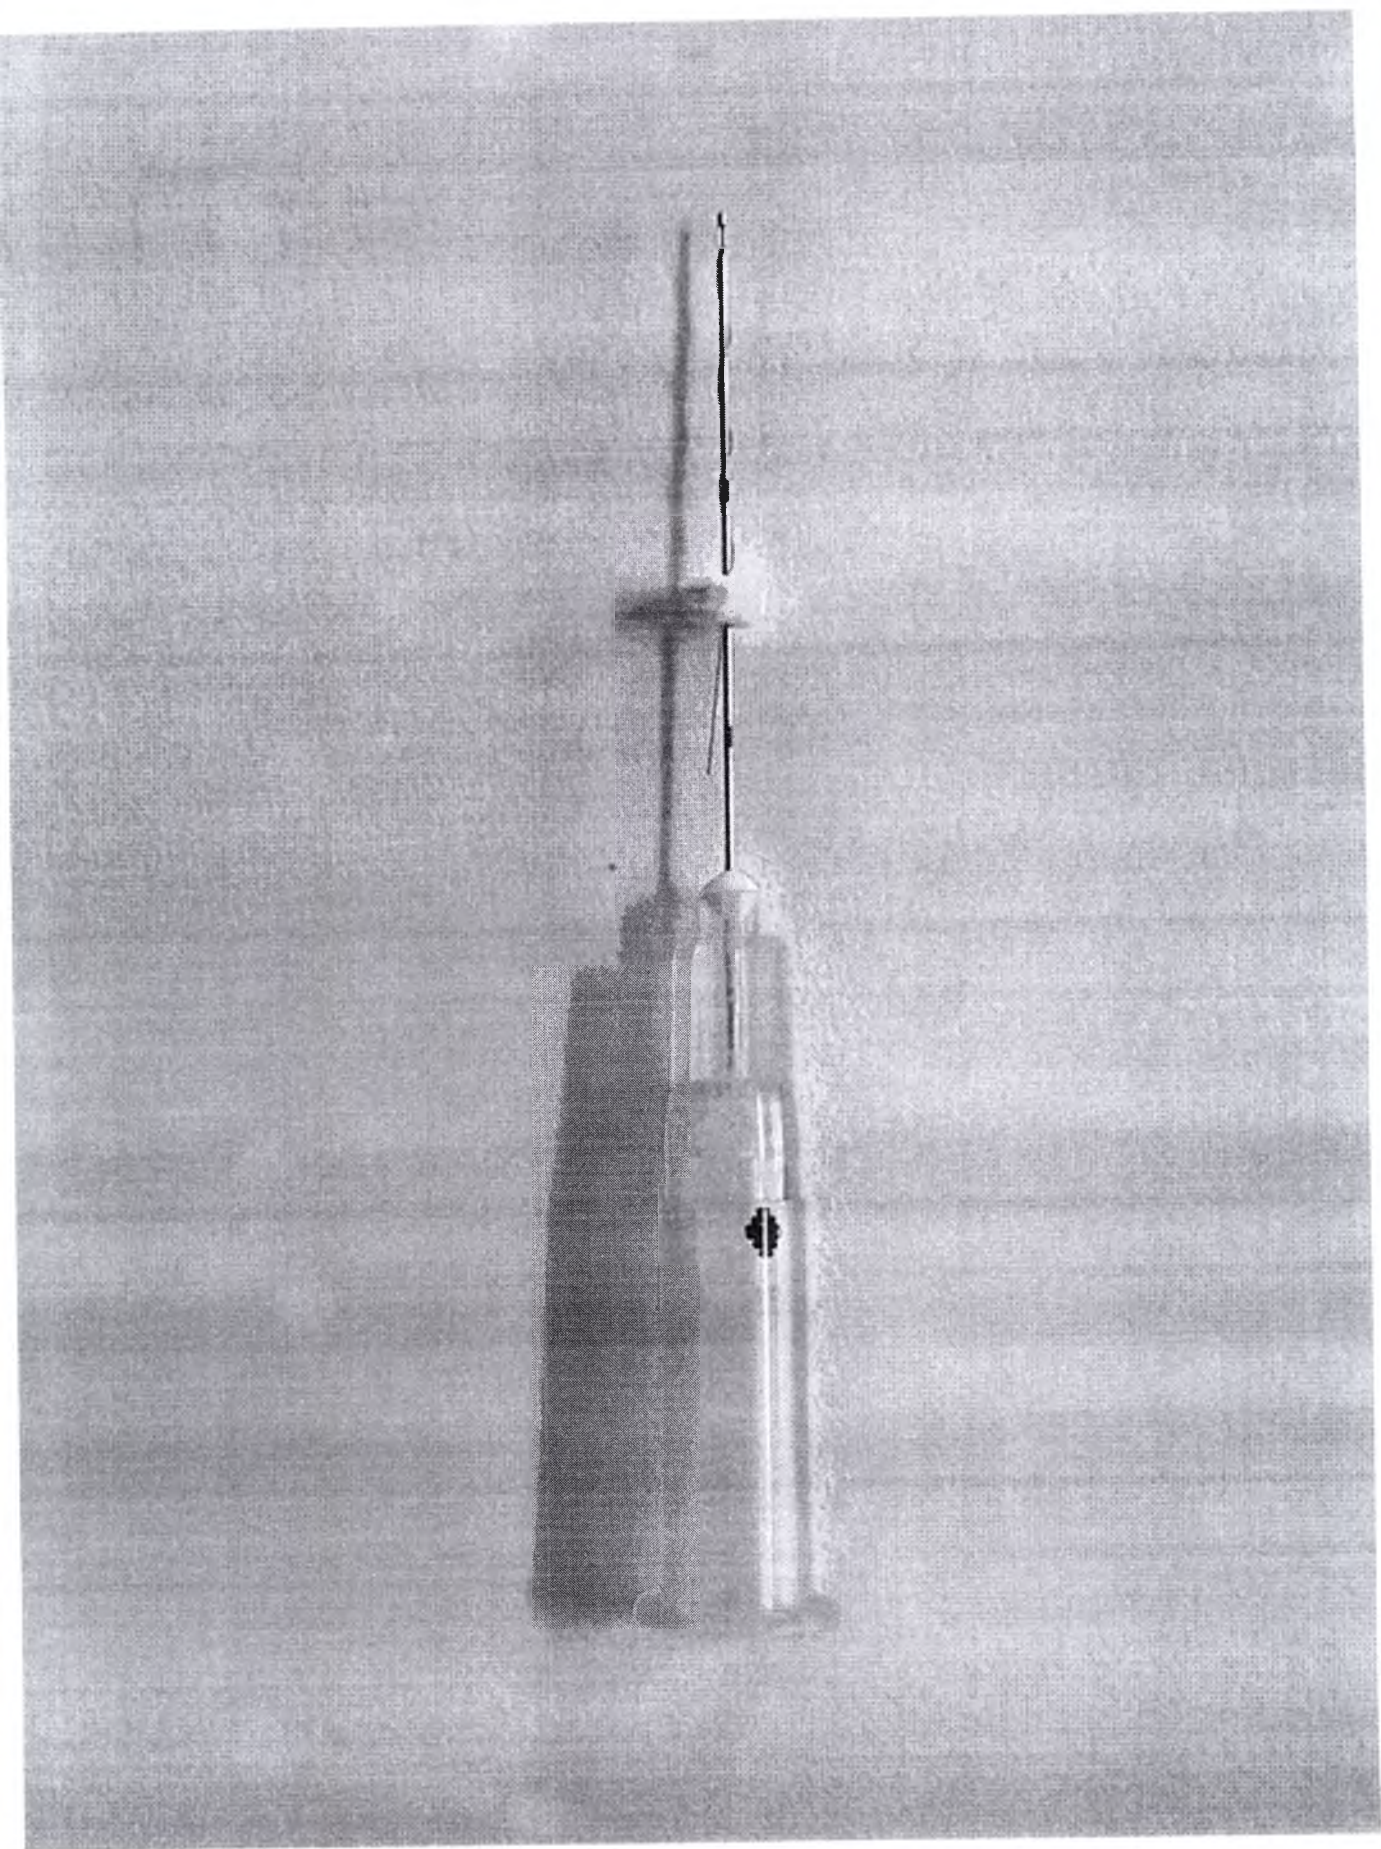

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Обычная нить с тупой иглой – Канюля О тип (4 модели)




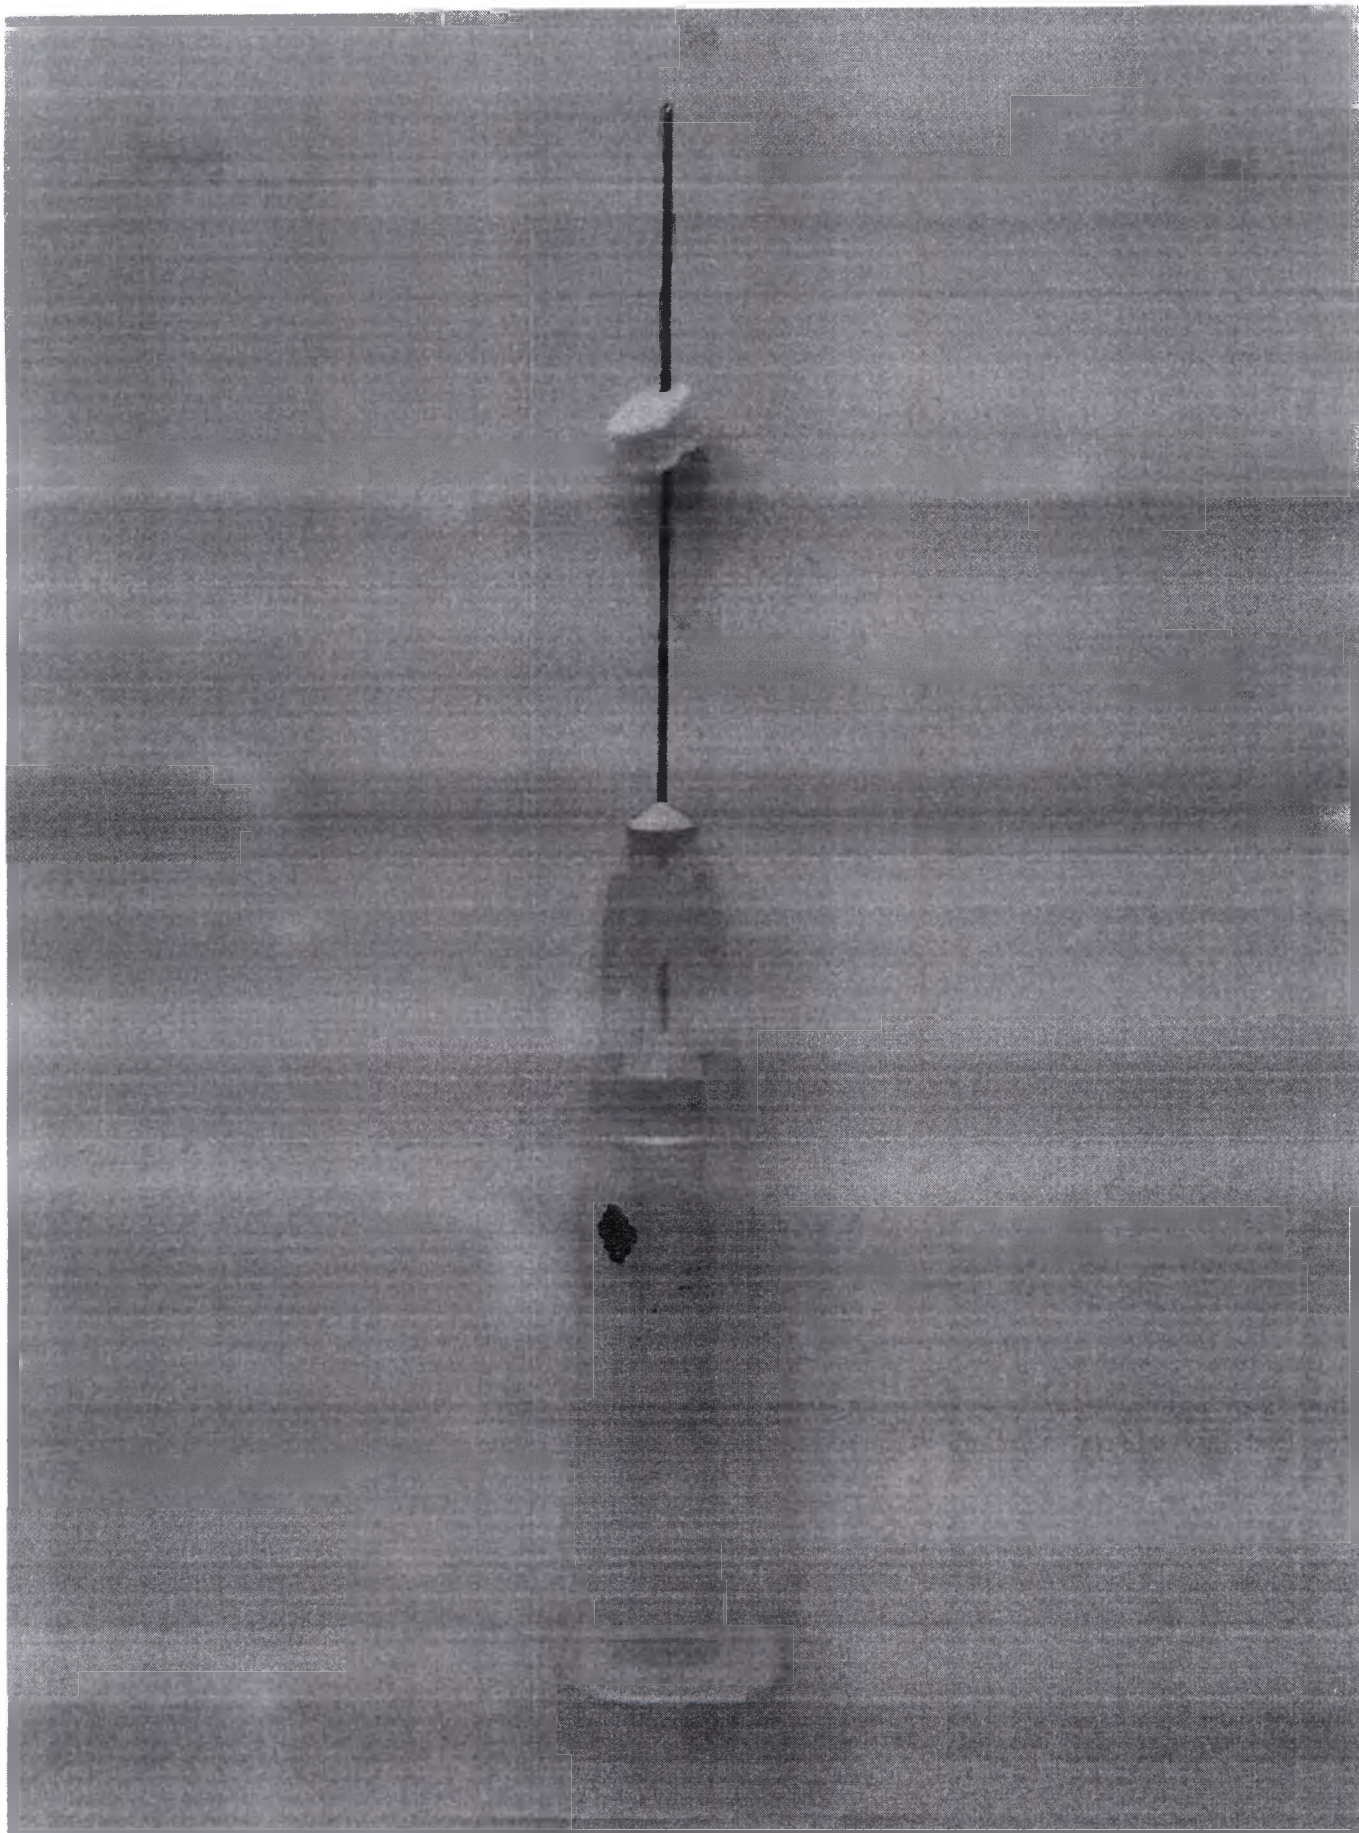

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Обычная нить с тупой иглой – Канюля L тип (4 модели)

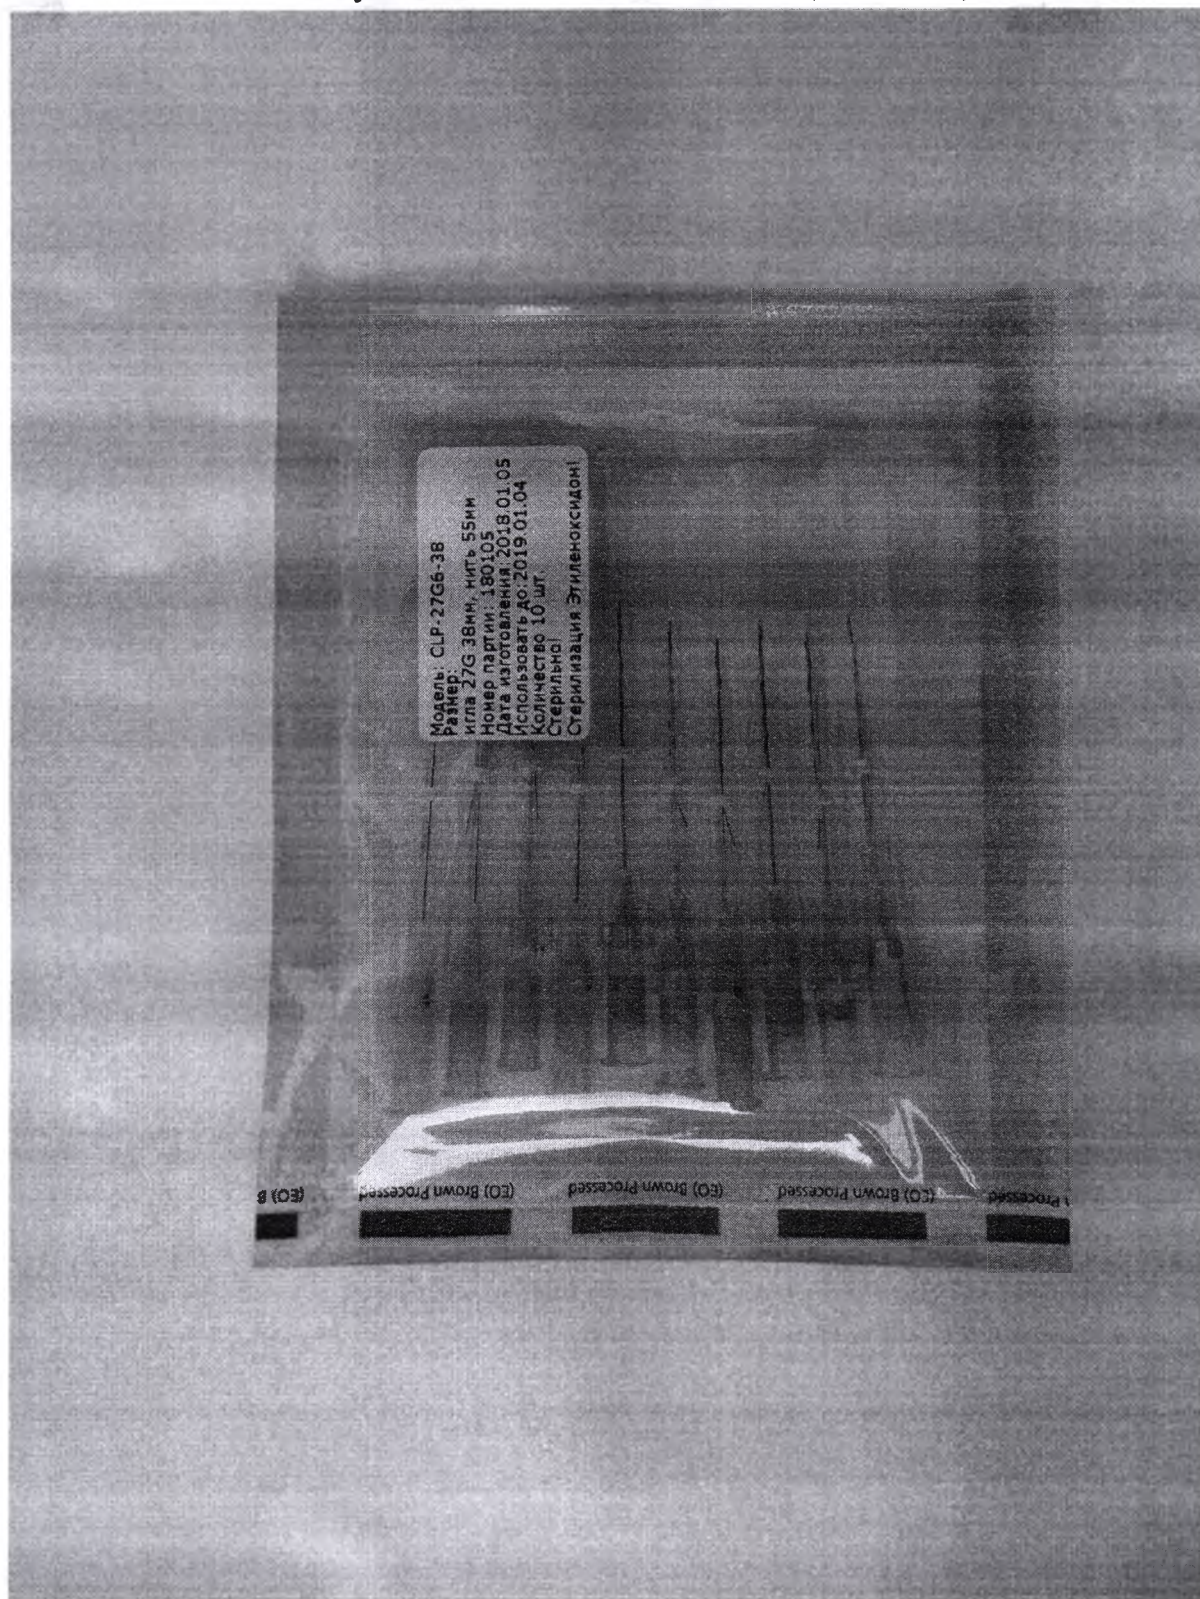


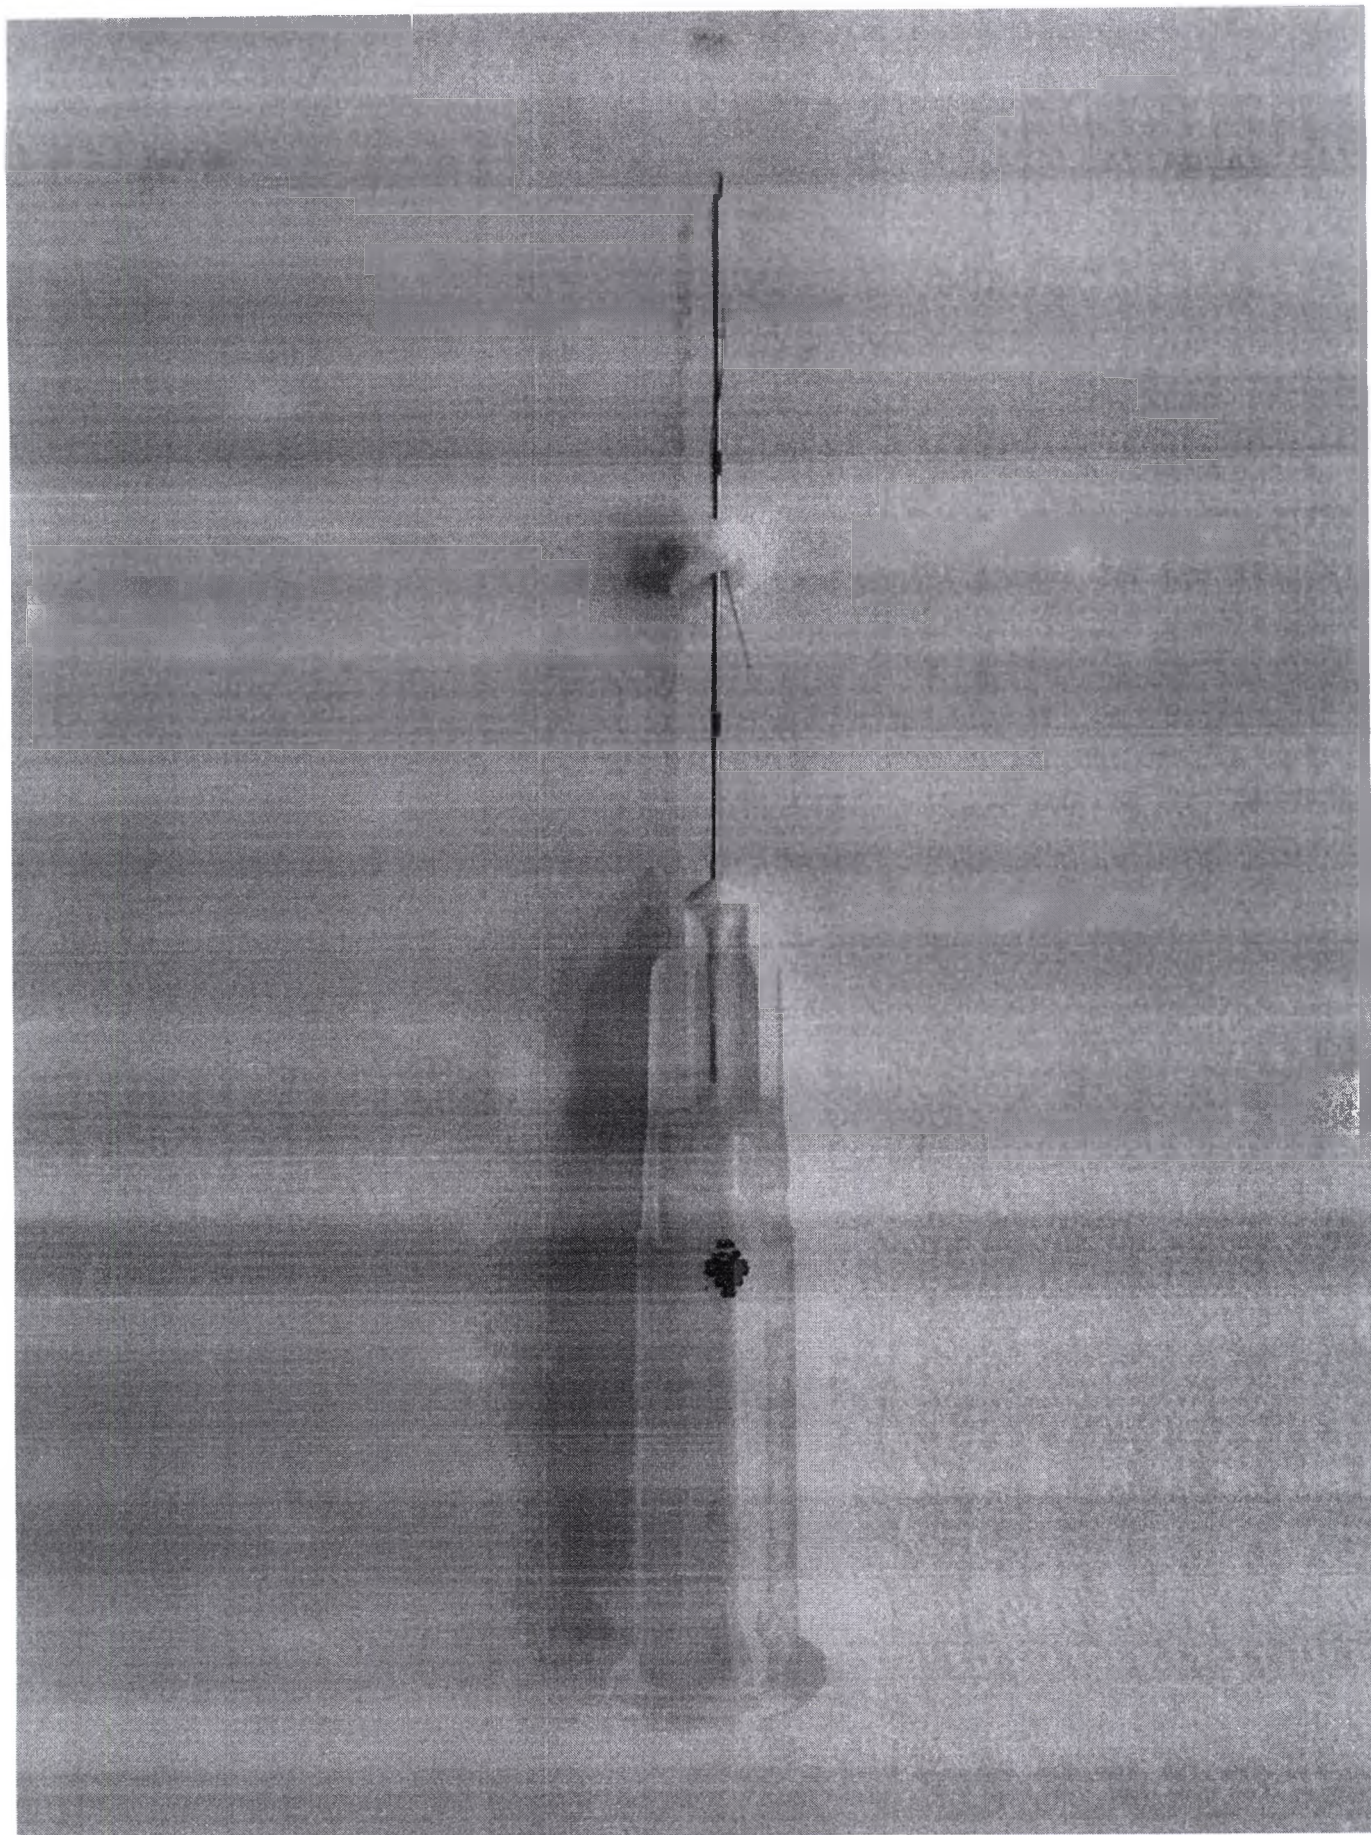

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Зубчатая нить с иглой – А тип (20 моделей)

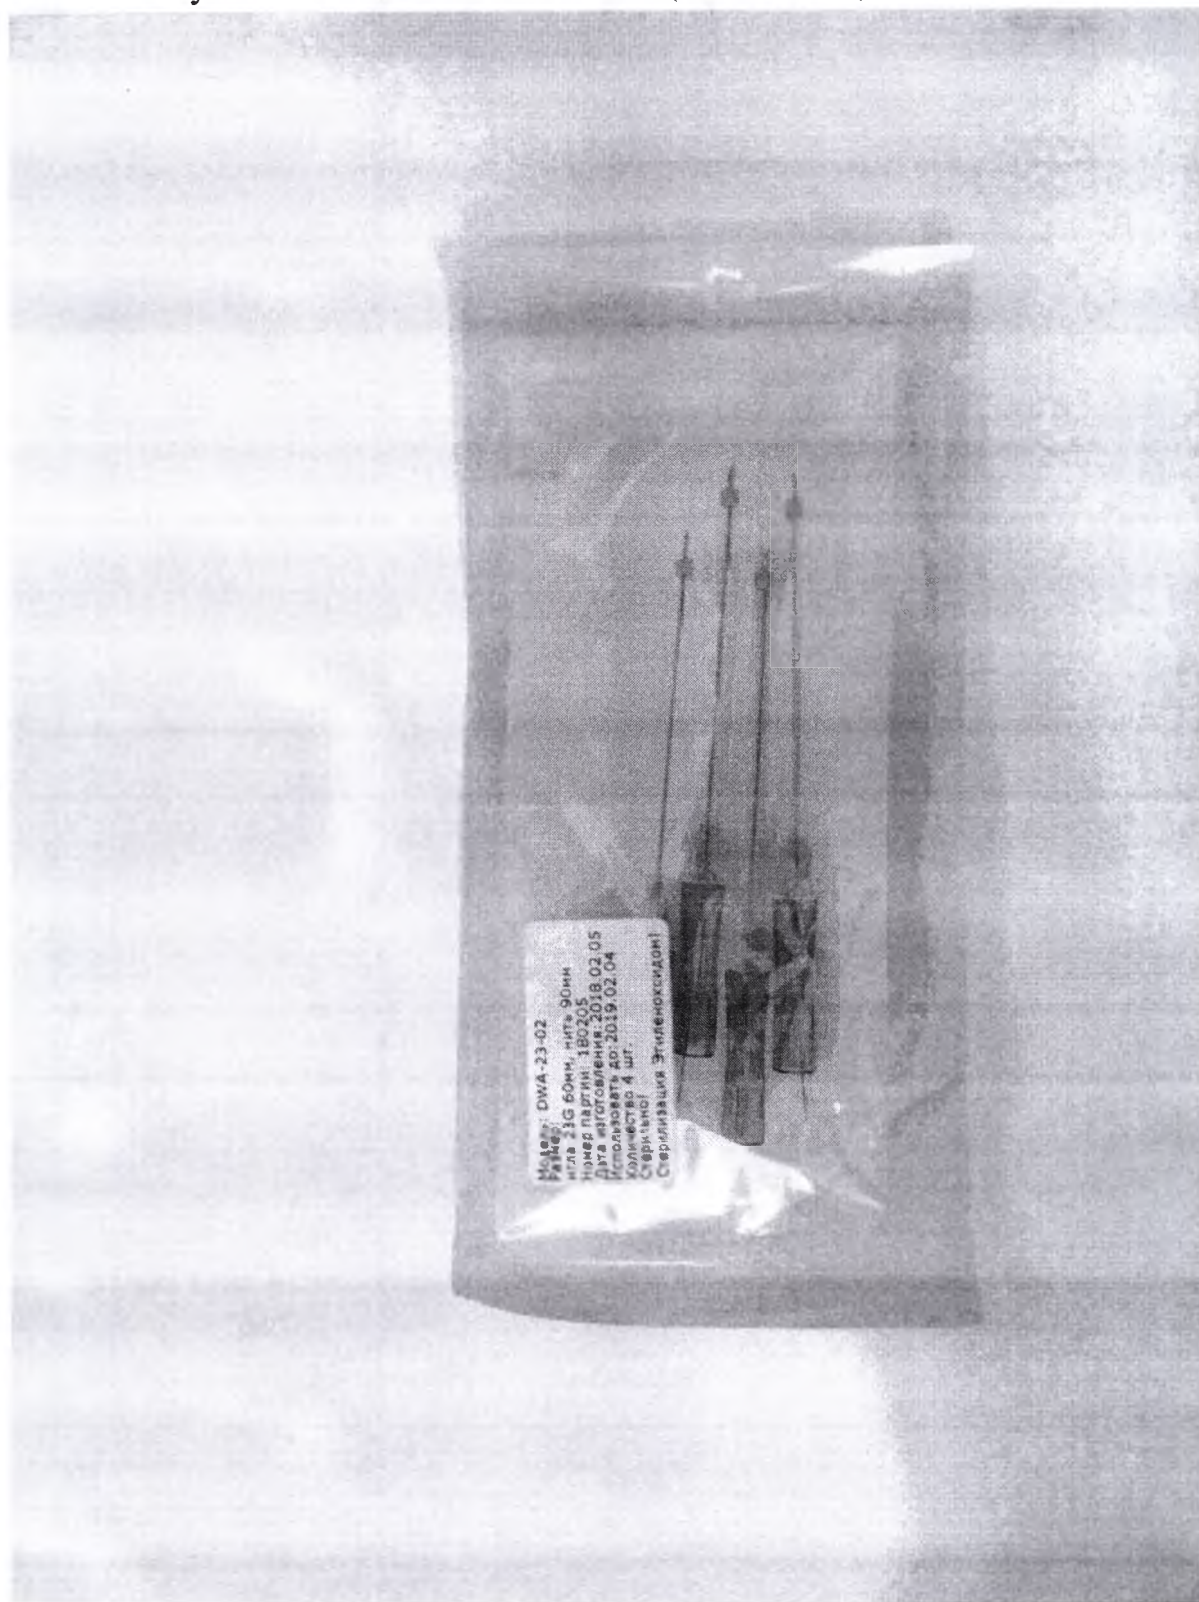


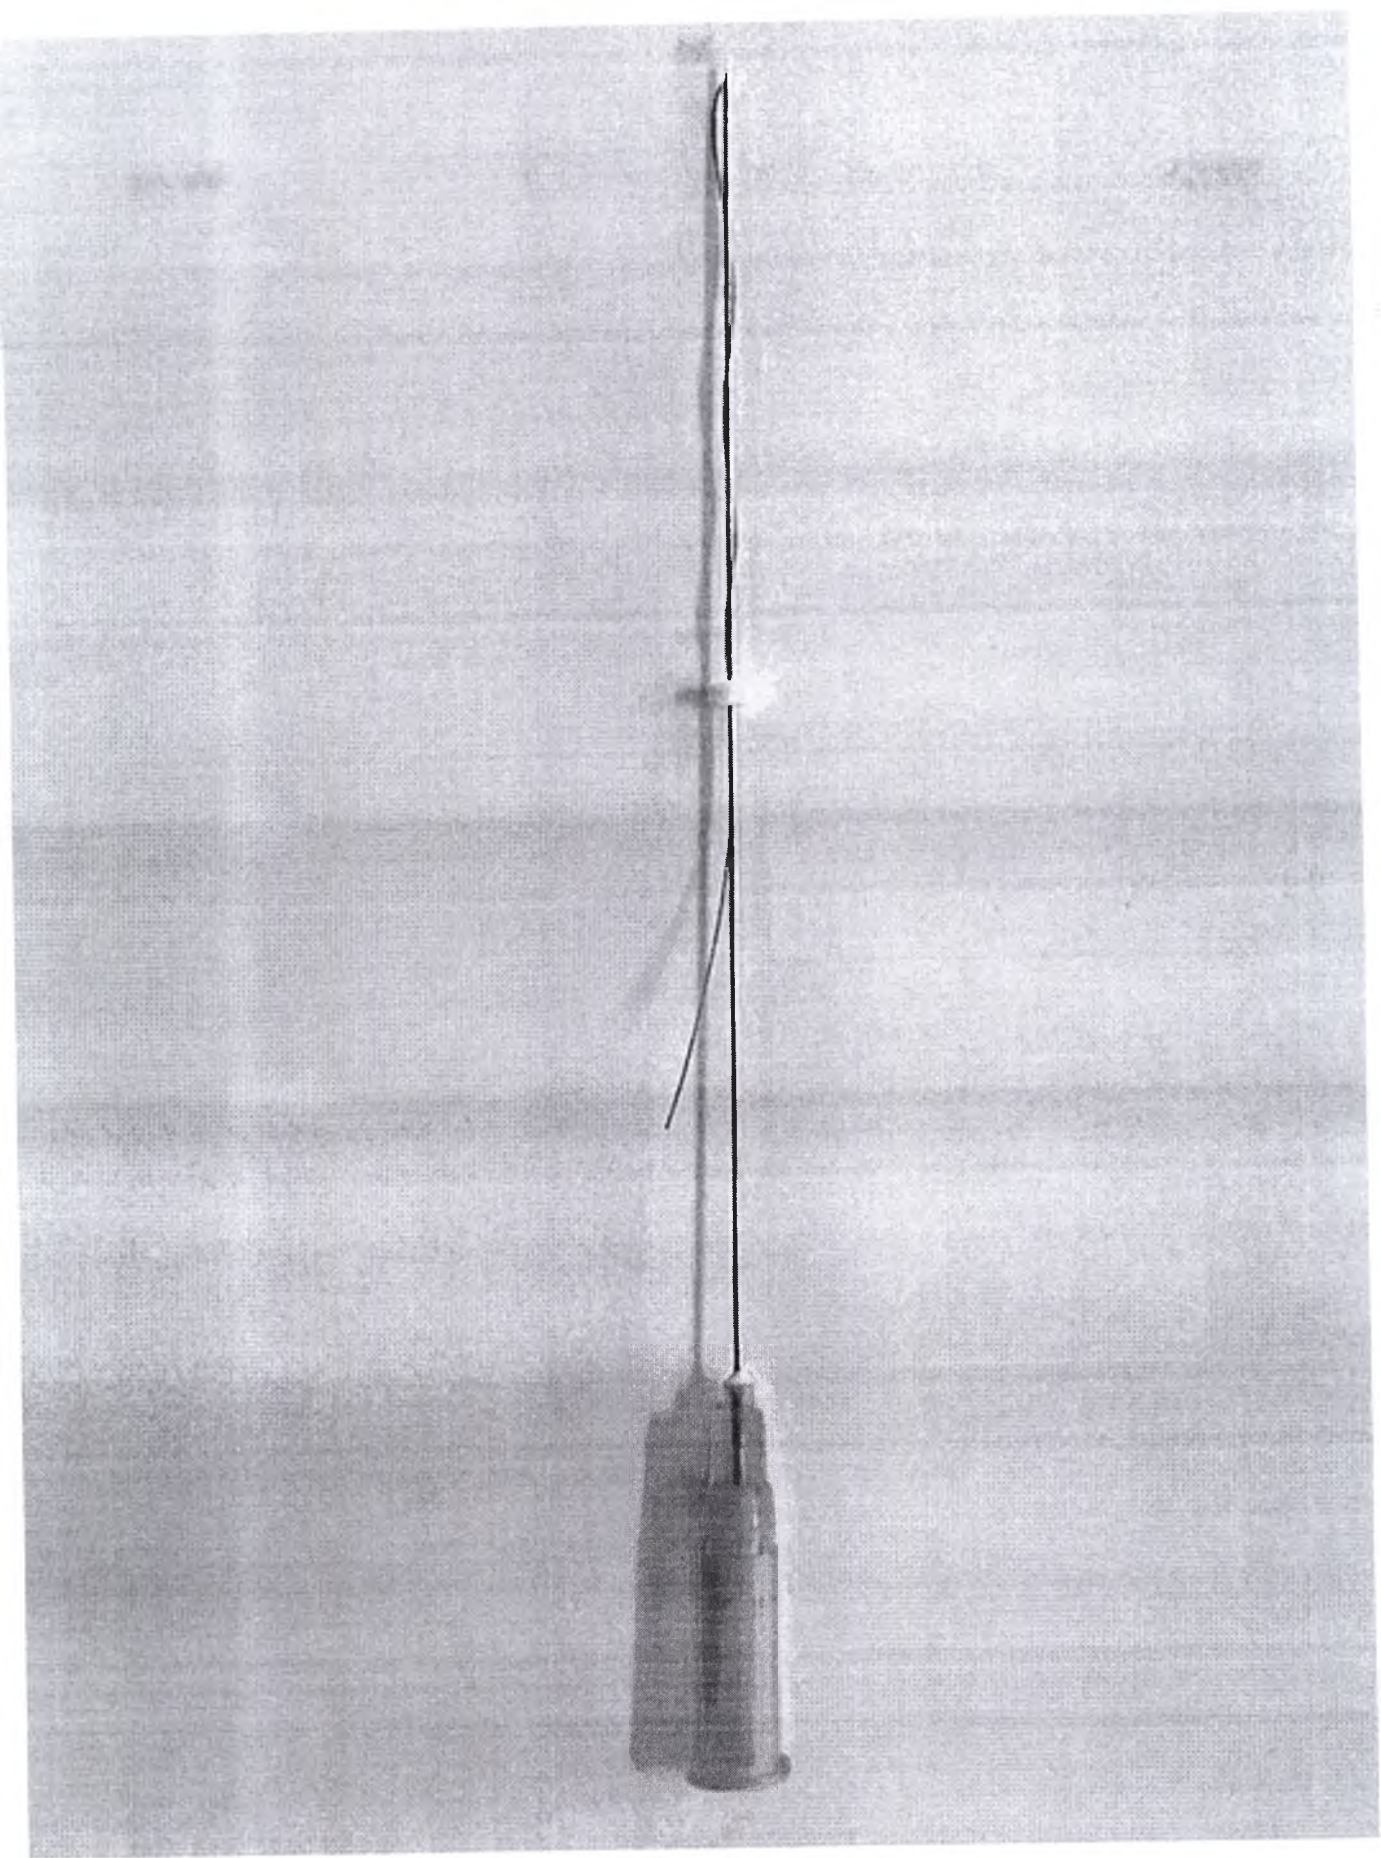

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Зубчатая нить с иглой – В тип (17 моделей)

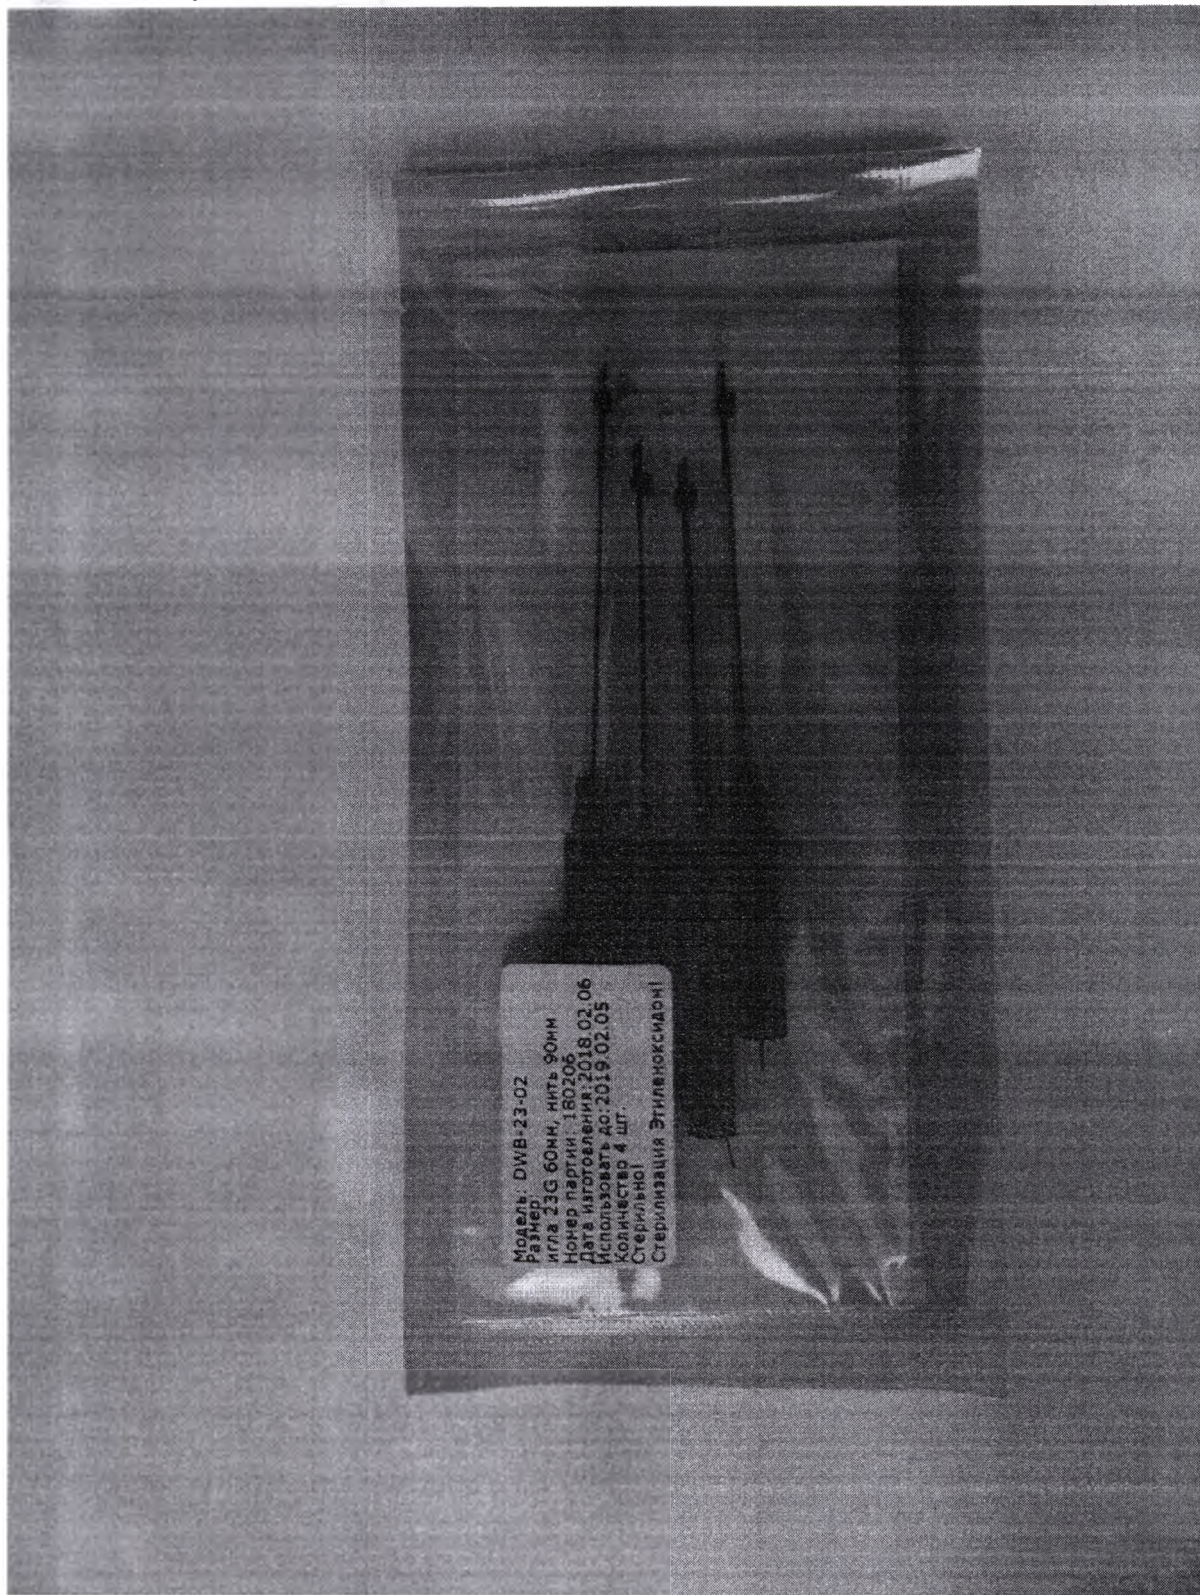


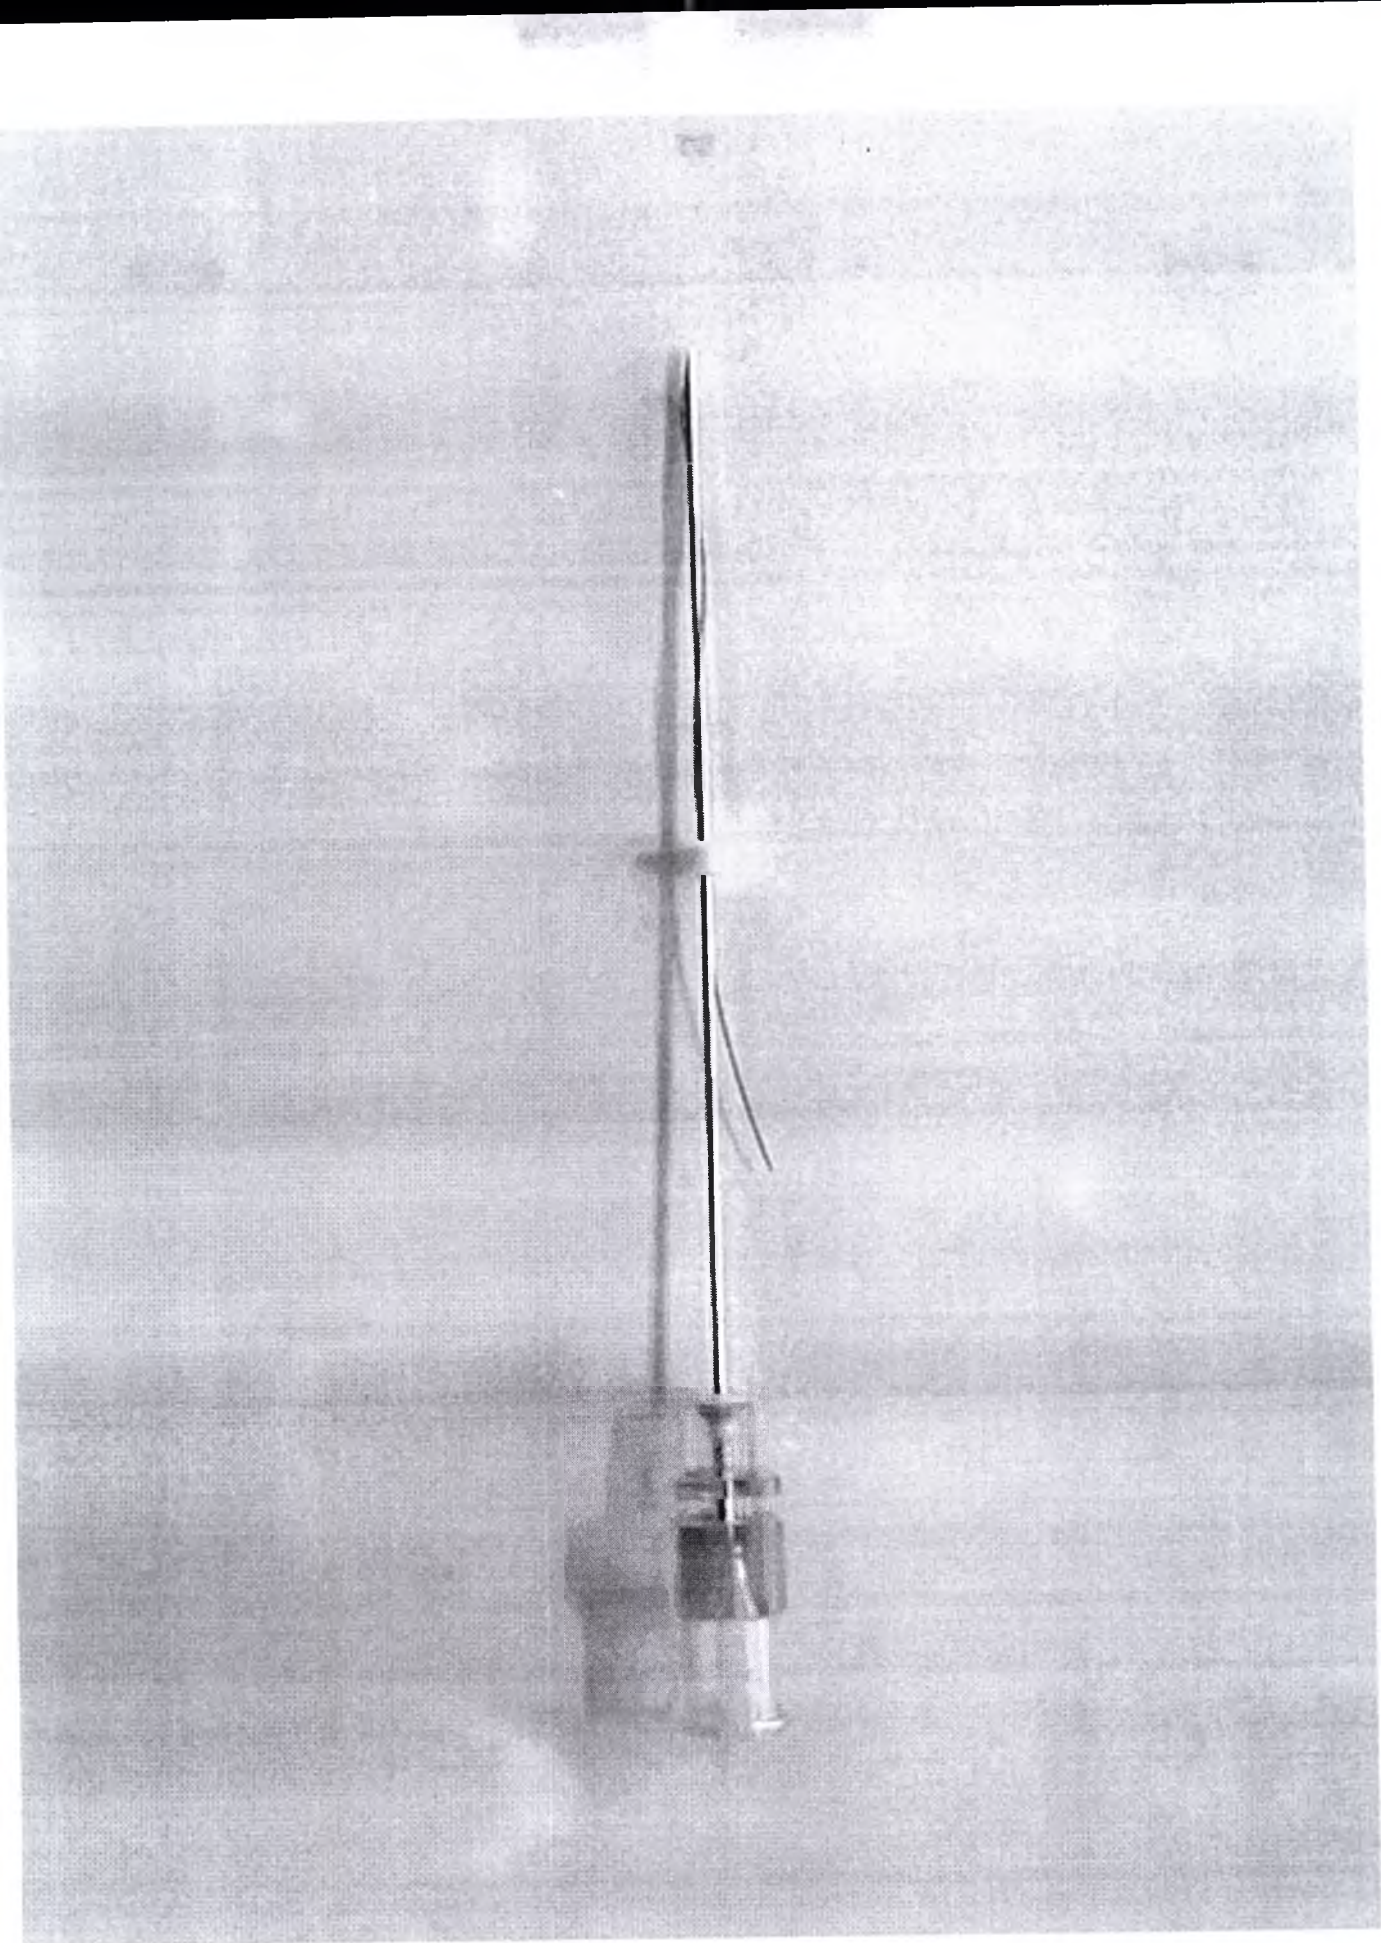


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Зубчатая нить с иглой – FA тип (17 моделей)

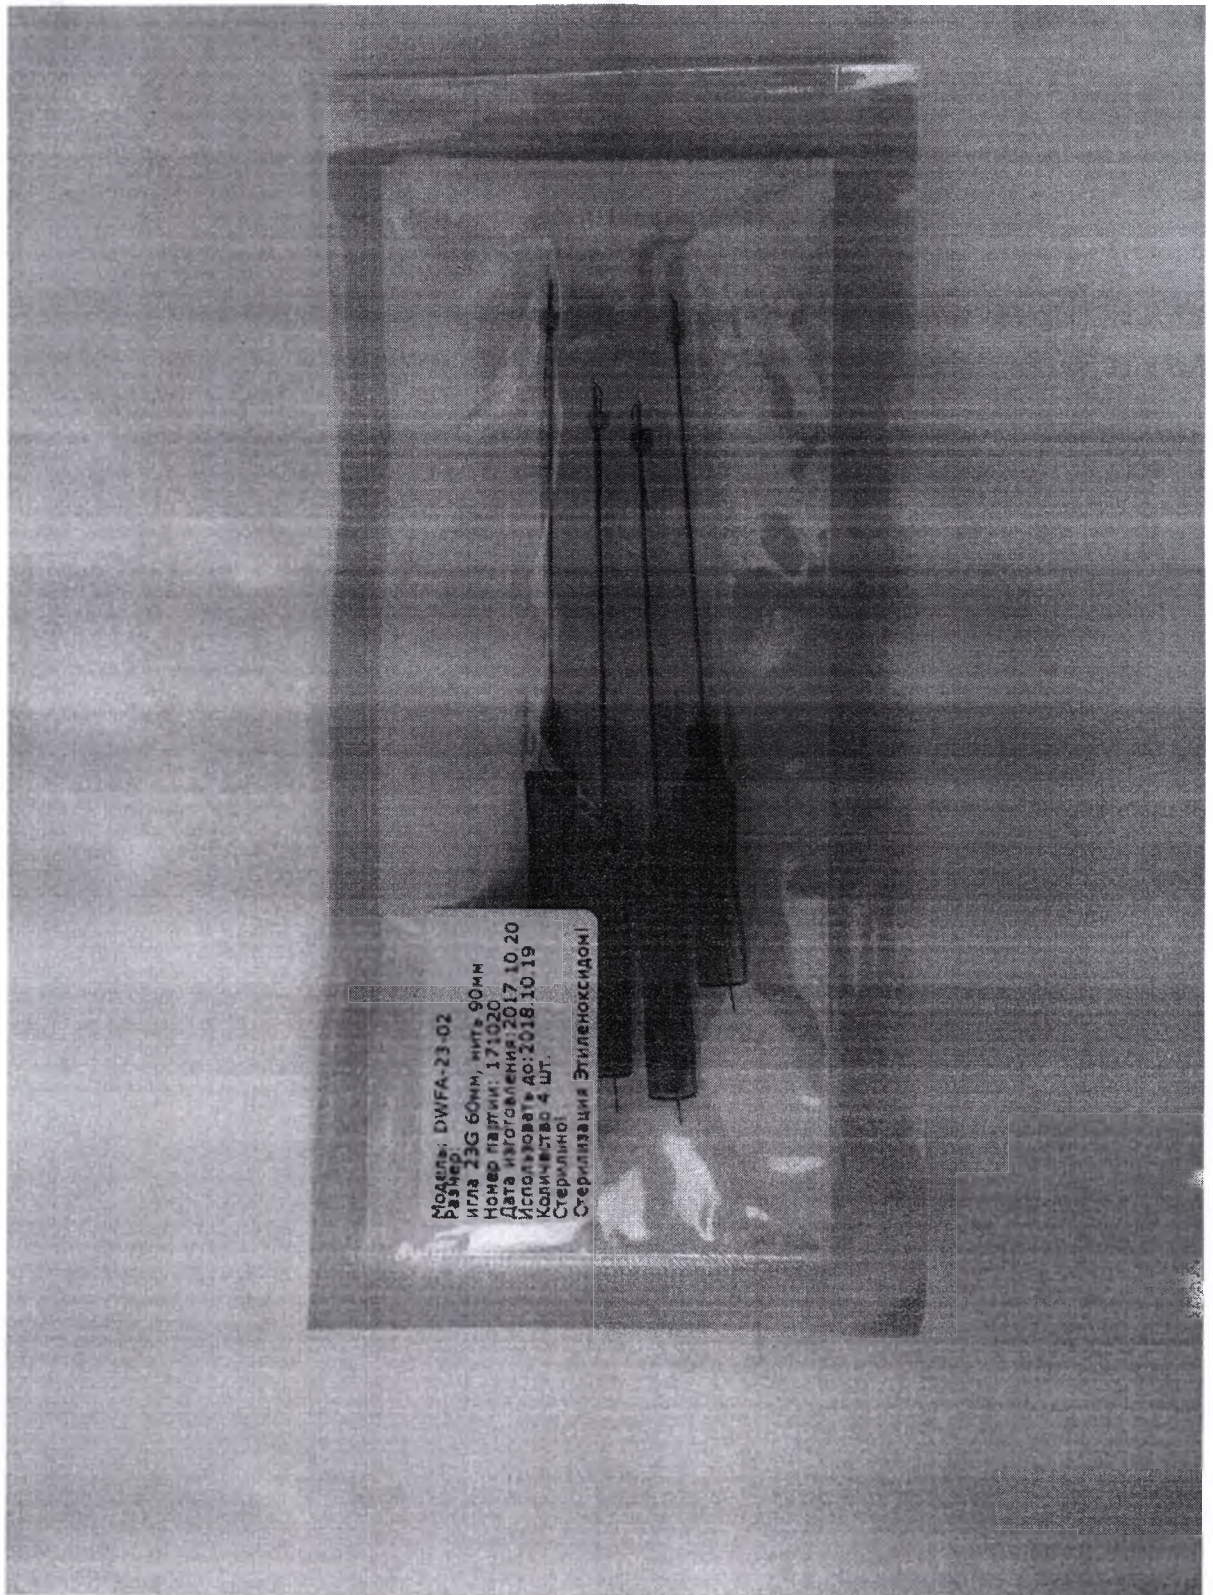

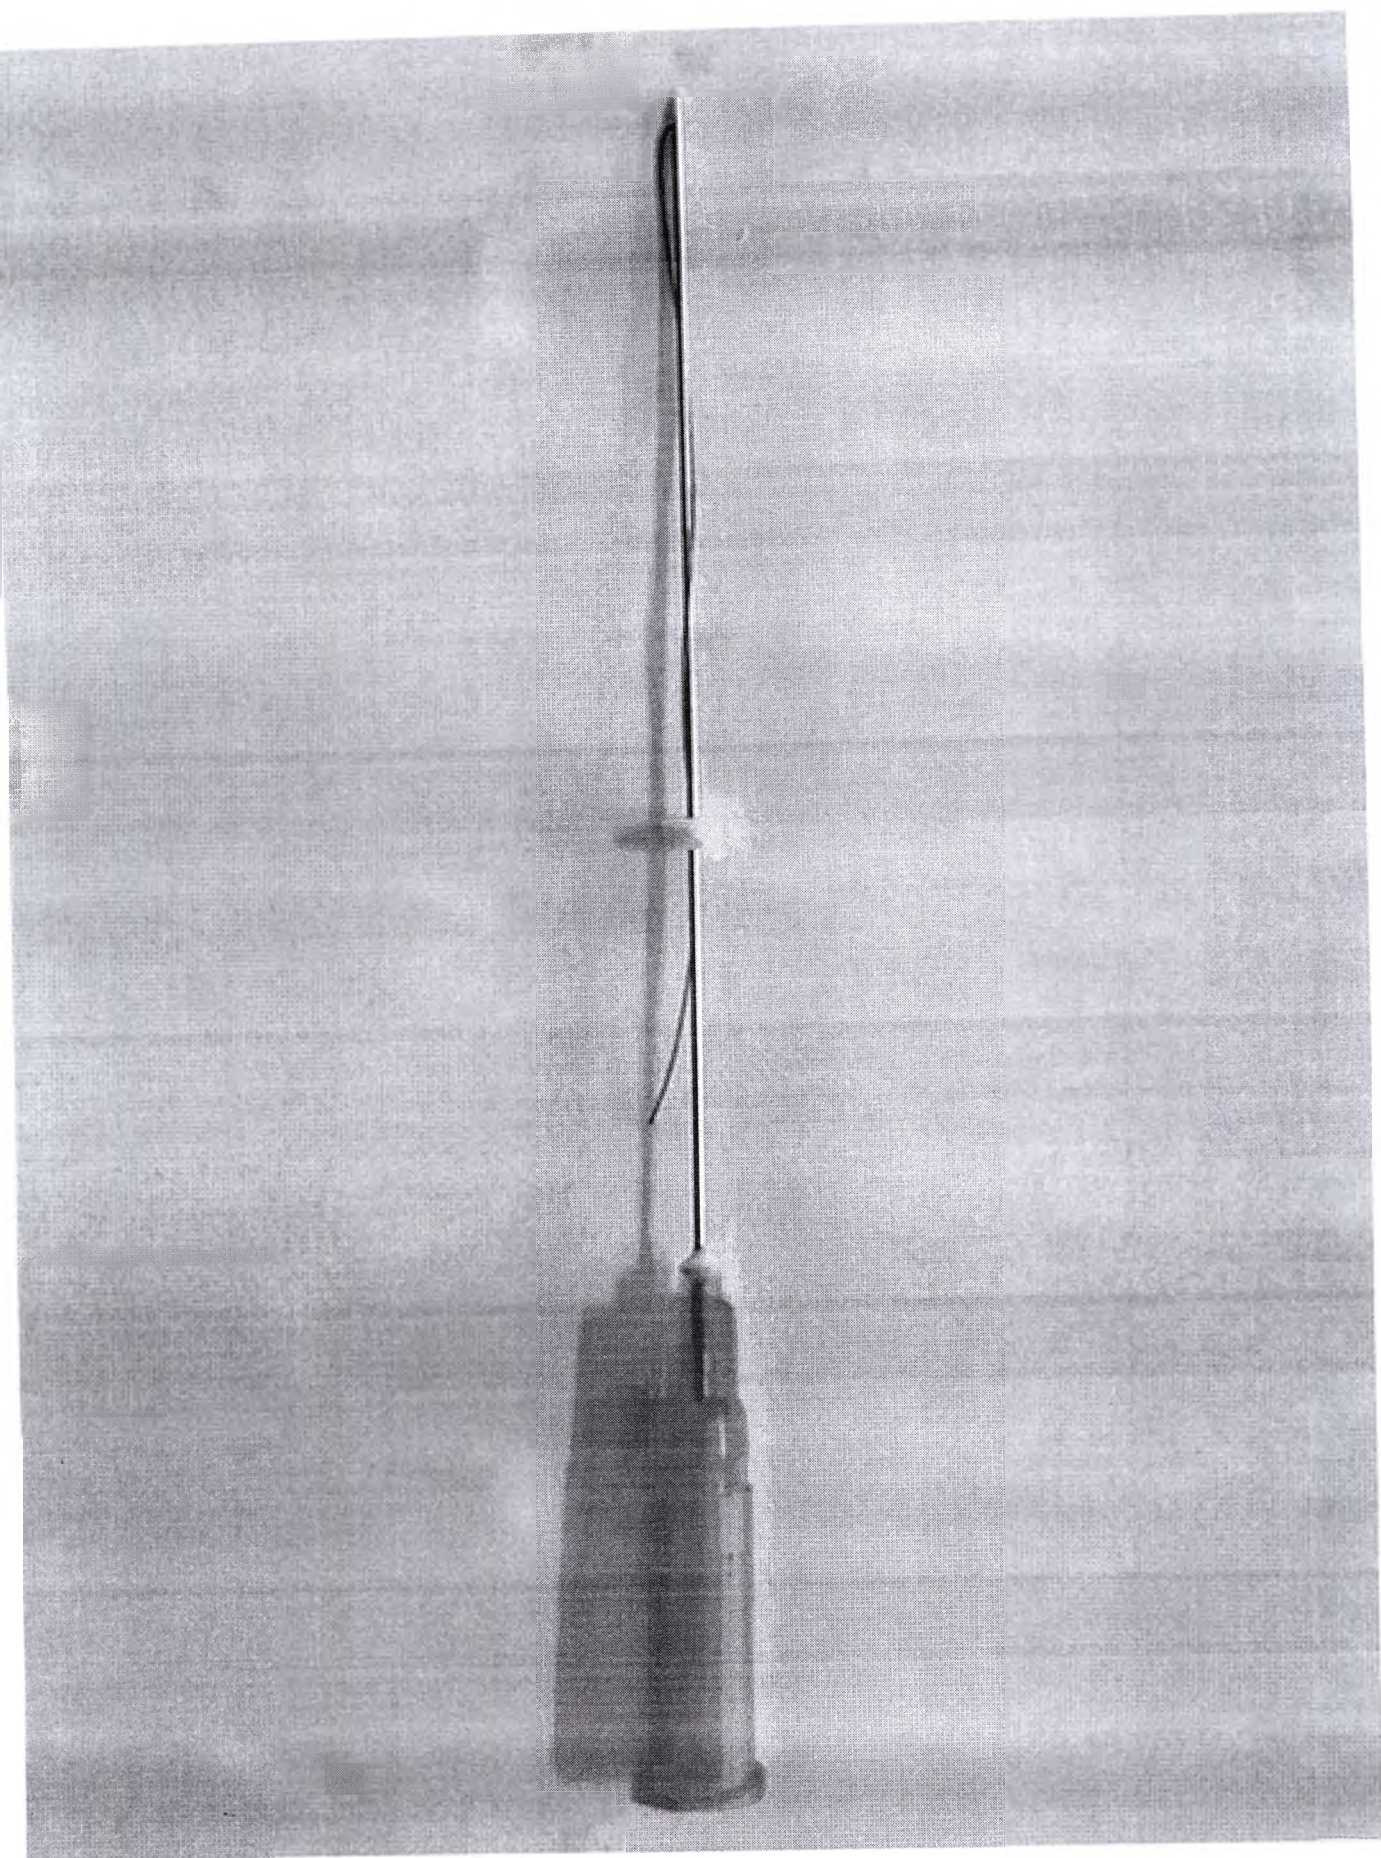



Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:
Зубчатая нить с иглой – FB тип (17 моделей)

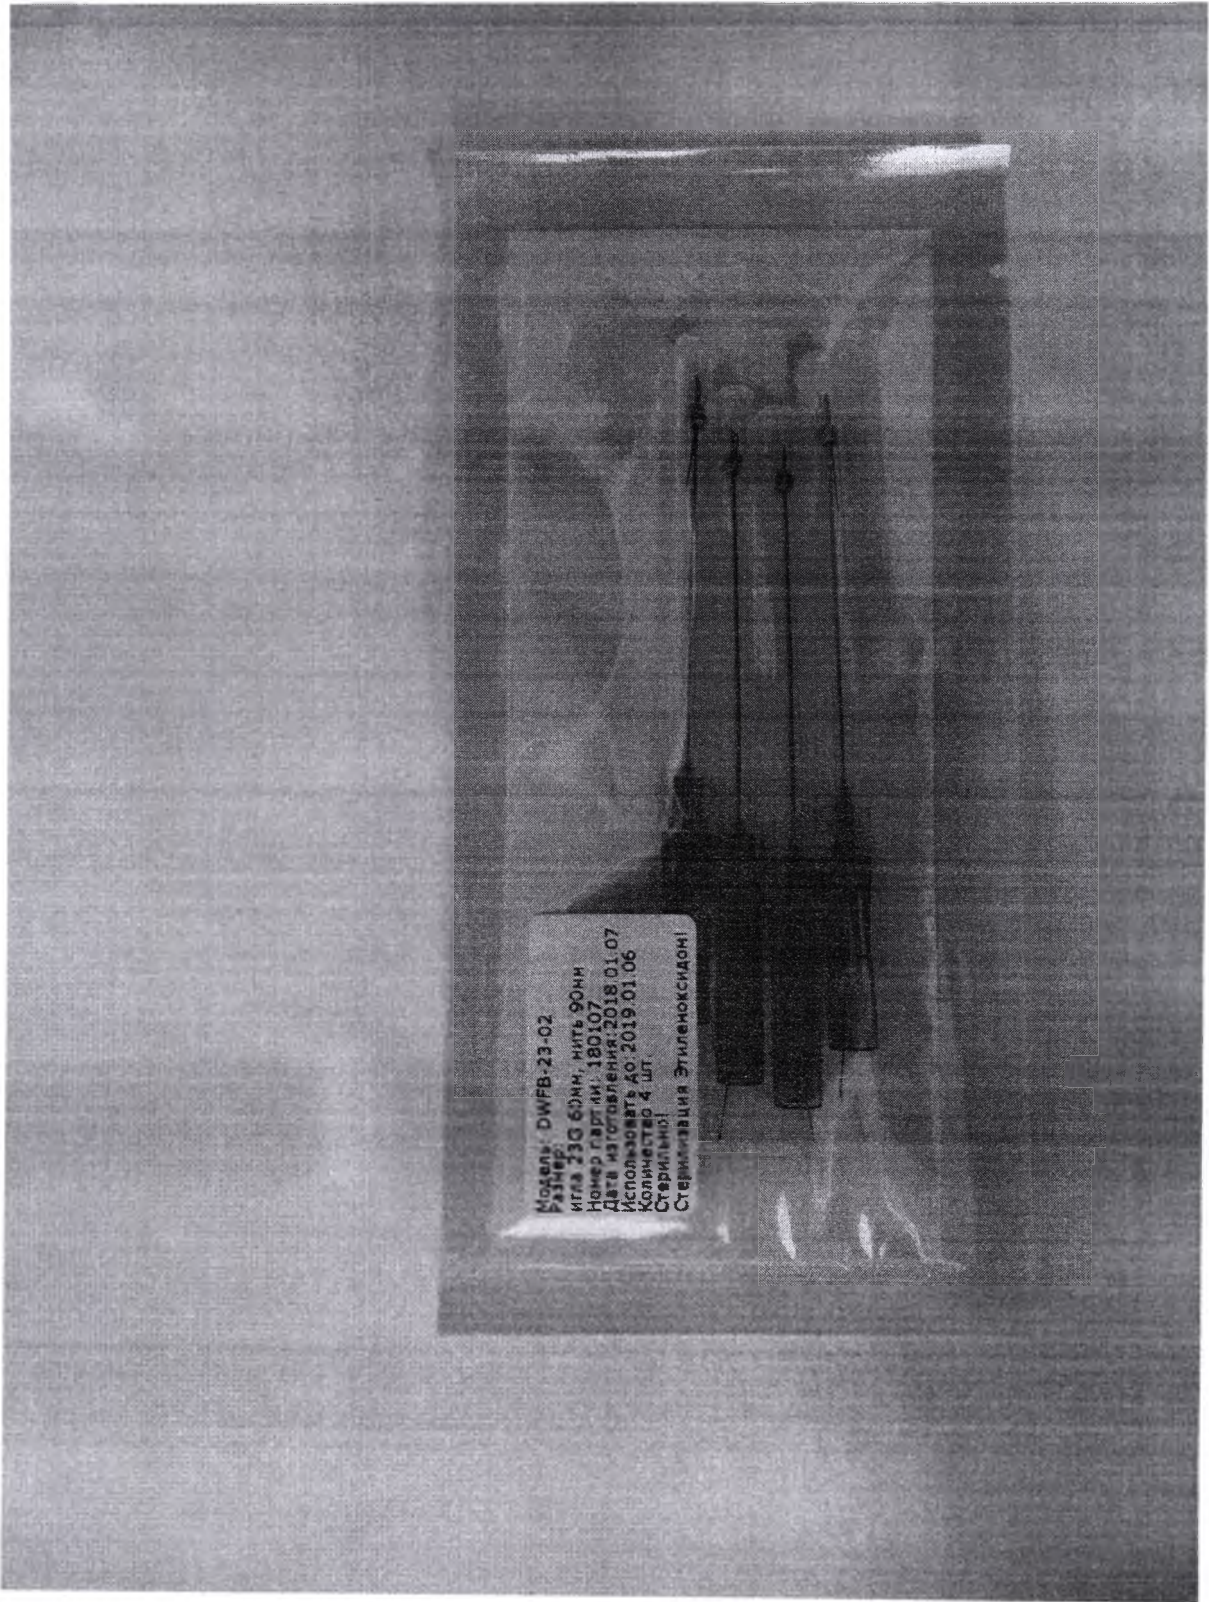

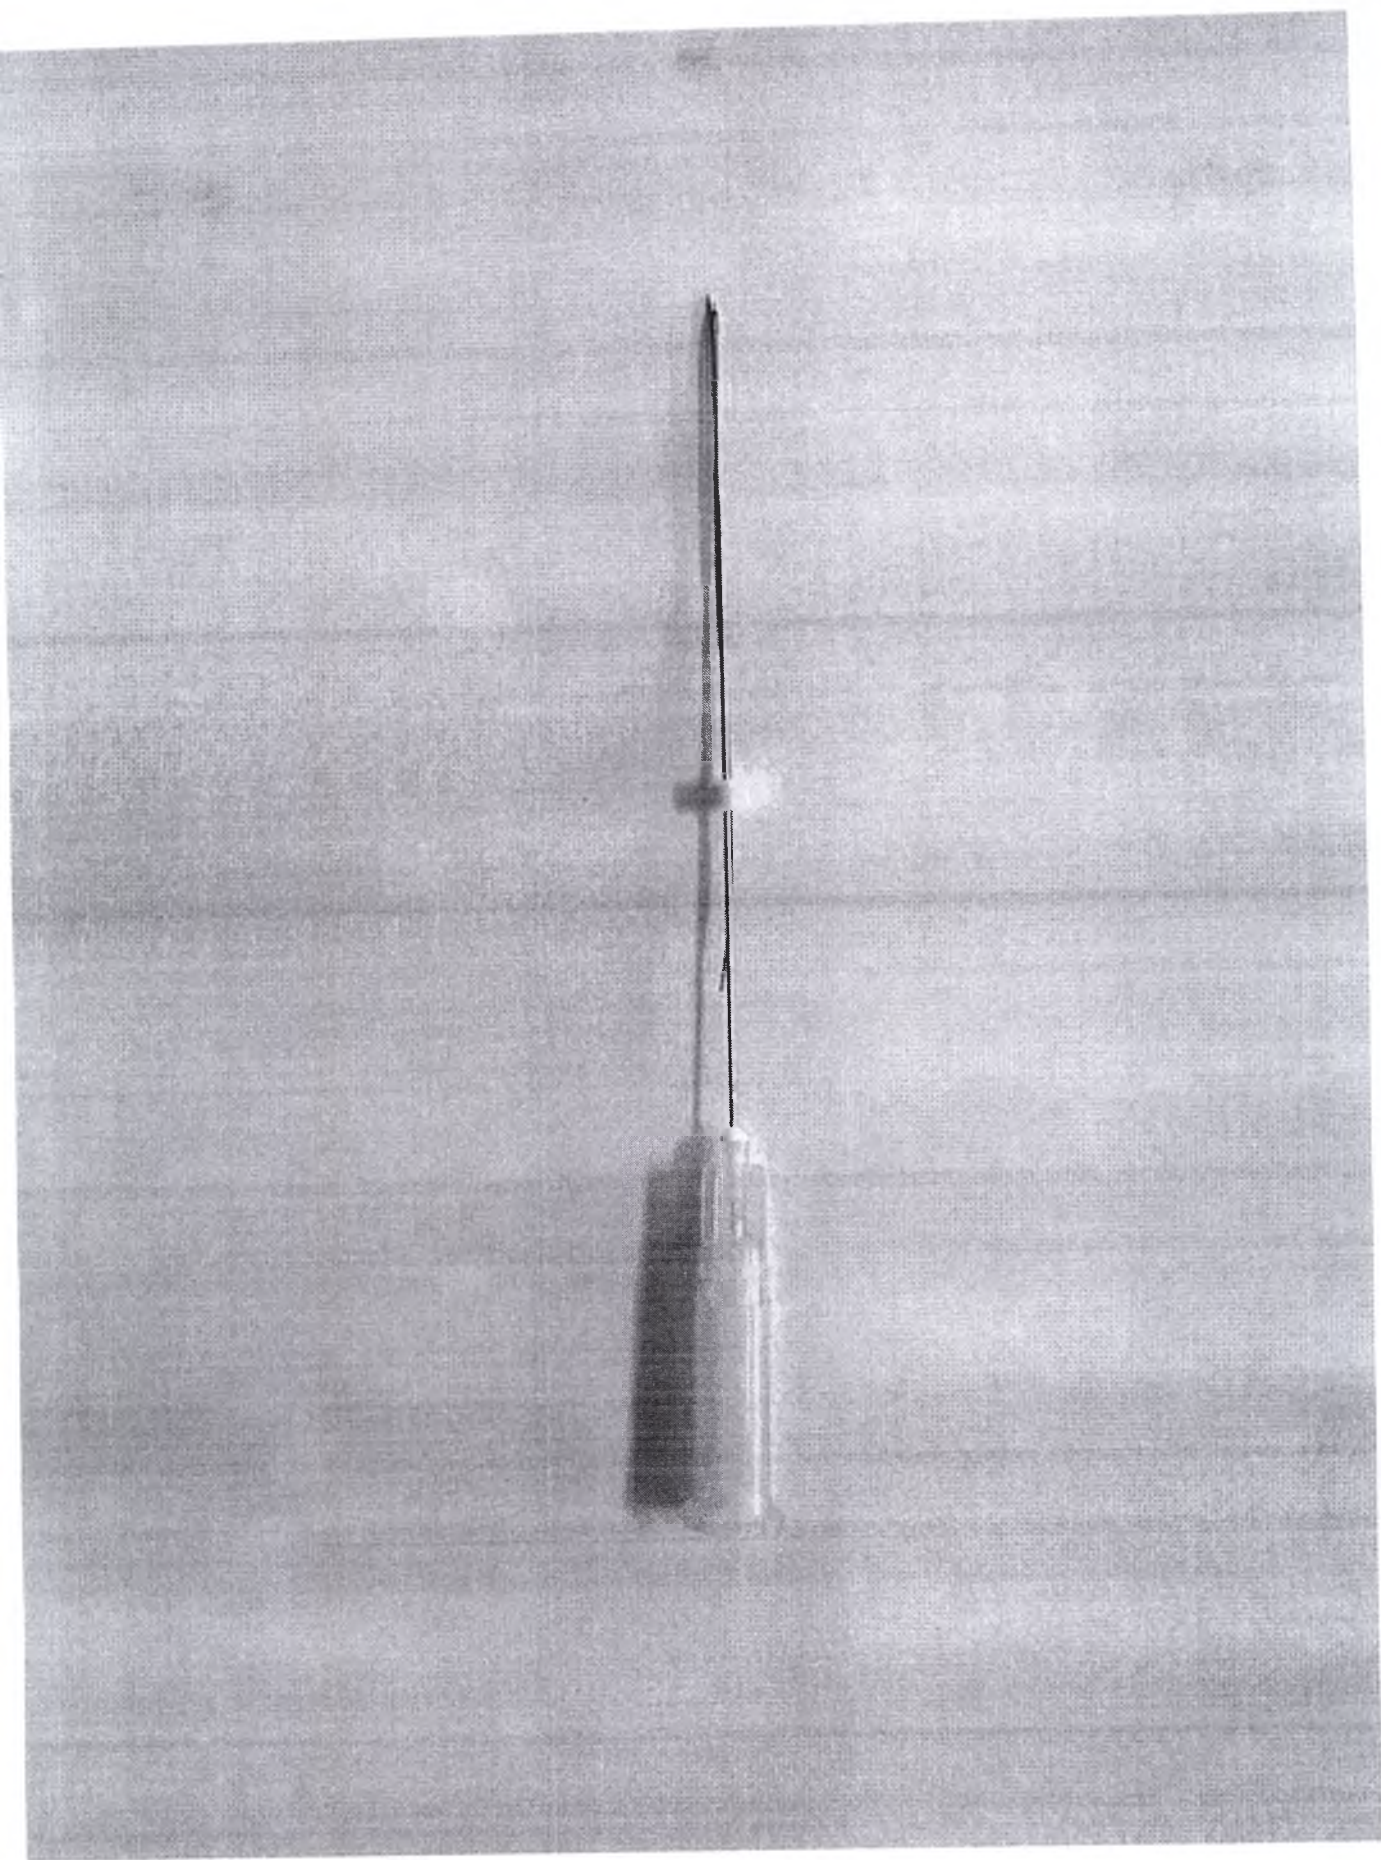



Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:
Зубчатая нить с иглой – VL тип (15 моделей)

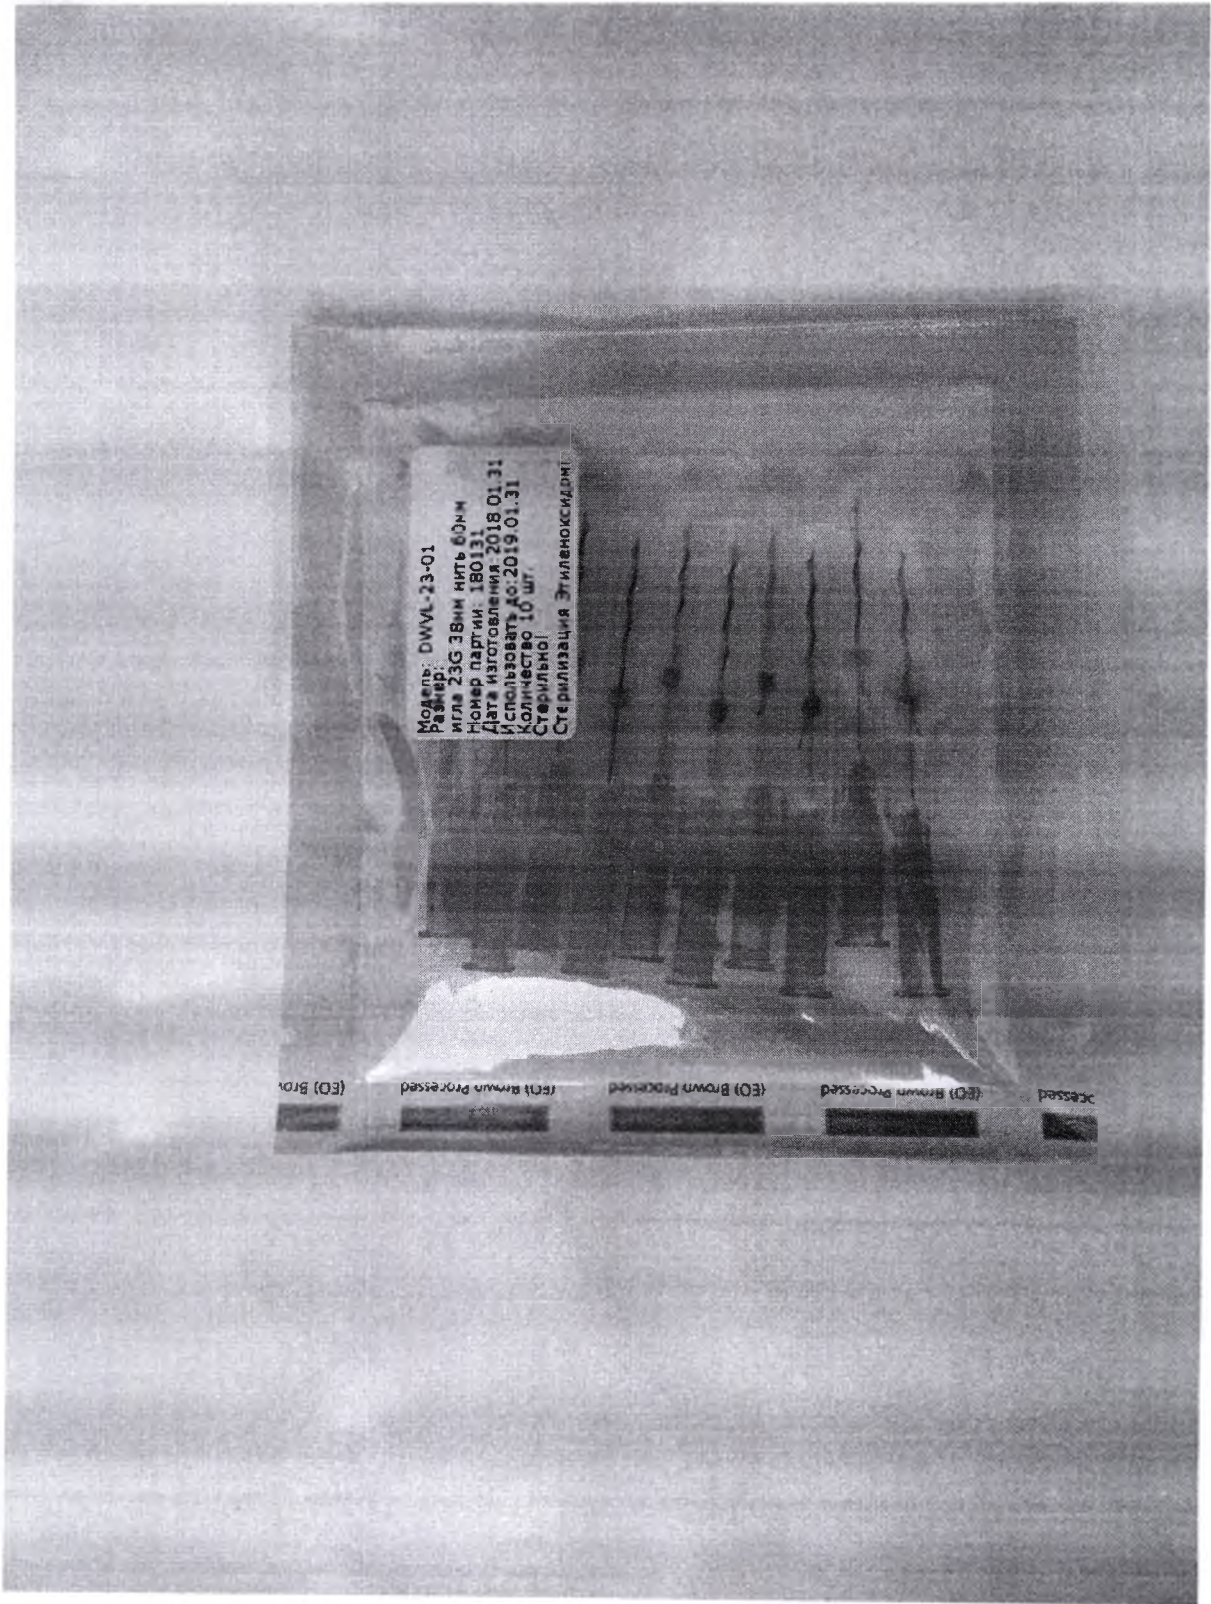

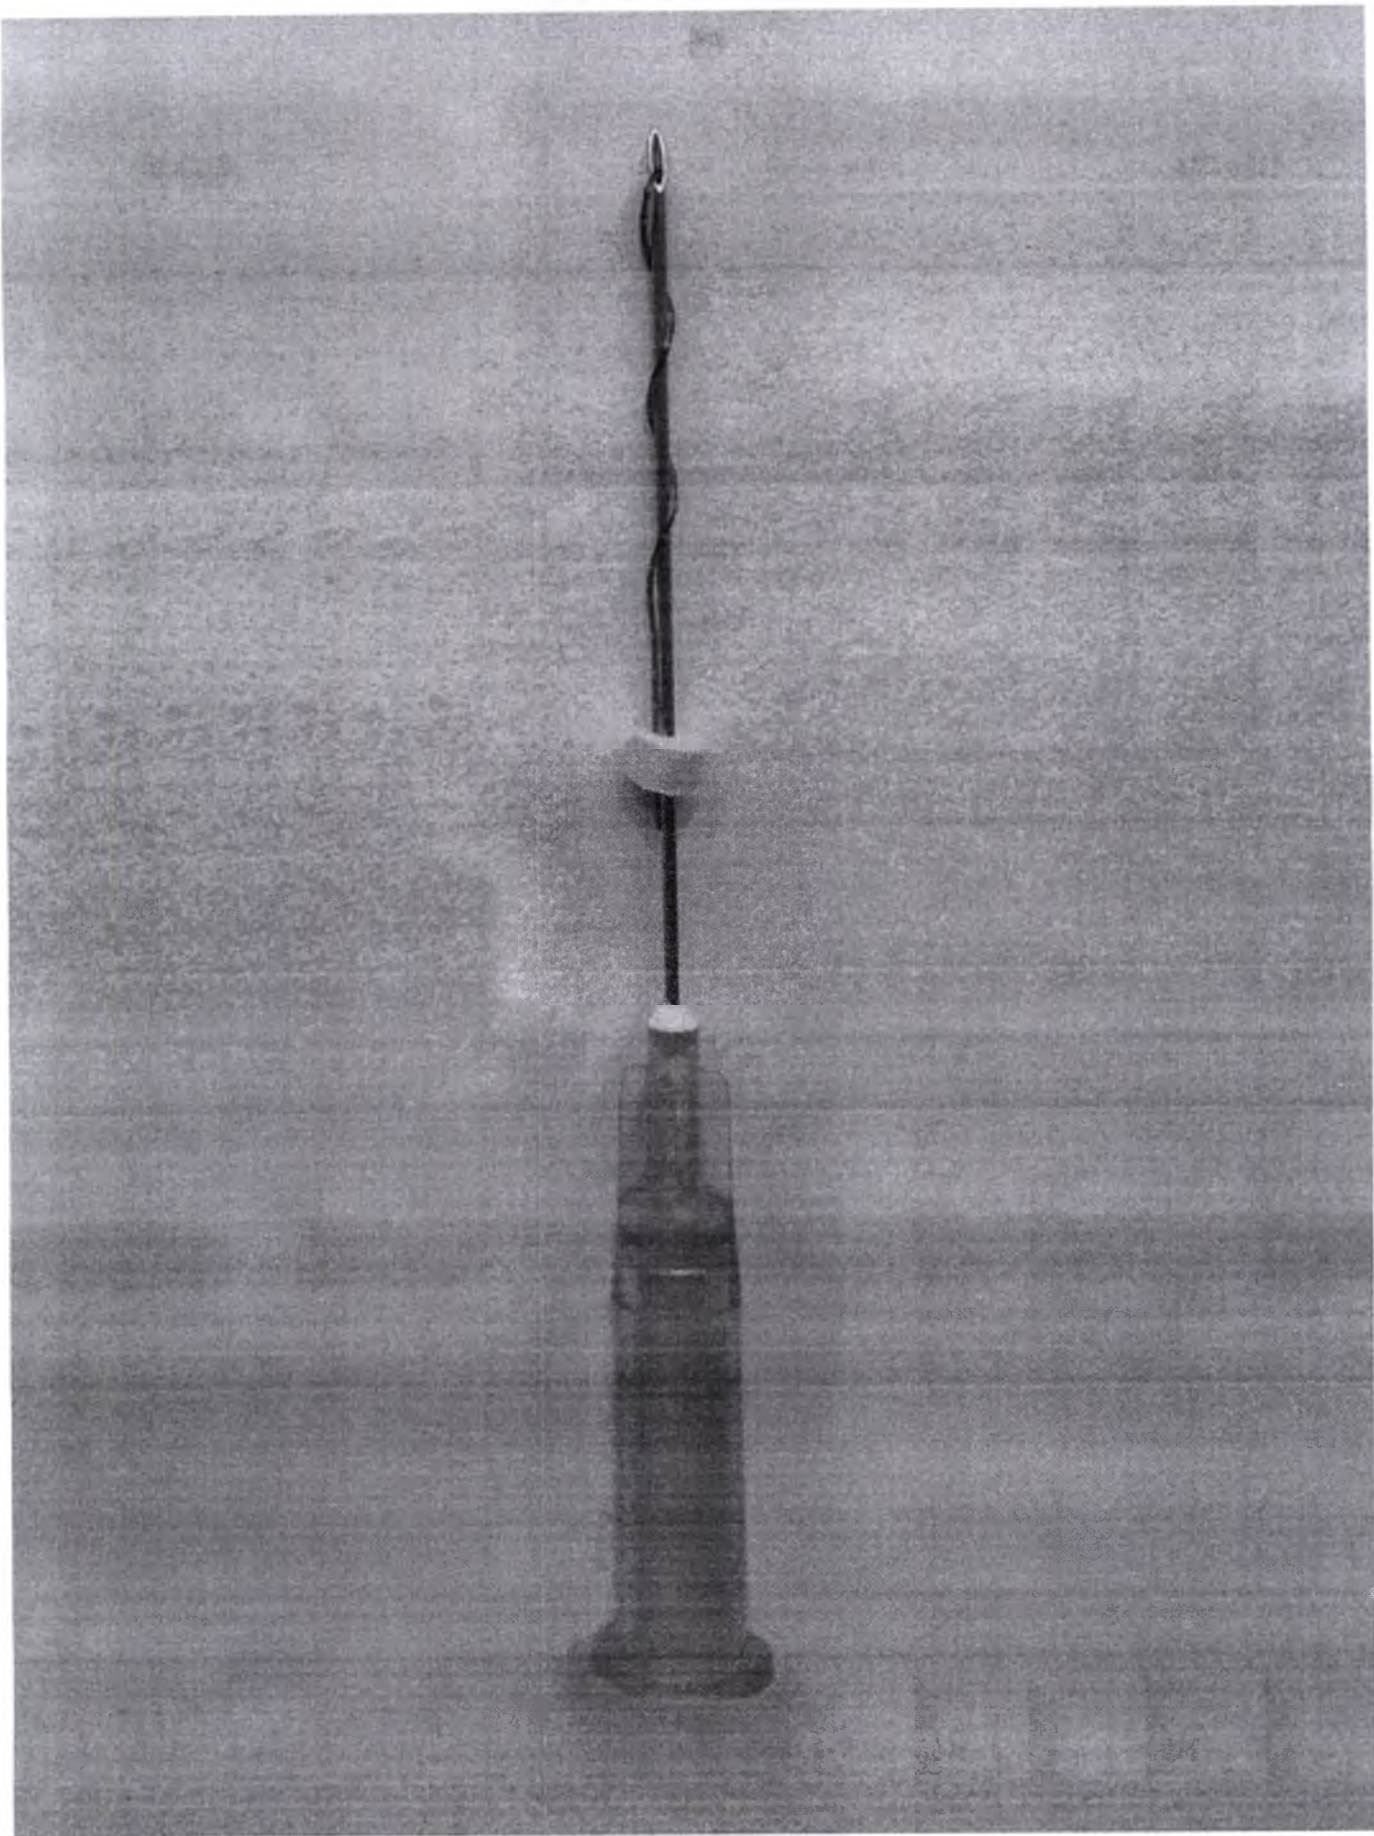



Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:
Зубчатая нить с иглой – VLS тип (13 моделей)

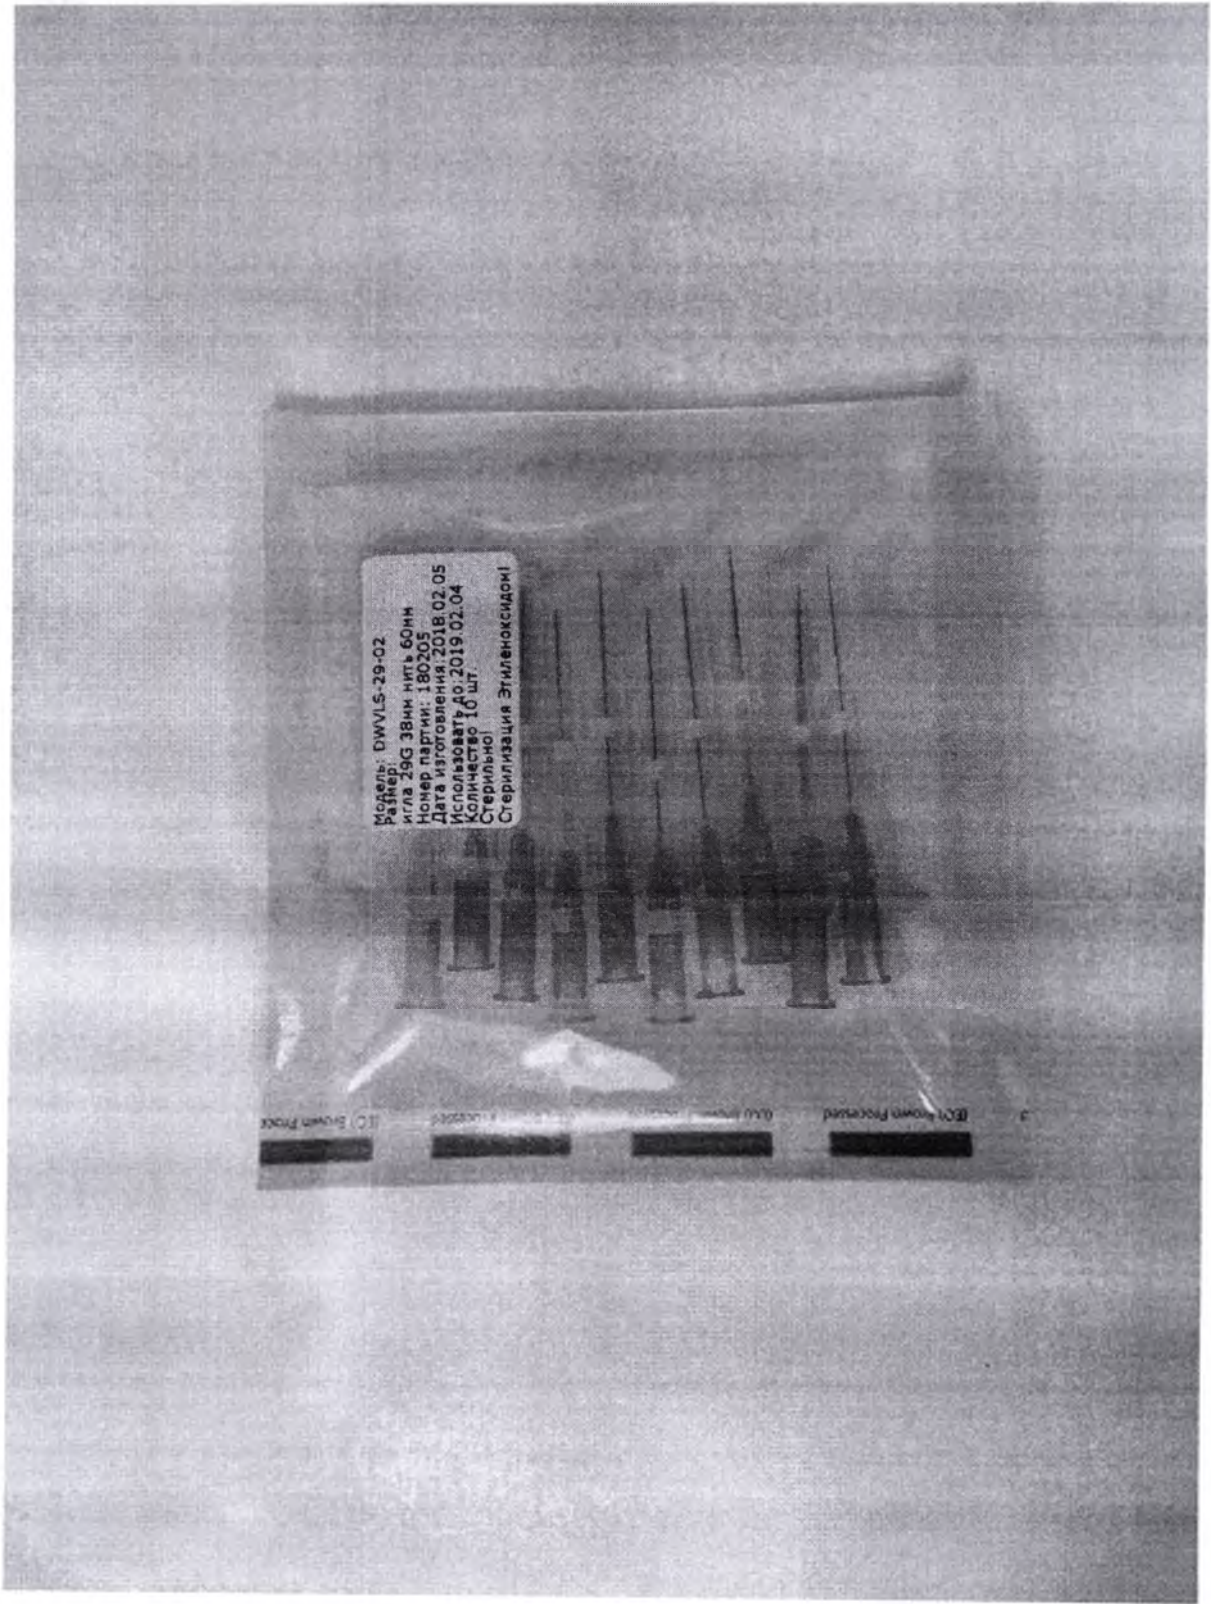

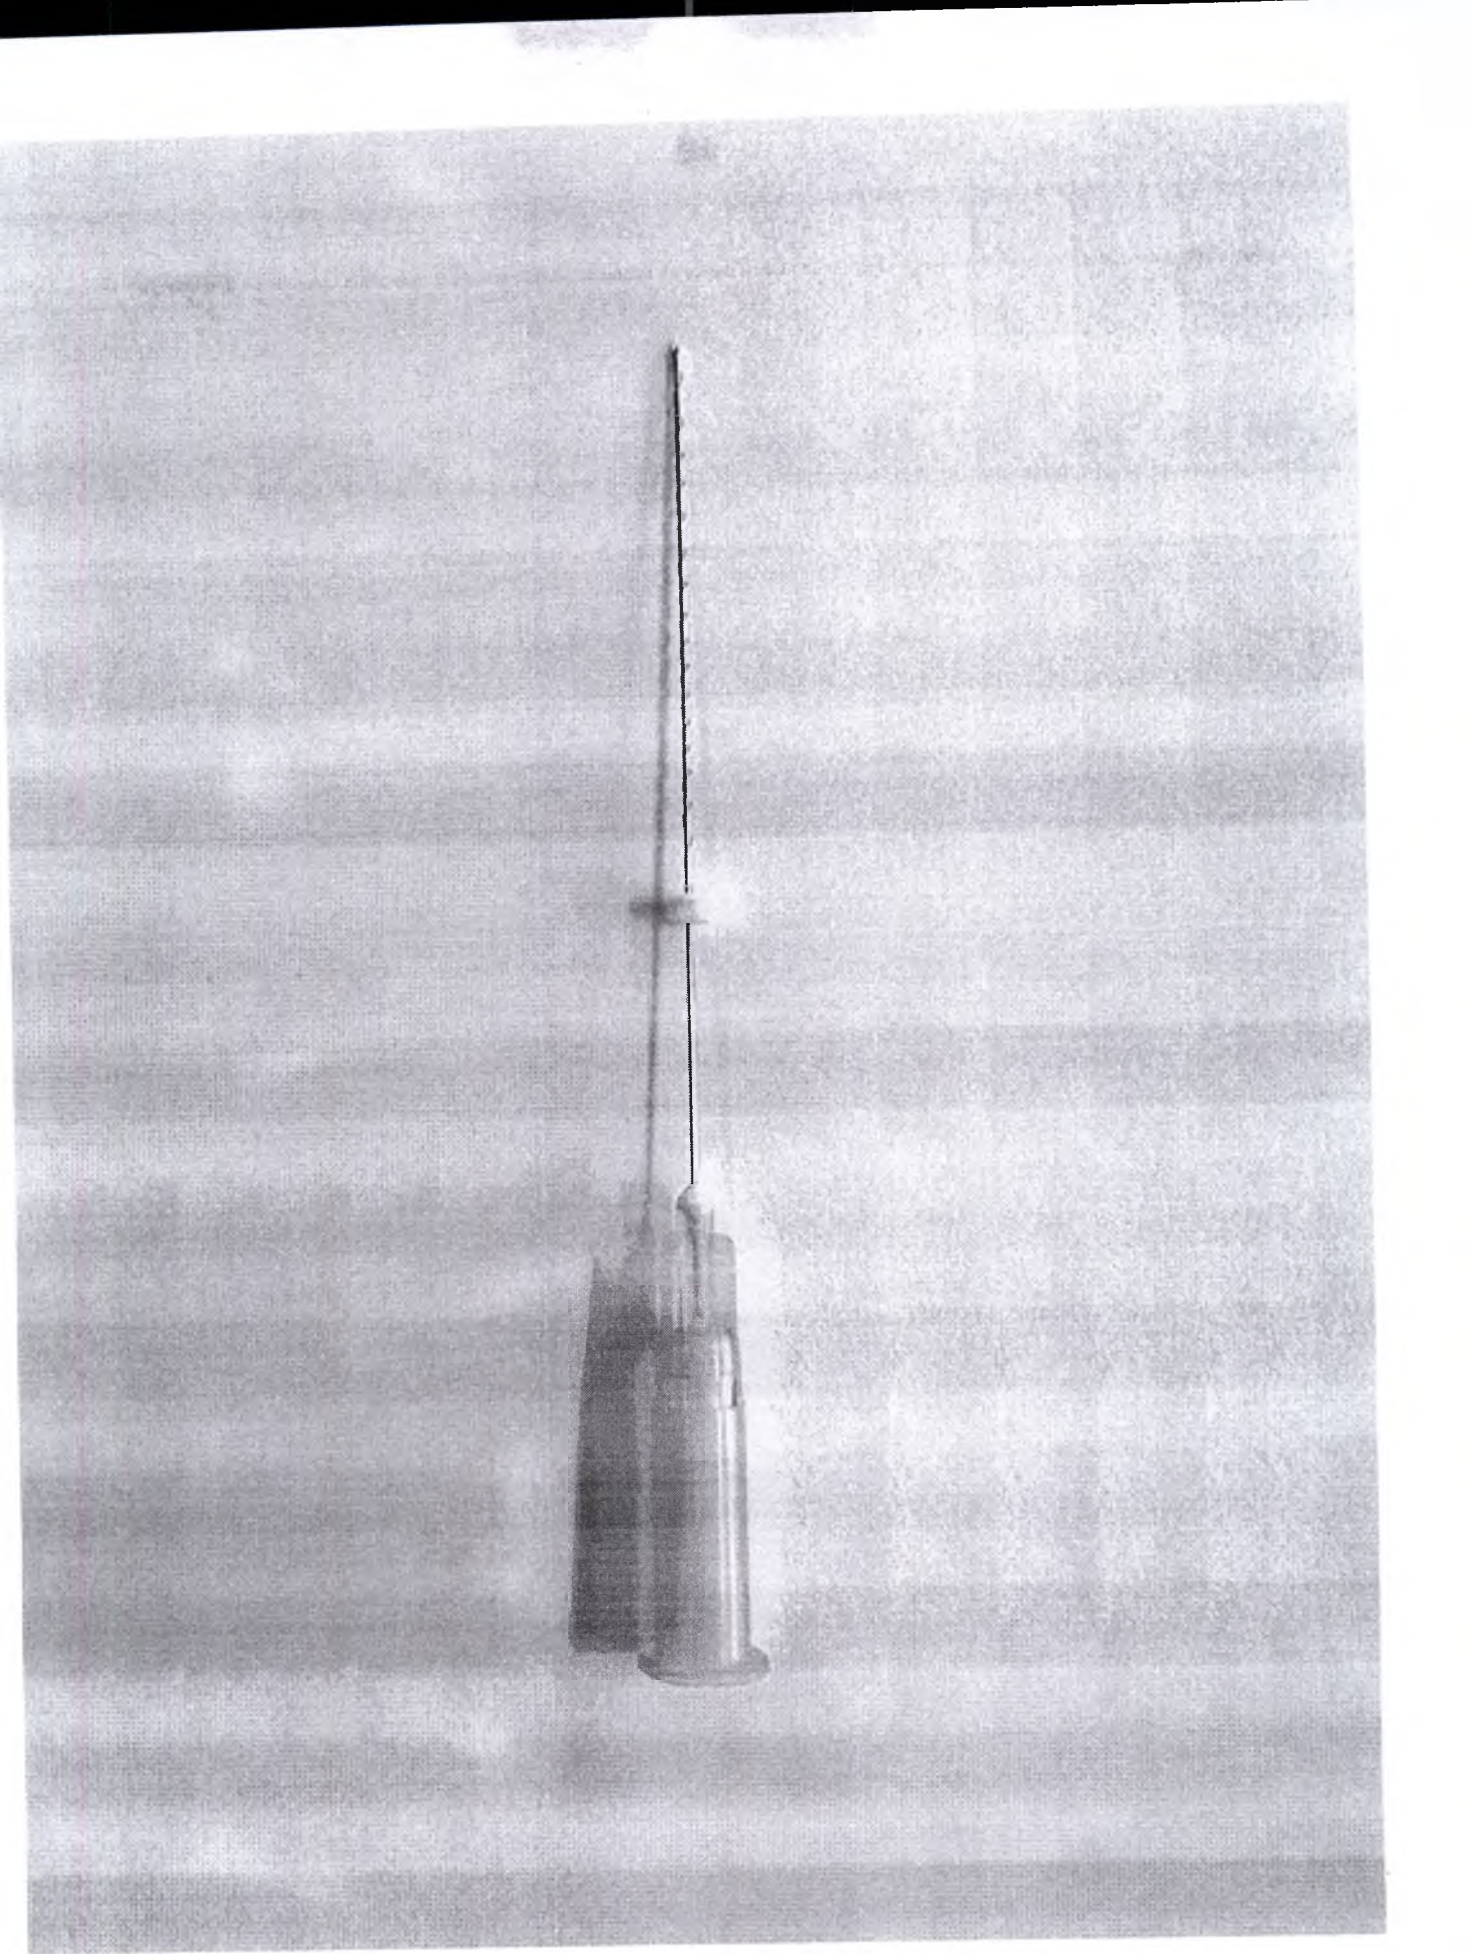


Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:
Зубчатая нить с иглой – S тип (16 моделей)

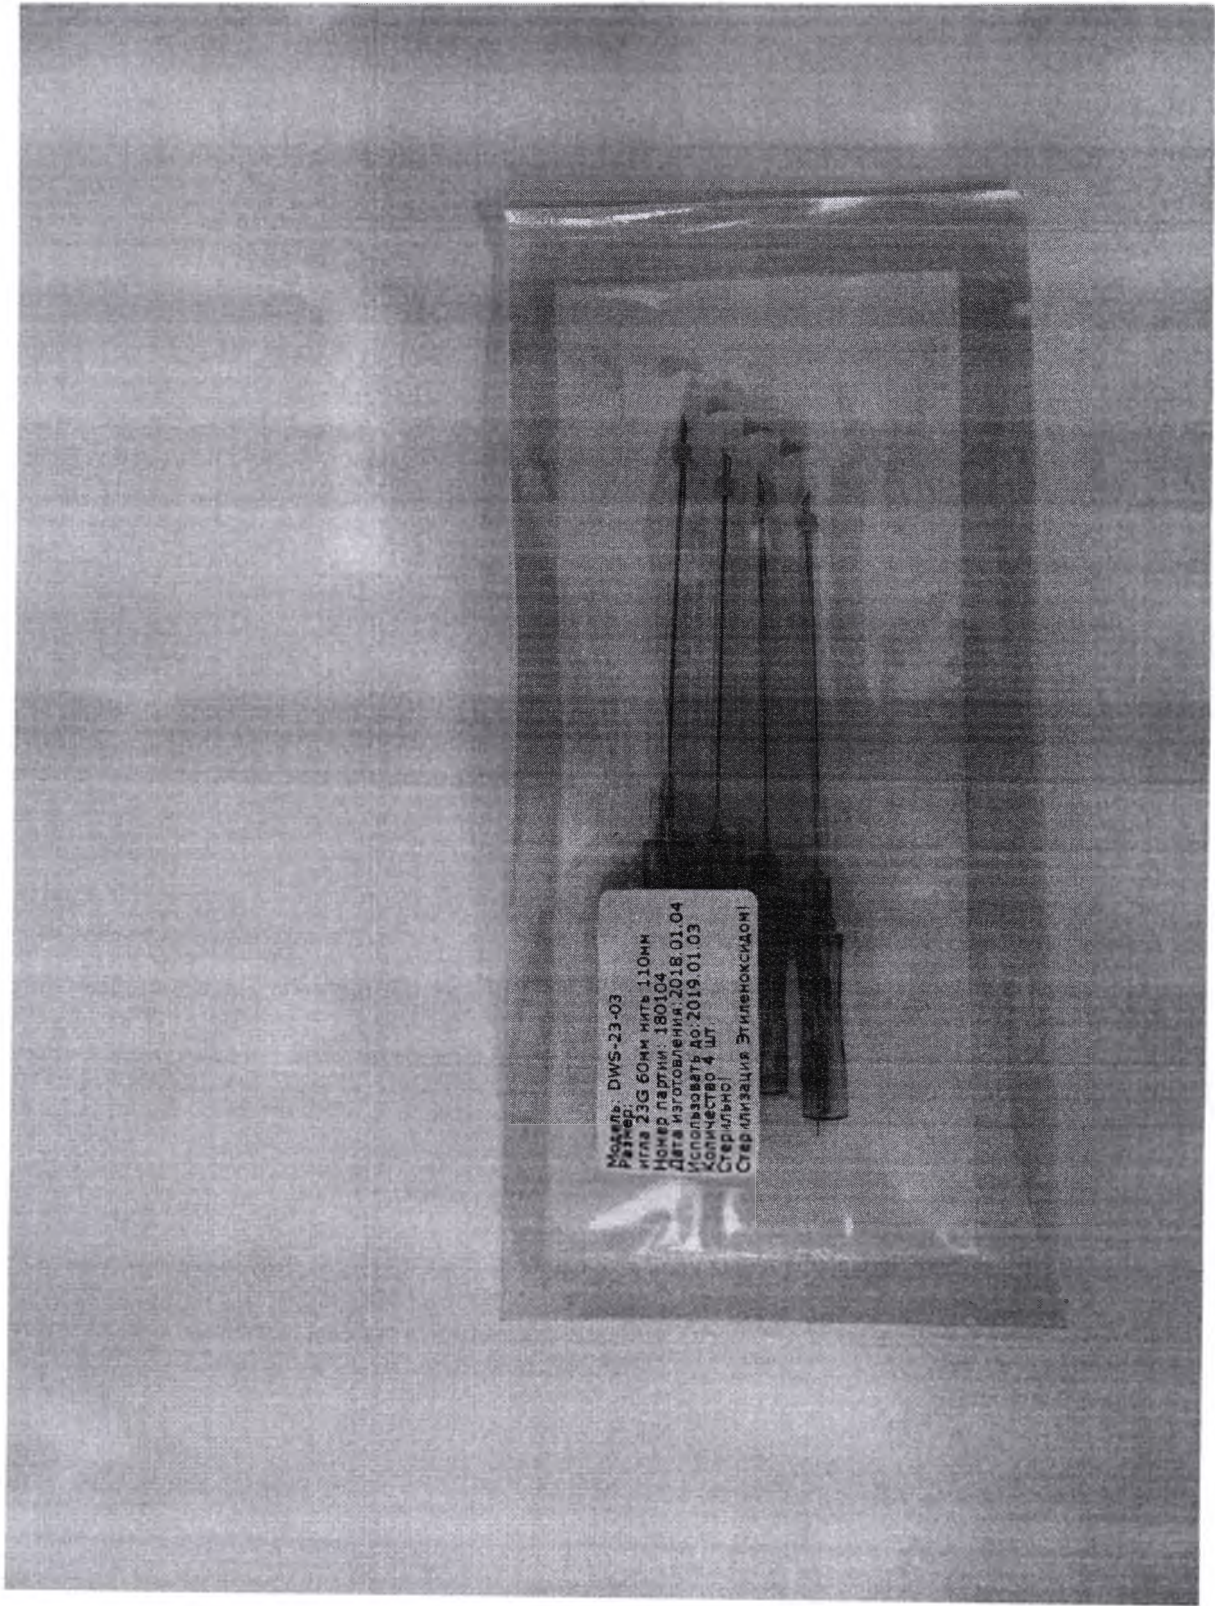


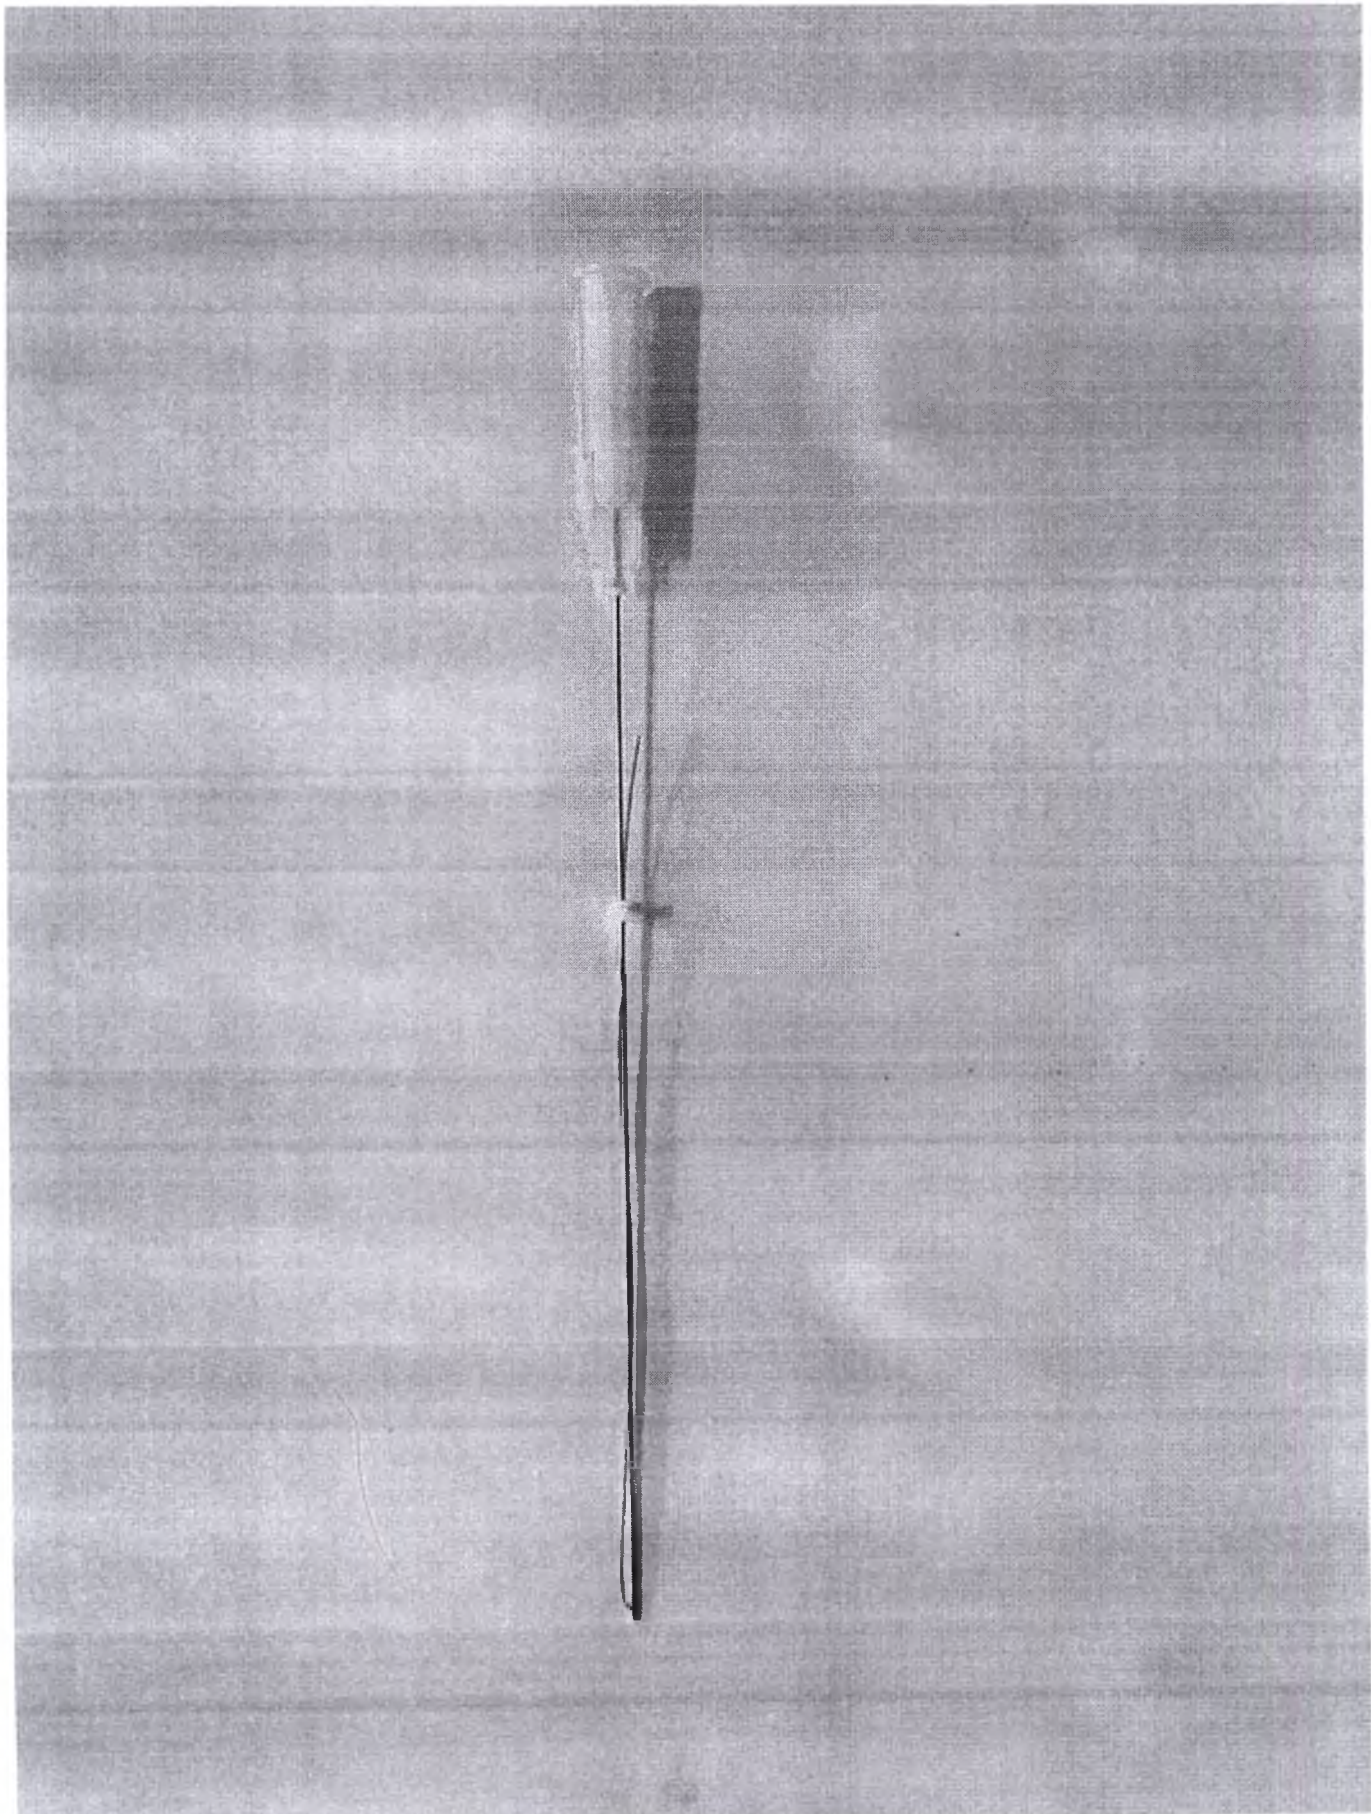

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Зубчатая нить с тупой иглой – А тип (20 моделей)

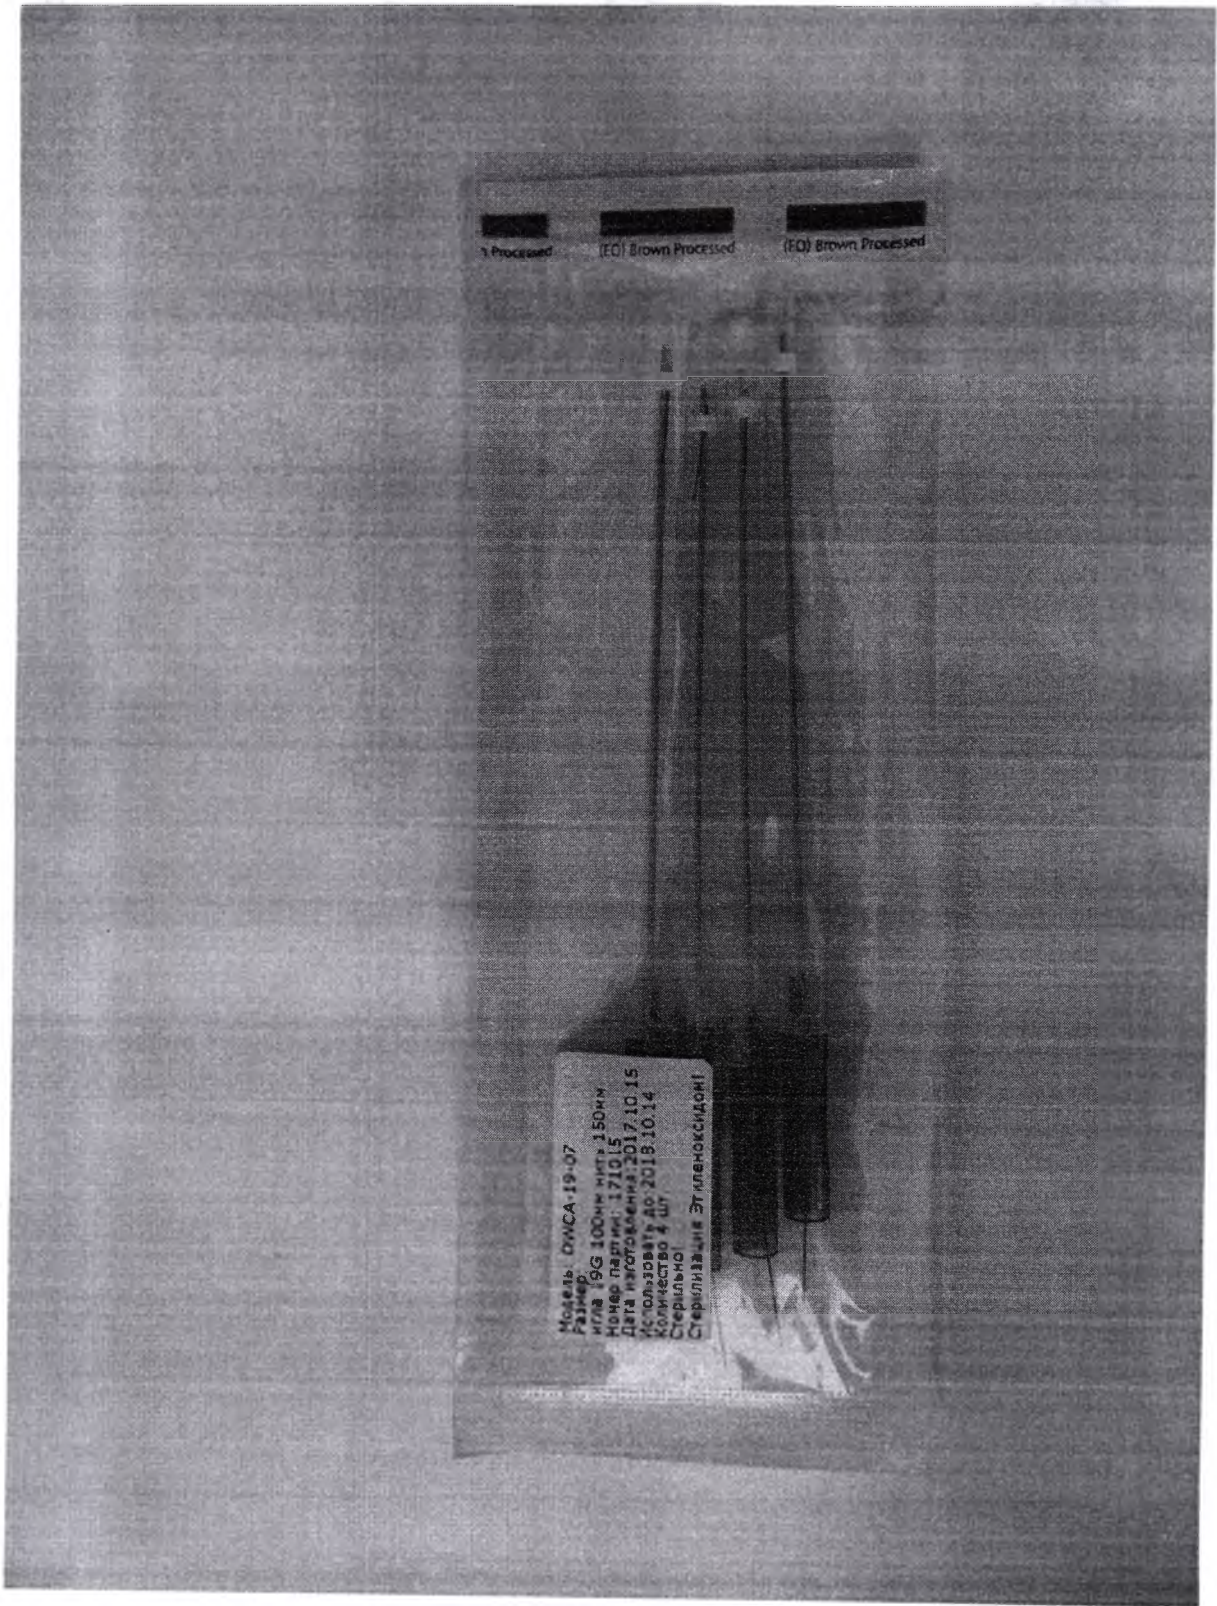


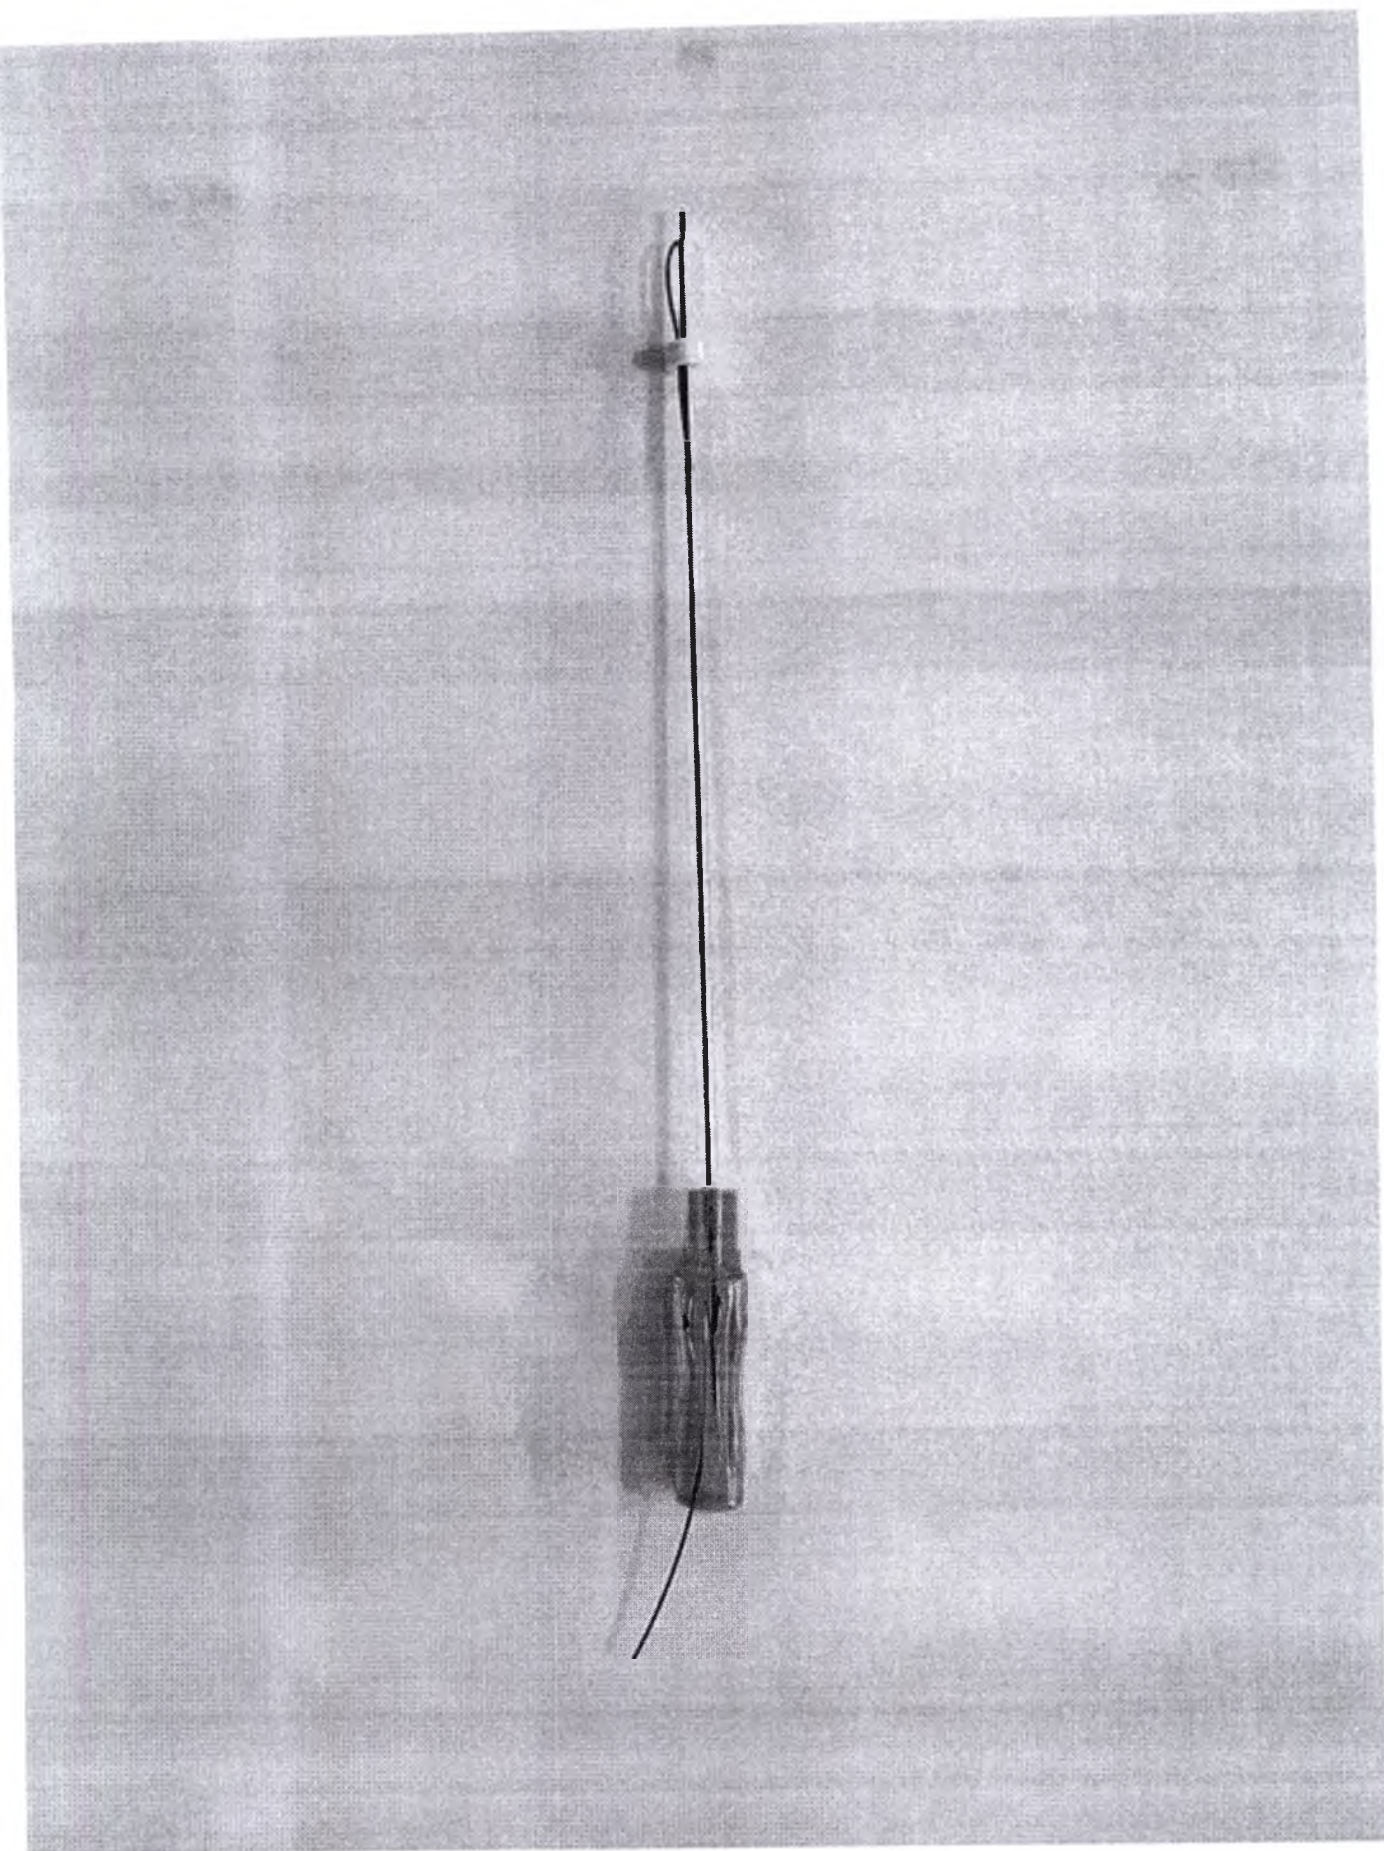

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Зубчатая нить с тупой иглой – В тип (17 моделей)

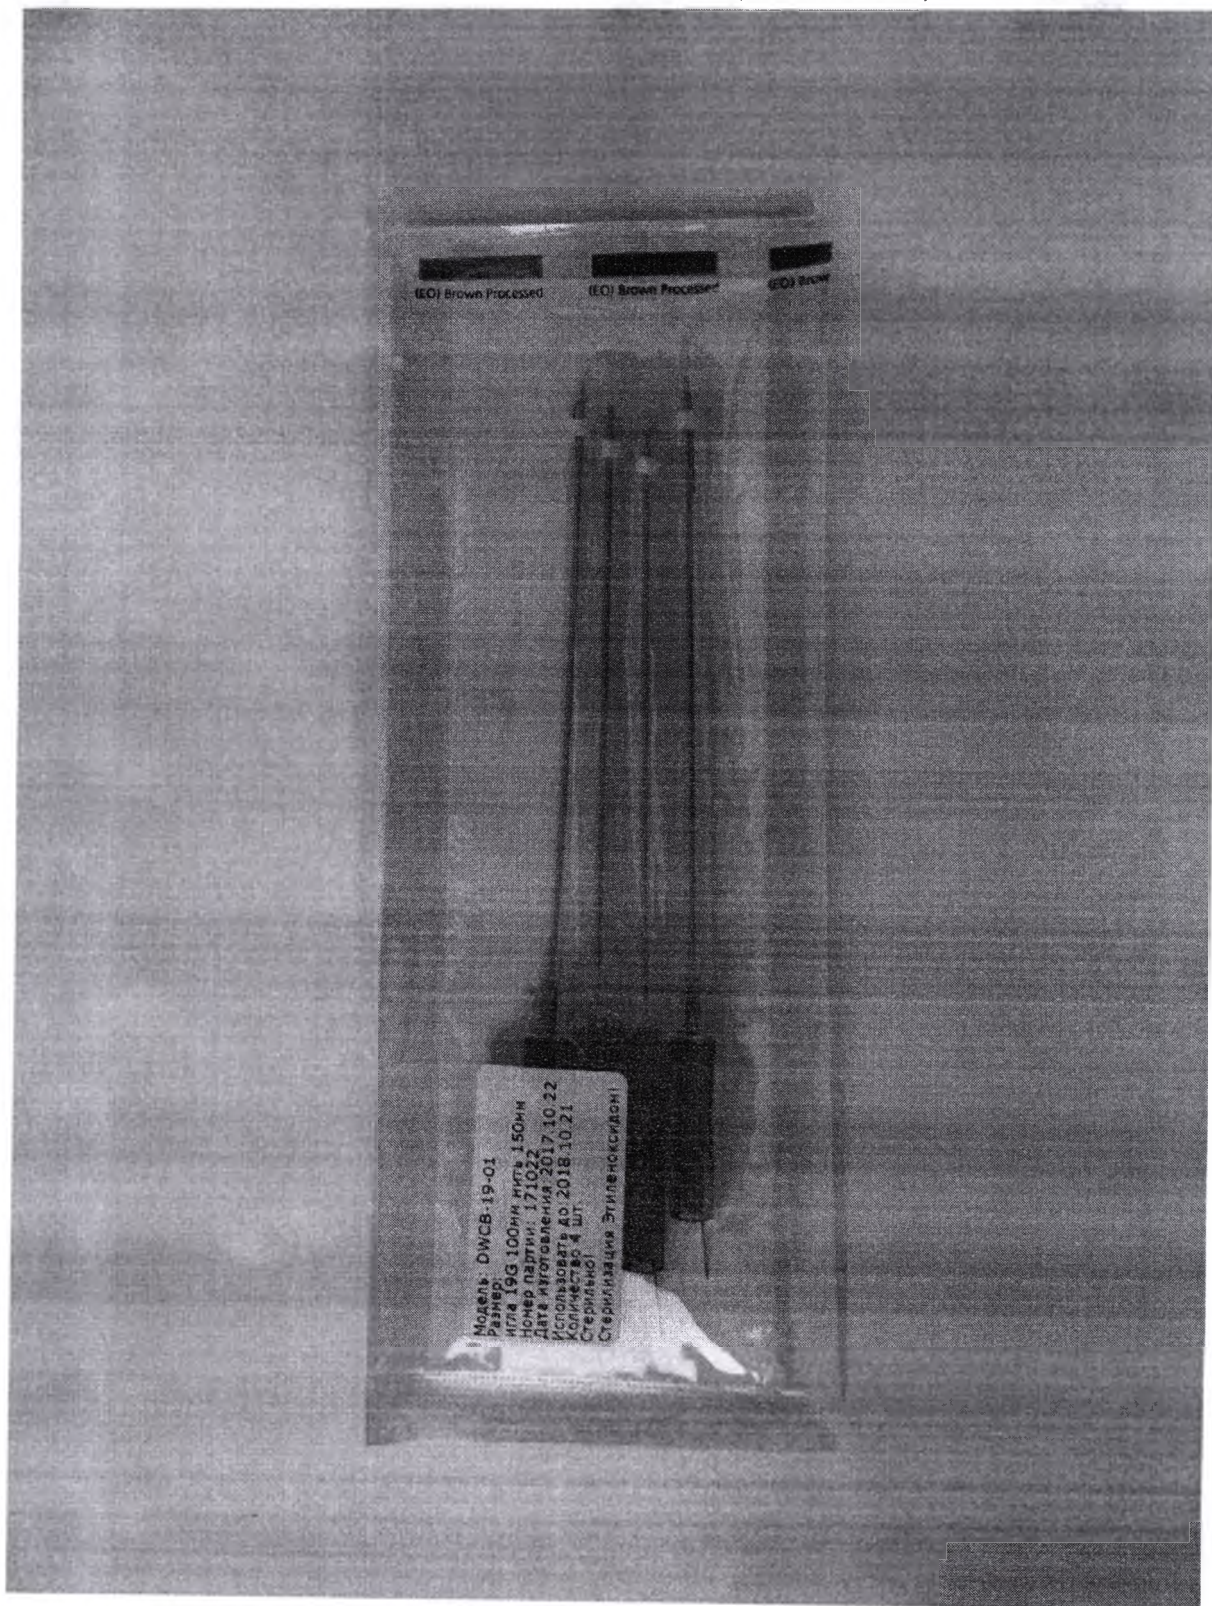


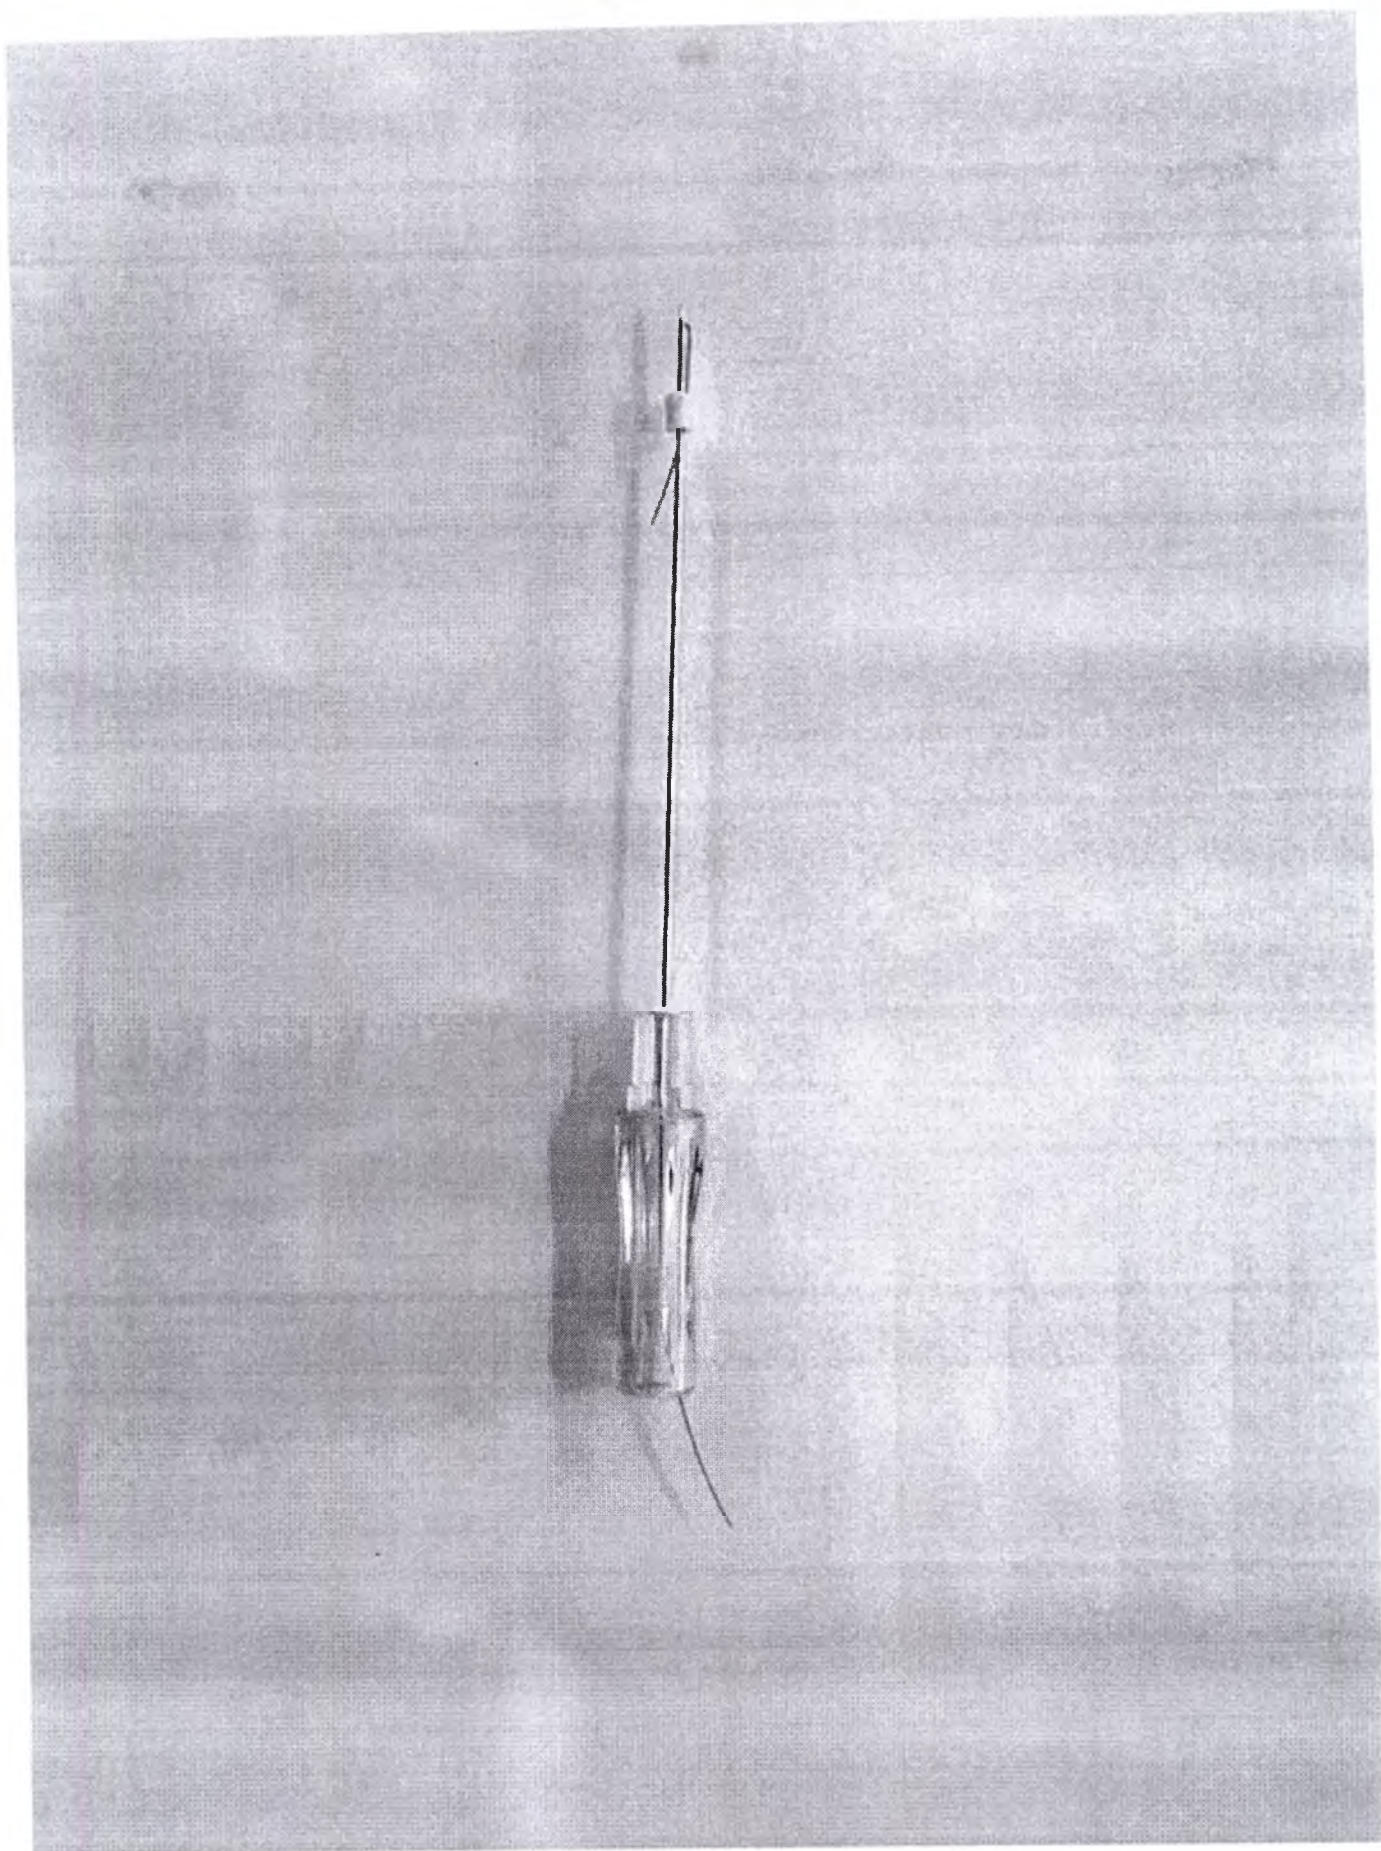

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Зубчатая нить с тупой иглой – FA тип (17 моделей)

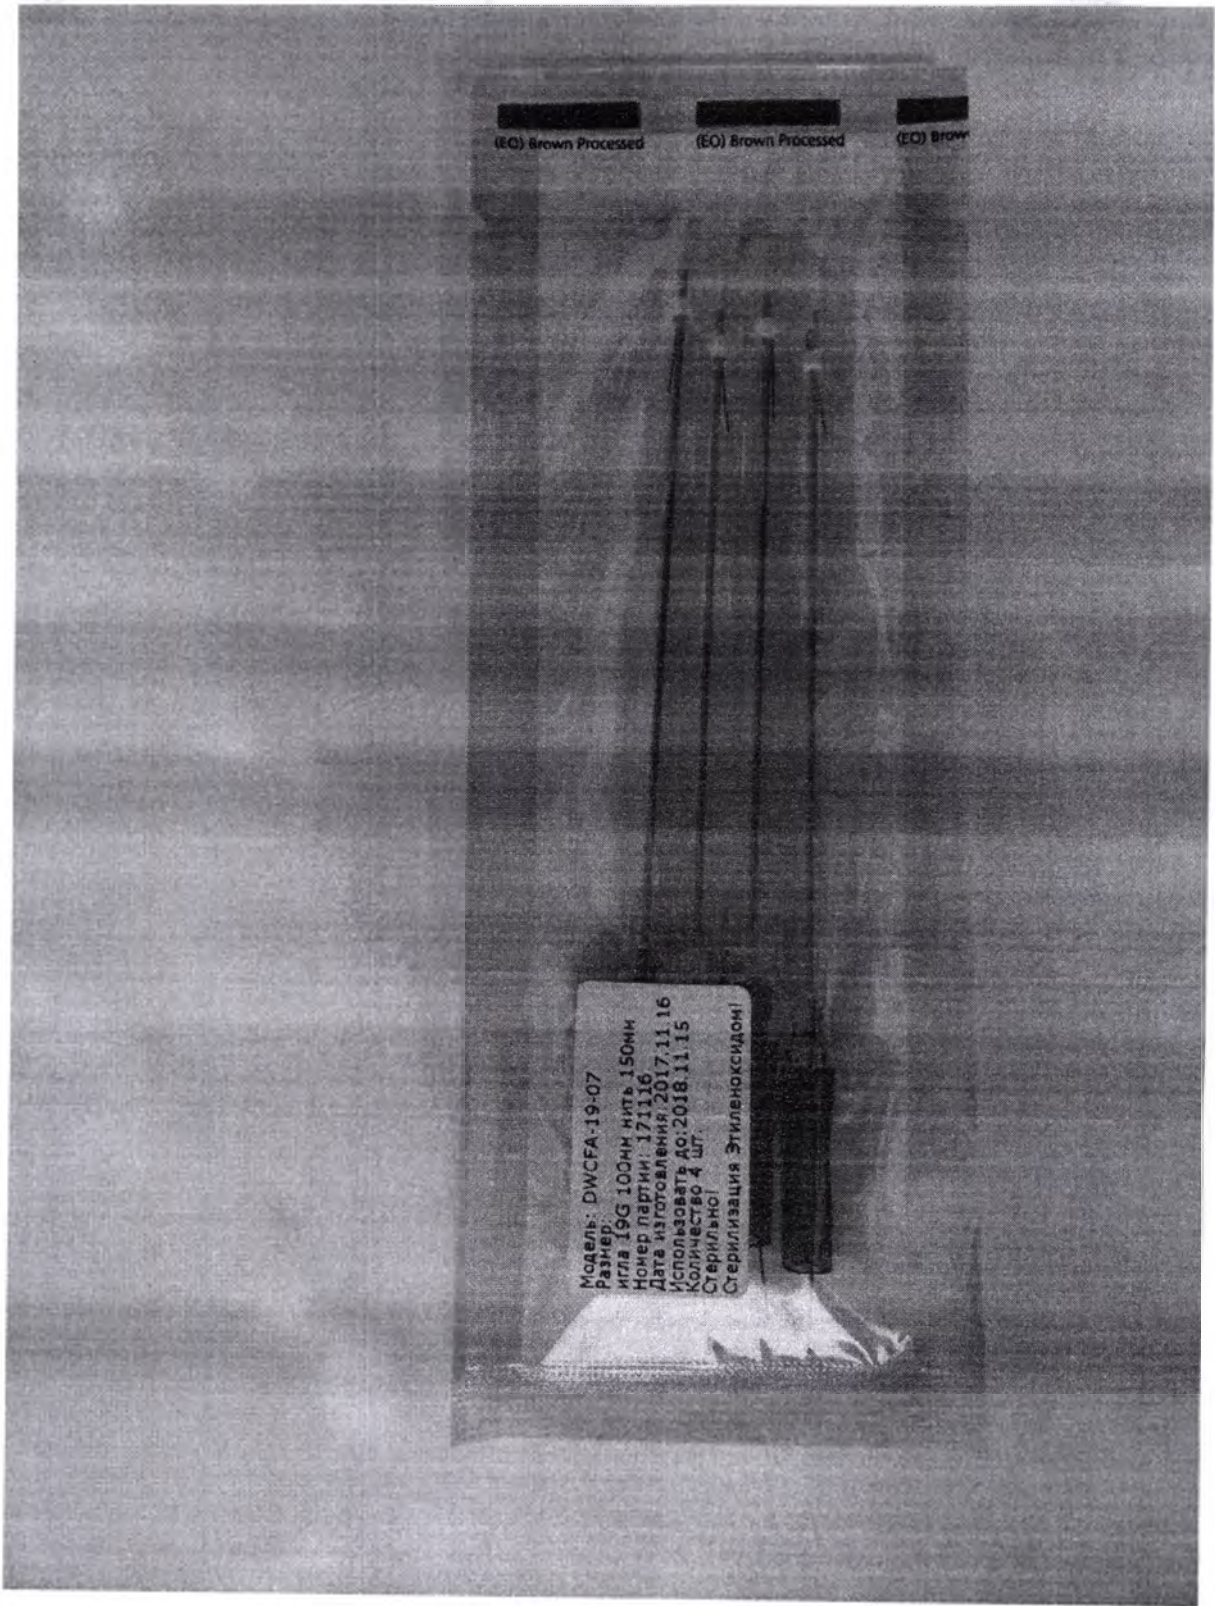


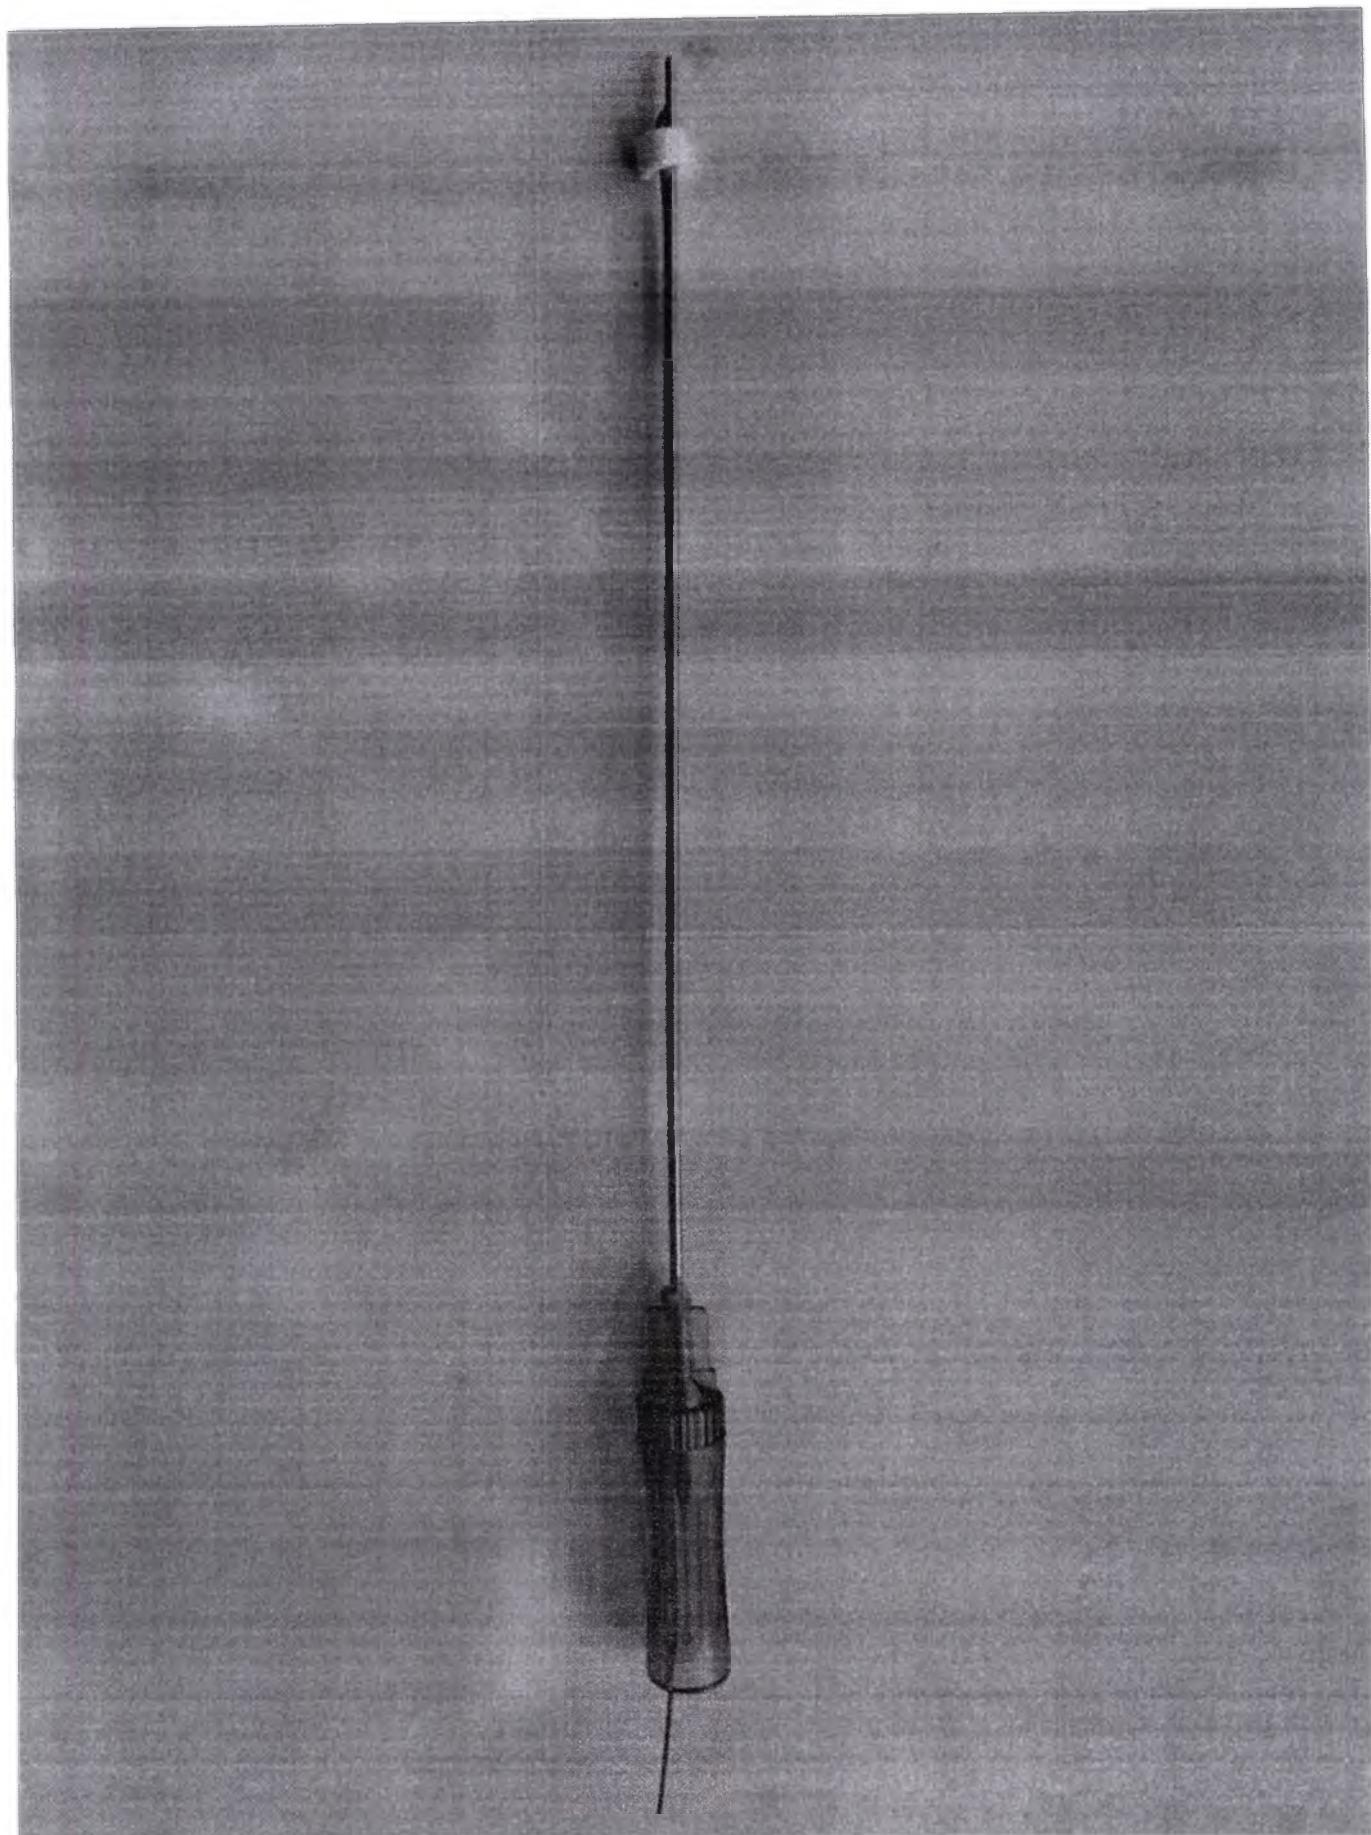

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Зубчатая нить с тупой иглой – FB тип (17 моделей)

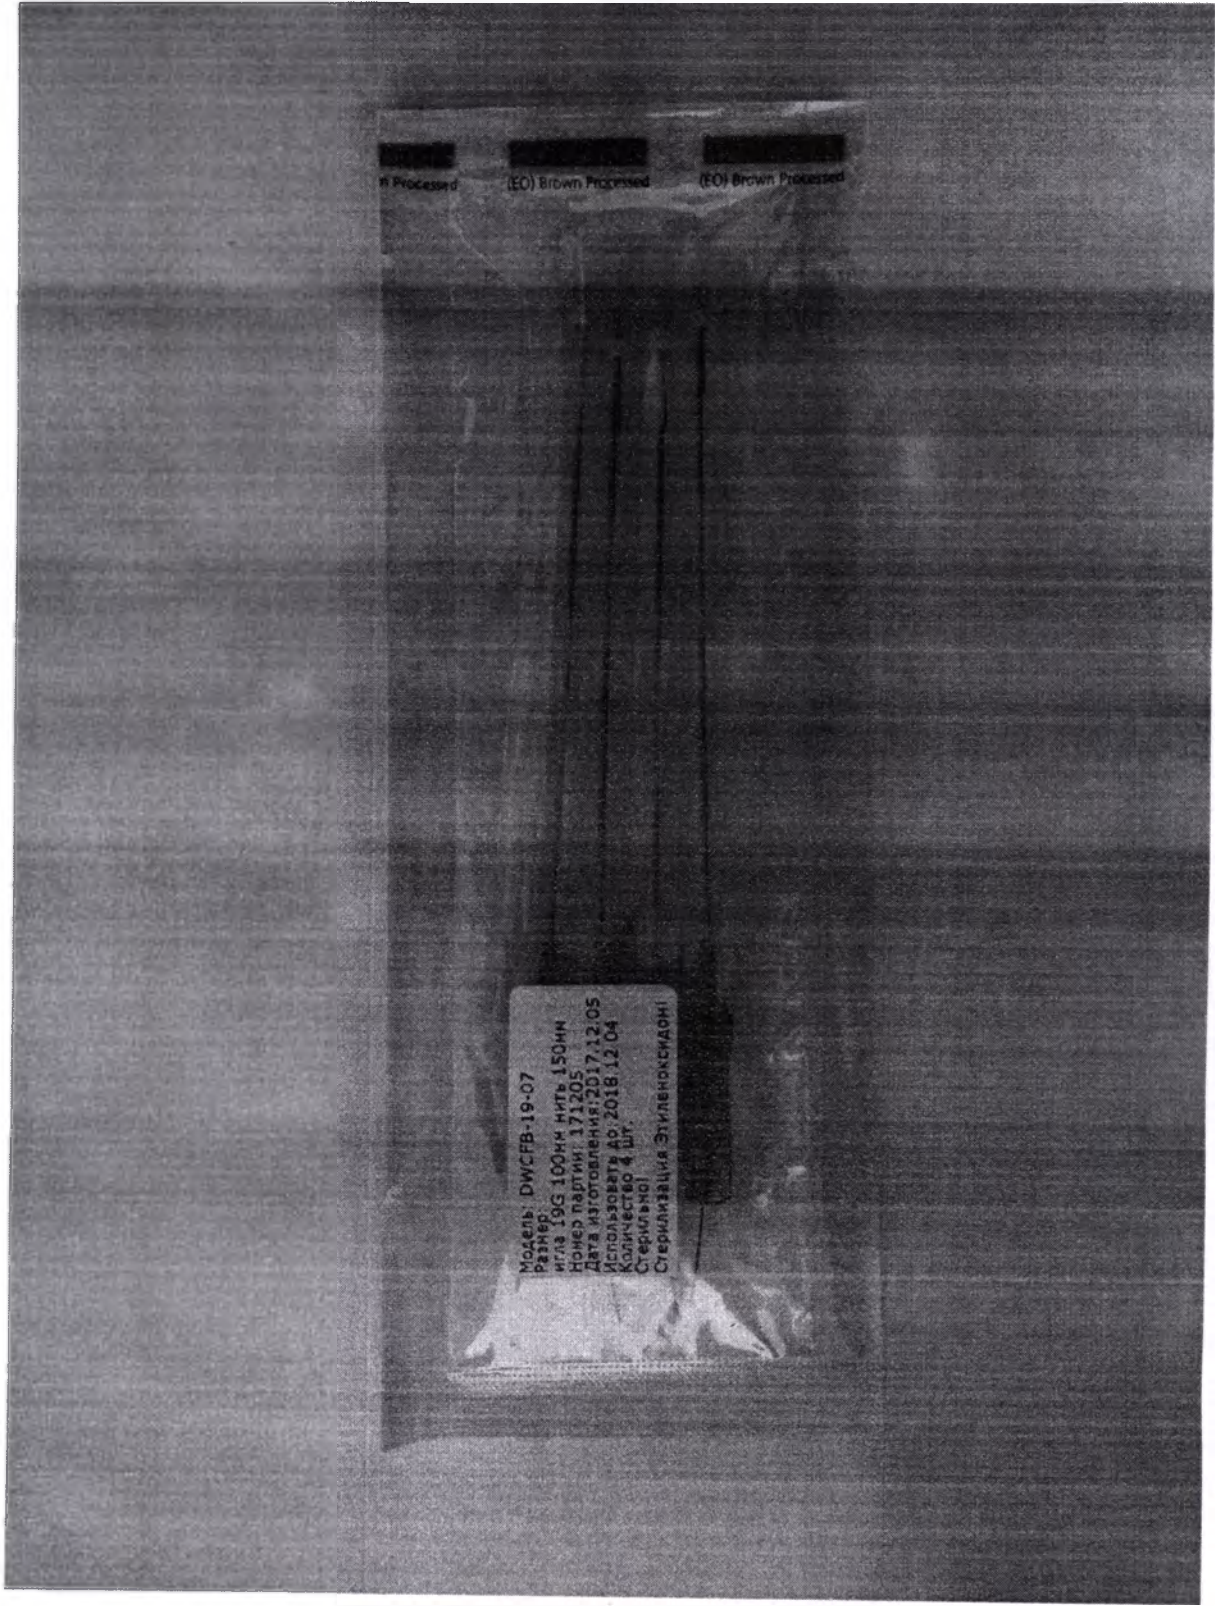


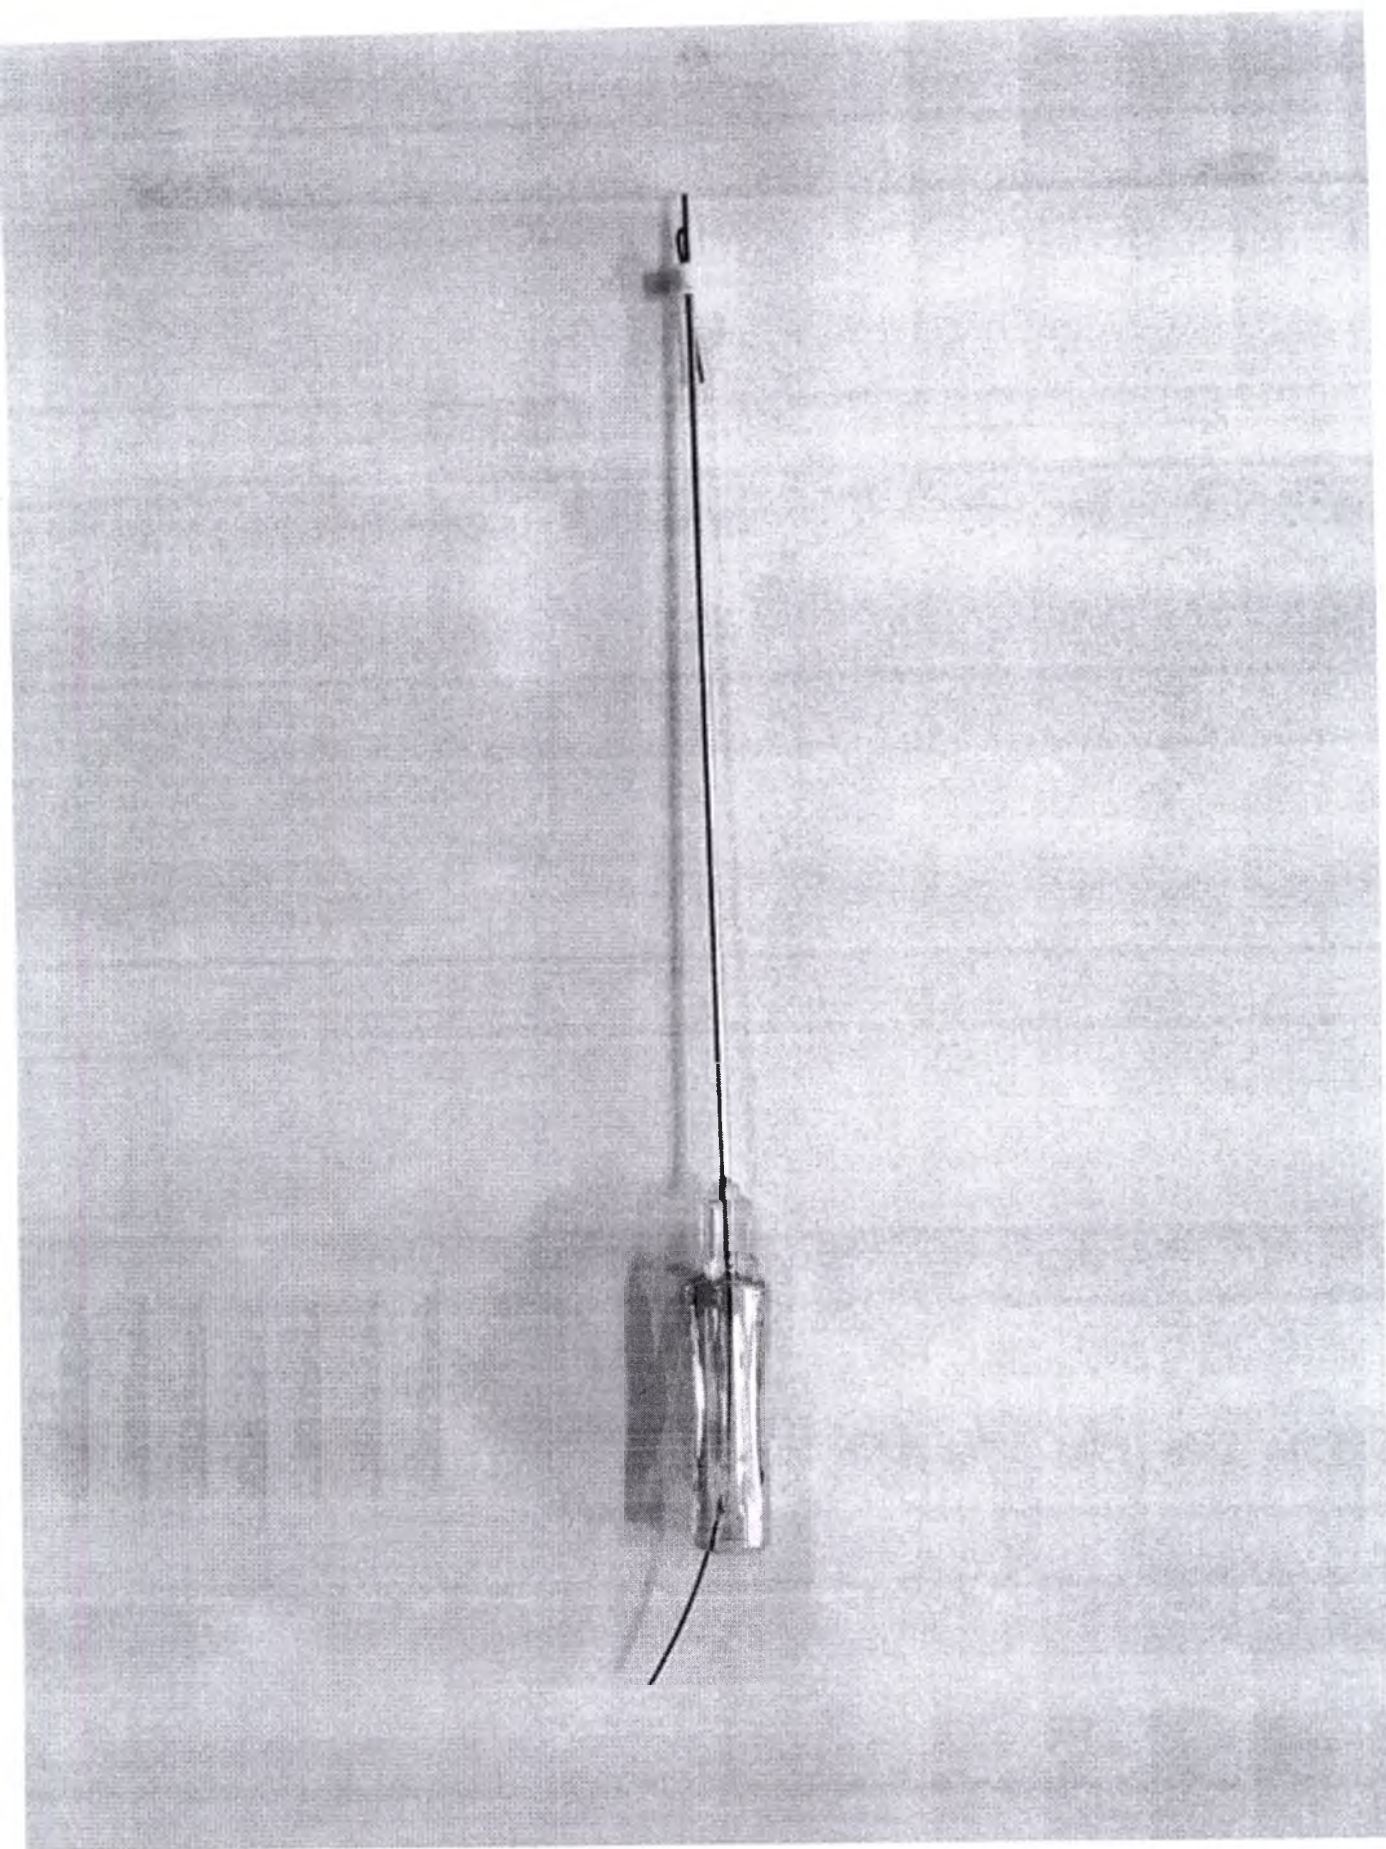

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:


Зубчатая нить с тупой иглой – S тип (16 моделей)

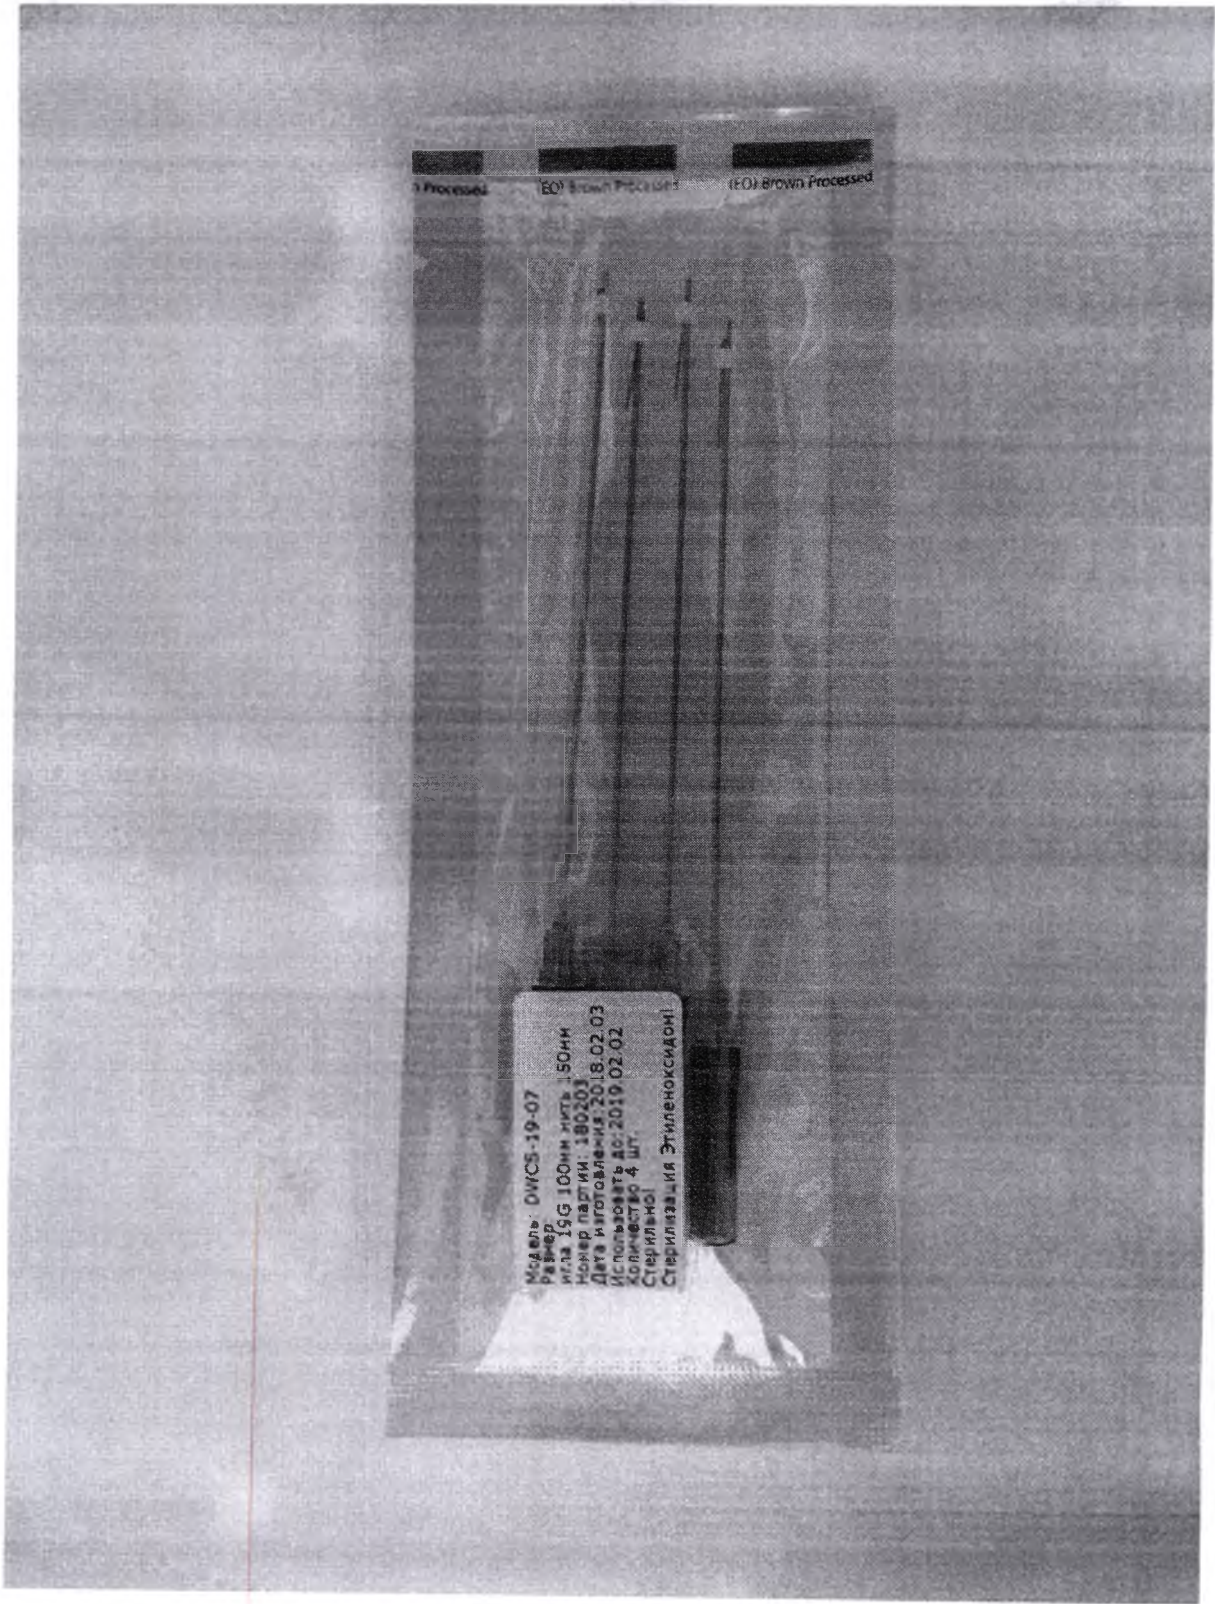


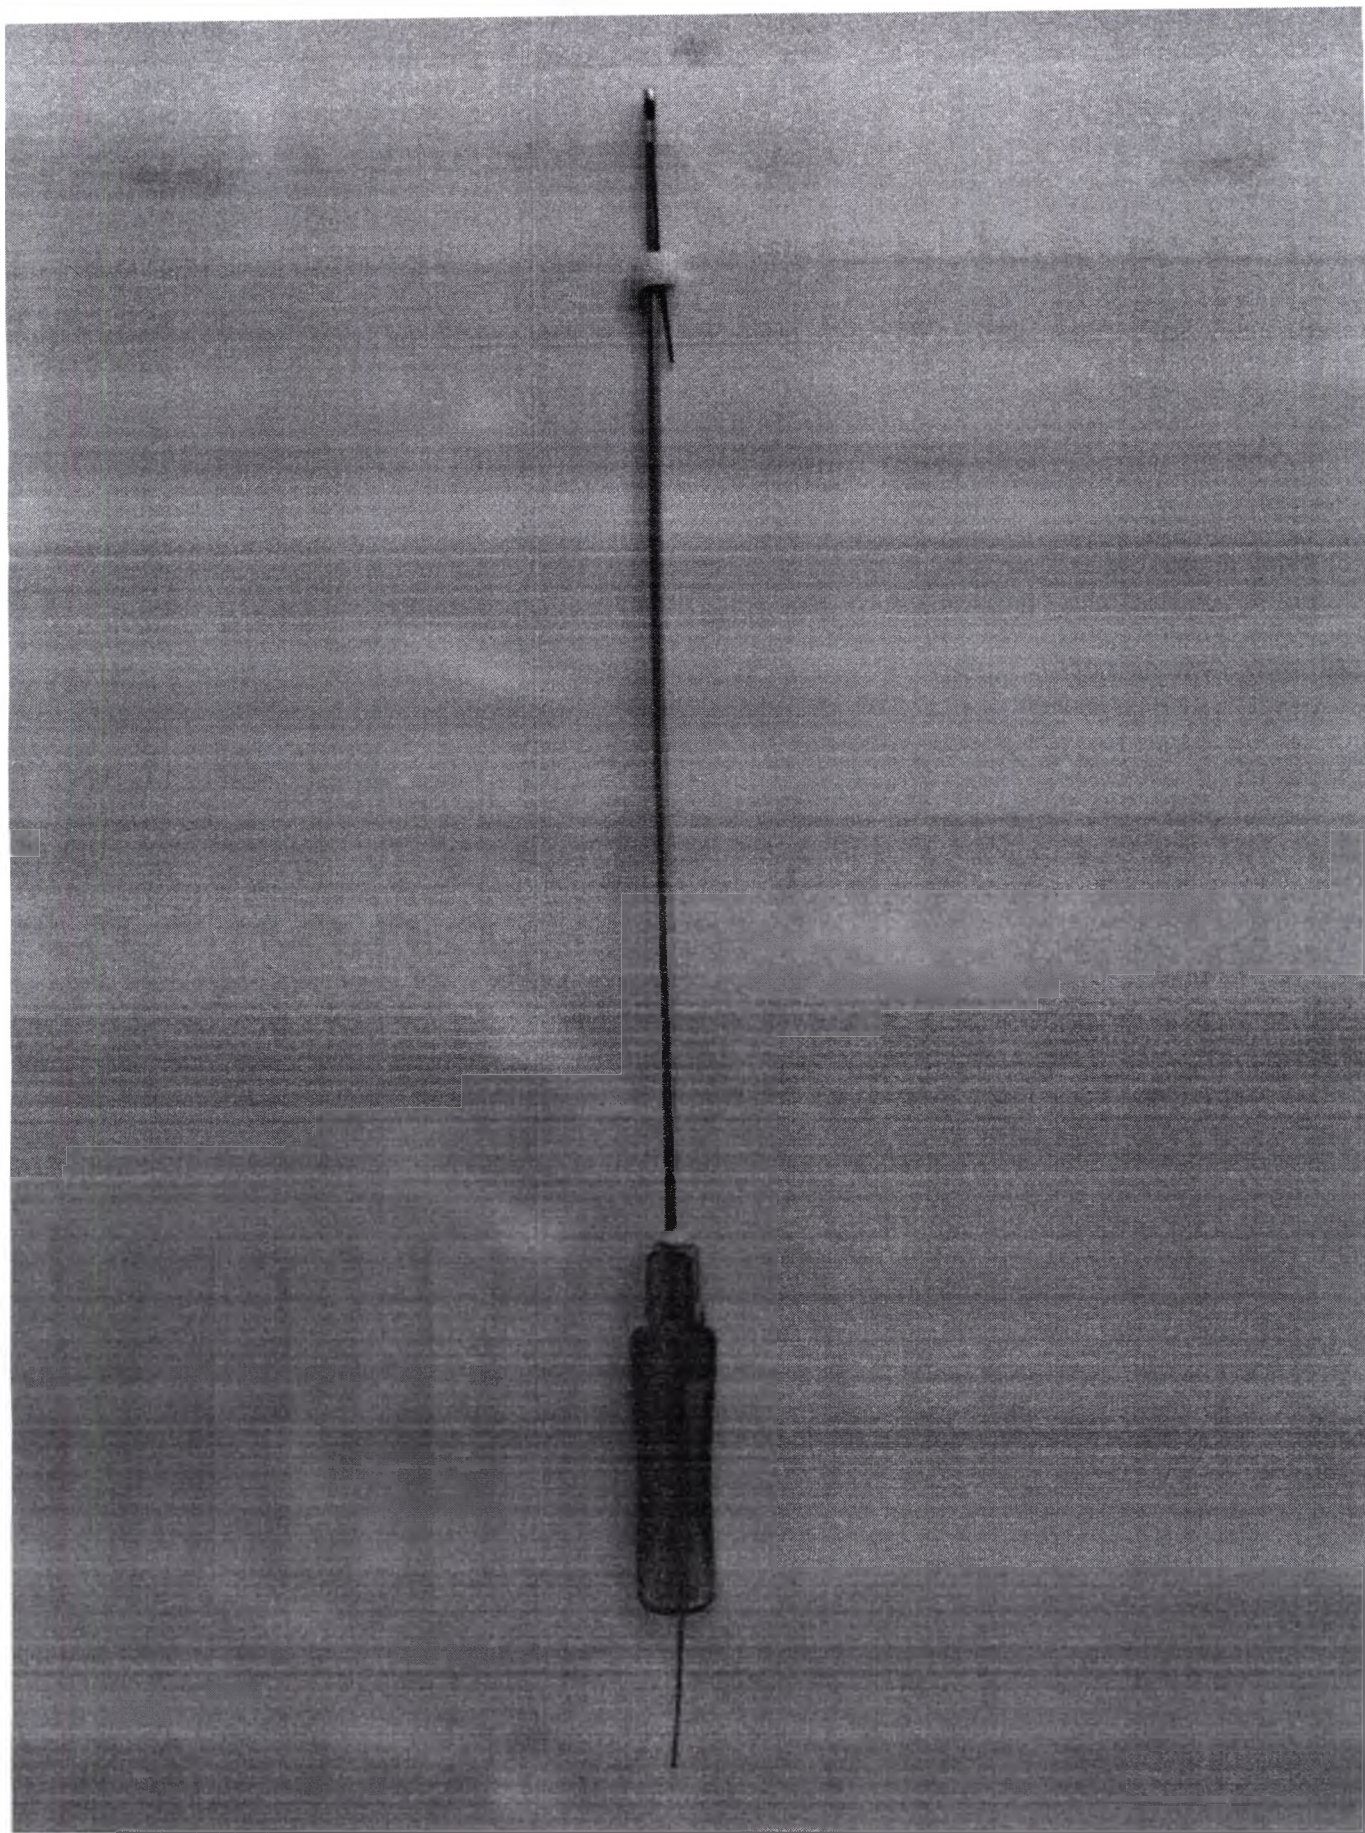

Нить рассасывающаяся Biosun, стерильная из полидиоксанона (ПДО) на игле-носителе,
варианты исполнения:

Зубчатая нить с тупой иглой – VL тип (15 моделей)

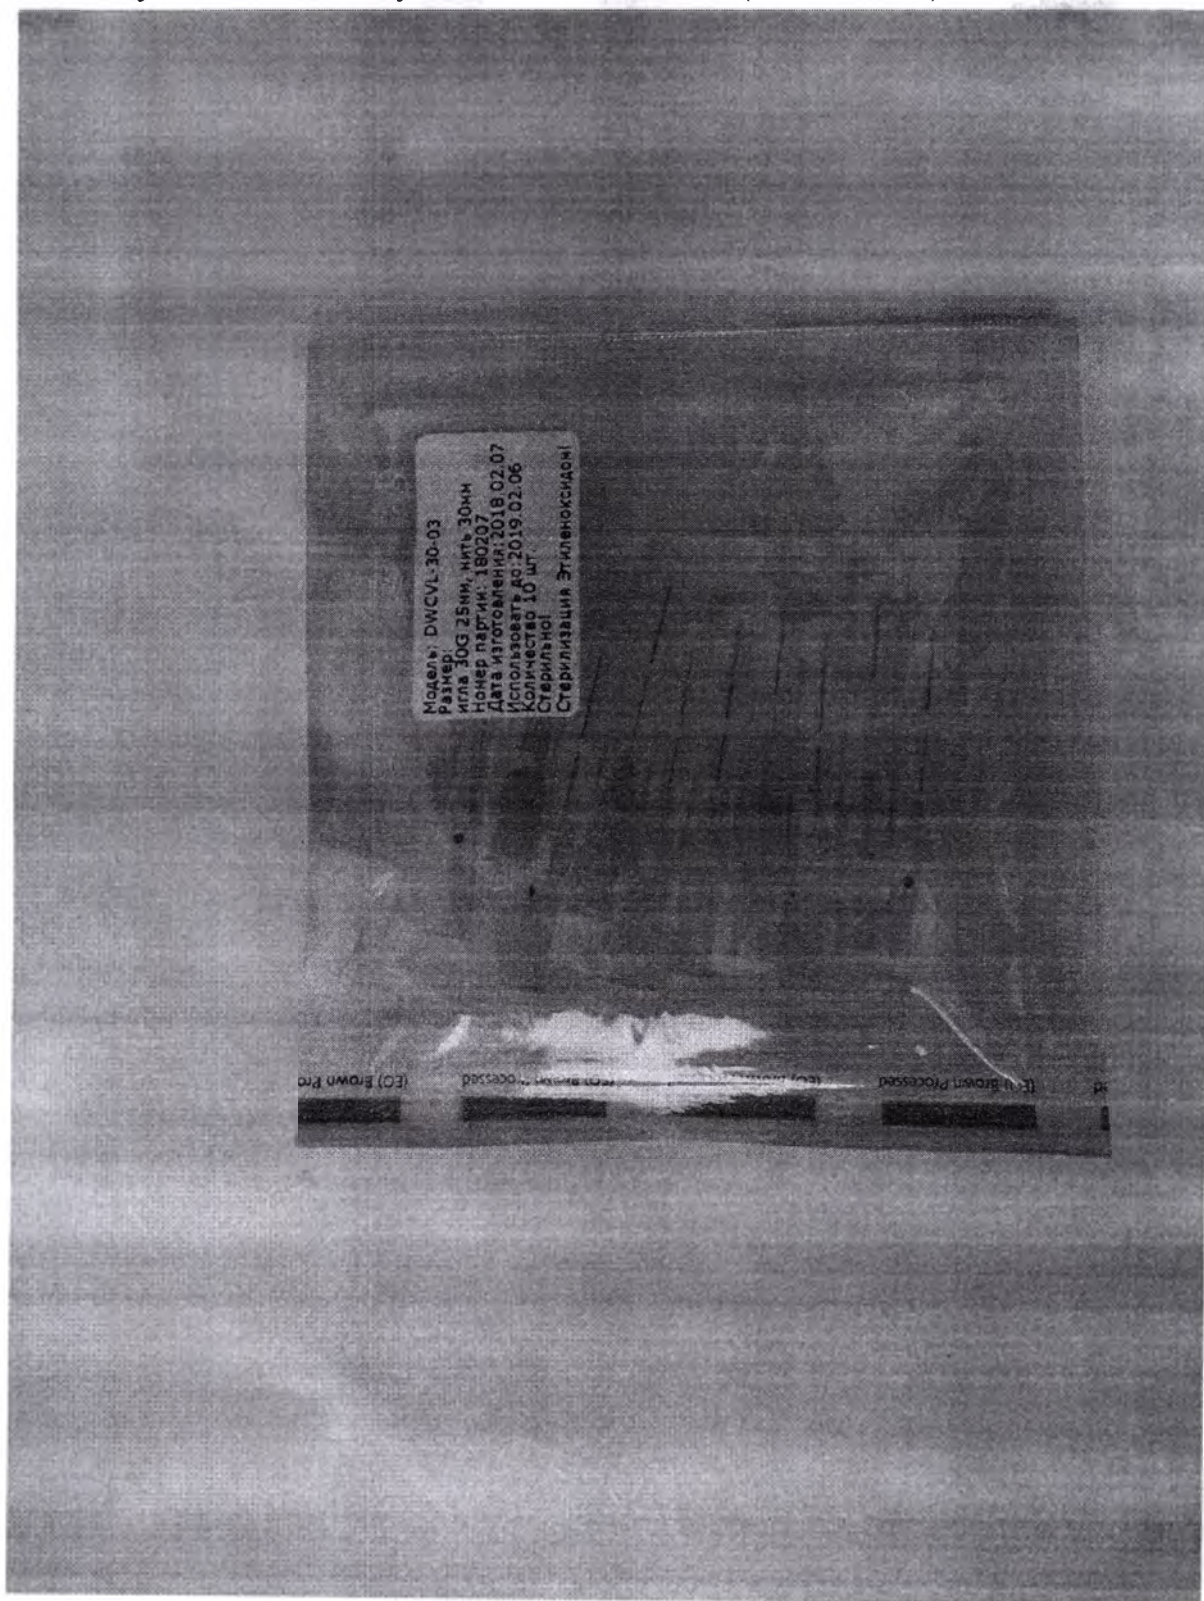

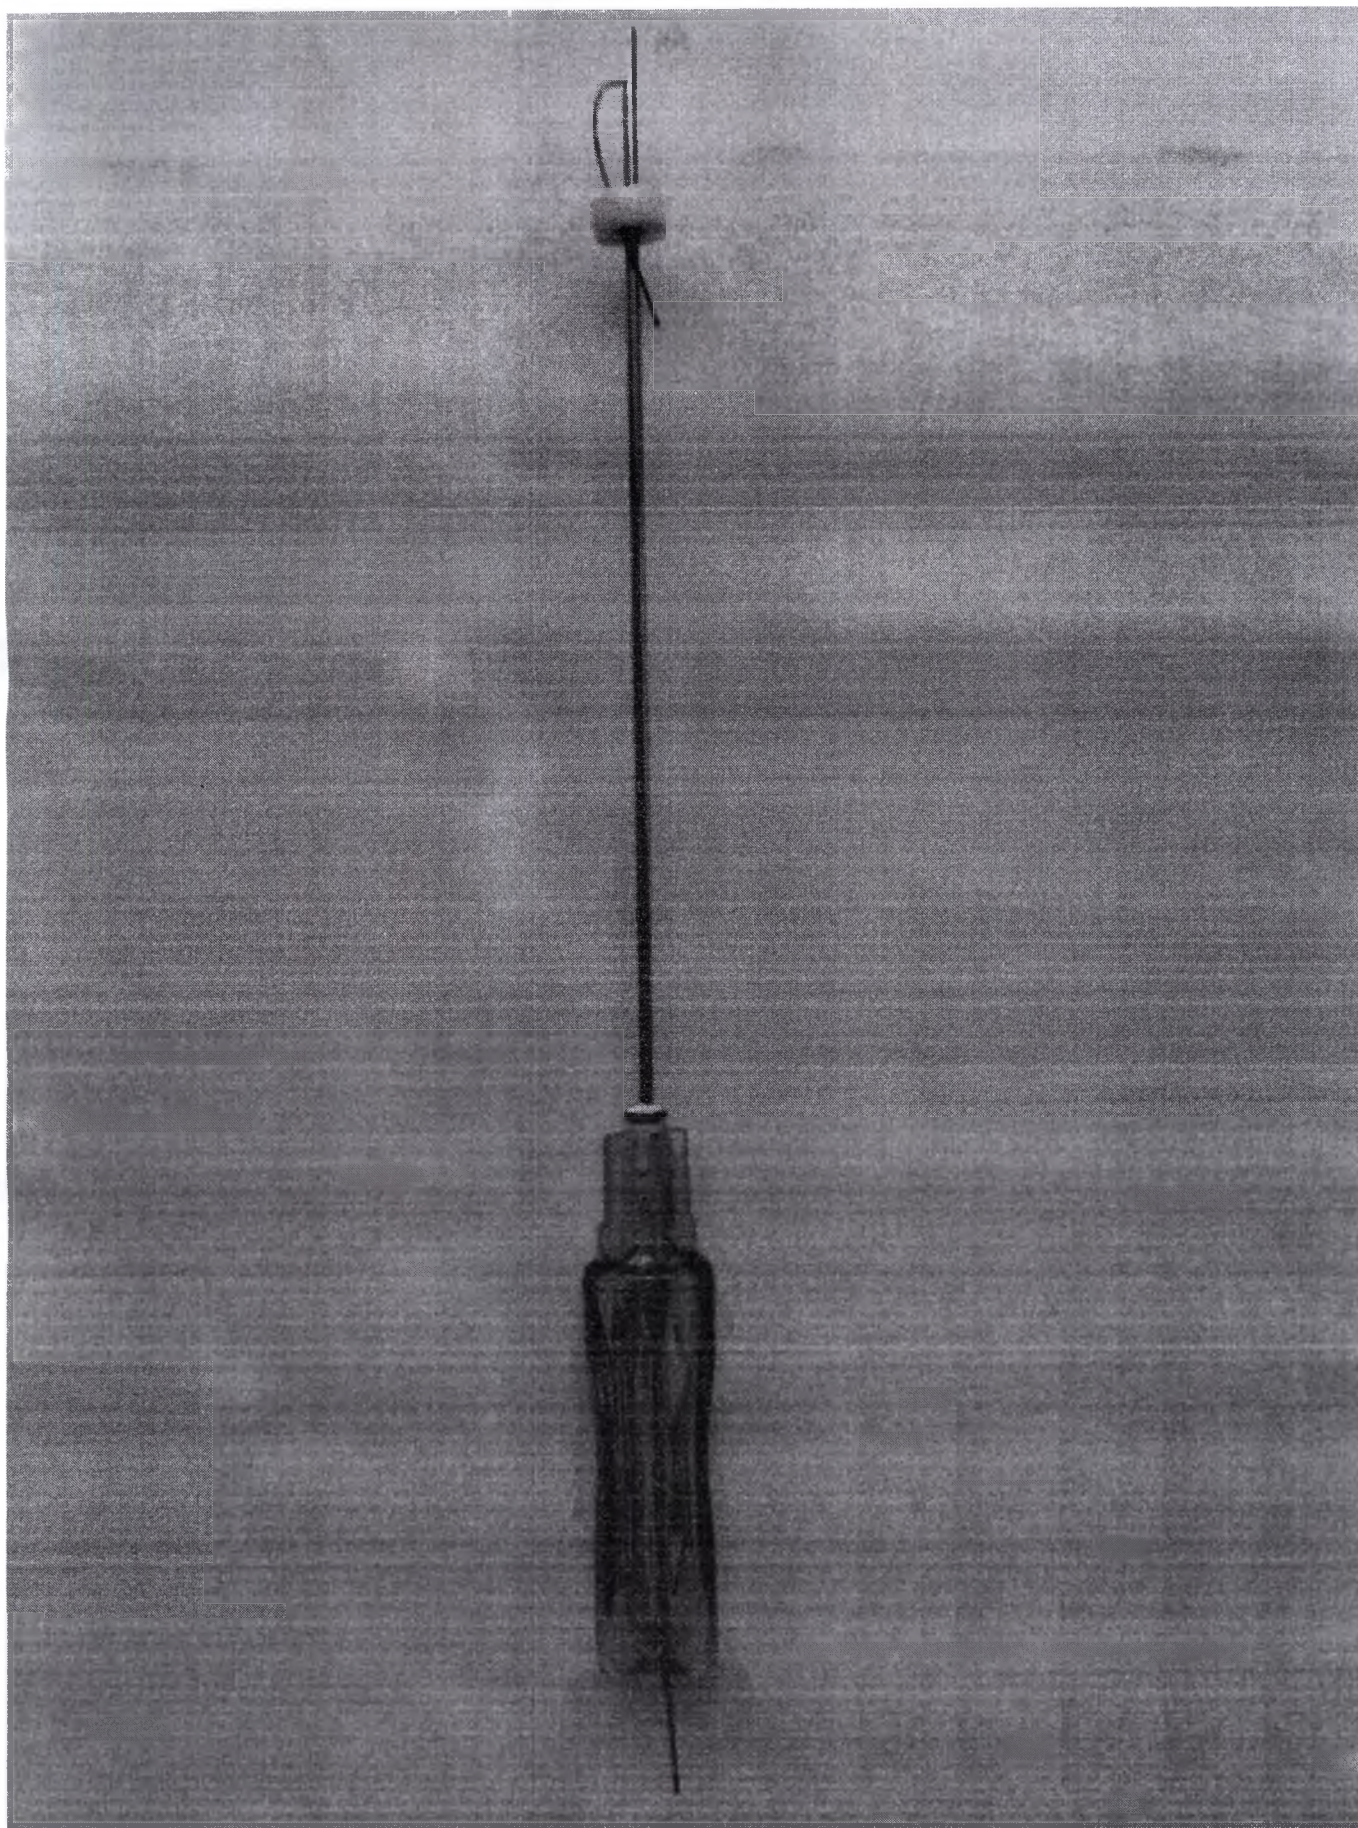

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

51 (на 51 листе) листа(ов)

Должность Генеральный директор

Подпись [подпись] / Клюйков Д.Б.

« » 20 г.

