


Внешний вид (лицевая сторона)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»
Копия верна
Виталфарм
И.В. Андреев В.В.
04.18
ЗАО «Виталфарм»
Кировский р-н, г.п. Спасское



СУЭК

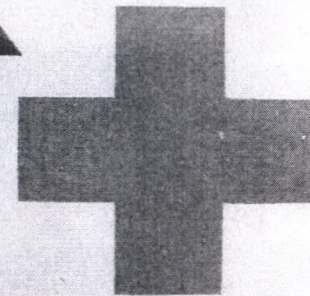

индивидуальная

АПТЕЧКА

шахтера

Аптечка индивидуальная шахтера

Перечень вложений

1. Бинт марлевый медицинский стерильный не менее 5 м x 7 см	1 шт.
2. Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
3. Лейкопластырь рулонный не менее 1 см x 250 см	1 шт.
4. Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см	5 шт.
5. Напальчник	2 шт.
6. Средство дезинфицирующее перевязочное стерильное	2 шт.
7. Салфетка кровоостанавливающая №3	1 шт.
8. Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 16 см x 14 см не менее №5	1 шт.
9. Инструкция по применению	1 шт.

ТУ 21.20.24-051-85535470-2017 РУ №

Не подлежит обязательной сертификации.

Аптечка предназначена для оказания первой помощи при травмах, связанных с профессиональной деятельностью на предприятиях угледобывающей промышленности, при работах под землей. Пополняется по мере расходования или истечения срока годности комплектующих.

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до -25°C.

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/Уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм», Россия, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru


Срок годности: 12 месяцев.

Гарантийный срок службы футляра: 12 месяцев.

Дата изготовления/номер партии: март 2018 г./01


2018-3-27 14:28


В раскрытом виде

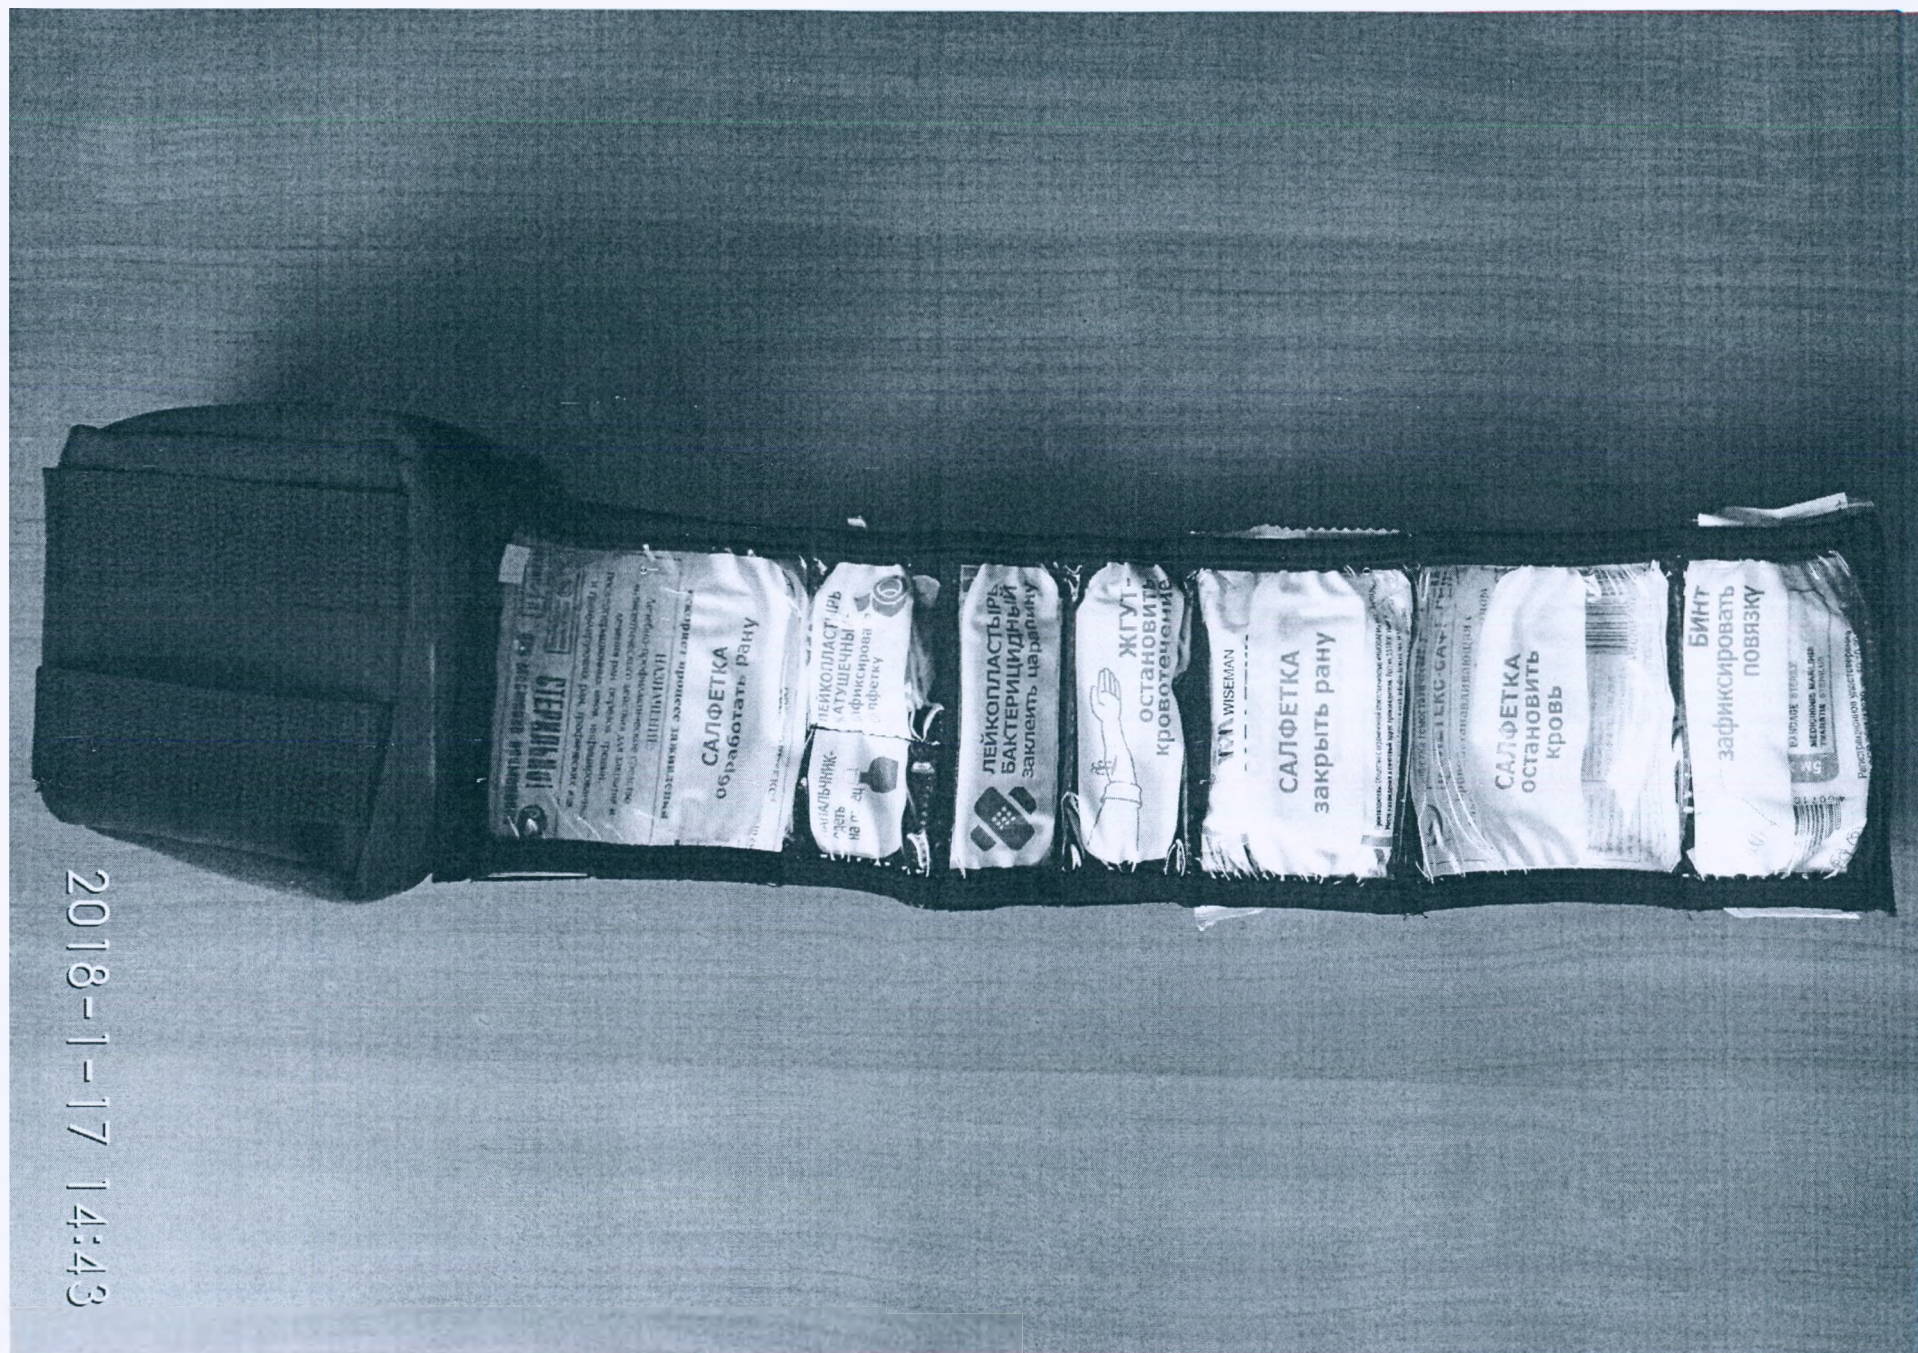

2018-1-17 14:43



Бинт марлевый медицинский стерильный не менее 5 м x 7 см

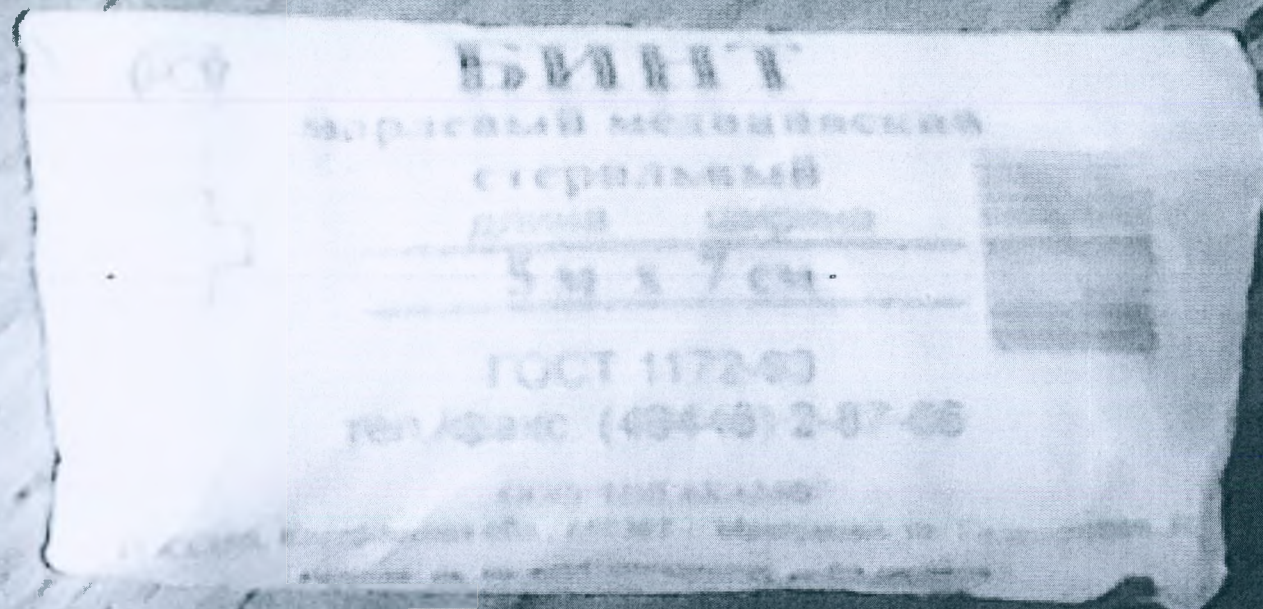

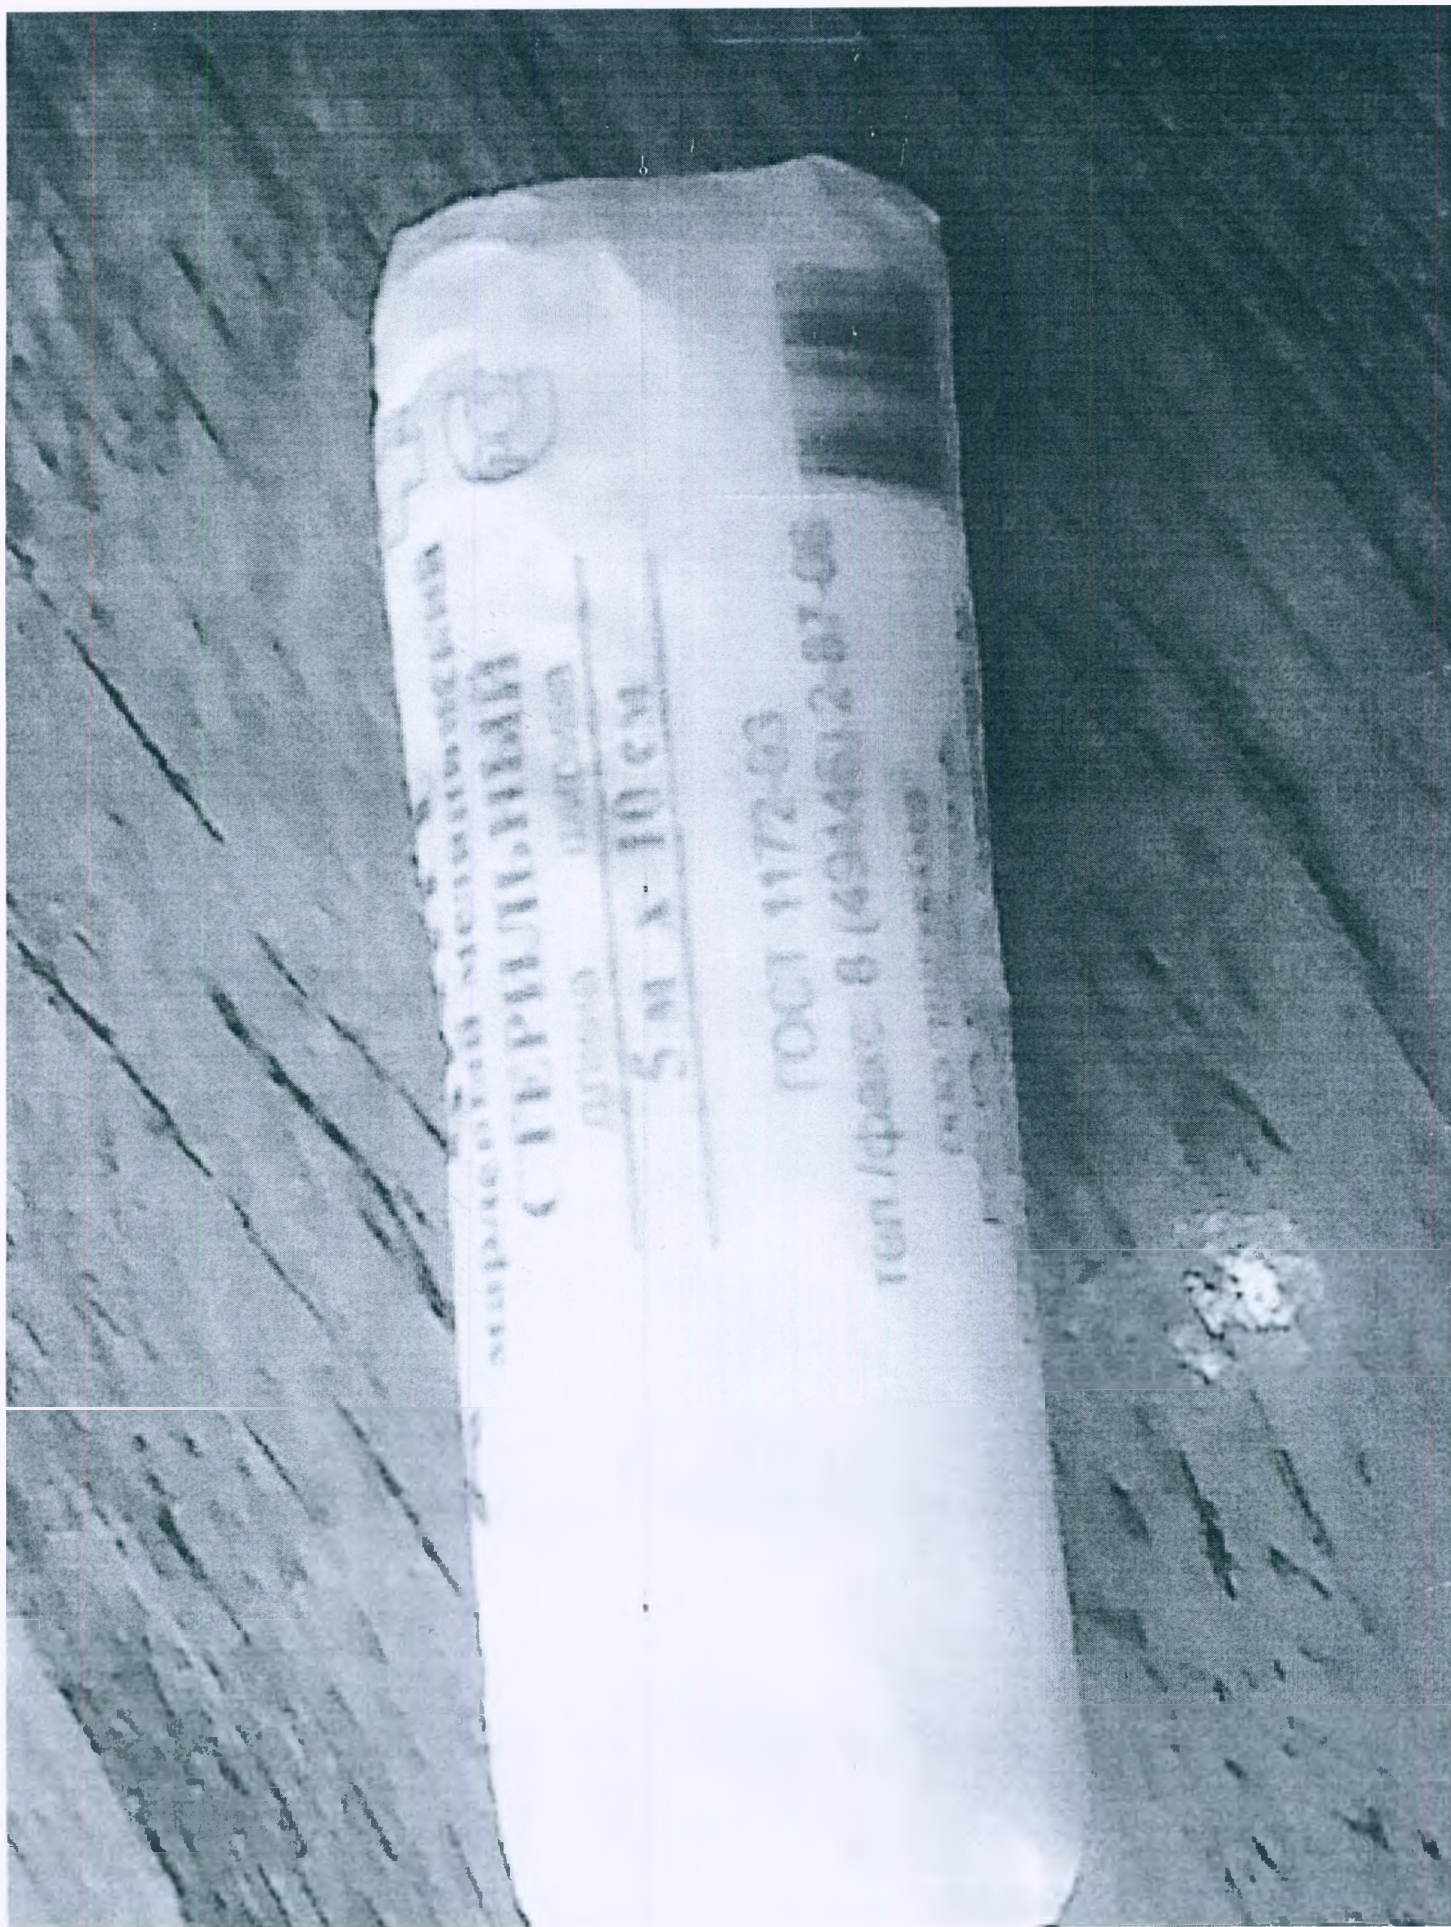

1. General Policy
 2. General Policy
 3. General Policy
 4. General Policy
 5. General Policy
 6. General Policy
 7. General Policy
 8. General Policy
 9. General Policy
 10. General Policy
 11. General Policy
 12. General Policy
 13. General Policy
 14. General Policy
 15. General Policy
 16. General Policy
 17. General Policy
 18. General Policy
 19. General Policy
 20. General Policy
 21. General Policy
 22. General Policy
 23. General Policy
 24. General Policy
 25. General Policy
 26. General Policy
 27. General Policy
 28. General Policy
 29. General Policy
 30. General Policy
 31. General Policy
 32. General Policy
 33. General Policy
 34. General Policy
 35. General Policy
 36. General Policy
 37. General Policy
 38. General Policy
 39. General Policy
 40. General Policy
 41. General Policy
 42. General Policy
 43. General Policy
 44. General Policy
 45. General Policy
 46. General Policy
 47. General Policy
 48. General Policy
 49. General Policy
 50. General Policy
 51. General Policy
 52. General Policy
 53. General Policy
 54. General Policy
 55. General Policy
 56. General Policy
 57. General Policy
 58. General Policy
 59. General Policy
 60. General Policy
 61. General Policy
 62. General Policy
 63. General Policy
 64. General Policy
 65. General Policy
 66. General Policy
 67. General Policy
 68. General Policy
 69. General Policy
 70. General Policy
 71. General Policy
 72. General Policy
 73. General Policy
 74. General Policy
 75. General Policy
 76. General Policy
 77. General Policy
 78. General Policy
 79. General Policy
 80. General Policy
 81. General Policy
 82. General Policy
 83. General Policy
 84. General Policy
 85. General Policy
 86. General Policy
 87. General Policy
 88. General Policy
 89. General Policy
 90. General Policy
 91. General Policy
 92. General Policy
 93. General Policy
 94. General Policy
 95. General Policy
 96. General Policy
 97. General Policy
 98. General Policy
 99. General Policy
 100. General Policy

Р. С. М. О. Р. 2010-00025

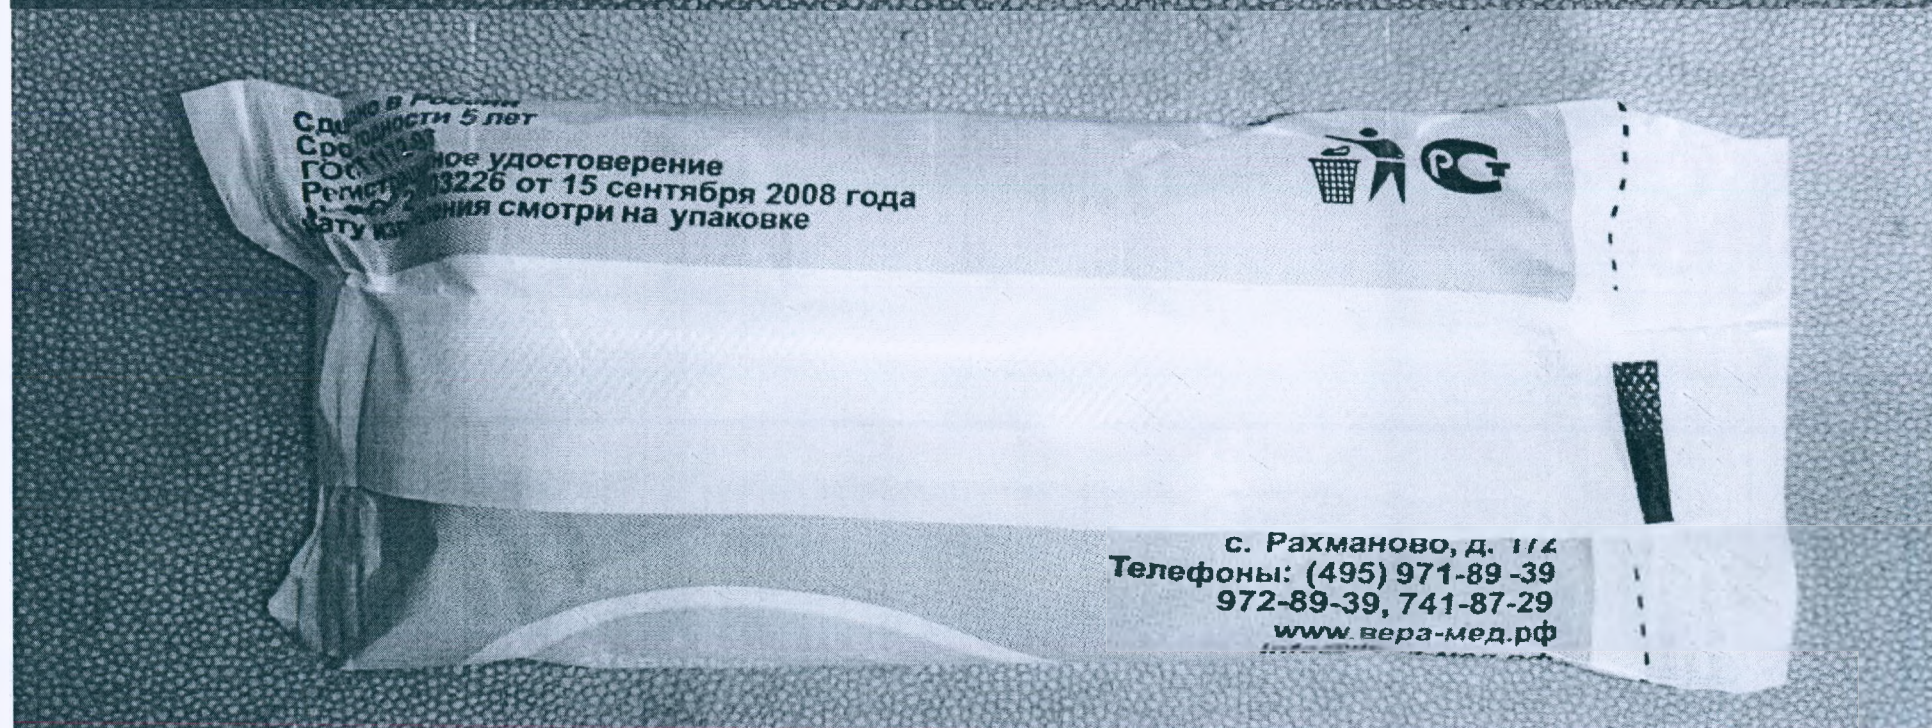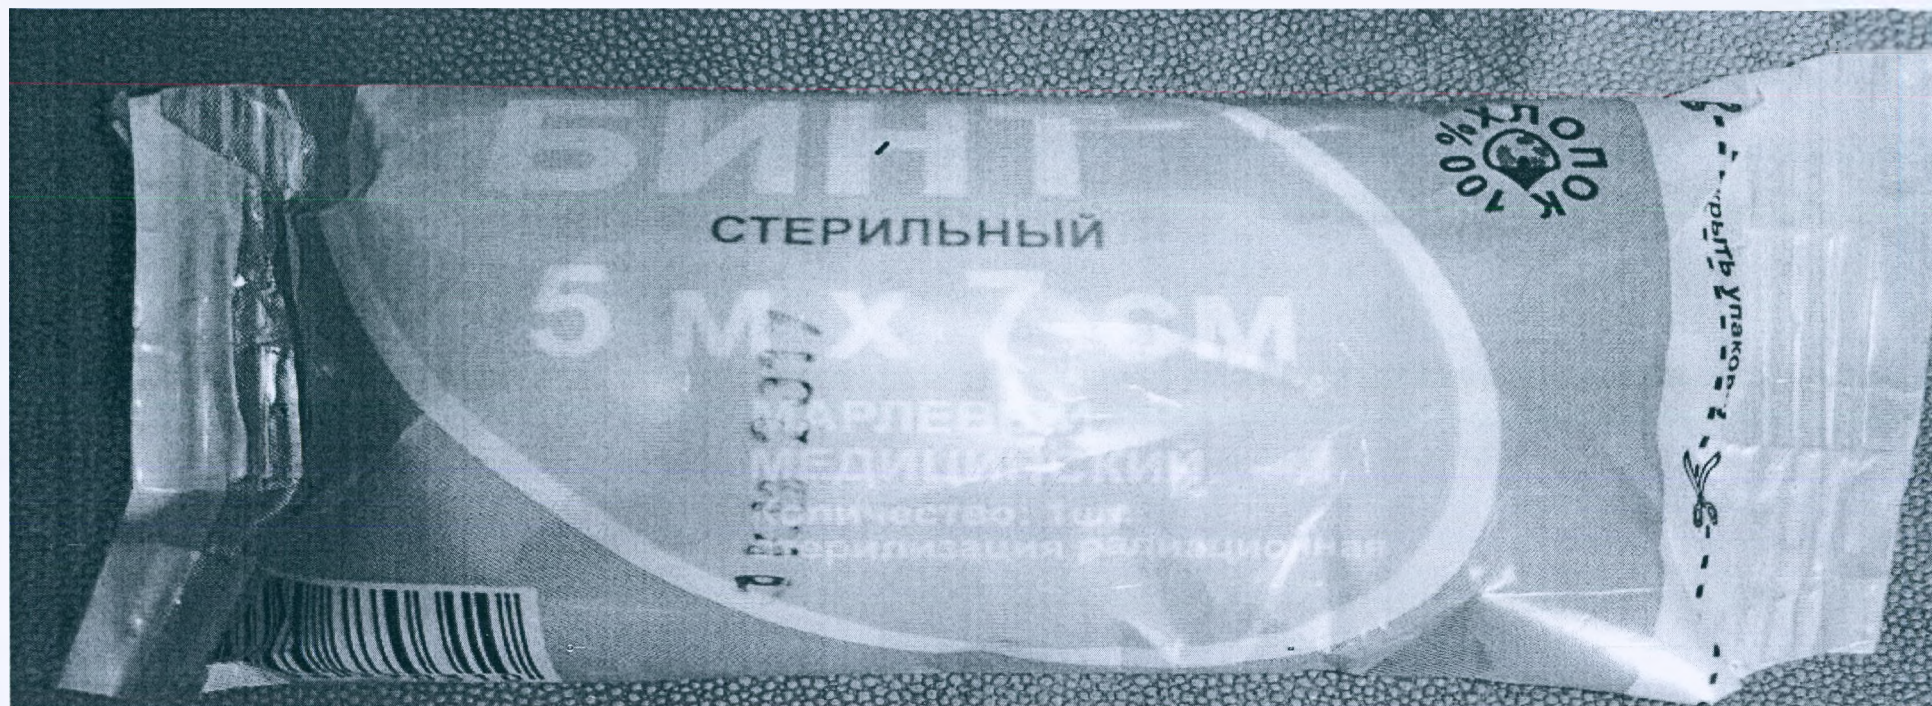

ПЕРУМАР-МЕДИЦИНСКОГО
ОДЕЖИИ

БИНТ ХАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
5м x 10 см, ГОСТ 1172-93



lif

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Срок годности 5 лет
Сделано в России:

БИНТ



Количество 1 штука



Произведено по заказу ООО «ТДЛ Текстиль». Производитель: ООО «ХБК «Навтекс».

марлевый медицинский стерильный. ГОСТ 1172-93. Пер. уд. № РЗН 2015/2552 от 10.04.2015.
Безопасный стерильный бинт относится к отходам класса А или Б и утилизируется в соответствии
с 4.2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"
с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 1.

Хранить при температуре от 0°C до +30°C. Вскрыть и использовать немедленно.
Удалить обложку.

Жгут кровоостанавливающий



ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ РЕЗИНОВЫЙ «ВИТАЛФАРМ»

Зарегистрировано под названием: «Набор экстренной помощи, медицинский «Виталфарм» в составе:

Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; Пакет-контейнер гипотермический «Виталфарм»; Интубационный эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм»; Воздуховод «Виталфарм» для проведения искусственного дыхания способом «рот в рот».

ТУ 9398-010-50887801-2005; Р. № ФСР 2008/03466 от 18.04.2013 г.

Назначение:

Жгут кровоостанавливающий резиновый предназначен для ограничения циркуляции крови.

Хранение:

Жгут следует хранить в упаковке при температуре от 0° до +25°С и относительной влажности не выше 30% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

ЖГУТ


КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
МАТЕРЧАТО-ЭЛАСТИЧНЫЙ
ДЛЯ САМО- И ВЗАИМОПОМОЩИ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
АППЛО

Петля жгута

Фиксатор

Корпус

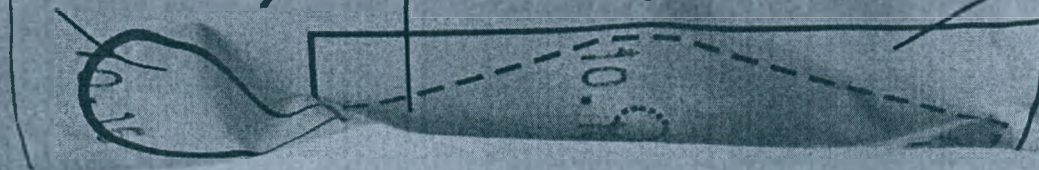

Изготовитель и патентодержатель:
ООО НПО «МИРАЛ»
394036, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 34-33
тел./факс: (473) 22-11-711
e-mail: info@npfmiral.ru
www.npfmiral.ru



ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ С ДОЗИРОВАННОЙ КОМПРЕССИЕЙ

ТУ 2545-008-26528997-10
рег. удостоверение № ФСР 2010/07432 от 25.08.2016 г.

Продеть ленту через пряжки, разместить петлю выше
пупка и затянуть.

2018-1-26 10:24

Жгут кровоостанавливающий (Витал)
матерчатый-эластичный одноразового
использования «Виталфарм»

Зарегистрировано в установленном порядке
Информация о товаре: Жгут кровоостанавливающий матерчатый-эластичный
«Виталфарм»
Сертификат соответствия № РОС RU.000.2016.3733 от 19.03.2016г.

1. Назначение: Жгут кровоостанавливающий матерчатый-эластичный одноразового использования
используется для временной остановки кровотечения.

Применение:
1. Наложить жгут на рану, оказывая давление.

2. Наложить жгут на рану, оказывая давление.

3. Наложить жгут на рану, оказывая давление.

Лейкопластырь рулонный не менее 1 см x 250см

ДЛЯ КОЖИ С НОРМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ, ПРОЧНЫЙ.
С КАУЧУКОВЫМ АДГЕЗИВНЫМ СЛОЕМ.

Применение: для фиксации медицинских устройств,
повязок, компрессов, тампонов и т.д.


Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света
месте, при комнатной температуре.

Не использовать по истечении срока годности

РУ № ФСЗ 2008/01442 от 14.01.2014 г.
Соответствует требованиям ГОСТ Р 53498-2009

Артикул: 151311

Дата выпуска: 07.2015
Годен до: 07.2020
LOT(партия): 20150720



4 607155 640011

LEIKOTM
PLASTER



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
на тканевой основе
гипоаллергенный

1 см x 250 см



S F M - PLASTER

С Ф М - ПЛАС ТЫРЬ



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
ЦИНКООКСИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

ЛЕЙКОПЛАСТИР

МЕДИЧНИЙ ФІКСУЄТЬСЯ ГІПОАЛЕРГЕННИ
ЦІНКООКСІДНИЙ НА ТКАНИННИЙ ОСНОВІ

Инструкция по применению:

1.Открыть индивидуальную упаковку. 2.Ножницами отрезать ленту необходимой длины. 3.Зафиксировать защитную повязку, тампон или компресс. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, влажность до 80%, в темном помещении.

РУ № ФСЗ 2011/11252 от 12.12.2011

Срок действия: НЕ ОГРАНИЧЕН

СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ

Зегельфлигердамм 67-89, 12487 Берлин (Германия)

Tel. +49(30) 63 97 88 25, Fax +49(30) 63 90 85 19

www.sfm-berlin.de www.sfm-shop.de




16 0

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский фиксирующий

1 см $\times$ 250 см

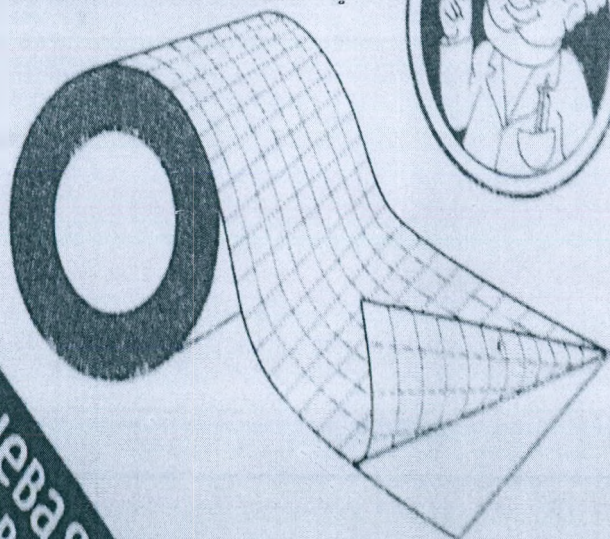

тканевая
основа

гипоаллергенный

Предназначен для фиксации медицинских приспособлений и перевязочных средств.

Использованный лейкопластырь утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.2796-10

Рег.уд № ФСР 2007/01017 от 25 октября 2007 г.
ТУ 9393-004-56334457-2007


Предприятие-изготовитель: ООО «Лейко»
Россия, 170039, г.Тверь, проезд Стеклопластик, д.5
Тел.: (4822) 56-37-59, (4822) 56-07-69
e-mail: leiko.tver@mail.ru www.leiko-medicine.ru



4 607131 360568



2018-1-26 10:40

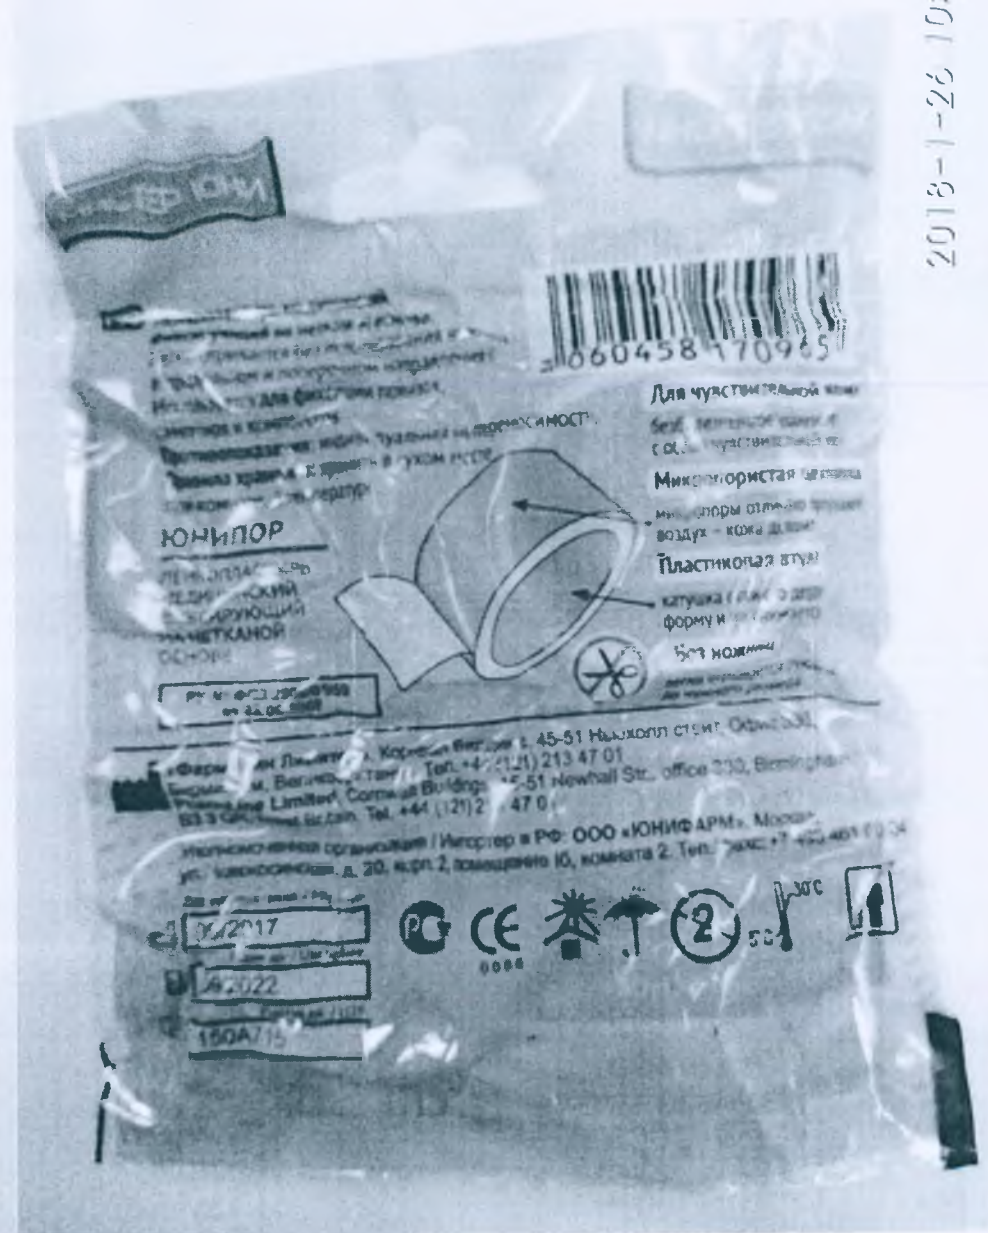

2018-1-26 10:40



2018-1-26 10:26



1 x 300 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

1 x 300 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

veropharm

Е-так: info@veropharm.ru
Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.

Способ и условия применения:

Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Край полосы прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.

Возможна индивидуальная непереносимость.

Не использовать по истечении срока годности.

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Лейкопластырь Верофарм 1 x 300 см
на основе ткани хлопчатобумажной

Р № ФСР 2009/05363 от 15.06.2015
ТУ 8363-015-45961725-2009



АО "ВЕРОФАРМ"

Юрид.
Адрес:
г. Воронеж,
Е-та

Предназнач

Способ и

Перед уп

полосу

наклады

к сухой, чистой, неповрежденной коже.

Возможна индивидуальная непереносимость.

Не использовать по истечении срока годности.

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Лейкопластырь Верофарм 1 x 300 см
на основе ткани хлопчатобумажной

Р № ФСР 2009/05363 от 15.06.2015
ТУ 8363-015-45961725-2009

PG, No fire, No open flame, No smoking, No alcohol, No food/drink

4 602435 002282

АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 107023, Россия, г. Москва, Бородинский пер., д. 8

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия,

г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90.

E-mail: info@veropharm.ru

1

Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см

ПОЛИМЕРНАЯ ОСНОВА

Под

МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ "Импэкс-Мед"

Хранить при комнатной температуре, в защищенном от света месте и влажности не более 80%.

1,9 см x 7,2 см

Гарантия качества

ИМПЭКС МЕД

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ФСЗ 2009/03549 от 12.03.2015 г.

Импортер: ООО "Импэкс-Мед", Тел/факс: +7(495)921-30-58
127644, Россия, Москва, улица Лобненская дом 21 строение 2

Изготовитель: «Чанжоу Хуалиан Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР,
Changzhou Huailian Health Dressing Co., Ltd., № 55 Yuejin Road,
Zhongu Town 213144 Changzhou, People's Republic of China.

Дата выпуска: 07.2016
Годен до: 07.2021
Лот/Lot: 160440

CE 0434

6 958627 514148

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ПОЛИМЕРНАЯ ОСНОВА

Под

МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ "Импэкс-Мед"

Хранить при комнатной температуре, в защищенном от света месте и влажности не более 80%.

1,9 см x 7,2 см

Гарантия качества

ИМПЭКС МЕД

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ФСЗ 2009/03549 от 12.03.2015 г.

Импортер: ООО "Импэкс-Мед", Тел/факс: +7(495)921-30-58
127644, Россия, Москва, улица Лобненская дом 21 строение 2

Изготовитель: «Чанжоу Хуалиан Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР,
Changzhou Huailian Health Dressing Co., Ltd., № 55 Yuejin Road,
Zhongu Town 213144 Changzhou, People's Republic of China.

Дата выпуска: 07.2016
Годен до: 07.2021
Лот/Lot: 160440

CE 0434

6 958627 514148

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

9 x 7,2 см

9 x 7,2 см

9 x 7,2 см

9 x 7,2 см

9 x 7,2 см

9 x 7,2 см

Медицинские изделия, не подлежащие сертификации
по требованиям Технического регламента Таможенного союза

Не использовать по истечении срока годности
ТУ 90-053-2006/01495 от 06.10.2013 г.

Производитель:
Центр Медицинских Технологий, ООО, ул. Бокка 1, зона промышленного развития Удмурт,
213143, г. Чайковский, промзона Центр-Удмурт.
Импортер/Уполномоченная организация:
ООО "Аризон" (ИНН 50/109652), г. Москва, ул. Никитинская д. 70, корп. 2,
кв. 17 (495) 743-29-40, e-mail: info@arizon.ru

Для нормальной и чувствительной кожи. С полимеризованным адгезивным слоем.
Антисептическое вещество - акриловое.
Применение: для оказания первой неотложной помощи при поверхностных ранениях
кожи, ссадин и порезах.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте
при комнатной температуре.

Не использовать по истечении срока годности
ТУ 90-053-2006/01495 от 06.10.2013 г.

Производитель:
Центр Медицинских Технологий, ООО, ул. Бокка 1, зона промышленного развития Удмурт,
213143, г. Чайковский, промзона Центр-Удмурт.

Импортер/Уполномоченная организация:
ООО "Аризон" (ИНН 50/109652), г. Москва, ул. Никитинская д. 70, корп. 2,
кв. 17 (495) 743-29-40, e-mail: info@arizon.ru

Для нормальной и чувствительной кожи. С полимеризованным адгезивным слоем.
Антисептическое вещество - акриловое.
Применение: для оказания первой неотложной помощи при поверхностных ранениях
кожи, ссадин и порезах.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте
при комнатной температуре.

Не использовать по истечении срока годности
ТУ 90-053-2006/01495 от 06.10.2013 г.

Производитель:
Центр Медицинских Технологий, ООО, ул. Бокка 1, зона промышленного развития Удмурт,
213143, г. Чайковский, промзона Центр-Удмурт.

Импортер/Уполномоченная организация:
ООО "Аризон" (ИНН 50/109652), г. Москва, ул. Никитинская д. 70, корп. 2,
кв. 17 (495) 743-29-40, e-mail: info@arizon.ru

Для нормальной и чувствительной кожи. С полимеризованным адгезивным слоем.
Антисептическое вещество - акриловое.
Применение: для оказания первой неотложной помощи при поверхностных ранениях
кожи, ссадин и порезах.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте
при комнатной температуре.

Не использовать по истечении срока годности
ТУ 90-053-2006/01495 от 06.10.2013 г.

Производитель:
Центр Медицинских Технологий, ООО, ул. Бокка 1, зона промышленного развития Удмурт,
213143, г. Чайковский, промзона Центр-Удмурт.

Импортер/Уполномоченная организация:
ООО "Аризон" (ИНН 50/109652), г. Москва, ул. Никитинская д. 70, корп. 2,
кв. 17 (495) 743-29-40, e-mail: info@arizon.ru

Для нормальной и чувствительной кожи. С полимеризованным адгезивным слоем.
Антисептическое вещество - акриловое.
Применение: для оказания первой неотложной помощи при поверхностных ранениях
кожи, ссадин и порезах.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте
при комнатной температуре.

Не использовать по истечении срока годности
ТУ 90-053-2006/01495 от 06.10.2013 г.

Производитель:
Центр Медицинских Технологий, ООО, ул. Бокка 1, зона промышленного развития Удмурт,
213143, г. Чайковский, промзона Центр-Удмурт.

Импортер/Уполномоченная организация:
ООО "Аризон" (ИНН 50/109652), г. Москва, ул. Никитинская д. 70, корп. 2,
кв. 17 (495) 743-29-40, e-mail: info@arizon.ru

Для нормальной и чувствительной кожи. С полимеризованным адгезивным слоем.
Антисептическое вещество - акриловое.
Применение: для оказания первой неотложной помощи при поверхностных ранениях
кожи, ссадин и порезах.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света места
при комнатной температуре.

Не использовать по истечении срока годности
ТУ 90-053-2006/01495 от 06.10.2013 г.





























Производитель:
Центр Медицинских Технологий, ООО, ул. Бокка 1, зона промышленного развития Удмурт,
213143, г. Чайковский, промзона Центр-Удмурт.

Импортер/Уполномоченная организация:
ООО "Аризон" (ИНН 50/109652), г. Москва, ул. Никитинская д. 70, корп. 2,
кв. 17 (495) 743-29-40, e-mail: info@arizon.ru

Для нормальной и чувствительной кожи. С полимеризованным адгезивным слоем.
Антисептическое вещество - акриловое.
Применение: для оказания первой неотложной помощи при поверхностных ранениях
кожи, ссадин и порезах.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света места
при комнатной температуре.

Не использовать по истечении срока годности
ТУ 90-053-2006/01495 от 06.10.2013 г.

Производитель:
Центр Медицинских Технологий, ООО, ул. Бокка 1, зона промышленного развития Удмурт,
213143, г. Чайковский, промзона Центр-Удмурт.



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

1,9 x 7,2 см

1,9 x 7,2 см

1,9 x 7,2 см

1,9 x 7,2 см

1,9 x 7,2 см

1,9 x 7,2 см

4 036534 54005

STRIP ■ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
ПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ

7,2 x 1,9 см

непереносимость
ру № ФСЗ 2011/11252 от 12.12.2011
Срок действия: не ограничен



Зегельфлигердамм 67-89 12487 Берлин (Германия)
Тел +49(30) 63 97 88 25 Факс +49(30) 63 90 85 19
www.sfm-berlin.de www.sfm-shop.de

Тоқылмаған негізіндегі медициналық
бактерицидті жабысқақ бұласыры
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: - индивидуальная

LOT	20150901
	09.2015
	09.2020

АШУ
ОТКРЫВАТЬ



STERILE EO



® СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ

2018-1-29 13:19

**БАКТЕРИЦИДНЫЙ
гипоаллергенный**
на нетканой основе

72мм x 19мм

Антисептик хлорид бензалкония

CE

5 009612 911242

МАСТЕР ЮНИ

РУ № ФСЗ 200001000 от 22.06.2007

Генеральный: Pharma Line Limited, Central Building, 45-51 Newhall St., office 330, Birmingham B3 3QF, Great Britain. Tel: +44 121 213 47 01 «Фармлайн Биомедикс, Корнелл»

Бразилия: 45-51 Newhall St., office 330, Birmingham, England, Great Britain. Tel: +44 121 213 47 01

Уполномоченное представительство в РФ: ООО «ГОСЗДРАВНОР», 119672, Москва, ул. Колодезниковская, д. 20, корпус 2, помещение 35, кабинет 2. Тел./факс: +7 495 465 91 04

Дата выпуска: 05/2017

Годен до: 05/2022

Партия №: 201705

МАСТЕР ЮНИ

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
гипоаллергенный**
на нетканой основе

72мм x 19мм

Антисептик хлорид бензалкония

CE

5 009612 911242

МАСТЕР ЮНИ

РУ № ФСЗ 200001000 от 22.06.2007

Генеральный: Pharma Line Limited, Central Building, 45-51 Newhall St., office 330, Birmingham B3 3QF, Great Britain. Tel: +44 121 213 47 01 «Фармлайн Биомедикс, Корнелл»

Бразилия: 45-51 Newhall St., office 330, Birmingham, England, Great Britain. Tel: +44 121 213 47 01

Уполномоченное представительство в РФ: ООО «ГОСЗДРАВНОР», 119672, Москва, ул. Колодезниковская, д. 20, корпус 2, помещение 35, кабинет 2. Тел./факс: +7 495 465 91 04

Дата выпуска: 05/2017

Годен до: 05/2022

Партия №: 201705

МАСТЕР ЮНИ

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
гипоаллергенный**
на нетканой основе

72мм x 19мм

Антисептик хлорид бензалкония

CE

5 009612 911242

МАСТЕР ЮНИ

РУ № ФСЗ 200001000 от 22.06.2007

Генеральный: Pharma Line Limited, Central Building, 45-51 Newhall St., office 330, Birmingham B3 3QF, Great Britain. Tel: +44 121 213 47 01 «Фармлайн Биомедикс, Корнелл»

Бразилия: 45-51 Newhall St., office 330, Birmingham, England, Great Britain. Tel: +44 121 213 47 01

Уполномоченное представительство в РФ: ООО «ГОСЗДРАВНОР», 119672, Москва, ул. Колодезниковская, д. 20, корпус 2, помещение 35, кабинет 2. Тел./факс: +7 495 465 91 04

Дата выпуска: 05/2017

Годен до: 05/2022

Партия №: 201705

МАСТЕР ЮНИ

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
гипоаллергенный**
на нетканой основе

72мм x 19мм

Антисептик хлорид бензалкония

CE

5 009612 911242

МАСТЕР ЮНИ

РУ № ФСЗ 200001000 от 22.06.2007

Генеральный: Pharma Line Limited, Central Building, 45-51 Newhall St., office 330, Birmingham B3 3QF, Great Britain. Tel: +44 121 213 47 01 «Фармлайн Биомедикс, Корнелл»


Бразилия: 45-51 Newhall St., office 330, Birmingham, England, Great Britain. Tel: +44 121 213 47 01

Уполномоченное представительство в РФ: ООО «ГОСЗДРАВНОР», 119672, Москва, ул. Колодезниковская, д. 20, корпус 2, помещение 35, кабинет 2. Тел./факс: +7 495 465 91 04

Дата выпуска: 05/2017

Годен до: 05/2022

Партия №: 201705

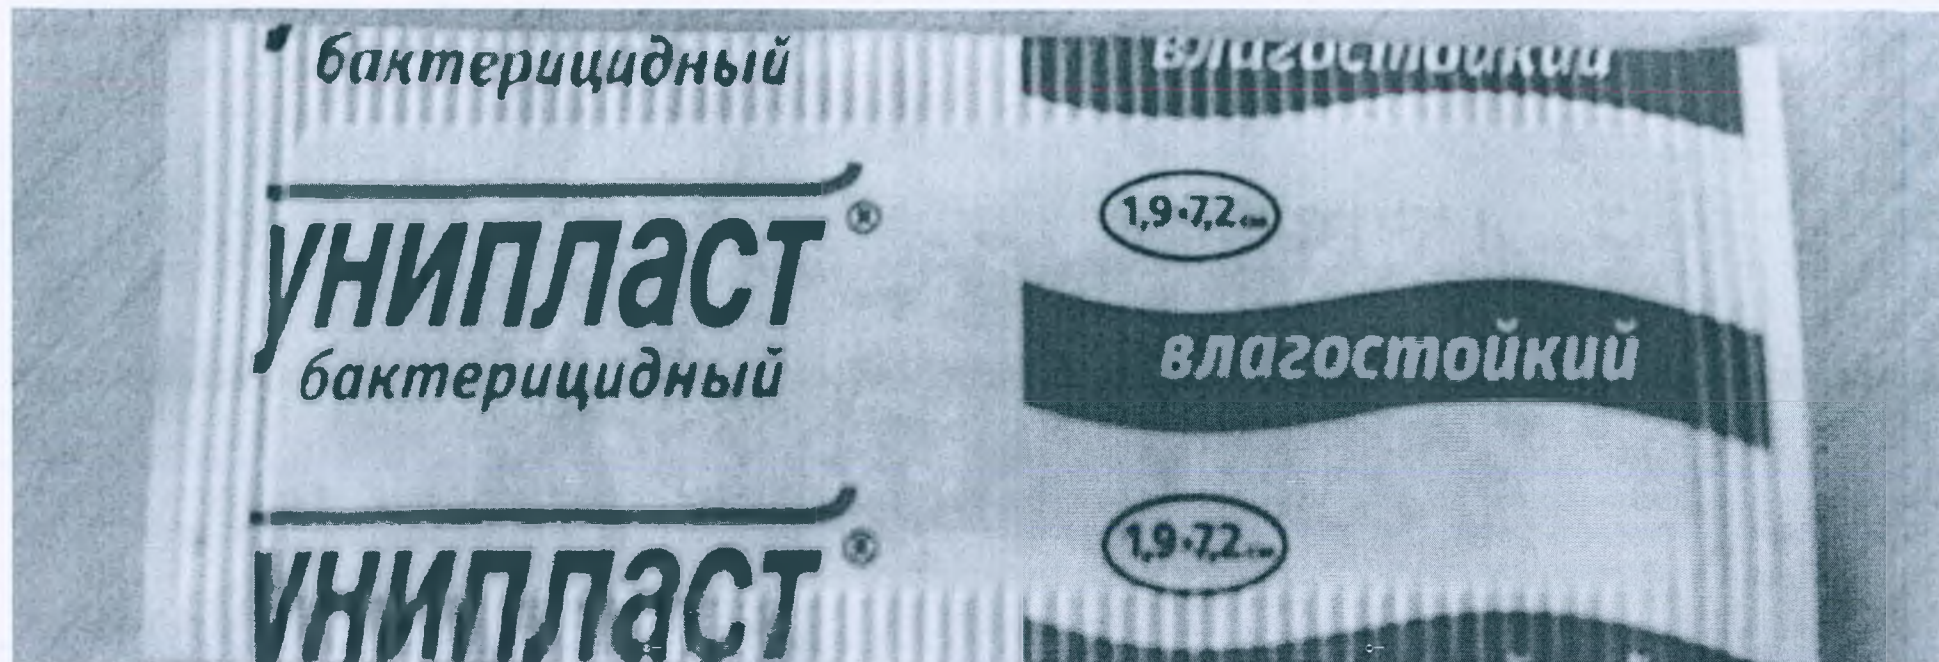

ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90

Лейкопластырь «Унипласт бактерицидный»
На основе пленки
 Хранить в сухом, защищенном от света месте.

1,9x7,2 см

Антисептическая пропитка: хлоргексидина биглюконат.
 Возможна индивидуальная непереносимость.

ОАО «ВЕРОФАРМ»
 Юридический адрес: 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3.
 Адрес производства и принятия претензий: 394006, г. Воронеж,
 ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90

Лейкопластырь «Унипласт бактерицидный»
На основе пленки
 Хранить в сухом, защищенном от света месте.

1,9x7,2 см

Антисептическая пропитка: хлоргексидина биглюконат.

ТУ 9393-013-45961725-2010
 Р № ФСР 2010/07192 от 14.07.2011
 Свидетельство на товарный знак № 202223

PG 2

4 602435 002749

ТУ 9393-013-45961725-2010
 Р № ФСР 2010/07192 от 14.07.2011



Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А или Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Возможна индивидуальная непереносимость.

Не использовать по истечении срока годности.

Р № ФСР 2008/03213 от 15.06.2015
ТУ 9393-017-45961725-2010

АО "ВЕРОФАРМ" 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3.
Телефон для принятия претензий (473) 277-94-90

Способ и условия применения: Снять защитное покрытие, подушечку приложить на рану и приклеить к сухой, чистой коже.

Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А или Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Возможна индивидуальная непереносимость.

Не использовать по истечении срока годности.

Р № ФСР 2008/03213 от 15.06.2015
ТУ 9393-017-45961725-2010

АО "ВЕРОФАРМ" 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3.
Телефон для принятия претензий (473) 277-94-90

Способ и условия применения: Снять защитное покрытие, подушечку приложить на рану и приклеить к сухой, чистой коже.

Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А или Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.


Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Возможна индивидуальная непереносимость.



Не использовать по истечении срока годности.

Р № ФСР 2008/03213 от 15.06.2015
ТУ 9393-017-45961725-2010


АО "ВЕРОФАРМ" 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3.




4 607083 721134

4 607083 721134







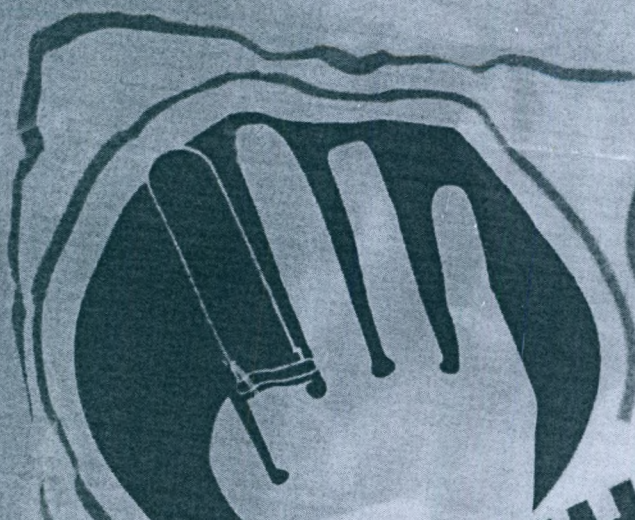
4 607083 721134




4 607083 721134



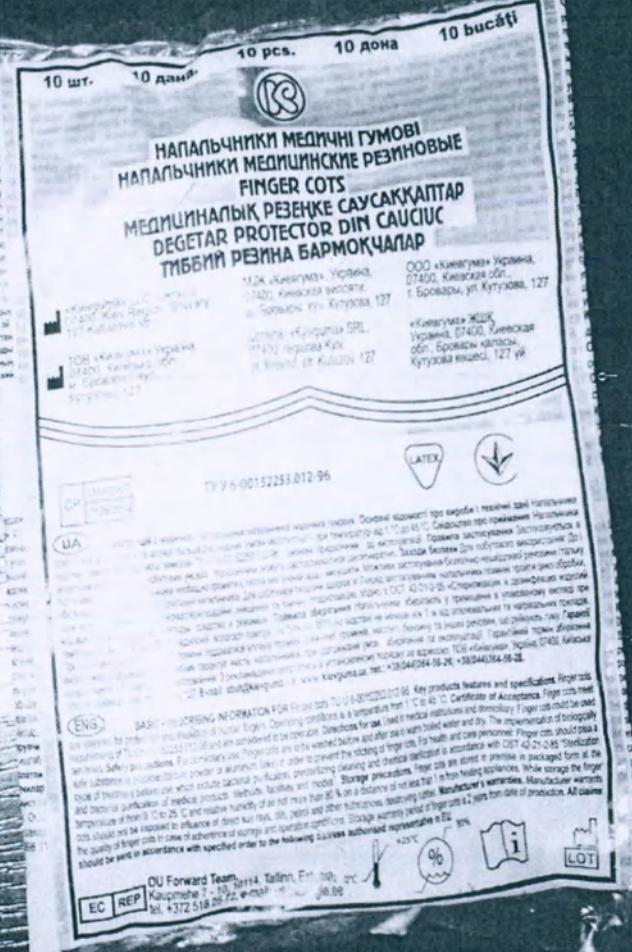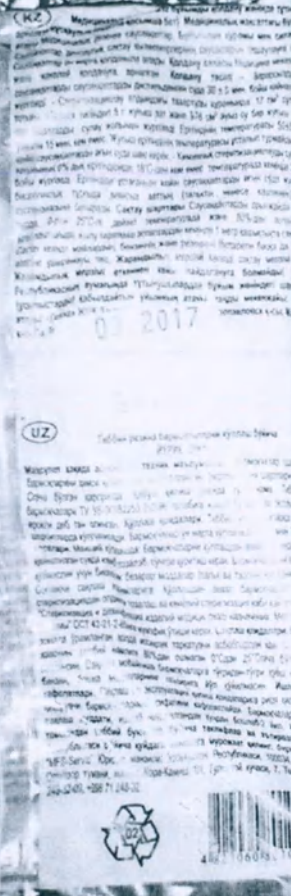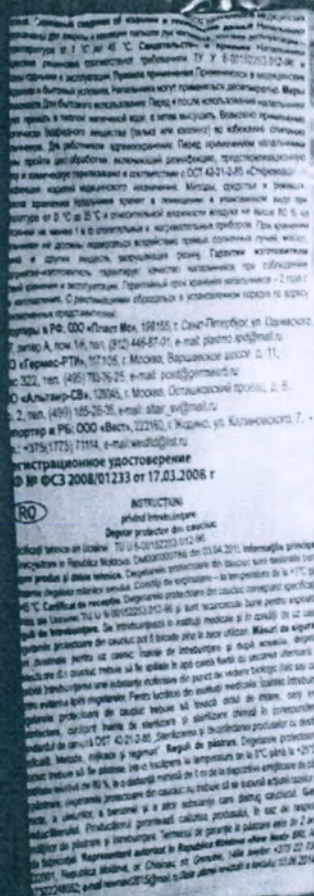



АЗРИ
ТРАДИЦИИ С 1930 ГОДА

НАПАЛЬЧНИКИ резиновые
медицинские
Тип 1 номер 3

ТУ 38.106 567-88

Качество продукции обеспечено
сертифицированной системой
менеджмента качества, соответствую-
ющей требованиям ГОСТ ISO 9001



6070061490086

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2010/07229 от 21.08.2015 года

02 2017

Дата изготовления

Гарантийный срок годности - три года

Ю «Армавирский завод резиновых изделий»
351311, РОССИЯ,

г. Армавир,
Краснодарского края,
ул. Новороссийская, 2/4.

Заказы и информация по
телефонам:

(861-37)3-00-24,
Факс: 4-64-22, 4-21-90
WWW.AZRI.RU



ООО "КОЛТЕКС"

Салфетка атравматическая, размер 6x10 см

КОЛТЕКС-СХГ-1

**с хлоргексидином и альгинатом натрия
ускоряет процесс заживления**

НАЗНАЧЕНИЕ:

Лечебно-профилактическое средство
антисептического действия для закрытия и
лечения ран, порезов, трещин,
послеоперационных швов, инфицированных
и гранулирующих ран, трофических язв.



STERILE R

СТЕРИЛЬНО!

для местного применения

2018-1-26 10:29



1 шт. 7x10 см

Антимикробное

Покрывте атраватическое с
лекарственными средствами для
первичного закрытия и лечения
инфицированных ран и ожогов

с ДиоксиДином,
ДиоксиДином, рутином и аскорбиновой кислотой

 Стерильно
Для однократного применения



Условия хранения: в сухом, темном месте Срок годности 3 года
Дата производства/стерилизации: на упаковке
рег. уд. ФСР 2009/04116 от 02.02.2009, ТУ 93-003-59132234 2008
Утилизация как отходы класса Б по СанПиН 2.1.7.279
Производитель: ООО «НПЦ «Сериал Мед», Россия, 125247,

Назначение:
Для закрытия грязных ран и ожогов
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость препаратов
Способ применения:
1. Вскрыть упаковку. 2. Смочить водой и нанести покрытие
окрашенной стороной на рану. 3. Зафиксировать бинтом или
пластырем. 4. Смену покрытия производить по мере смачивания.

112017

2018-1-26 10:31



товар года
2011



АСЕПТИКА

САЛФЕТК. С ЙОДОВИДОНОМ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ

Для обработки мелких травм кожи:
ссадин, порезов, поверхностных ожогов
Практически не вызывает жжения

16 03 2017

Салфетка антисептическая из бумажного
текстилеподобного материала стерильная
«М.К.Асептика» с йодовидоном

Размер салфетки: 135x185 мм
Рег. удостоверение: Россия
ФСР 2009/05439
от 27.07.2016 г.
ТУ 9393-001-51276525-00
Срок годности: 2 года с даты,
указанной на упаковке

Произведено:
ООО «М.К. Асептика»
Россия, 111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 9, стр. 3,
пом. 2. www.aseptica.ru



изготовлено под контролем


STERILE R



4 607174 650015

16 03 2017

Салфетка кровоостанавливающая №3

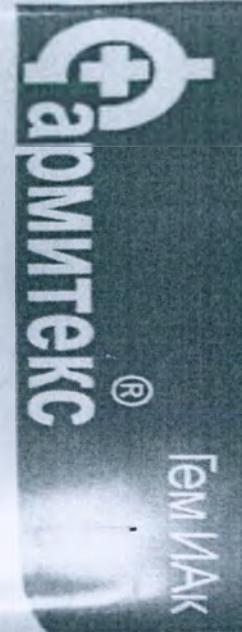

3 шт.

7x10 см

Кровоостанавливающее

Покрытие атравматическое с
лекарственными средствами для
первичного закрытия и лечения
инфицированных ран и ожогов

с йодополироном
и аминокапроновой кислотой



Стерильно

STERILE R



Для однократного применения



Условия хранения: в сухом, темном месте. Срок годности 3 года
Дата производства/стерилизации: см. на упаковке
рег. уд. ФСР 2009/04116 от 02.02.2009, ТУ 9393-003-59132234-2008
стерилизация как отходы класса Б по СанПин 2.1.7.2790
Производитель: ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия, 127247,

Назначение:

Для остановки кровотечений

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость препаратов

Способ применения:

1. Вскрыть упаковку. 2. Наложить покрытие окрашенной стороной на рану.
3. Прижать к ране на 1 минуту, при обильном кровотечении использовать дополнительный сорбционный слой (вата, марля).
4. Закрепить бинтом или пластырем.
5. Смену покрытия производит, со сменением

072017



ООО "КОЛТЕКС"
Салфетка гемостатическая, размер 6х10 см

КОЛТЕКС-САФГ-ГЕМ

кровоостанавливающая с
альгинатом натрия и фурагином

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для экстренной остановки капиллярно-паренхиматозных кровотечений, а также кровотечений из мелких кровеносных сосудов в быту и в условиях скорой помощи.



СТЕРИЛЬНО!



STERILE R

для местного применения

16 03 2017



ООО "КОЛТЕКС"
Салфетка гемостатическая, размер 6х10 см

КОЛТЕКС-САФГ-ГЕМ

кровоостанавливающая с
альгинатом натрия и фурагином

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Салфетку наложить на рану стороной с лекарственным средством и прижать на 30-40 секунд.
- После полной остановки кровотечения салфетку удалить.
- При присыхании салфетки к ране перед удалением смочить ее кипяченой или дистиллированной водой.

Марка: САФГ-ГЕМ.
Состав: альгинат
натрия, фурагин.
Противопоказания:
аллергическая реак-
ция на препараты.

Количество: 3 шт
Срок годности: 3 года
Дата изготовления и номер партии
см. на шве упаковки
ТУ 9393-008-58223785-2005
ПУ № ФСР 2010/08240 от 18 марта 2014 г.
Хранить в сухом, защищенном от
света месте при температуре
от +5 до +40°C.




Производитель: ООО «Колтекс», 115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, д. 21, н/п 4-6.
Тел./факс: +7 (495) 730-5645 (многоканальный) www.coletex.ru

16 03 2017

02.02.2017



товар года
2011



АСЕПТИКА

**САЛФЕТКА С ФЕРАКРИЛОМ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩАЯ**

Наружное гемостатическое средство
Обладает бактерицидной способностью
и обезболивающим действием



Салфетка гемостатическая из бумажного
текстилеподобного материала с феракрилом,
стерильная «Сф-Асептика»


Размер салфетки: 135x185 мм
Рег. удостоверение: Россия
№ ФСР 2011/11830
от 26.07.2016 г.
ТУ 9393-002-51276525-2002
Срок годности: 2 года с даты,
указанной на упаковке

Произведено:
ООО «М.К. Асептика»
Россия, 111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 5, стр. 3,
пом. 2. www.aseptica.ru

STERILE R



Салфетка марлевая медицинская стерильная 16смх14см не менее №5

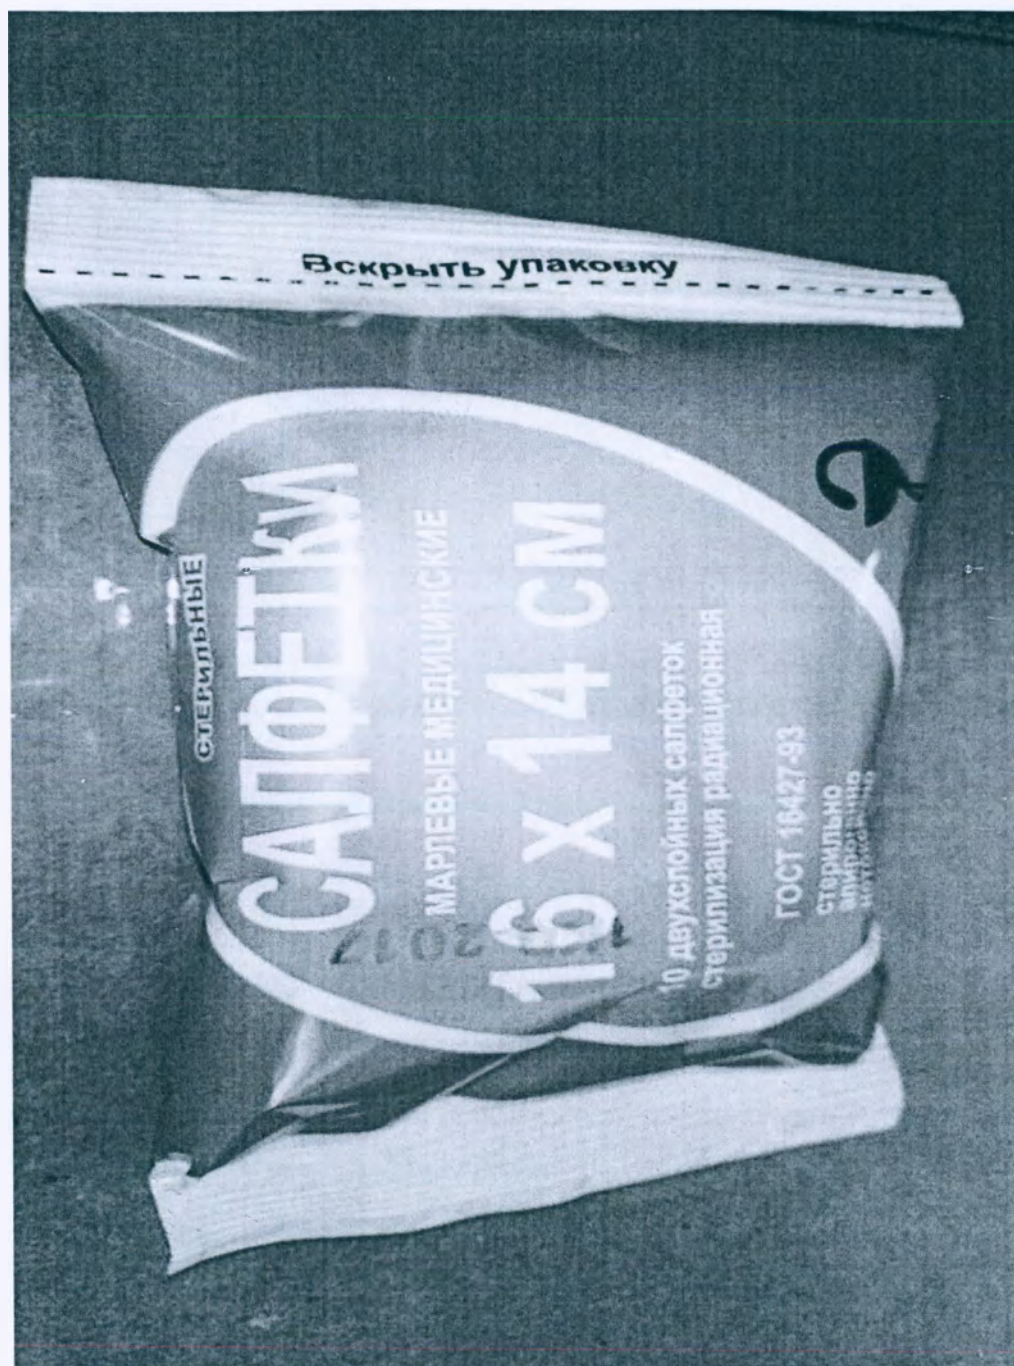

ООО «ГК «Городничская» санитарно-гигиеническая фабрика
Россия, 401 130, Владимирская обл., Петушинский район
д. Городничье, ул. Советская, 1, тел. (49243) 3 25-25

САЛФЕТКИ МАРЛЕННЫЕ



МЕДИЦИНСКИЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ
НЕУСЛОБНЫЕ



Упаковка — 100%.

45 см X 29 см — 6 шт

ГОСТ 10417-98

Срок годности 5 лет, дата стерилизации IV квартал 2016г.

Р.У. М. ФСР 2010-08026

М 1

2018-1-26 10:37



ООО "ИНГЛАМАД"
РОССИЯ, Костромская обл.,
157305 г. Мануфурово, ул. Гвардейская, 32

САЛФЕТКИ

марлевые медицинские

СТЕРИЛЬНЫЕ


двухслойные

16 см x 18 см


Коп-80
10 шт.

43

Способ вскрытия: оболочку разорвите по вырезу.
Условия хранения: хранить в сухом месте.
Утилизация: в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, допускается утилизация с бытовыми отходами.

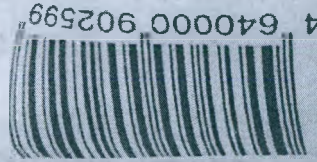

Срок годности: 5 лет.
квартал, год, серия:
Дата стерилизации
С 5 0
4 К В 1 6
e-mail: everis@everis.ru, <http://www.everis.ru>
РФ № ФСР 2007/01316 от 15.10.2014 г.

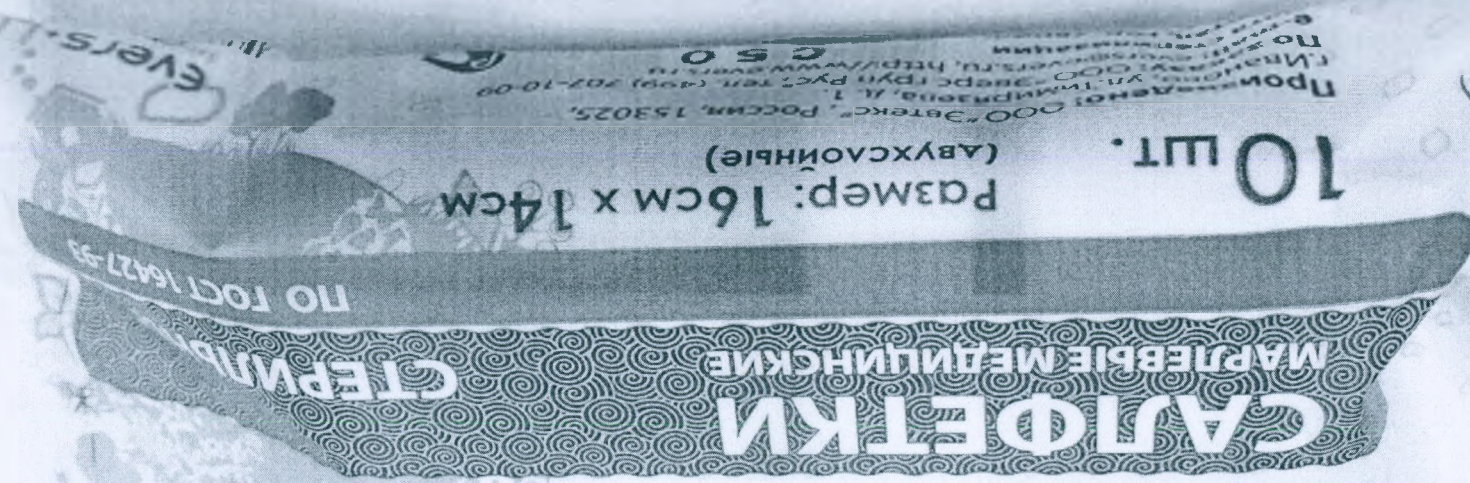

использованные салфетки относятся к отходам класса А жидкие и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10



наименование
медицинского
предия

САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
16x14 см, 2-х СЛОЙНЫЕ, 10 ШТУК, ТУ 9393-006-1071507



САЛФЕТКИ

Количество 10 шт.
(десять двухслойных салфеток)
16 x 14 см

17 03 2017

произведено по заказу ООО «ТДЛ Текстиль».

производитель: ООО «ХБК «Навтекс». 155830, Россия, Ивановская обл.,
Ивановский р-н, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1.

телефоны: (4932) 9-77-32, (4932) 59-11-11, (495) 734-33-39.

при открытии: разорвите оболочку.

срок годности 5 лет

сделано в России

Хранить в сухом и
при температуре
от 0 °C до +25 °C

17 03 2017



17 03 2017

45

WISEMAN

САЛФЕТКИ

марлевые медицинские двухслойные

СТЕРИЛЬНЫЕ

16 см x 14 см

Количество: 10 штук

КВ2016
LOT 2

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ» (ООО «НЬЮФАРМ»), ИНН 5407013893, ОГРН 1055407013893, адрес: 446000, Самарская обл., г. Новокузнецк, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1, этаж 1, пом. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

ГОСТ 16427-93.
ПУ № ФСР 2011/11141 от 28.06.2011.
Гарантийный срок годности – 5 лет.
Номер серии указан на упаковке.
Дата стерилизации указана на упаковке.
Утилизация относится к отходам класса Б.



2018-1-26 10:34

Производитель: ООО ПКФ "АХТАМАР", 13-я Березниковская 11, Иваново, Россия
Тел./факс +7(4932) 232-538, 232-547; e-mail: ahtamar@bk.ru; www.ahtamar.ru

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12069 от 10.10.2011

Медицинское изделие однократного применения. Применяется для использования
в качестве готовых операционно-перевязочных средств.

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от 0 до 30 °C

АХТАМАР®
АТТАМАР

АХТАМАР®
АТТАМАР

САЛФЕТКИ
МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ
(ДВУХСЛОЙНЫЕ)

16 x 14 см

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
414 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.В.

30.03.18