

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор ООО «Комен-Мед»

Герликов Альберт Владимирович

«3» августа 2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мультипараметрический монитор пациента С-90

2018 г.

Фото 1. Основной блок Мультипараметрического монитора пациента С-90



Фото 2. Кабель ЭКГ на 3 отведения

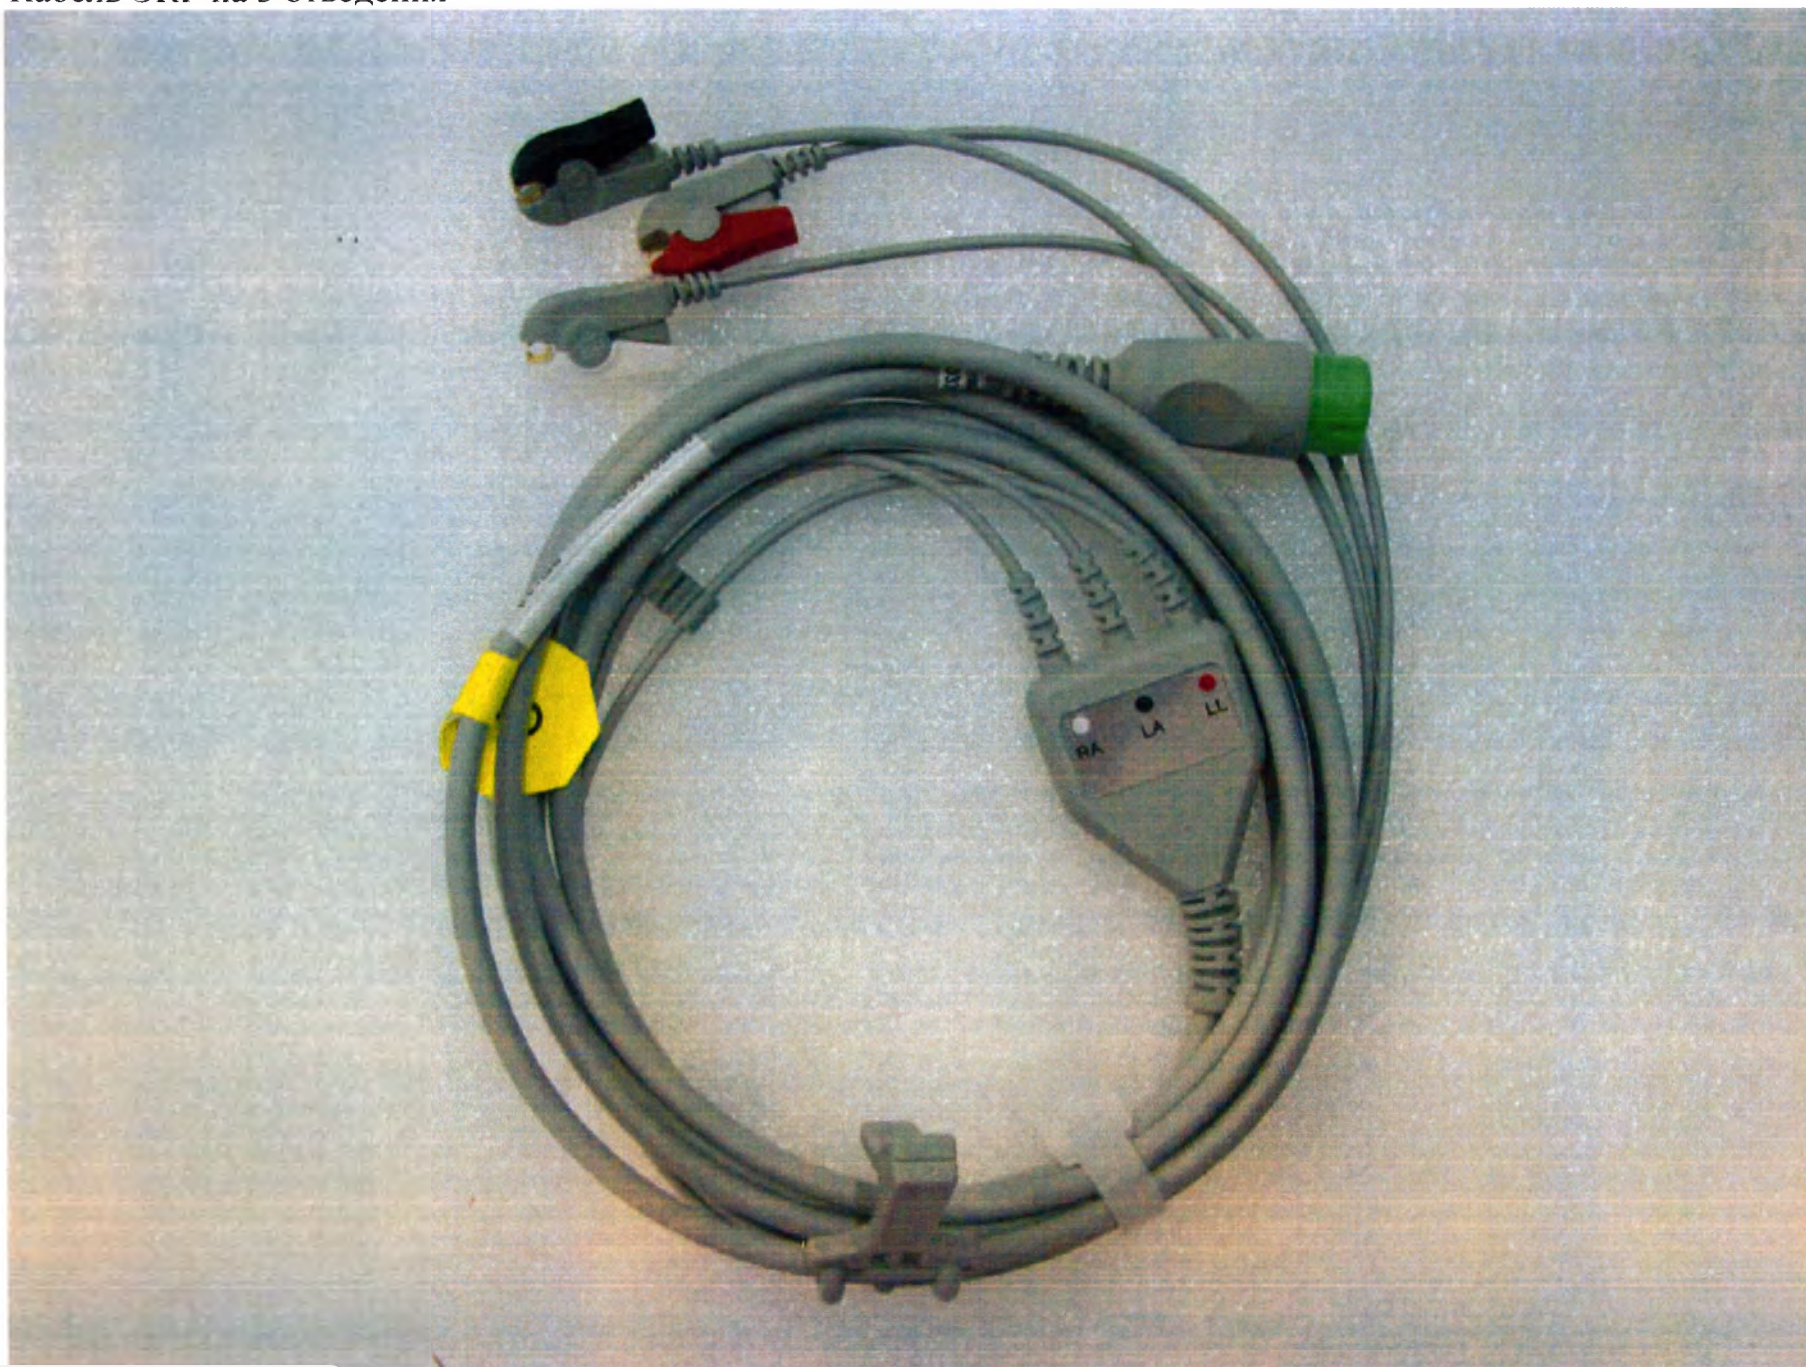


Фото 3. Кабель ЭКГ на 5 отведений.

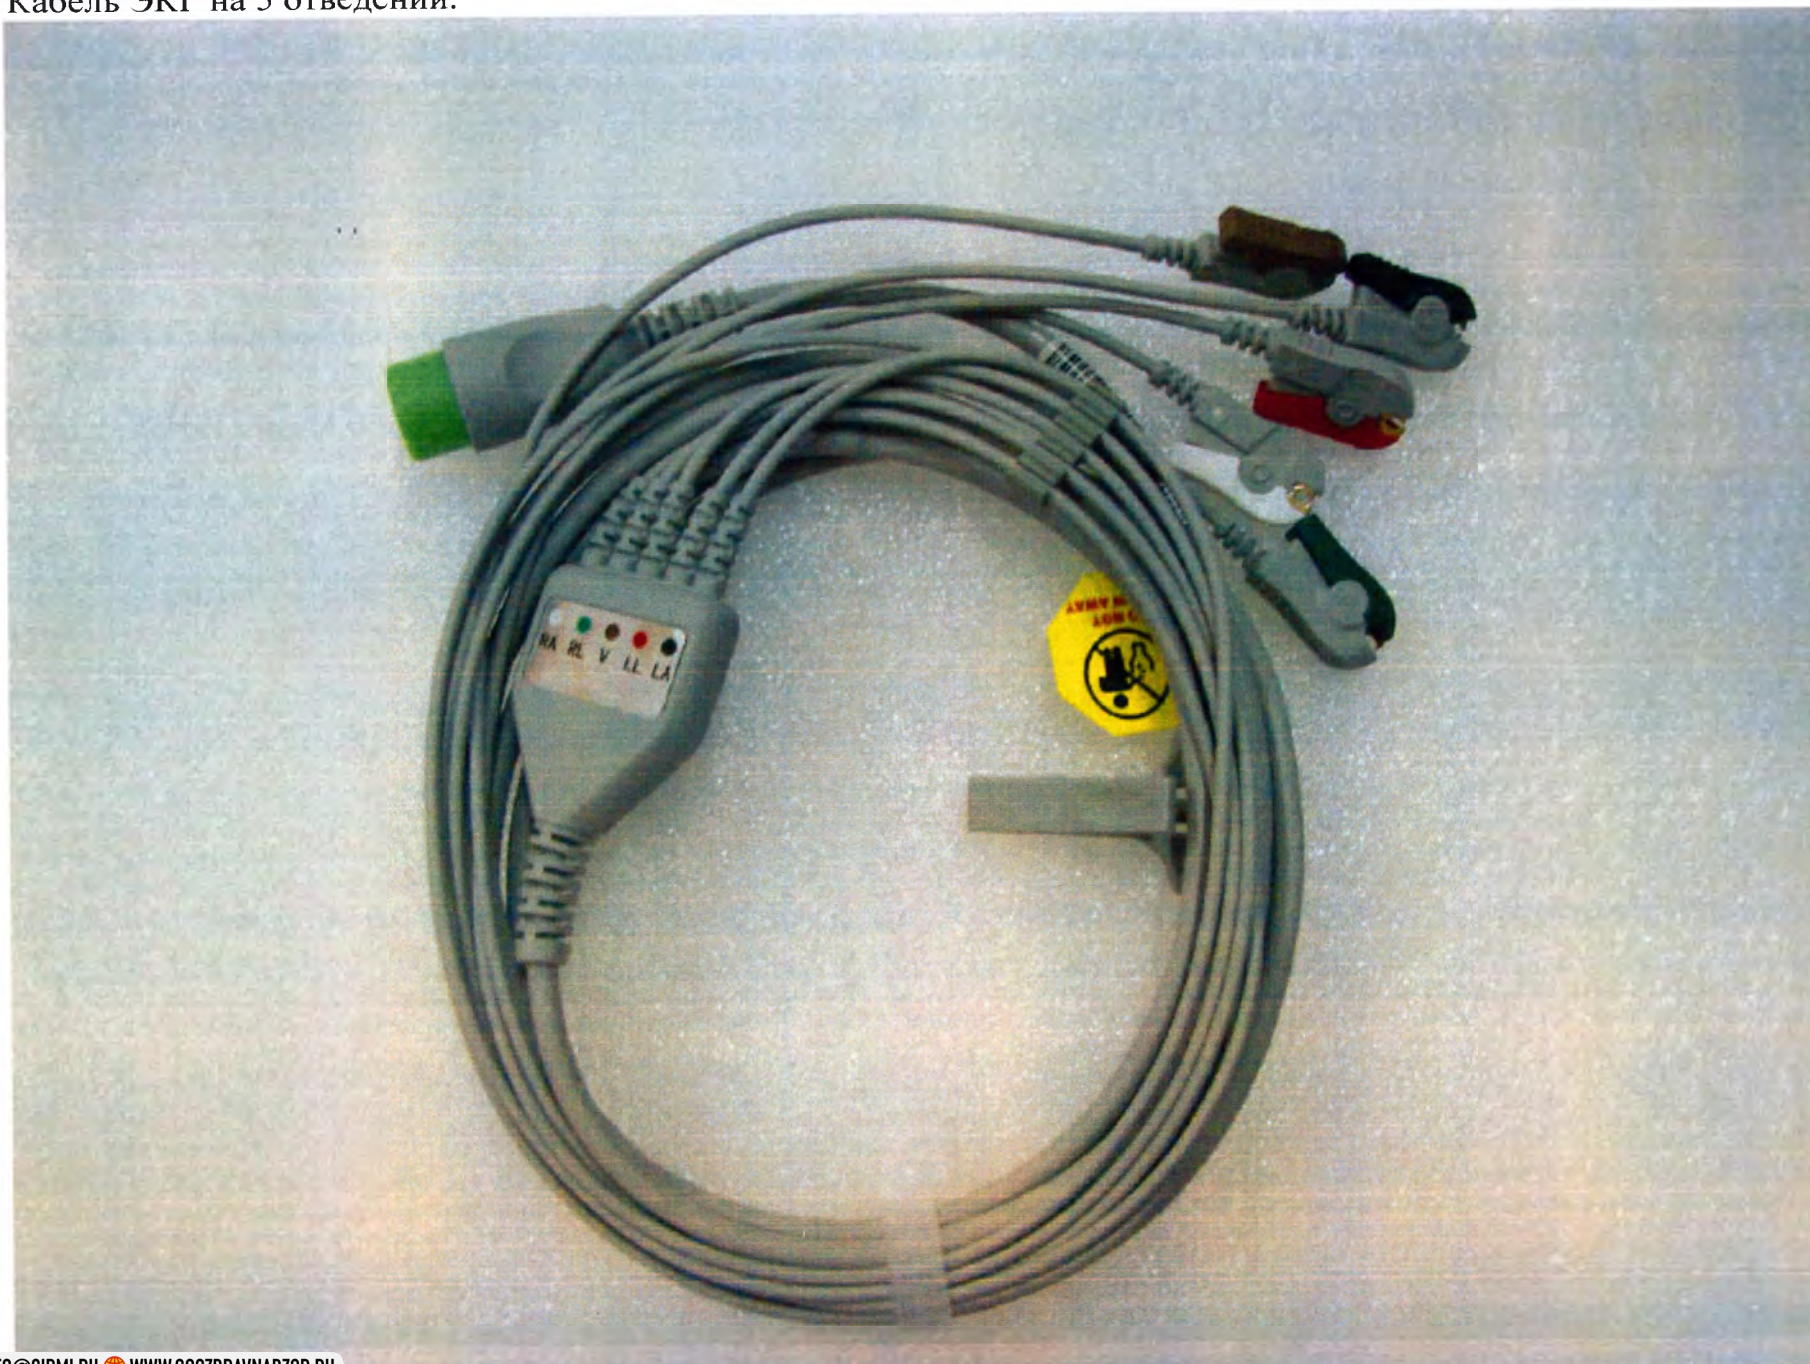


Фото 4. Кабель ЭКГ на 12 отведений.

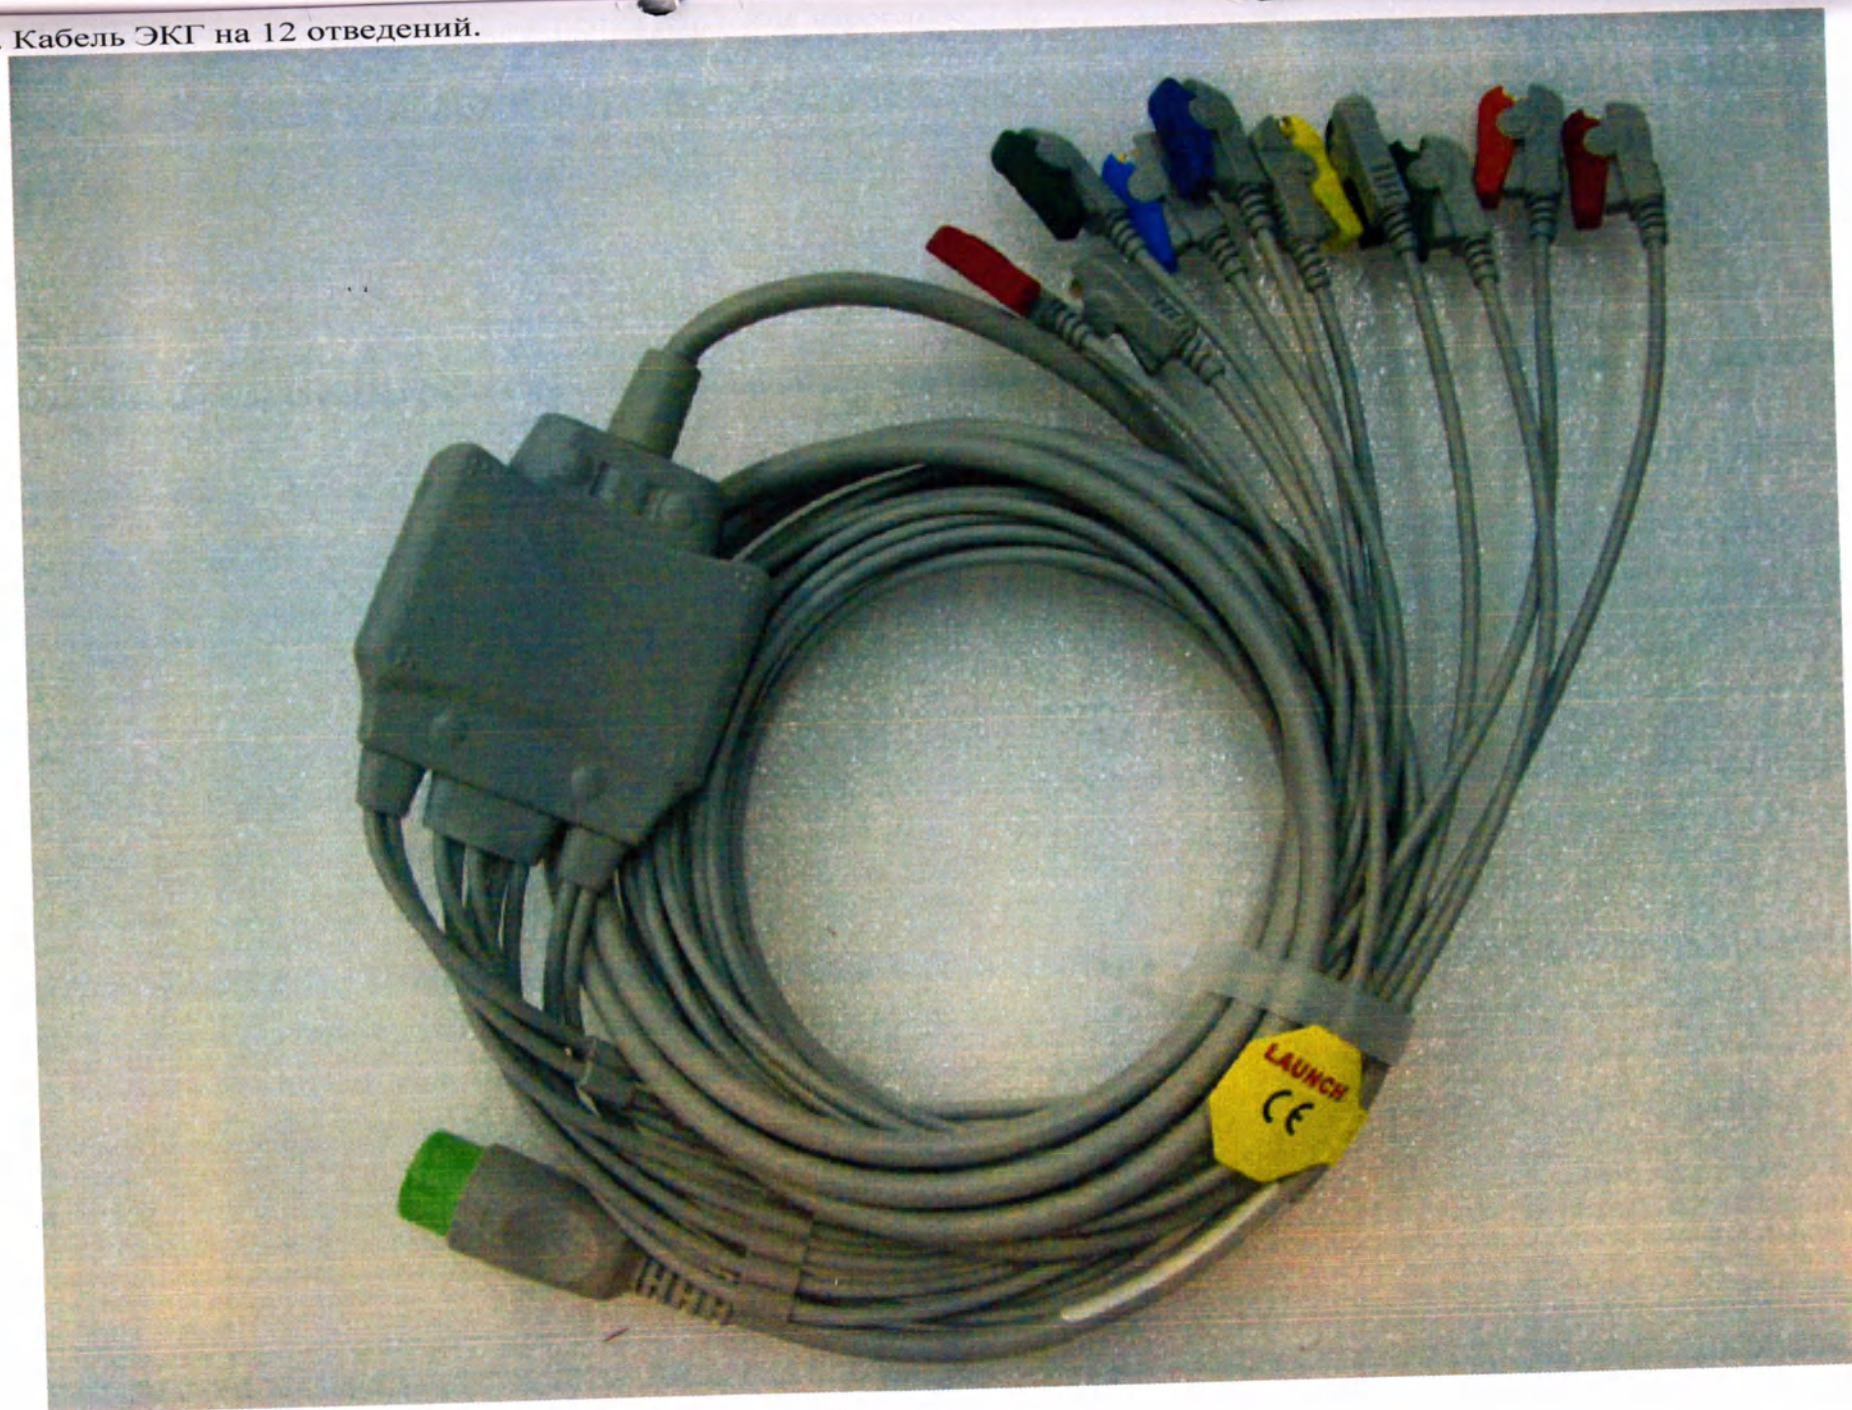


Фото 5. Манжета для неинвазивного измерения давления взрослых.



Фото 6. Манжета для неинвазивного измерения давления детей.



Фото 7. Манжета для неинвазивного измерения давления новорожденных.



Фото 8. Датчик температуры тела



Фото 9. Датчик содержания кислорода в крови



Фото 10. Датчика ИАД



Фото 11. Датчик CO₂

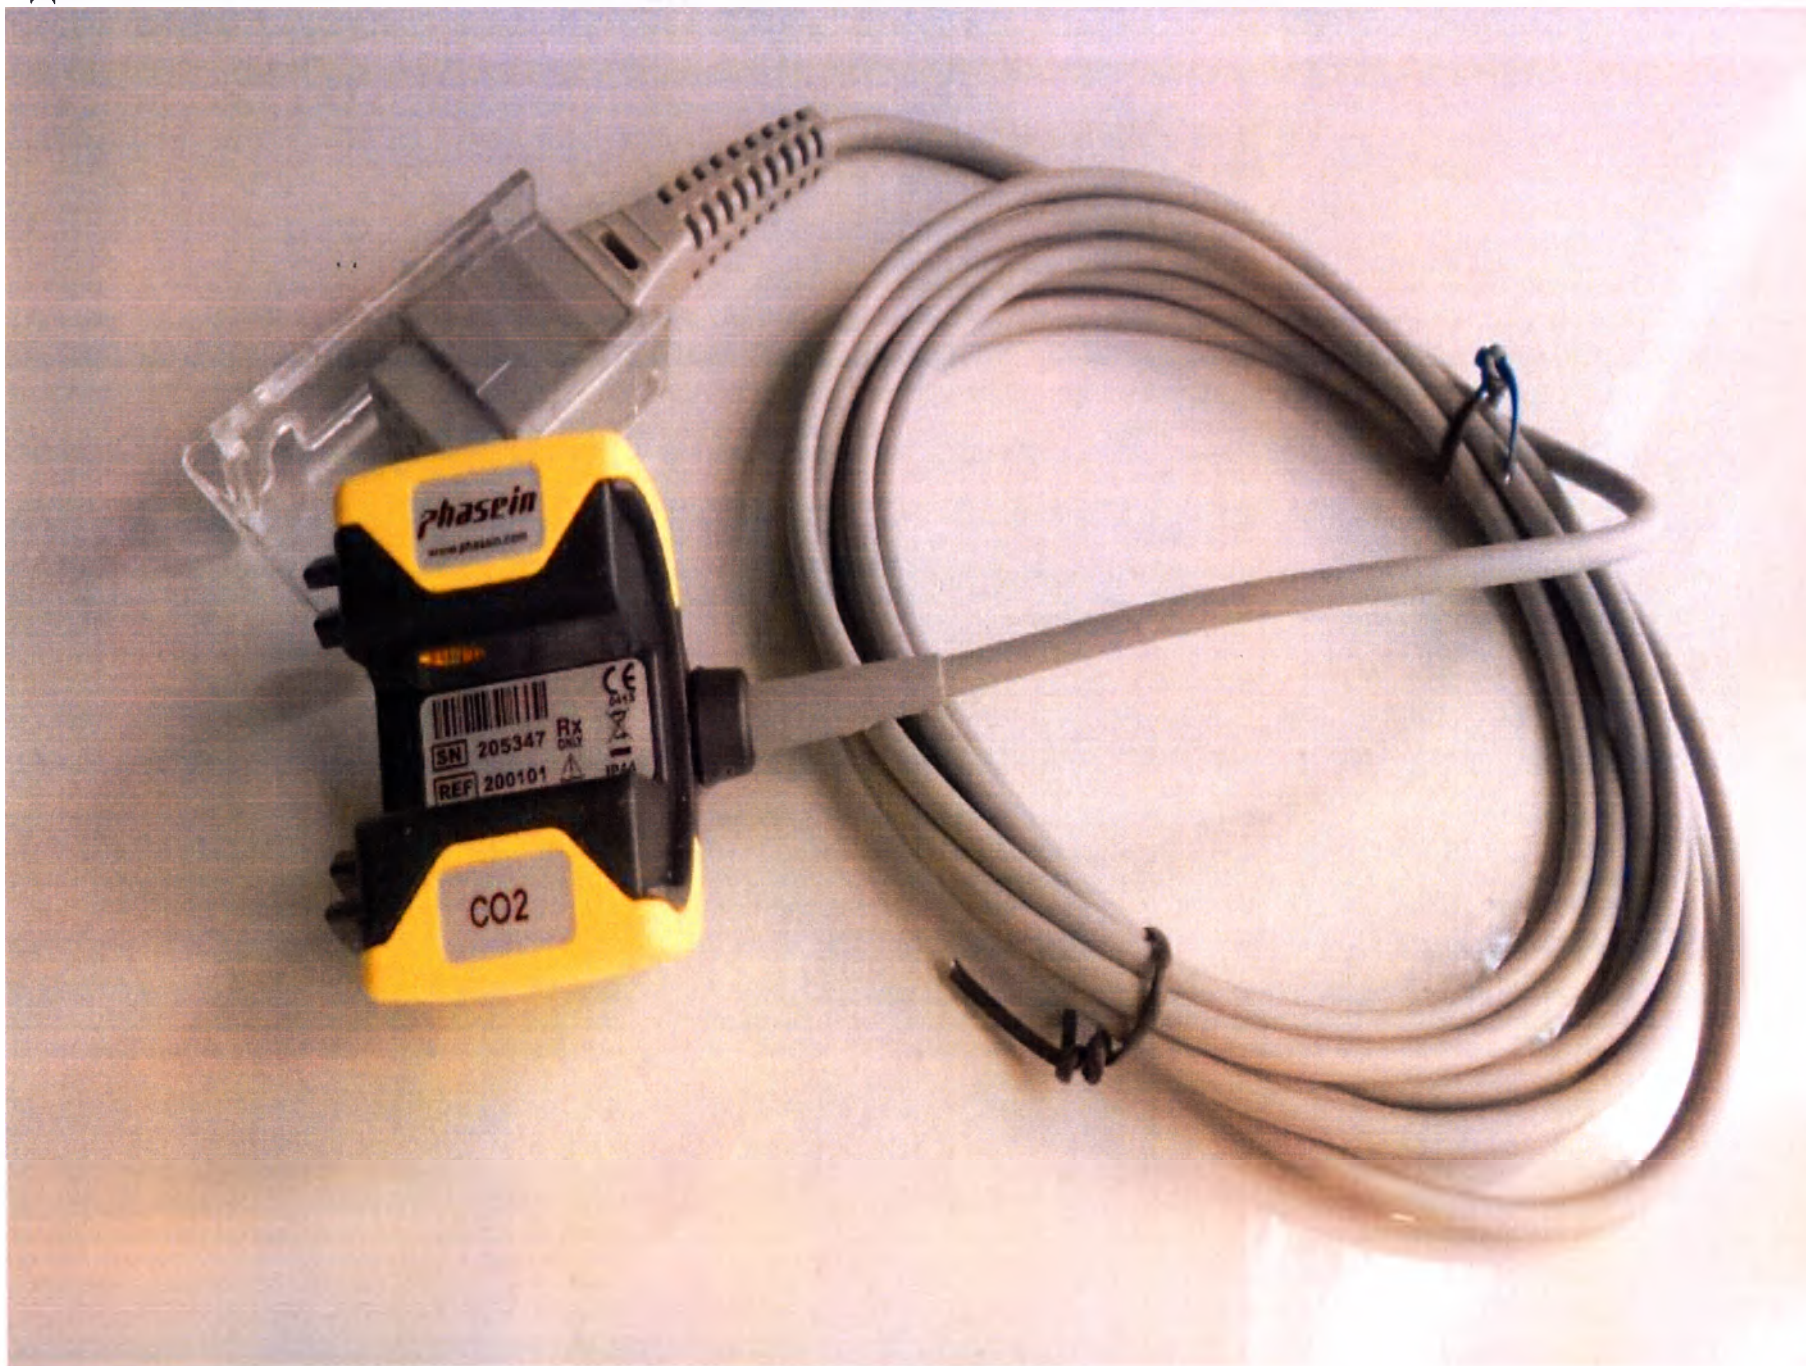


Фото 12. Датчик неинвазивного определения сердечного выброса.



Фото 13. Датчик температуры введенной жидкости для инвазивного определения сердечного выброса



Фото 14. Датчик глубины наркоза

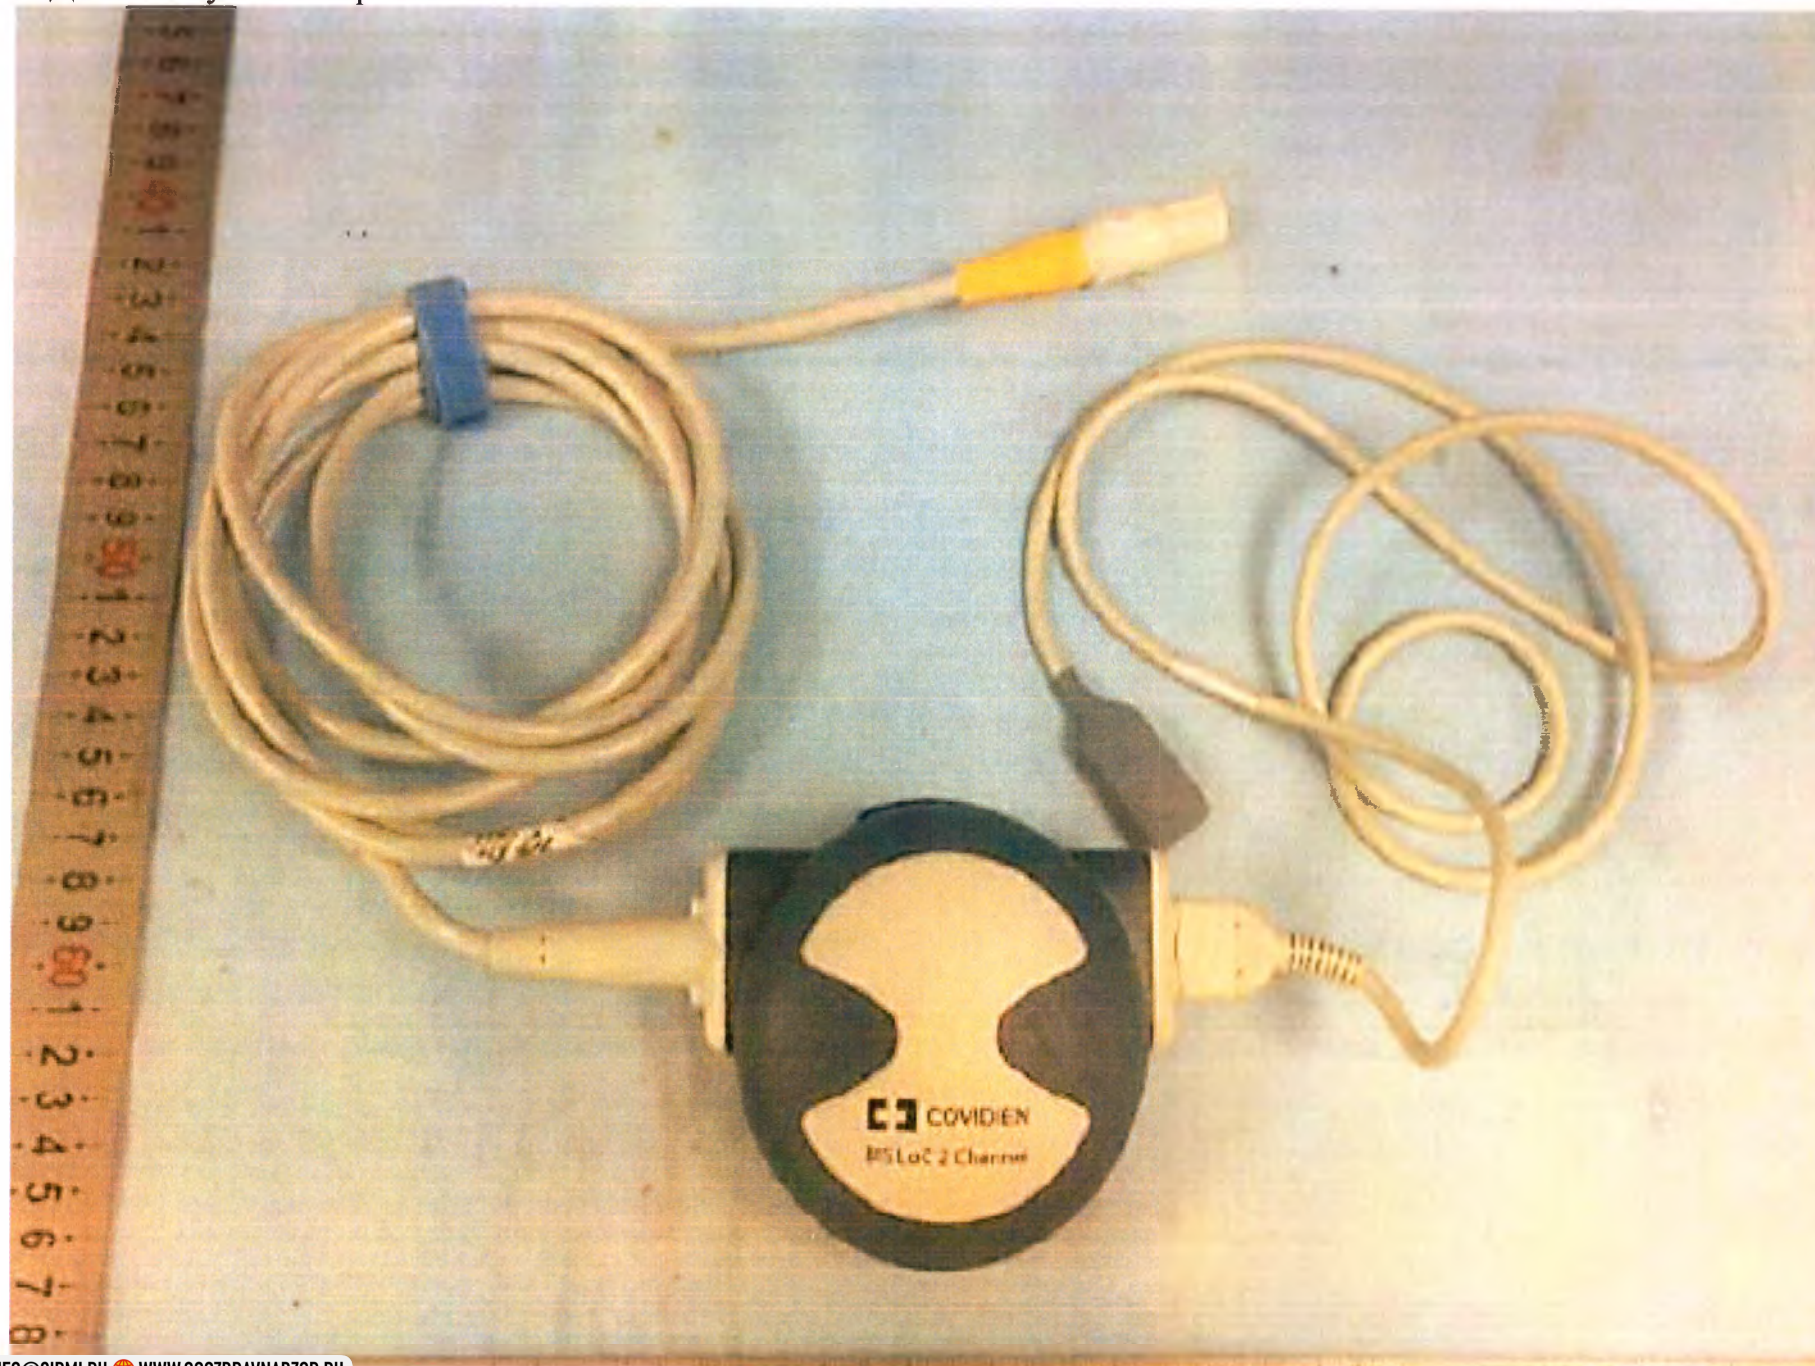


Фото 15. Кабель питающий



Фото 16. Электрод неинвазивного определения сердечного выброса.

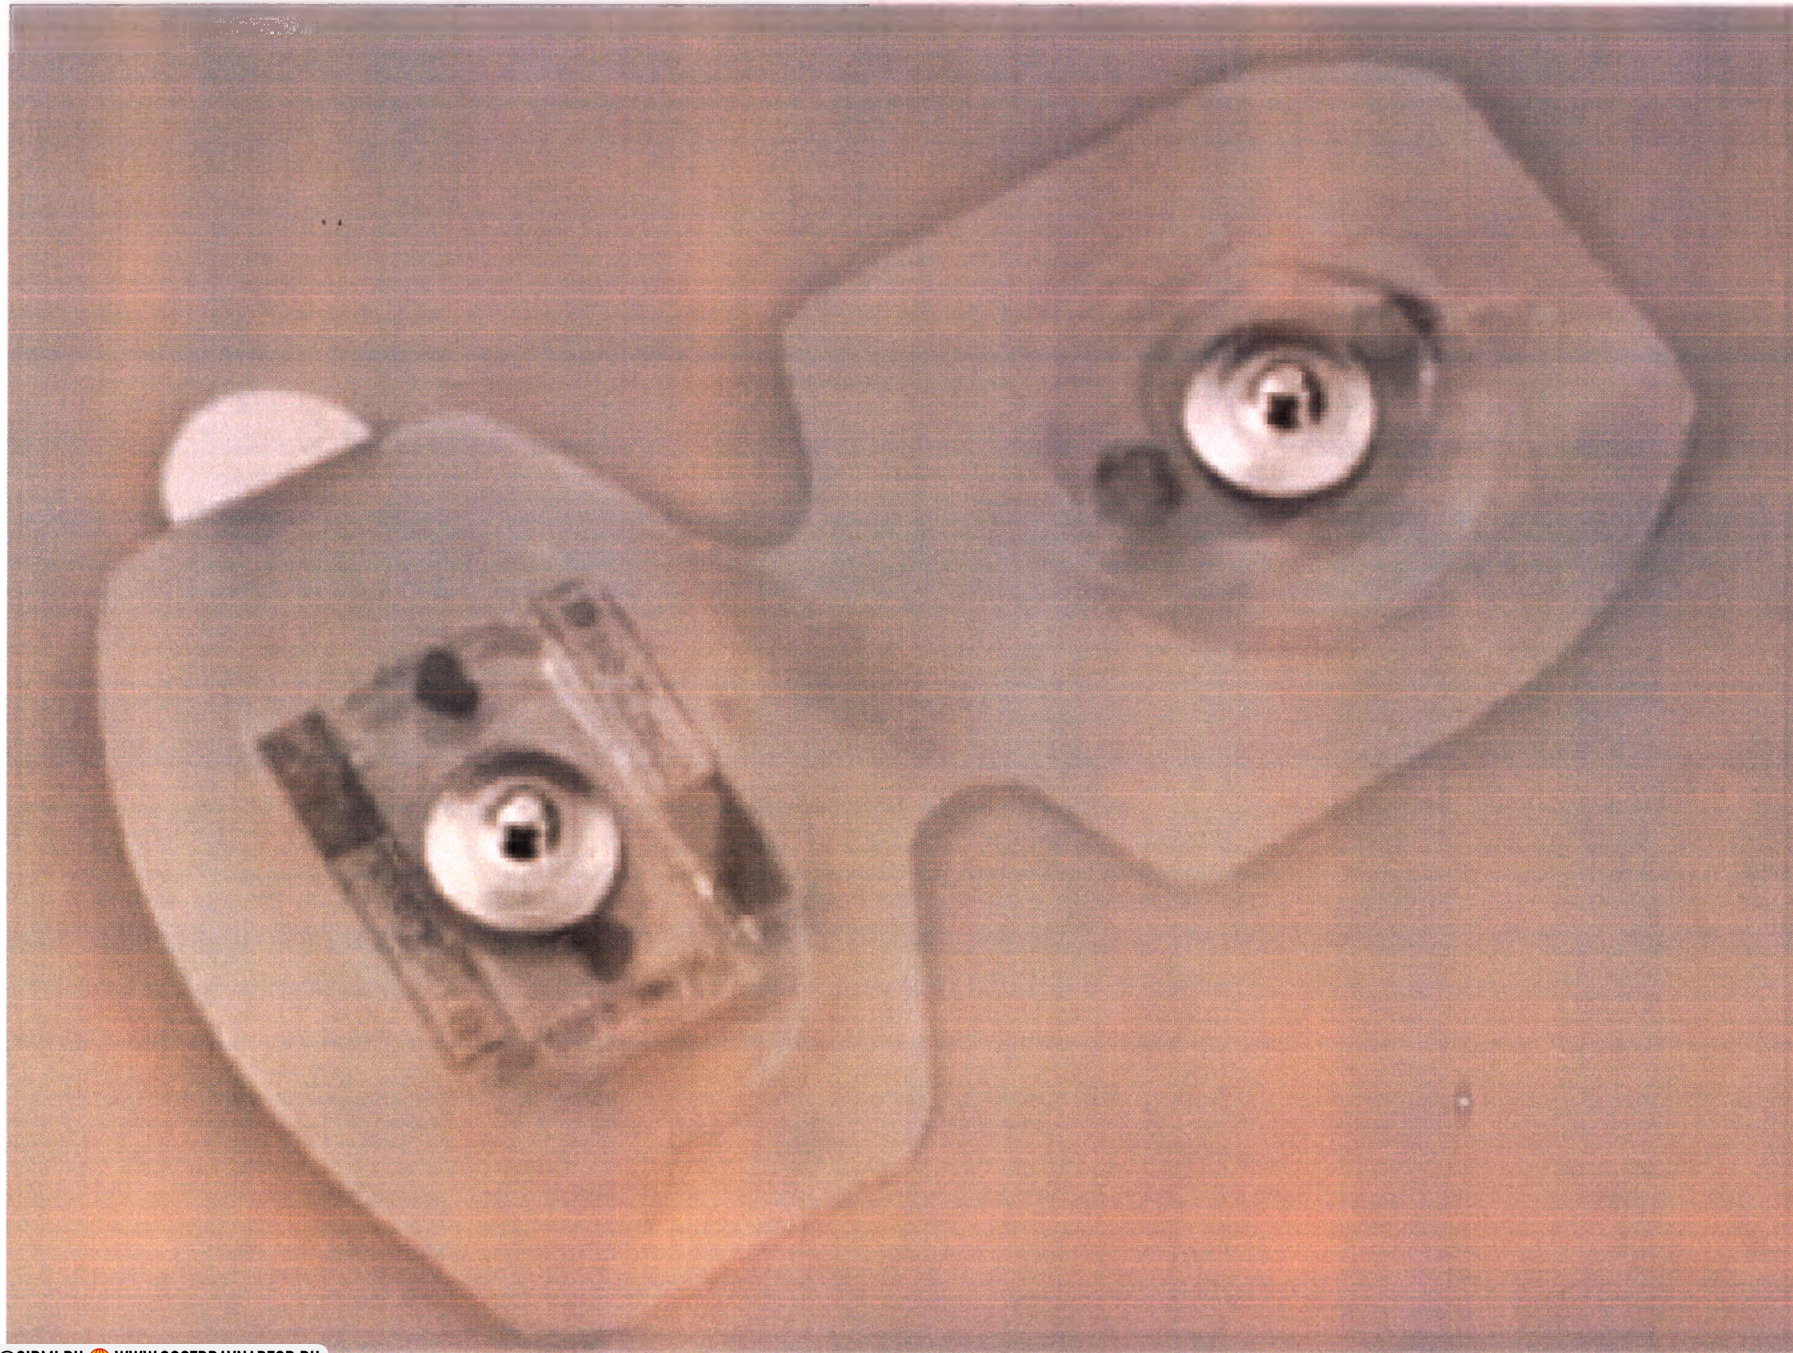


Фото 17. Электроды ЭКГ для взрослых

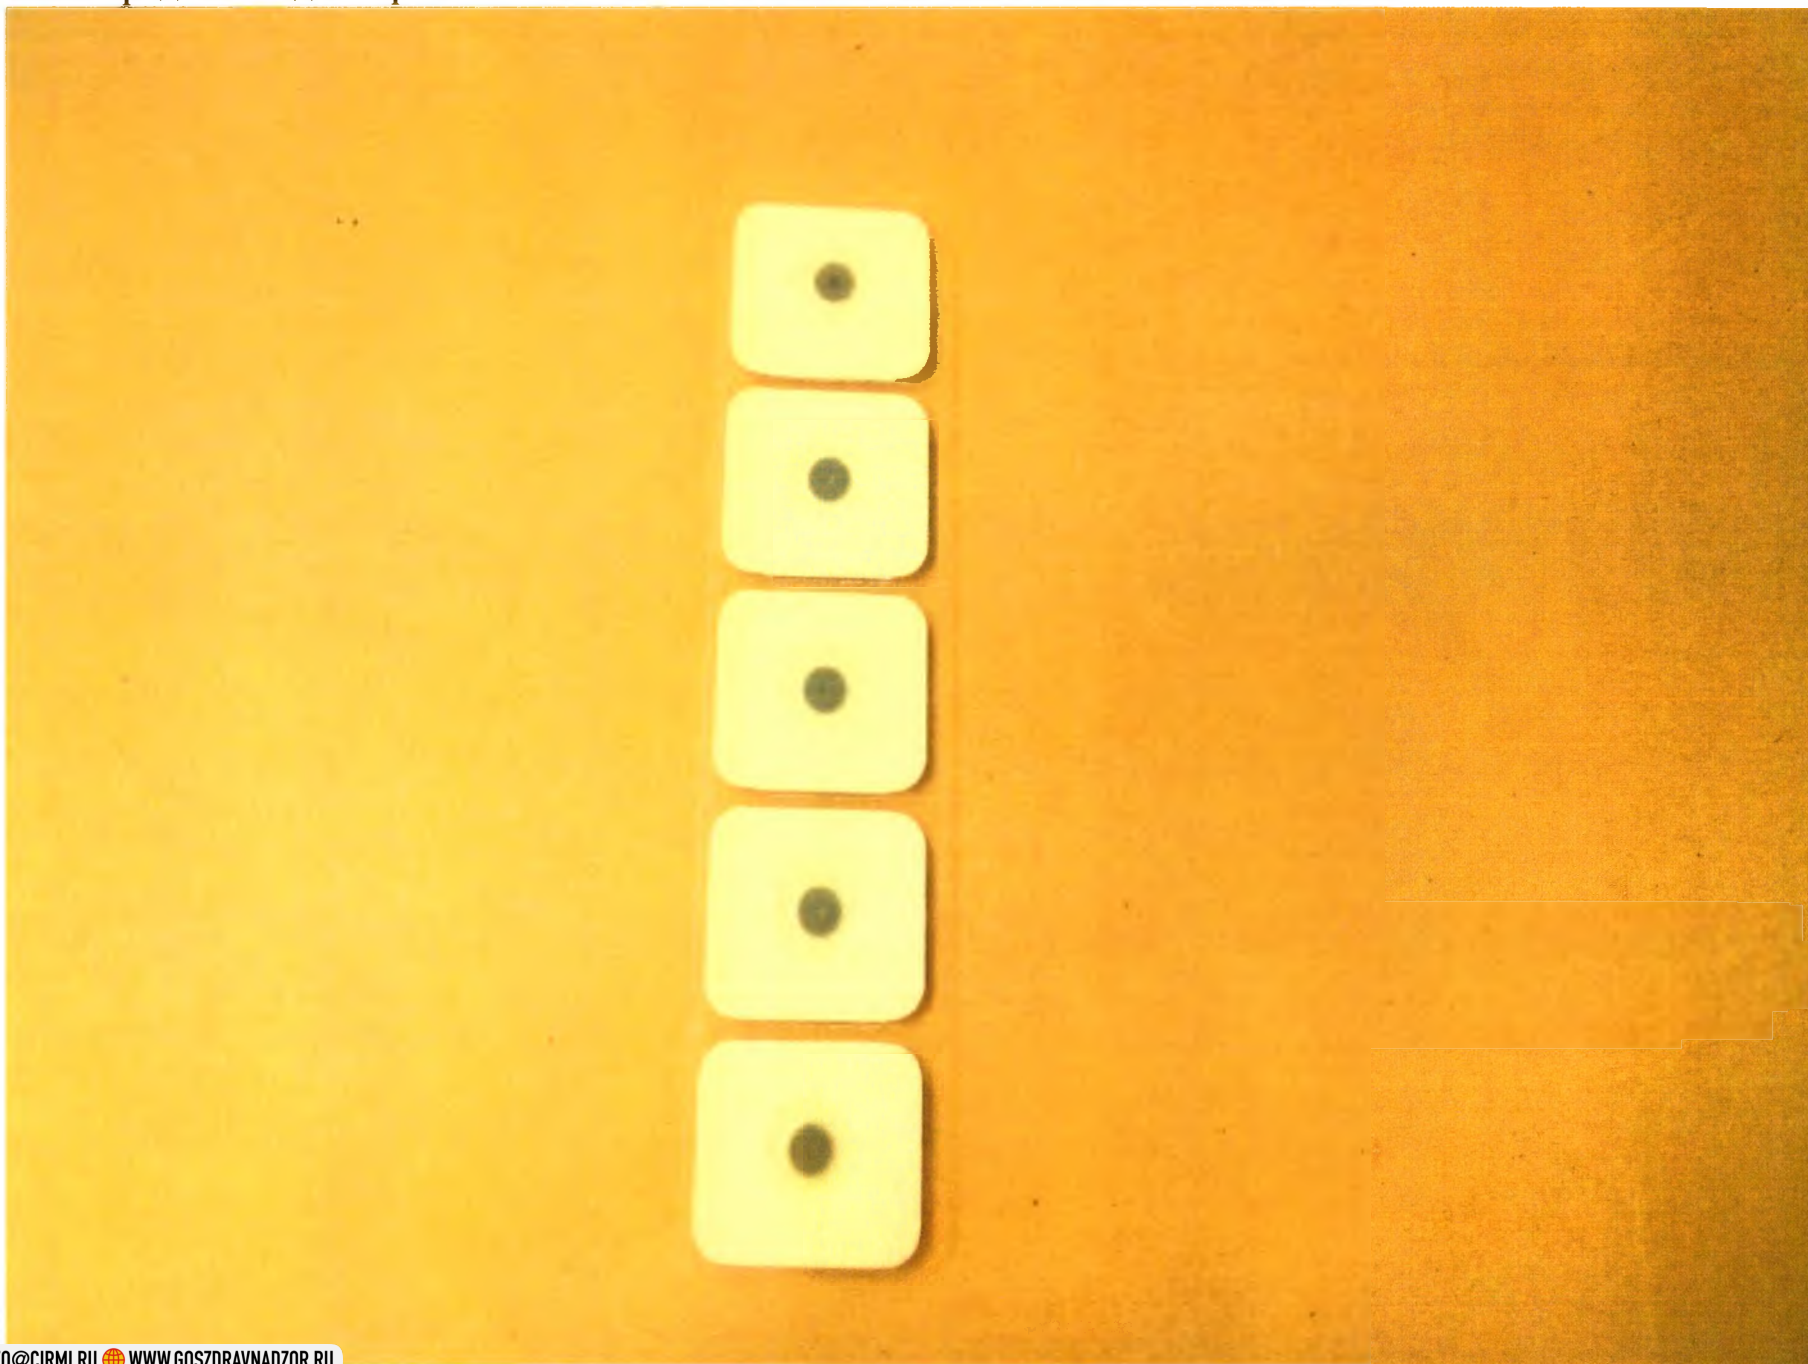


Фото 18. Электроды ЭКГ для детей


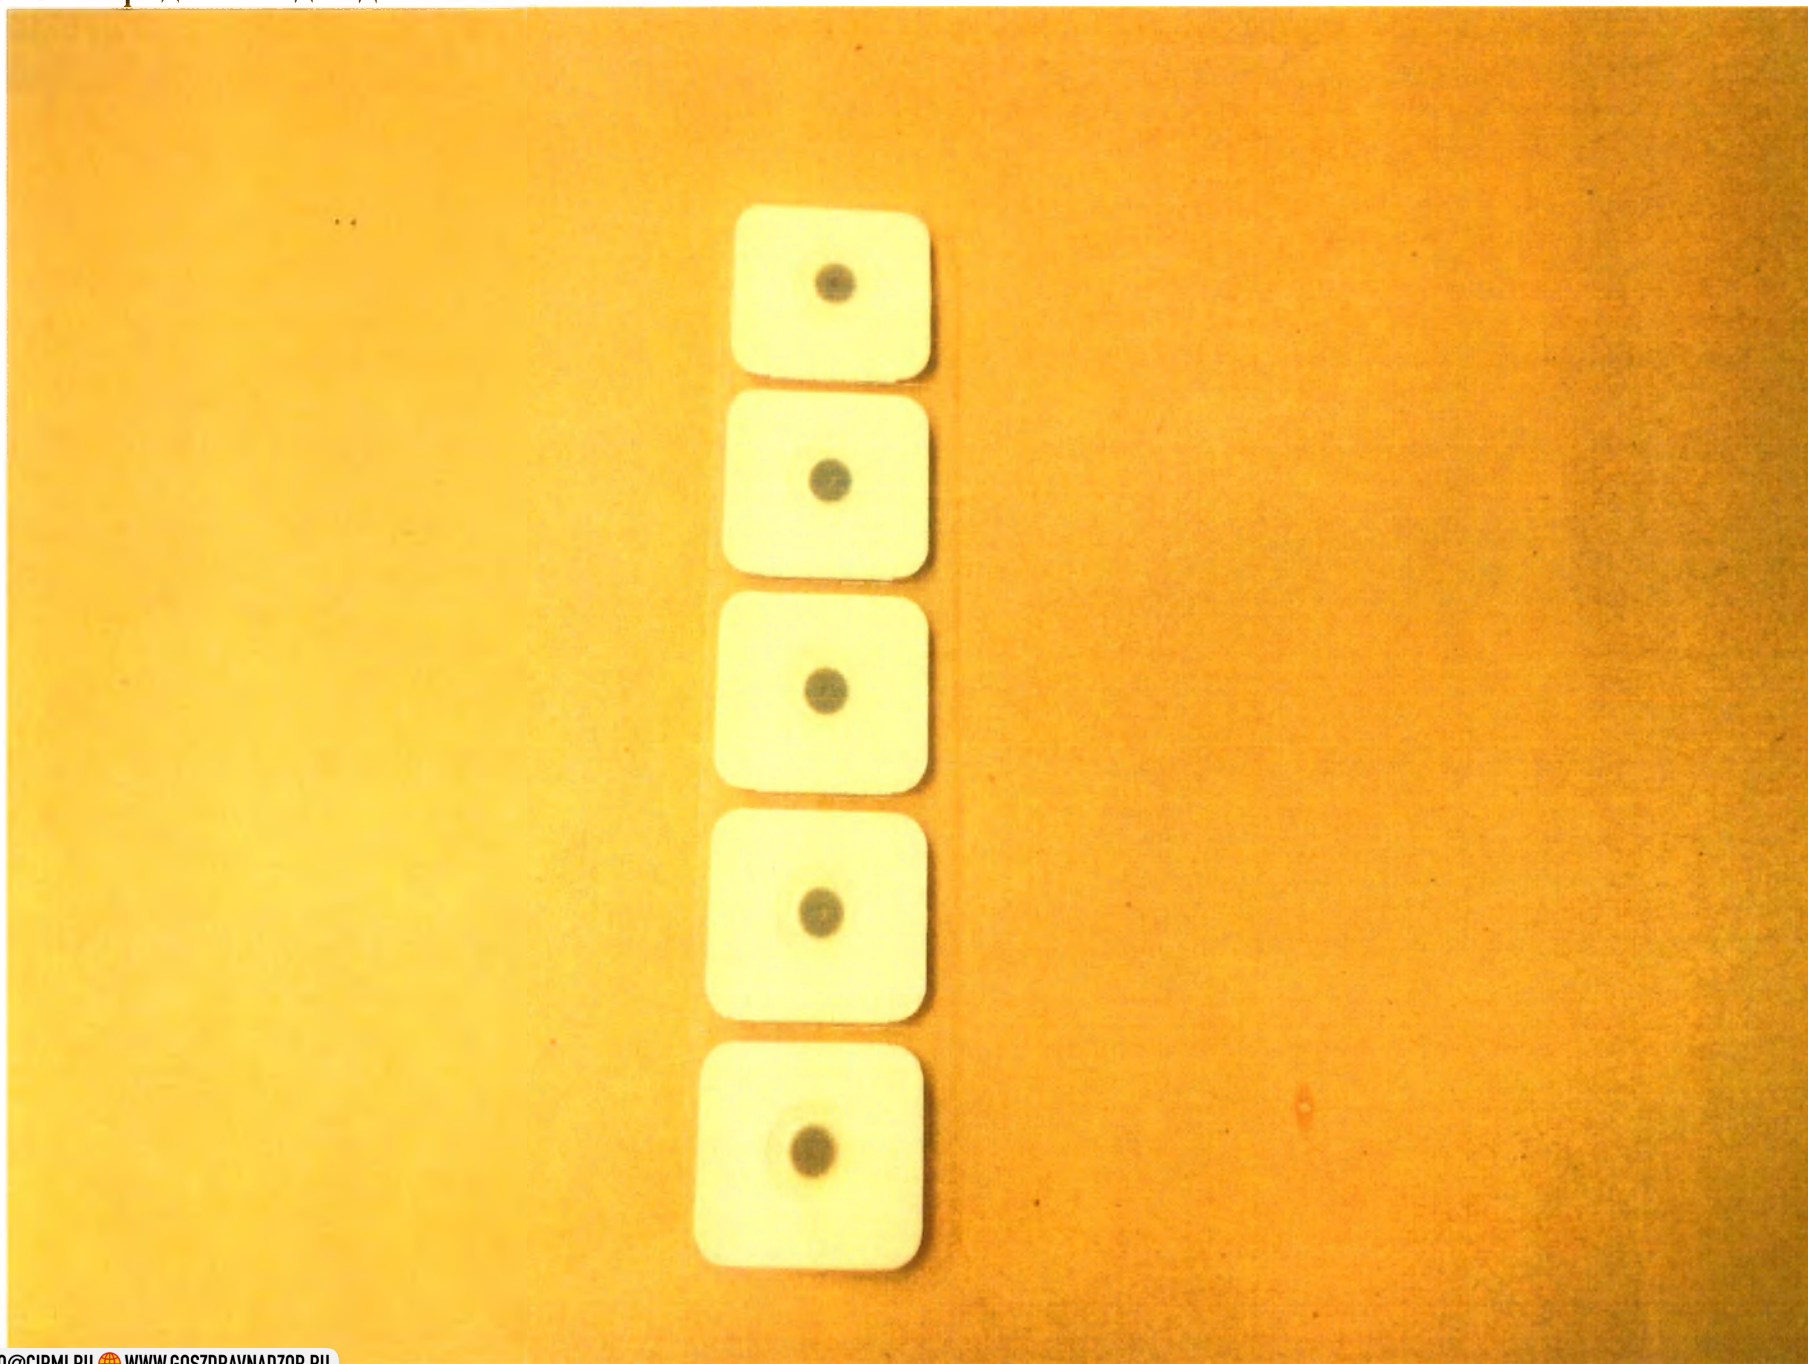


Фото 19. Электрод ЭКГ для новорожденных.



Фото 20. Анализатор модуля анестезии.

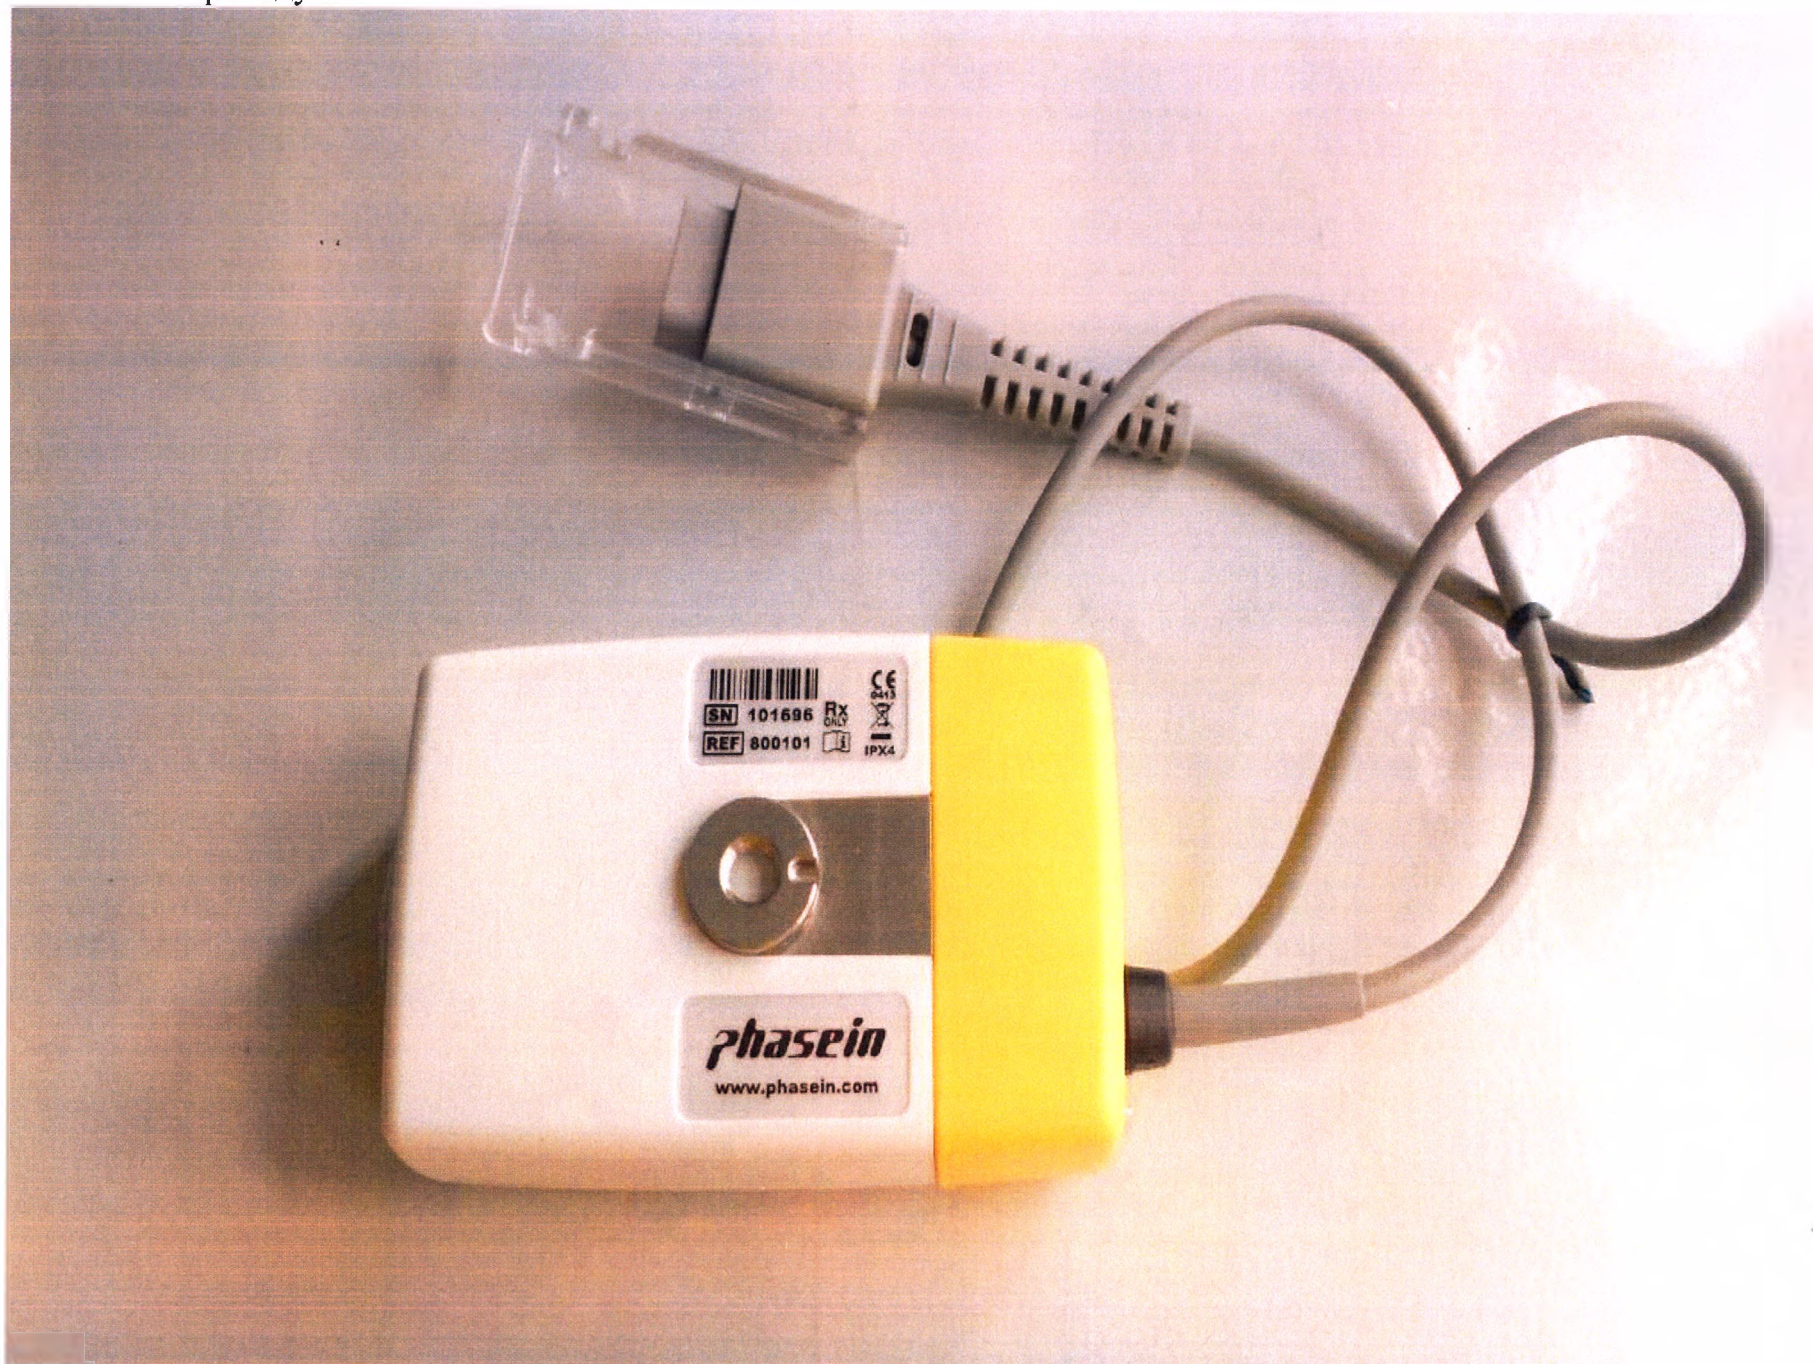

Прошнуровано и пронумеровано

Кол-во стр. 22

Генеральный директор

ООО «КоменМед»

Терликов А.В.

Дата: 03.08.18

