

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
качественного и полуколичественного определения антител класса IgG к
цитомегаловирусу иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме
крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "CMV антитела IgG
Контрольные материалы (Alinity i CMV IgG Controls)"**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

CMV IgG Ctrls




www.abbottdiagnostics.com/IFU

R01




07P4210



Exp.

2018-02-16



74069FN00



G70160R02

(01) 00380740129781 (17) 180216


(10) 74069FN00 (240) 07P4210

Фотографическое изображение открытой упаковки CMV антитела IgG Контрольные материалы (Alinity i CMV IgG Controls)





Фотографическое изображение флаконов CMV антитела IgG Контрольные материалы (Alinity i CMV IgG Controls)

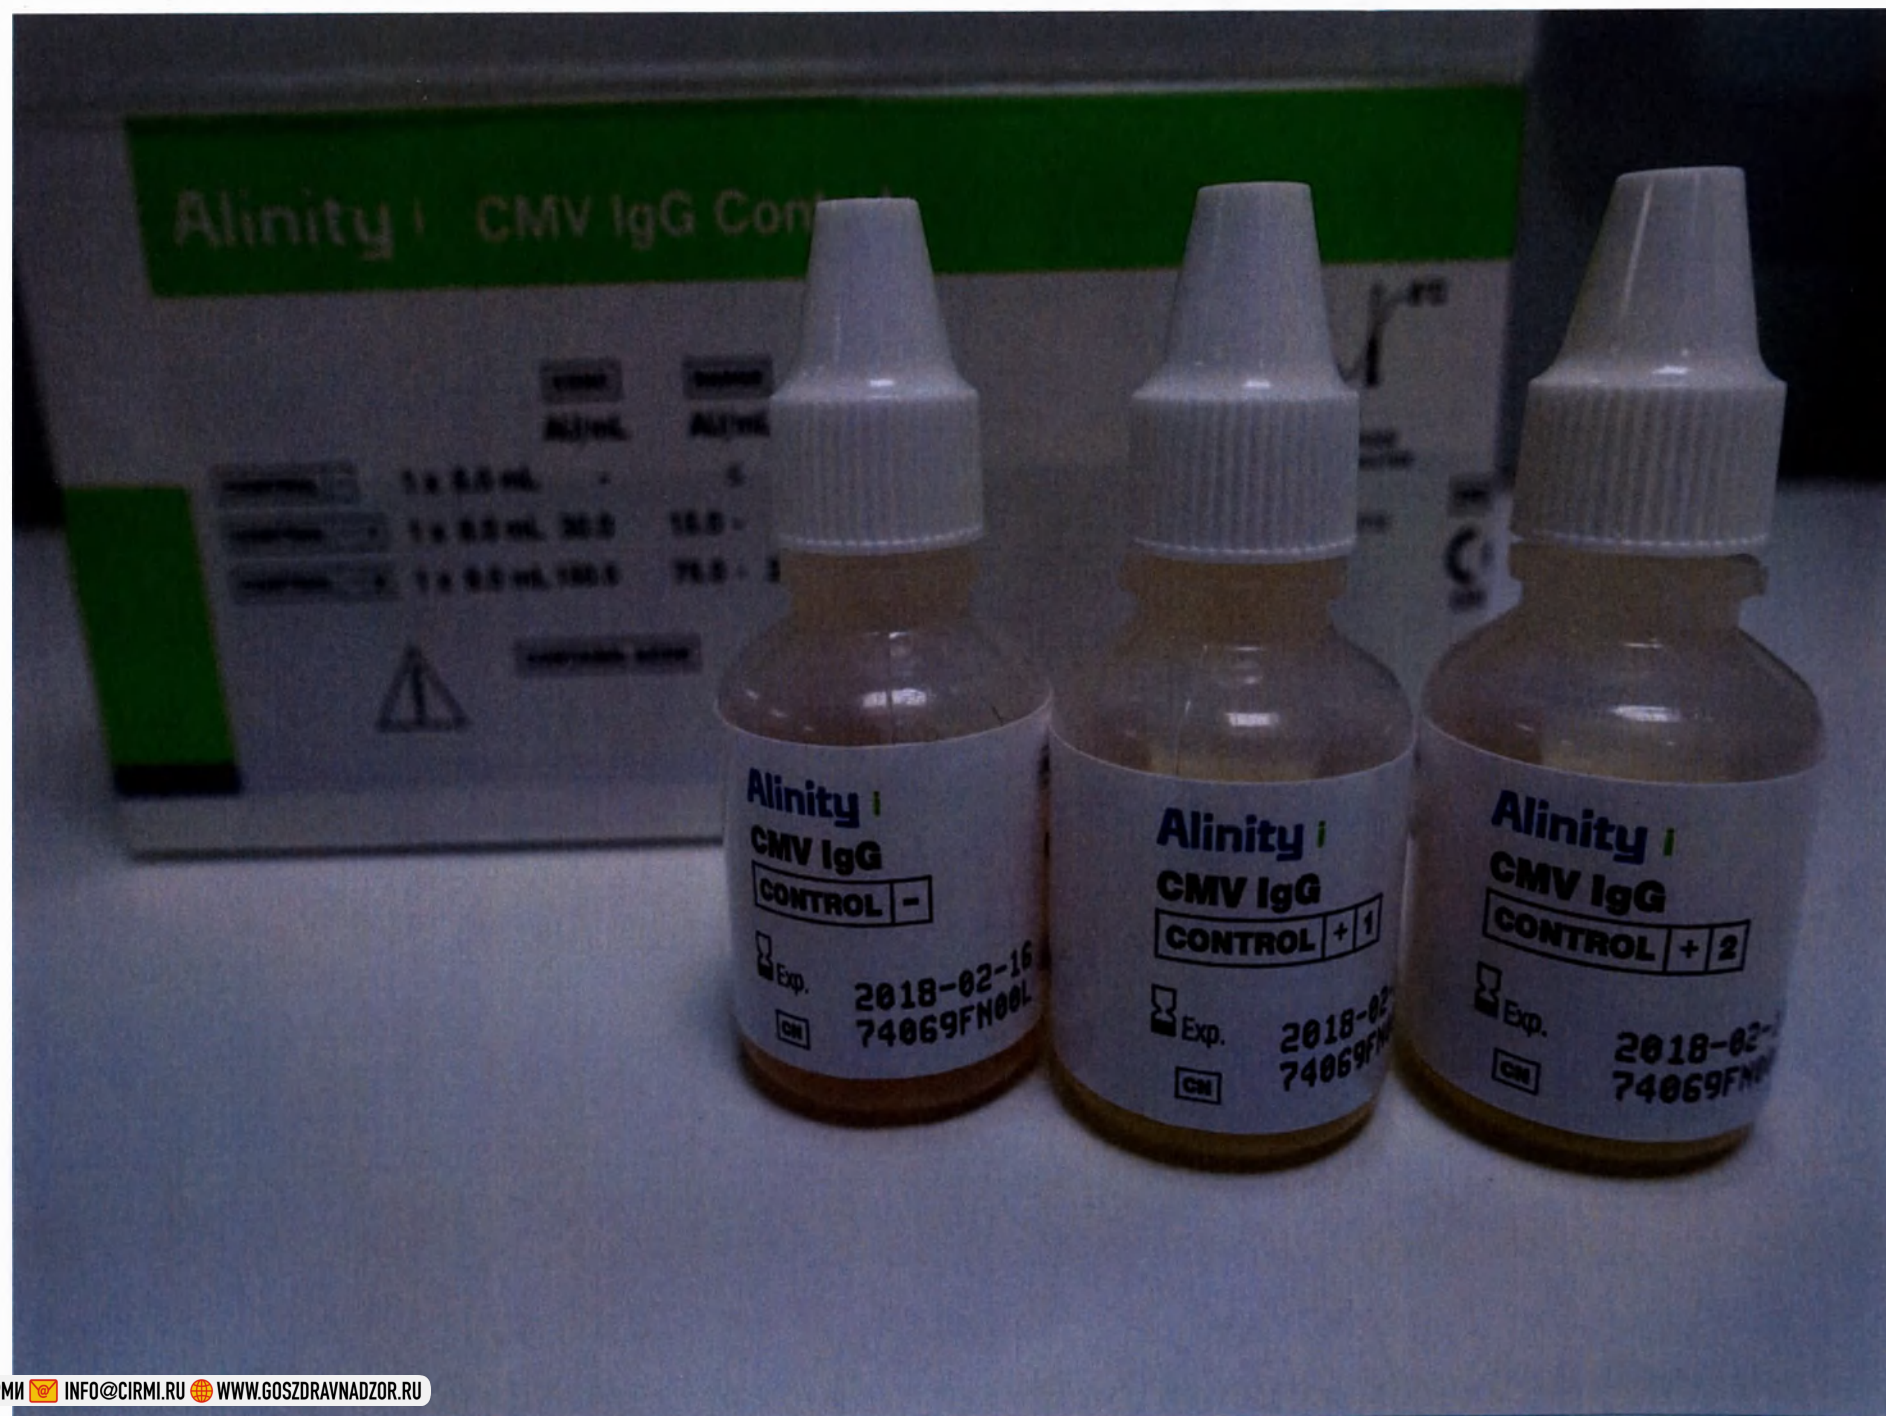

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью


31 лист листов



Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
качественного и полуколичественного определения антител класса IgG к
цитомегаловирусу иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме
крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "CMV антитела IgG
Контрольные материалы (Alinity i CMV IgG Controls)"**

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия





Alinity i
CMV IgG
CONTROL -

Exp.

CN

07P42L
 8.0 mL
 670173R01

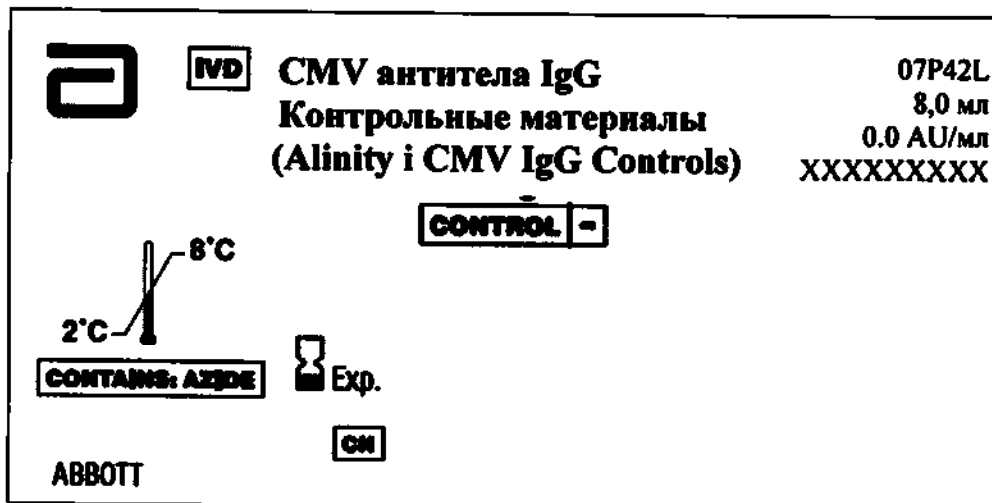


Alinity i
CMV IgG
CONTROL + 1

Exp.

CN

07P42M
 8.0 mL
 30.0 AU/mL
 670174R01

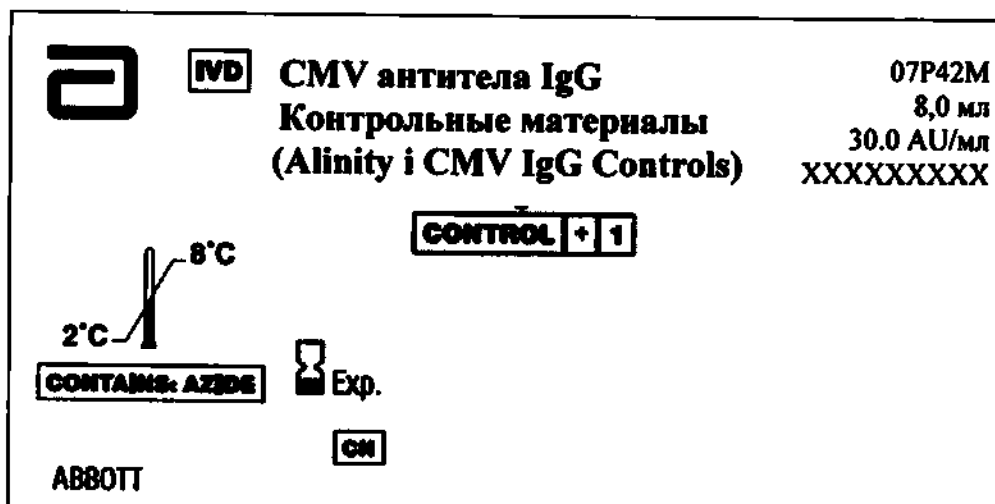



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

Alinity i
CMV IgG

CONTROL + 2



CN


07P42N
8.0 mL
150.0 AU/mL
G70175R01



CMV антитела IgG
Контрольные материалы
(Alinity i CMV IgG Controls)

07P42N
8,0 мл
150.0 AU/мл
XXXXXXXXXX

CONTROL + 2



CONTAINS: AZIDE



CN

ABBOTT

всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
7/8 листов

