

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности качественного и полуколичественного определения антител класса IgG к цитомегаловирусу иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "CMV антитела IgG Калибраторы (Alinity i CMV IgG Calibrators)"

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i CMV IgG Calibrators

 Abbott

CONC
AU/mL



CONTAINS: AZIDE

CAL A	1 x 3.0 mL	0
CAL B	1 x 3.0 mL	10.0
CAL C	1 x 3.0 mL	50.0
CAL D	1 x 3.0 mL	75.0
CAL E	1 x 3.0 mL	125.0
CAL F	1 x 3.0 mL	250.0




www.abbottdiagnostics.com/IFU

R02

REF

07P4201



Exp.


2018-06-20

LOT

78157FN00



G70159R02



(01) 00380740129774 (17) 180620

(10) 78157FN00 (240) 07P4201 (91) CMV IgG

Фотографическое изображение открытой упаковки CMV антитела IgG Калибраторы (Alinity i CMV IgG Calibrators)



Фотографическое изображение упаковки и флаконов CMV антитела IgG Калибраторы (Alinity i CMV IgG Calibrators)



Фотографическое изображение флаконов CMV антитела IgG Калибраторы (Alinity i CMV IgG Calibrators)



всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

311 листов листов



Подпись

Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности качественного и
полуколичественного определения антител класса IgG к цитомегаловирусу
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "CMV антитела IgG Калибраторы"
(Alinity i CMV IgG Calibrators)"**



REF

07P42-01

IVD



Калибраторы для обеспечения правильности качественного и полуколичественного определения антител класса IgG к цитомегаловирусу иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

"CMV антитела IgG Калибраторы (Alinity i CMV IgG Calibrators)"

В составе:

- Калибратор А (Alinity i CMV IgG Calibrator A) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор В (Alinity i CMV IgG Calibrator B) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор С (Alinity i CMV IgG Calibrator C) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор D (Alinity i CMV IgG Calibrator D) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор E (Alinity i CMV IgG Calibrator E) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор F (Alinity i CMV IgG Calibrator F) – 1 x 3,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland (Ирландия) / РУ № _____ / _____ от ____./____./____./


Инструкцию по применению на русском языке см:

www.abbottdiagnostics.com/IFU




Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют/
Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз»,
125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

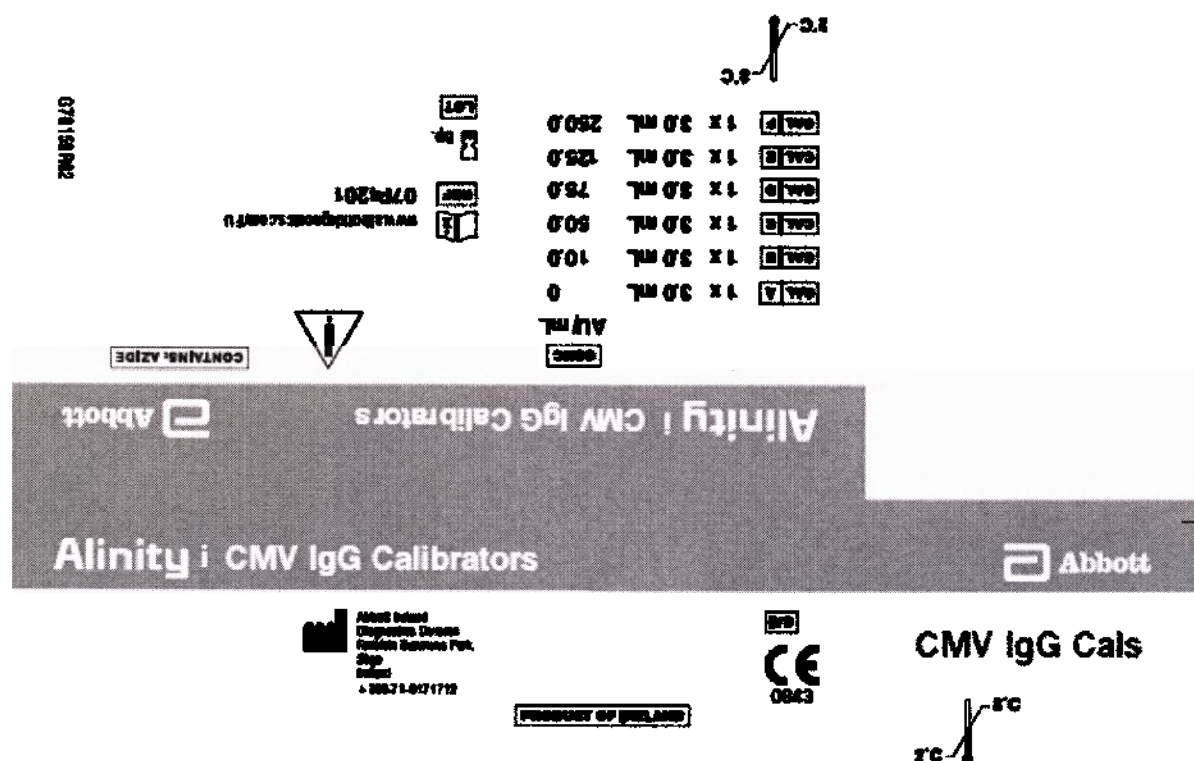

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

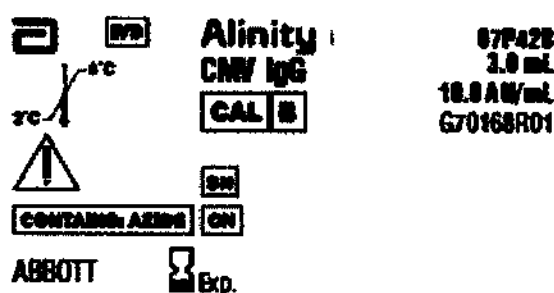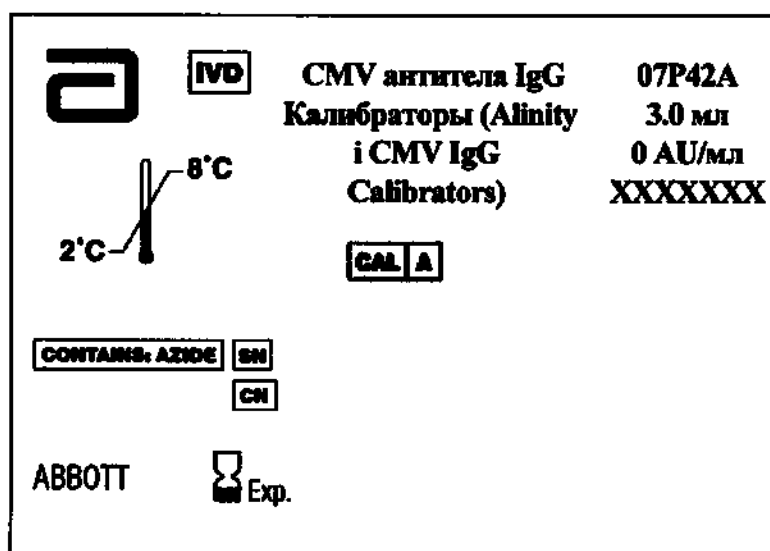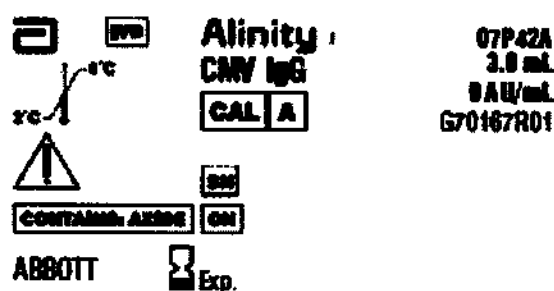



IVD

CMV антитела IgG

Калибраторы (Alinity i CMV IgG Calibrators)


CAL B

07P42B

3.0 мл

10.0 AU/мл

XXXXXXX



CONTAINS: AZIDE

SN

CN

ABBOTT

Exp.



IVD

Alinity i CMV IgG

CAL C

07P42C

3.0 мл

50.0 AU/мл

G7D169R01



CONTAINS: AZIDE

SN

CN

ABBOTT

Exp.



IVD

CMV антитела IgG

Калибраторы (Alinity i CMV IgG Calibrators)

CAL C

07P42C

3.0 мл

50.0 AU/мл

XXXXXXX



CONTAINS: AZIDE

SN


CN

ABBOTT

Exp.



Alinity i
CMV IgG
 





 
CONTAINS: AZIDE

ABBOTT  Exp.

07P42D
 3.0 mL
 75.0 AU/mL
 G70170R01



CMV антитела IgG
Калибраторы (Alinity i CMV IgG Calibrators)
 





 
CONTAINS: AZIDE

ABBOTT  Exp.

07P42D
 3.0 мл
 75.0 AU/мл
 XXXXXXXX



Alinity i
CMV IgG
 




 
CONTAINS: AZIDE

ABBOTT  Exp.

07P42E
 3.0 mL
 125.0 AU/mL
 G70171R01



CMV антитела IgG
Калибраторы (Alinity i CMV IgG Calibrators)
 





 
CONTAINS: AZIDE

ABBOTT  Exp.

07P42E
 3.0 мл
 125.0 AU/мл
 XXXXXXXX



Alinity
CMV IgG
 








CONTAINS: AZIDE

ABBOTT
 **Exp.**

07P42F
3.0 mL
250.0 AU/mL
G70172R01



CMV антитела IgG
Калибраторы (Alinity
i CMV IgG
Calibrators)
 







CONTAINS: AZIDE

ABBOTT
 **Exp.**

07P42E
3.0 mL
250.0
AU/mL
XXXXXXXX

всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

5/шесть листов

