

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител класса IgM к цитомегаловирусу иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "CMV антитела IgM Калибратор (Alinity i CMV IgM Calibrator)"

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i CMV IgM Calibrator

 Abbott

CONC

INDEX

S/CO

CAL 1

1 x 3.0 mL

1.00



CONTAINS: AZIDE



www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF

07P4401

R01



Exp.


2018-01-21

LOT

78020FN00




G70189R02




(01) 00380740129859 (17) 180121

(10) 78020FN00 (240) 07P4401 (91) CMV IgM

Фотографическое изображение открытой упаковки CMV антитела IgM Калибратор (Alinity i CMV IgM Calibrator)

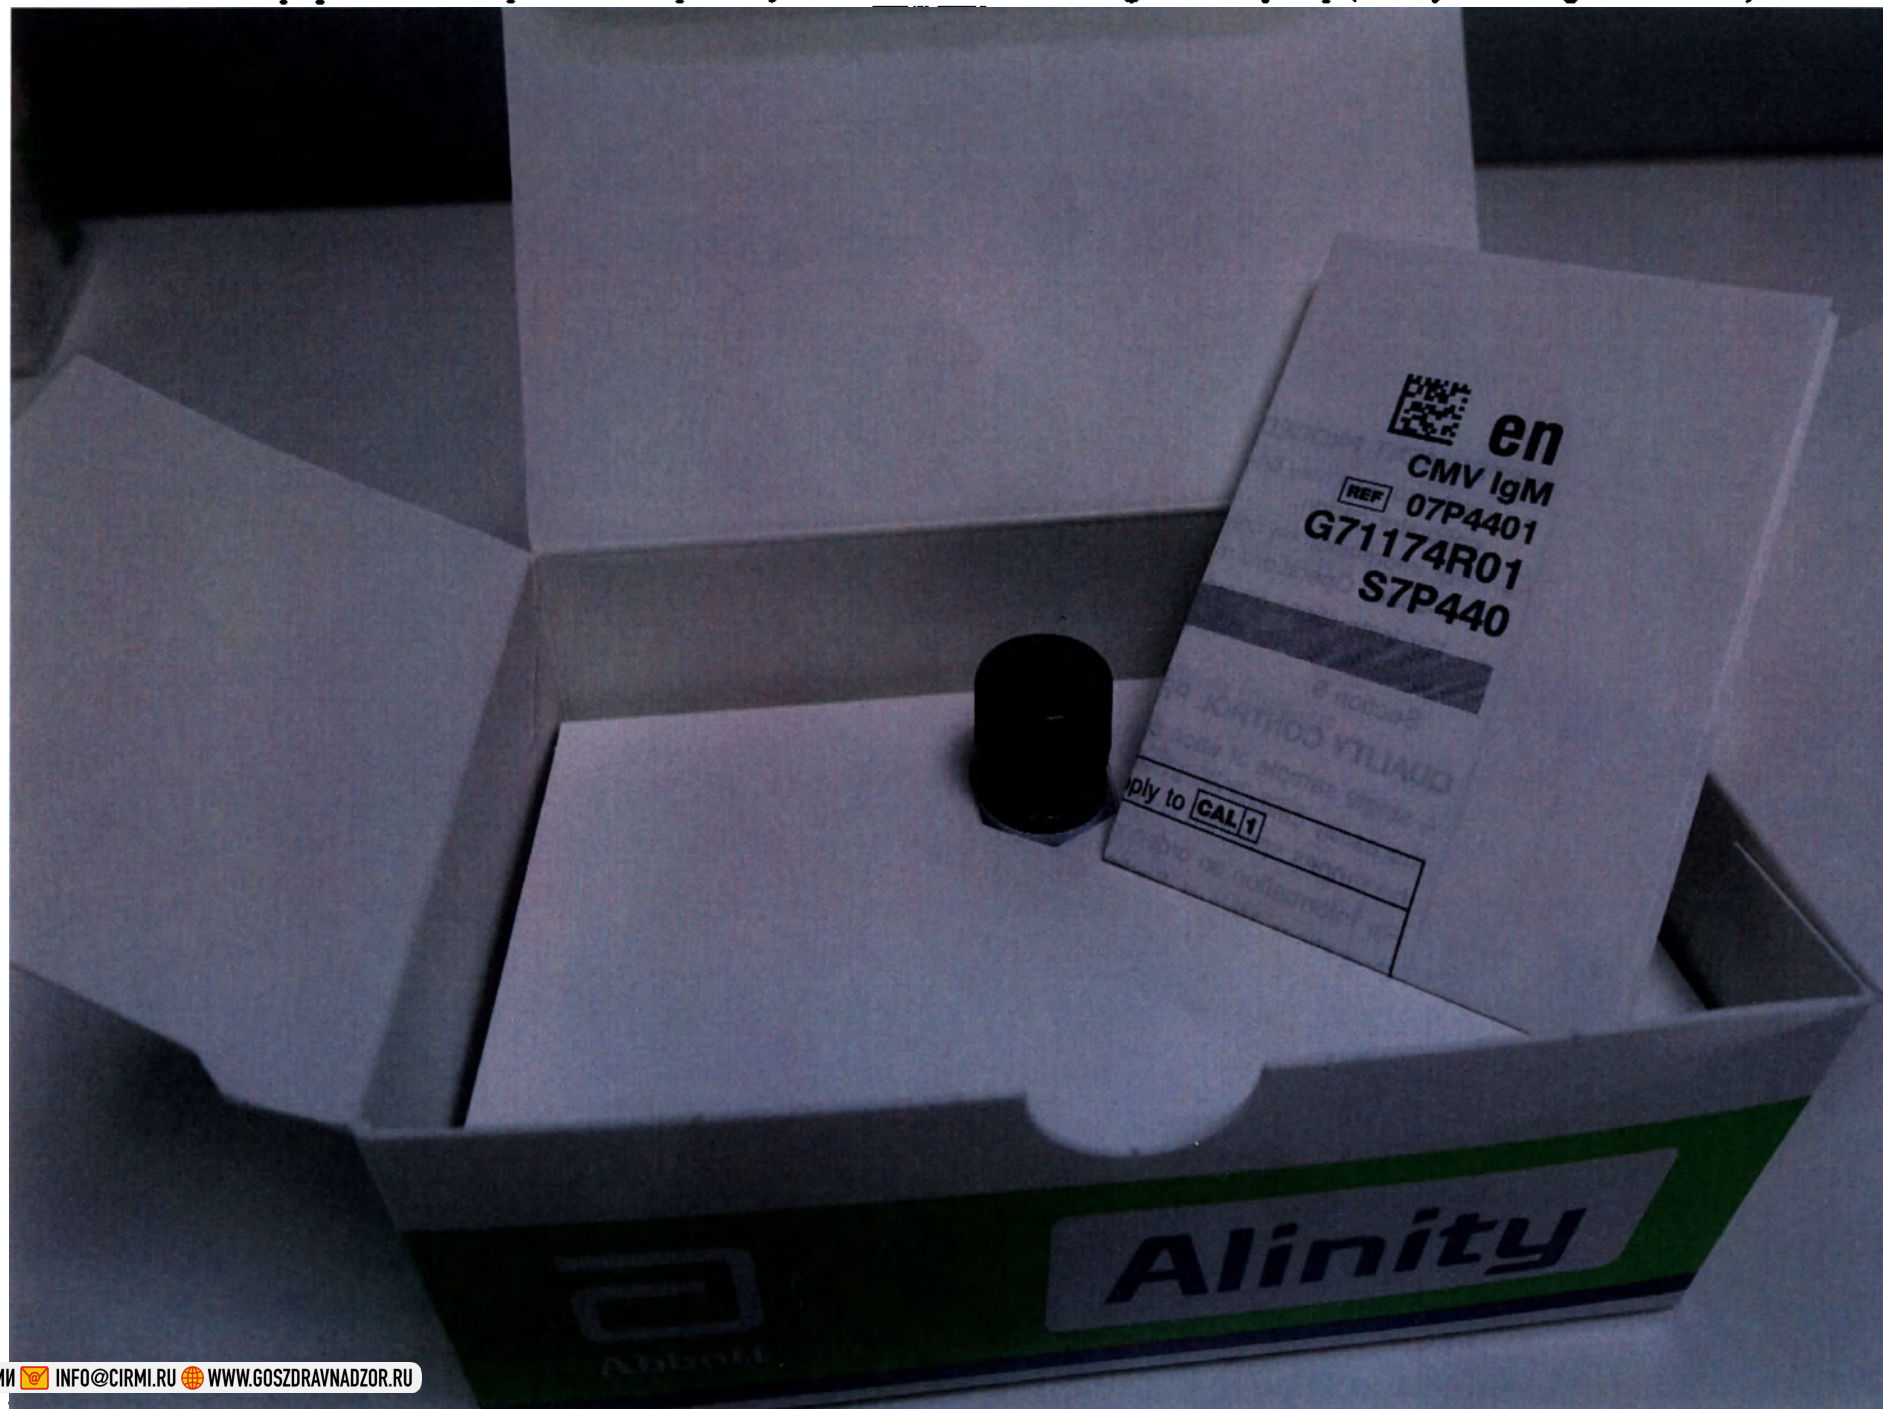

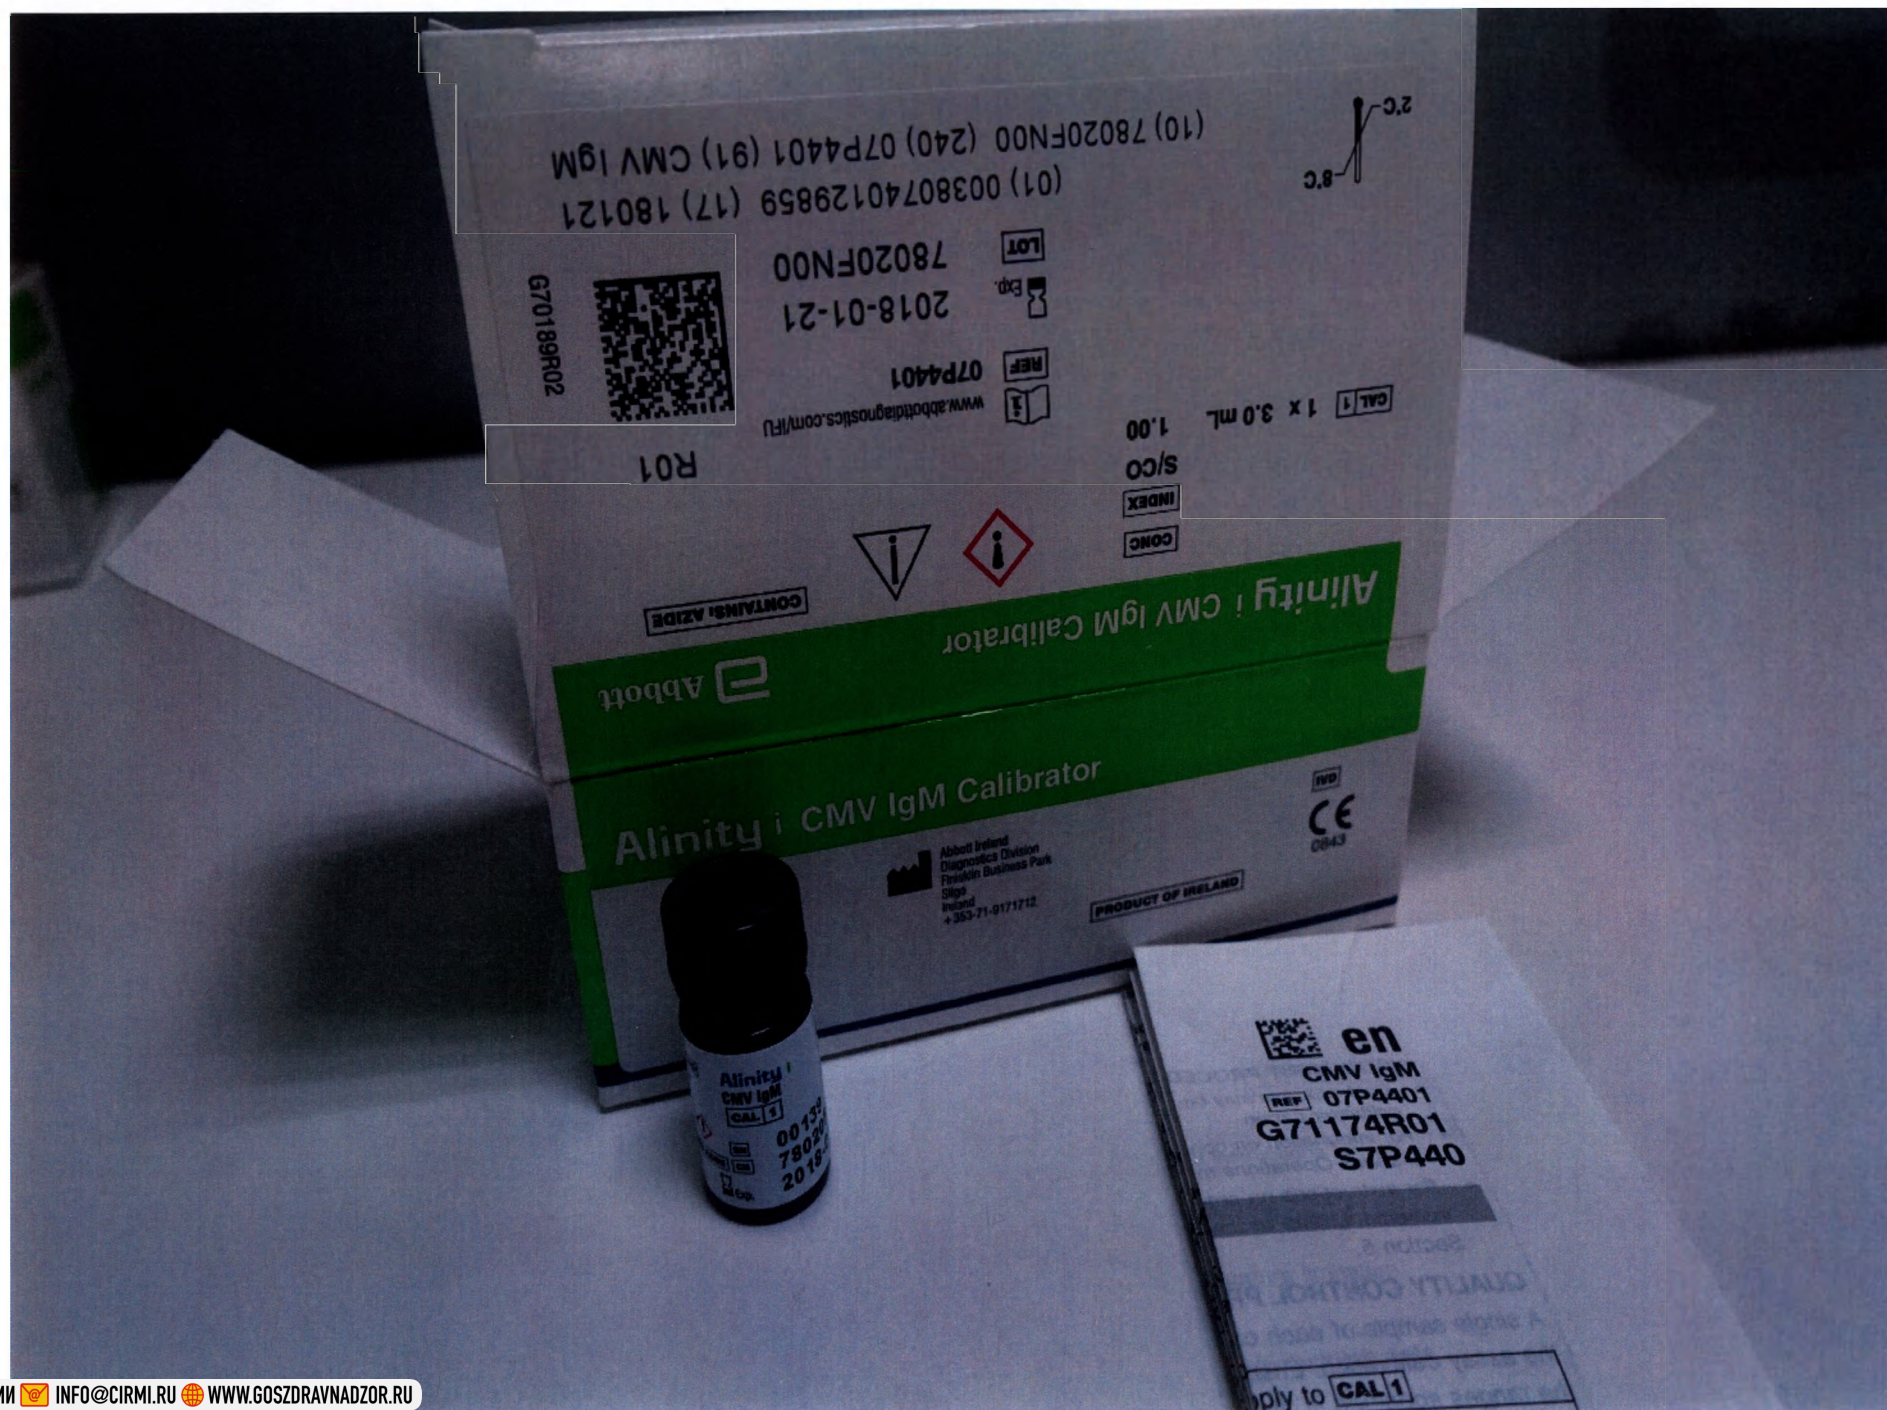

Фотографическое изображение флакона CMV антитела IgM Калибратор (Alinity i CMV IgM Calibrator)





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5/Метс листов



Макет маркировки на медицинское изделие

Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител класса IgM к цитомегаловирусу иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "CMV антитела IgM Калибратор (Alinity i CMV IgM Calibrator)"

Макет маркировки компонента медицинского изделия

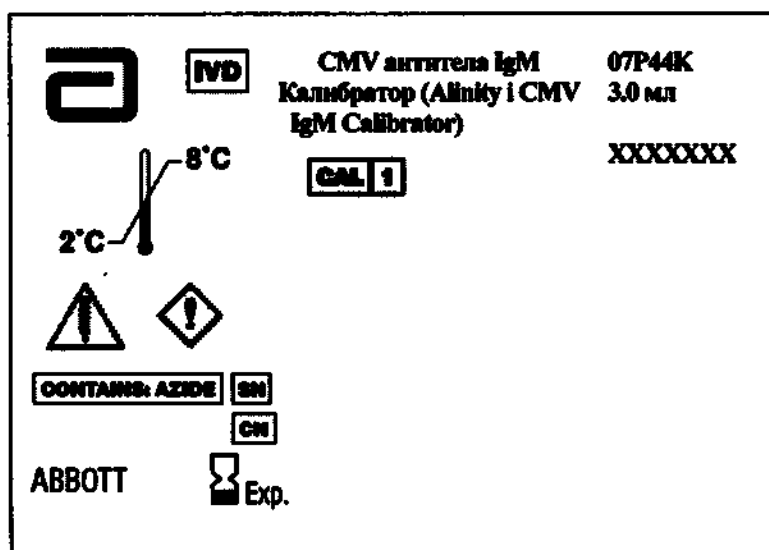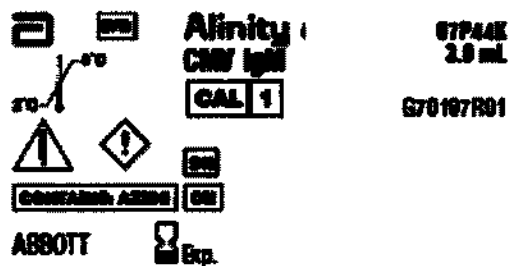

3/4 ЛИСТОВ

Подпись

