

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
качественного определения антител класса IgM к цитомегаловирусу
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "CMV антитела IgM Контрольные
материалы (Alinity i CMV IgM Controls)"**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

CMV IgM Ctrl



www.abbottdiagnostics.com/IFU

R01




07P4410



Exp.

2018-08-16




80064FN00





G70190R02

(01) 00380740129866 (17) 180816

(10) 80064FN00 (240) 07P4410

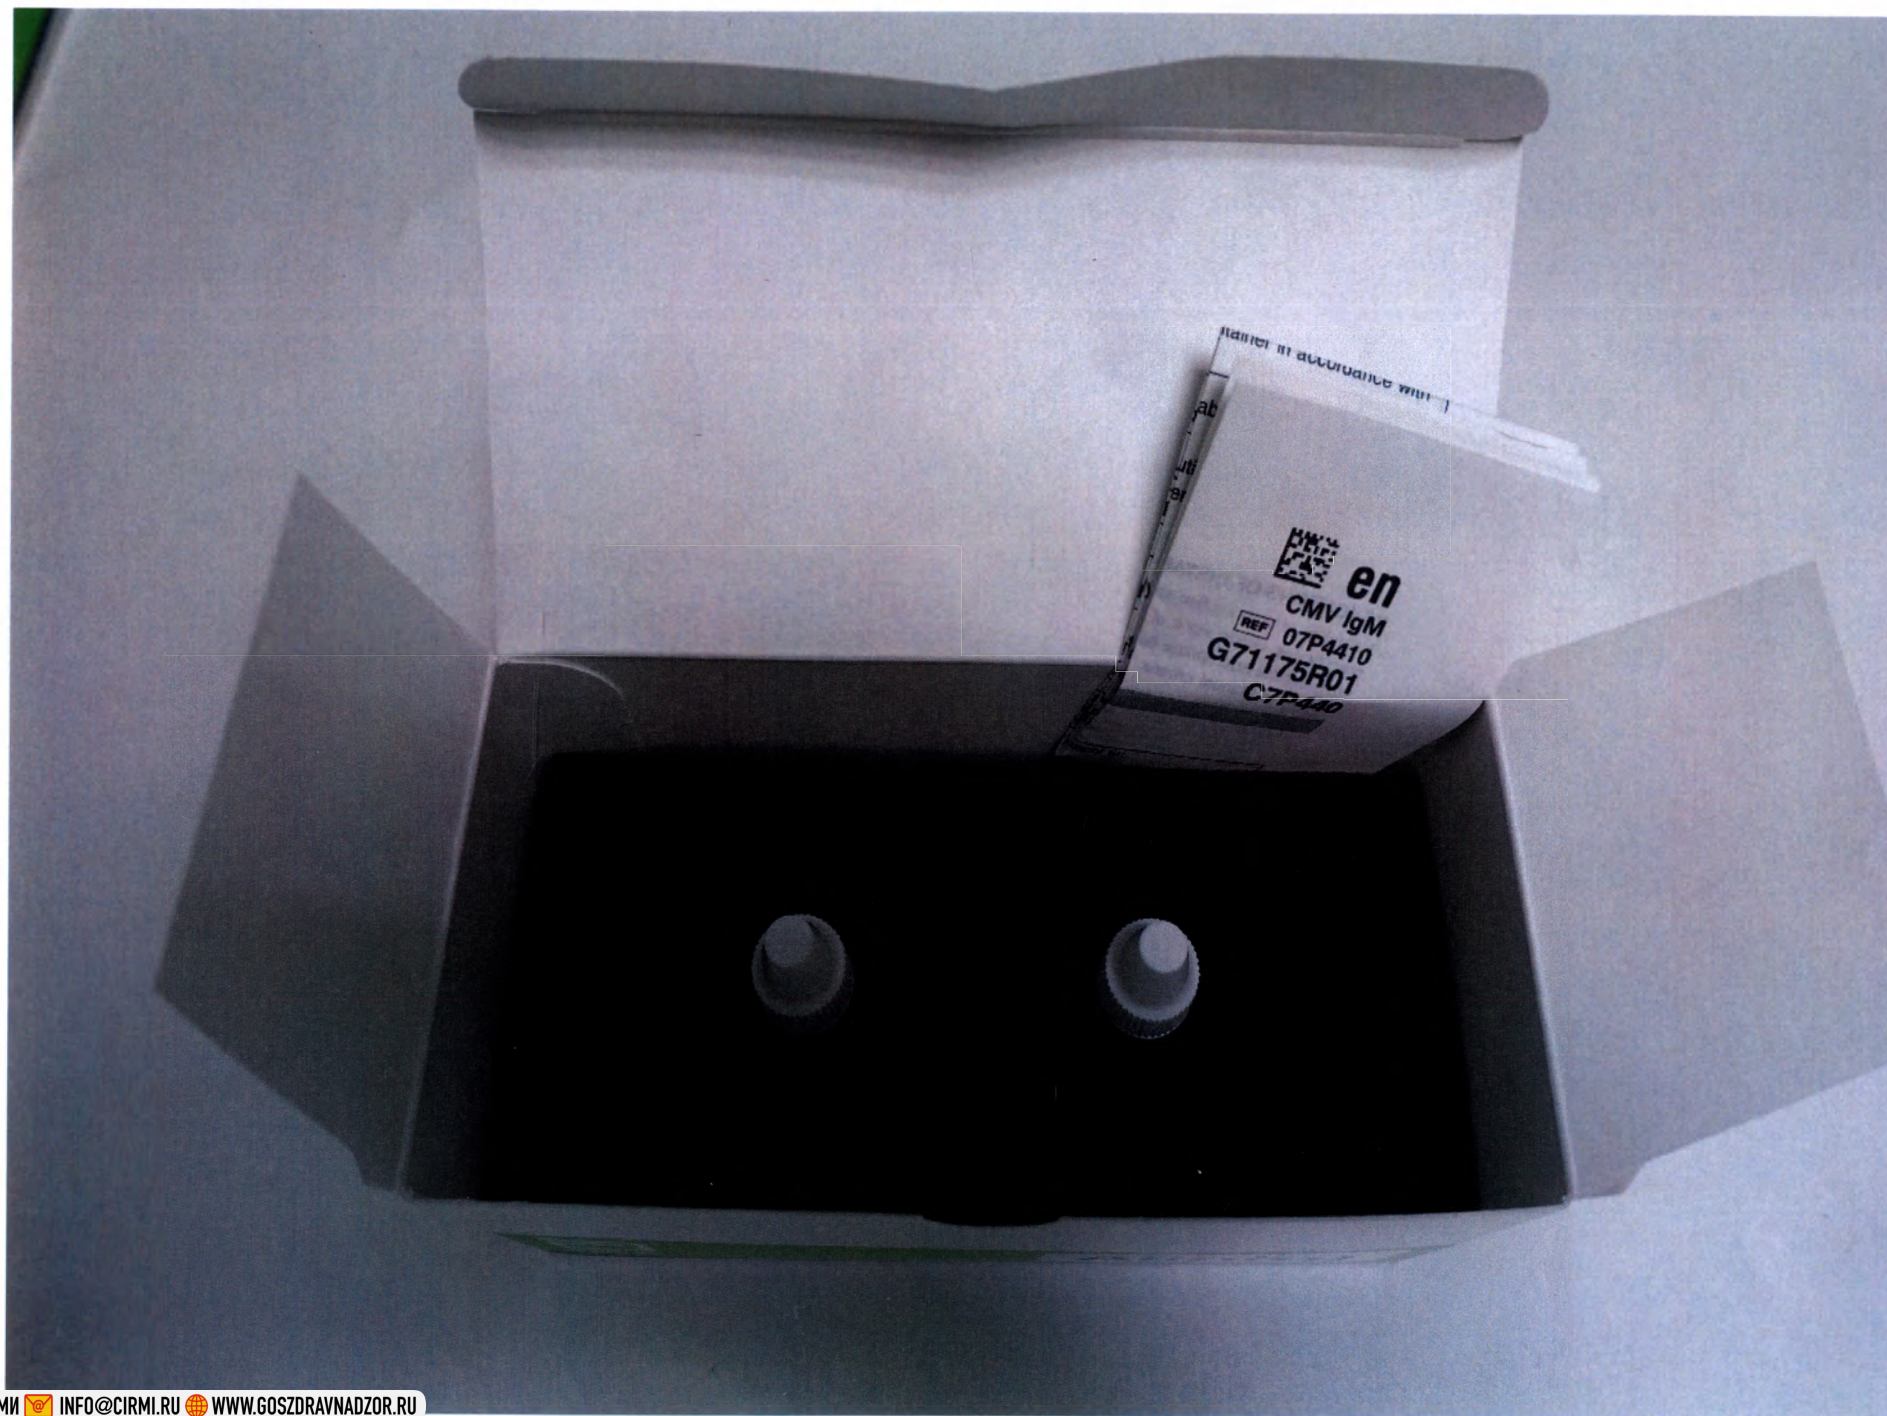

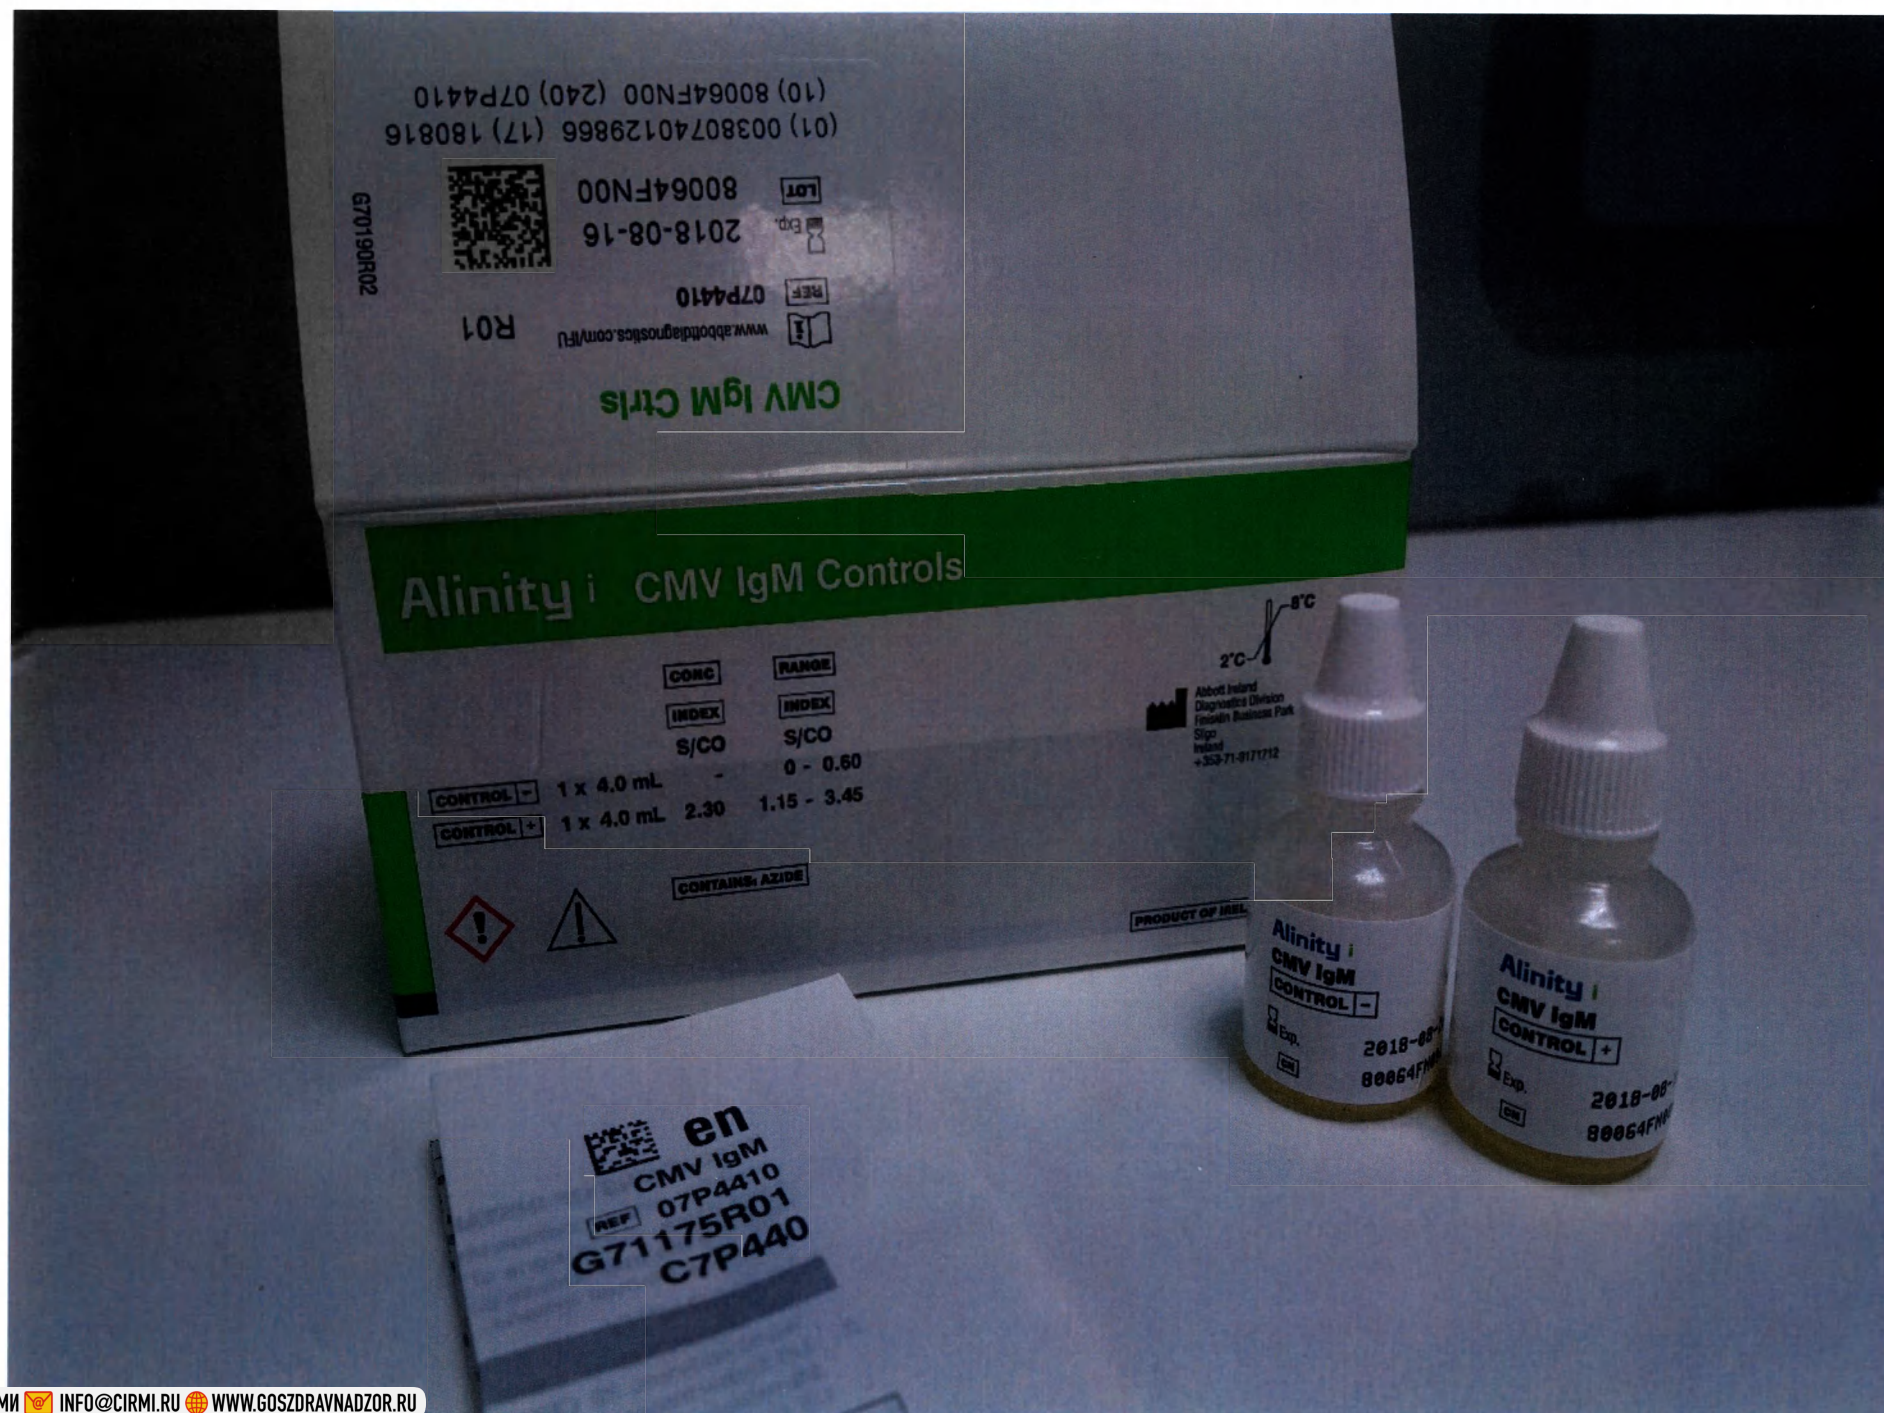

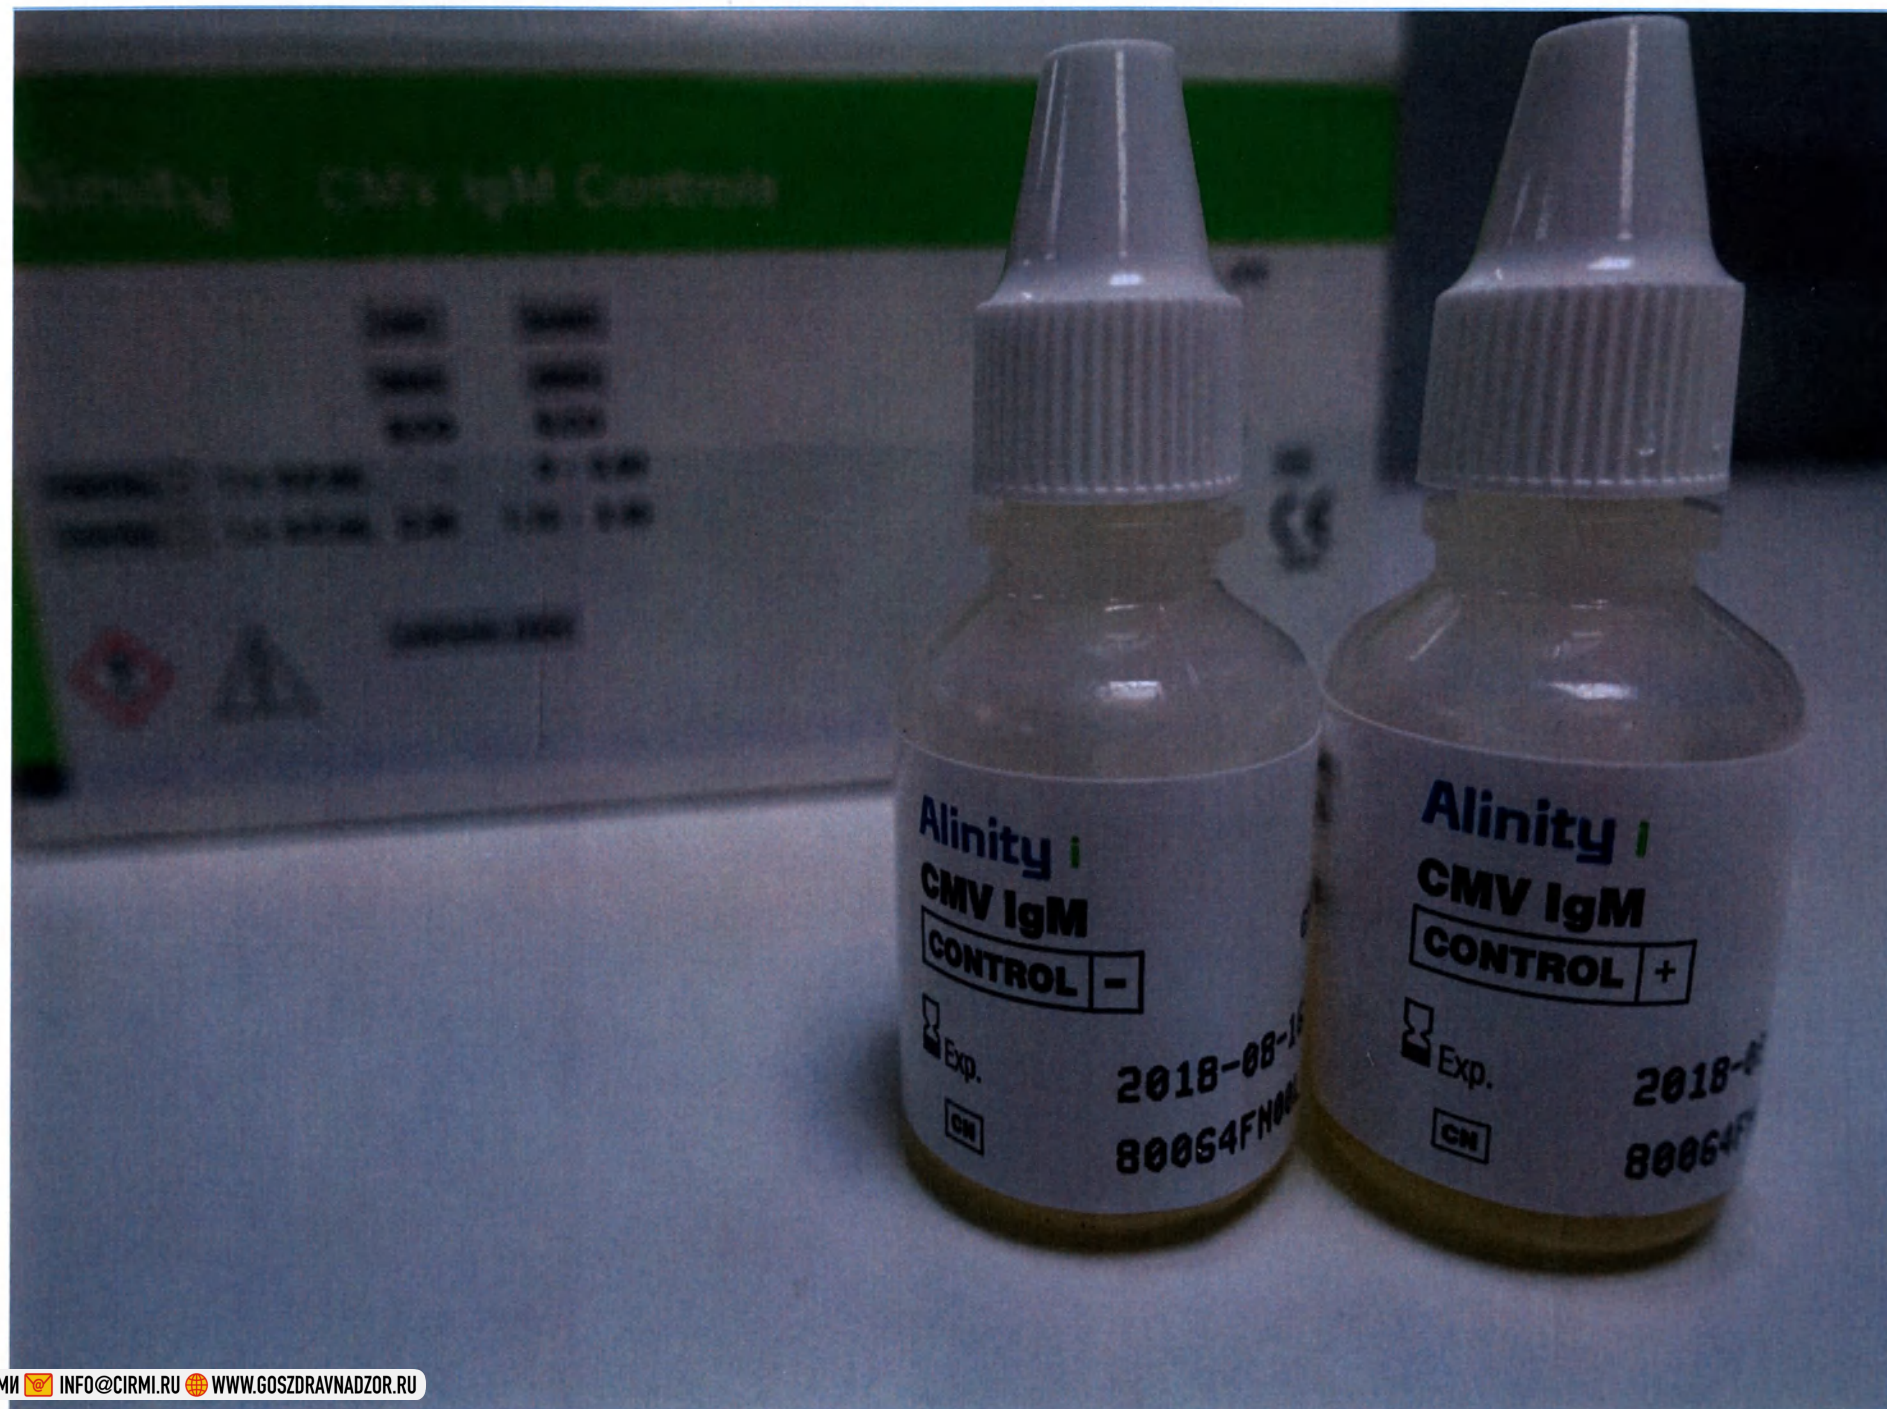

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 / 11 листов листов



Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
качественного определения антител класса IgM к цитомегаловирусу
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "CMV антитела IgM Контрольные
материалы (Alinity i CMV IgM Controls)"**



REF 07P44-10

IVD



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного определения антител класса IgM к цитомегаловирусу иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

"CMV антитела IgM Контрольные материалы (Alinity i CMV IgM Controls)"

В составе:

- Отрицательный контроль (Alinity i CMV IgM Negative Control) – 1 x 8,0 мл
- Положительный контроль (Alinity i CMV IgM Positive Control) – 1 x 8,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland (Ирландия) / РУ № _____ / _____ от _____ /

Инструкцию по применению на русском языке см: www.abbottdiagnostics.com/IFU
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

200000.0.02



CMV IgM Ctrl

Alinity i CMV IgM Controls

Abbott

	CMV IgM Ctrl	CMV IgM Ctrl
Содержимое	1x 4.0 mL	1x 4.0 mL
Срок годности	-	0 - 0.00
Срок хранения	12 4.0 mL 2.30	1.15 - 2.45



Содержимое: 1x 4.0 mL




CMV IgM Ctrl

PRODUCT OF IRELAND





Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия




Alinity i
CMV IgM
CONTROL -
 Exp.
 CN

07P44L
 4.0 mL
 G70198R01

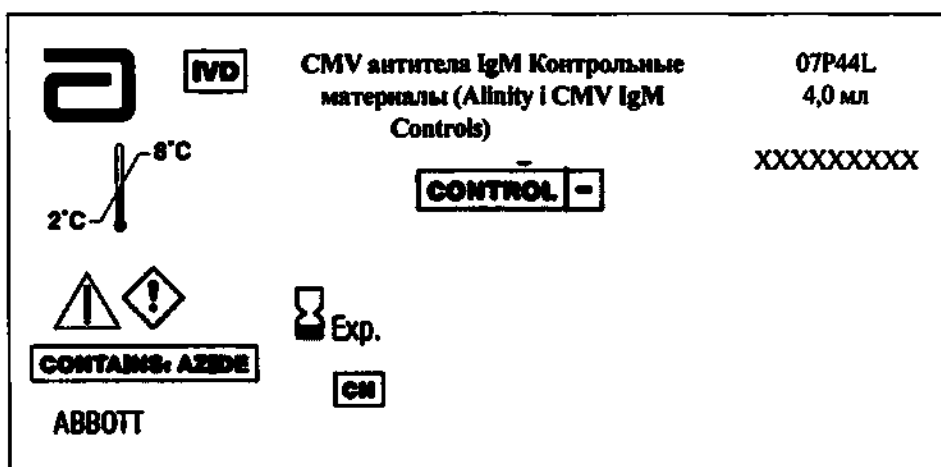

Alinity i
CMV IgM
CONTROL +
 Exp.
 CN

07P44M
 4.0 mL
 G70199R01

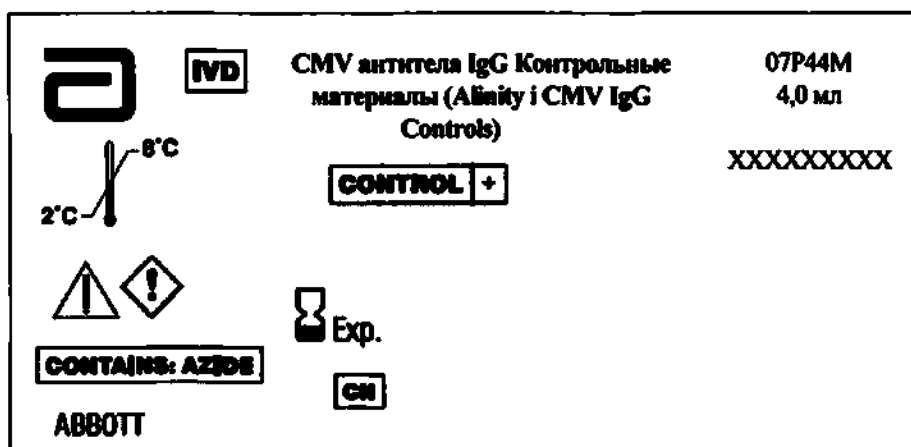

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

31/11/11 листов а

