


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
определения авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "CMV авидность антител IgG
Контрольные материалы (Alinity i CMV IgG Avidity Controls)"**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



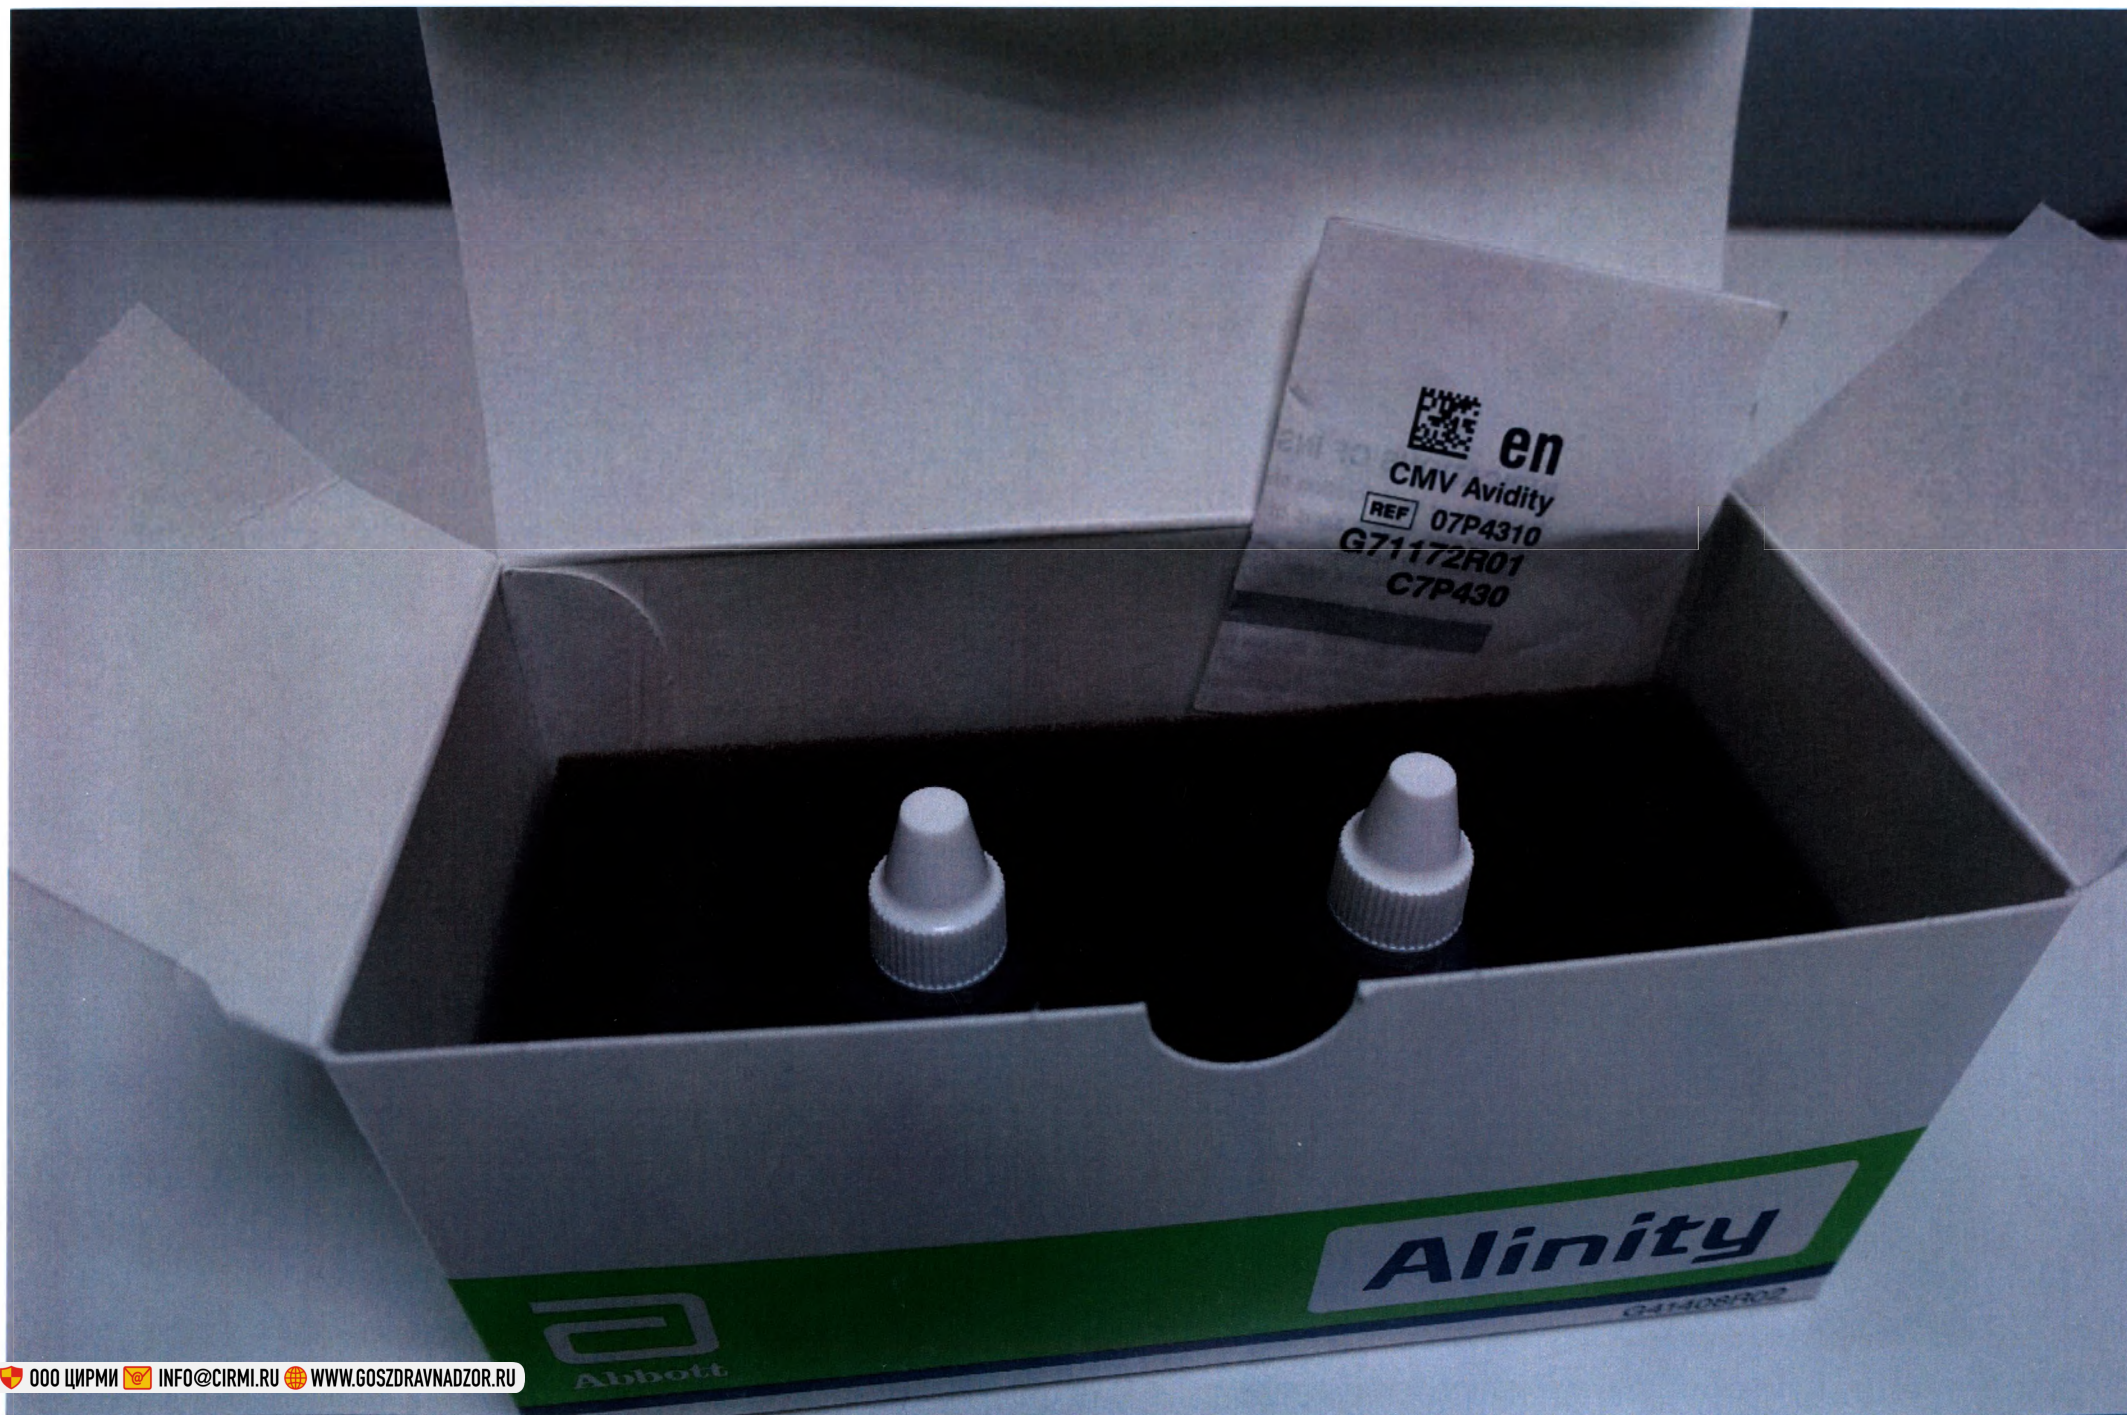

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4/8 страниц листов 12



Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
определения avidности антител класса IgG к цитомегаловирусу
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "CMV avidность антител IgG
Контрольные материалы (Alinity i CMV IgG Avidity Controls)"**

**REF 07P43-10****IVD**

Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности определения авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

"CMV авидность антител IgG Контрольные материалы (Alinity i CMV IgG Avidity Controls)"

В составе:

- Низкий контроль (Alinity i CMV IgG Avidity Low Control) – 1 x 8,0 мл
- Высокий контроль (Alinity i CMV IgG Avidity High Control) – 1 x 8,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland (Ирландия) / РУ № ____/____ от ____/____/____

Инструкцию по применению на русском языке см: www.abbottdiagnostics.com/IFU

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171,

Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

G0177R02



0109443


www.abbottdiagnostics.com/IFU



CMV Avidity Ctrls

Alinity i CMV IgG Avidity Controls**CMV Avidity Ctrls****RANGE****%Avi****CONTROL L** 1 x 8.0 mL <50.0**CONTROL H** 1 x 8.0 mL ≥ 80.0**CONTAINS ALKALIS****PRODUCT OF IRELAND****CMV Avidity Ctrls**


Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

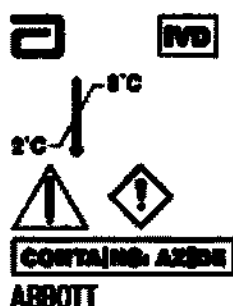

Alinity i
CMV Avidity
CONTROL L

07P43M
 8,0 mL

G70186R01

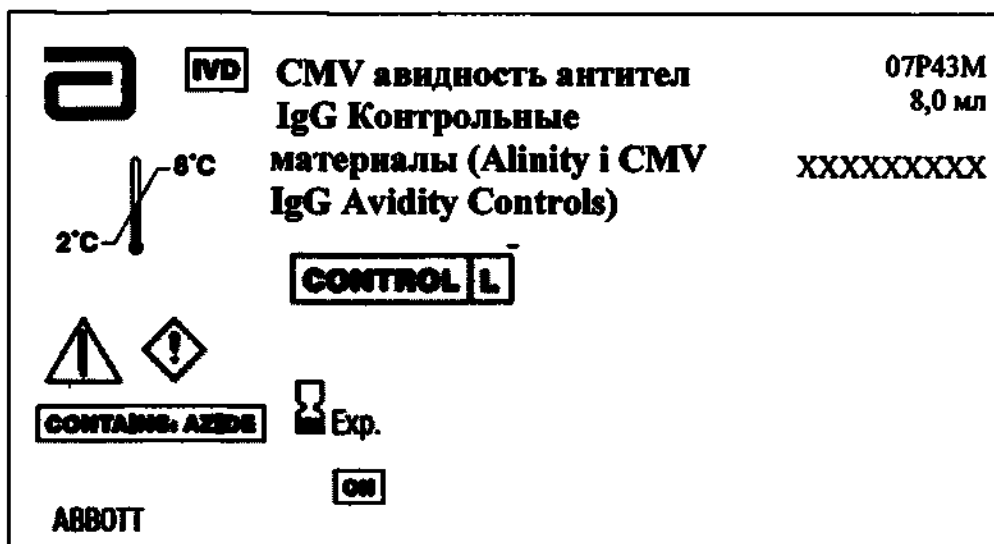


CMV авидность антител
IgG Контрольные
материалы (Alinity i CMV
IgG Avidity Controls)

07P43M
 8,0 mL

XXXXXXXXXX


CONTROL L



Alinity i
CMV Avidity
CONTROL H

07P43M
 8,0 mL

G70185R01

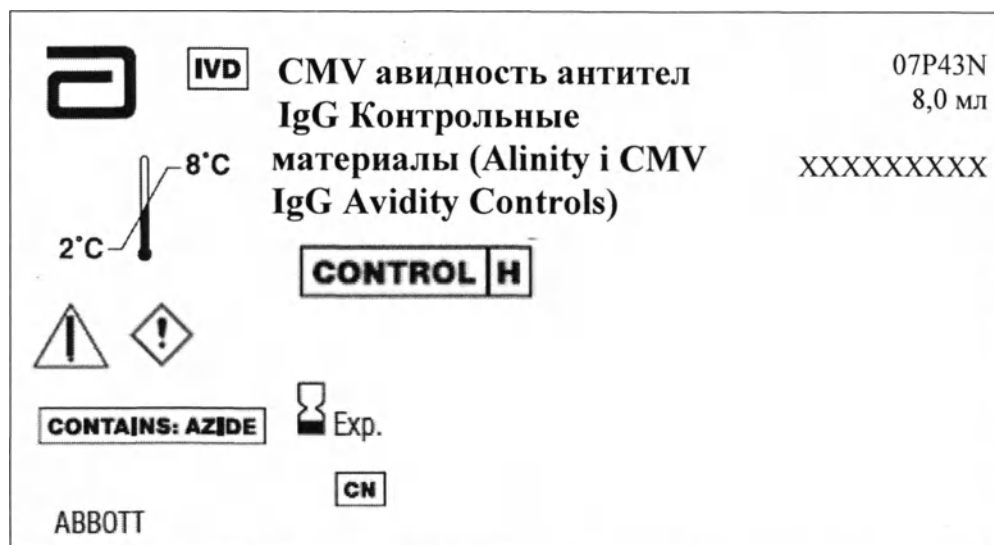


CMV авидность антител
IgG Контрольные
материалы (Alinity i CMV
IgG Avidity Controls)

07P43N
 8,0 mL

XXXXXXXXXX

CONTROL H



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3/11/19 листов

Подпись

