


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
количественного определения свободного Т3 иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических
анализаторах Alinity i «Т3 Свободный Контрольные материалы (Alinity i Free T3
Controls)»
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)**

Alinity i Free T₃ Controls

		CONC	RANGE	CONC	RANGE
		pg/mL	pg/mL	pmol/L	pmol/L
CONTROL L	1 x 8.0 mL	3.1	2.02 - 4.09	4.8	3.1 - 6.29
CONTROL M	1 x 8.0 mL	6.0	4.20 - 7.80	9.2	6.45 - 11.98
CONTROL H	1 x 8.0 mL	10.5	7.88 - 14.18	16.1	12.10 - 21.77





Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000



CONTAINS: AZIDE

PRODUCT OF IRELAND

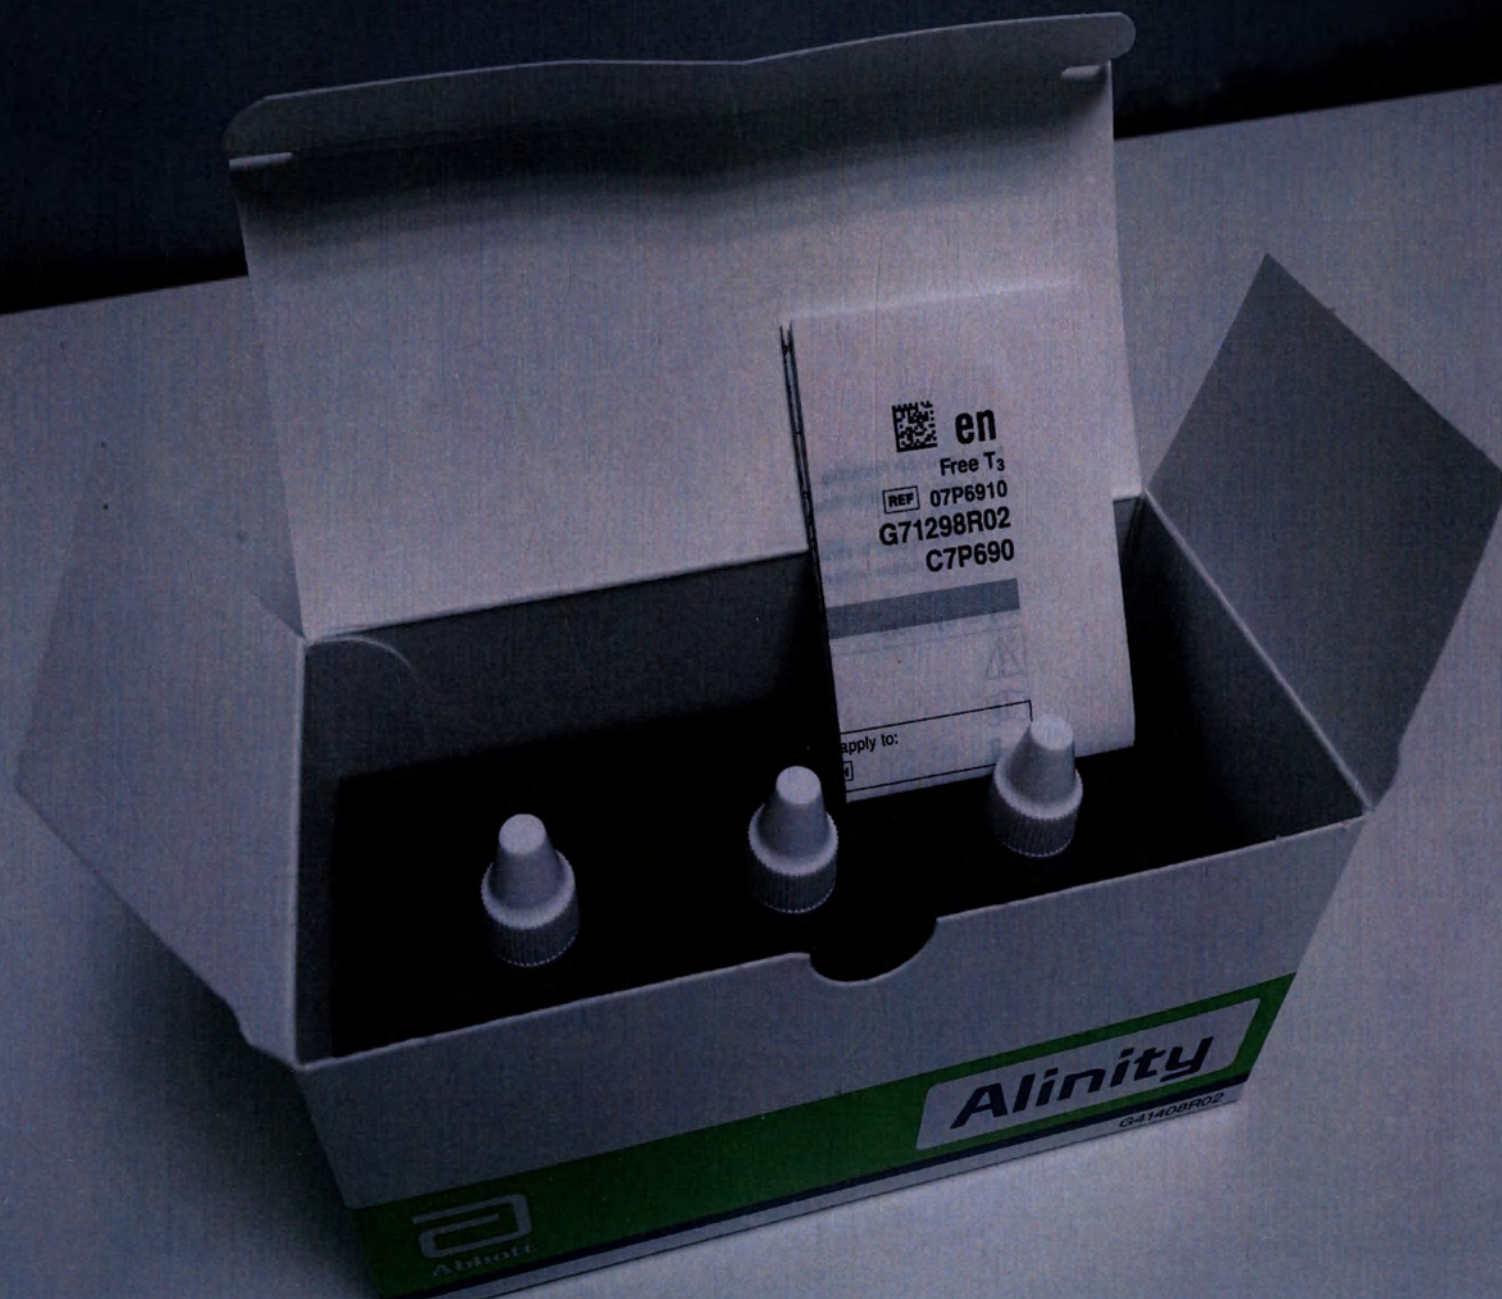

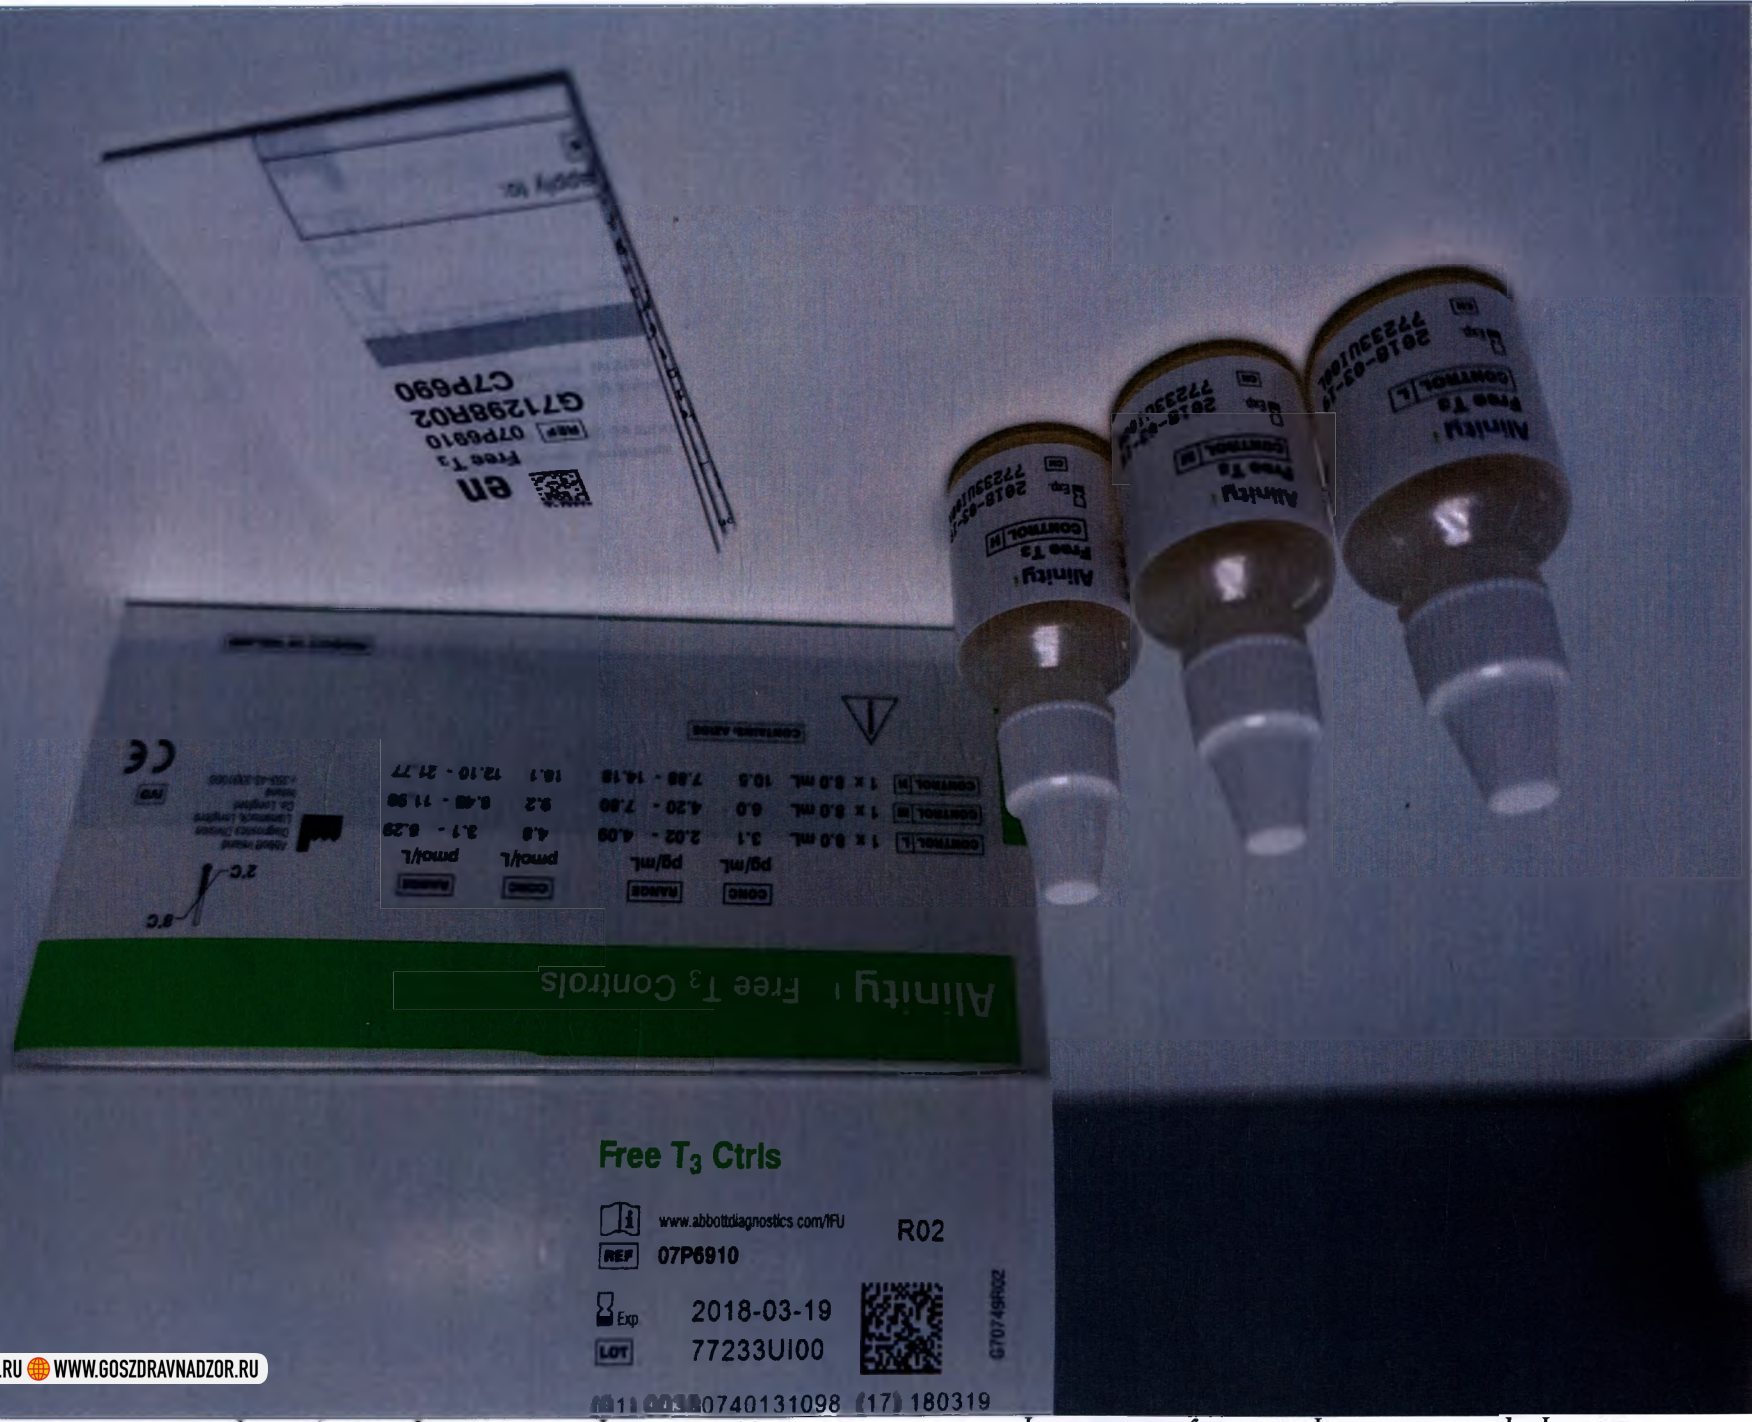

Free T₃
 REF 07P6910
 G71298R02
 C7P690

CE
 2°C
 8°C

CONTROLS	1 x 8.0 mL	1 x 8.0 mL	1 x 8.0 mL
CONTROL L	3.1	2.02 - 4.08	4.8
CONTROL M	6.0	4.20 - 7.80	9.2
CONTROL H	10.5	7.88 - 14.18	18.1
			12.10 - 21.77
	pg/mL	pmol/L	pmol/L

Alinity Free T₃ Controls

Free T₃ Ctrl

www.abbott diagnostics.com/IFU
 REF 07P6910
 Exp 2018-03-19
 LOT 77233UI00

G70749R02




0740131098 17 180319





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
6 листов

Подпись

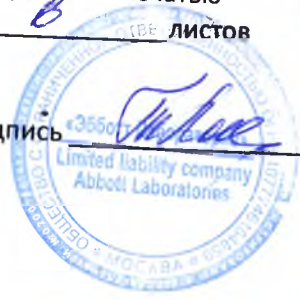

Макет маркировки на медицинское изделие
Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения свободного Т3
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i «Т3 Свободный Контрольные
материалы (Alinity i Free T3 Controls)»



REF

07P69-10

IVD



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения свободного Т3 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«Т3 Свободный Контрольные материалы (Alinity i Free T3 Controls)»

в составе:

- Контроль L (Alinity i Free T3 CONTROL L) – 1 флакон х 8,0 мл
- Контроль M (Alinity i Free T3 CONTROL M) – 1 флакон х 8,0 мл
- Контроль H (Alinity i Free T3 CONTROL H) – 1 флакон х 8,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co.

Longford, Ireland (Ирландия) / РУ № ____ / ____ от ____ / Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют / Инструкцию по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU /

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

070749R02




07P69-10

www.abbottdiagnostics.com/IFUFree T₃ CtrlsAlinity i Free T₃ Controls

Abbott

		CONC	RANGE	CONC	RANGE
		pg/mL	pg/mL	pmol/L	pmol/L
CONTROL L	1 x 8.0 mL	3.1	2.02 - 4.09	4.8	3.1 - 6.29
CONTROL M	1 x 8.0 mL	6.0	4.20 - 7.80	9.2	6.45 - 11.98
CONTROL H	1 x 8.0 mL	10.5	7.88 - 14.18	16.1	12.10 - 21.77



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

Free T₃ Ctrls

CONTAINS: AZIDE

PRODUCT OF IRELAND




07P69-TF-10_Eng_POTe.indd 1

10.08.2016 12:05:02

File: 07P69-TF-10_Eng_POTe.indd
Template: ICQ IA Control Kit Label Template.indd
Size: 183 mm x 115 mm Drawing: AK4563
See drawing for stamp fields and material
Text, Symbols: Black
Branding: PMS 376 c
Material: Refer to site specific documents

Пакет маркировки каждого компонента медицинского изделия



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

Alinity i


Free T₃

CONTROL L



CN

07P69L
8.0 mL
3.1 pg/mL
G70763R01



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

T₃ Свободный Контрольные материалы (Alinity i Free T₃ Controls)

CONTROL L



CN

07P69L
8,0 мл
3,1 пг/мл
XXXXXXXXXX



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

Alinity i

Free T₃

CONTROL M



CN

07P69M
8.0 mL
6.0 pg/mL
G70764R01



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

T₃ Свободный Контрольные материалы (Alinity i Free T₃ Controls)

CONTROL M



CN

07P69M
8,0 мл
6,0 пг/мл
XXXXXXXXXX



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

Alinity i

Free T₃

CONTROL H



CN

07P69N
8.0 mL
10.5 pg/mL
G70765R01



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT

T₃ Свободный Контрольные материалы (Alinity i Free T₃ Controls)

CONTROL H



CN

07P69N
8,0 мл
10,5 пг/мл
XXXXXXXXXX

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов

Подпись

