

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела качества
и нормативного регулирования

ООО «Био-Рад Лаборатории»




А.И. Гришина

«19» 2018г.

М.П.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор контрольных материалов BioPlex 2200 HIV Ag-Ab Control Set для одновременного определения антигена р24 ВИЧ-1, антител к ВИЧ-1, 2 в сыворотке и плазме крови человека методом мультиплексной проточной иммунофлуоресценции на приборе BioPlex 2200 с принадлежностями.

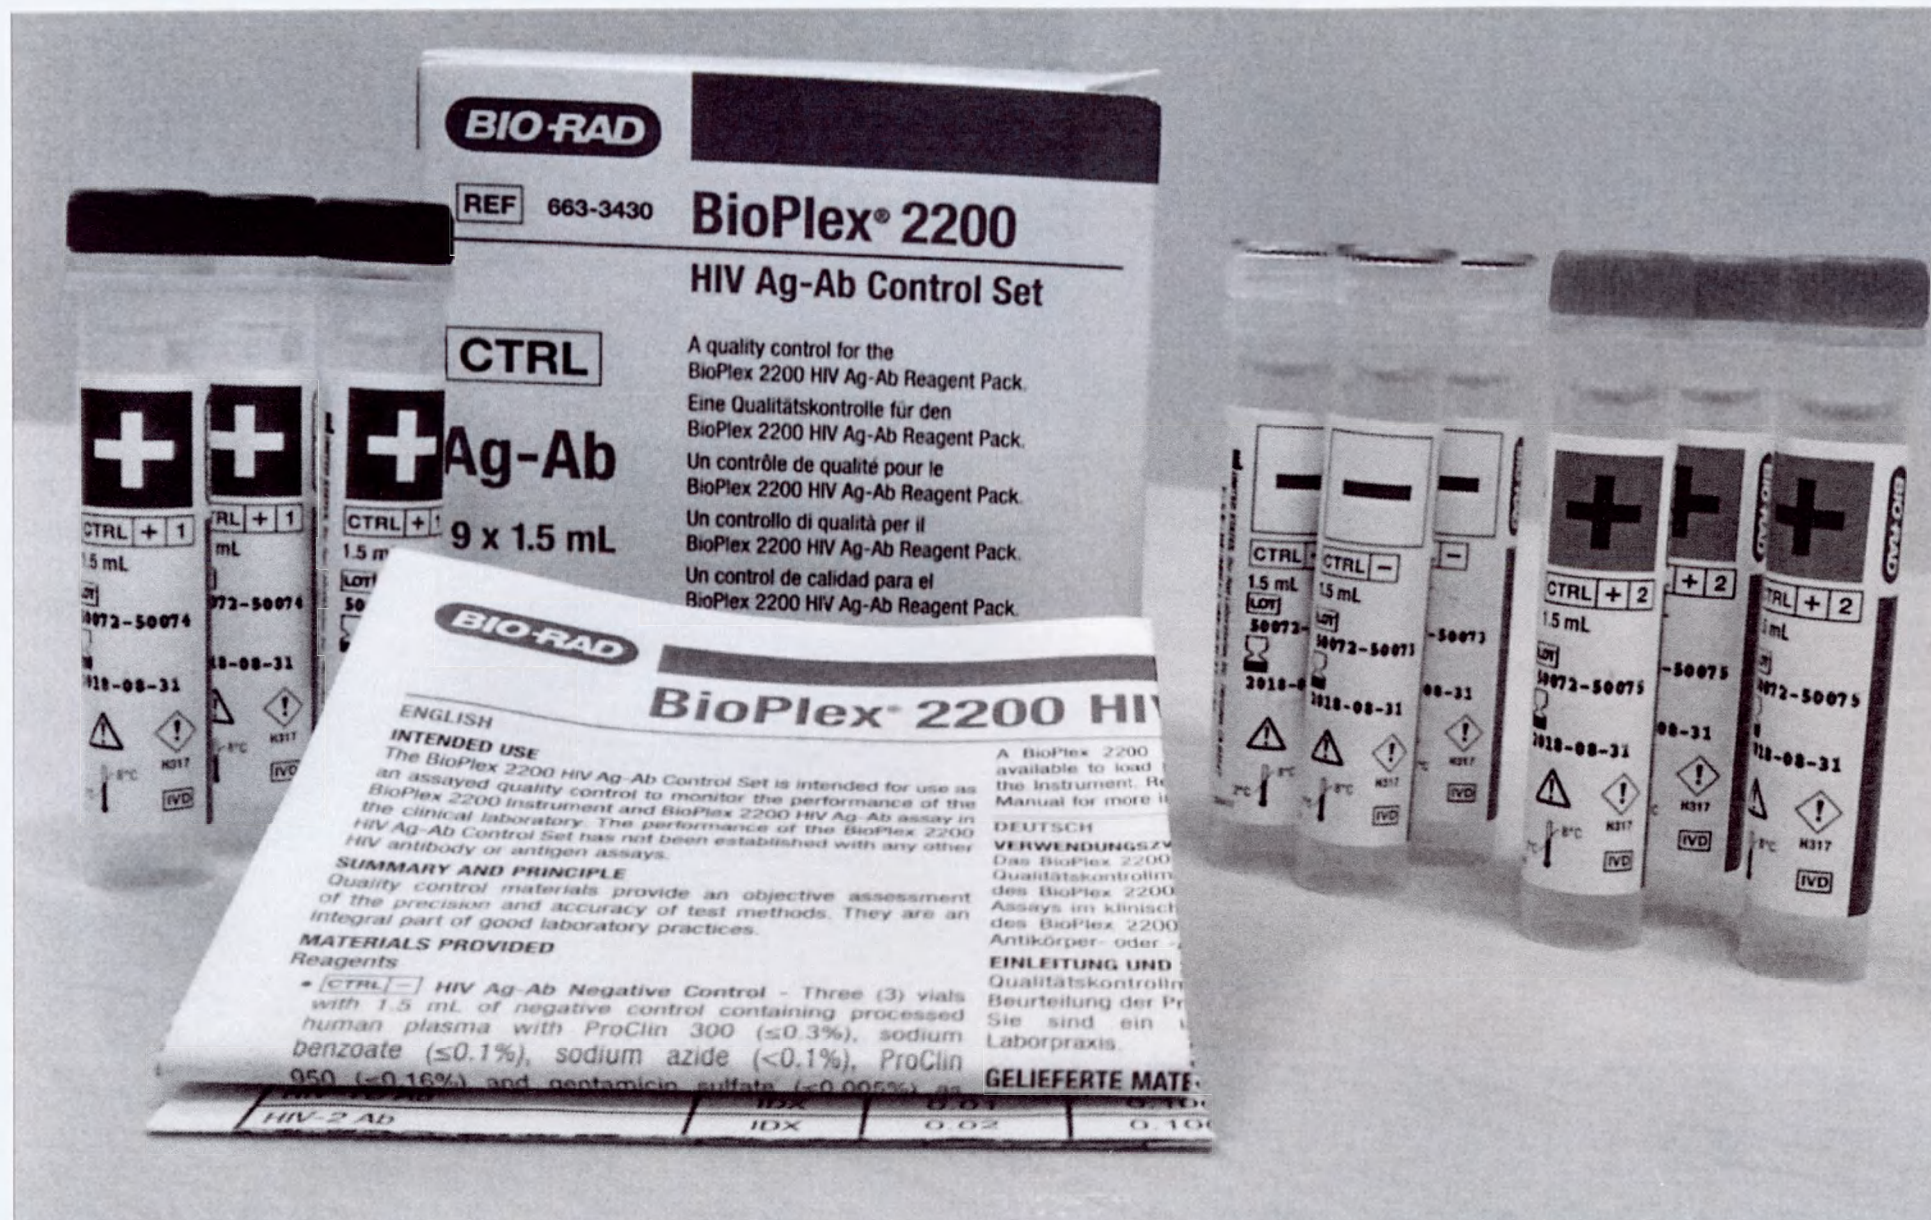

Набор контрольных материалов BioPlex 2200 HIV Ag-Ab Control Set для одновременного определения антигена p24 ВИЧ-1, антител к ВИЧ-1, 2 в сыворотке и плазме крови человека методом мультиплексной проточной иммунофлуоресценции на приборе BioPlex 2200 с принадлежностями.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 2 листа(ов)

Смирнов

