

Фотографические изображения медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного определения С-пептида
в биологических жидкостях человека
«С-ПЕПТИД-ИФА»»

000 «ХЕМА»
Контроль качества
XEMA CS SHEET
TY CONTROL SHEET

Иммуноферментный анализатор «ХЕМА»/ХЕМА СА. LMS
Полное наименование препарата / Drug name of this sheet № 2012/013

№ п/п	Наименование препарата	Дозировка	Срок годности	Срок годности	Срок годности
1	ХЕМА	1 шт.	1 год	1 год	1 год



Instruction for use



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
С-ПЕПТИДА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА
«С-ПЕПТИД-ИФА»

A SOLID-PHASE ENZYME IMMUNOASSAY
FOR THE QUANTITATIVE DETERMINATION
OF C-PEPTIDE IN HUMAN BLOOD SERUM OR PLASMA, URINE

C-peptide EIA

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ






for 96 determinations/на 96 определений



Для in vitro исследований



XEMA Co., Ltd.
The 9th Parkovaya str., 48
105264 Moscow, Russia
Tel./fax: +7(495) 510-57-07
e-mail: redkin@xema-medica.com
Internet: www.xema-medica.com

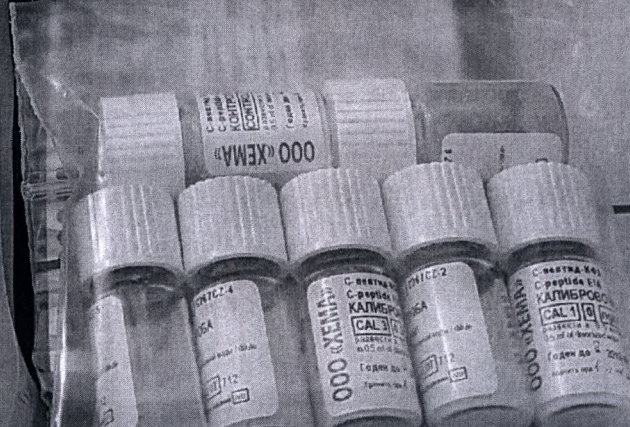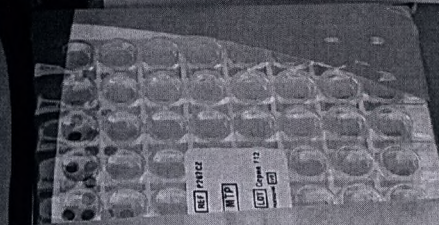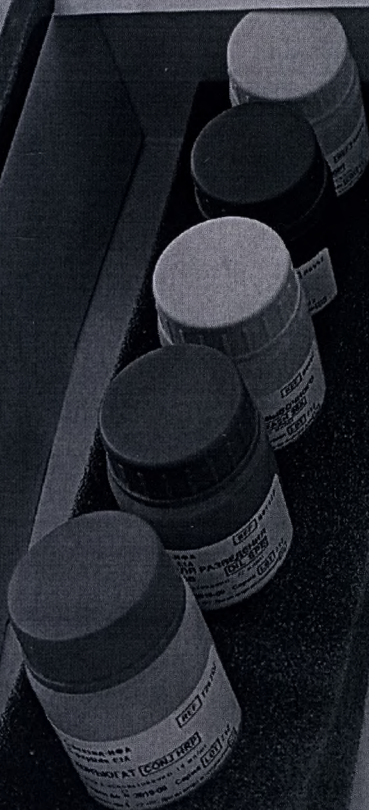

ООО «ХЕМА»
100000 МОСКВА
УЛ. ЛЕНИНА, 100
ИНТЕР-СЕРВИС

Обязательное к сертификации свидетельство «ХЕМА» / XEMA Co. Ltd.
Протокол контроля качества / Quality control data sheet № 267C/112

Наименование	Содержимое упаковки	Срок годности	Упаковка	Доп. прим.	Примеч.
Содержимое упаковки	Product list	Срок годности	Упаковка	Доп. прим.	Примеч.



Inst...



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
С-ПЕПТИДА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА

«С-ПЕПТИД ЛФА»

SOLID-PHASE TIME-IMMUNOASSAY
THE QUANTITATIVE DETERMINATION



Хар-к-ти-ка	Содержимое упаковки Product form	Серия Lot	К-во в упаковке Qty per set	Дата вкл. в про- дукт Date of prod.	Гаран-ти-й срок Warranty date
K267C	Комплект для определения С-пептида	712	10	2018.12	2019.12



Instruction for use



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
С-ПЕПТИДА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА

«С-ПЕПТИД-ИФА»

A SOLID-PHASE ENZYME IMMUNOASSAY
FOR THE QUANTITATIVE DETERMINATION
OF C-PEPTIDE IN HUMAN BLOOD SERUM OR PLASMA, URINE

C-peptide EIA

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ REF K267C






For 96 determinations/На 96 определений



Для in vitro исследований



XEMA Co. Ltd.
The 9th Parkovaya str. 48
119044 Moscow, Russia
Tel./Fax: +7(495) 510 57 07
e-mail: info@xema-medica.com
internet: www.xema-medica.com

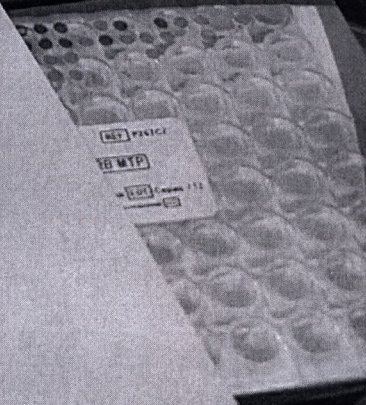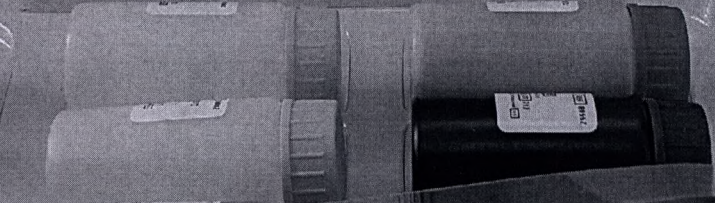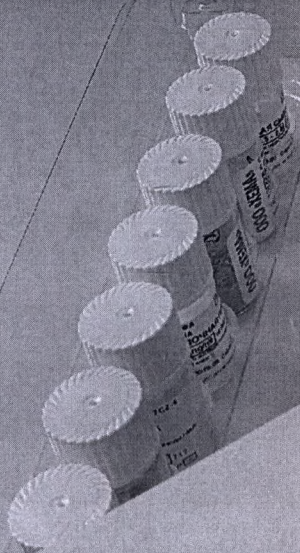

ПРОШИТО

В КОЛИЧЕСТВЕ 4 ЛИСТОВ

Генеральный директор ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин

