


ОФТ-"СВЕТОНЯНЯ-М1" (Стойка с мобильным основанием М1)





ОФТ-”СВЕТОНЯНЯ-М2” (Стойка с мобильным основанием М2)

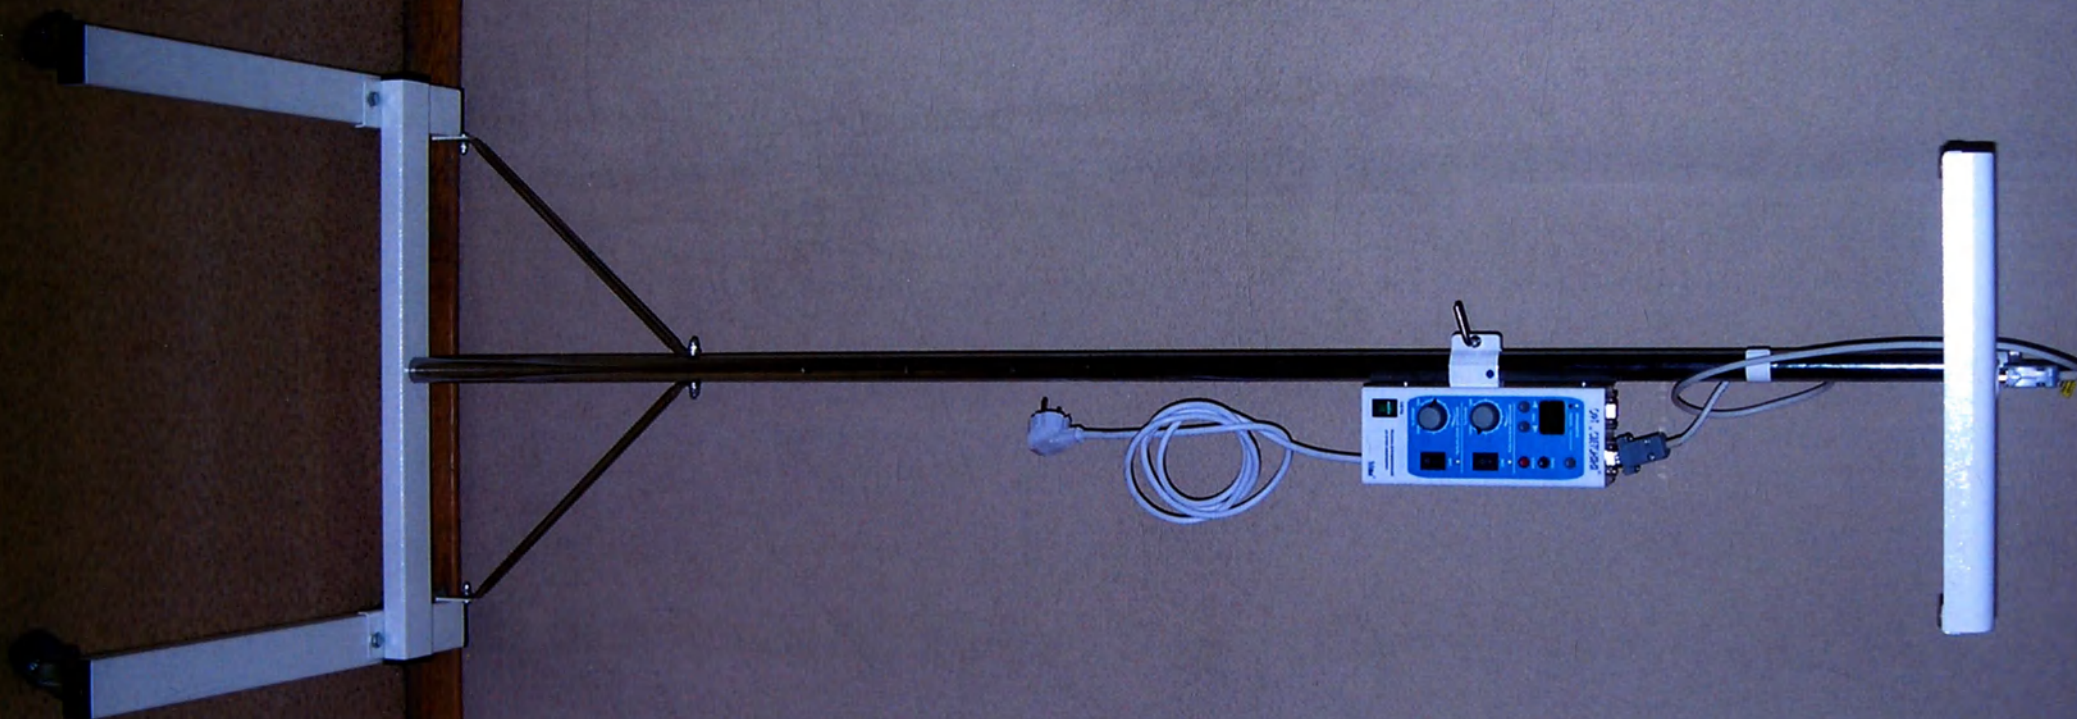





Блок коммутации и питания аппарата ОФТ - "СВЕТОНЯНЯ-М"

ОФТ «СВЕТОНЯНЯ-М»

Облучатель фототерапевтический
для лечения новорожденных с
принадлежностями

ТУ 32.50.21-047-26857421-2017

Режим работы-непрерывный

Сеть ~ 230В, 50Гц

Потребляемая мощность-50ВА

IP50

Сер.№ 003 20 17 г.

ООО «ТРИМА» 410033г.Саратов, ул.Панфилова, 1

Тел.(8452)45-02-15, (8452)45-02-46

e-mail: trima@trima.ru

EAC



**Матрица светодиодная
верхняя аппарата
ОФТ - “СВЕТОНЯНЯ-М”**



**Матрица светодиодная
нижняя аппарата
ОФТ - “СВЕТОНЯНЯ-М”**





**Кабель для подключения матрицы
светодиодной нижней аппарата
ОФТ - “СВЕТОНЯНЯ-М”**




**Кабель для подключения матрицы
светодиодной верхней аппарата
ОФТ - “СВЕТОНЯНЯ-М”**





Защита для глаз при
фототерапии

Конверт для новорожденного
аппарата ОФТ - "СВЕТОНЯЯ-М"

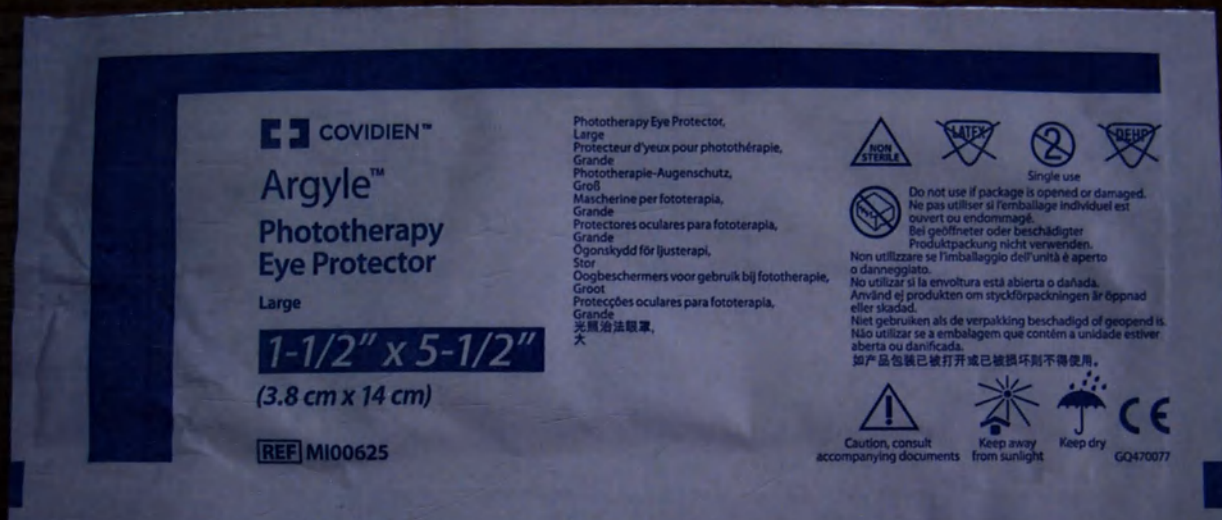



Датчик контроля освещенности аппарата ОФТ - “СВЕТОНЯНЯ-М”



Комплект крепежных элементов с ключом для винтов с внутренним шестигранником 7812 - 0373



