

ОФТ-”СВЕТОНЯНЯ-К2”


(Тележка К2 для новорожденных с прозрачным пластиковым кувезом и стойкой крепления матриц светодиодных)





ОФТ-"СВЕТОНЯНЯ-К1"

(Тележка К1 для новорожденных с прозрачным пластиковым кувезом и стойкой крепления матриц светодиодных)

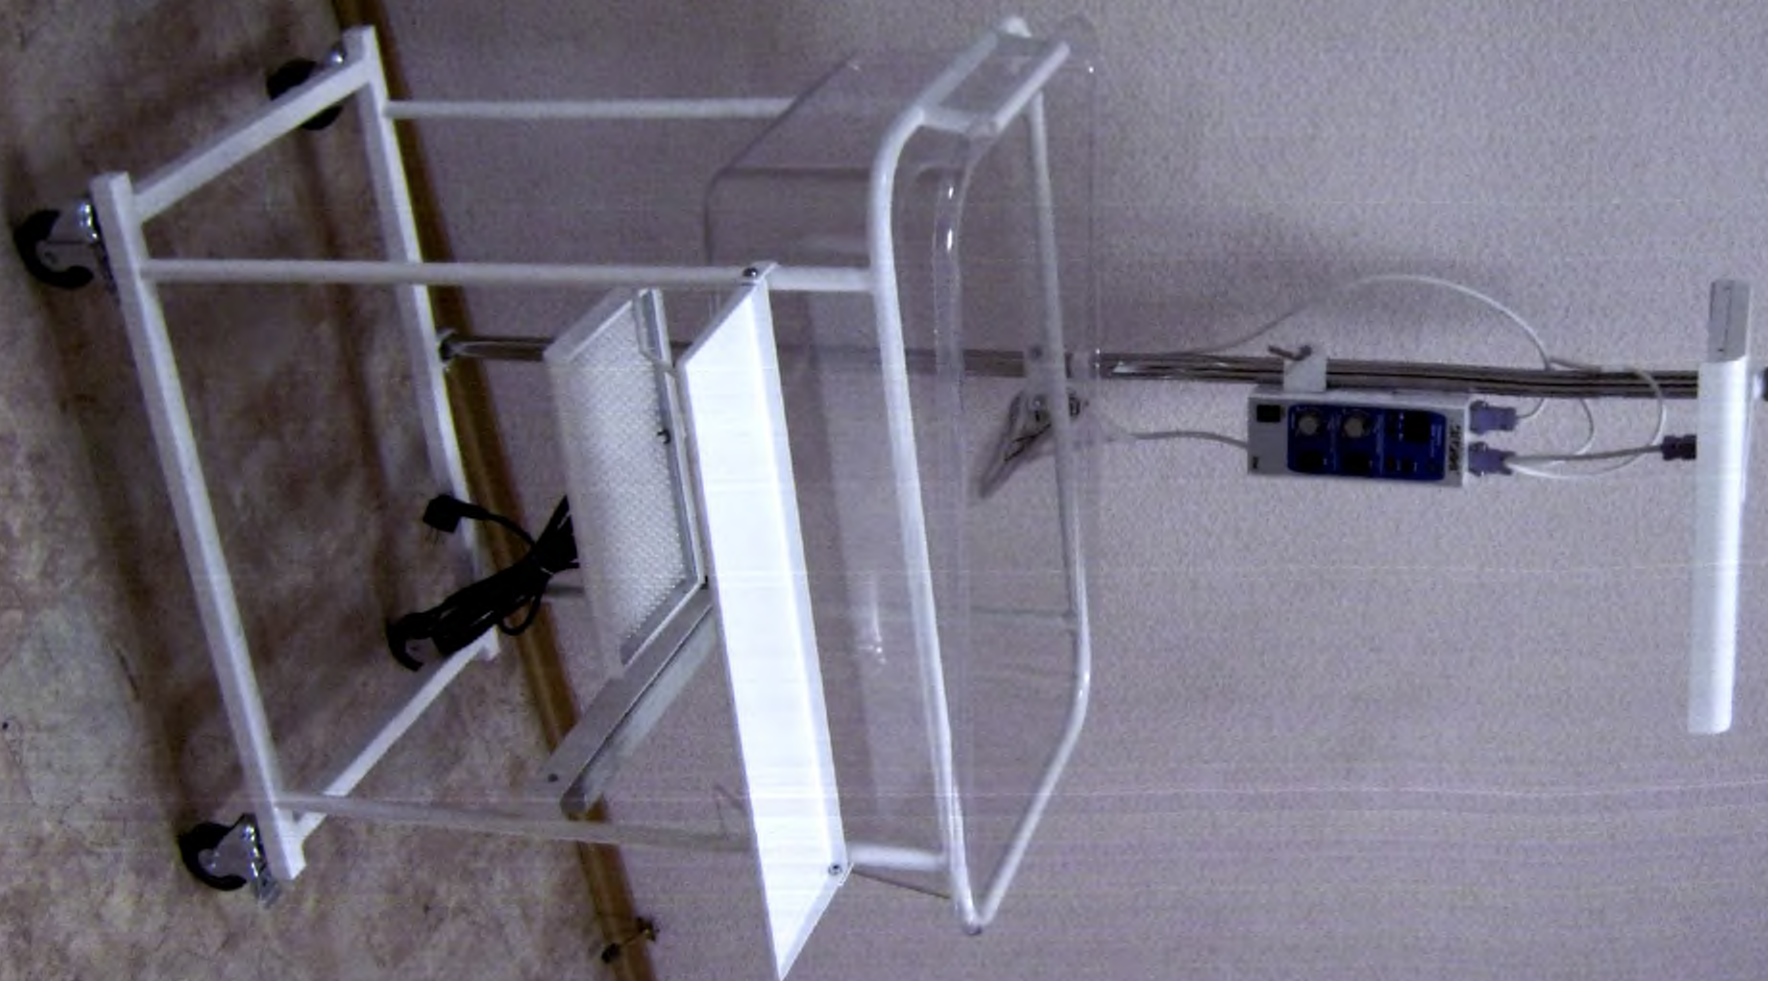





Блок коммутации и питания аппарата ОФТ - "СВЕТОНЯНЯ-К"

ОФТ «СВЕТОНЯНЯ-К»

Облучатель фототерапевтический
для лечения новорожденных с
принадлежностями

ТУ 32.50.21-048-26857421-2017

Режим работы-непрерывный

Сеть ~ 230В, 50Гц

Потребляемая мощность-50ВА

IP50

Сер.№ 002 20 17г.

ООО «ТРИМА» 410033г.Саратов, ул.Панфилова, 1

Тел.(8452)45-02-15, (8452)45-02-46

e-mail: trima@trima.ru

EAC



**Матрица светодиодная
верхняя аппарата
ОФТ "СВЕТОНЯНЯ-К"**



**Матрица светодиодная
нижняя аппарата
ОФТ "СВЕТОНЯНЯ-К"**





Кабель для подключения матрицы светодиодной нижней аппарата ОФТ - “СВЕТОНЯНЯ-К”



Кабель для подключения матрицы светодиодной верхней аппарата ОФТ - “СВЕТОНЯНЯ-К”





Защита для глаз при фототерапии



Конверт для новорожденного аппарата ОФТ - "СВЕТОНЯНЯ-К"





Датчик контроля освещенности аппарата ОФТ - “СВЕТОНЯНЯ-К”



Ключ для винтов с внутренним шестигранником 7812 - 0373



