



Фотографические изображения
медицинского изделия

**«Аппарат рентгеновский OPTIMA XR с принад-
лежностями»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента регистрации и серти-
фикации России и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»



С. Б. Парахина

« 22 » ноября 2018 г.





GE Medical Systems, LLC
3000 North Grandview Blvd.
Waukesha, WI 53188, USA

Модель: Optima XR220AMX
30KW

REF

SN



100 - 240V~

50/60Hz 1440 V A класс A: Группа 1

см. другие этикетки для международных
символов, которые демонстрируют соответствие





GE Medical Systems, LLC
3000 North Grandview Blvd.
Waukesha, WI 53188, USA


Модель: Optima XR200AMX
30KW


REF

SN




100 - 240V~
50/60Hz 1440 V A класс A: Группа 1
см. другие этикетки для международных
символов, которые демонстрируют соответствие

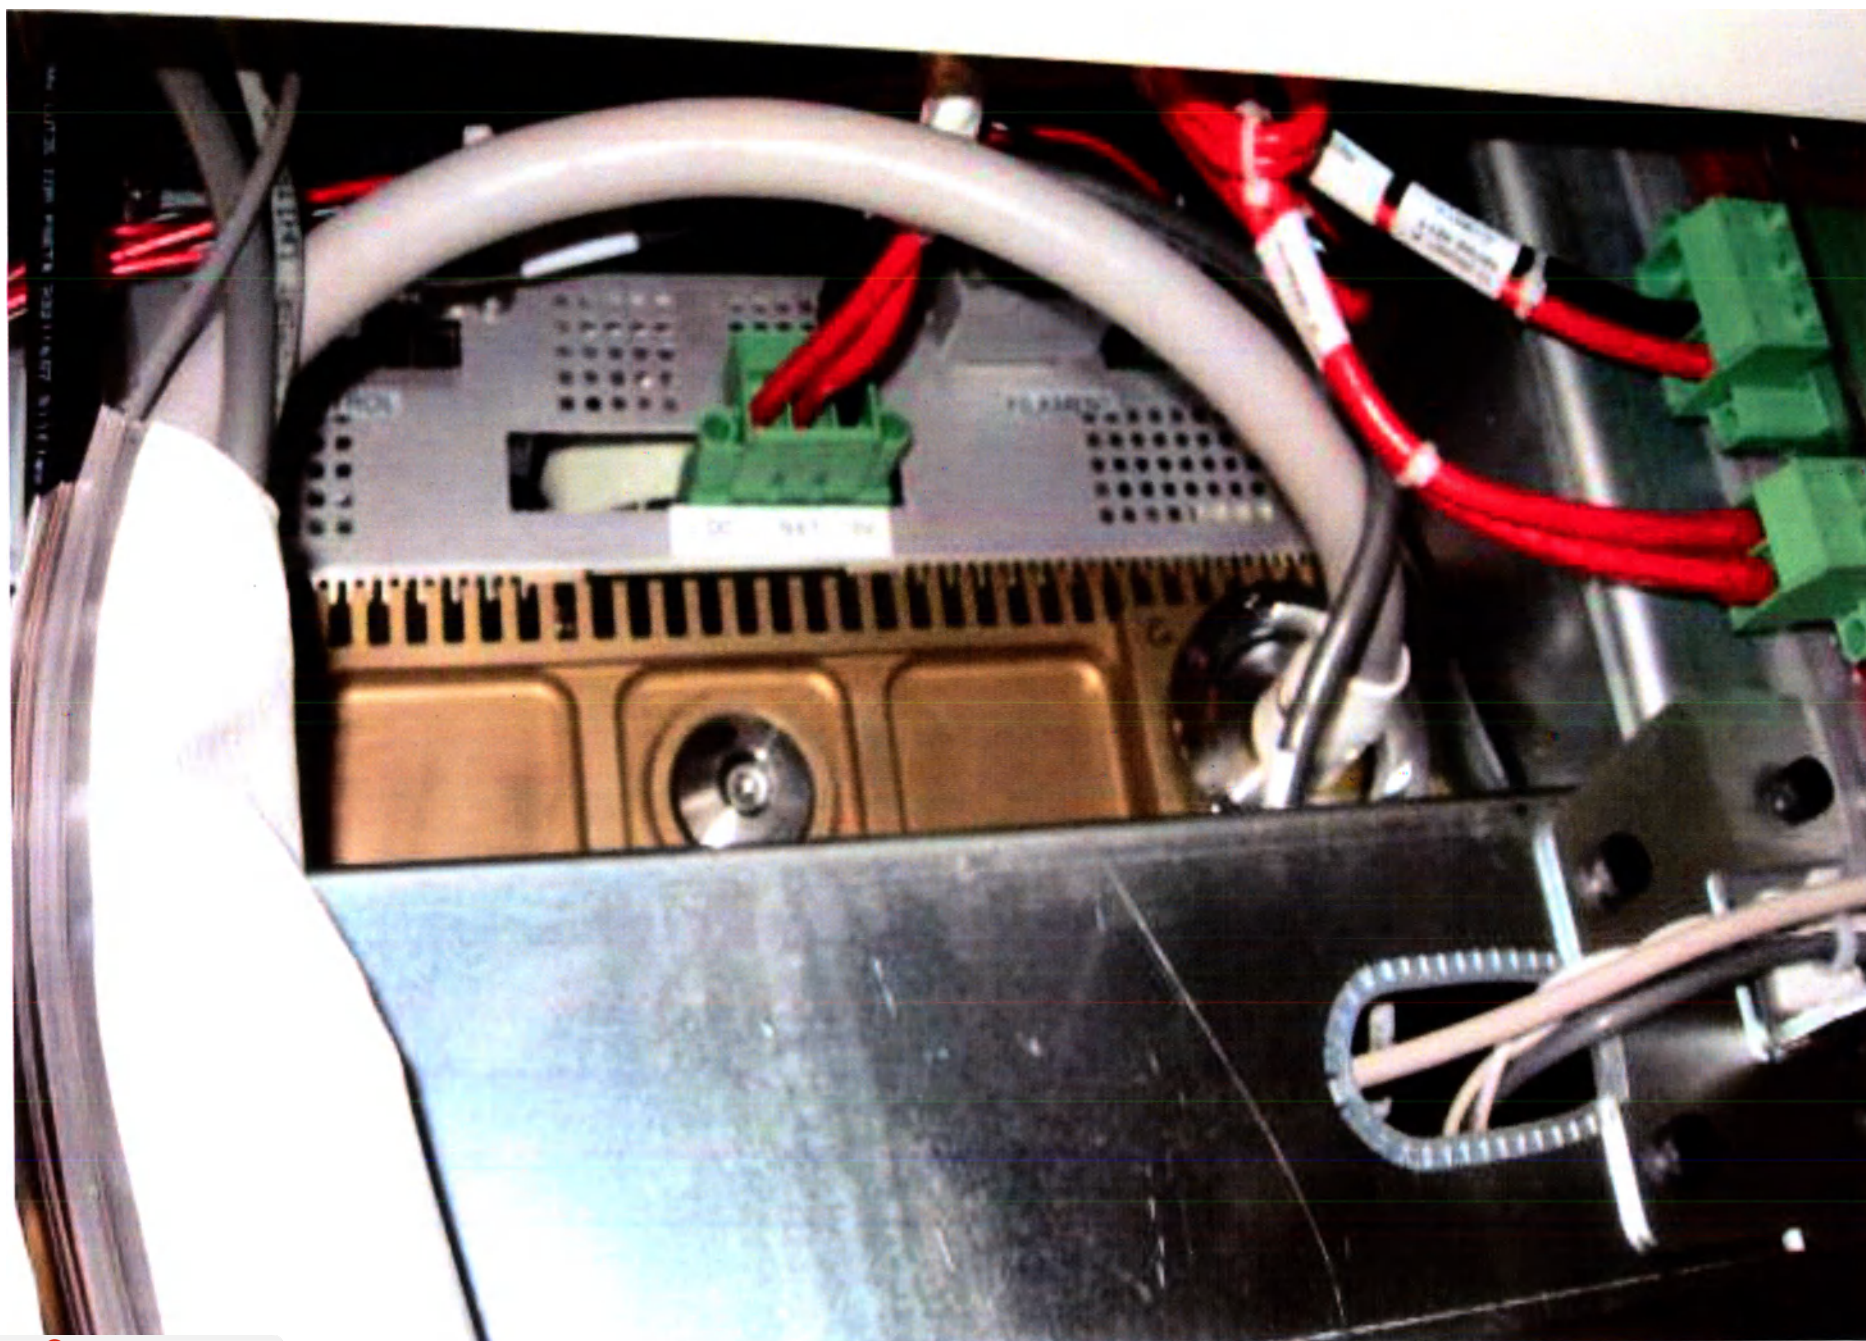

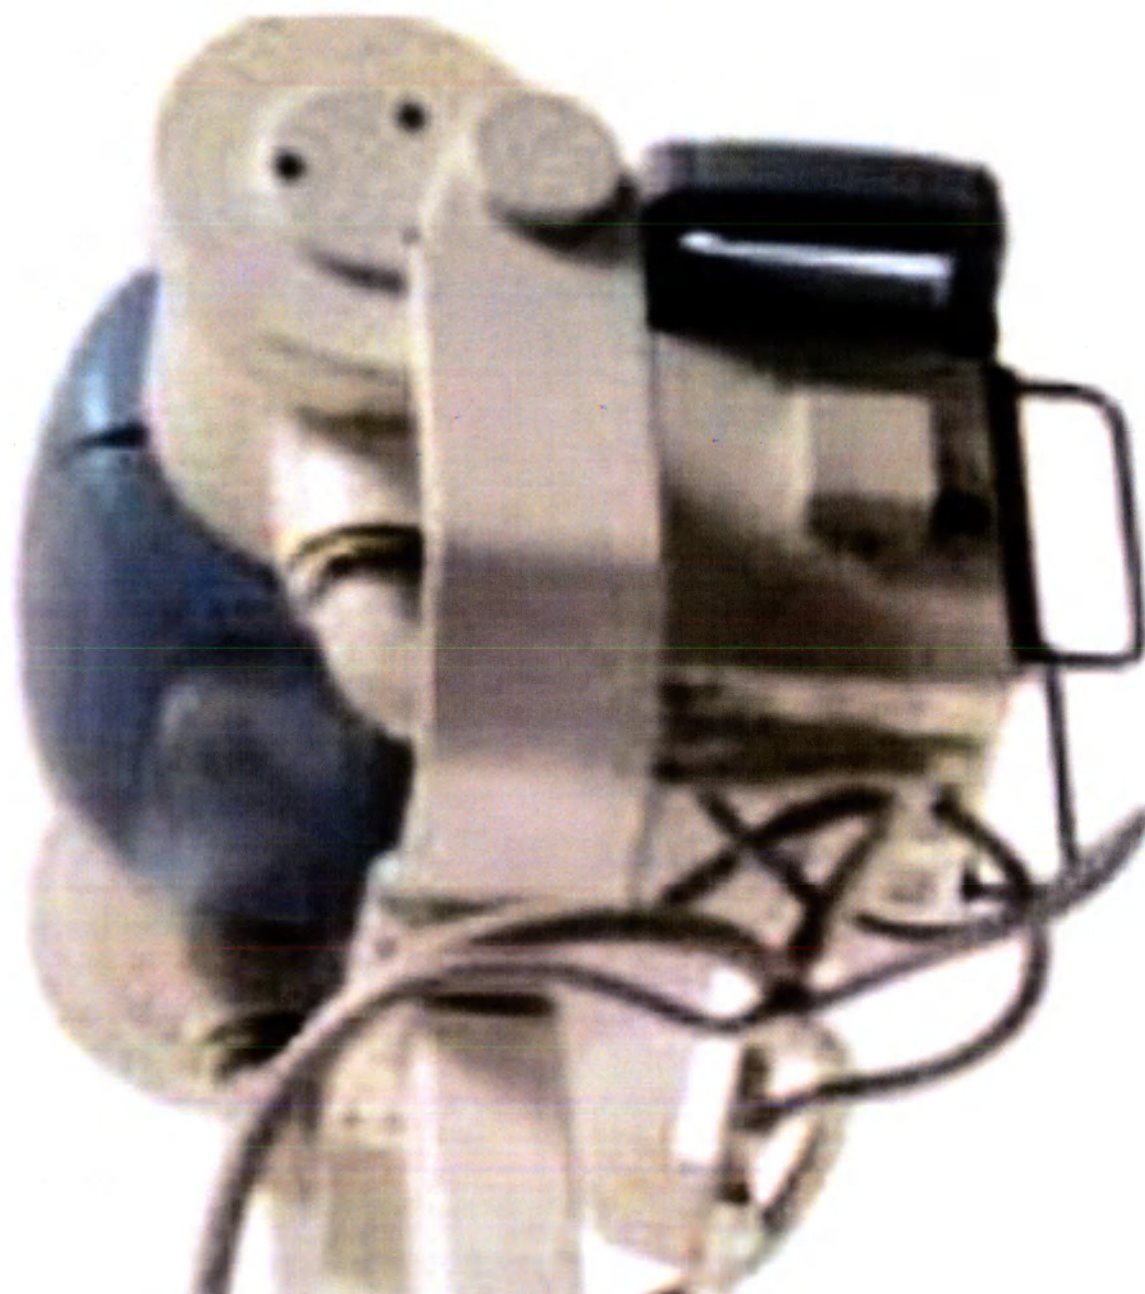





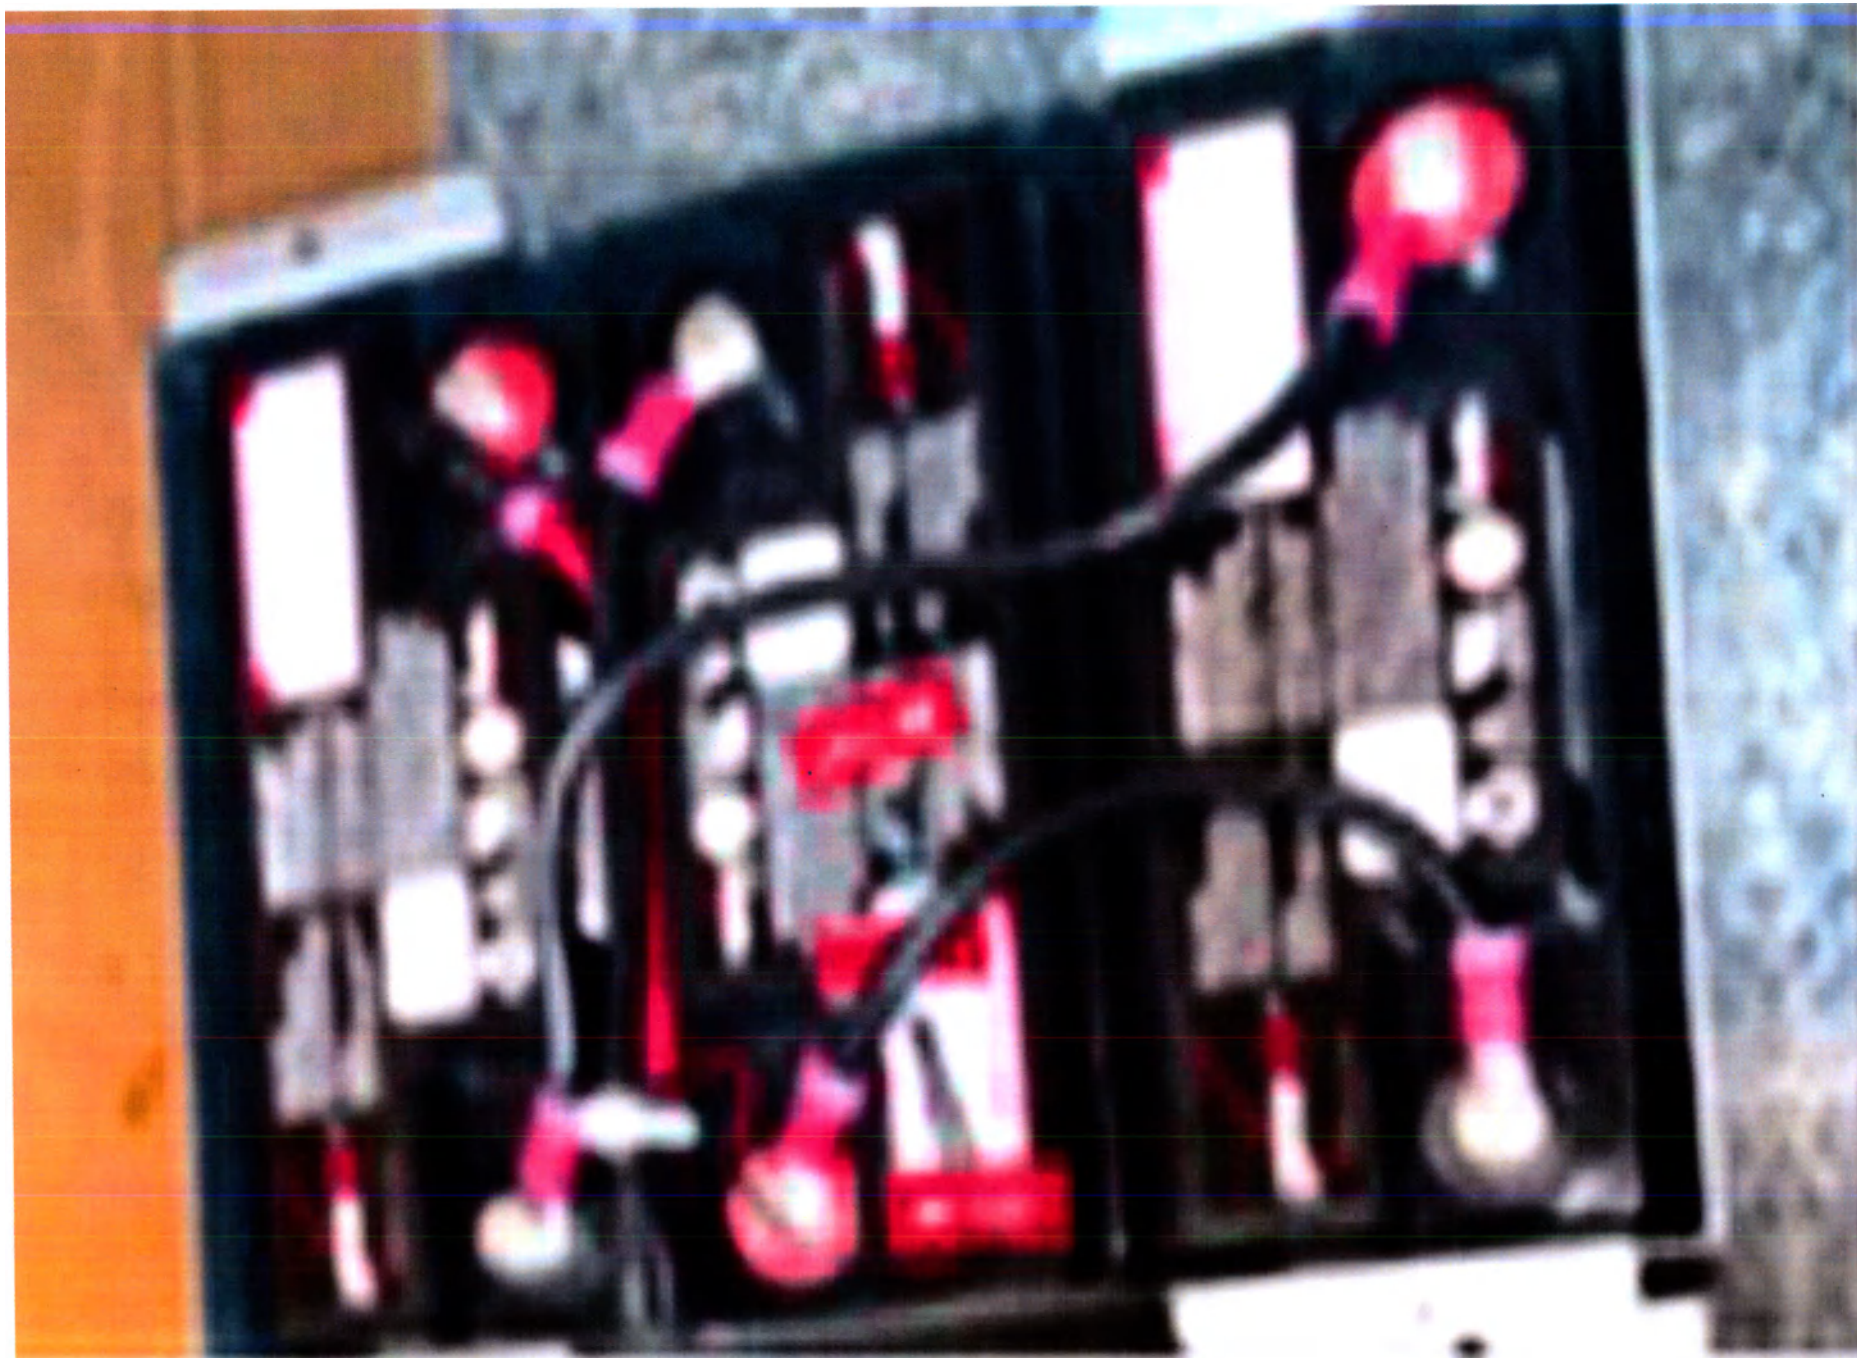







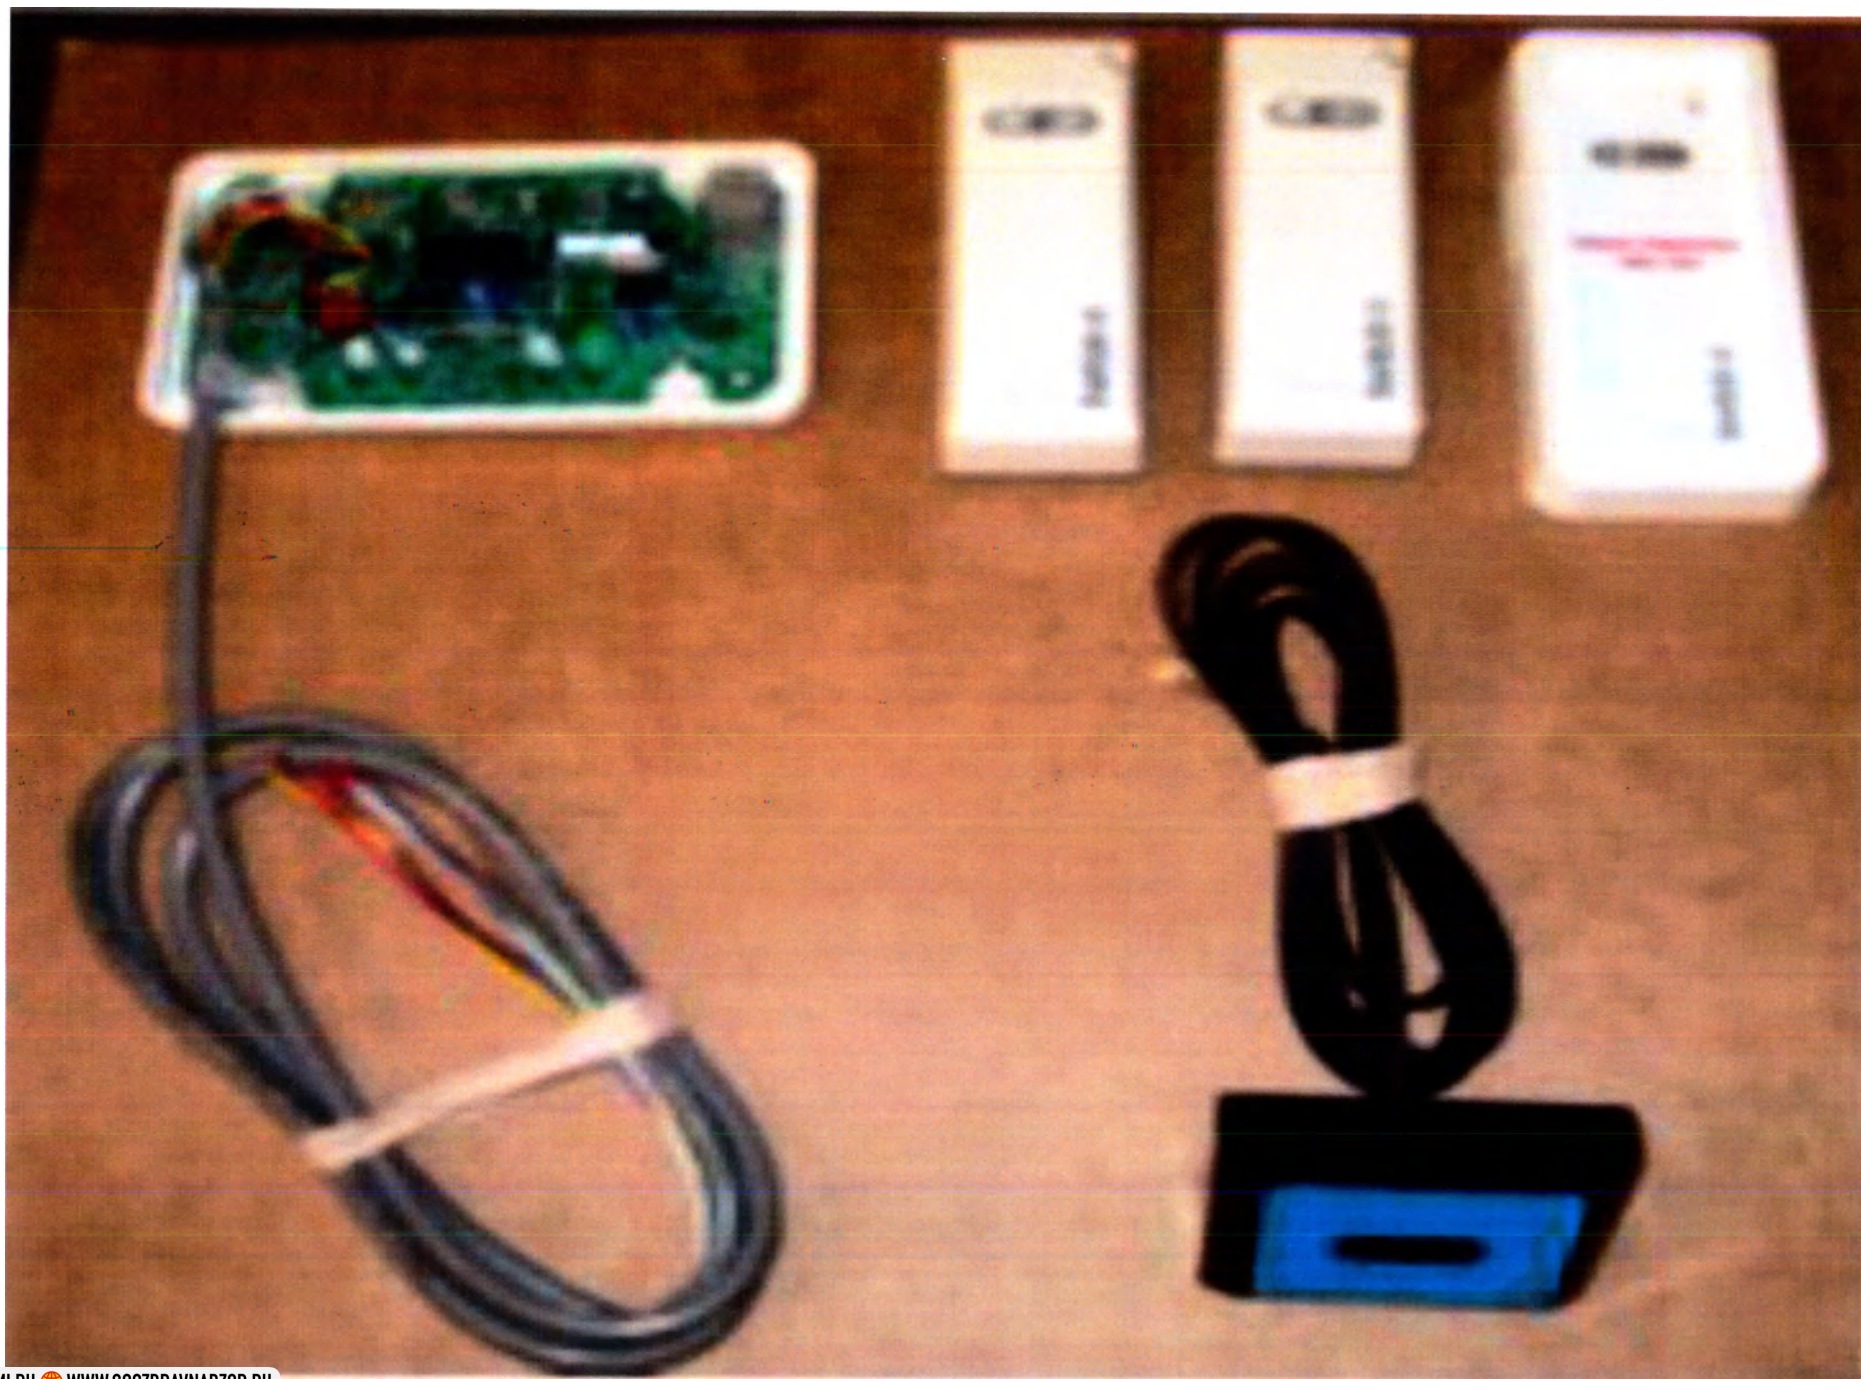


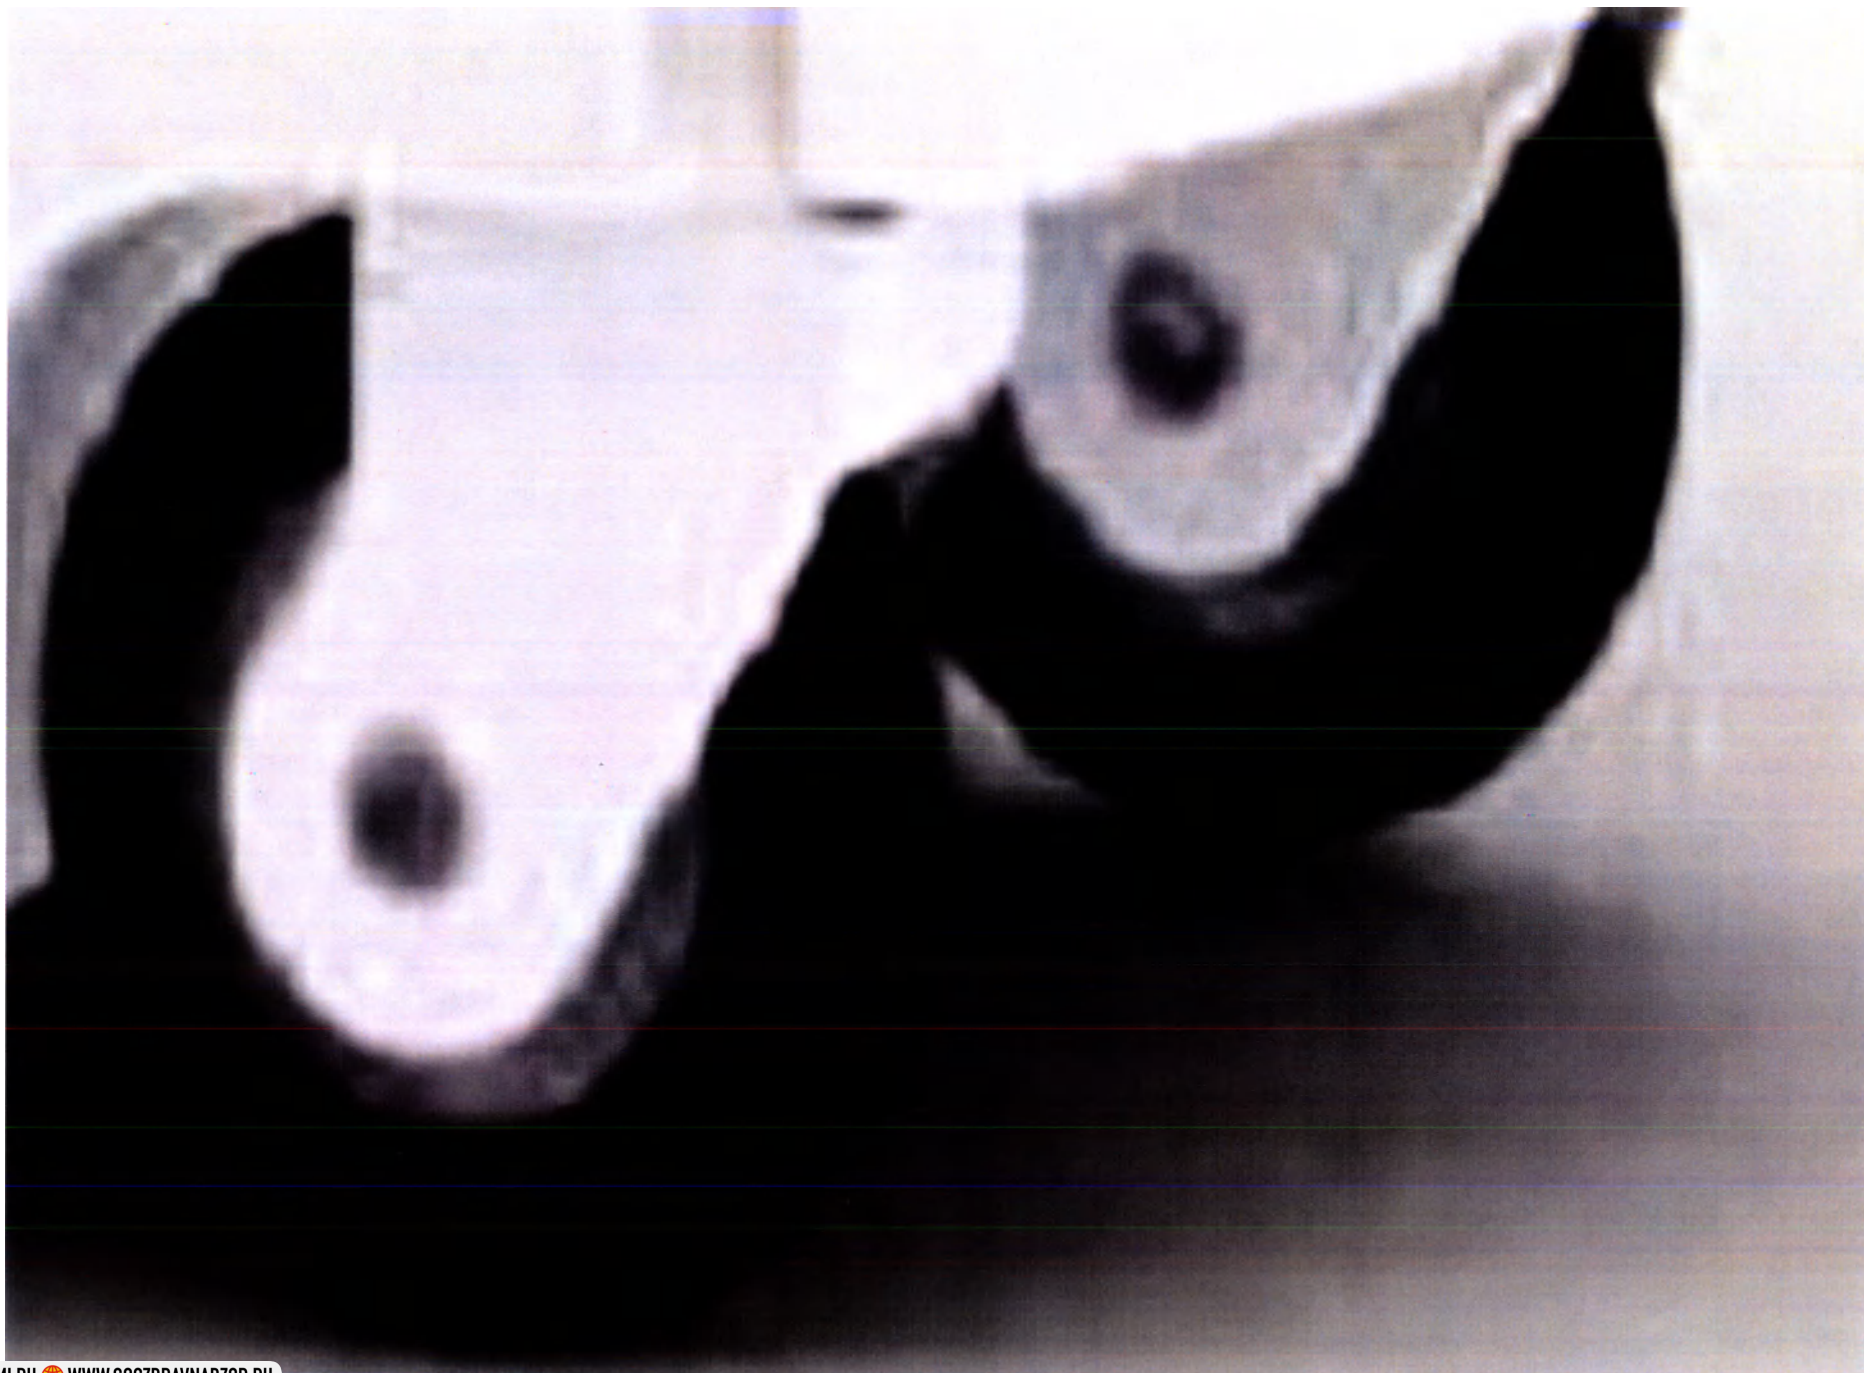


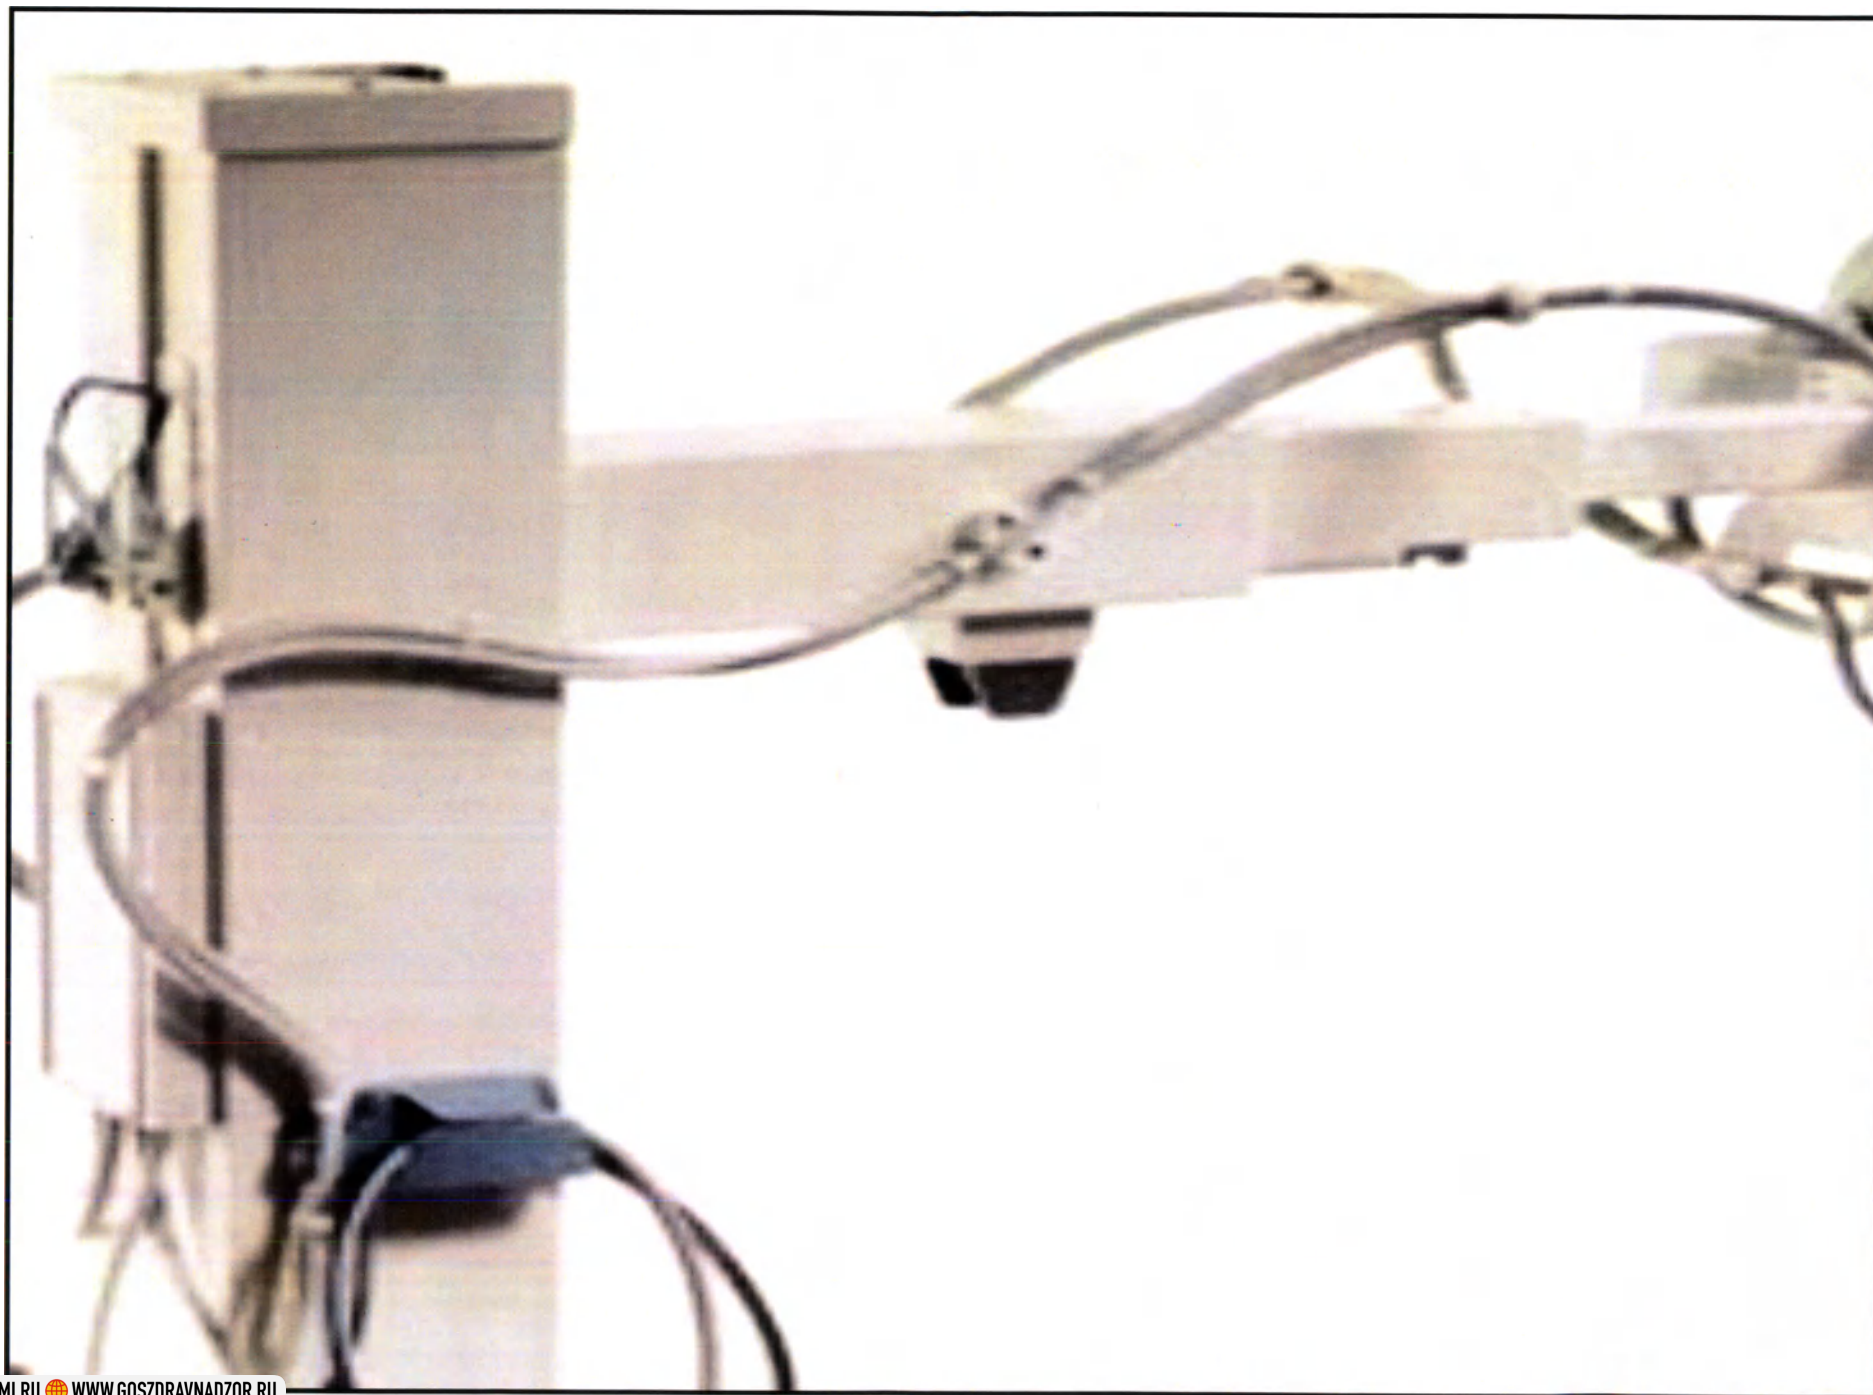




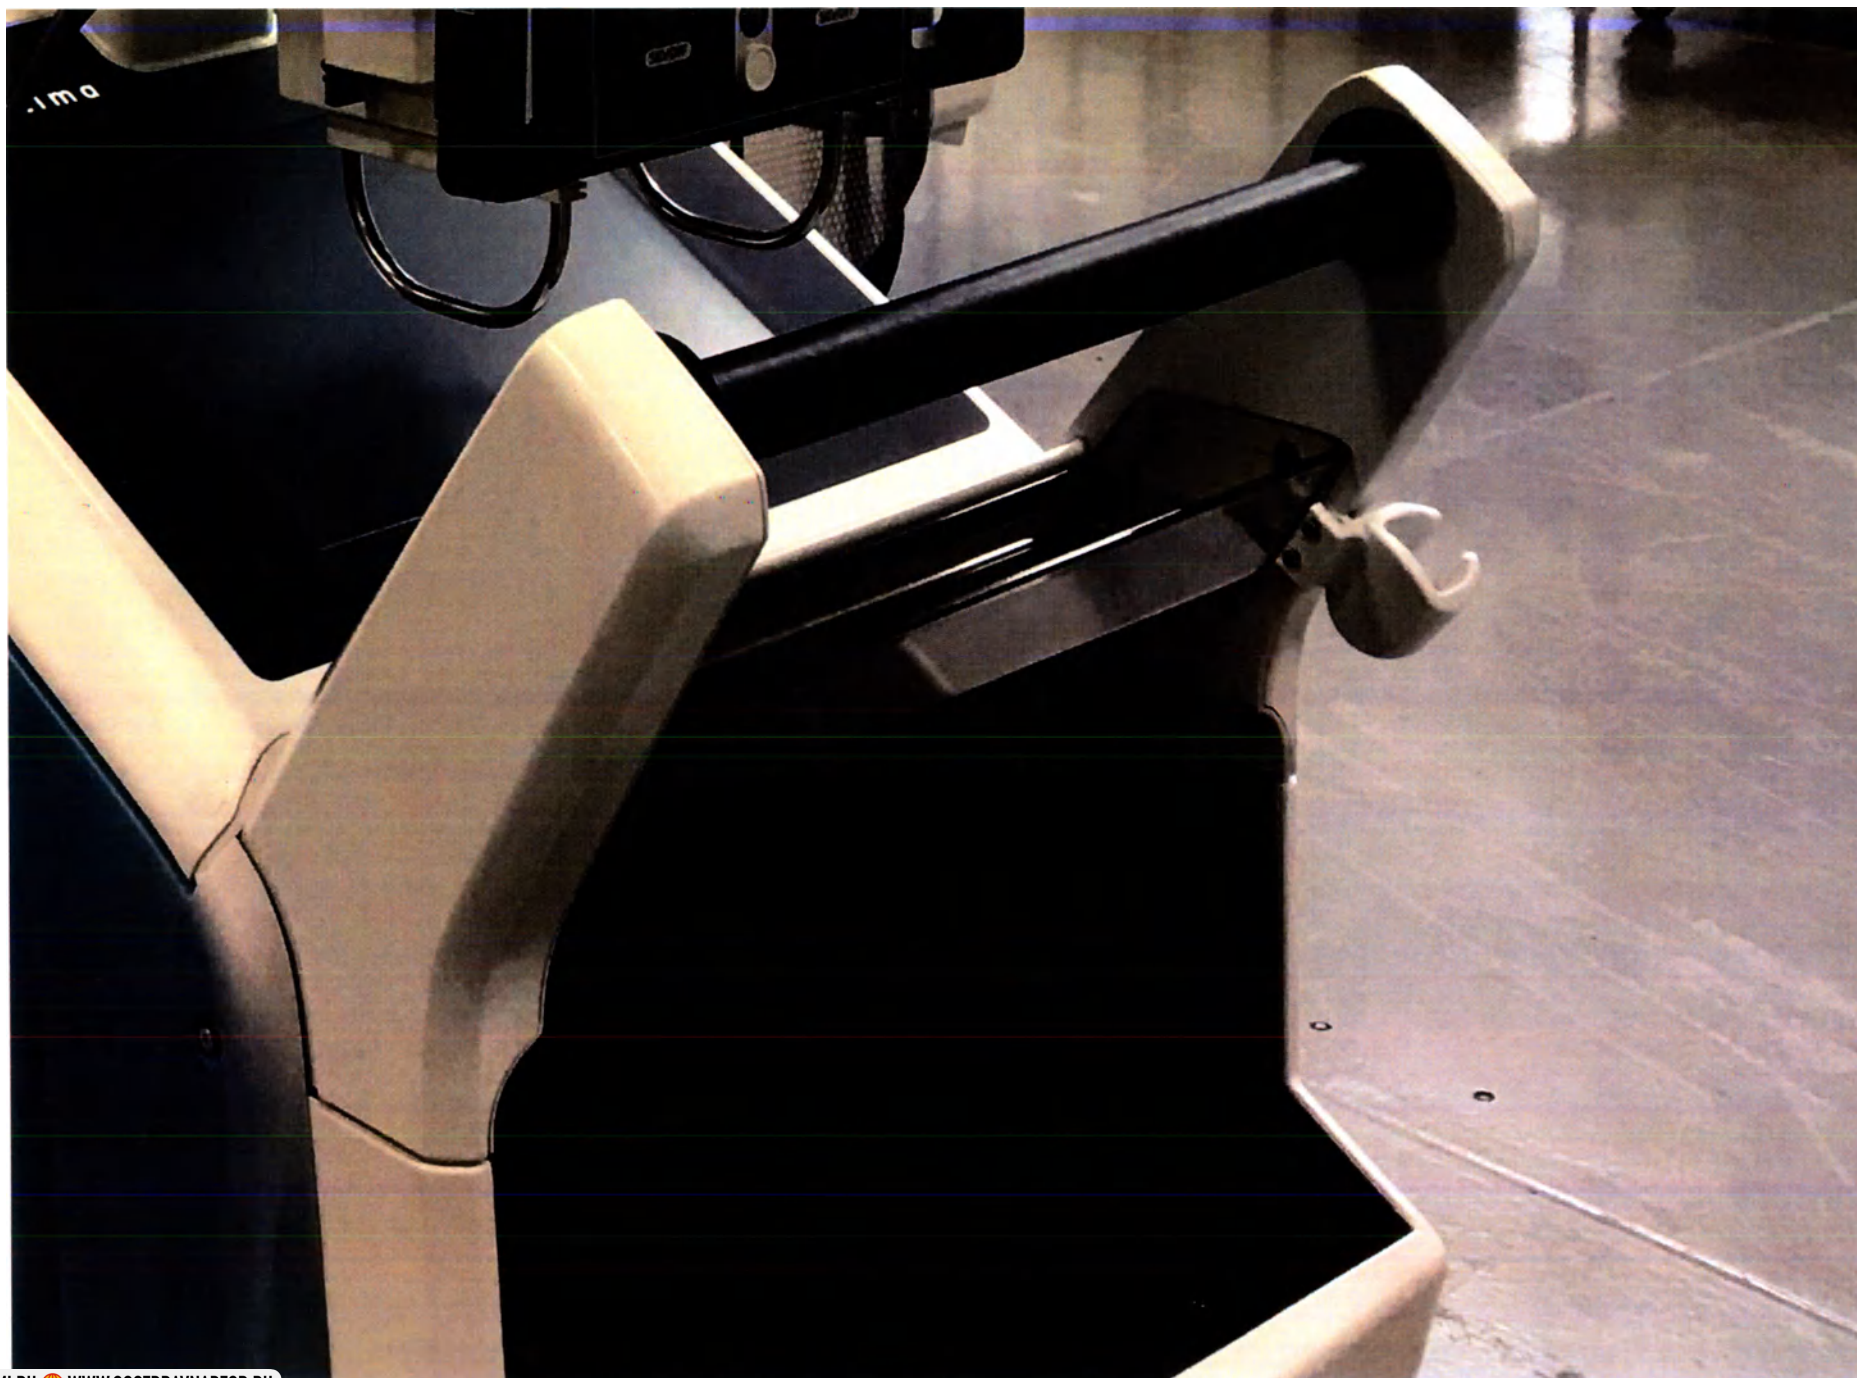

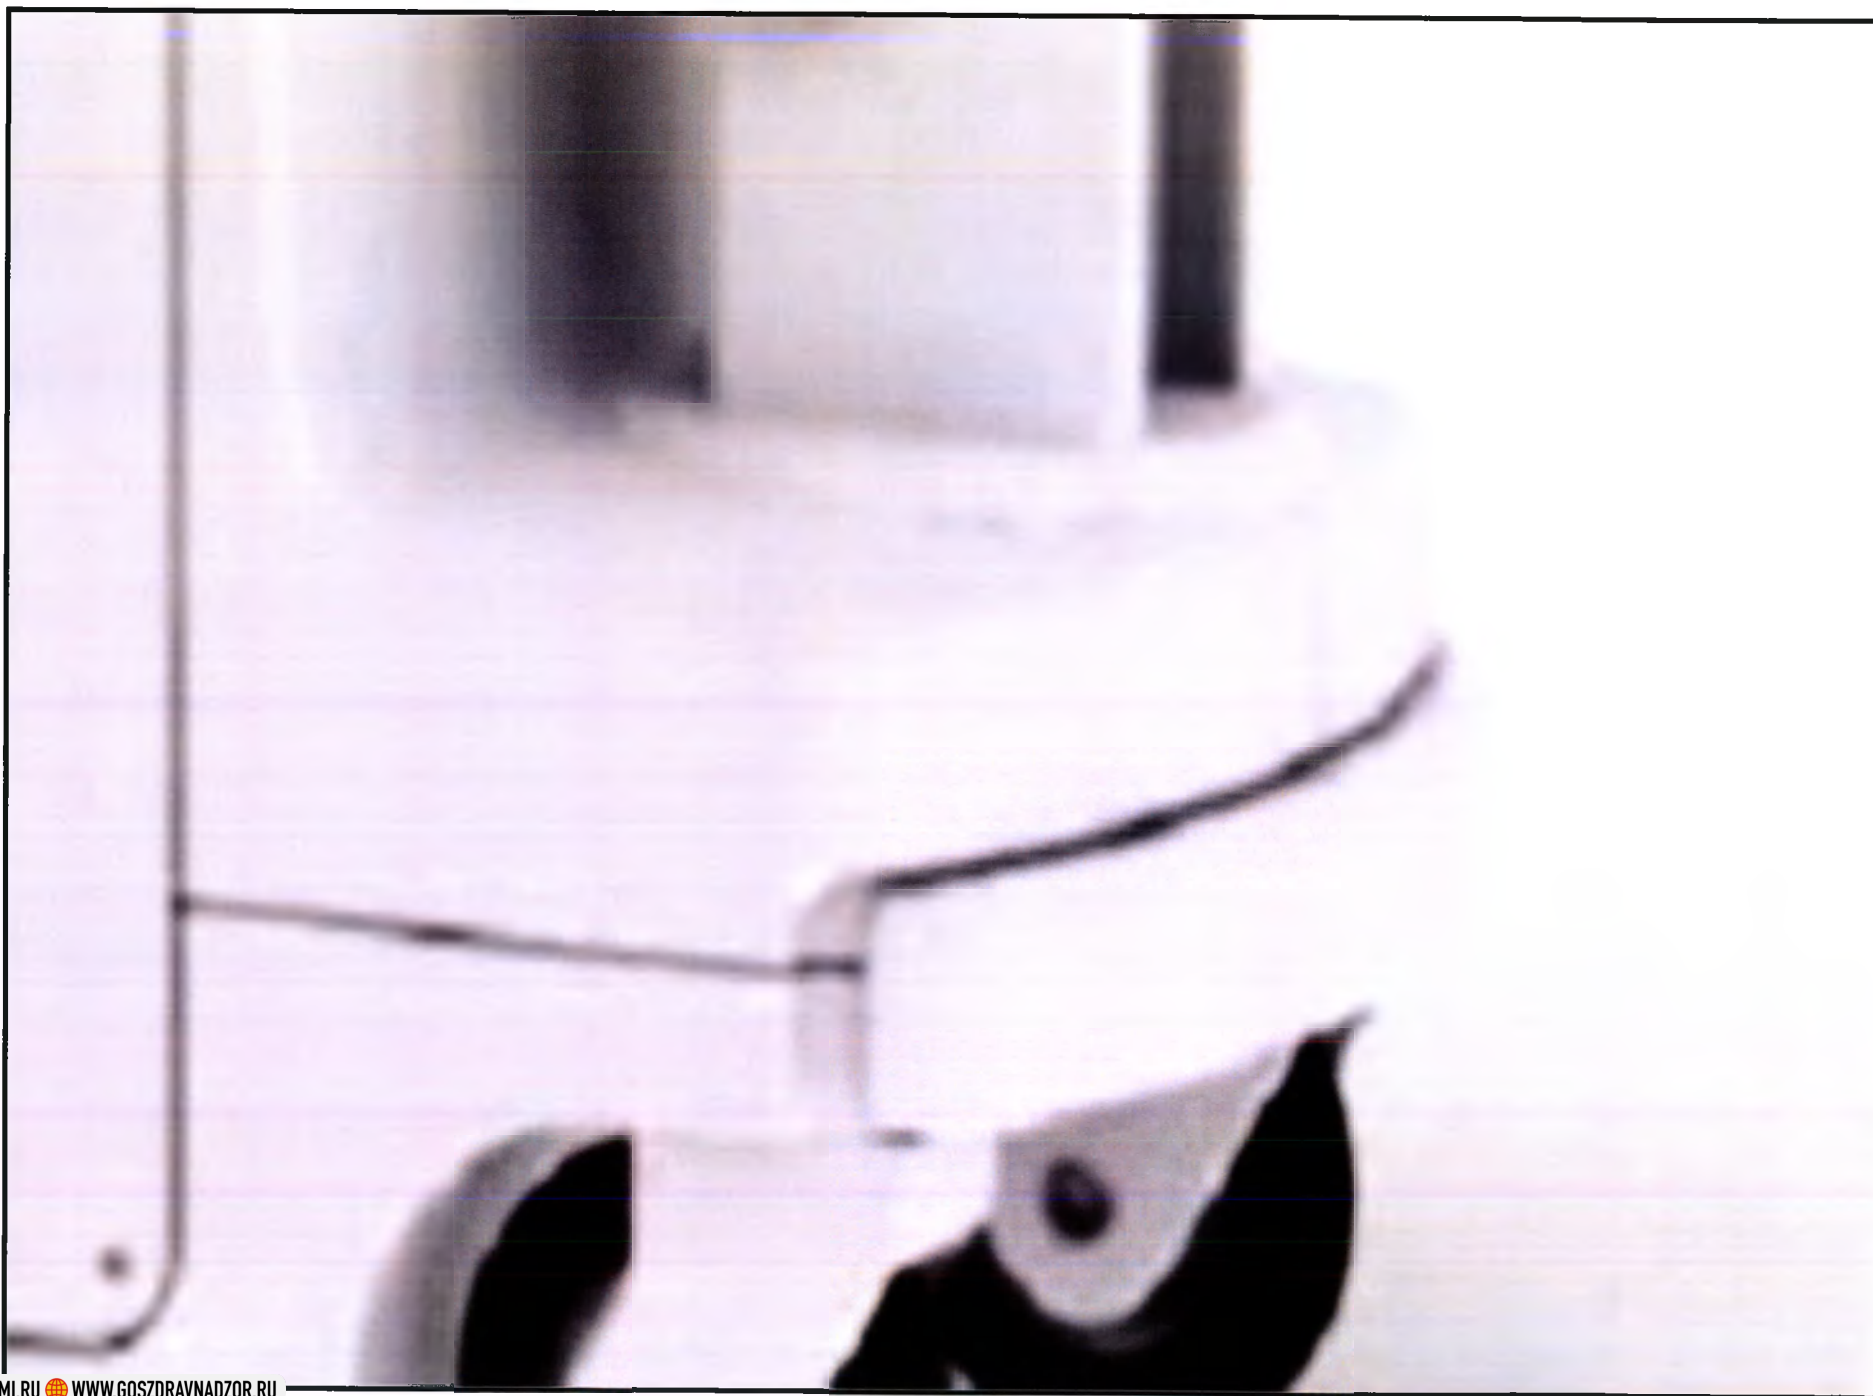

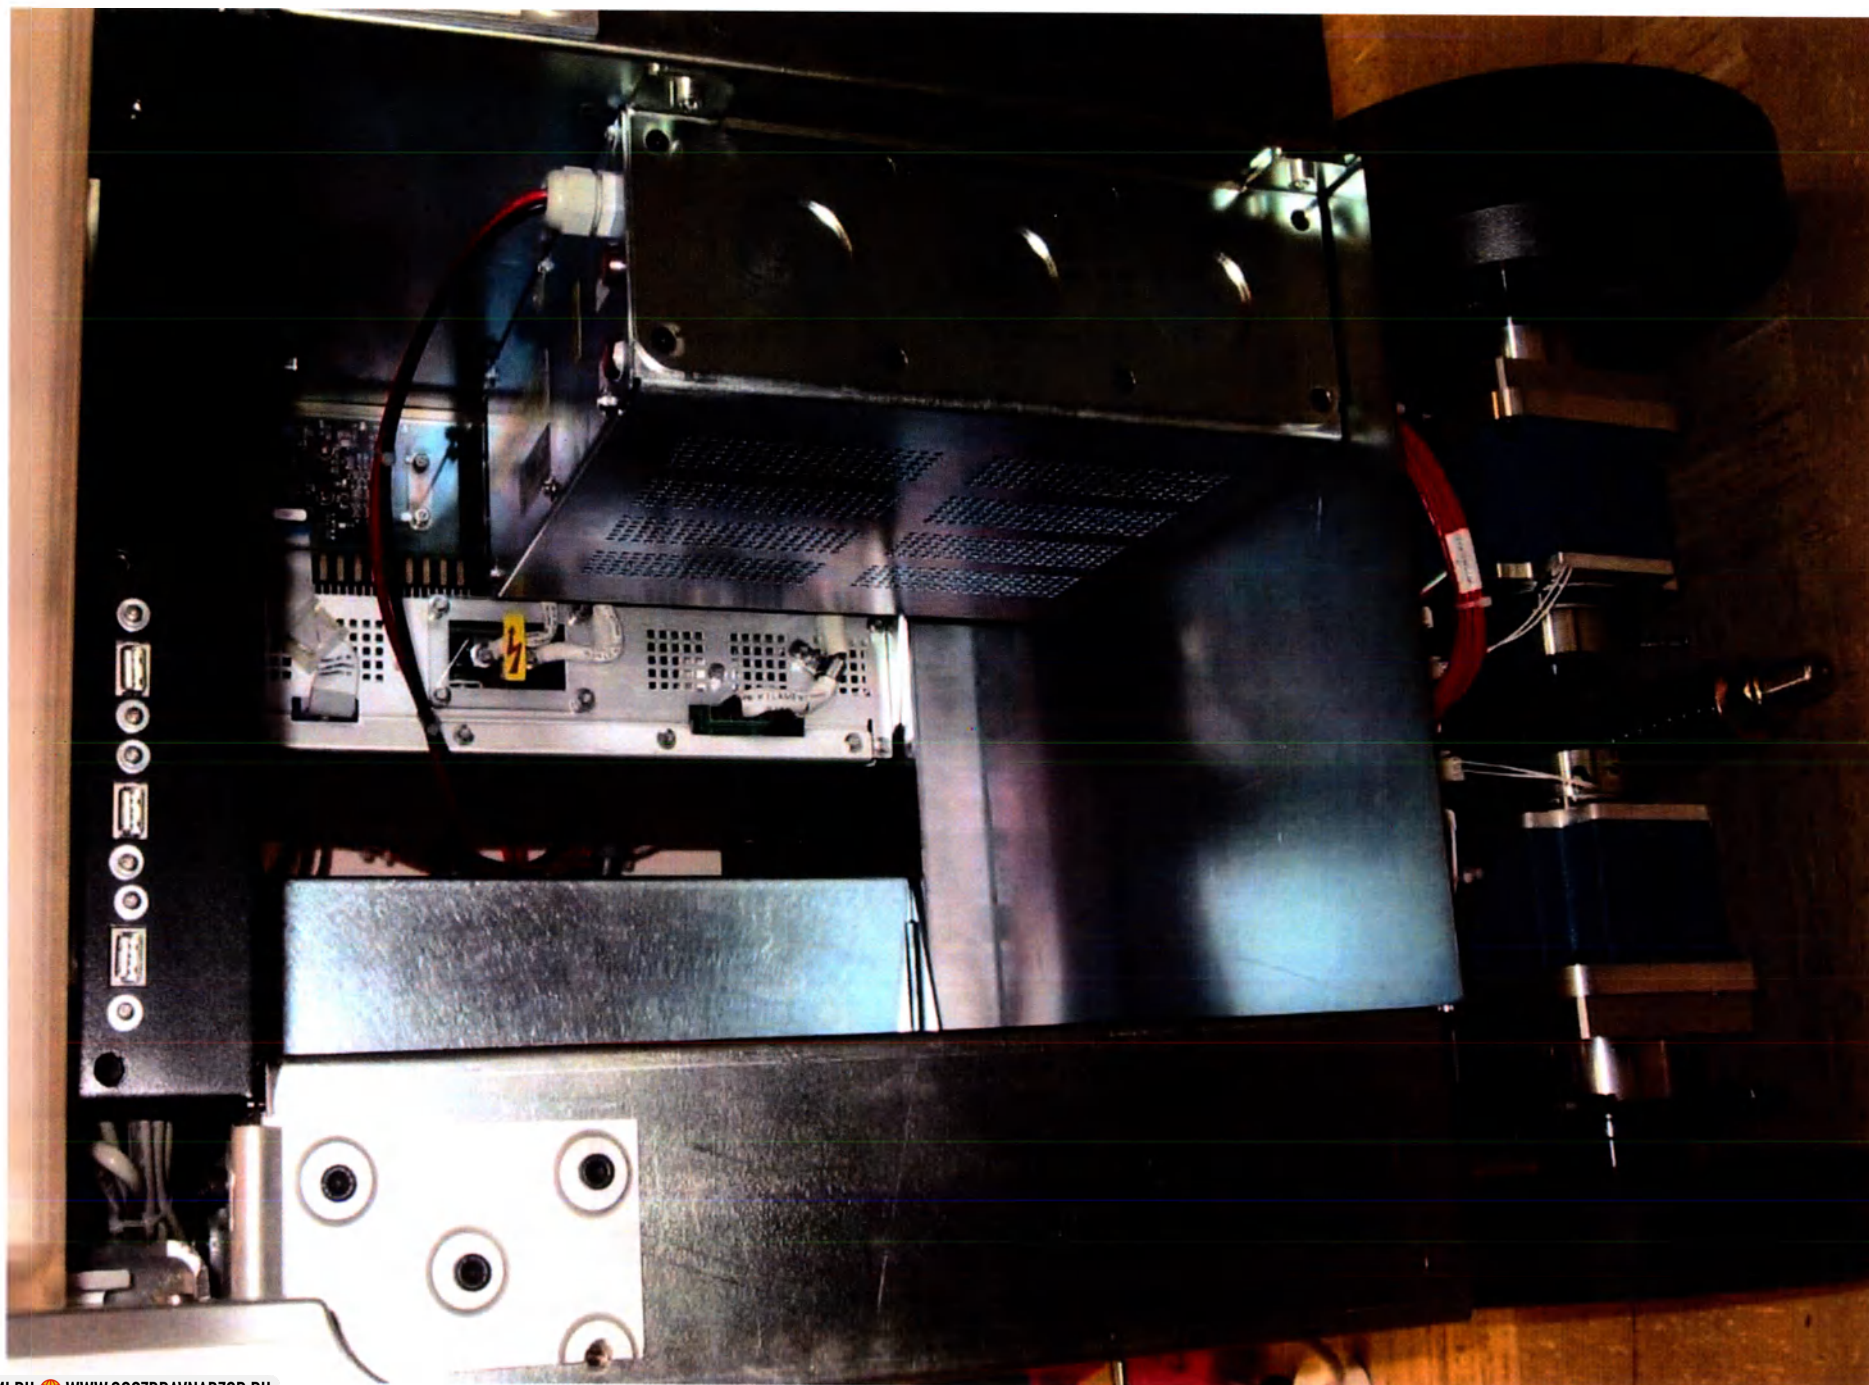

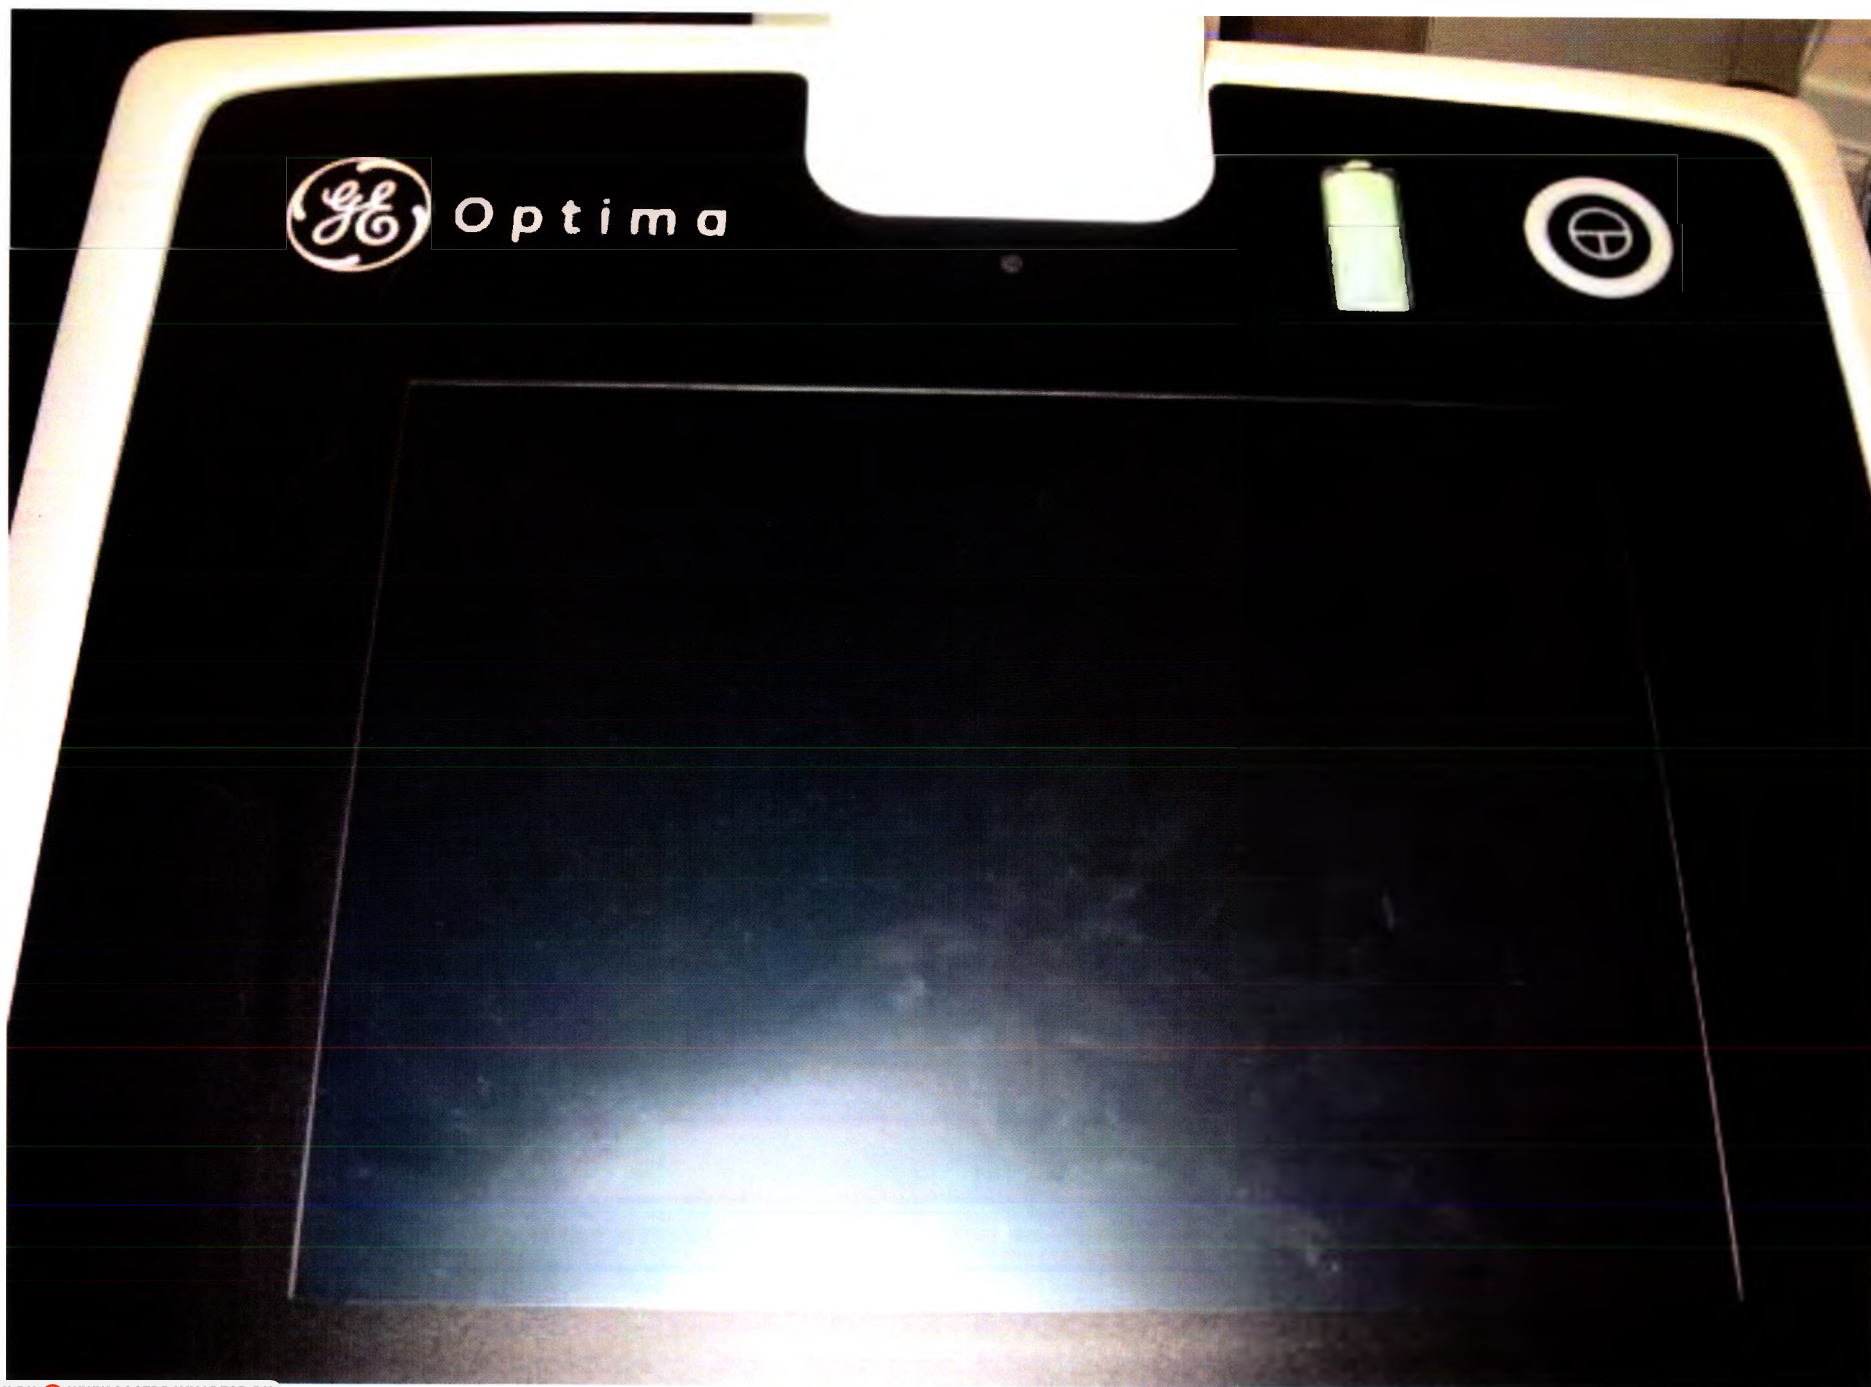


Принадлежности: 1. USB-порты (не более 4 шт.).

20




2. Антенны для беспроводного подключения к сети (не более 2 шт.).

21

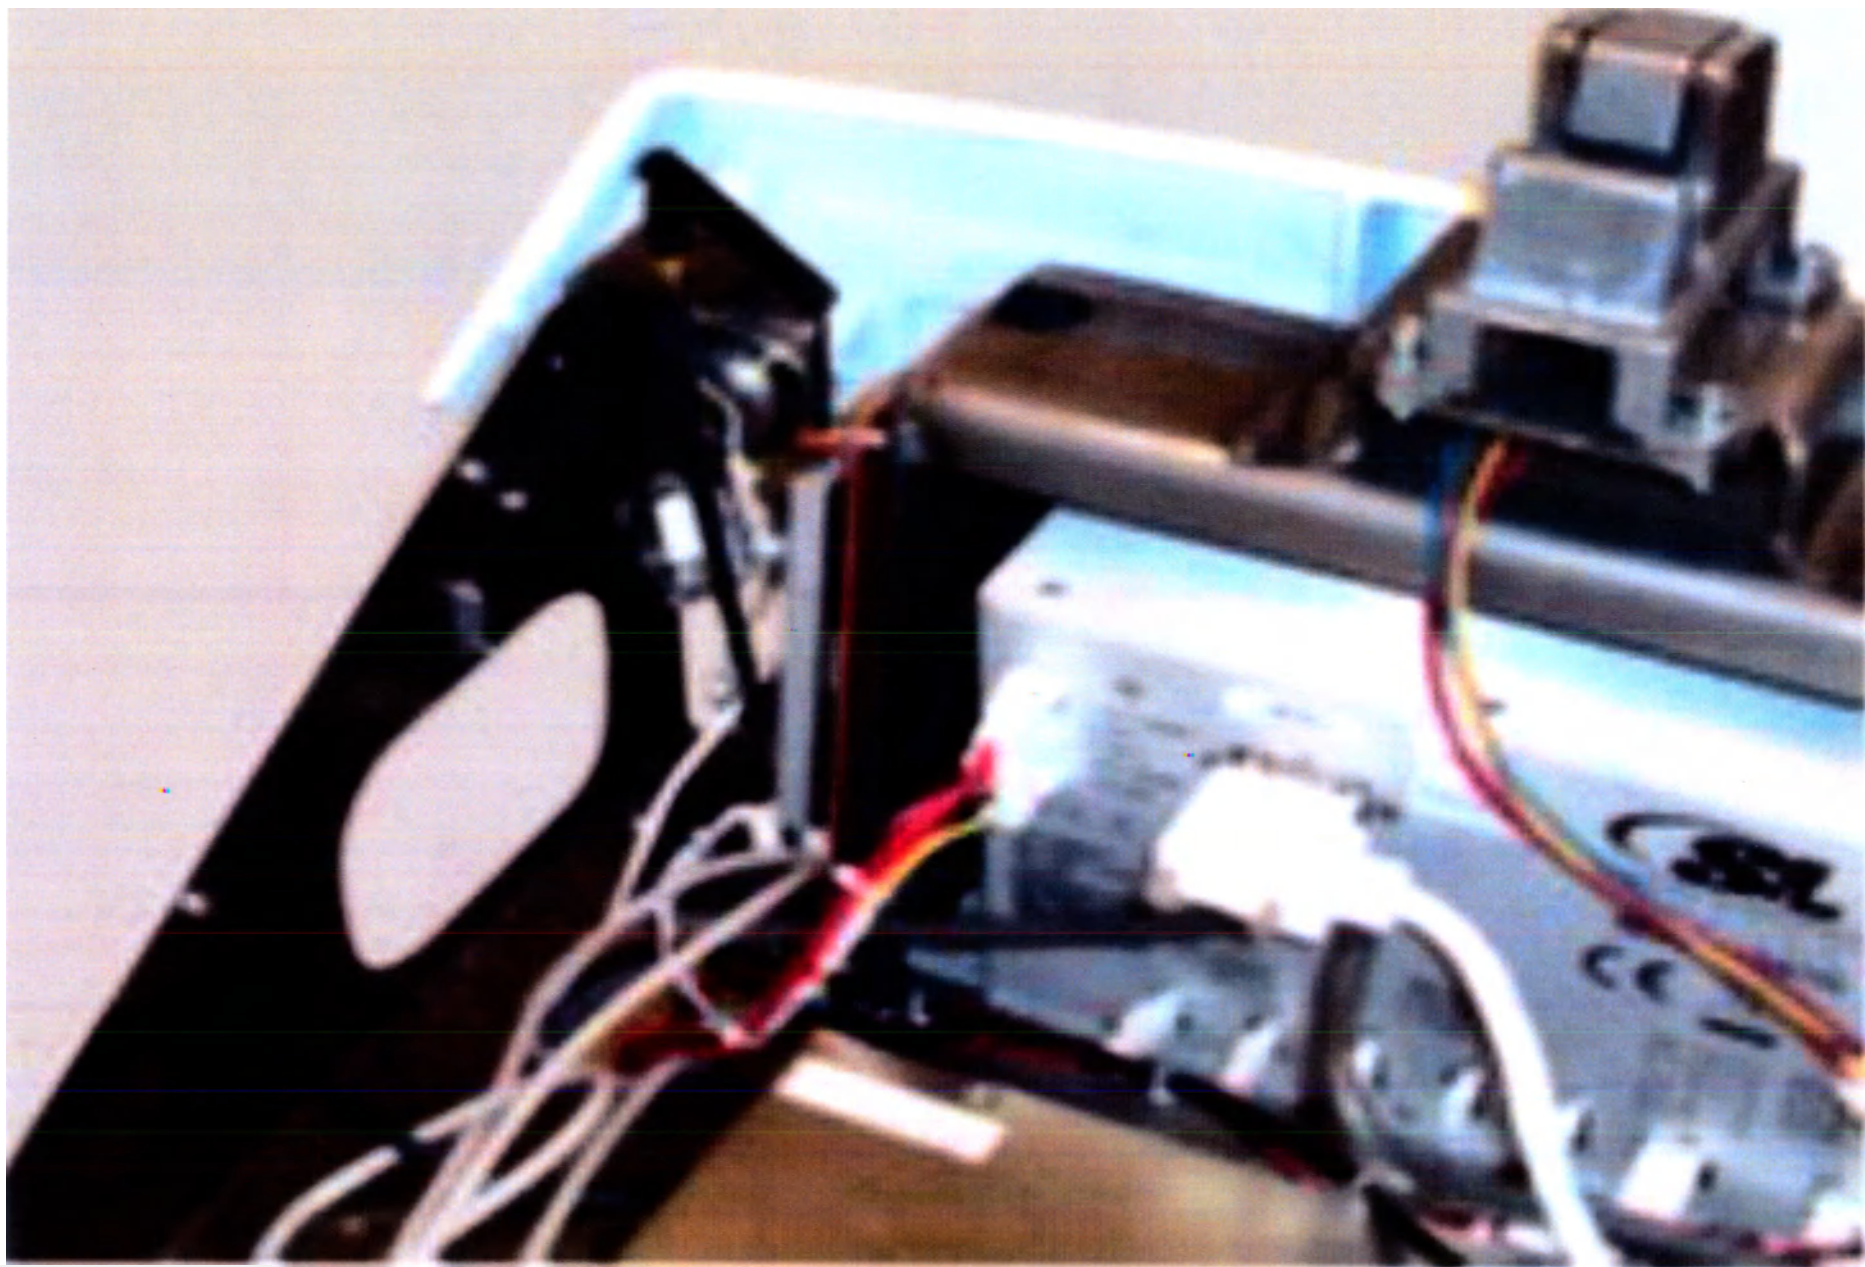


№ п/п	Наименование
1	1. 1-й этаж - 1-й этаж
2	2. 1-й этаж - 1-й этаж
3	3. 1-й этаж - 1-й этаж
4	4. 1-й этаж - 1-й этаж
5	5. 1-й этаж - 1-й этаж
6	6. 1-й этаж - 1-й этаж
7	7. 1-й этаж - 1-й этаж




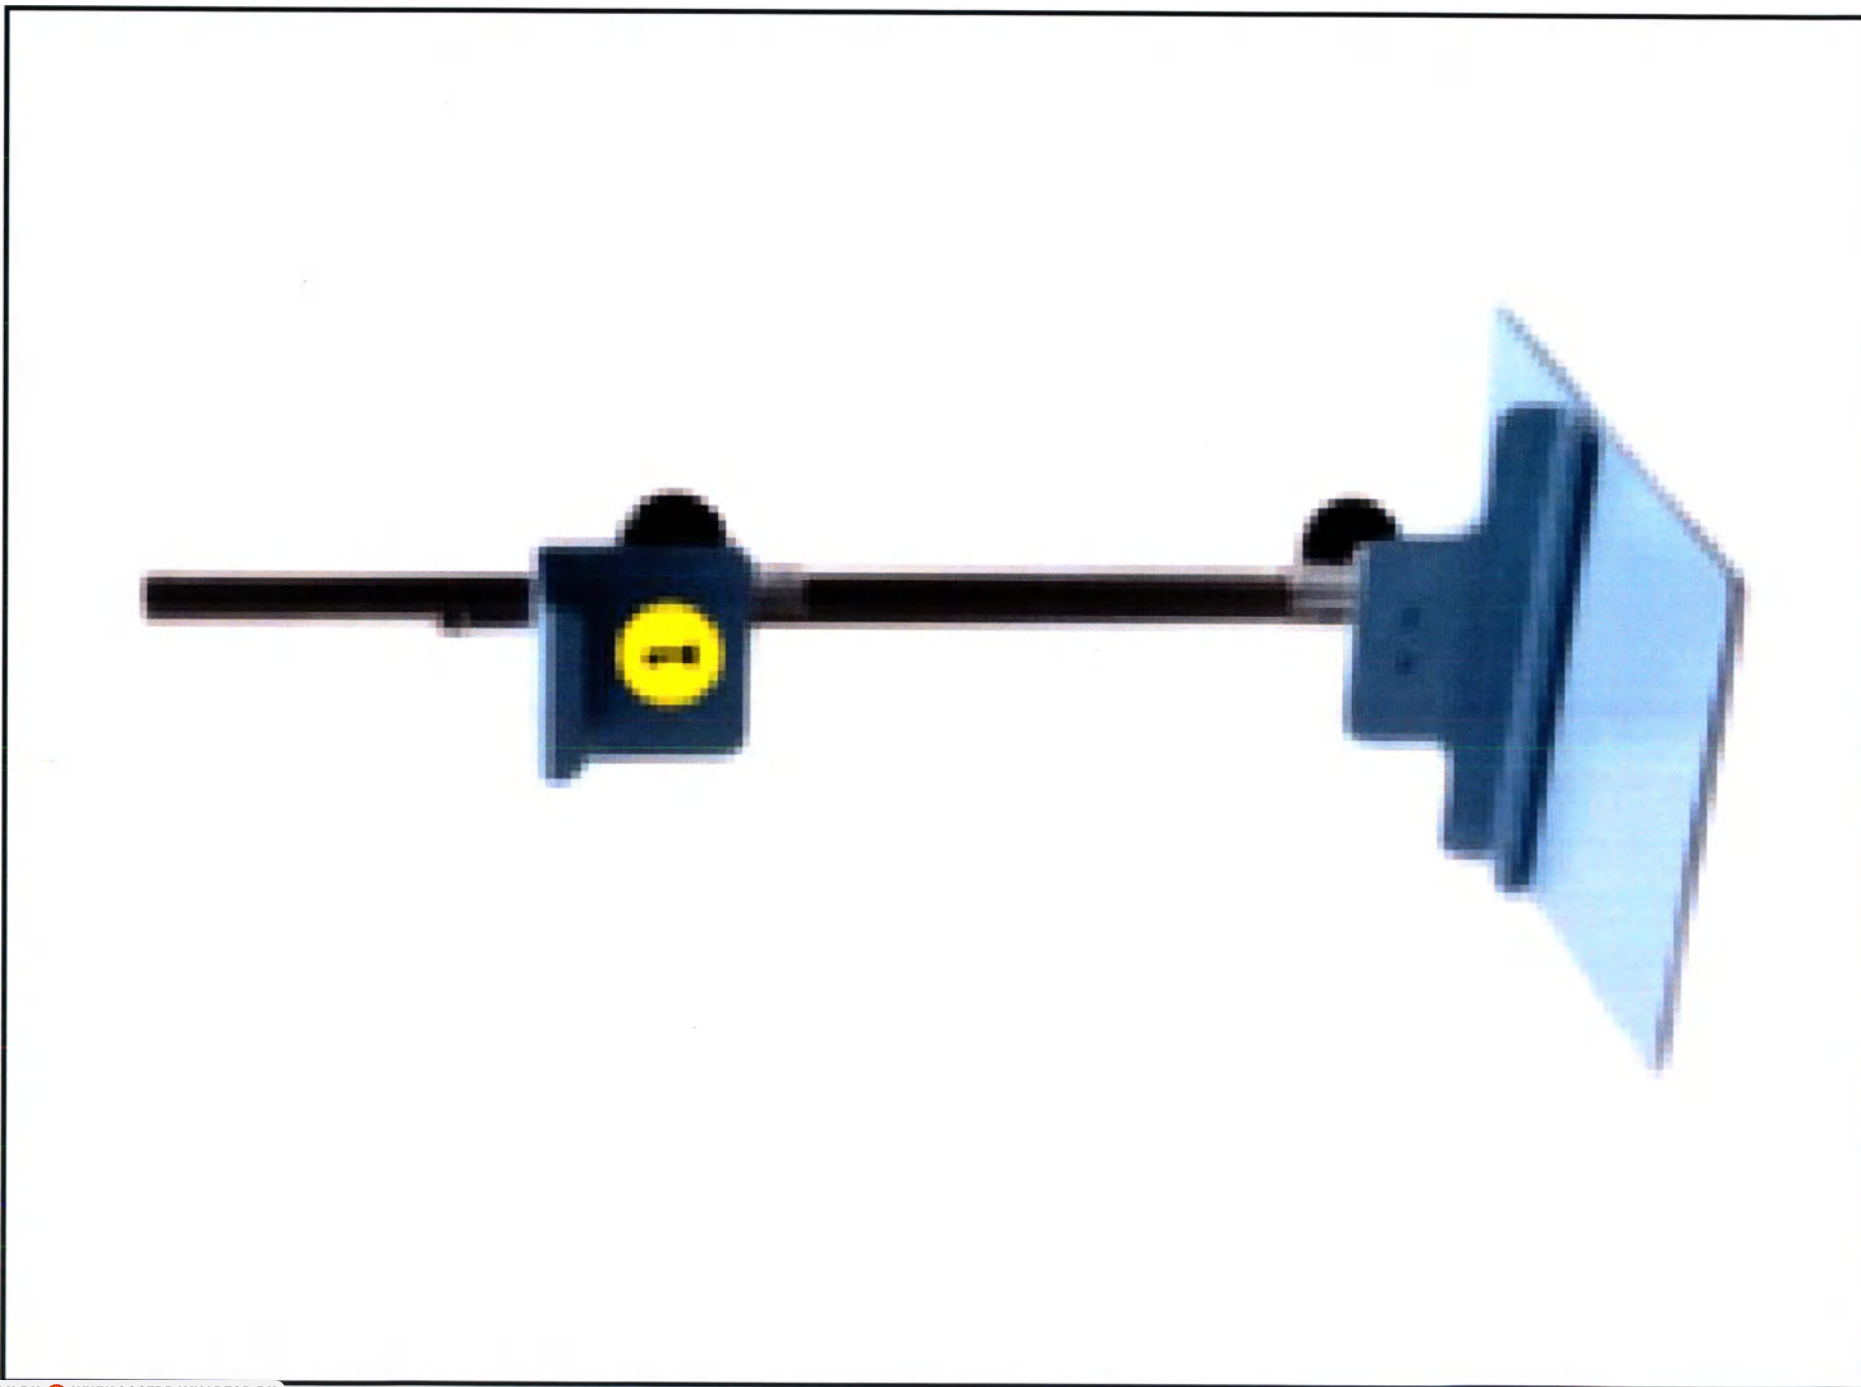



6. Дополнительные растры (не более 2 шт).

25

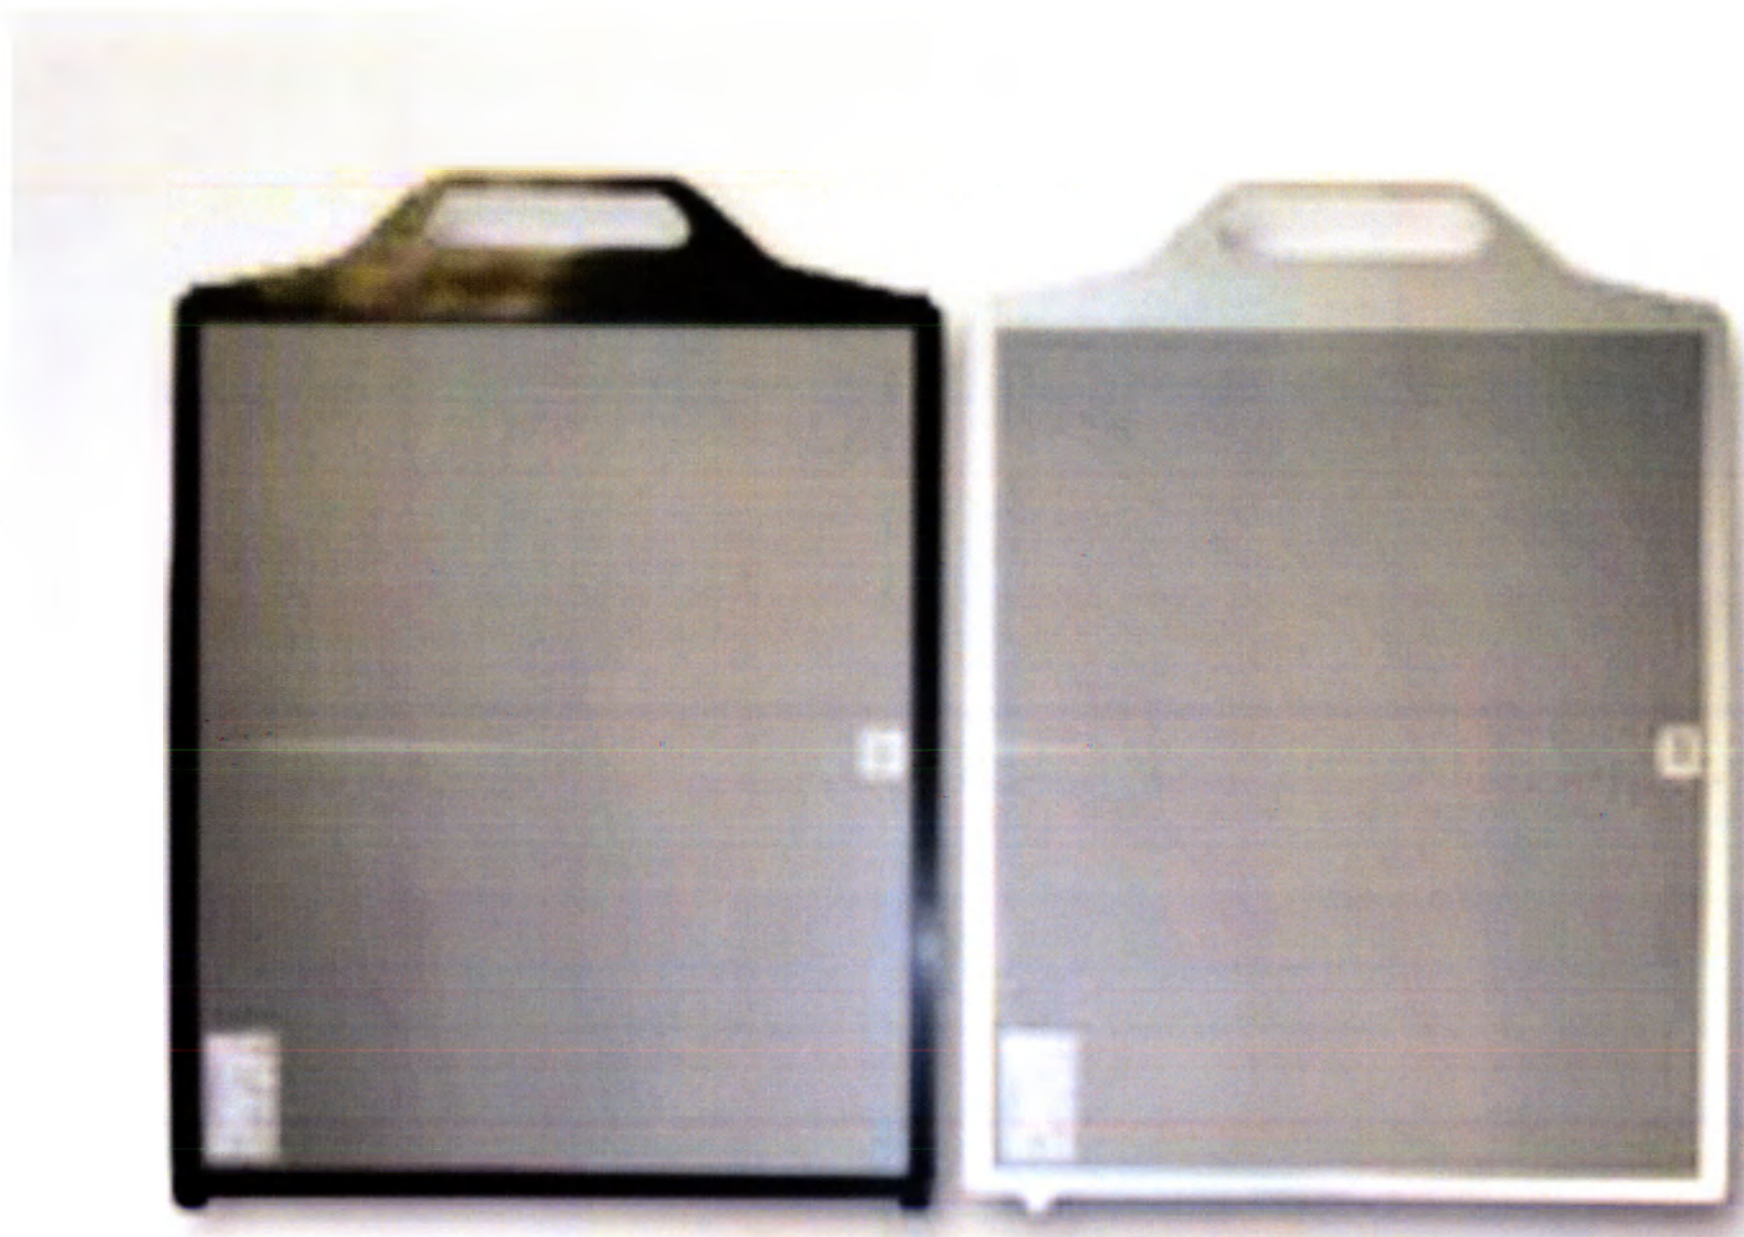

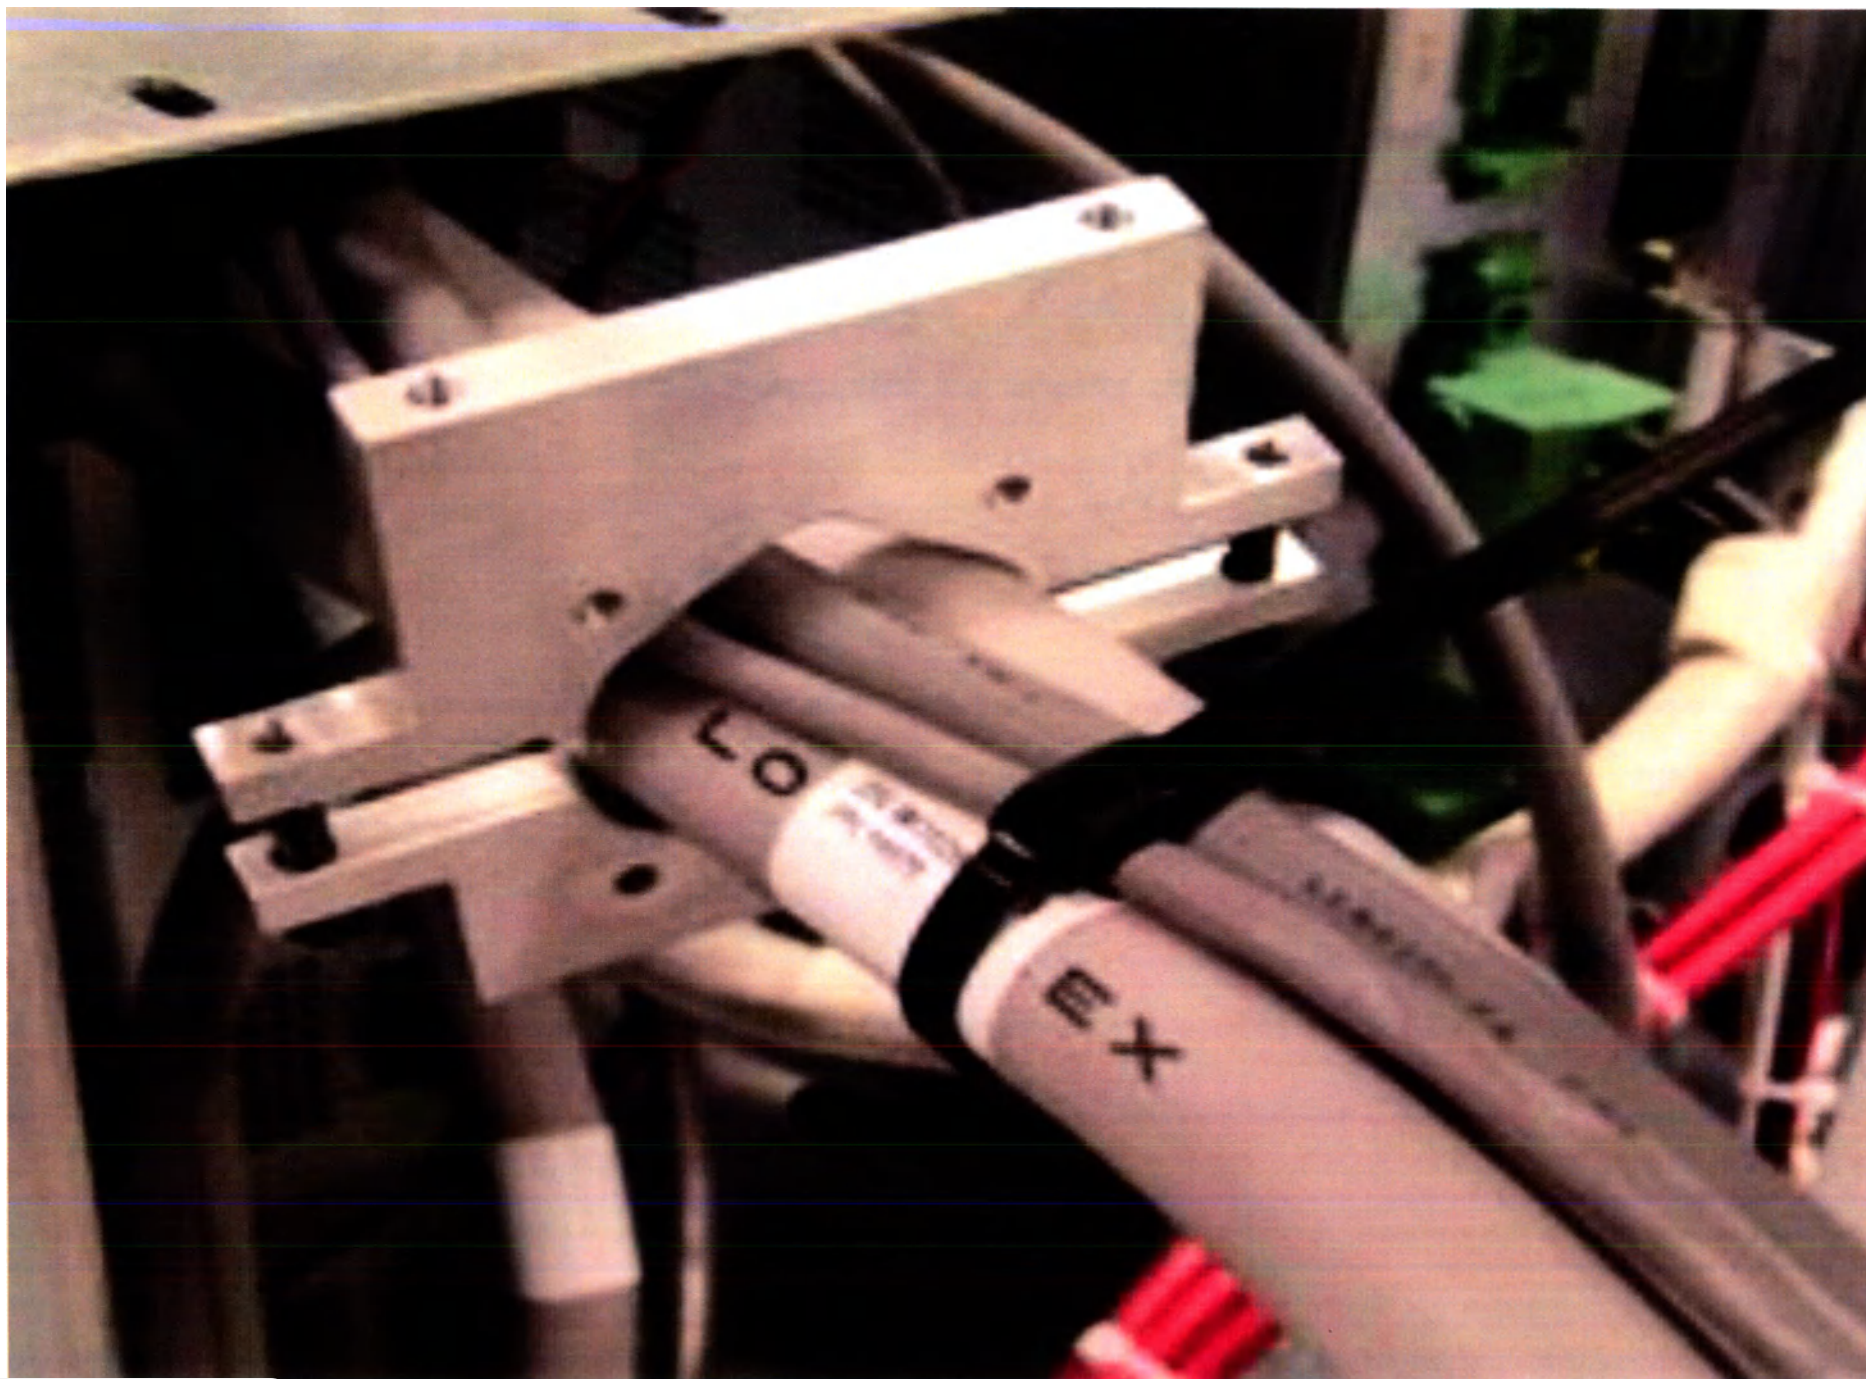

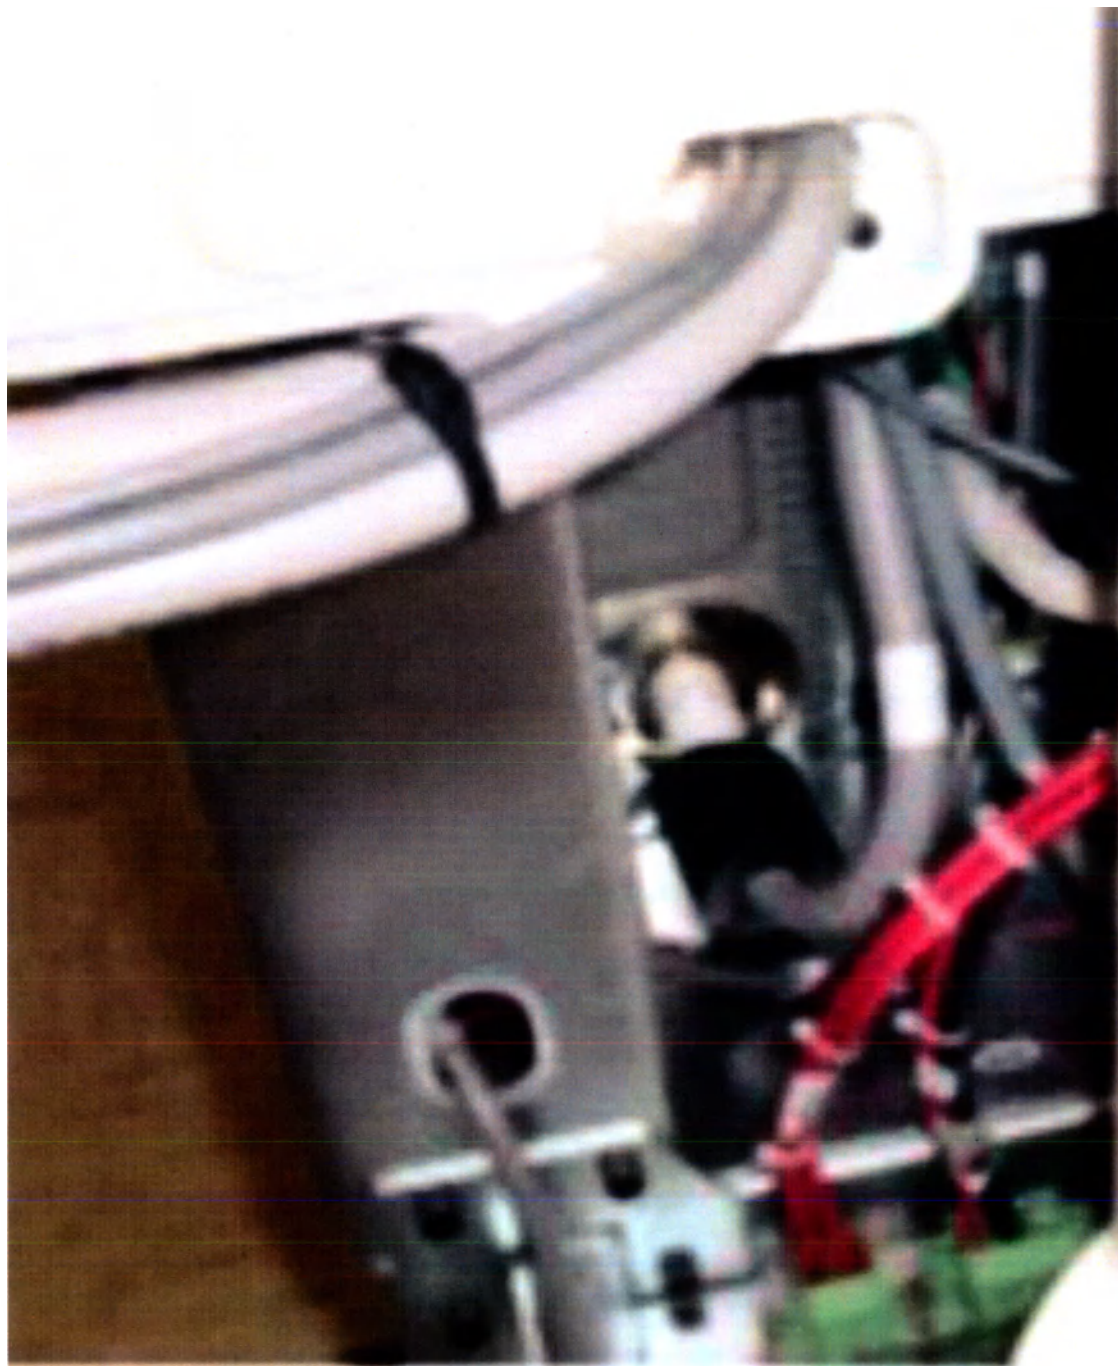

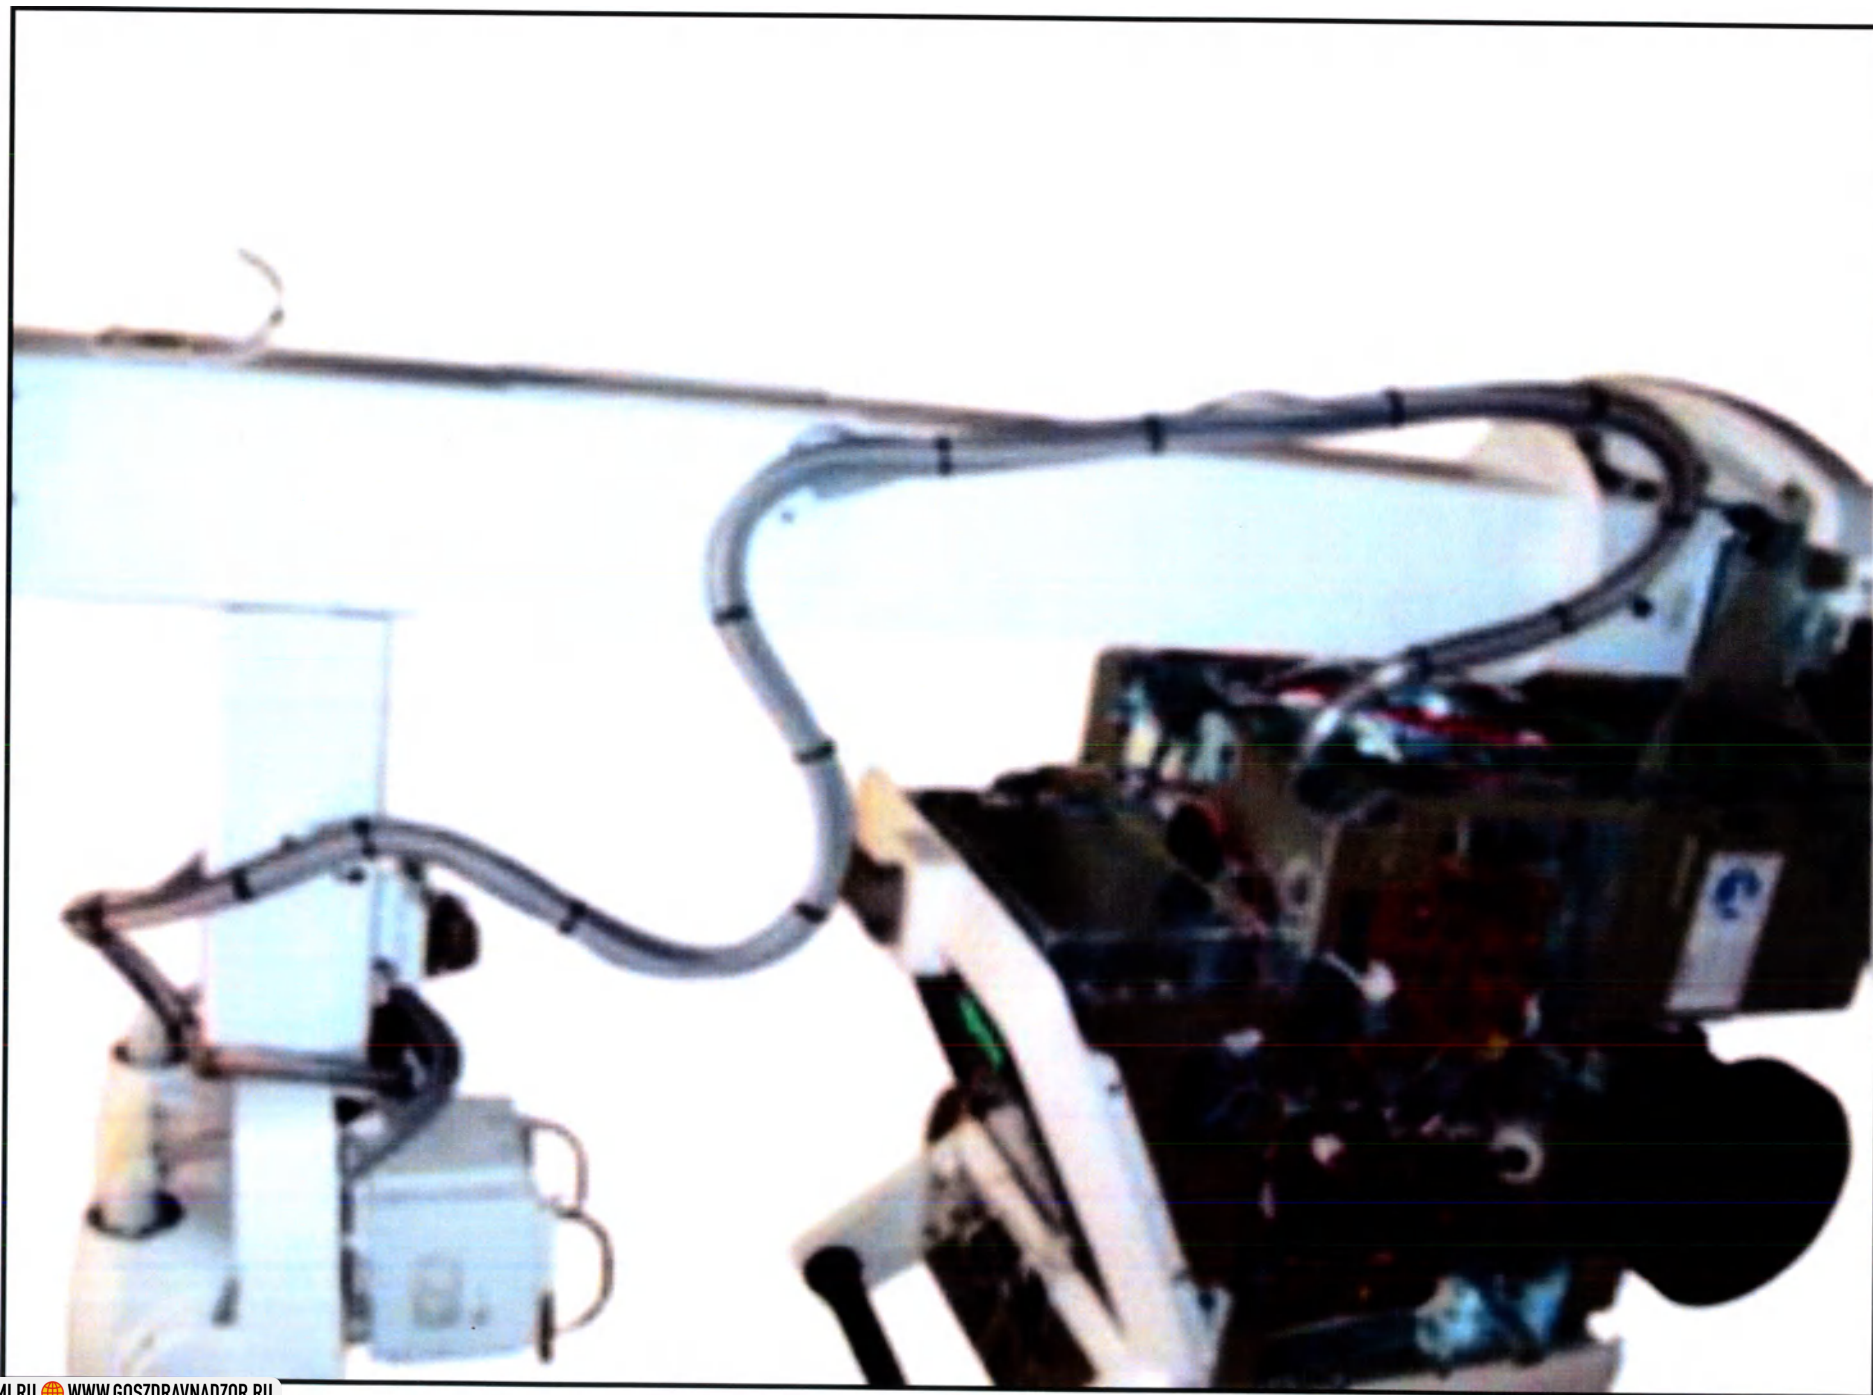



8. Лазерная мультимедийная камера.













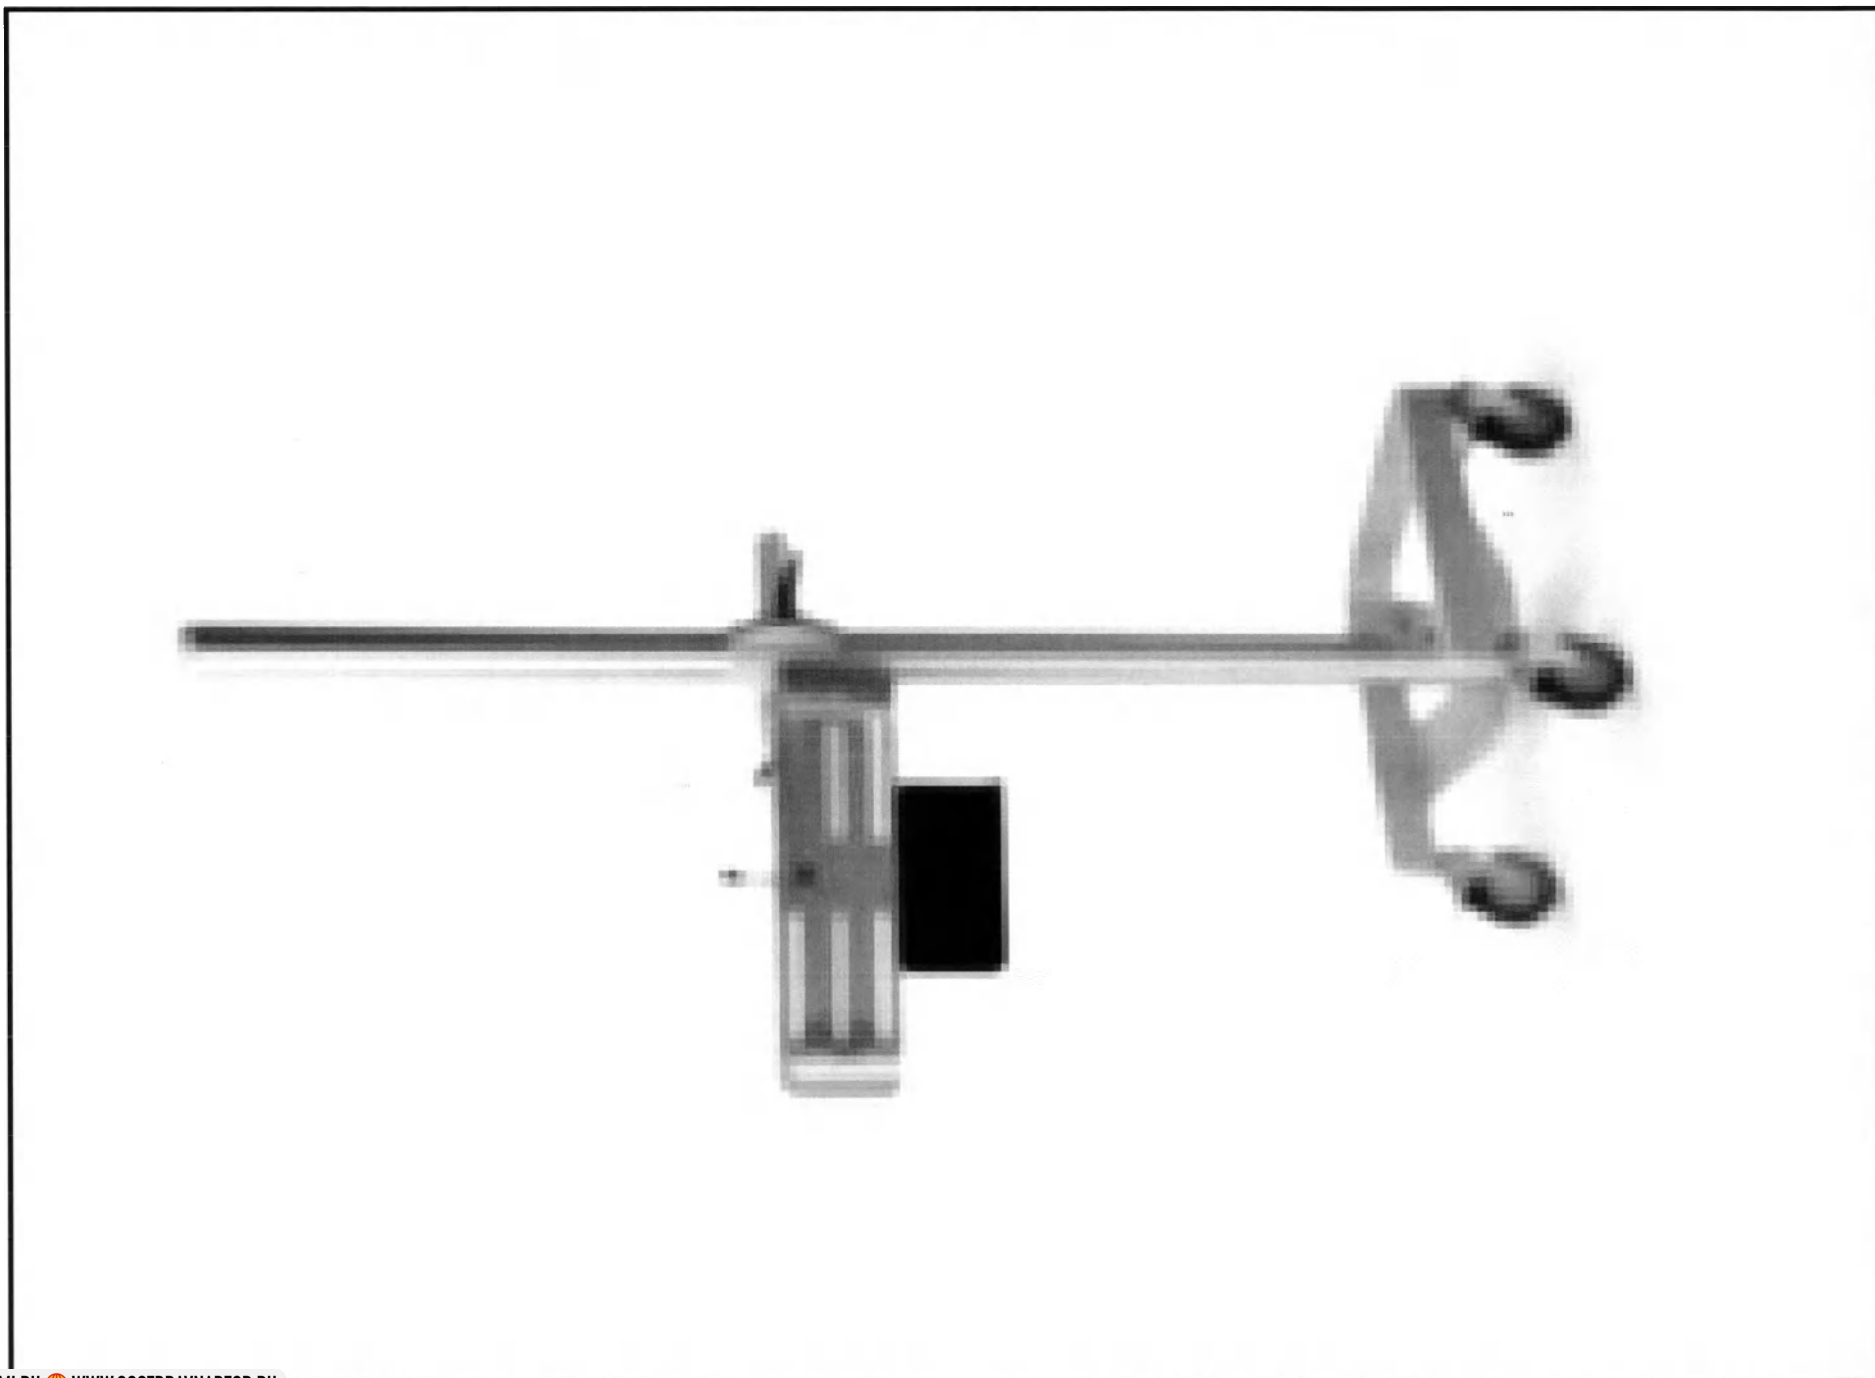

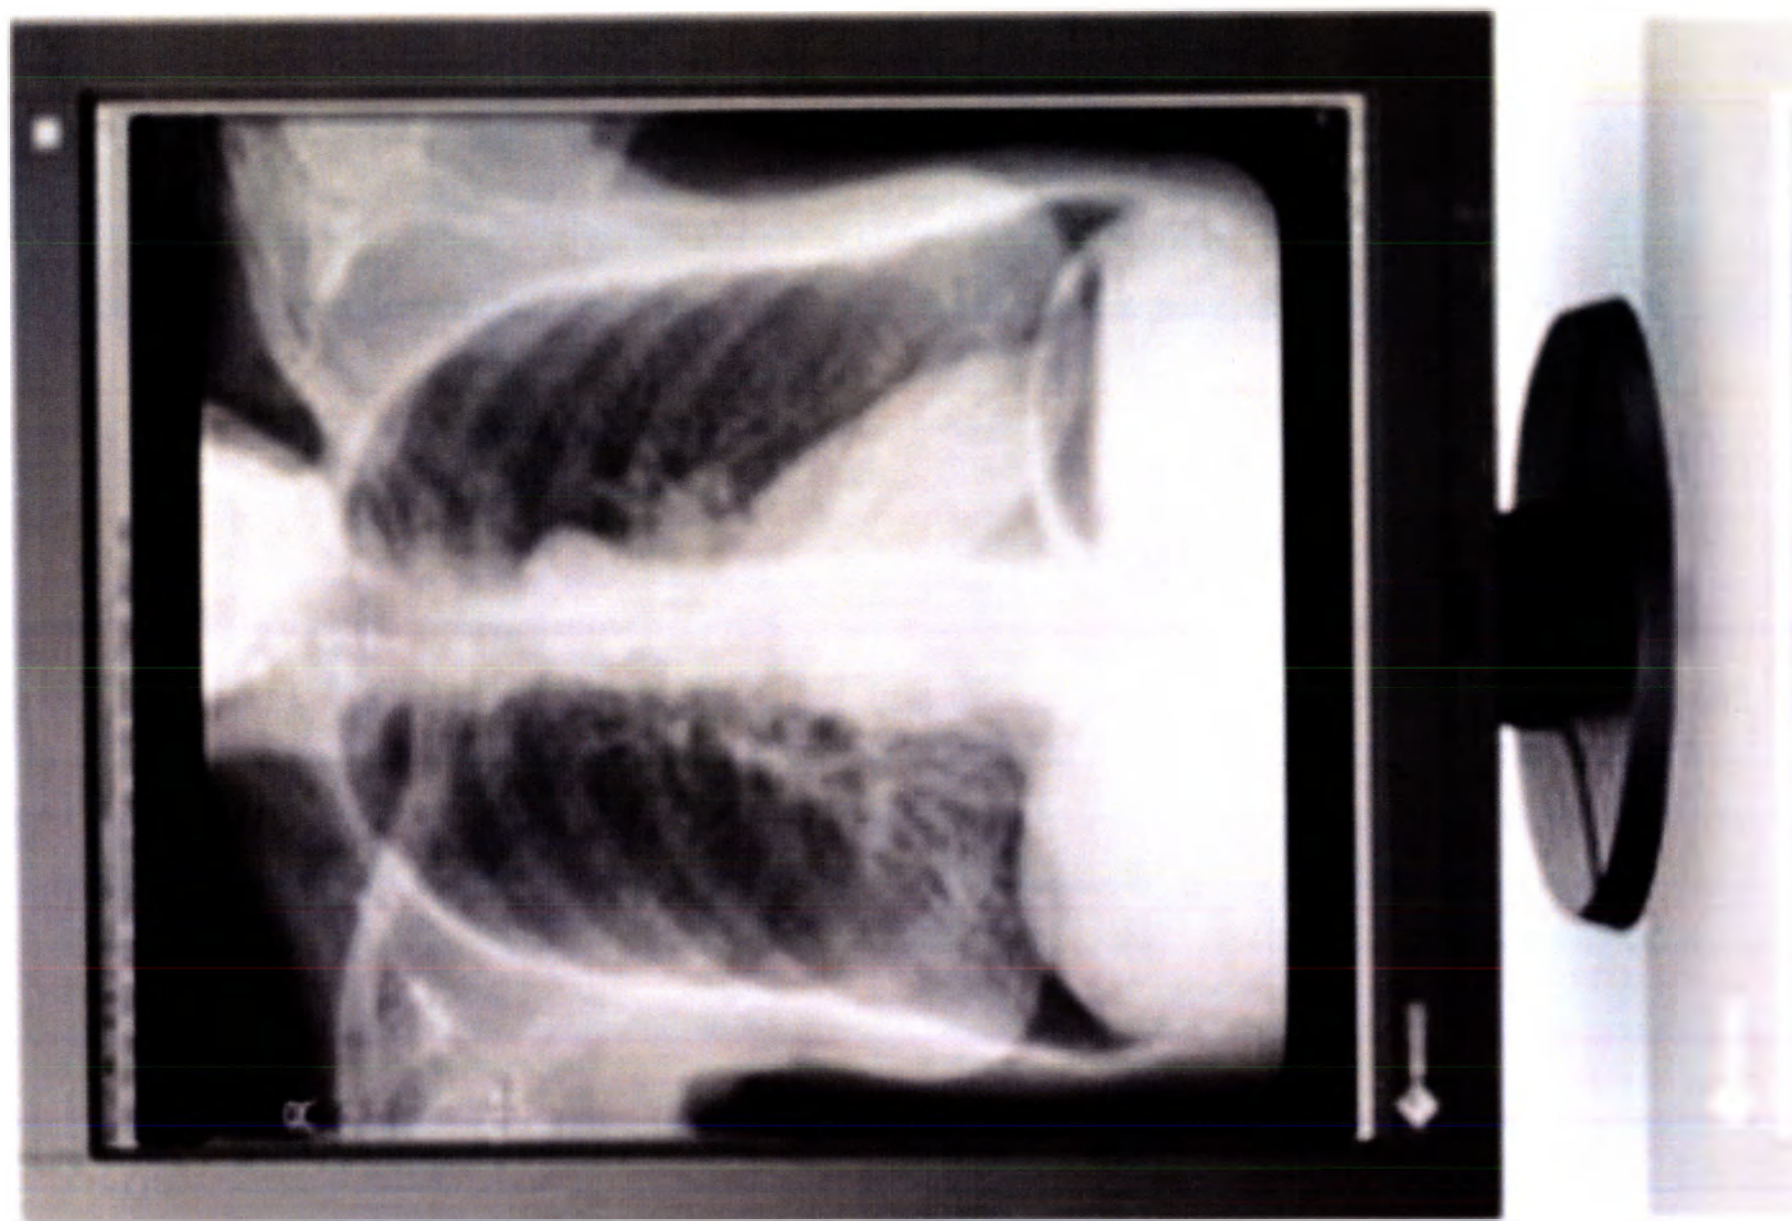










13. Набор наклеек для системы рентгеновской (не более 2 шт.)

40

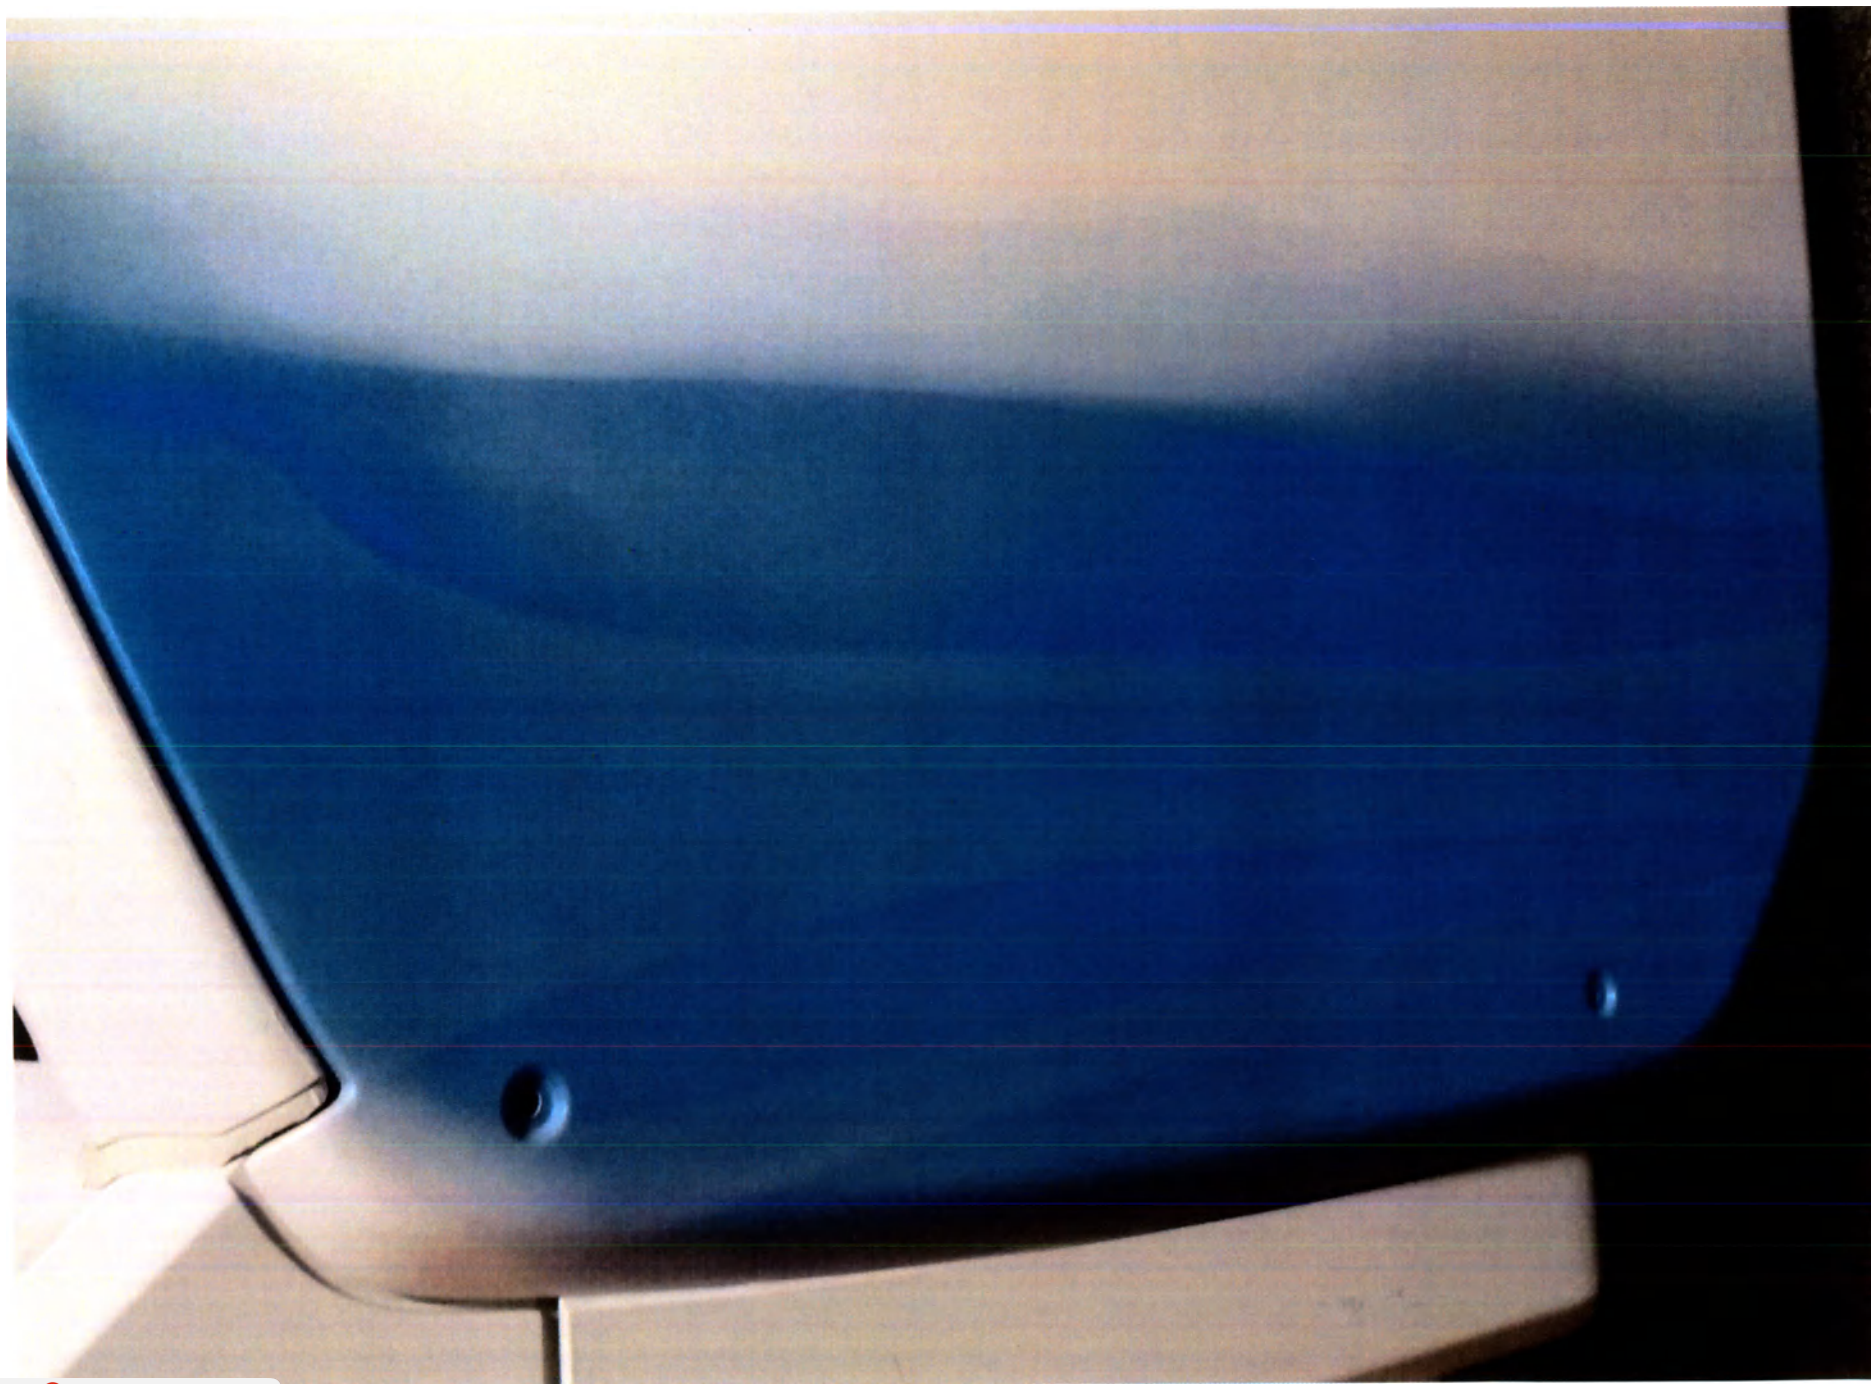


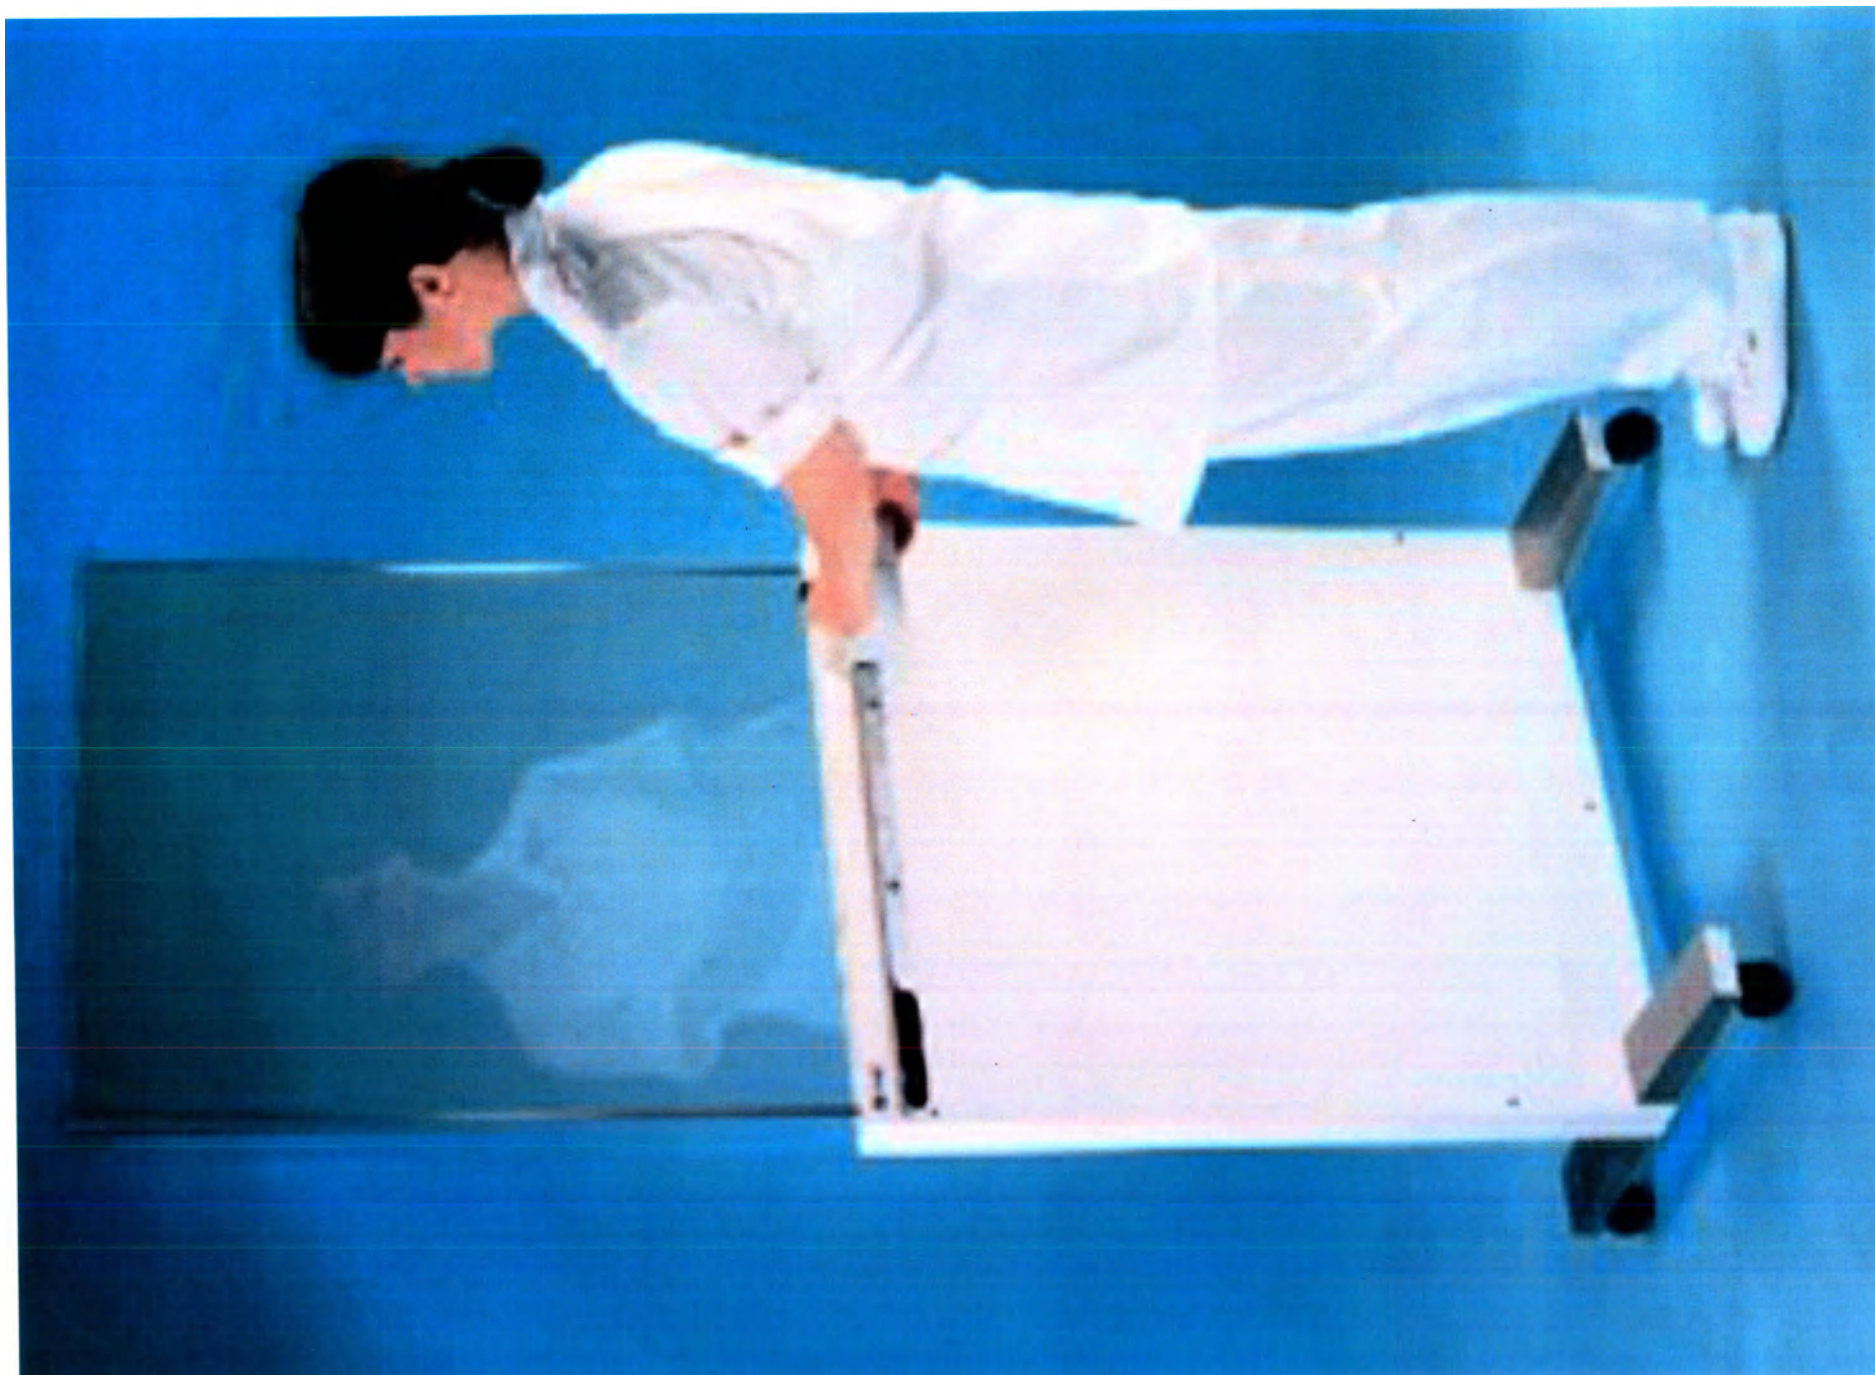

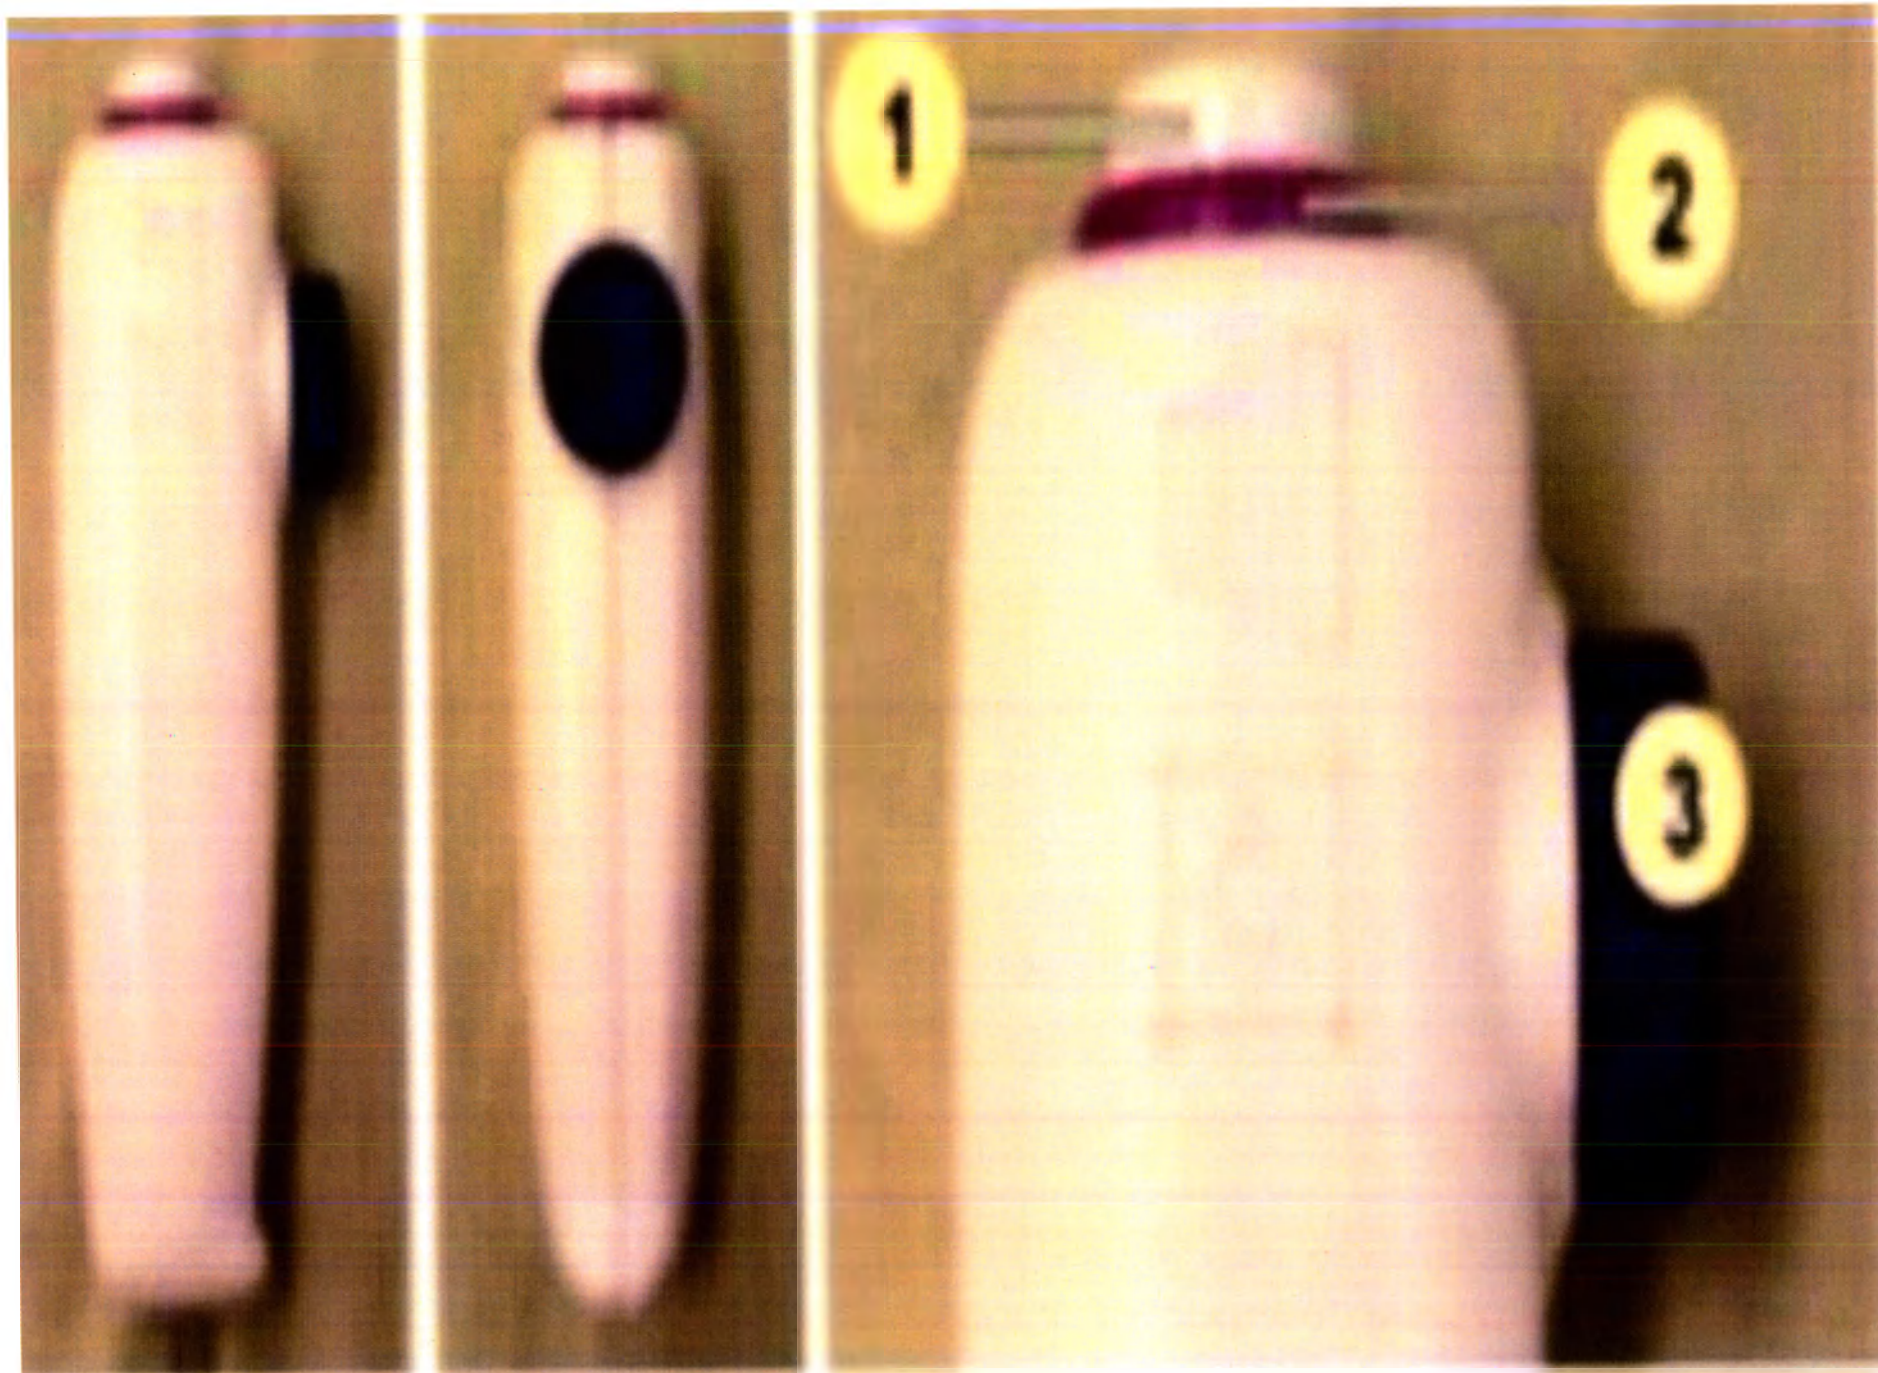



17. Специальные мыши (не более 2 шт.)

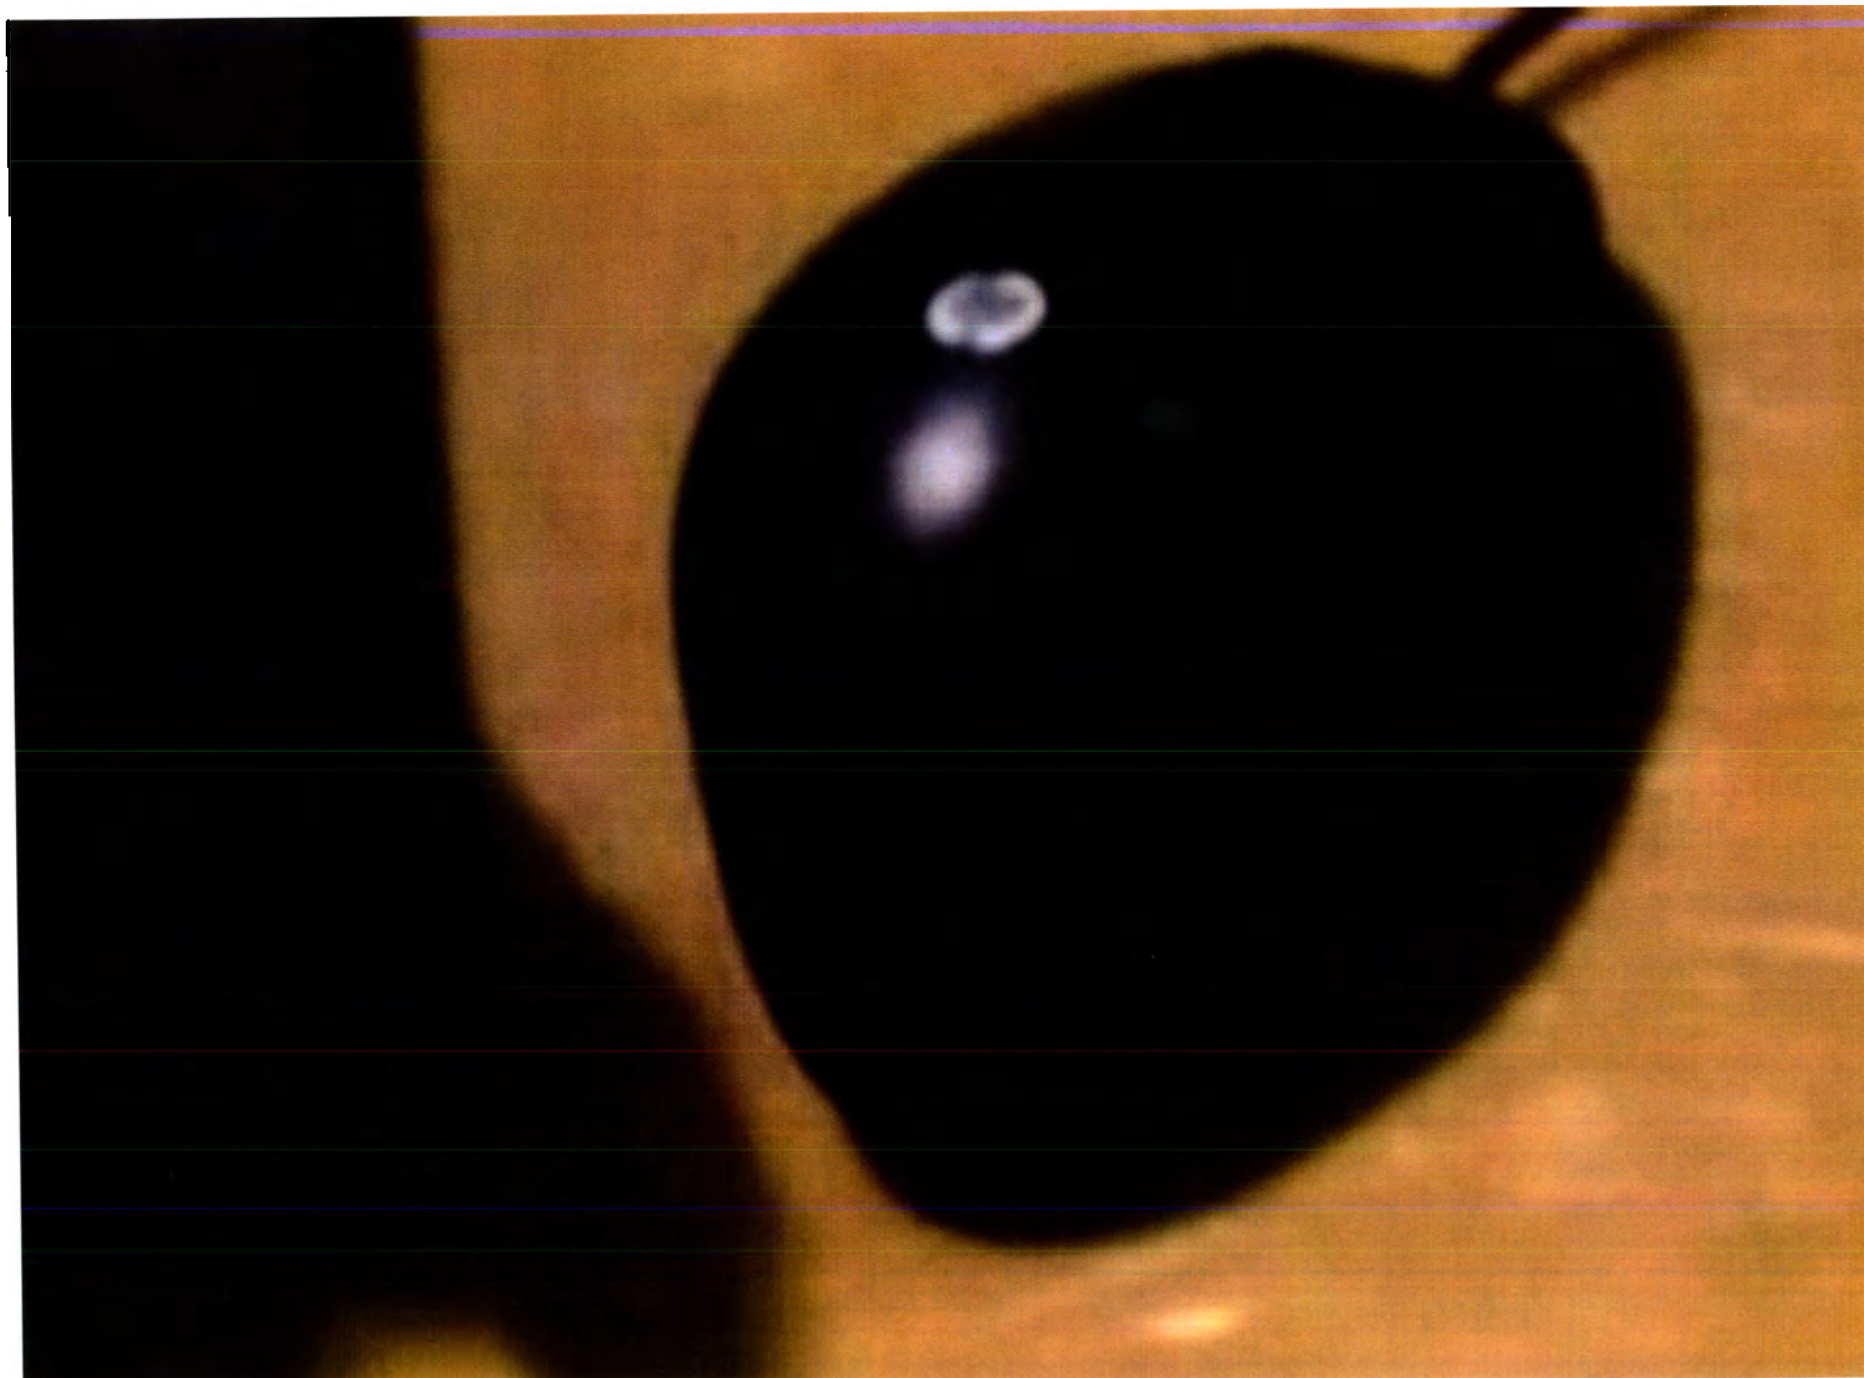



18. Средства рентгензащиты (не более 15 шт.)



19. Станция сбора медицинских данных (не более 4 шт.)




20. Стол мобильный для проведения исследований




21. Стол мобильный для проведения исследований



22. Техническая документация (не более 2 шт.)

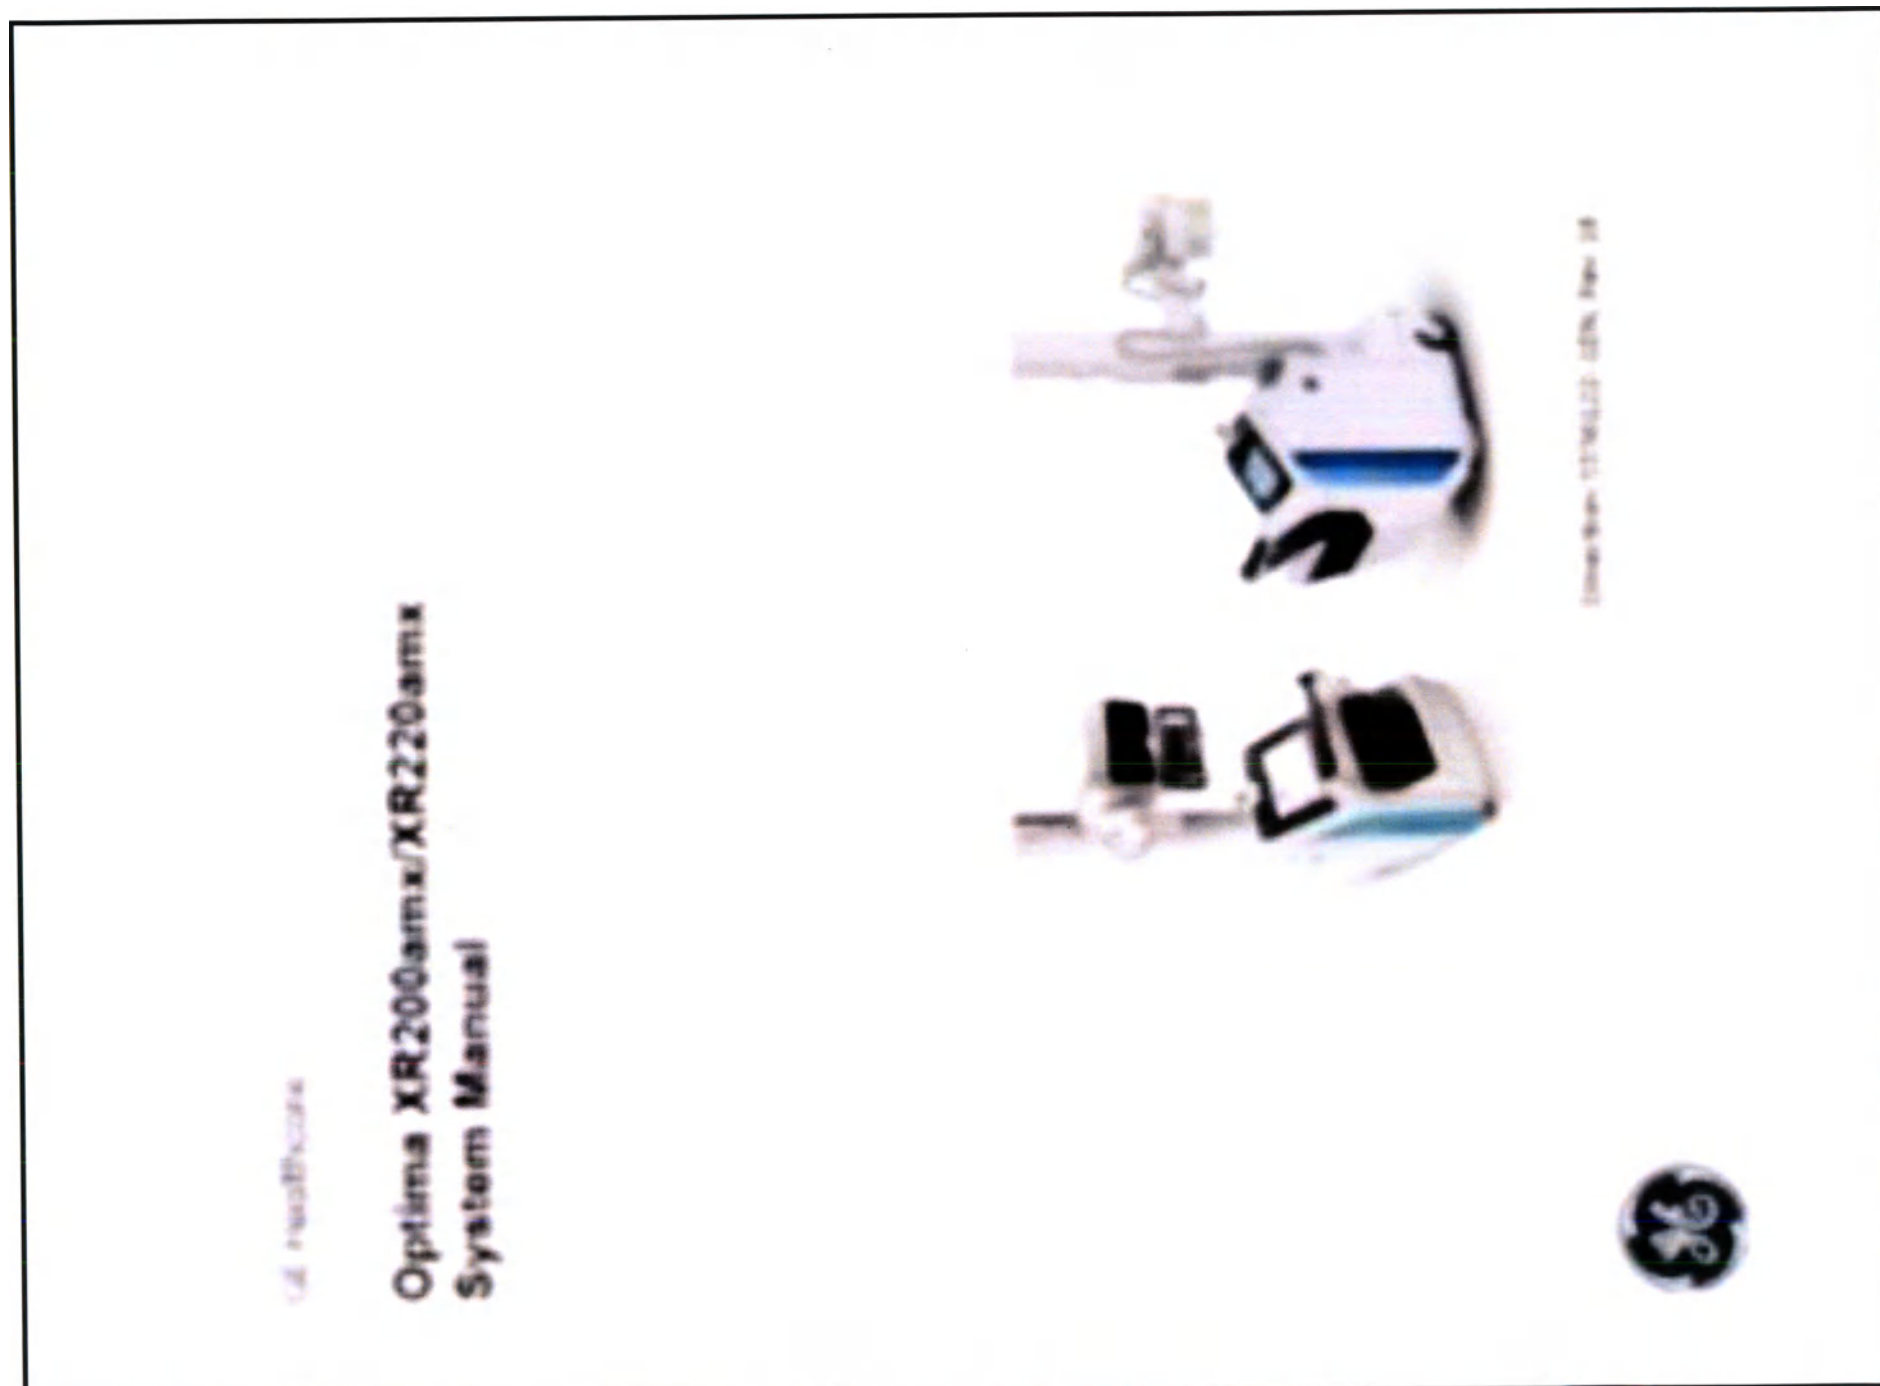

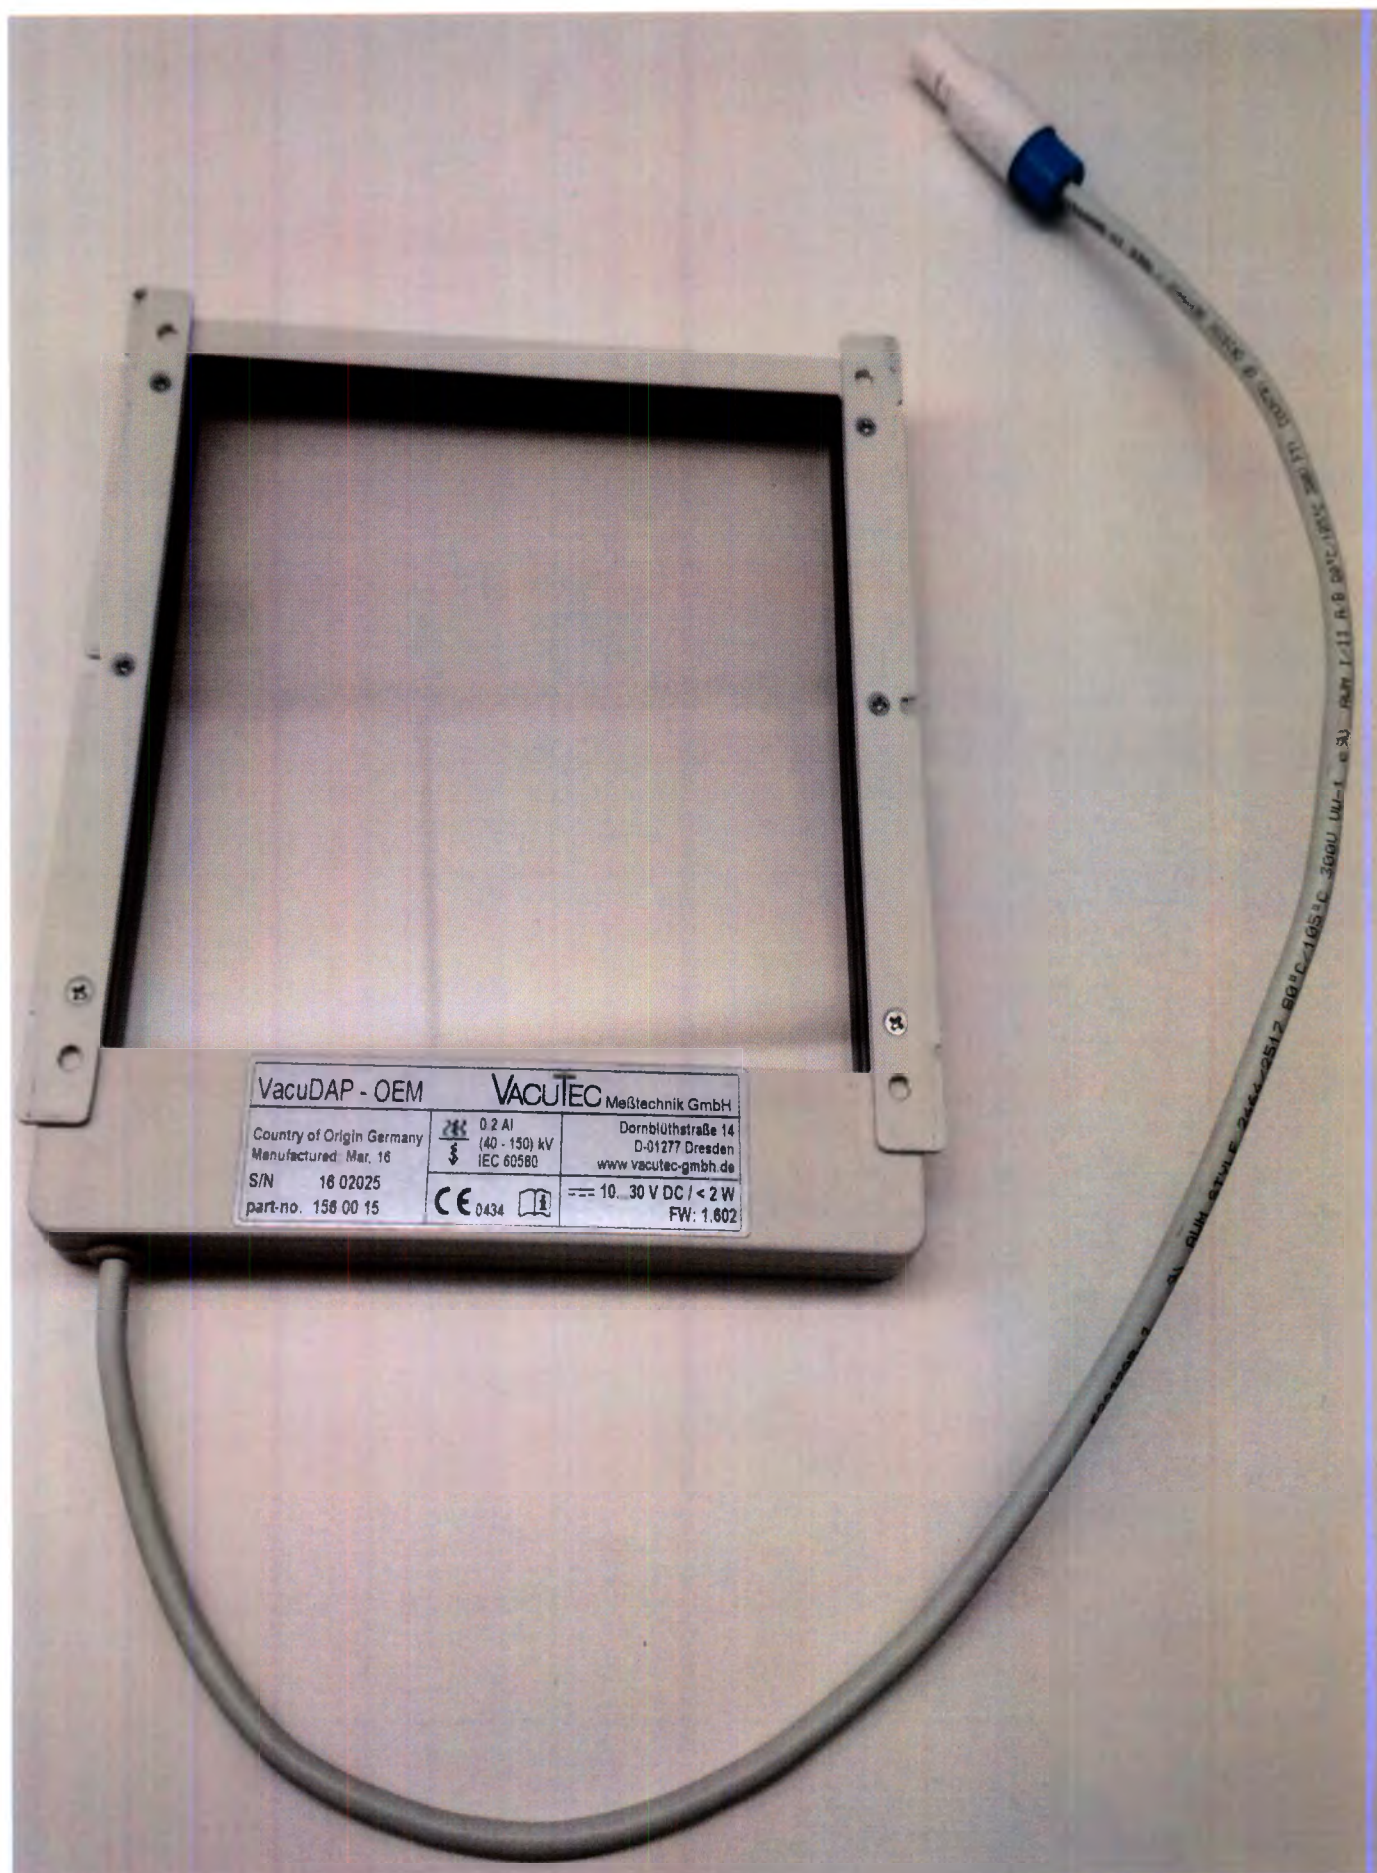







ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО

ПЕЧАТЬЮ 34 л.





Фотографические изображения
медицинского изделия

«Аппарат рентгеновский OPTIMA XR с принадлежностями»

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента регистрации и сертификации России и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»

С.Б. Парахина 
« 27 »  2018 г.







GE Medical Systems, LLC
3000 North Grandview Blvd.
Waukesha, WI 53188, USA

Модель: Optima XR220AMX
30KW

REF

SN



100 - 240V~

50/60Hz 1440 V A класс A: Группа 1

см. другие этикетки для международных
символов, которые демонстрируют соответствие




GE Medical Systems, LLC
3000 North Grandview Blvd.
Waukesha, WI 53188, USA

Модель: Optima XR200AMX
30KW




100 - 240V~
50/60Hz 1440 V A класс A: Группа 1
см. другие этикетки для международных
символов, которые демонстрируют соответствие

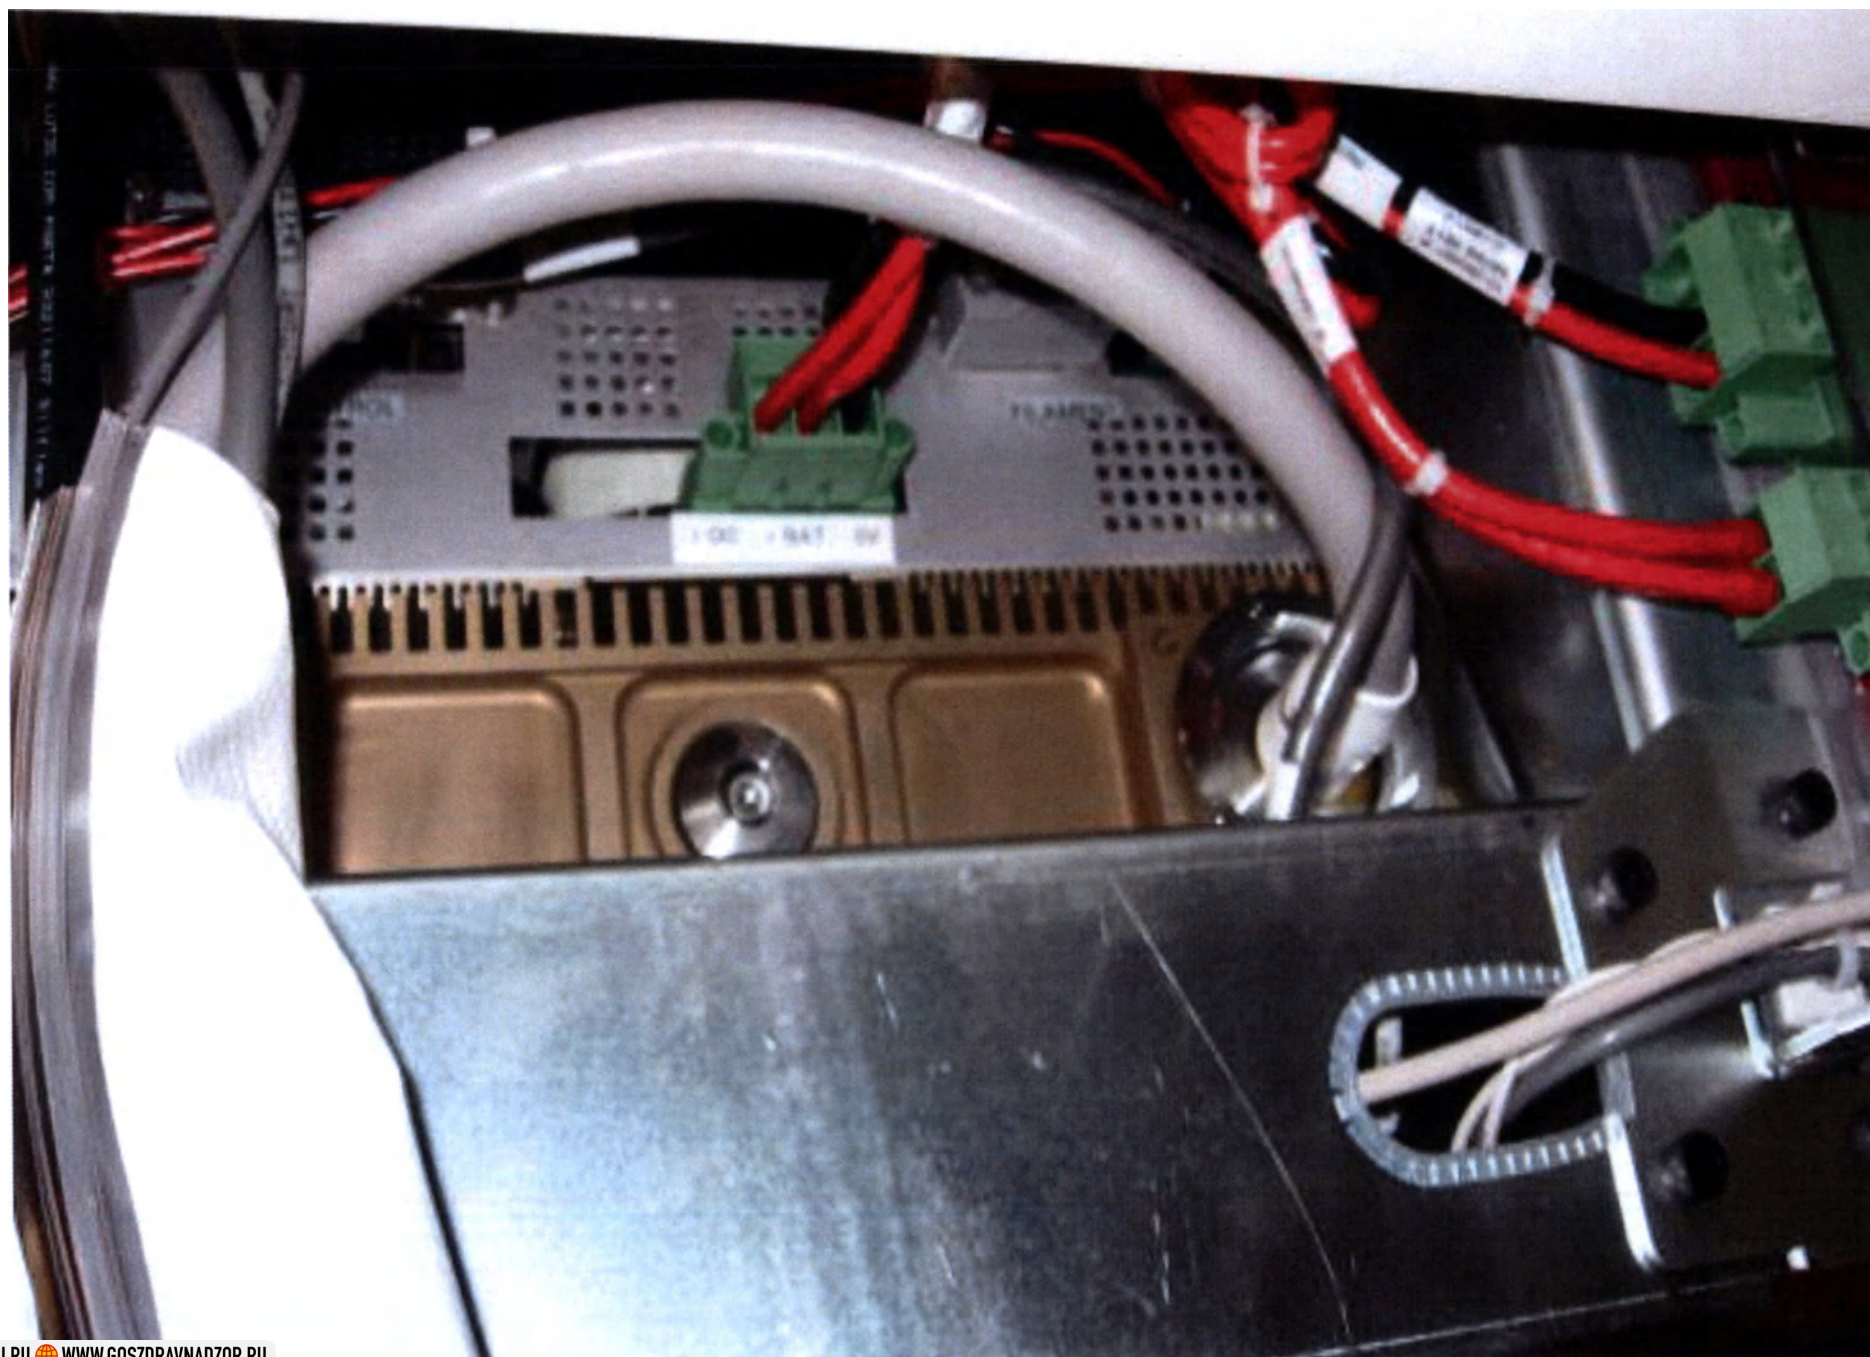









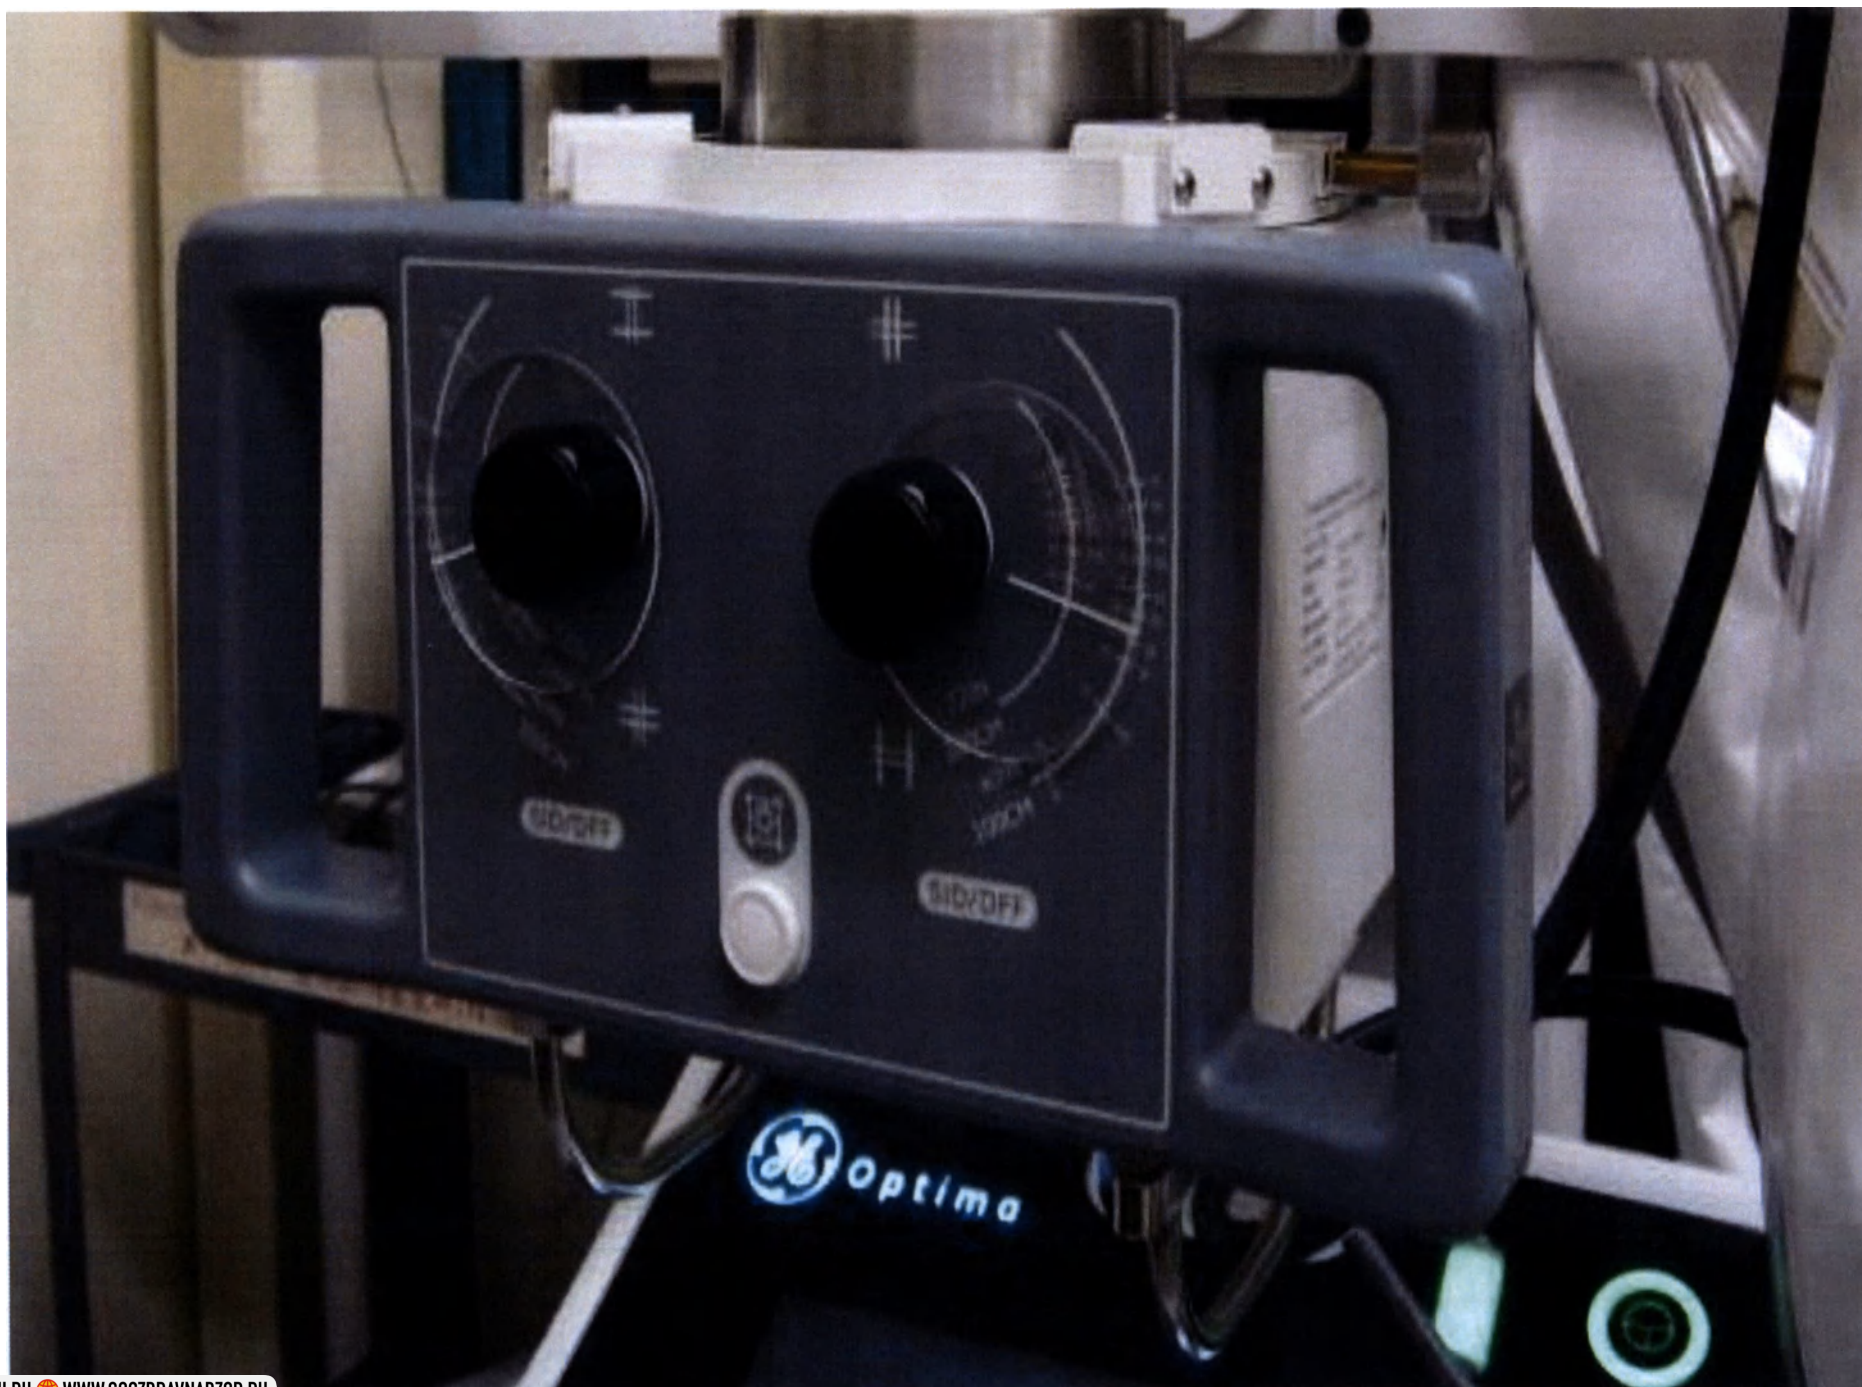






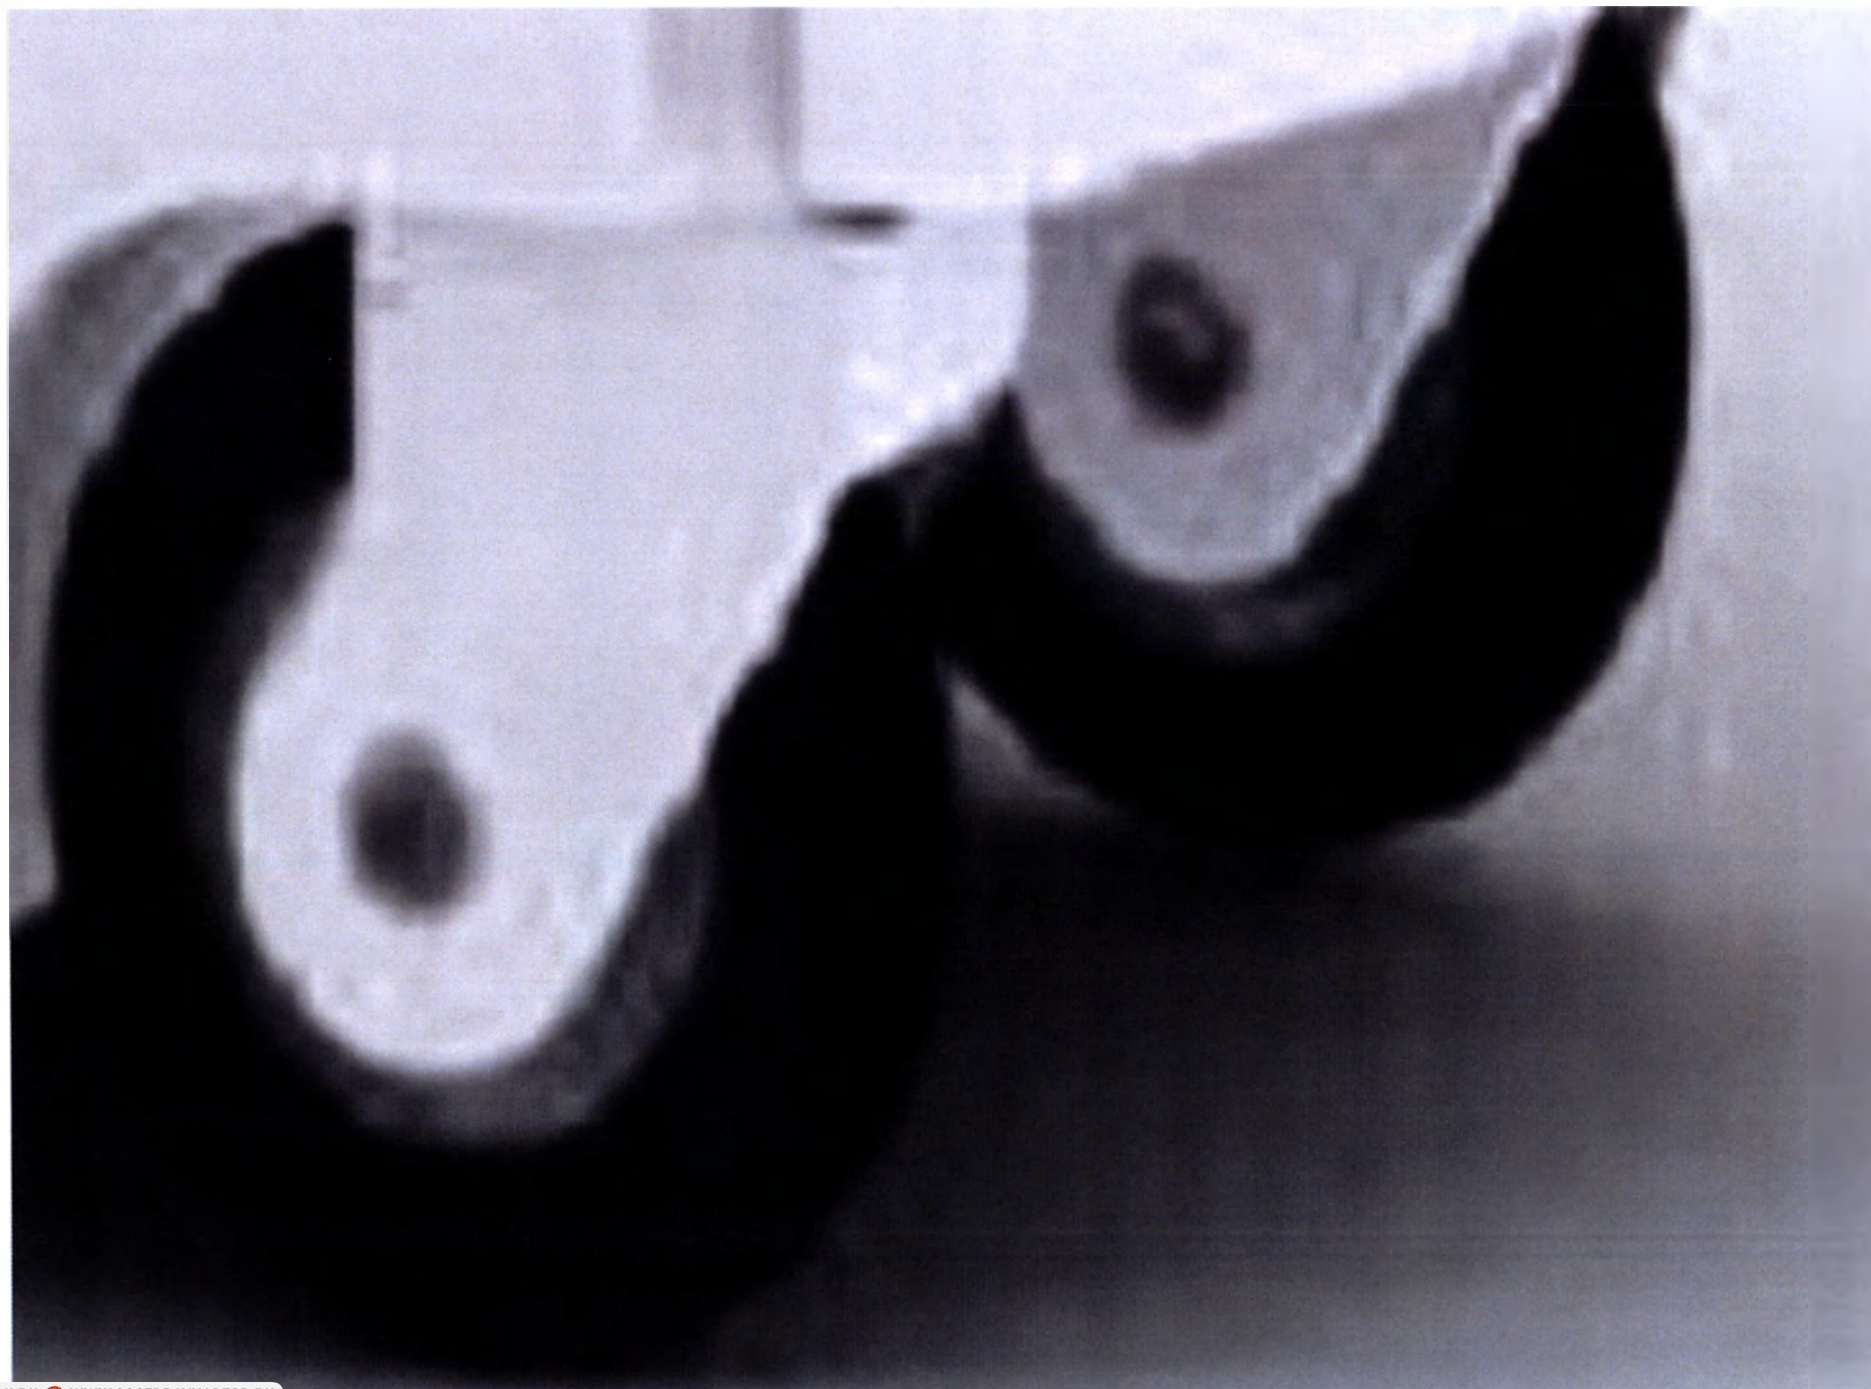


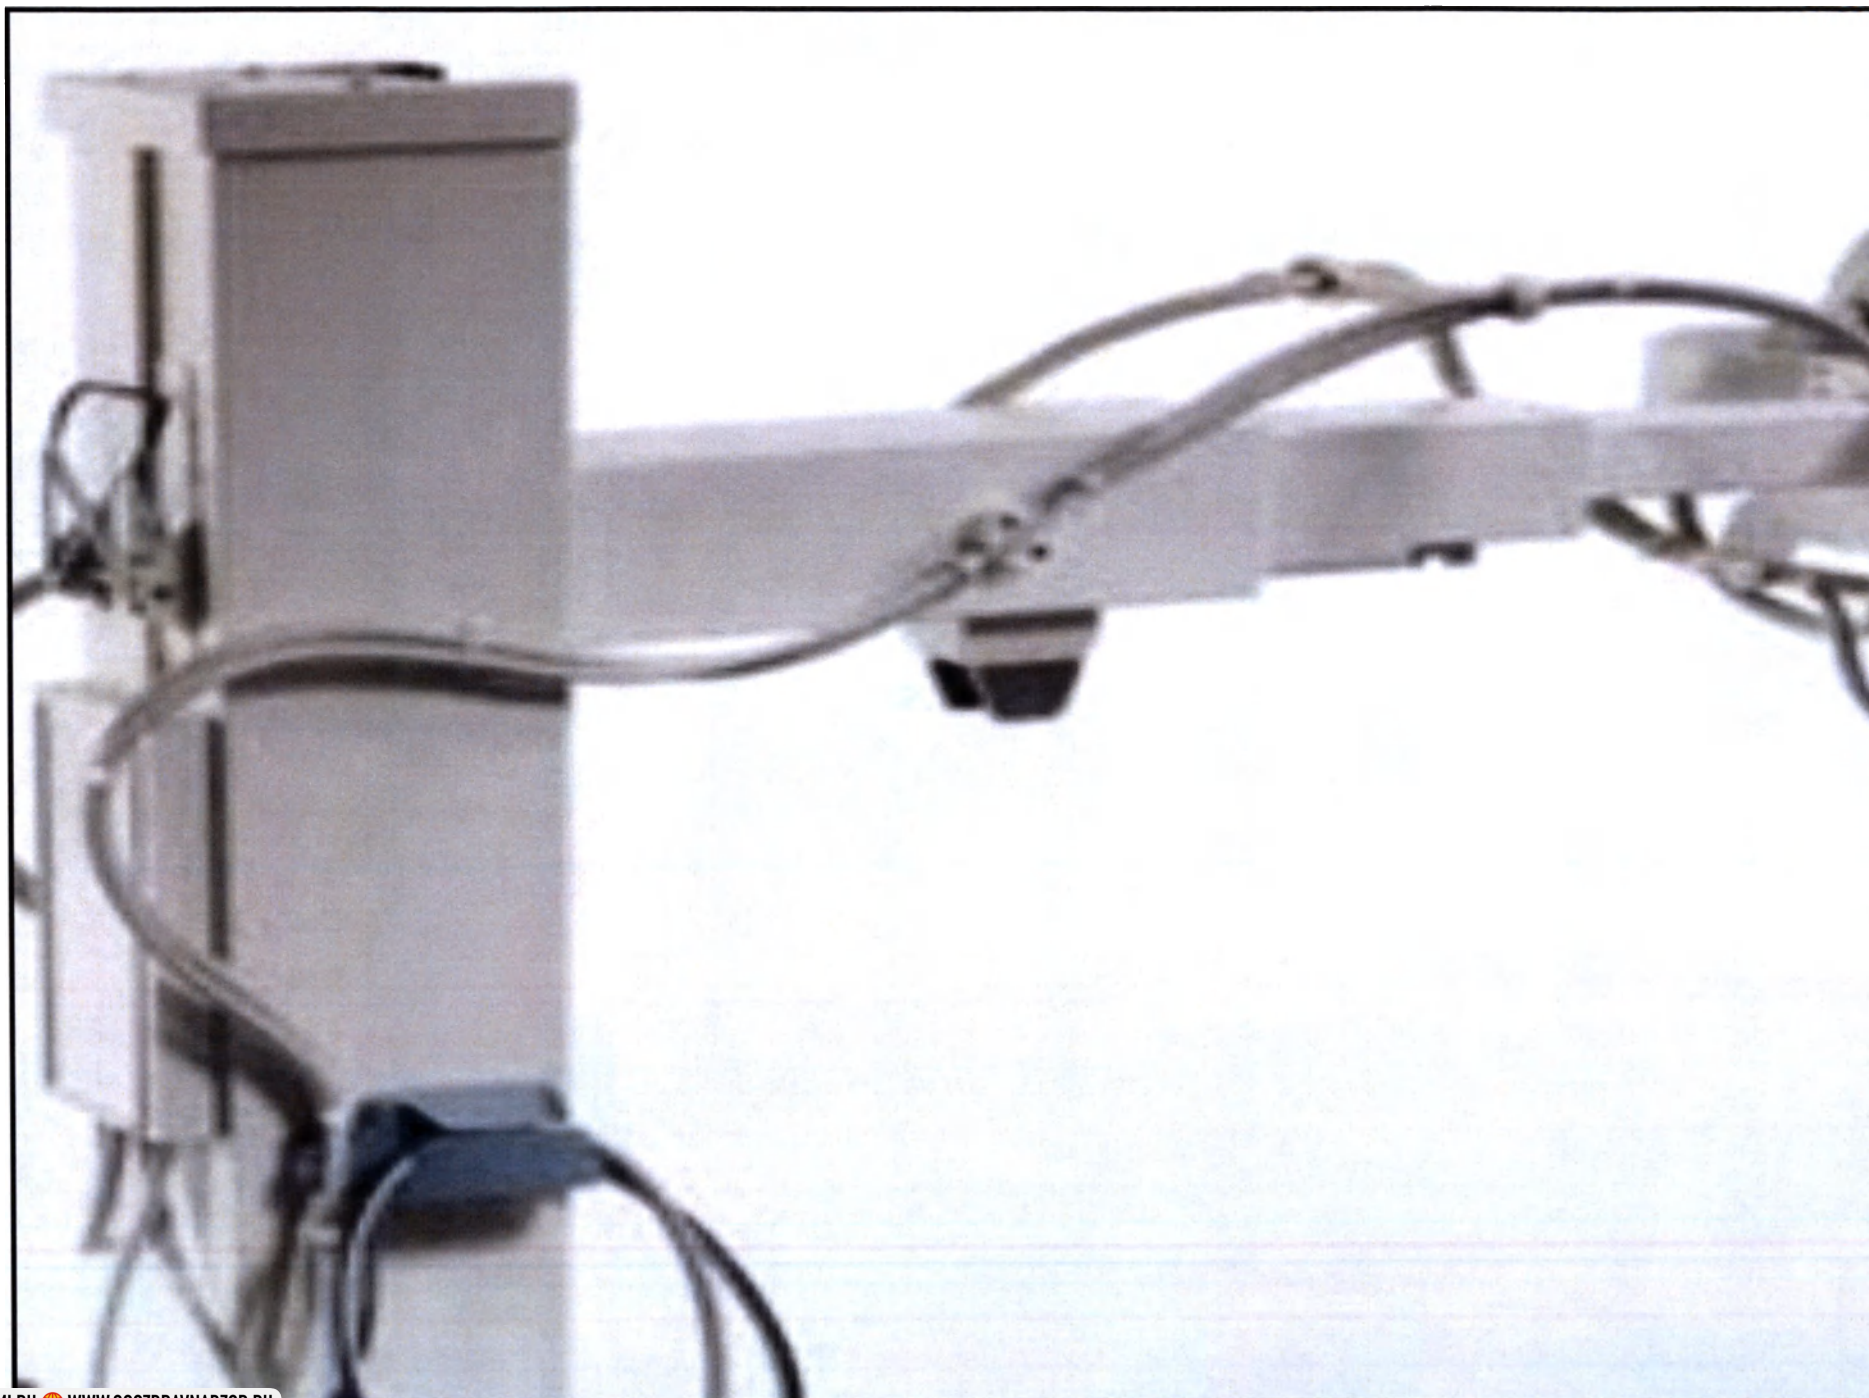







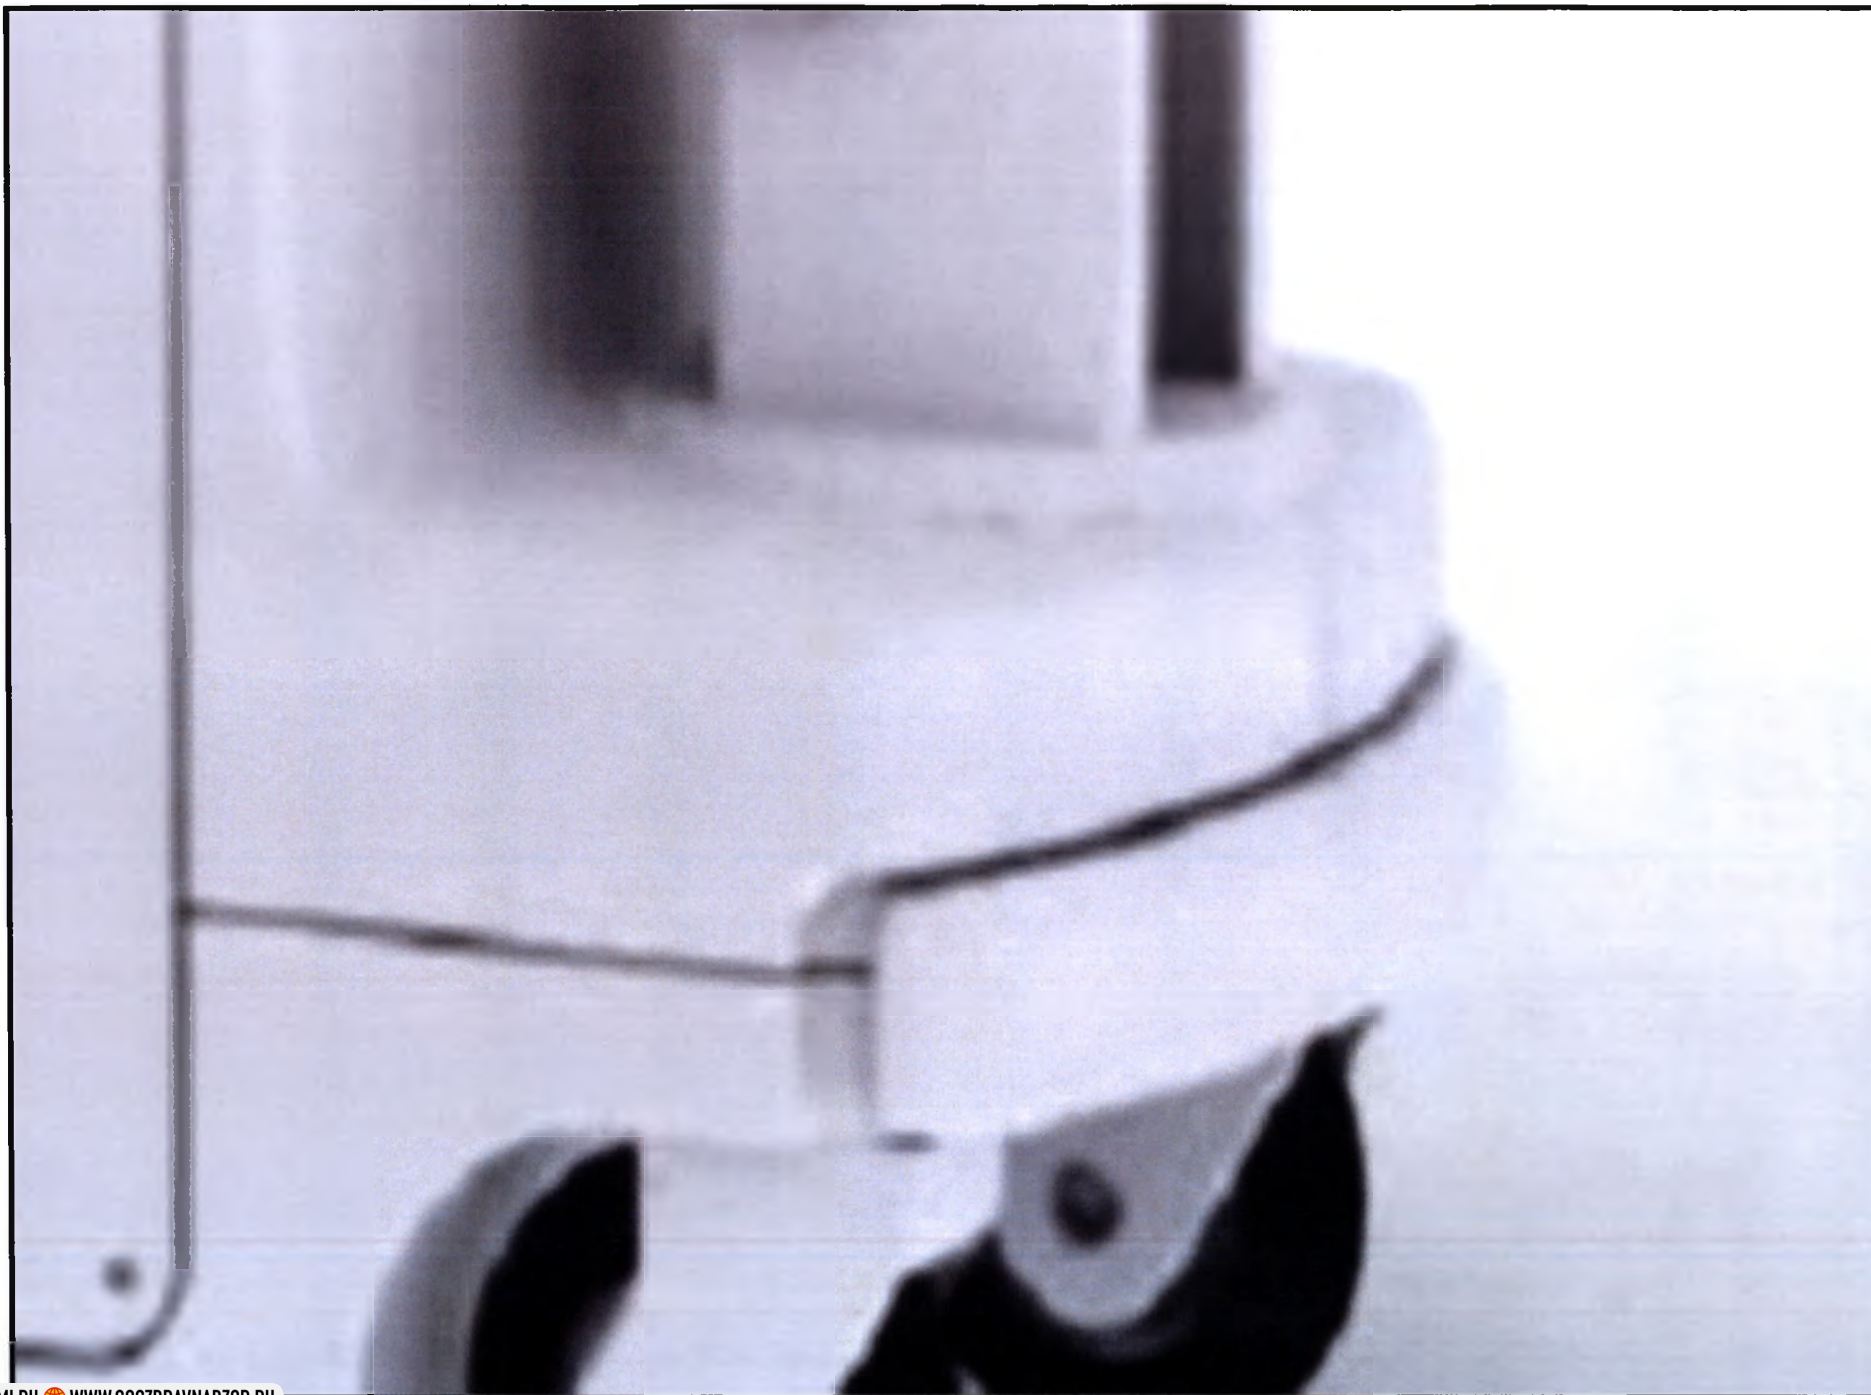

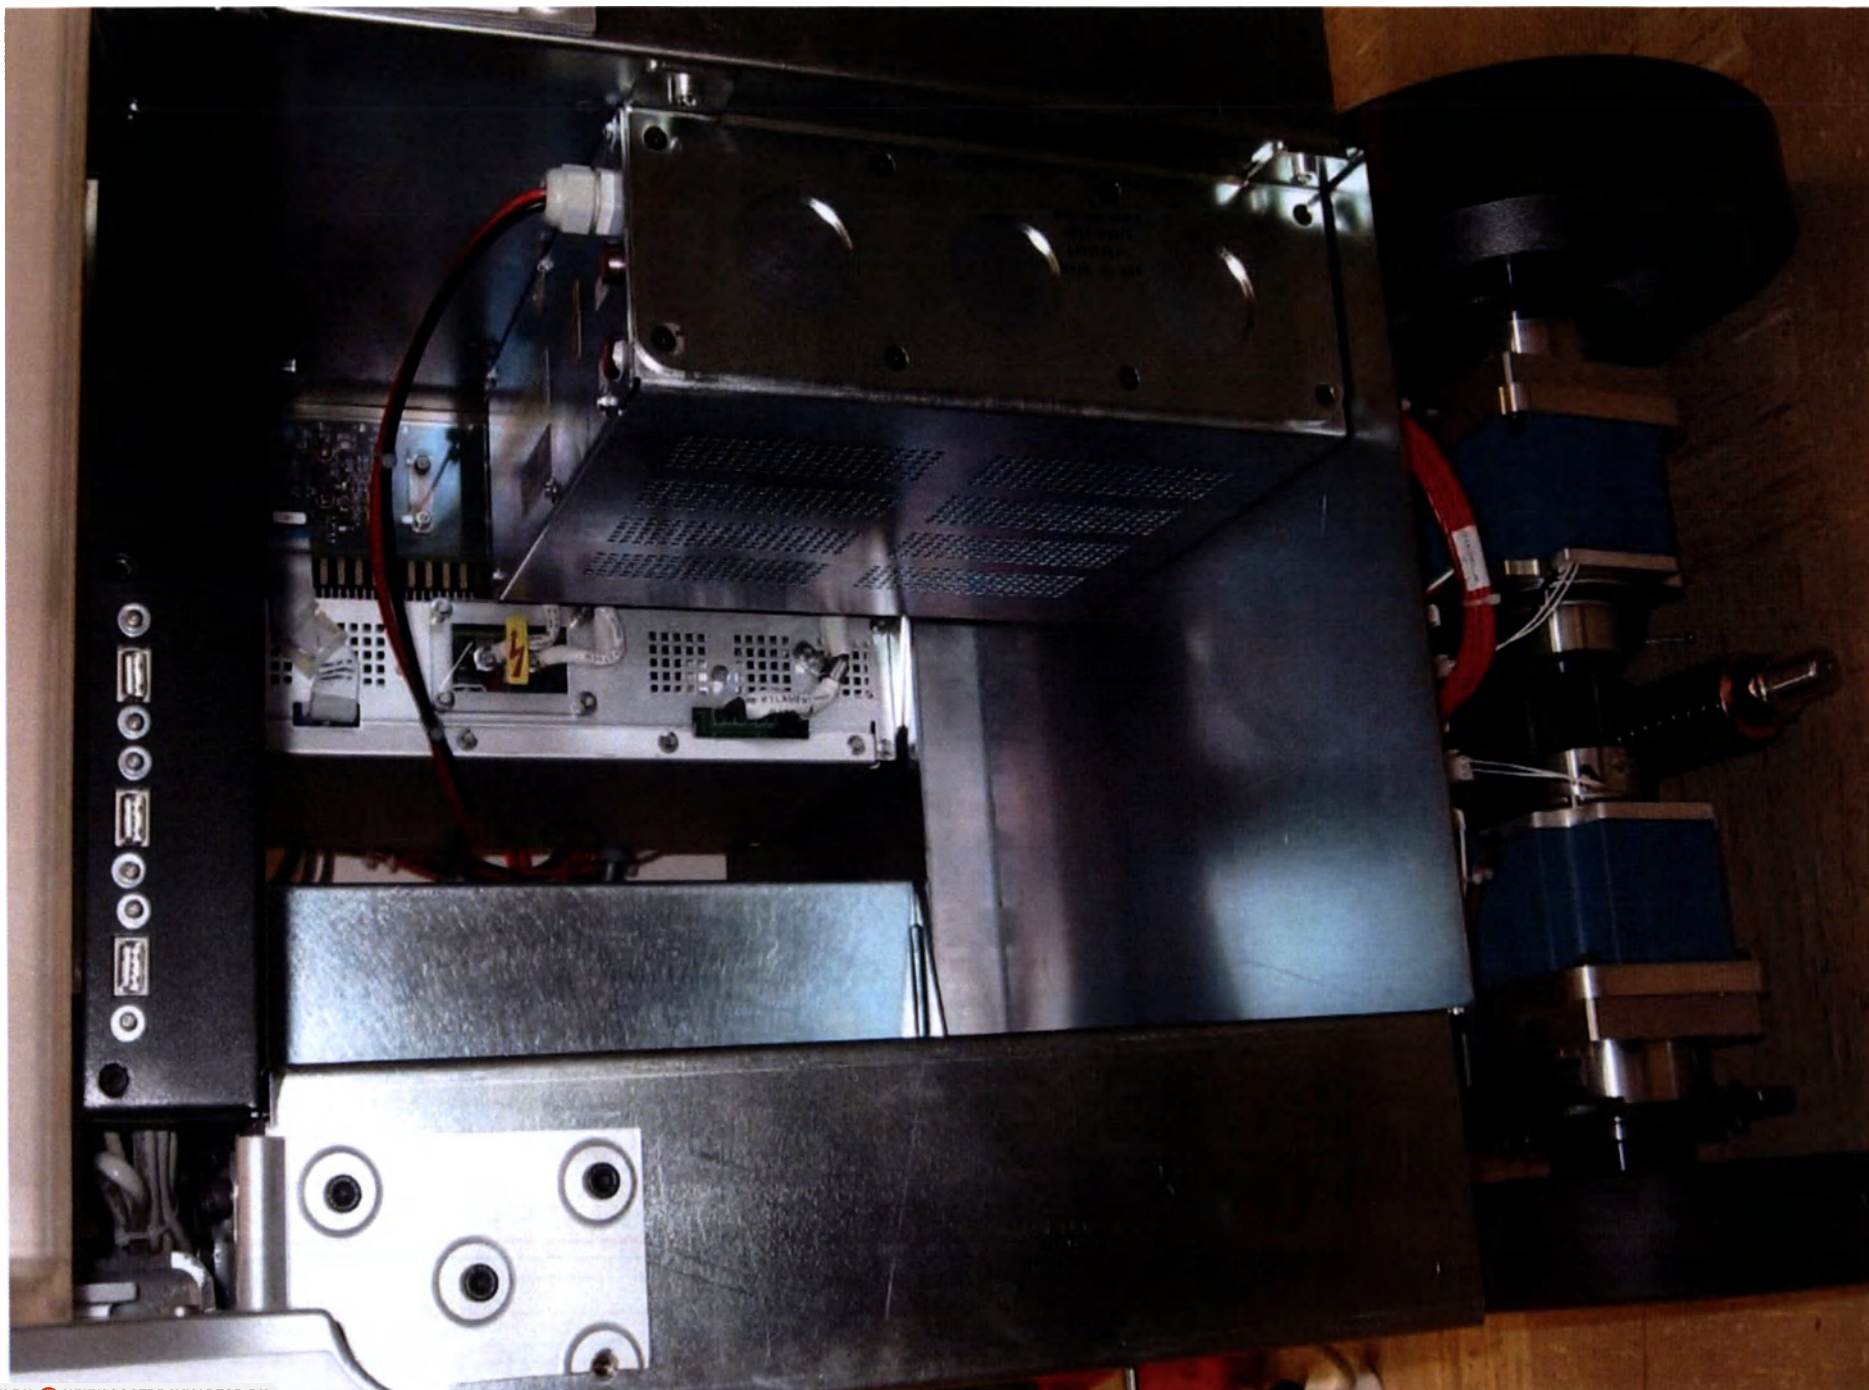




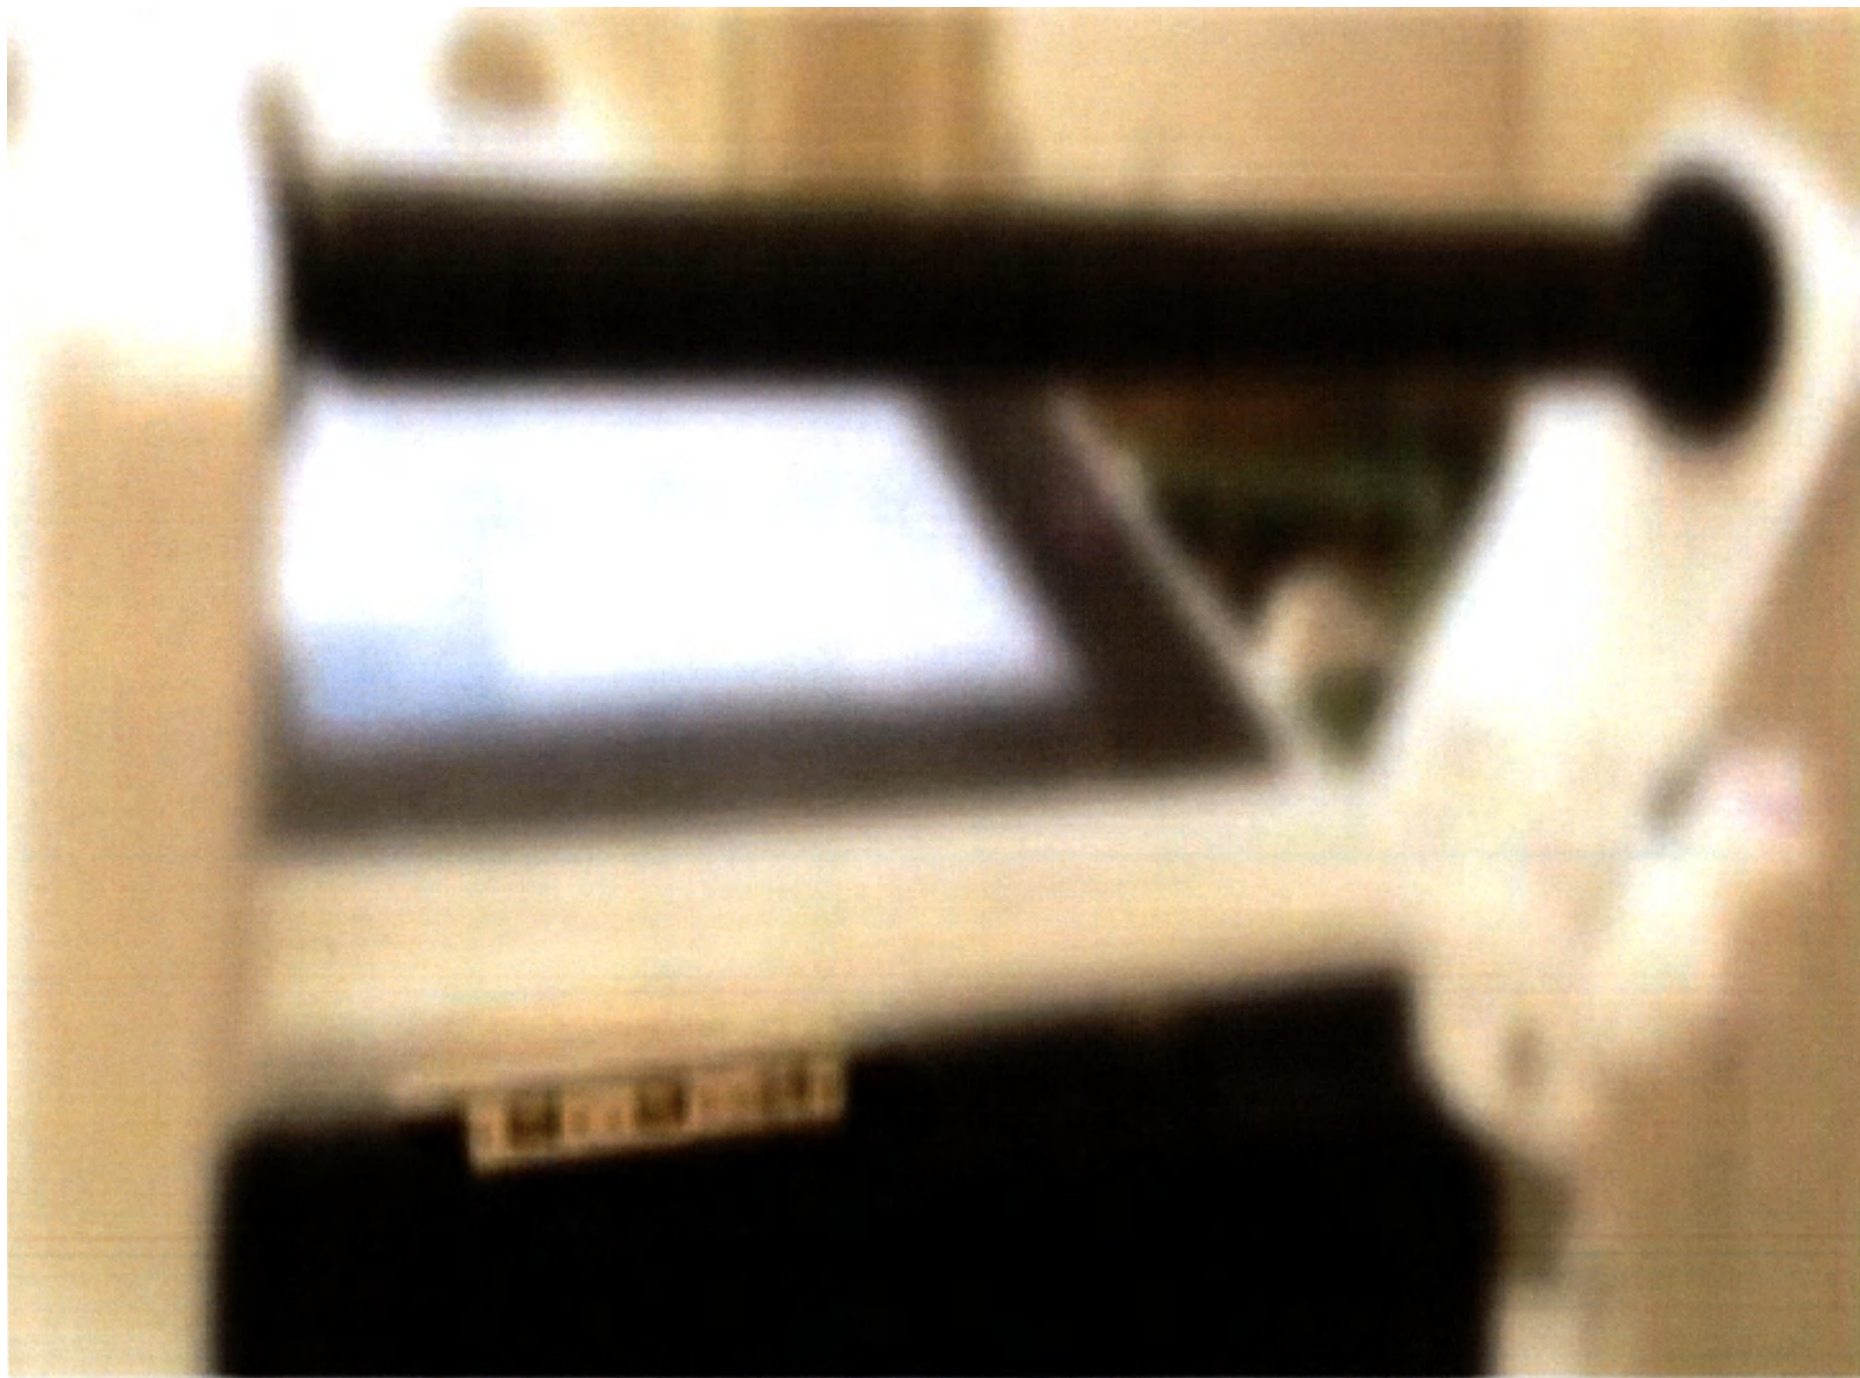


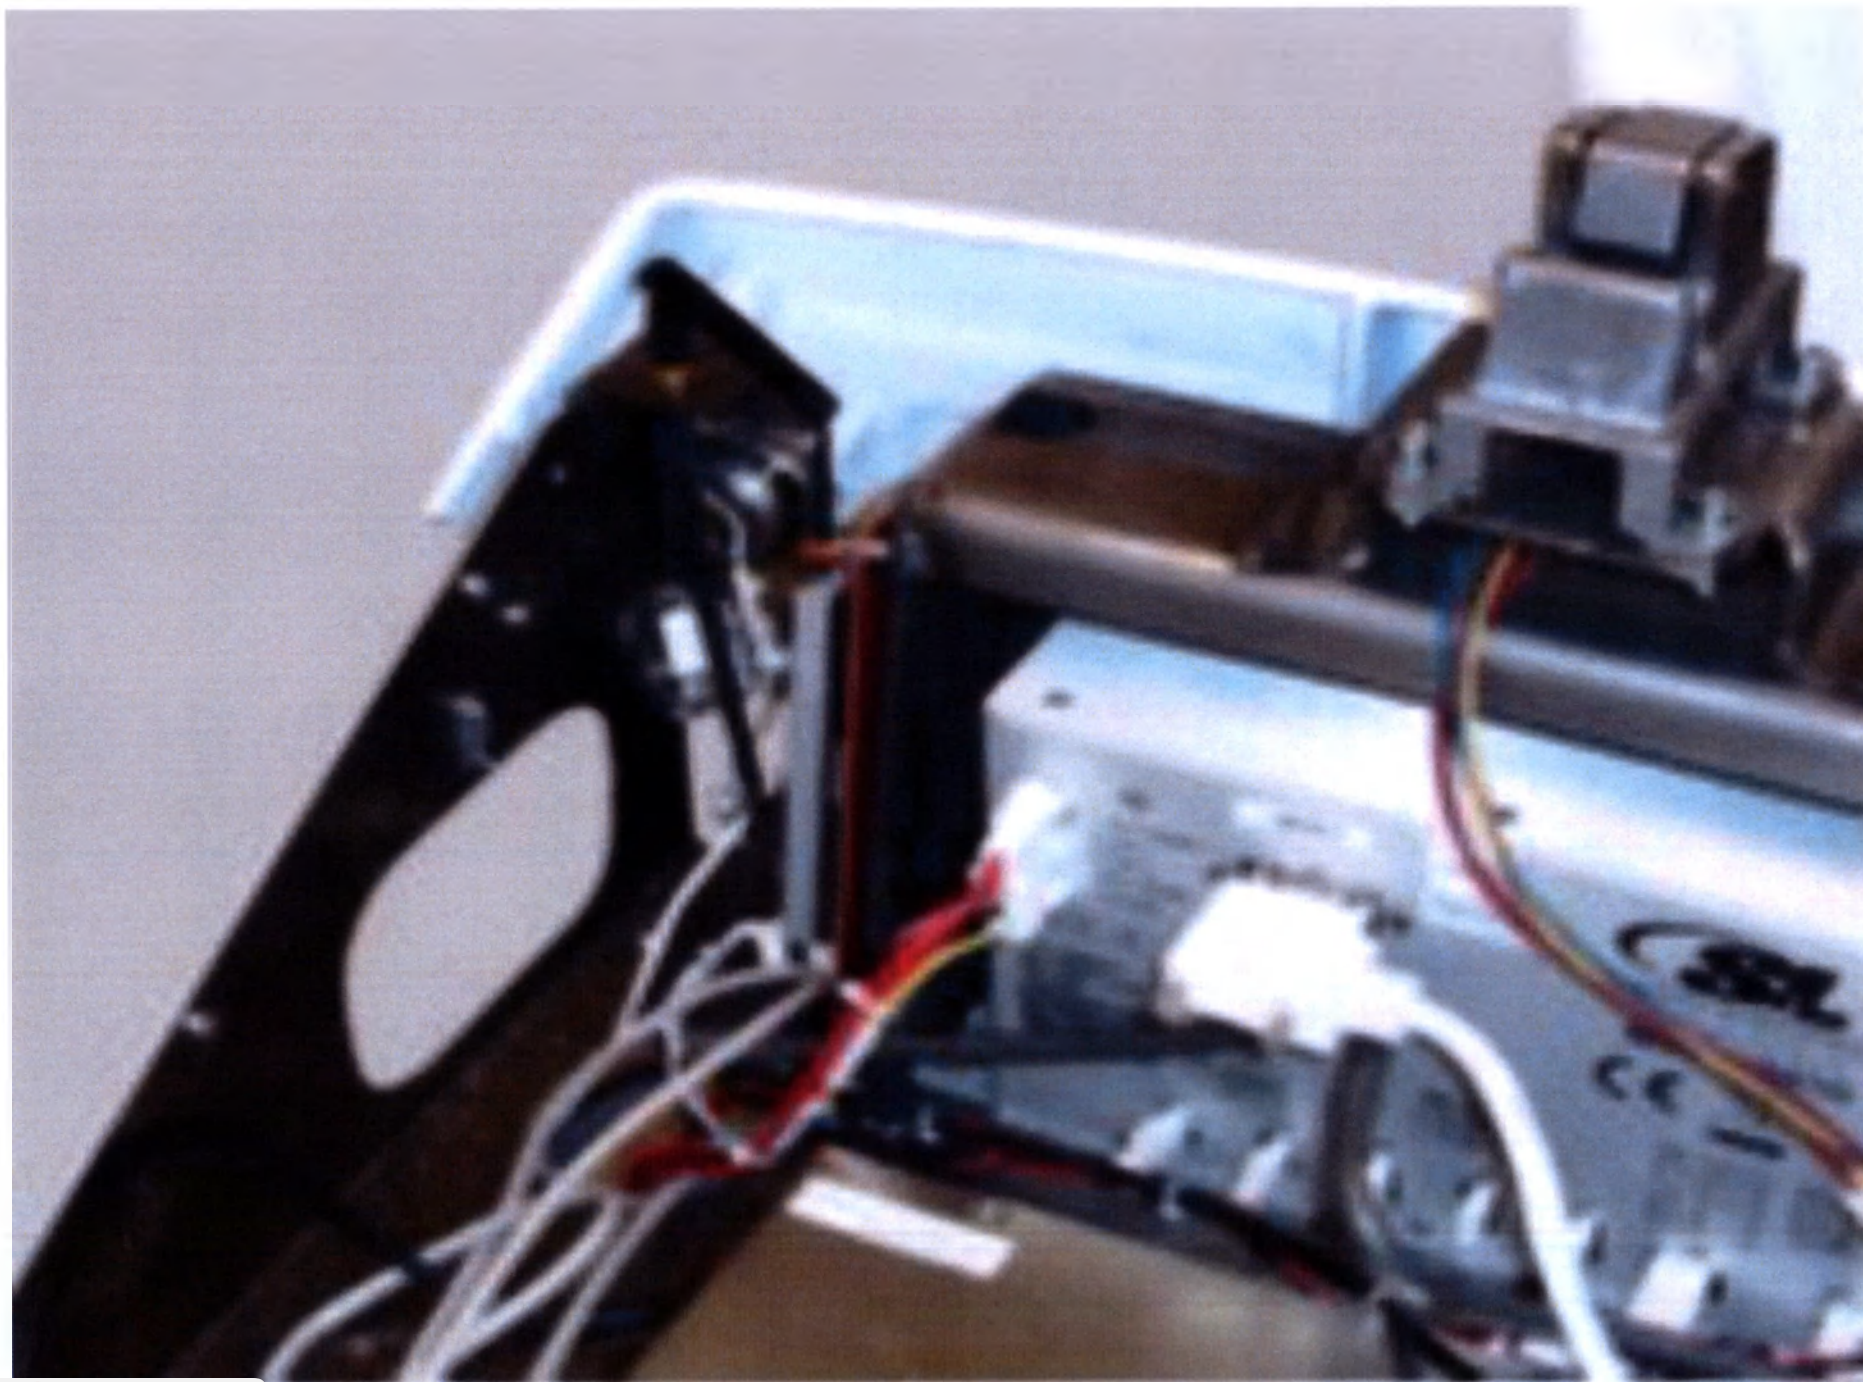


	Информация
	Информация о состоянии системы
	Информация о состоянии системы
	Информация о состоянии системы
	Информация о состоянии системы
	Информация о состоянии системы
	Информация о состоянии системы




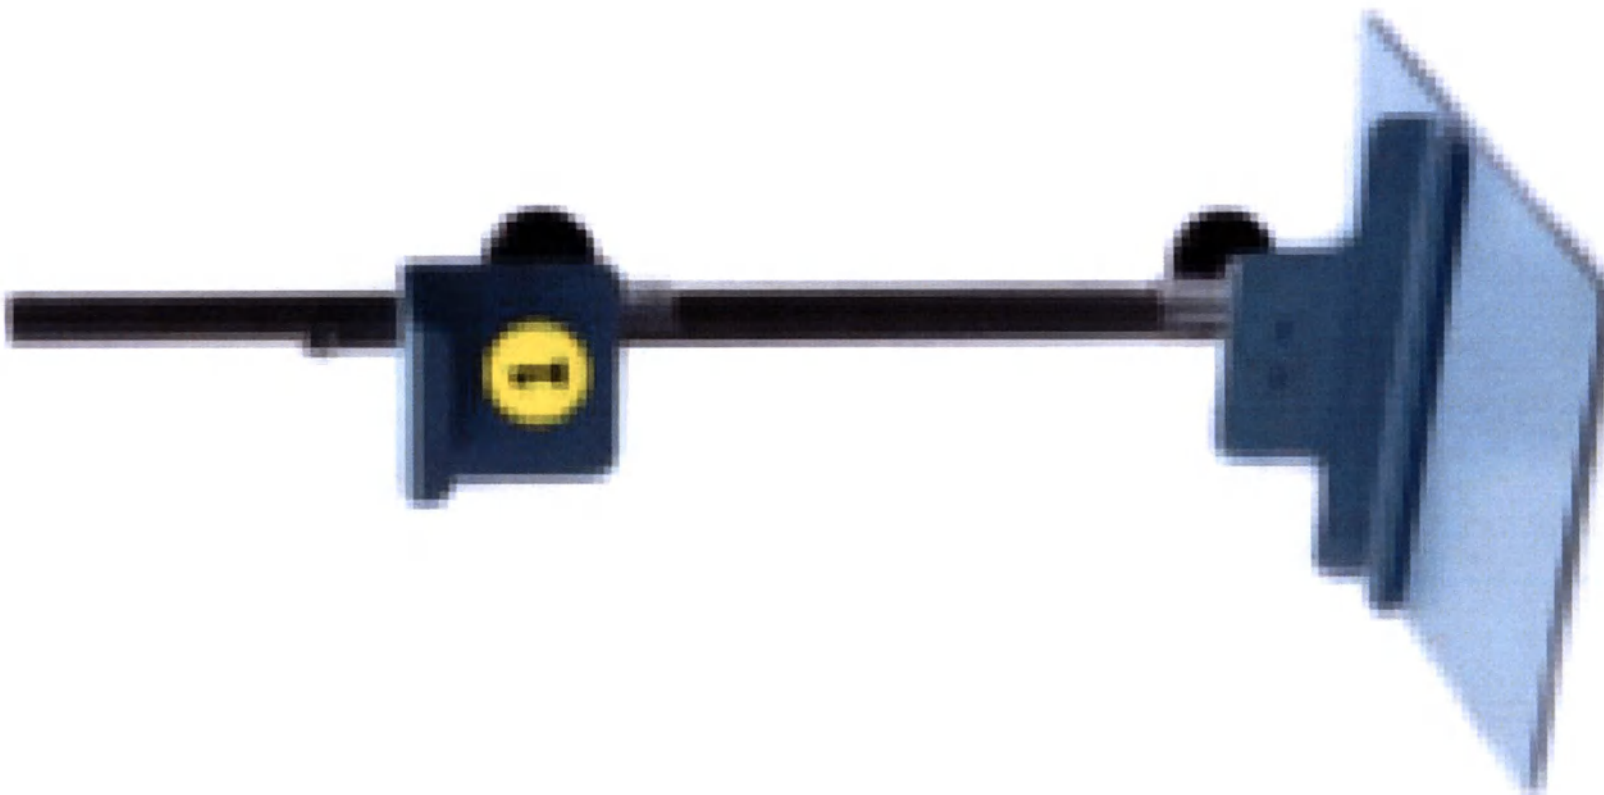

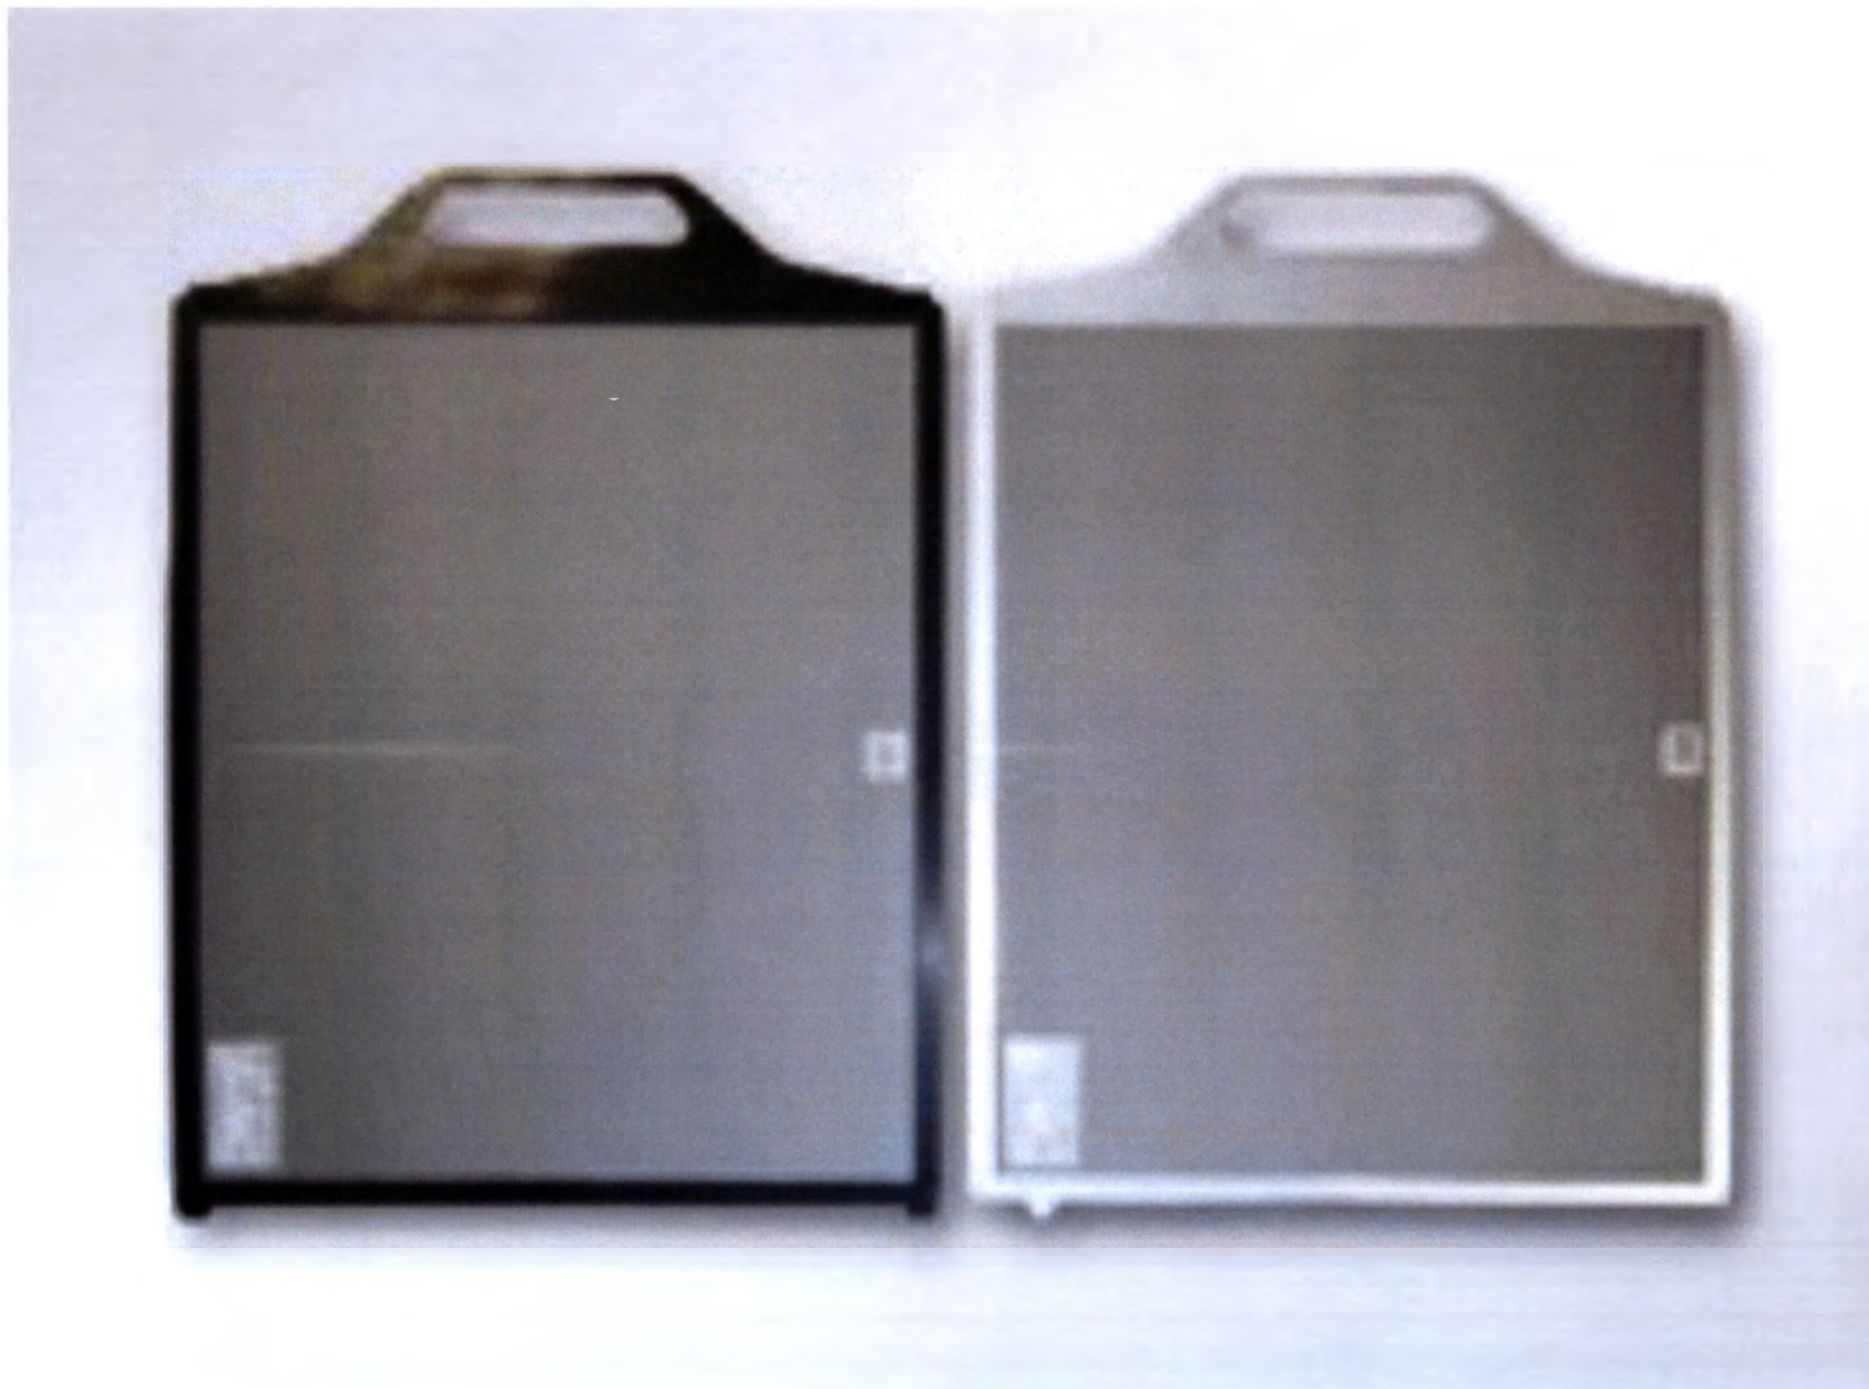

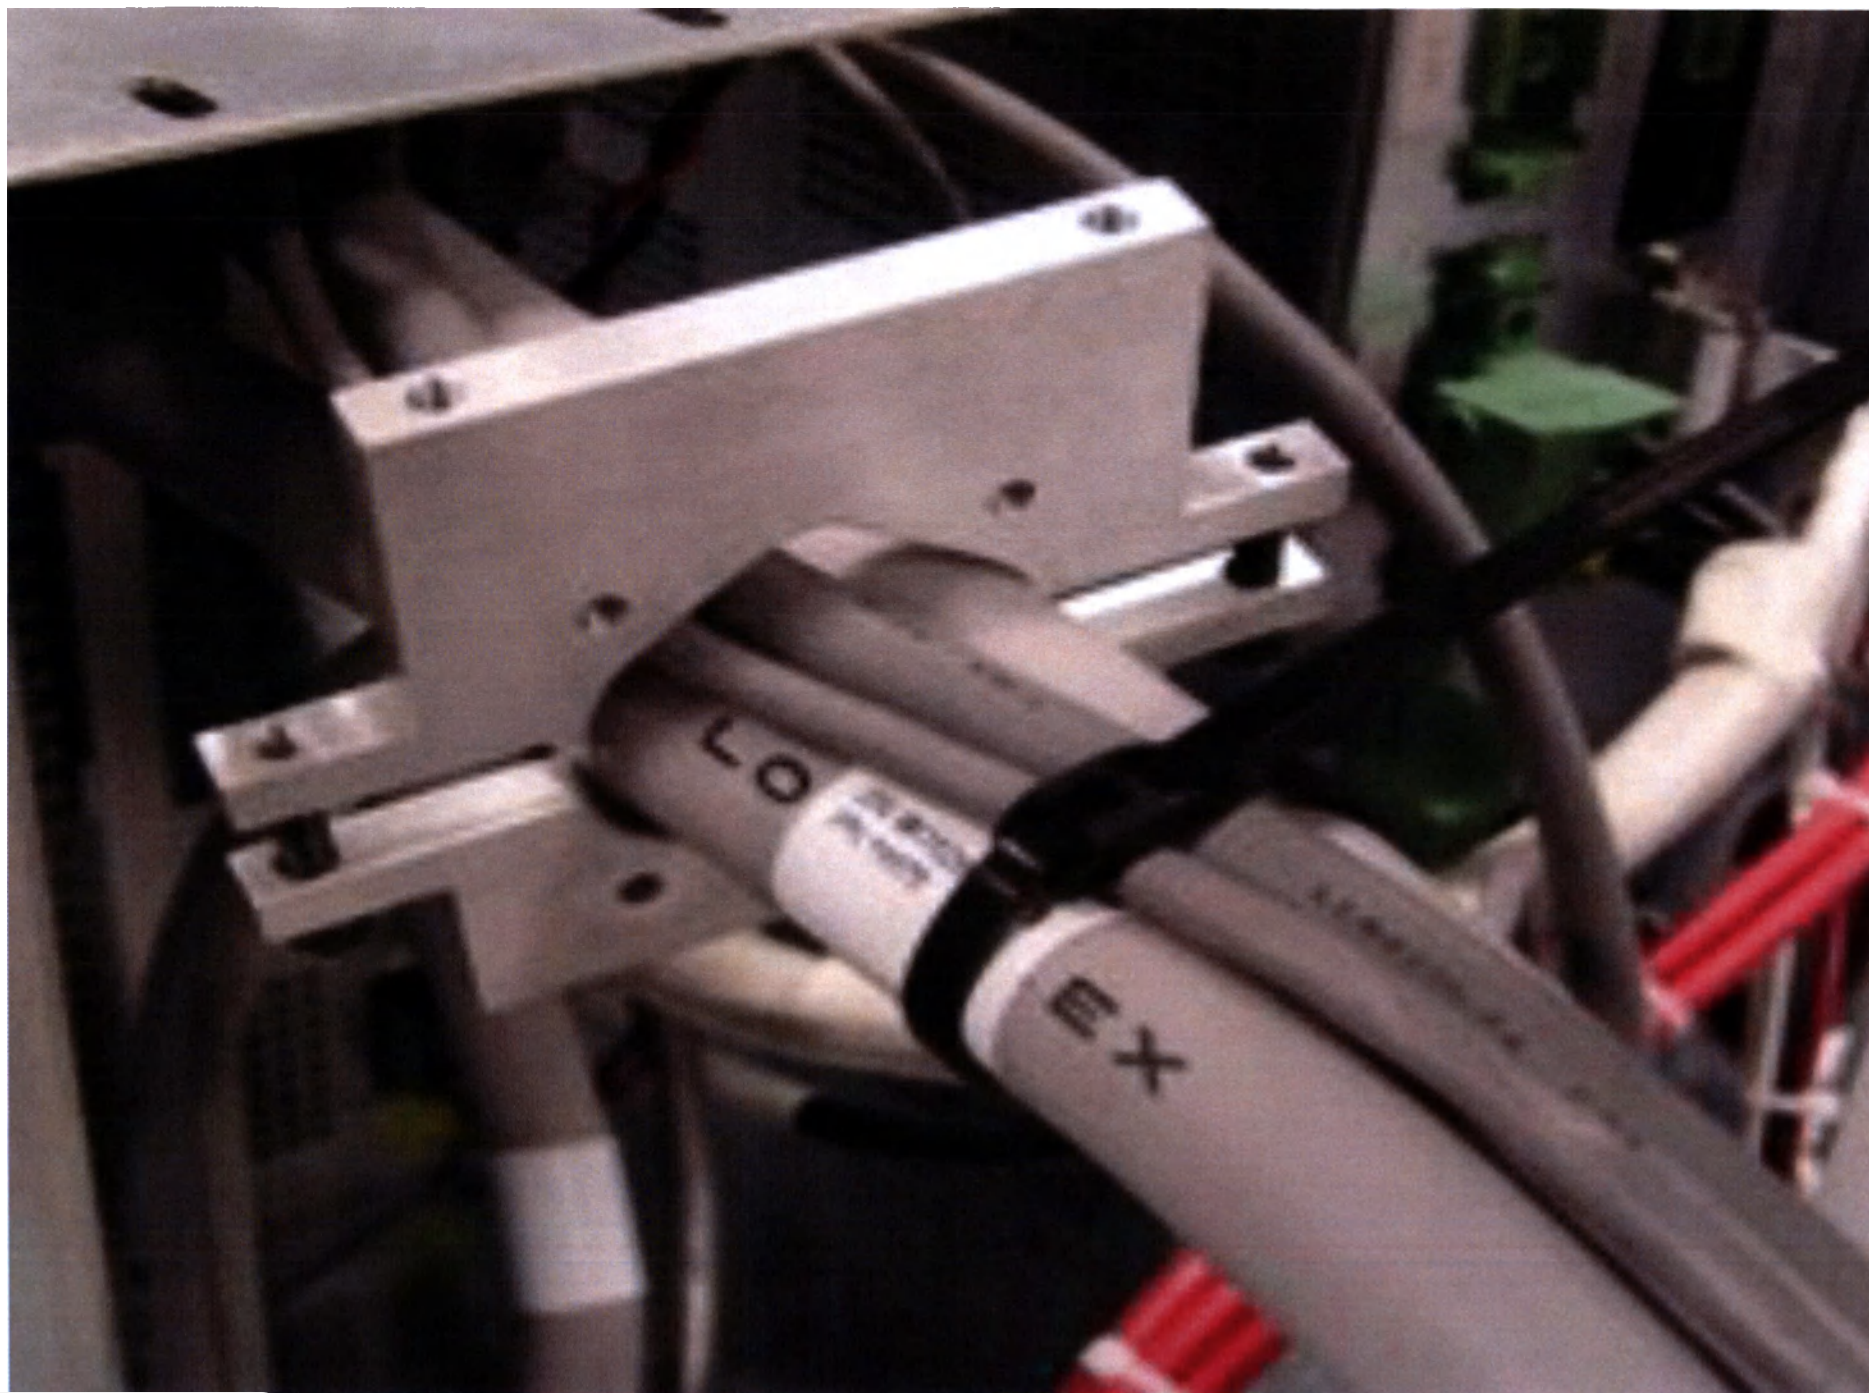



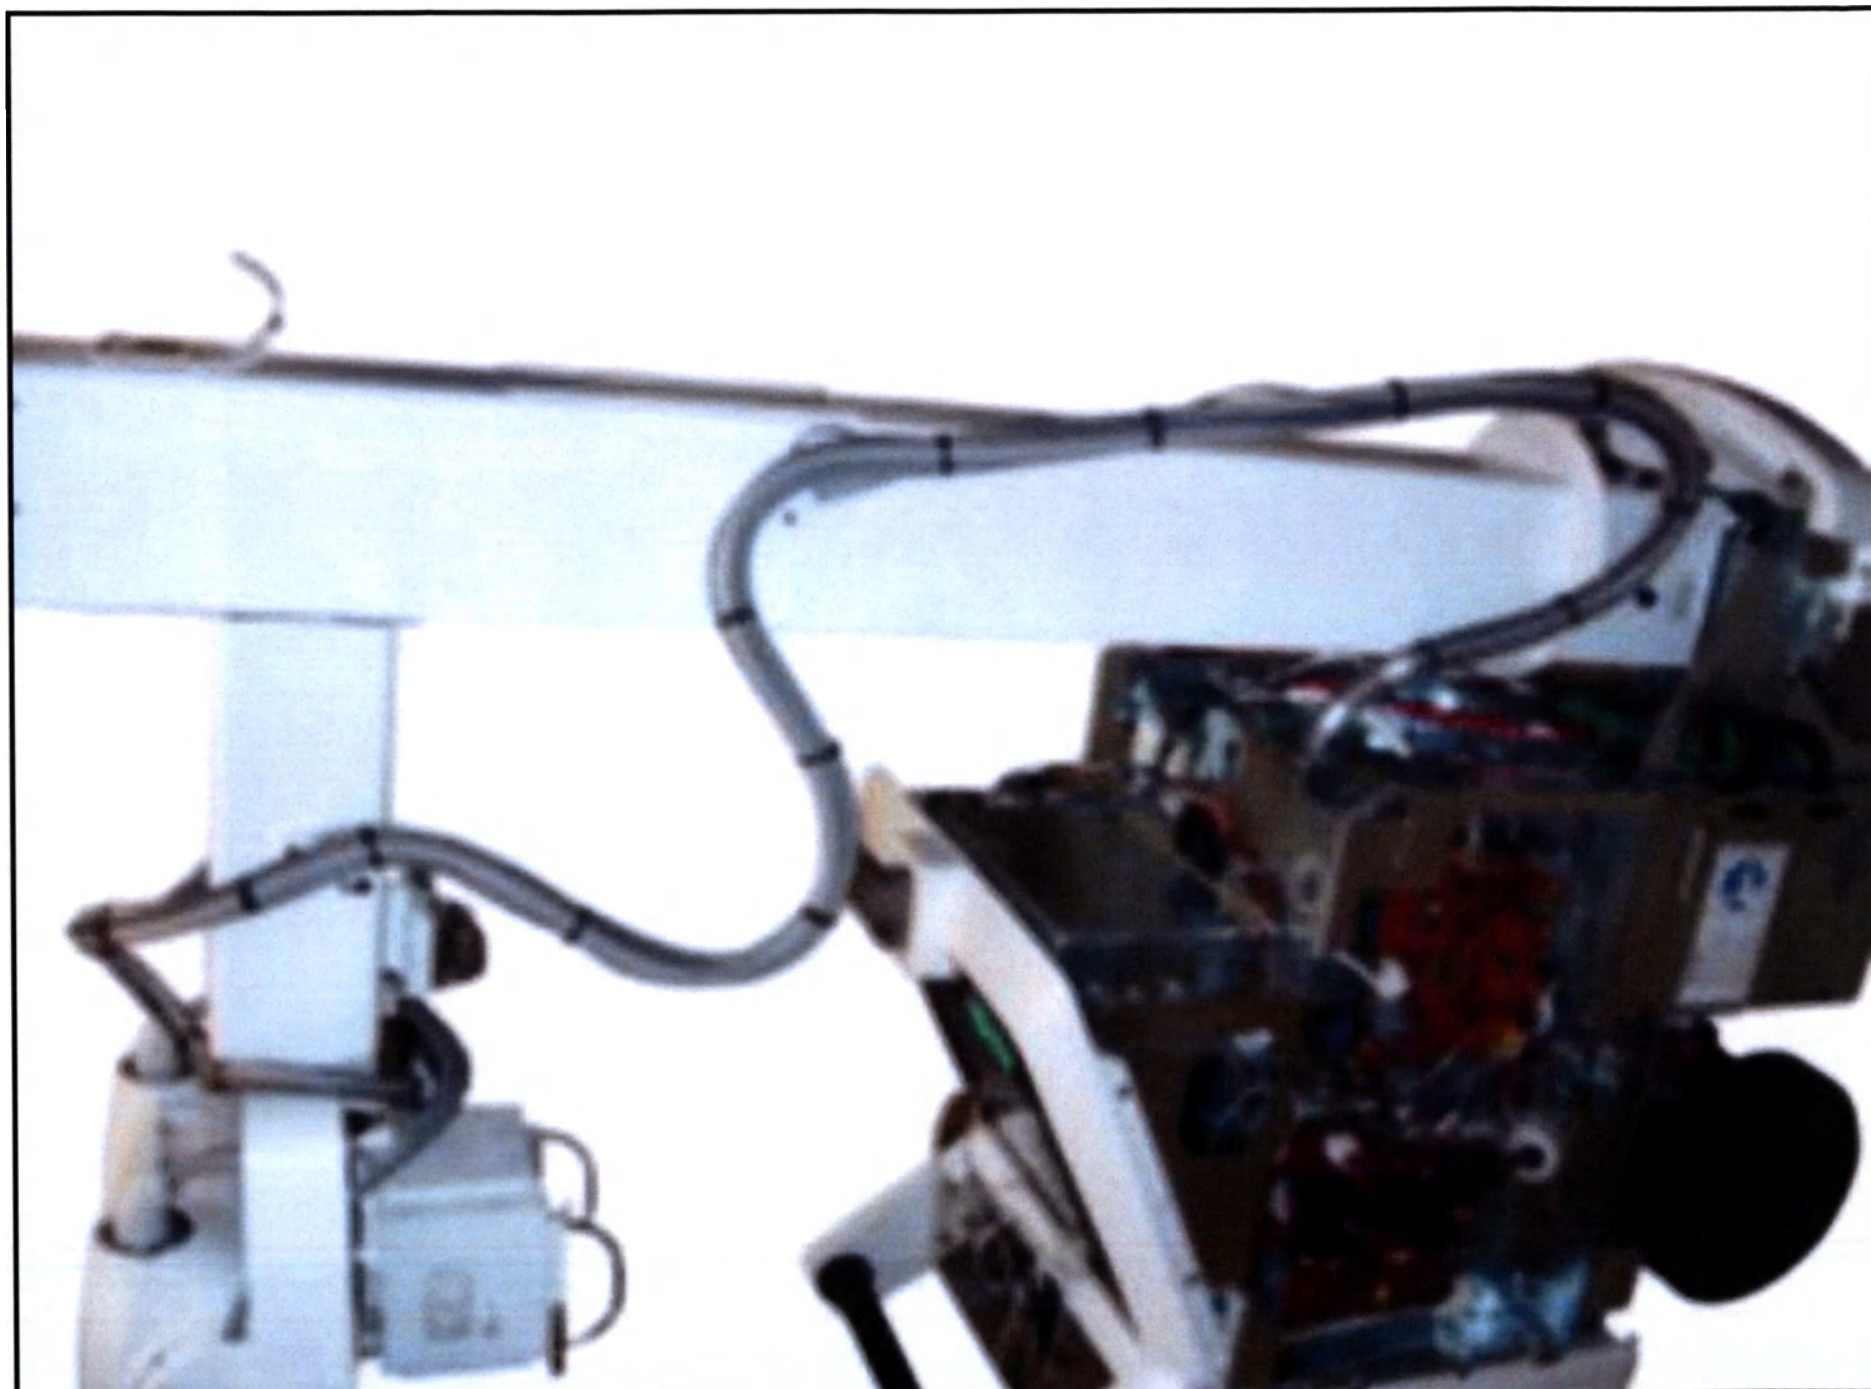















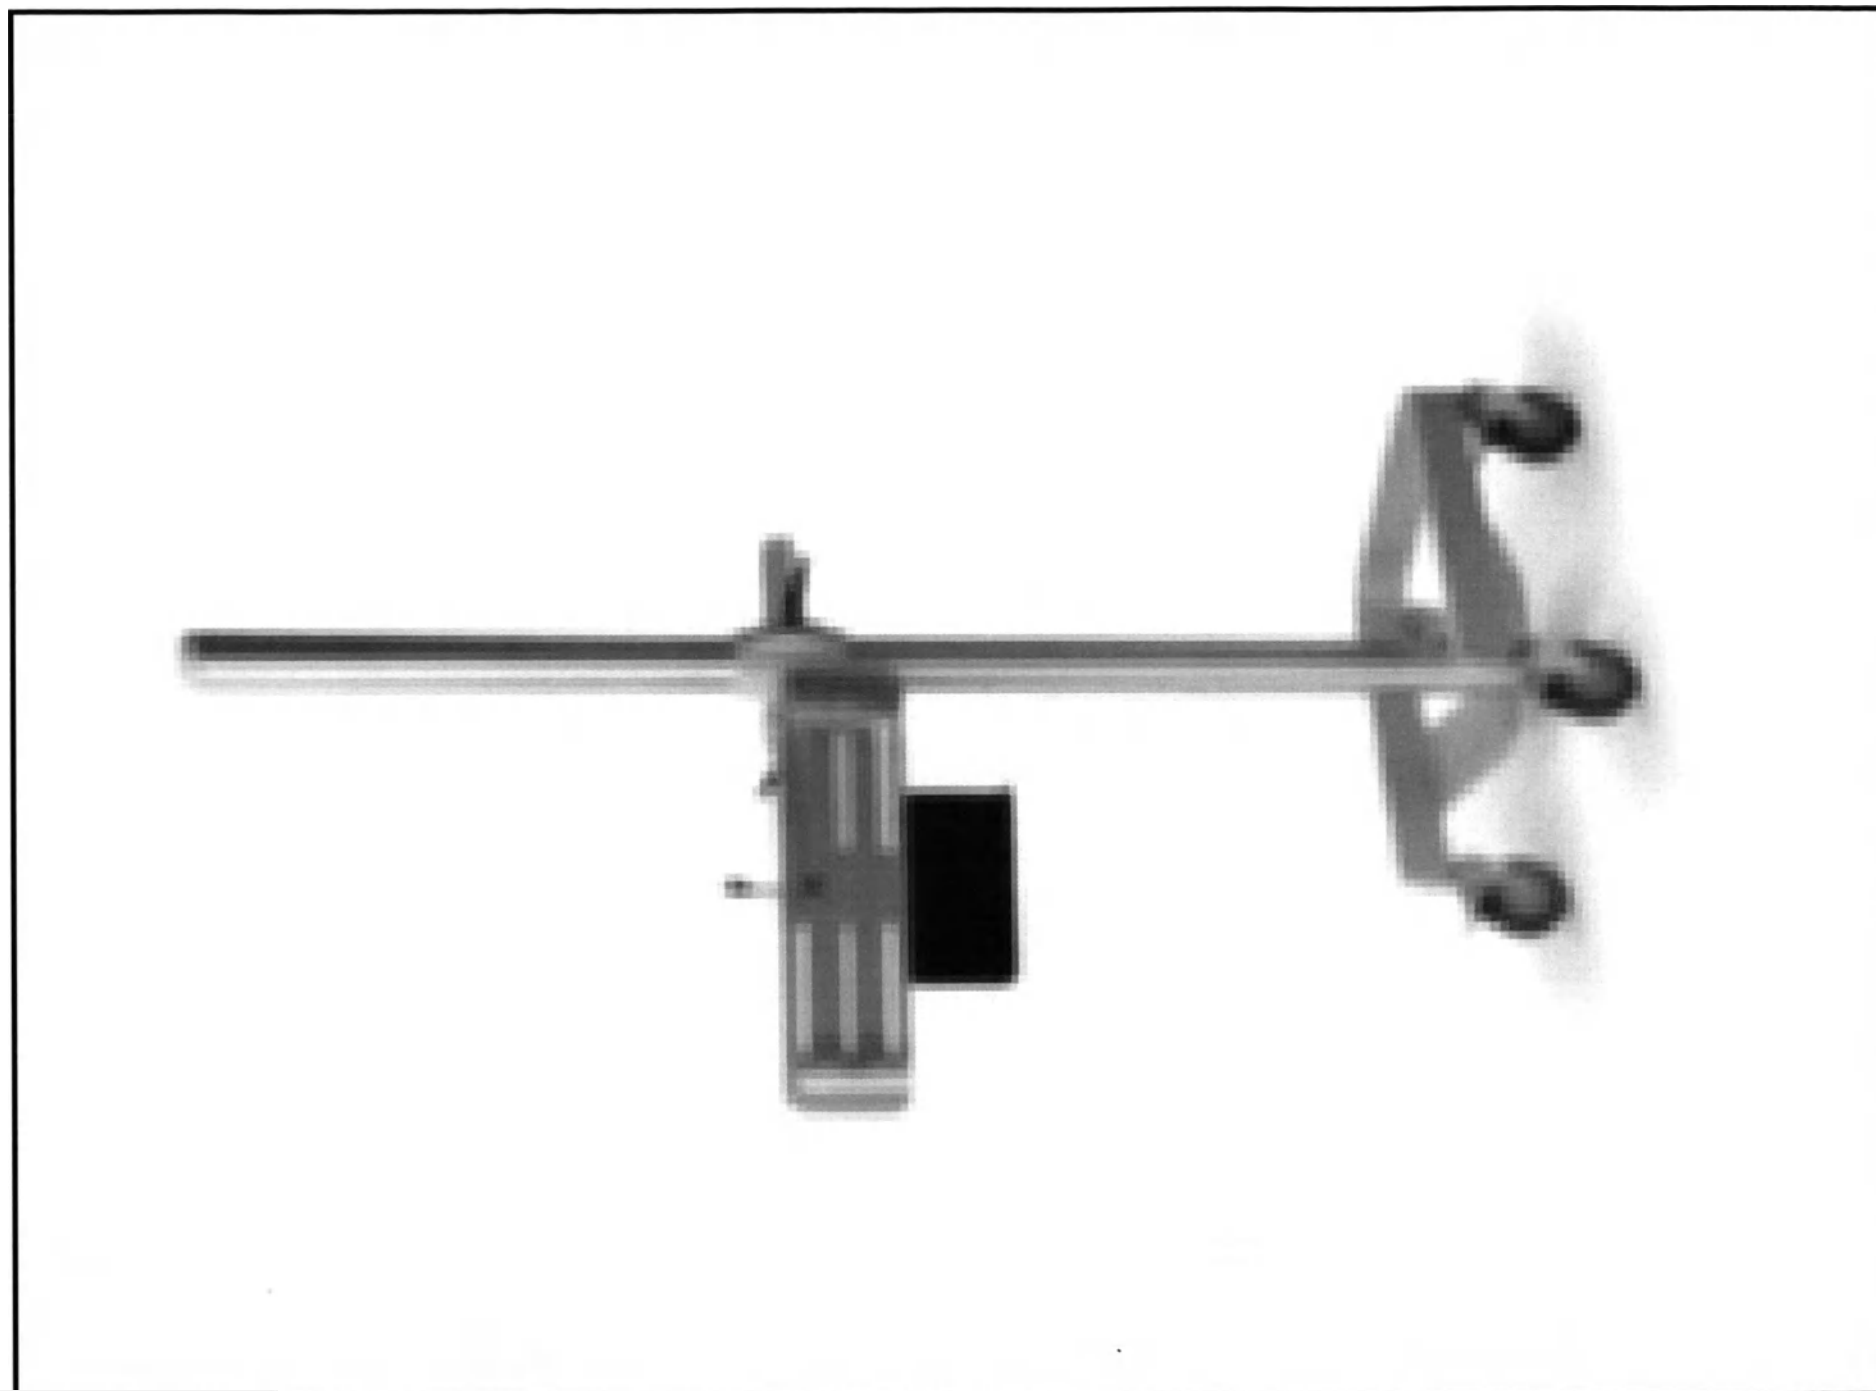


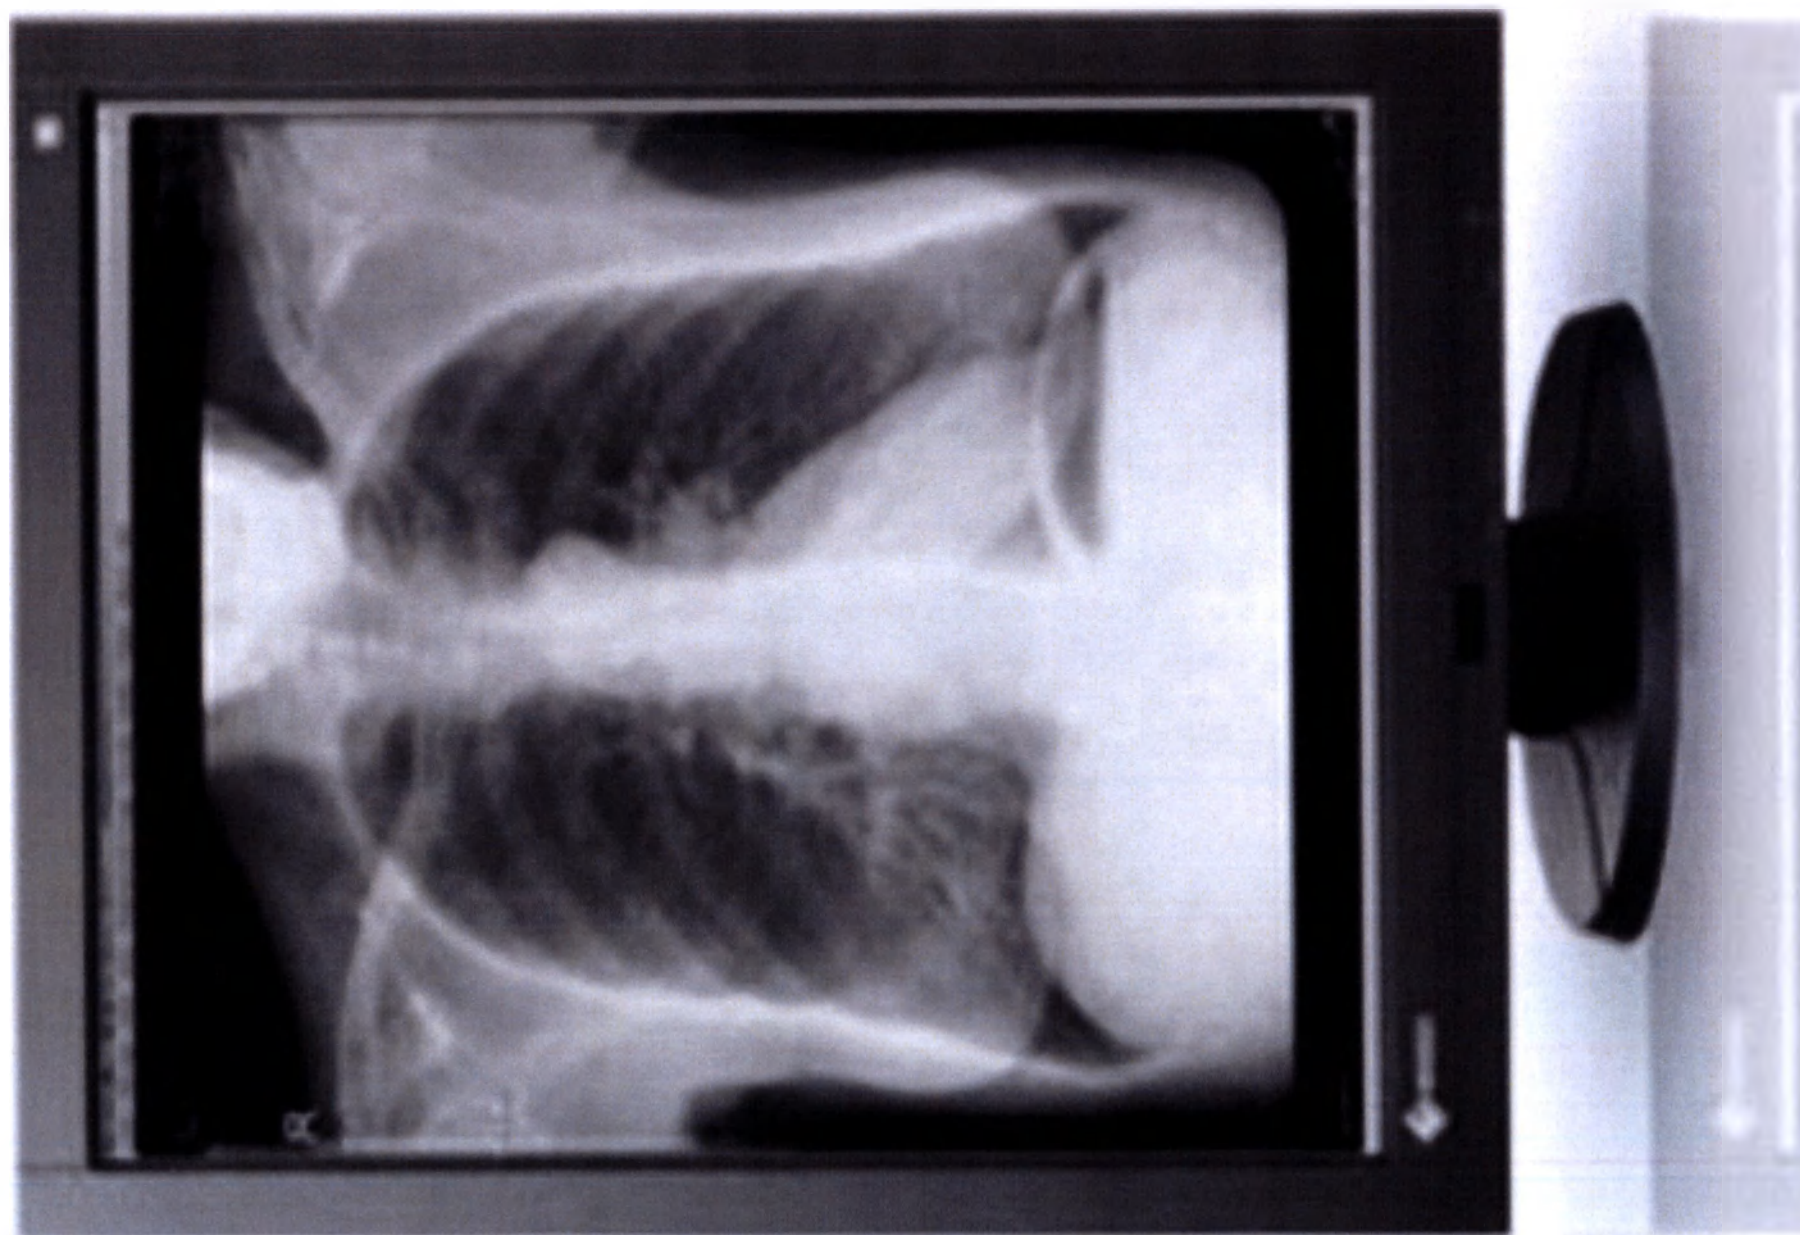









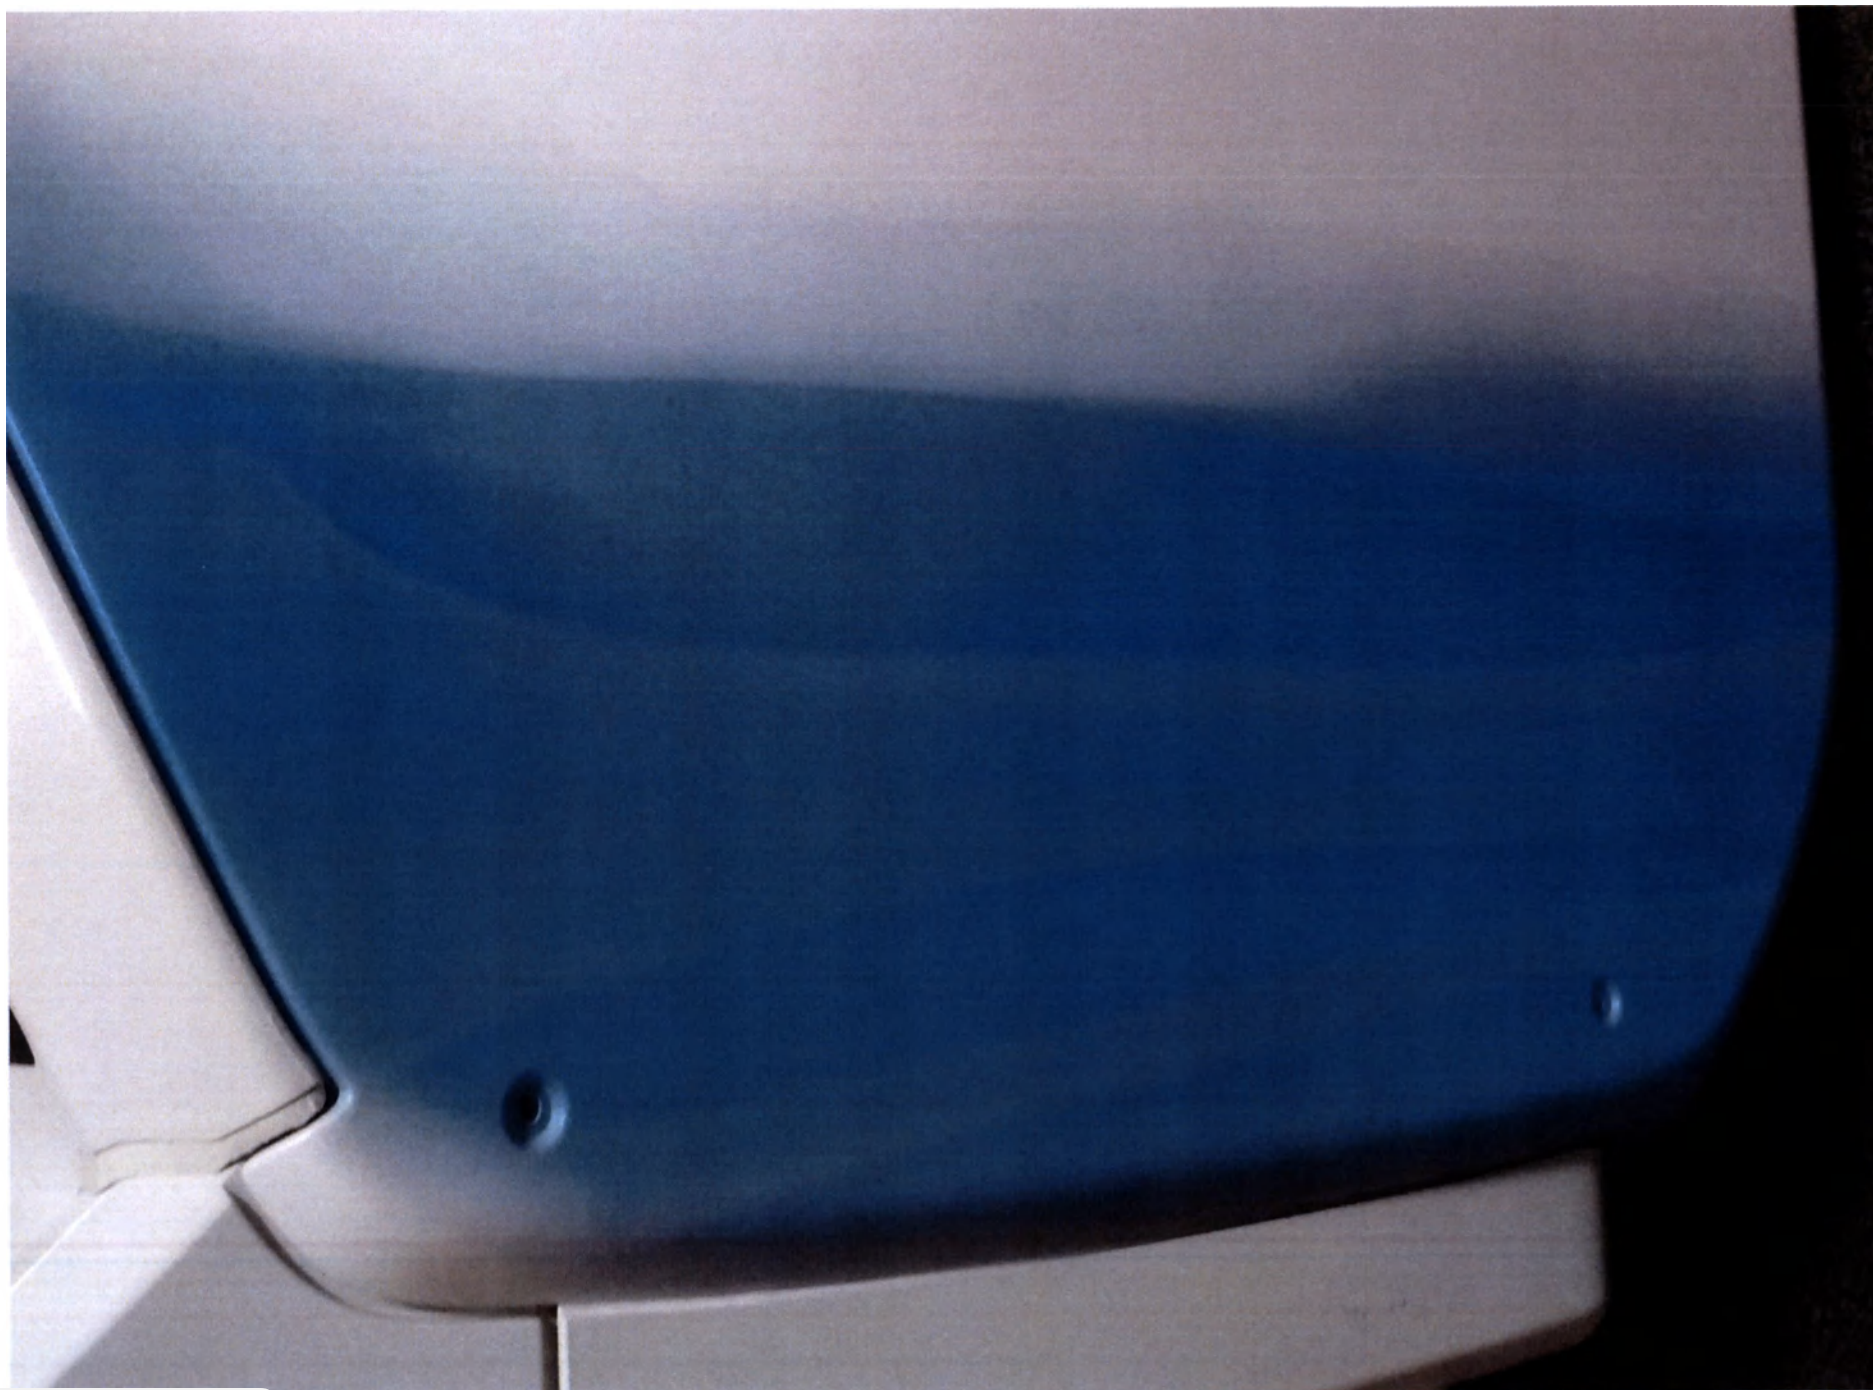

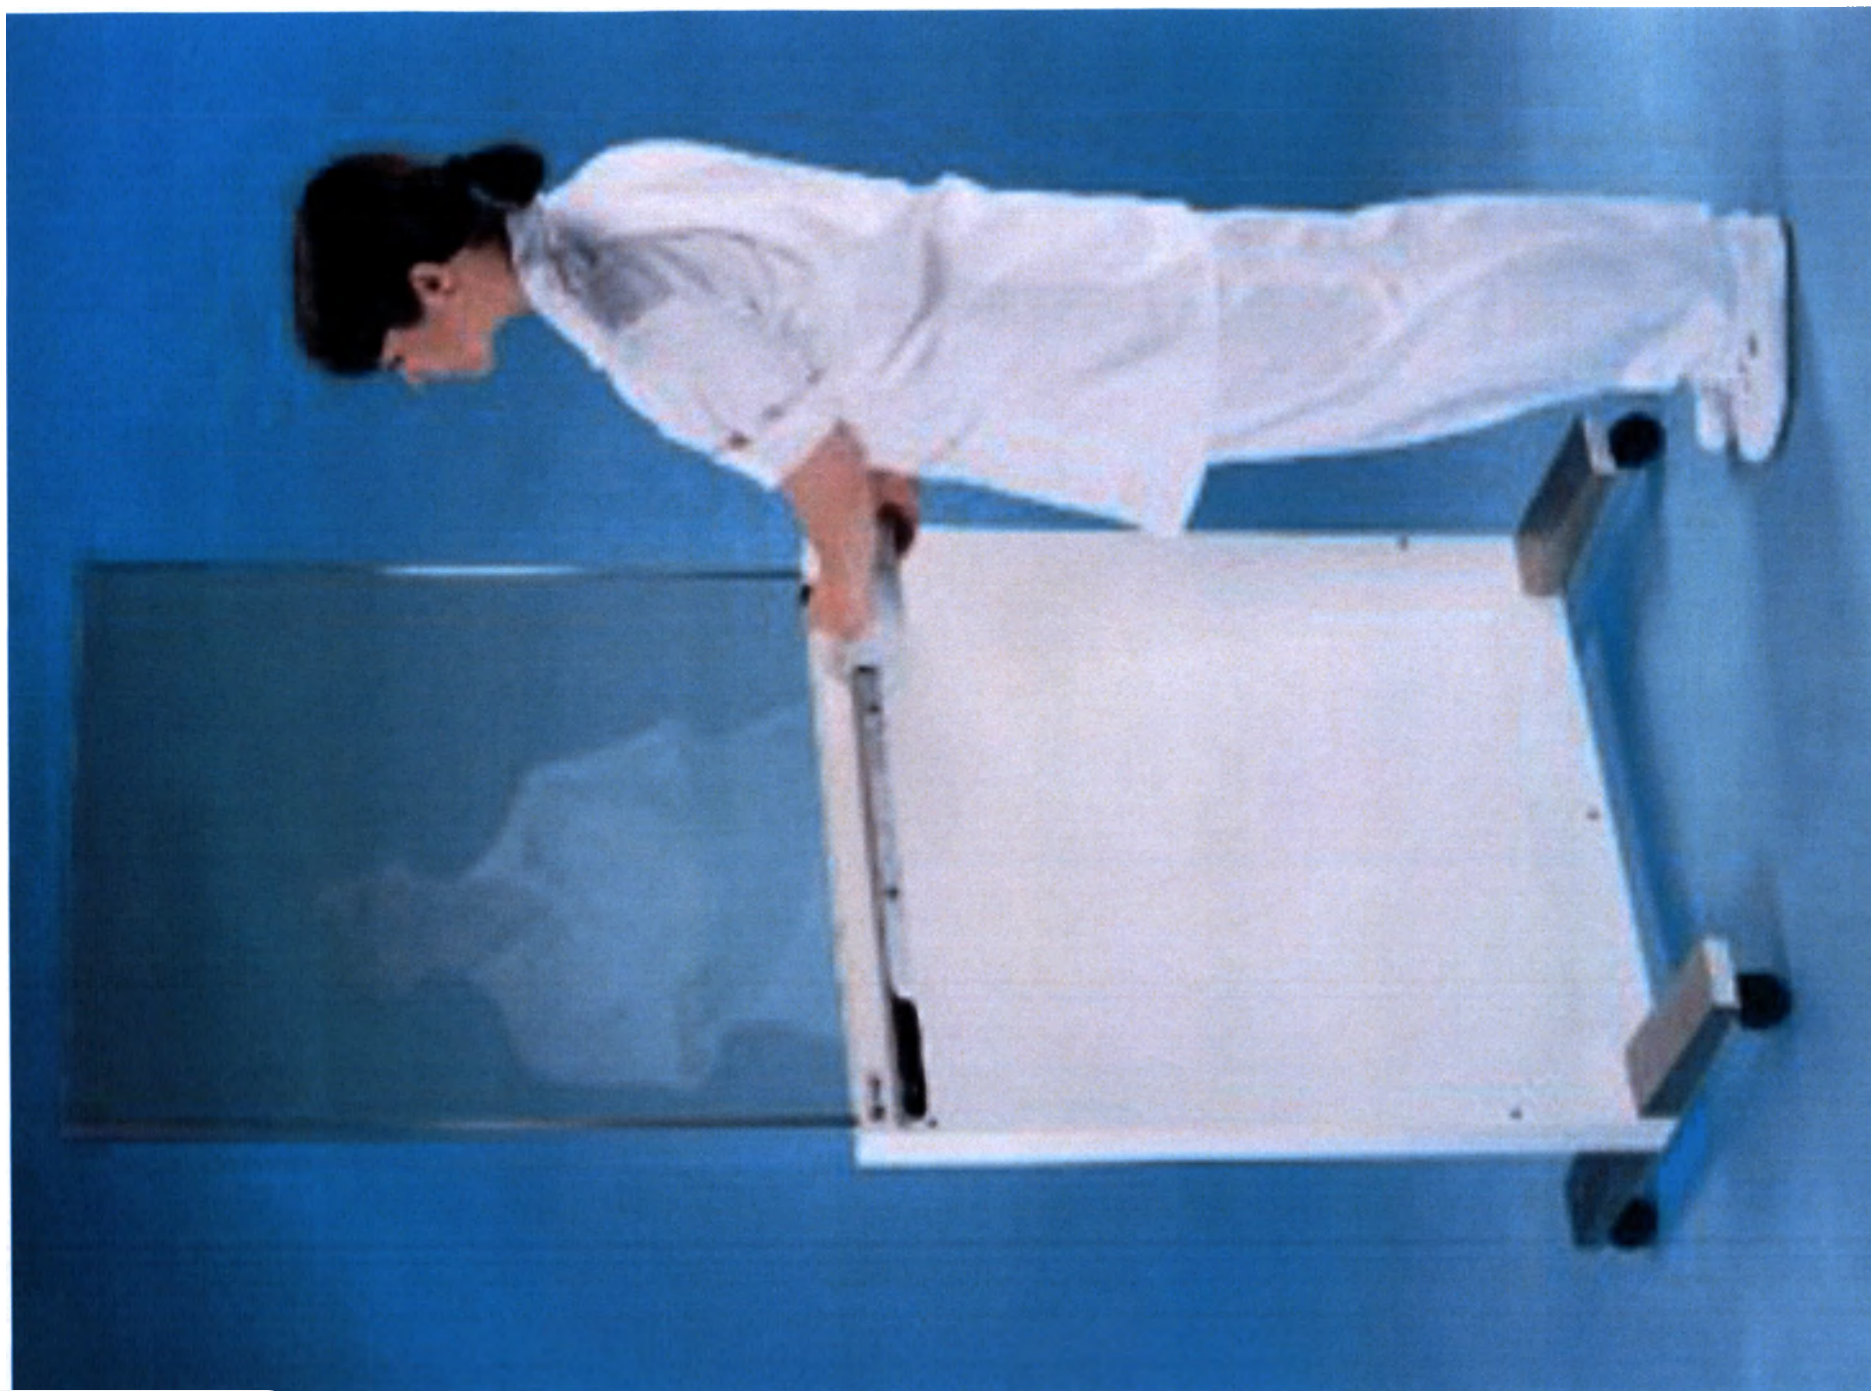

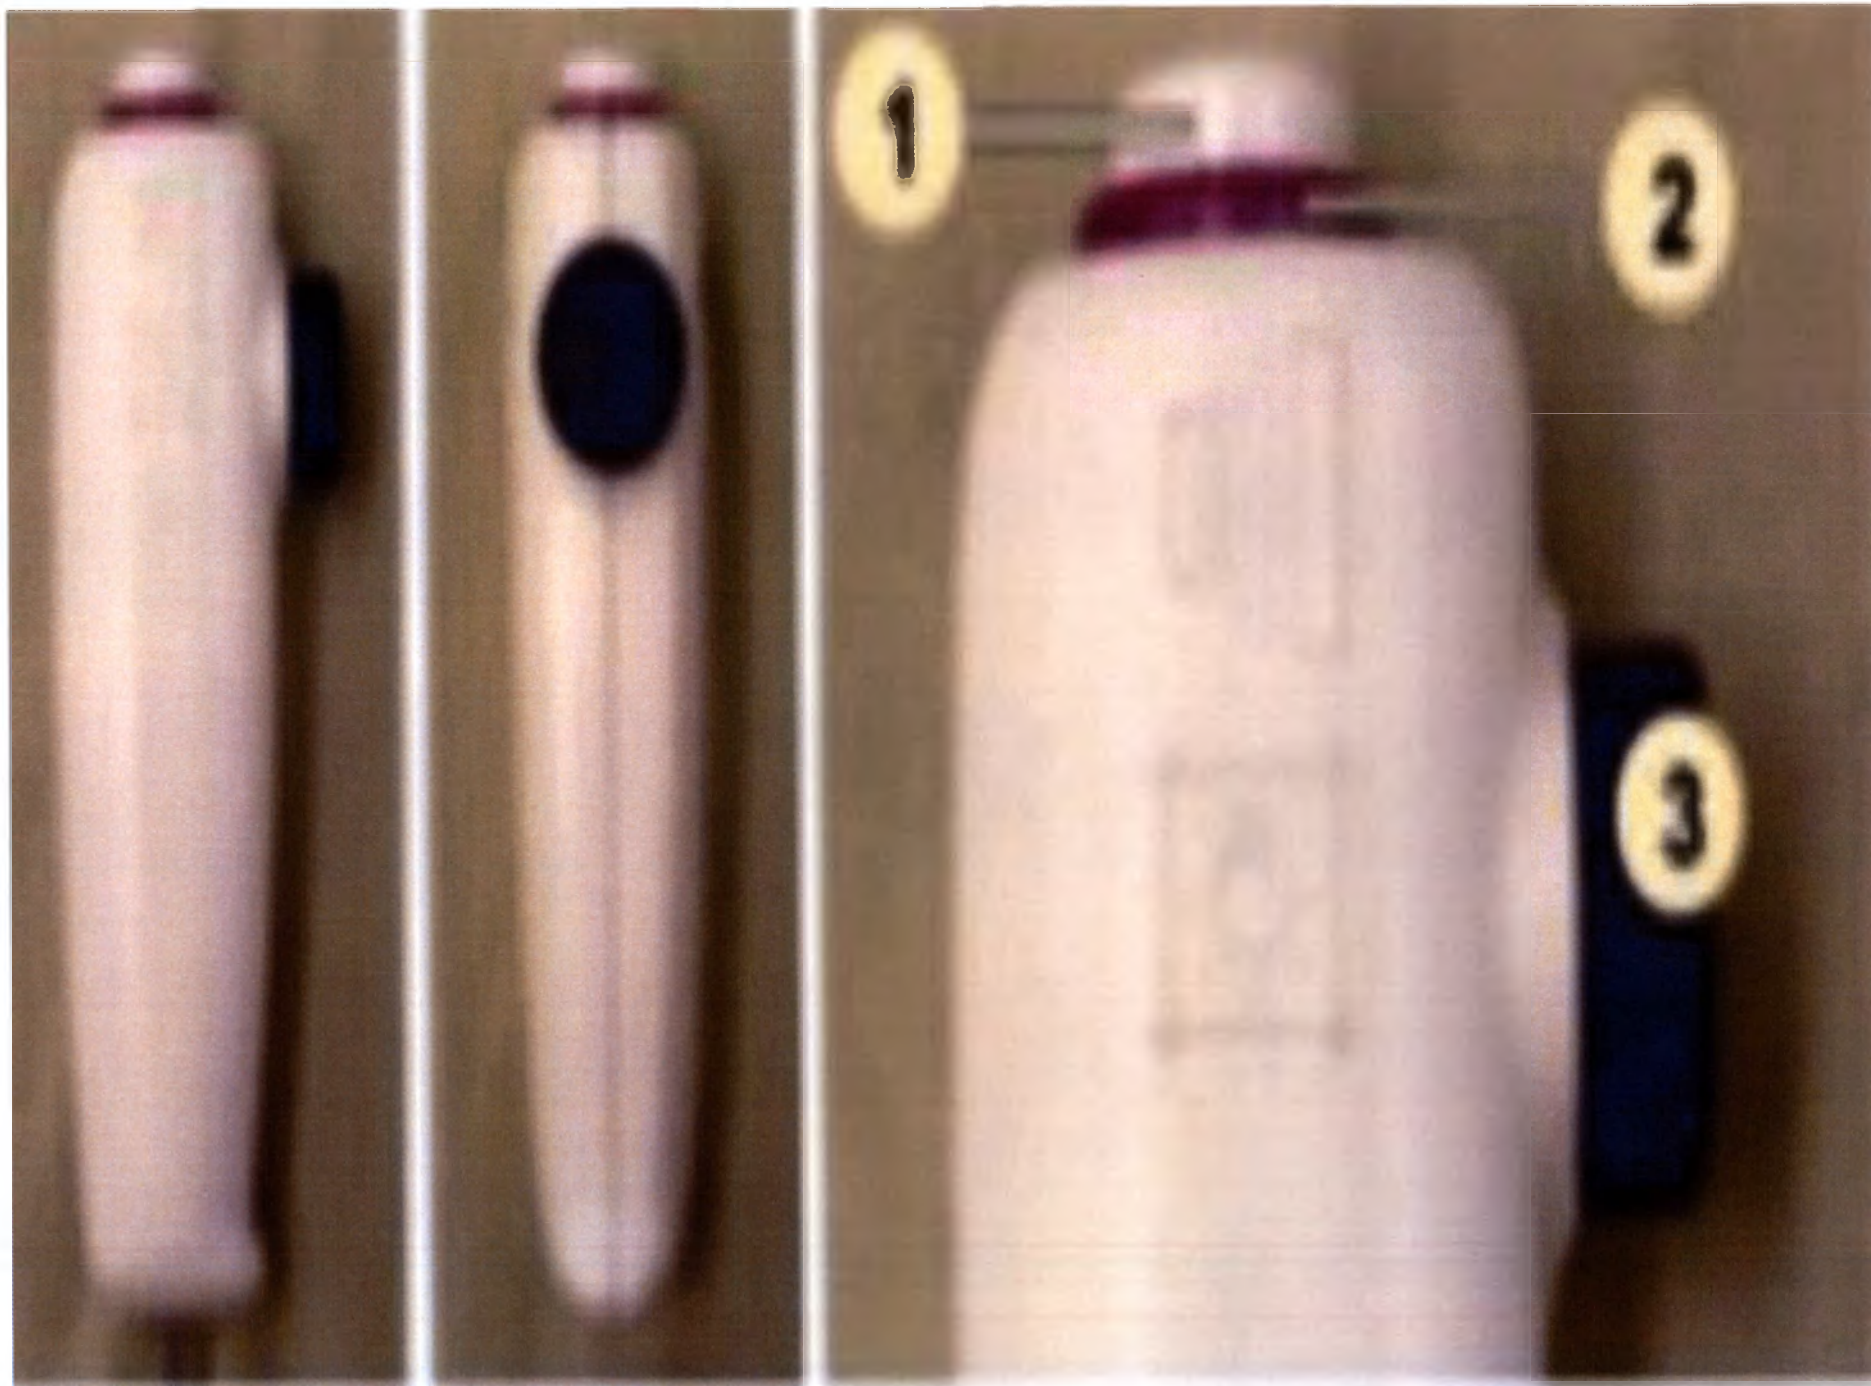


















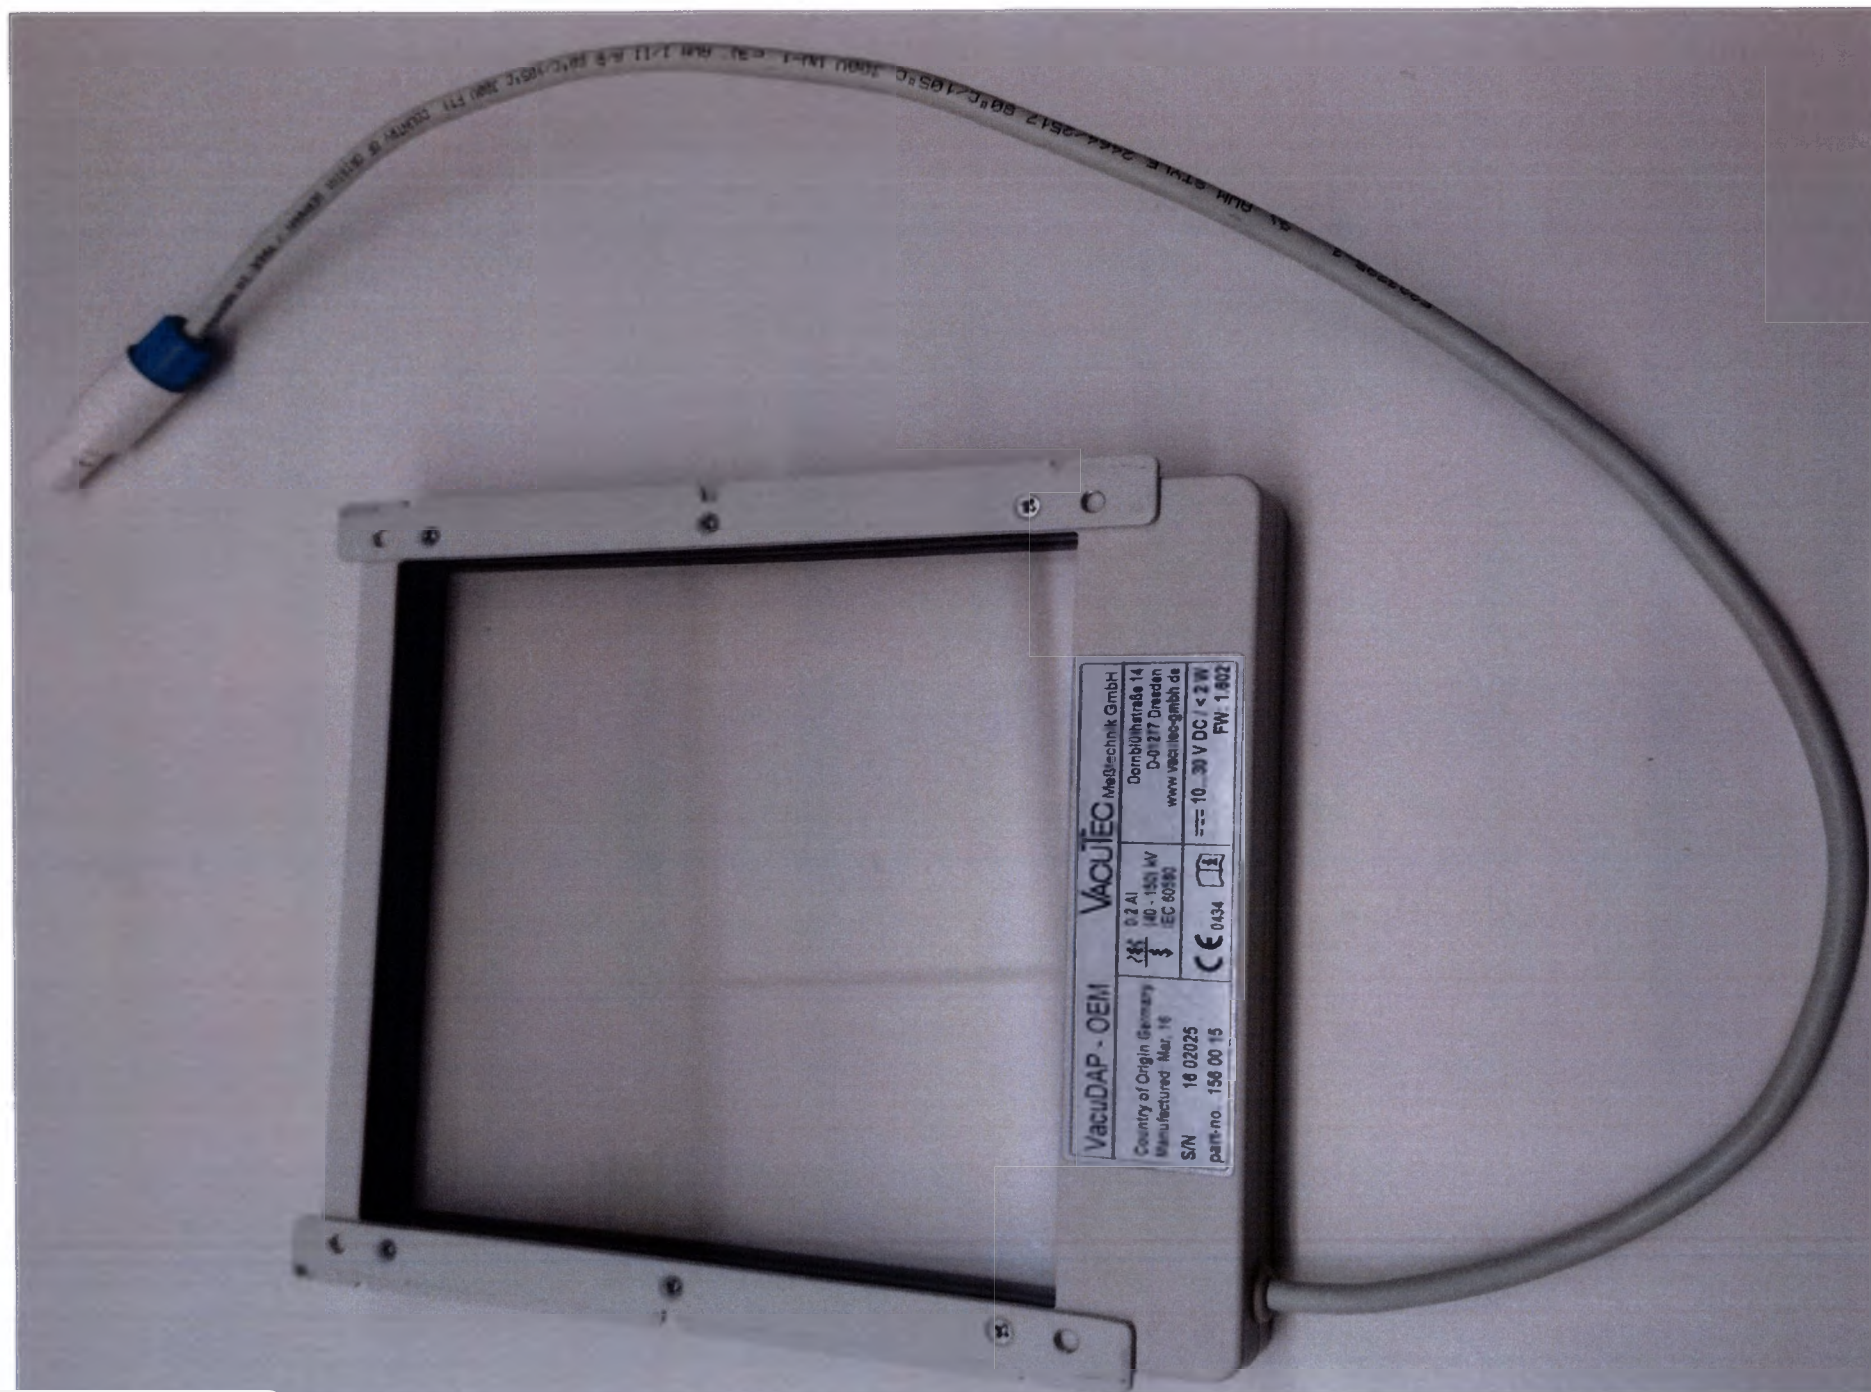









ПГС-ЛО и скреплено
печатью 53 л.