




Фотографические изображения
медицинского изделия

«Комплекс ангиографический Discovery IGS 730 с принадлежностями»

УТВЕРЖДАЮ

Лидер по регистрации
ООО «Джи Хэлскеа»

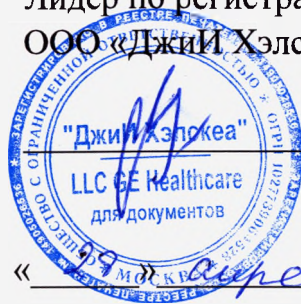

А.В. Андриук

«19» апрель 2018 г.





R ONLY



CE 0459



SP LR 80463
C US



**LAMP CONTAINS MERCURY,
DISPOSE ACCORDING TO
STATE/LOCAL LAW. 灯泡含
水银, 请按当地法律处理。**

Информация для России

Модель Discovery IGS 730



**См. международные символы
и другую идентификационную
информацию выше**



≥ 3.5 mm Al 70kV

Discovery IGS 730

REF 5715524

SN SS-SS-SSS



**GE MEDICAL SYSTEMS SCS
283 RUE DE LA MINIERE
78530 BUC-FRANCE**



2018-04


MODEL NUMBER: 5418812

MANUFACTURED: APRIL 2018


**COMPLIES WITH DHHS RADIATION
PERFORMANCE STANDARDS 21 CFR
SUBCHAPTER j**

**Diimpor oleh: PT GE Operations Indonesia
Jakarta - Indonesia
Kemenkes RI AKL 21501311102**




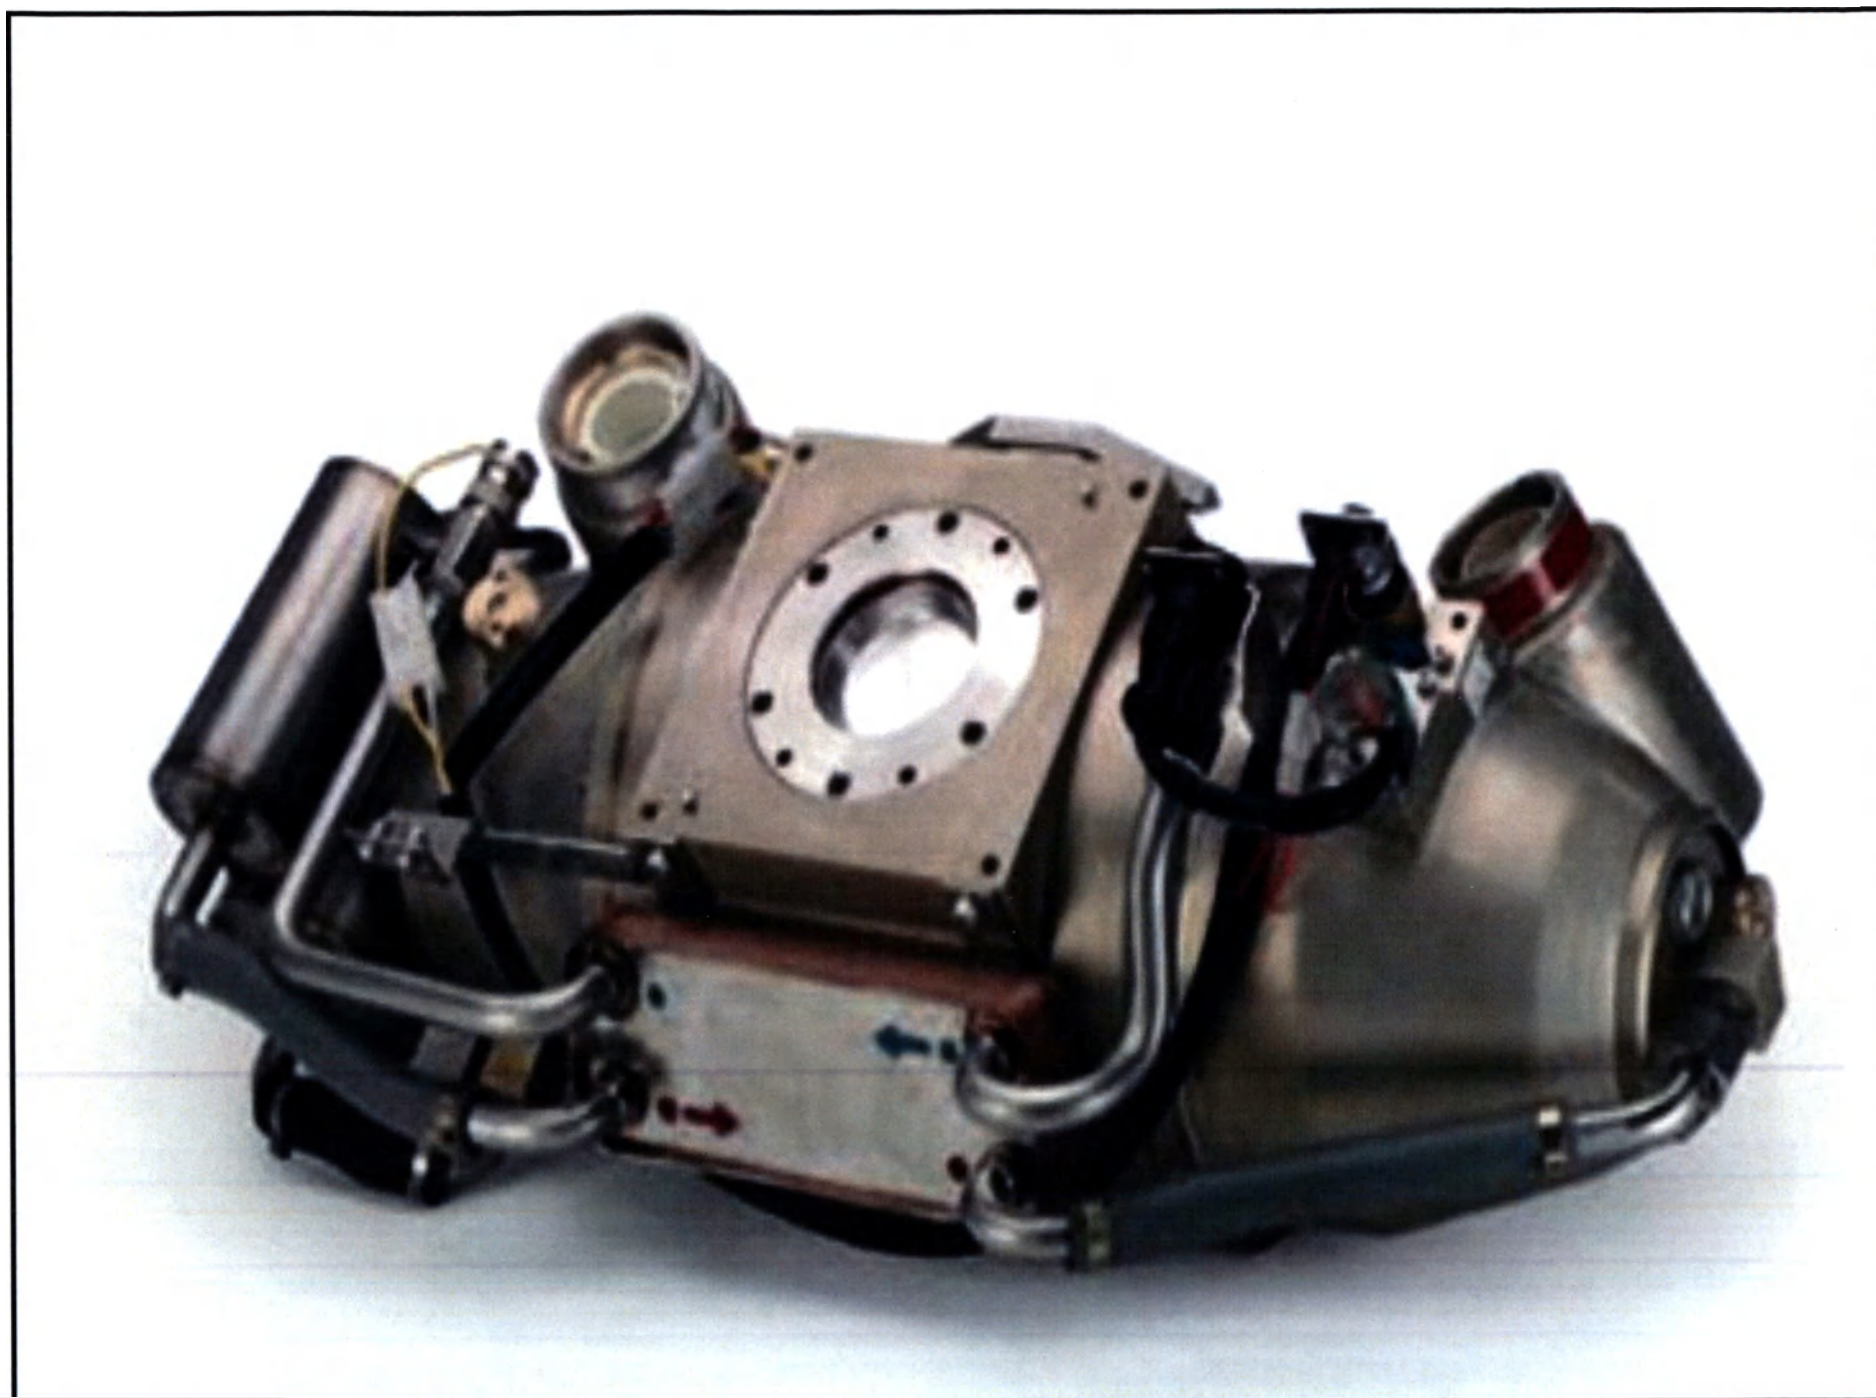




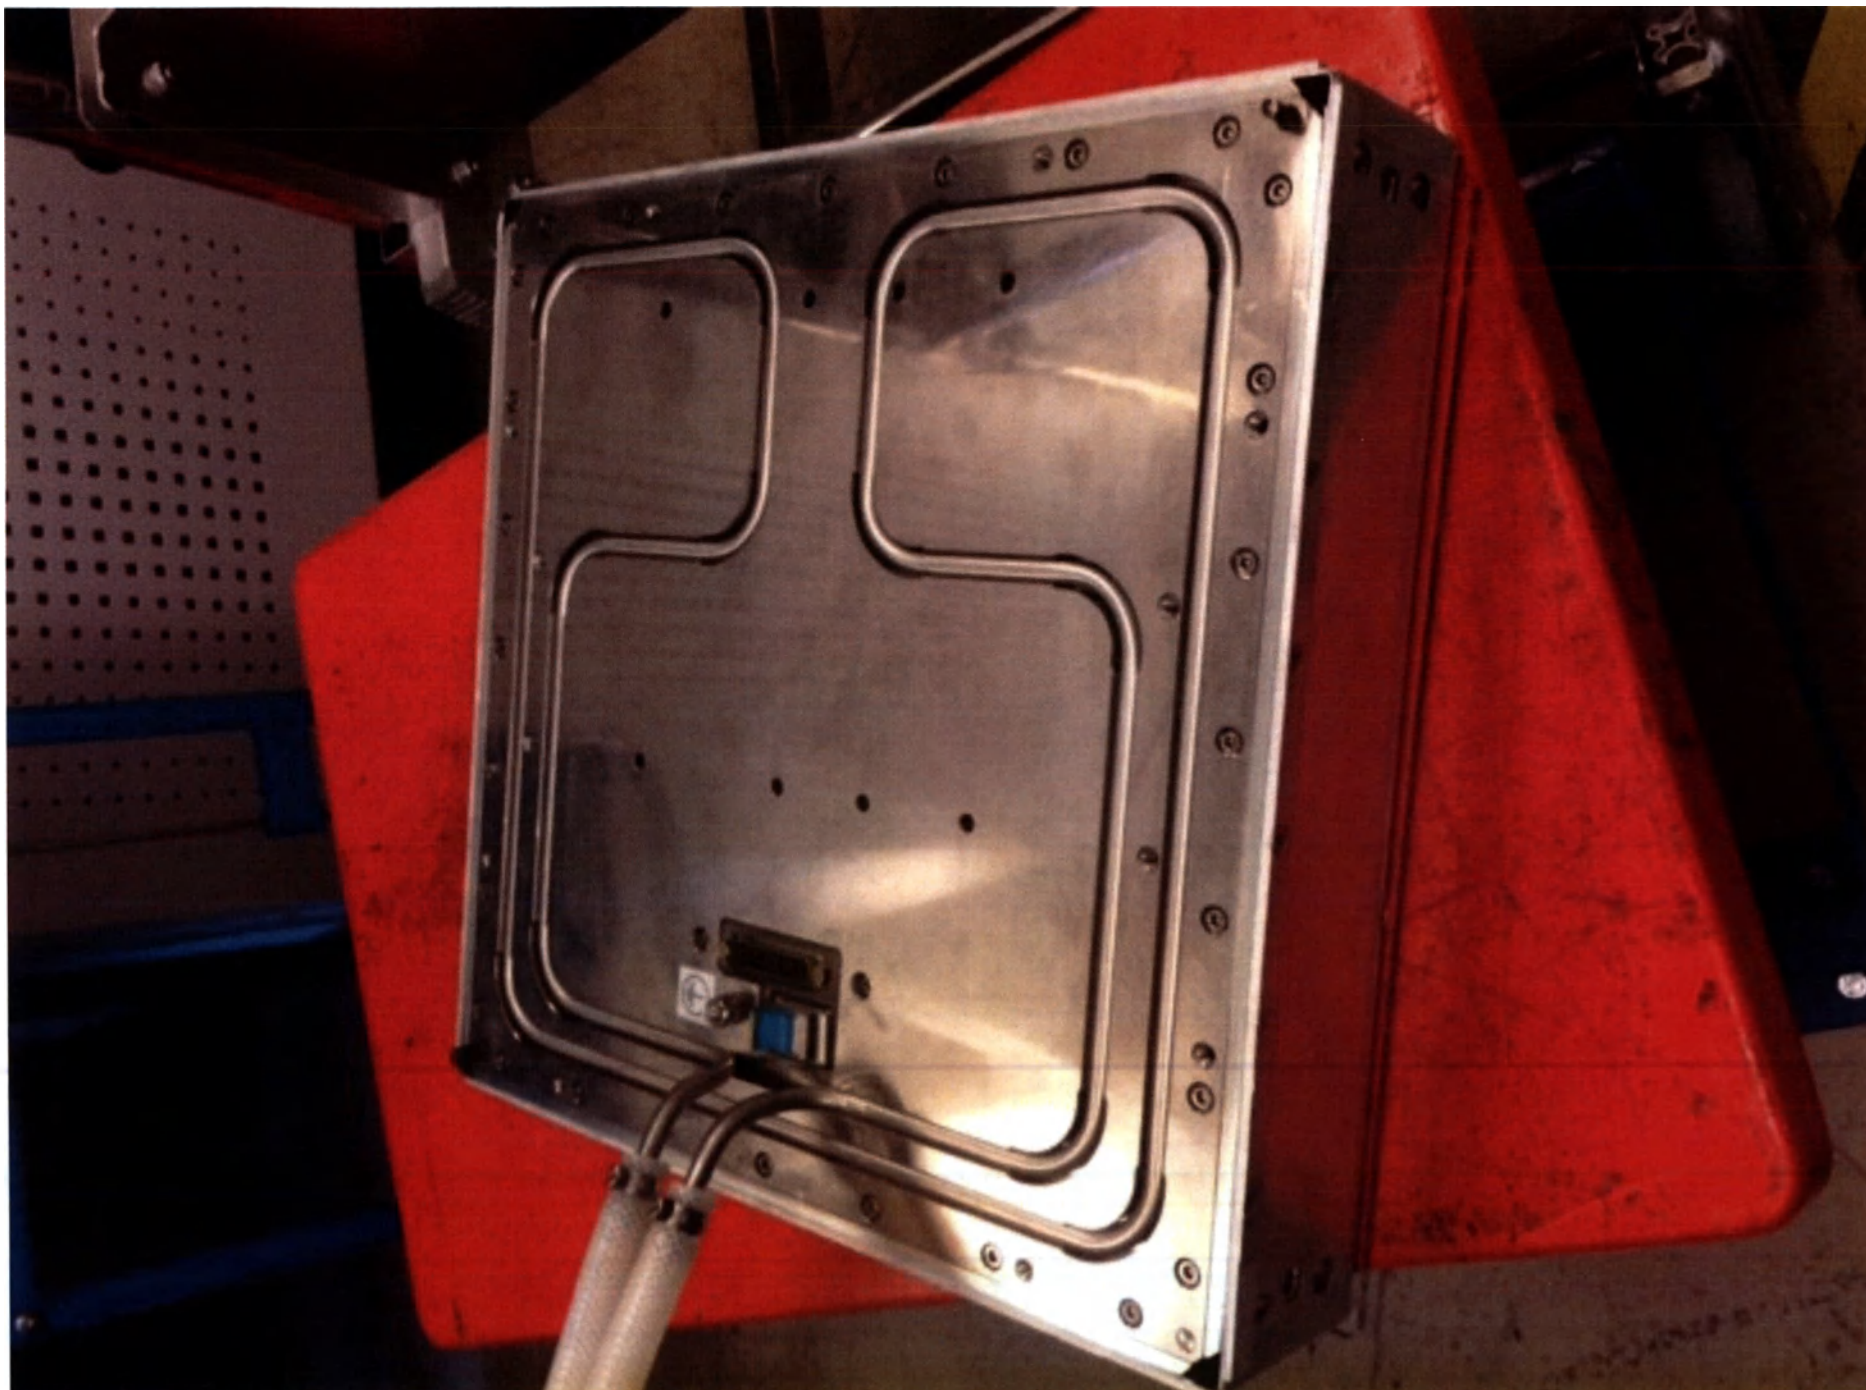




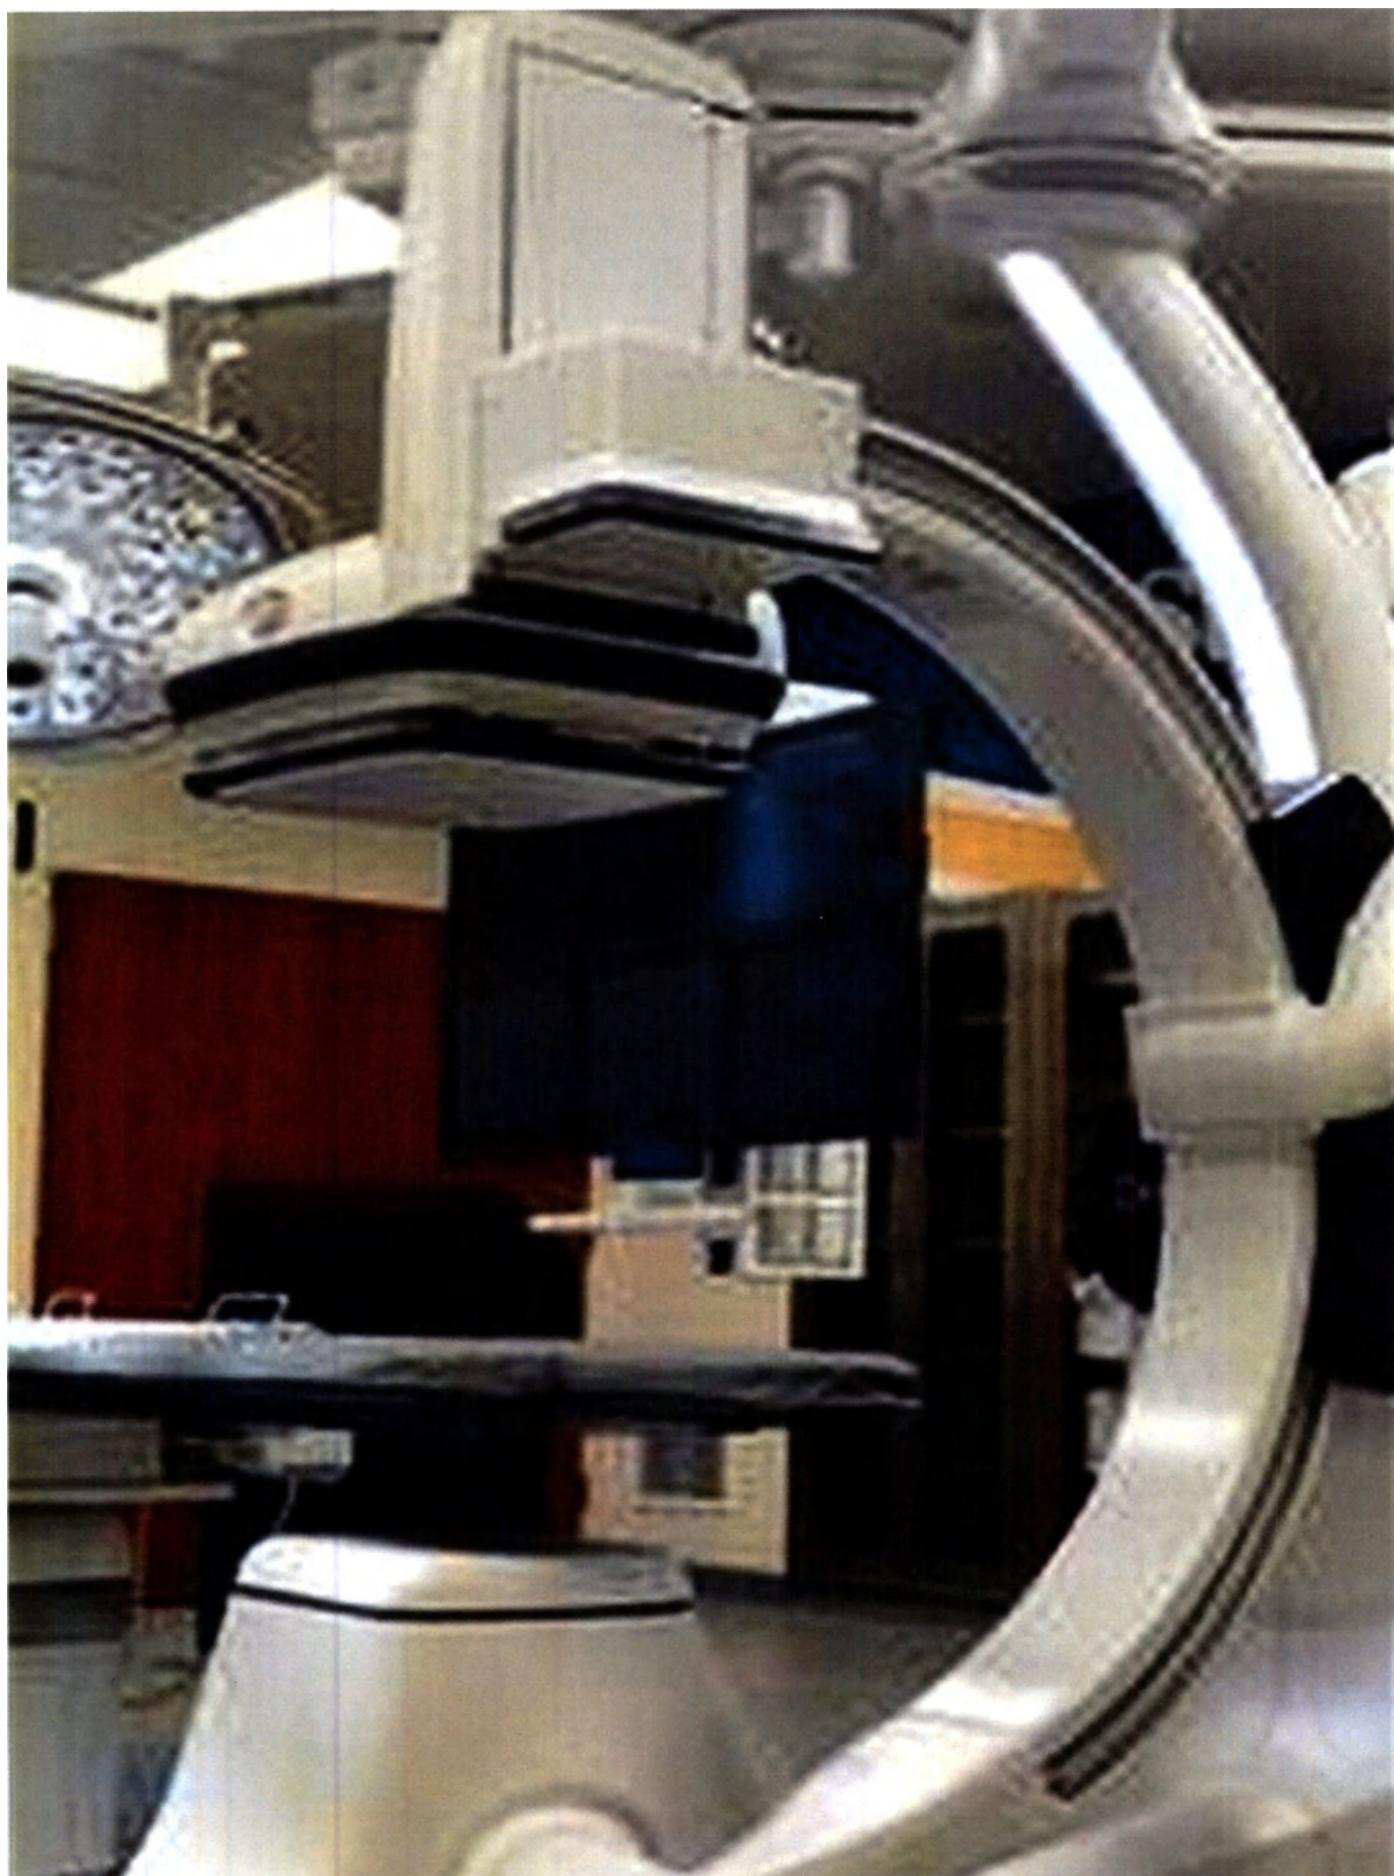




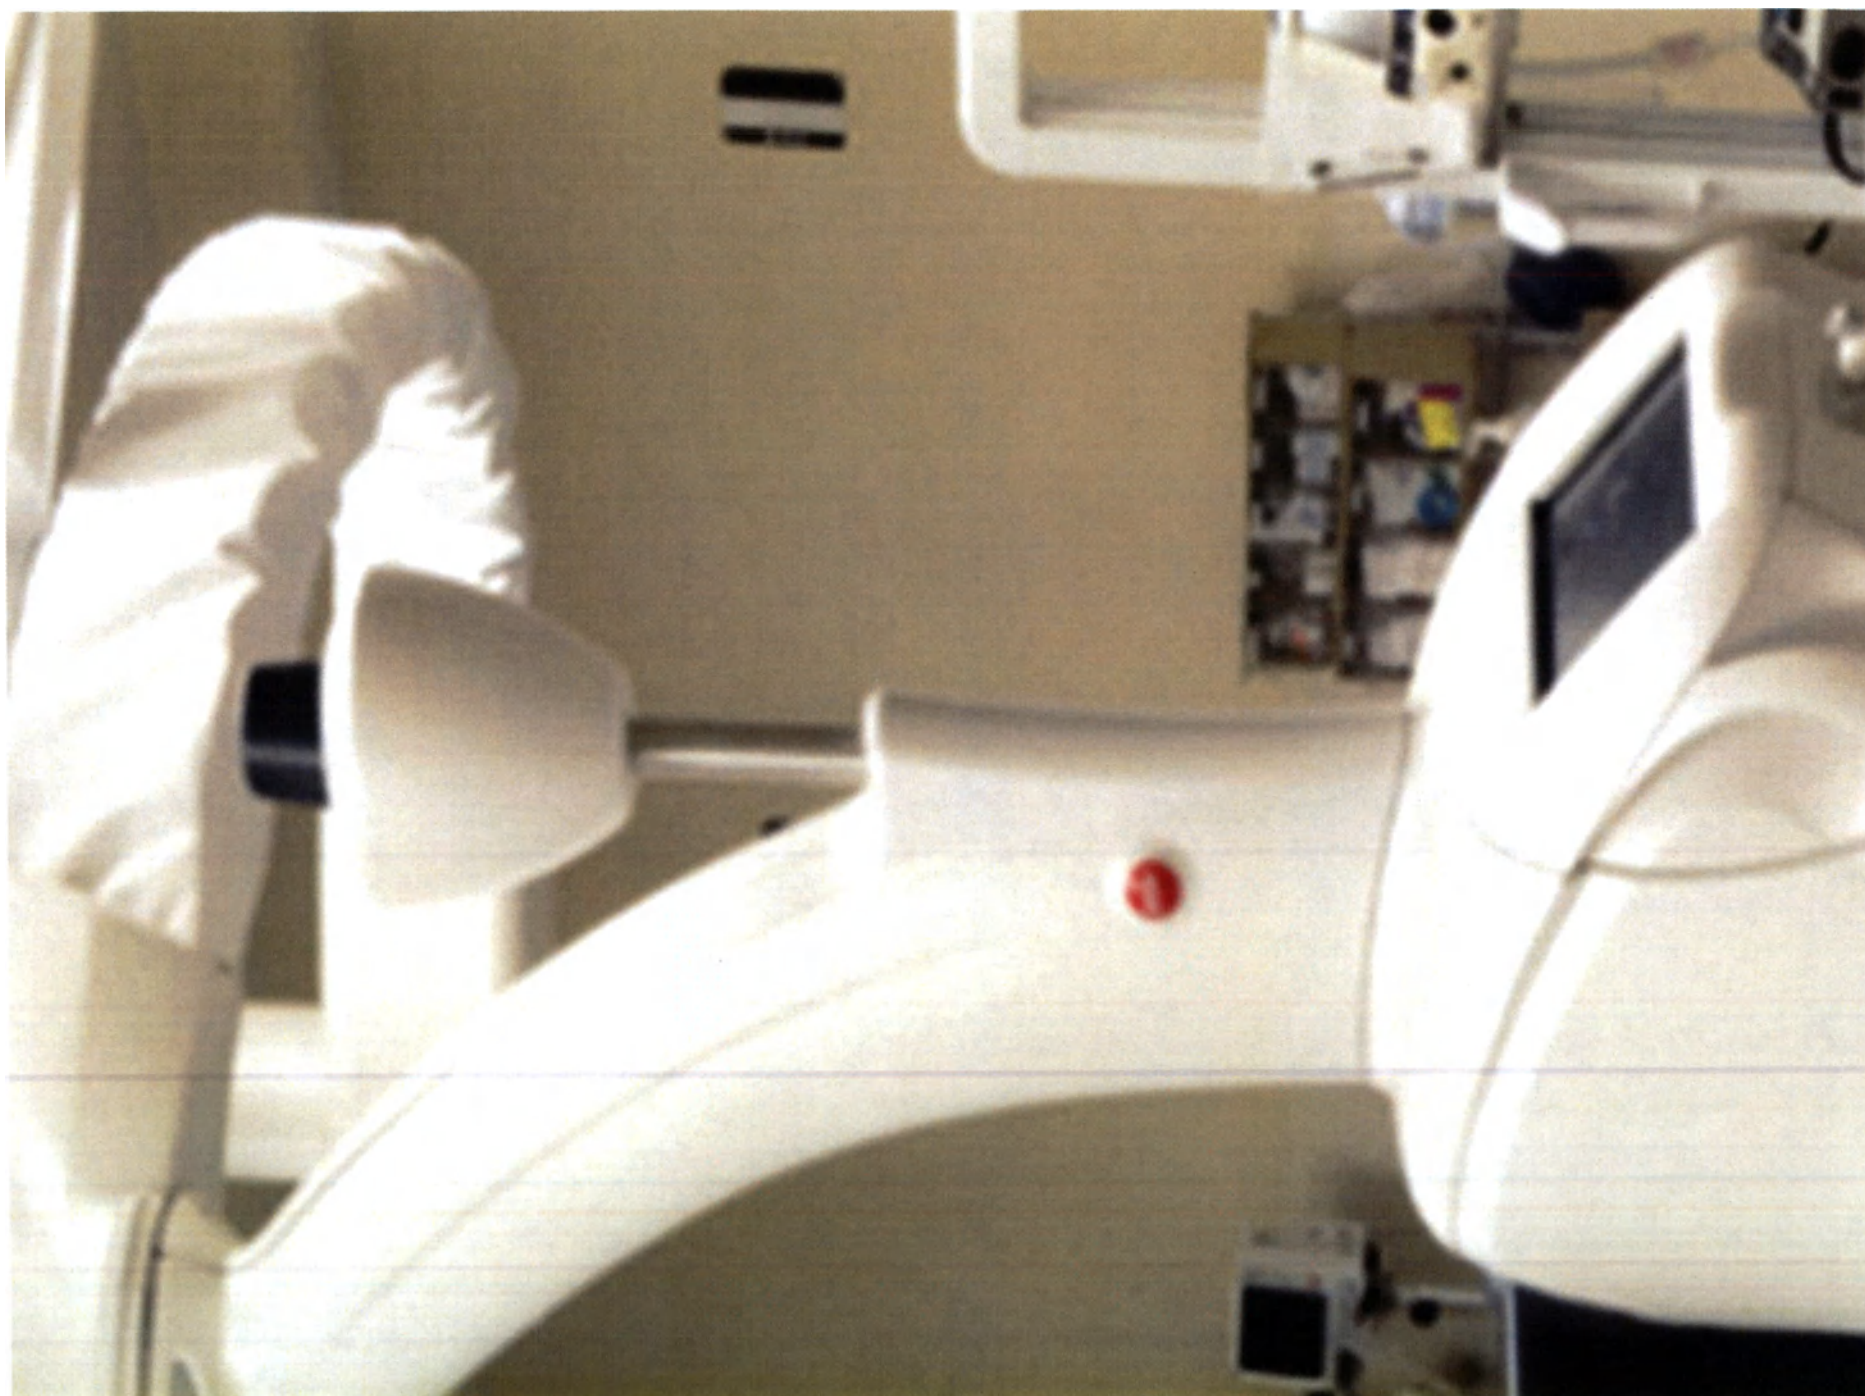



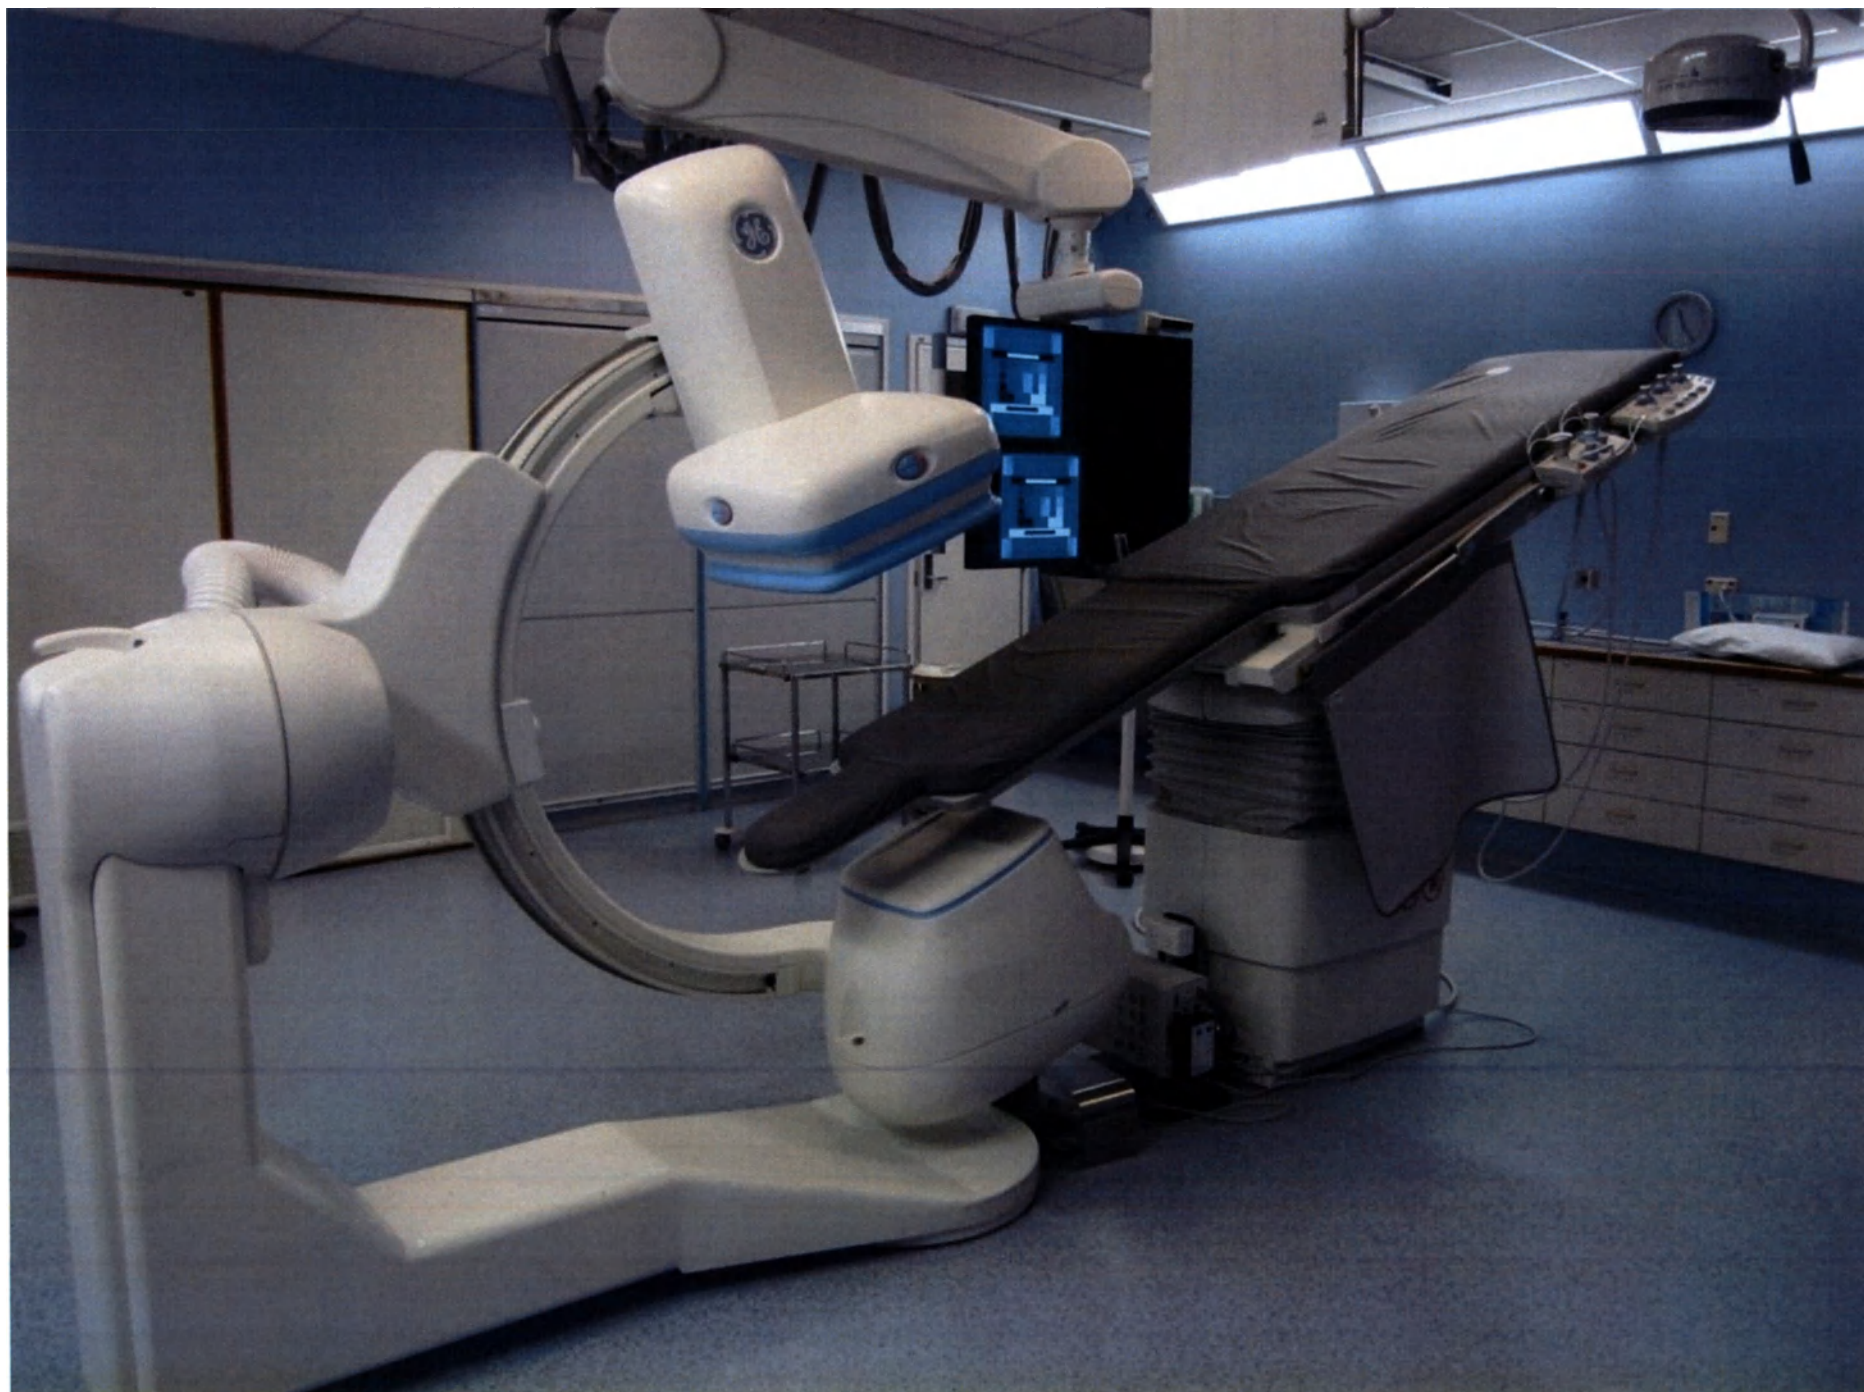

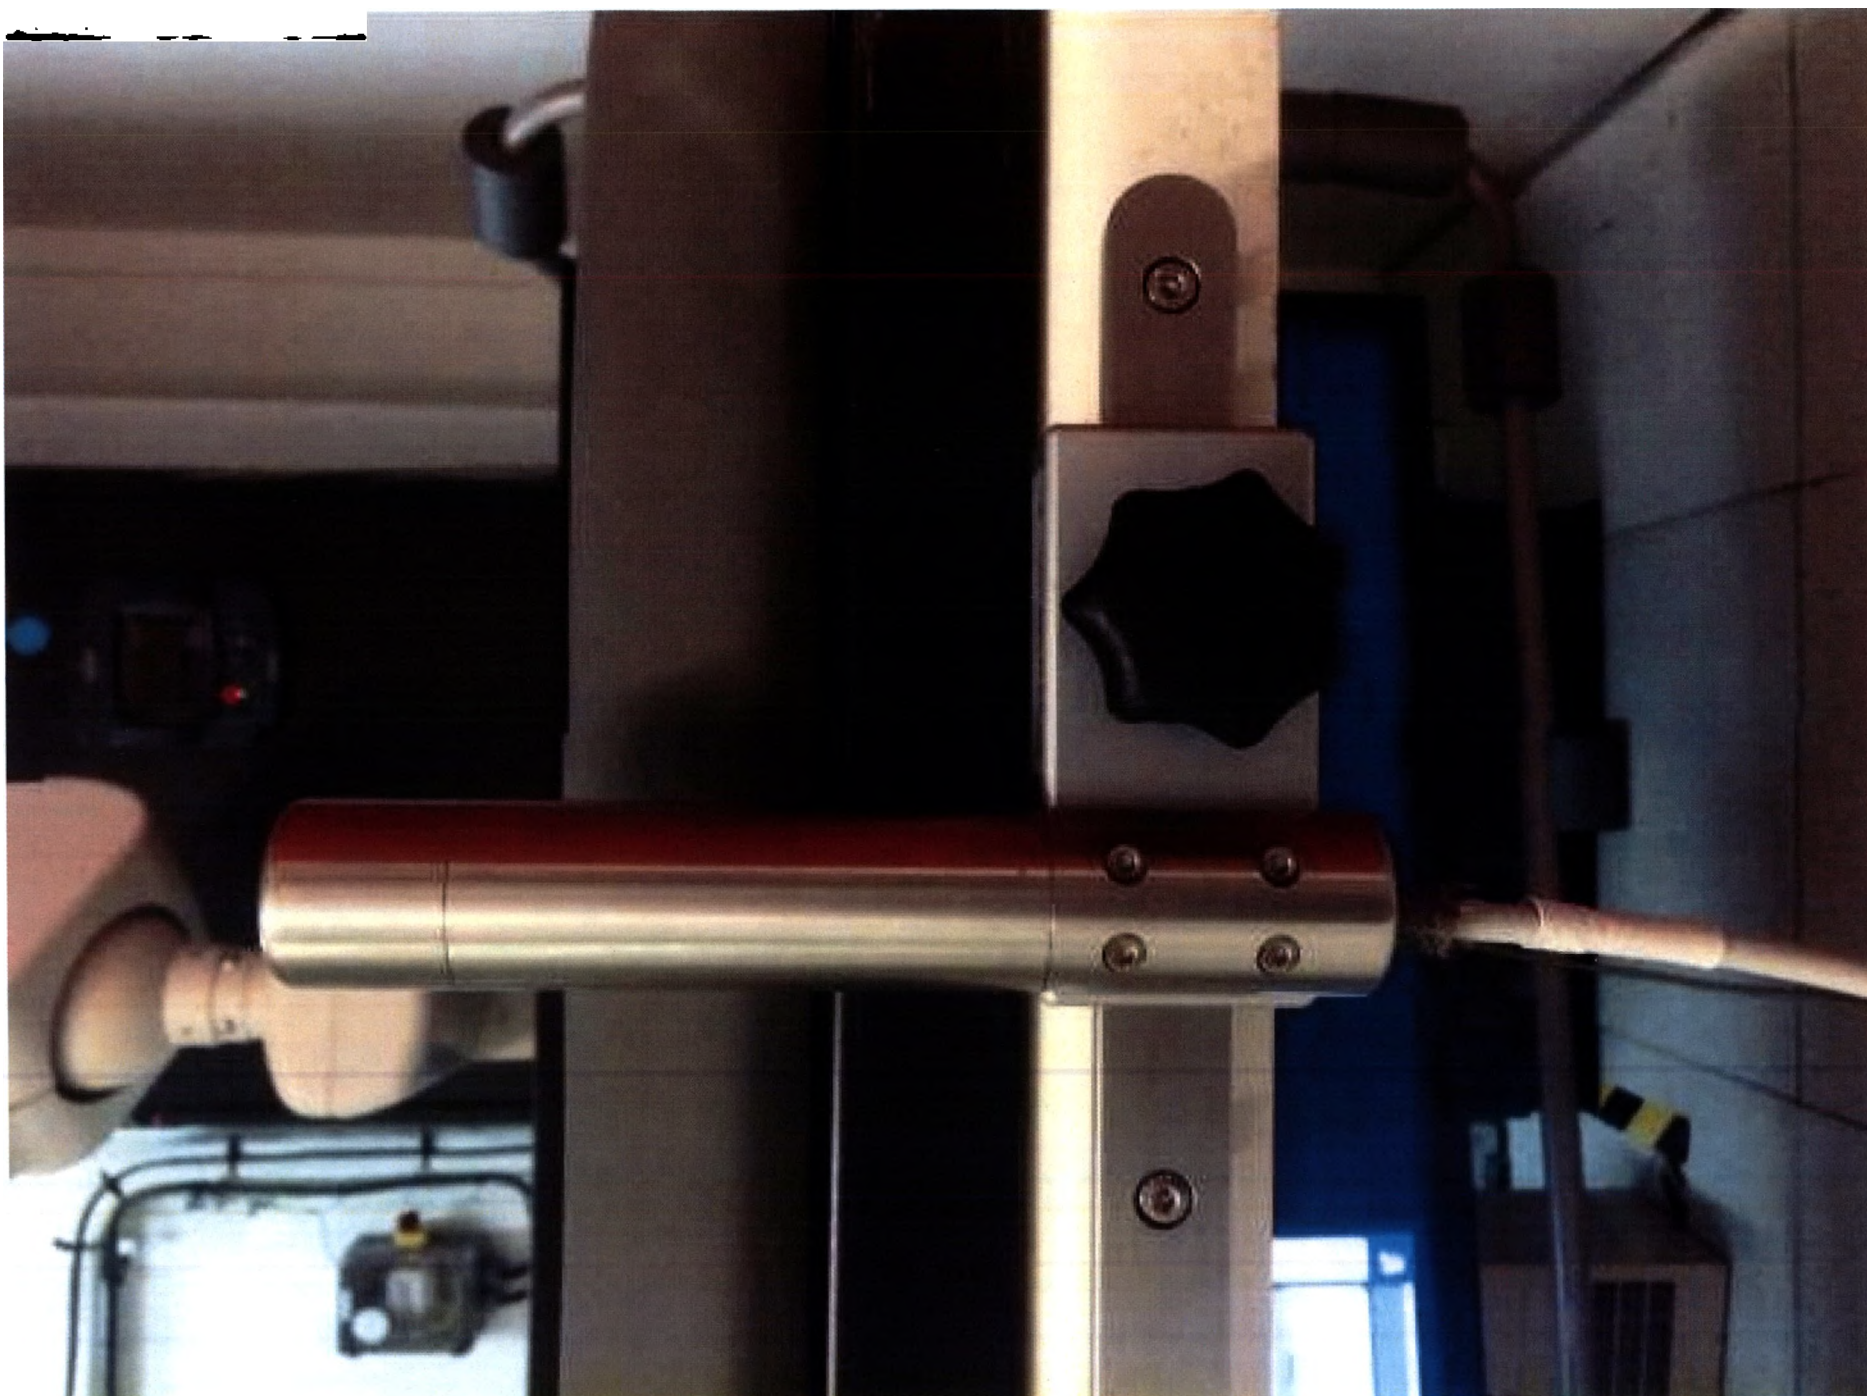













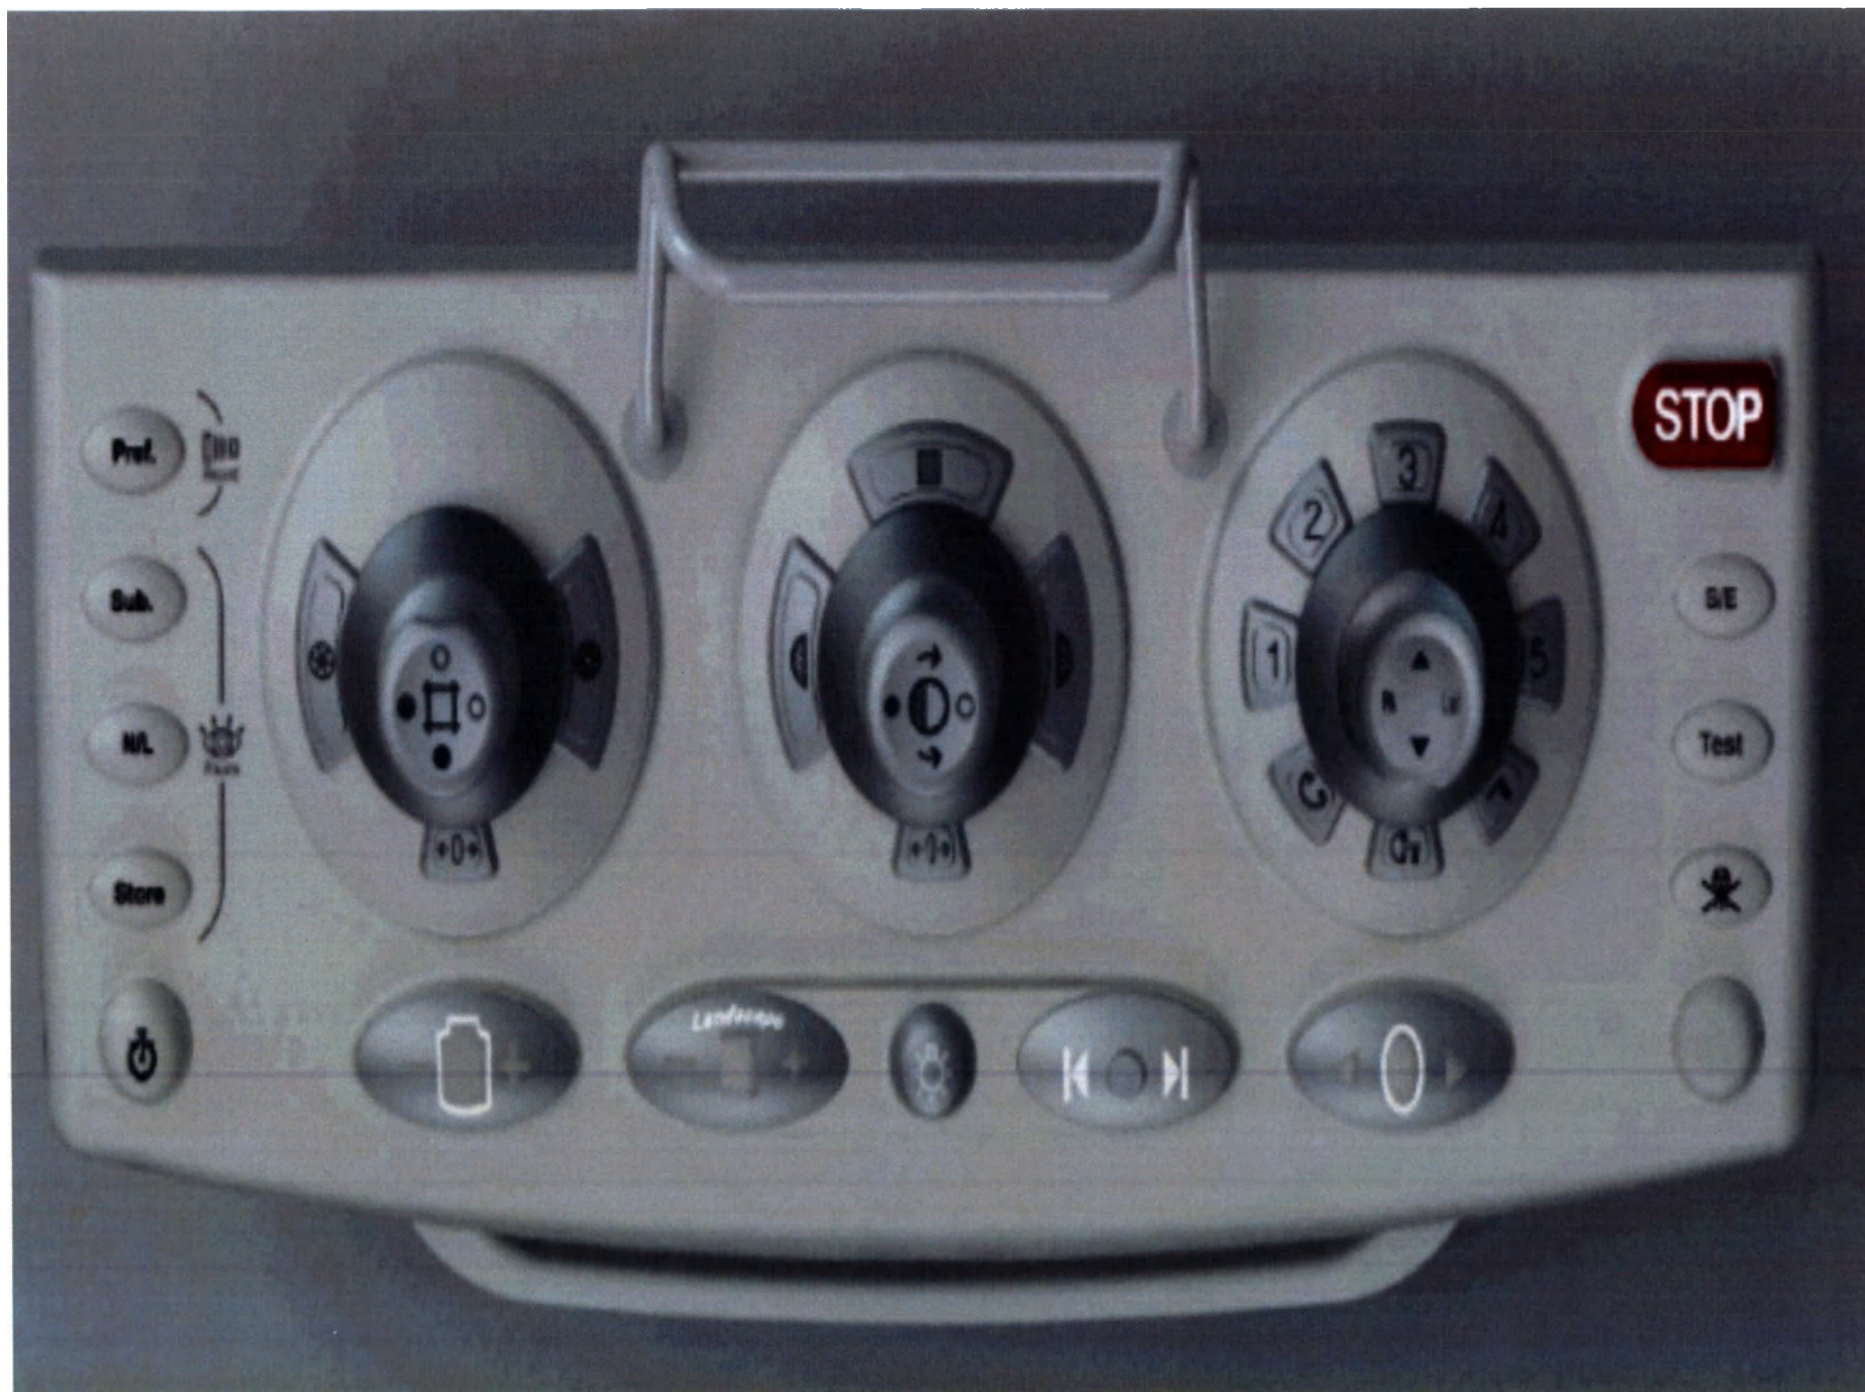










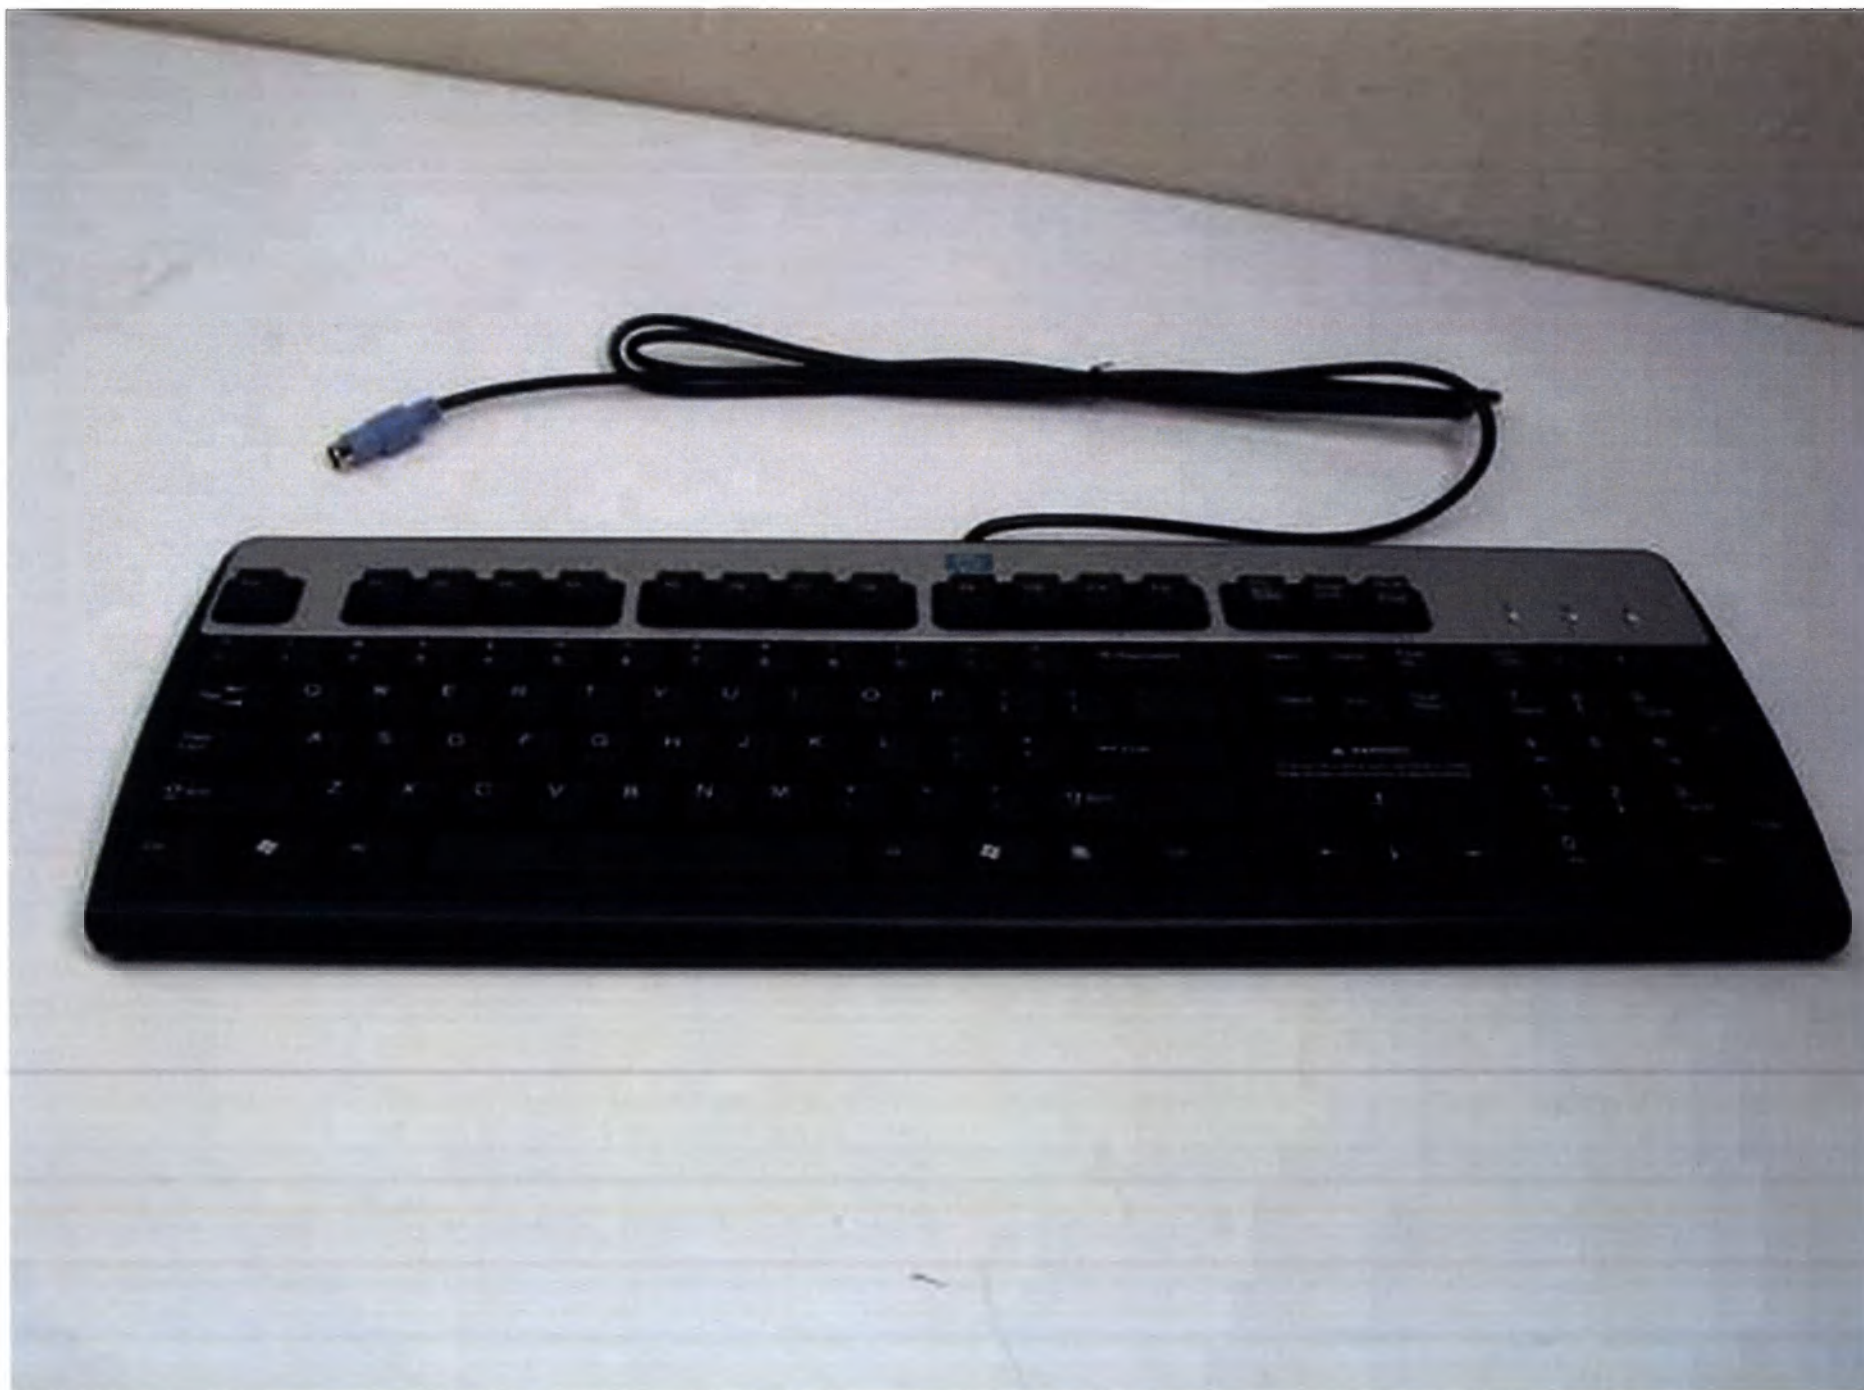

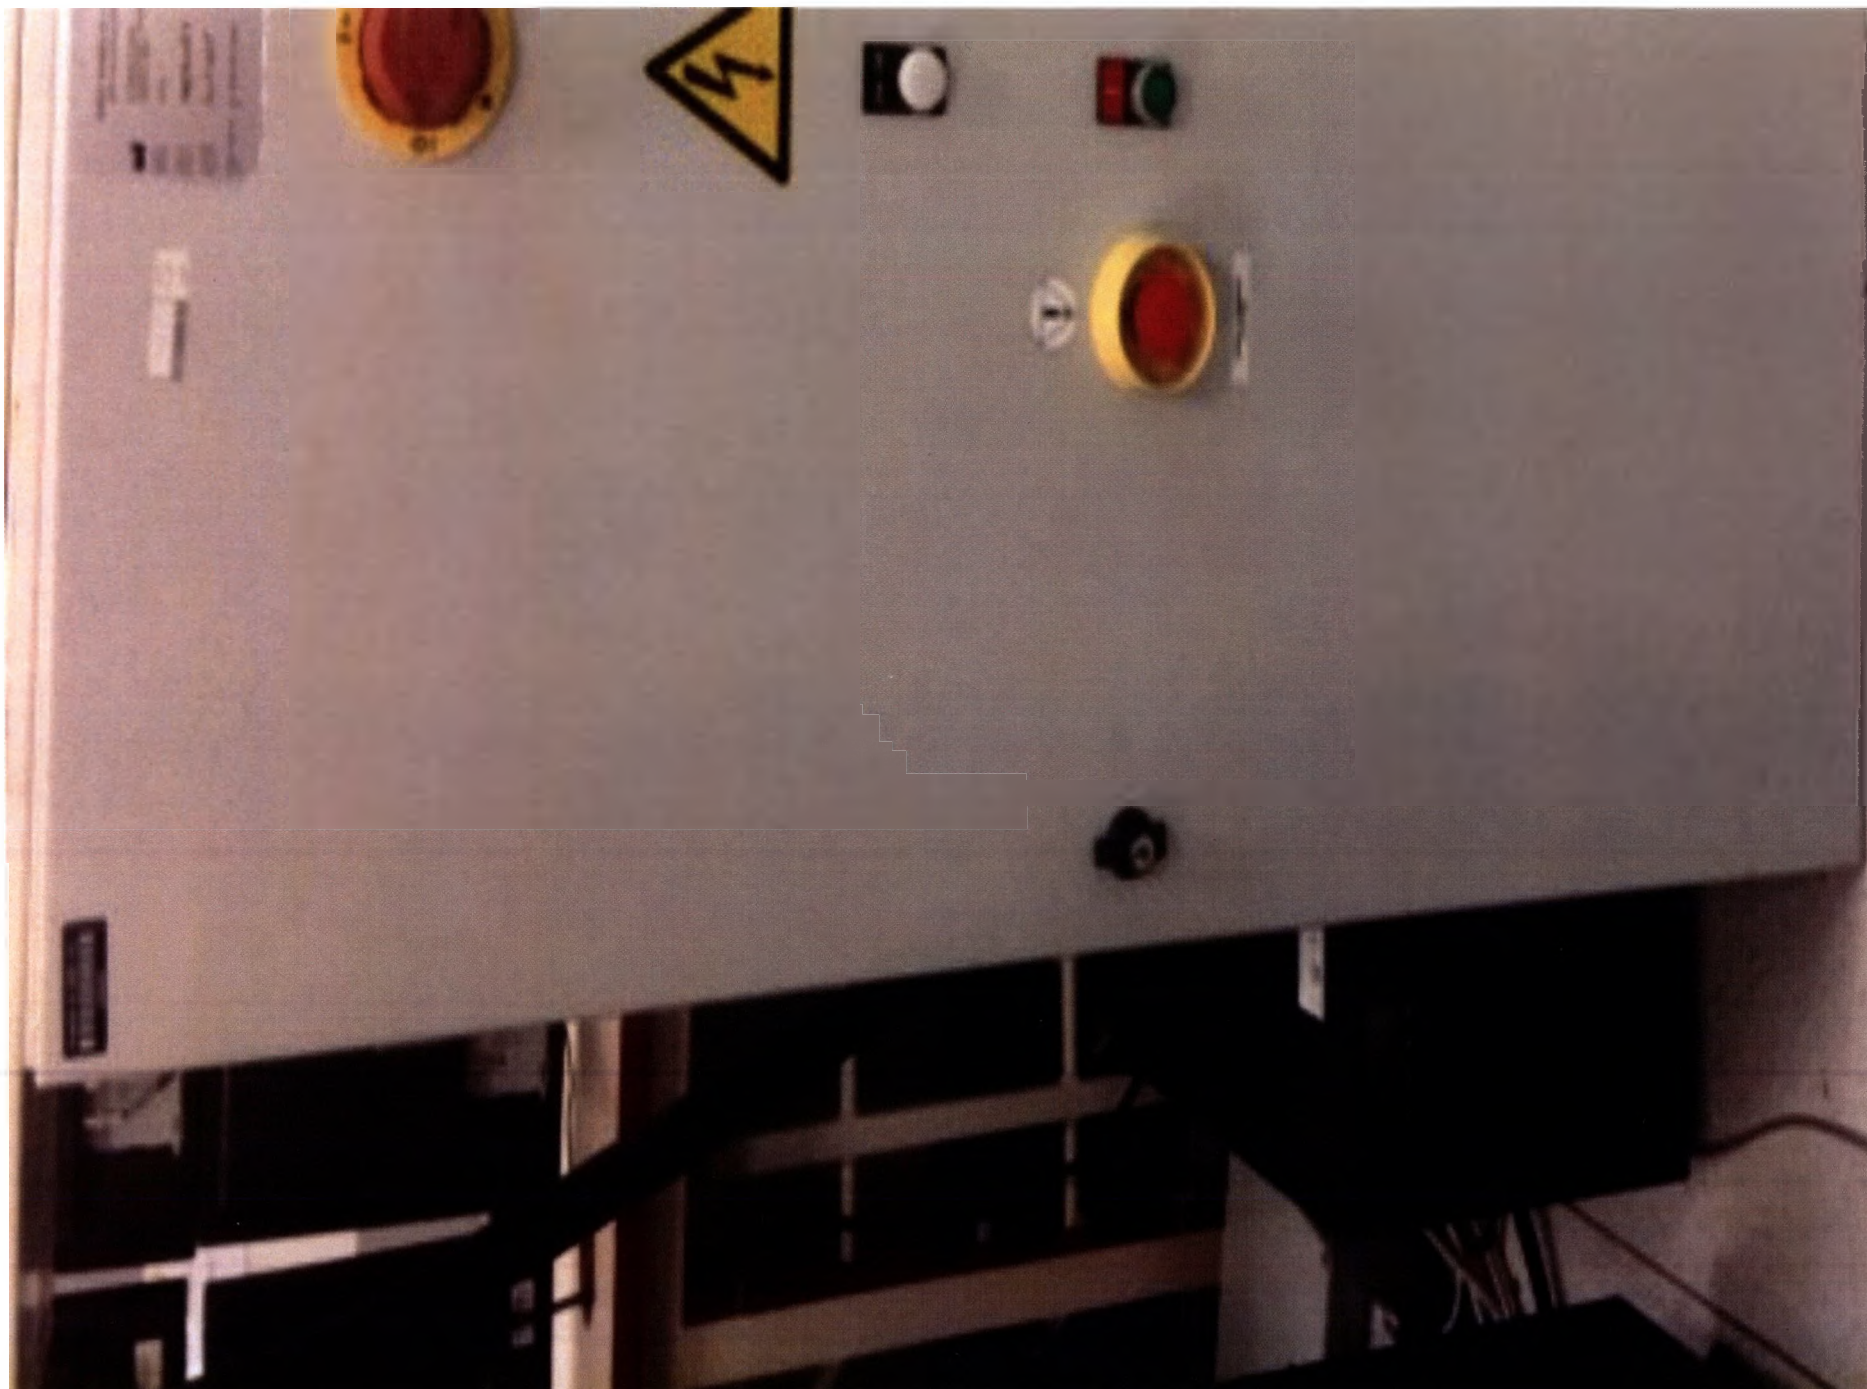

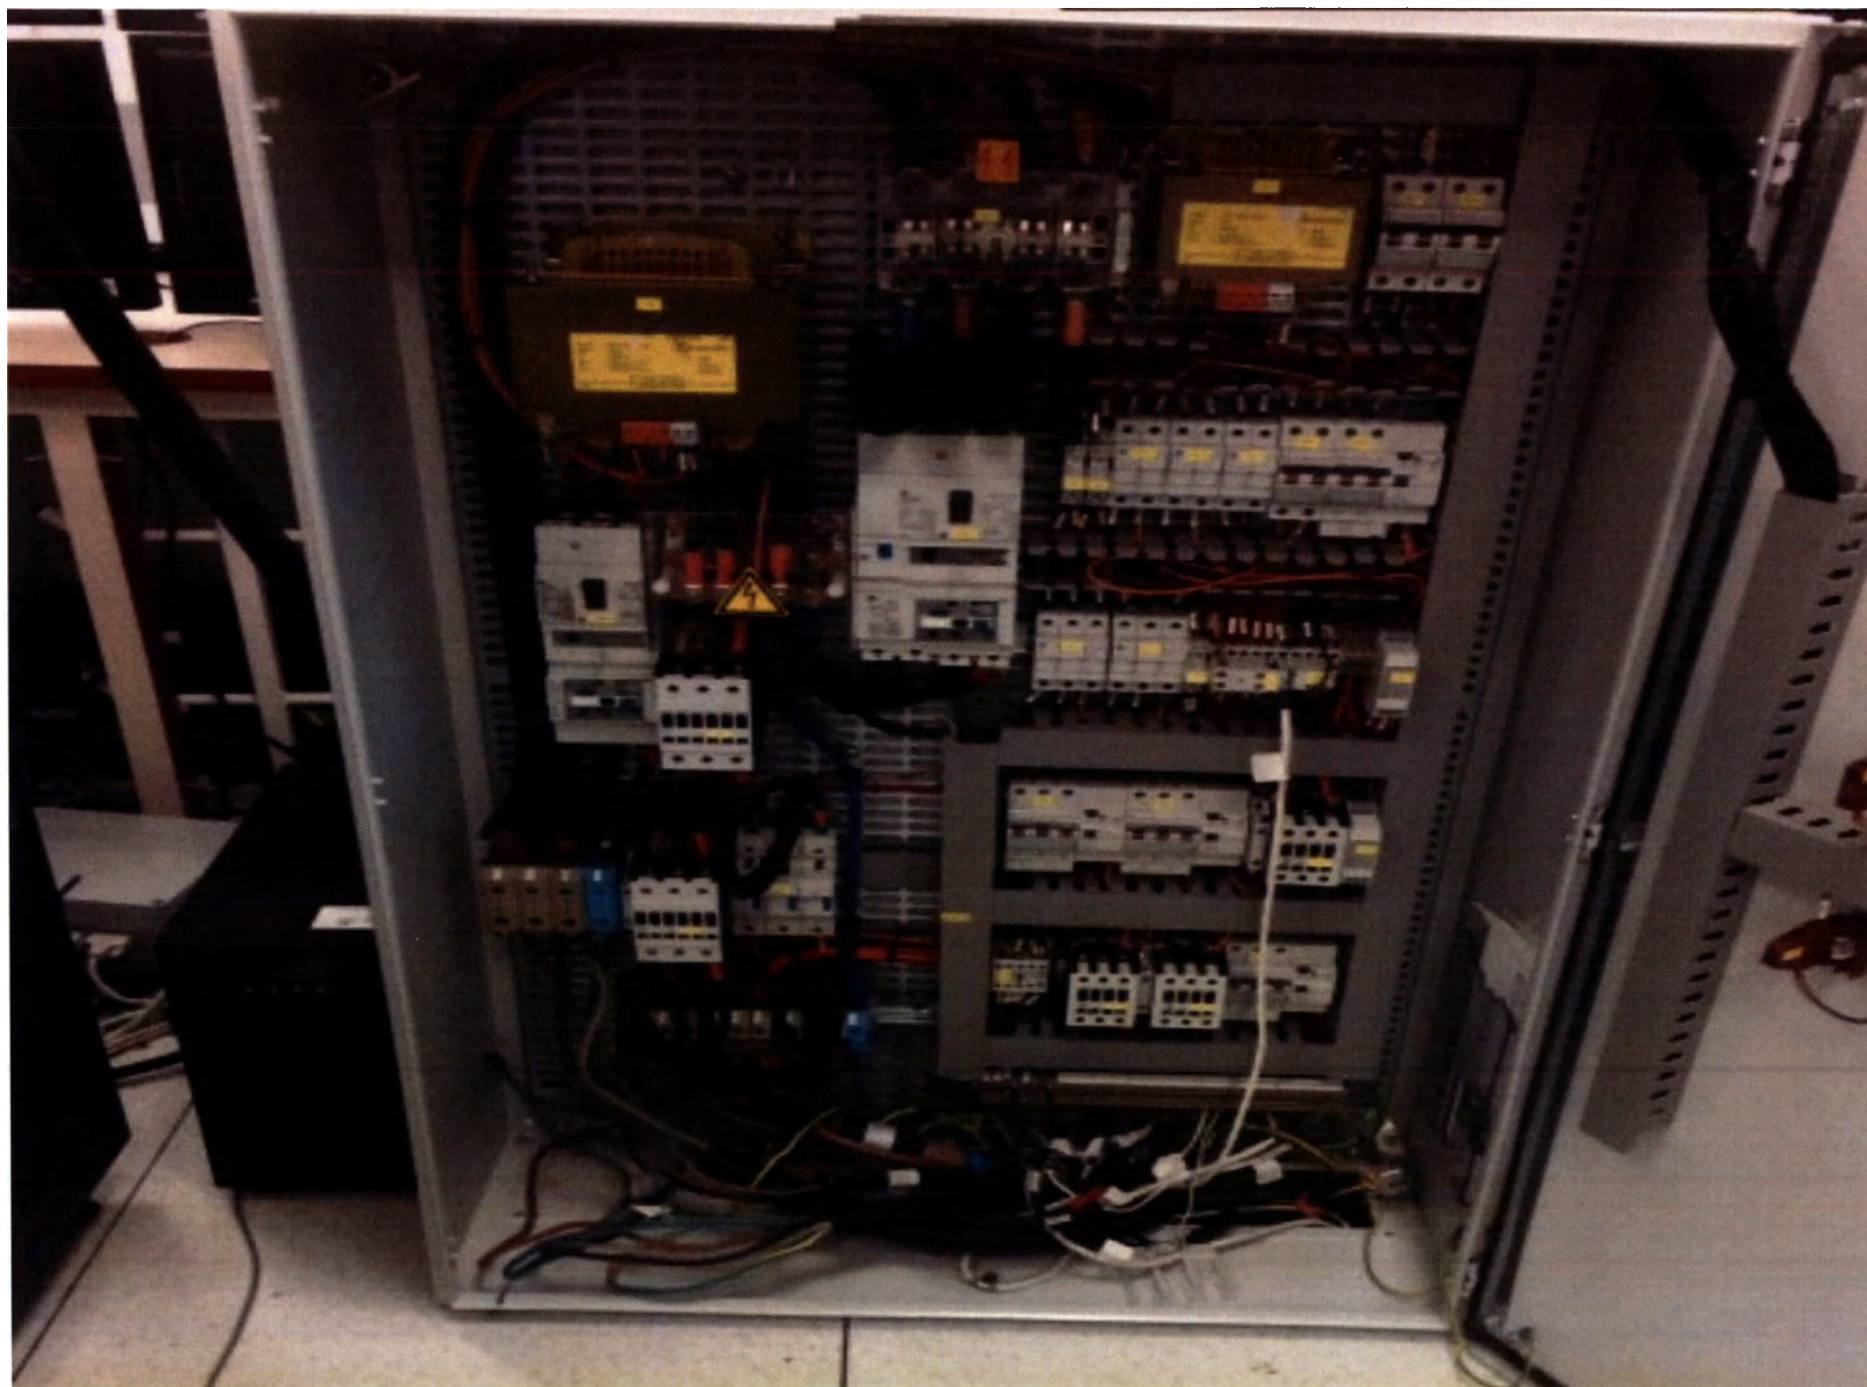



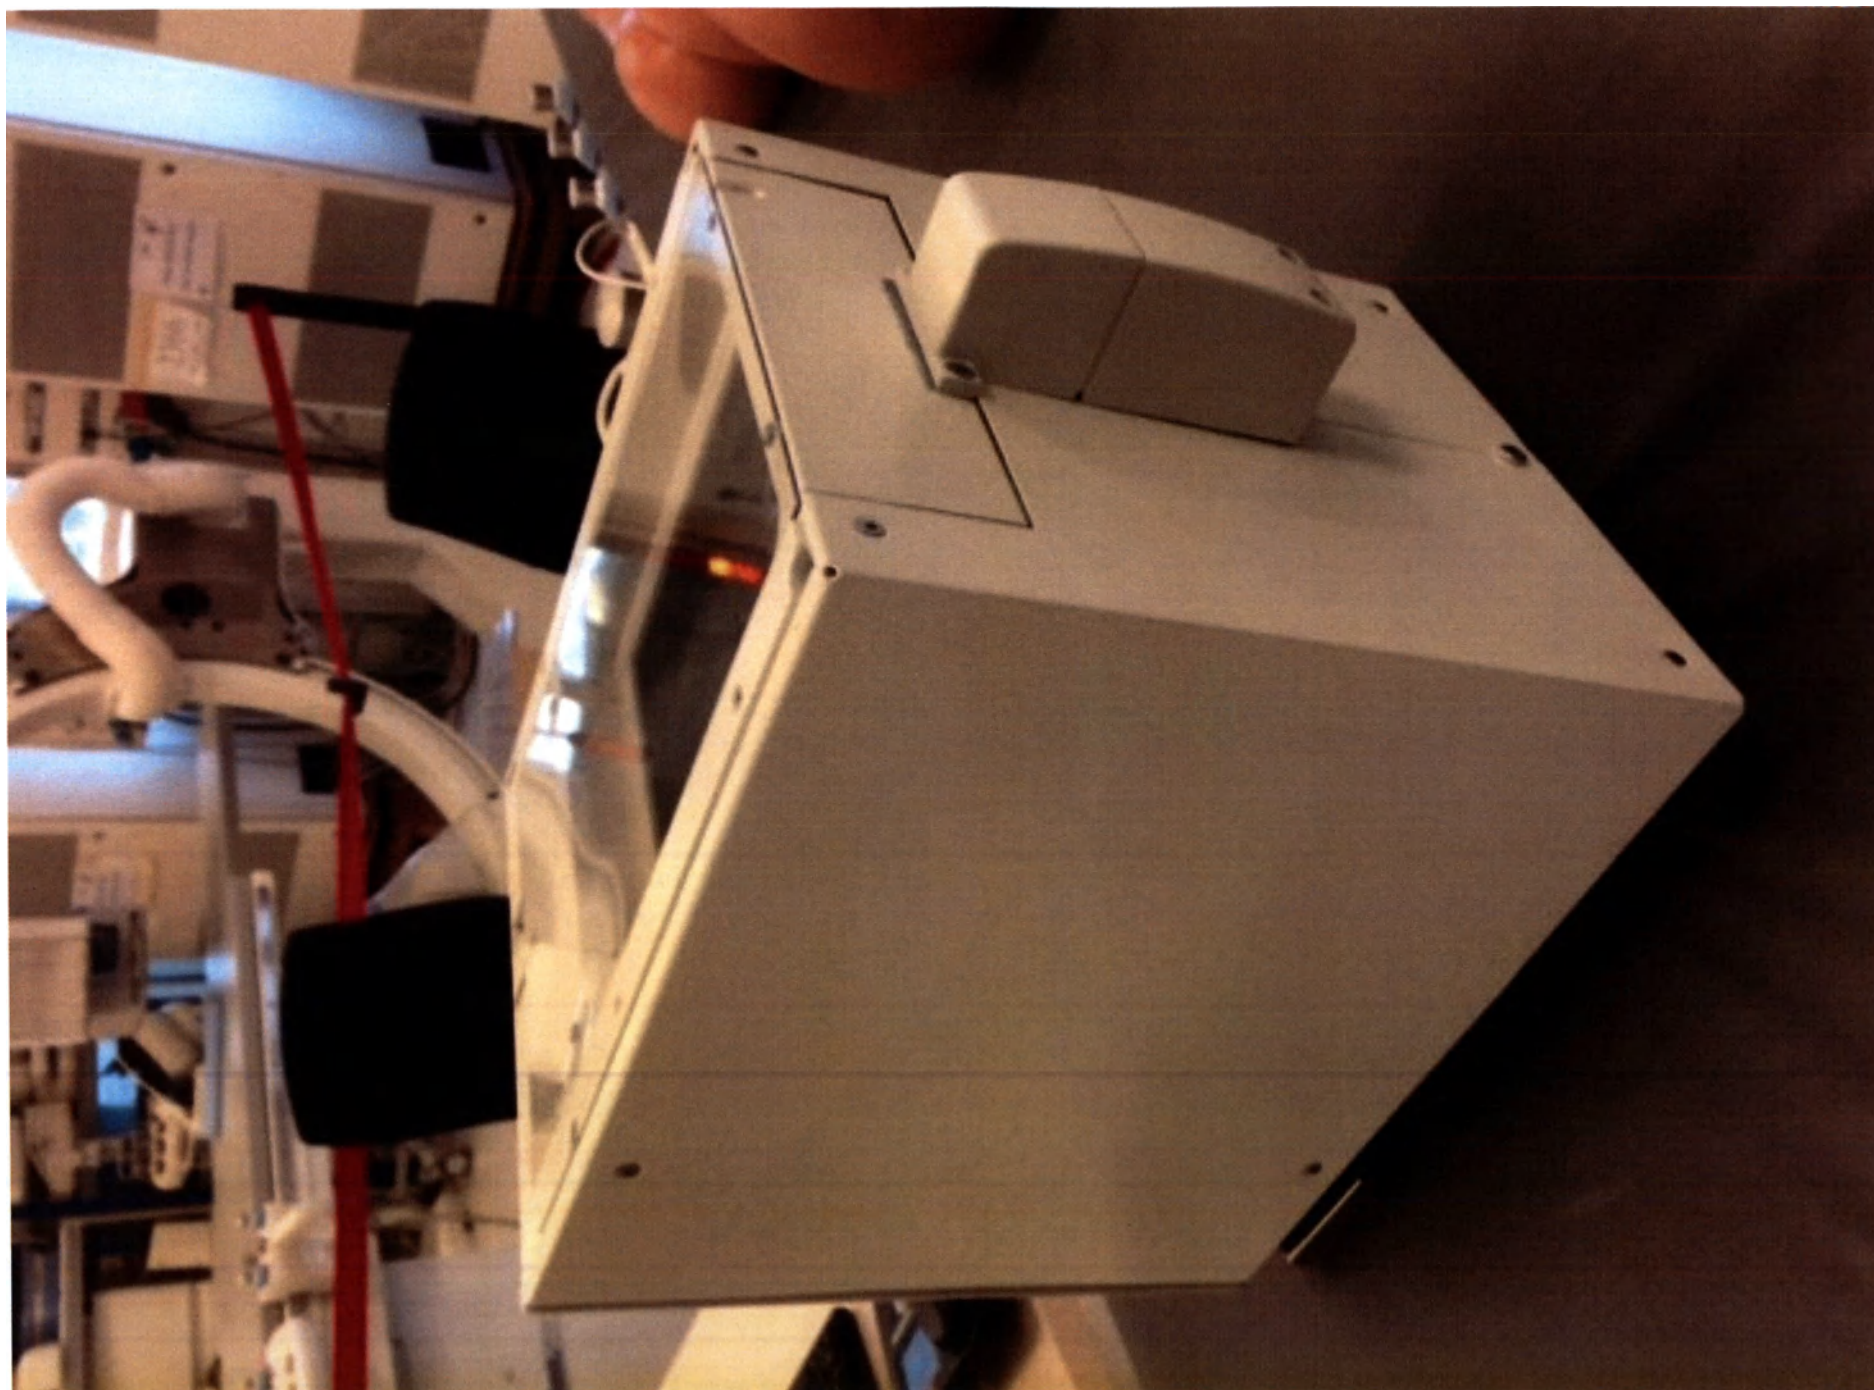









Discovery™ IGS 730, Discovery™ IGS 740 Pre-Installation Manual



OPERATING DOCUMENTATION

5507046-1-1EN
Revision 2

Direction 5534661-1-3EN rev 1

Operating Documentation

Discovery™ IGS 730, Discovery™ IGS 740 Interactive Service Information



© 2015 General Electric Company. All rights reserved

Discovery™ IGS 730, Discovery™ IGS 740

Руководство оператора




ОСТОРОЖНО! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОЙ СИСТЕМЫ

К ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОЙ СИСТЕМЫ ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО ЛИЦА, ПРОШЕДШИЕ НАДЛЕЖАЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ.


НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ПАЦИЕНТА, ОПЕРАТОРА ИЛИ ДРУГИХ ЛИЦ.




5490200-1-1RU
Revision 2

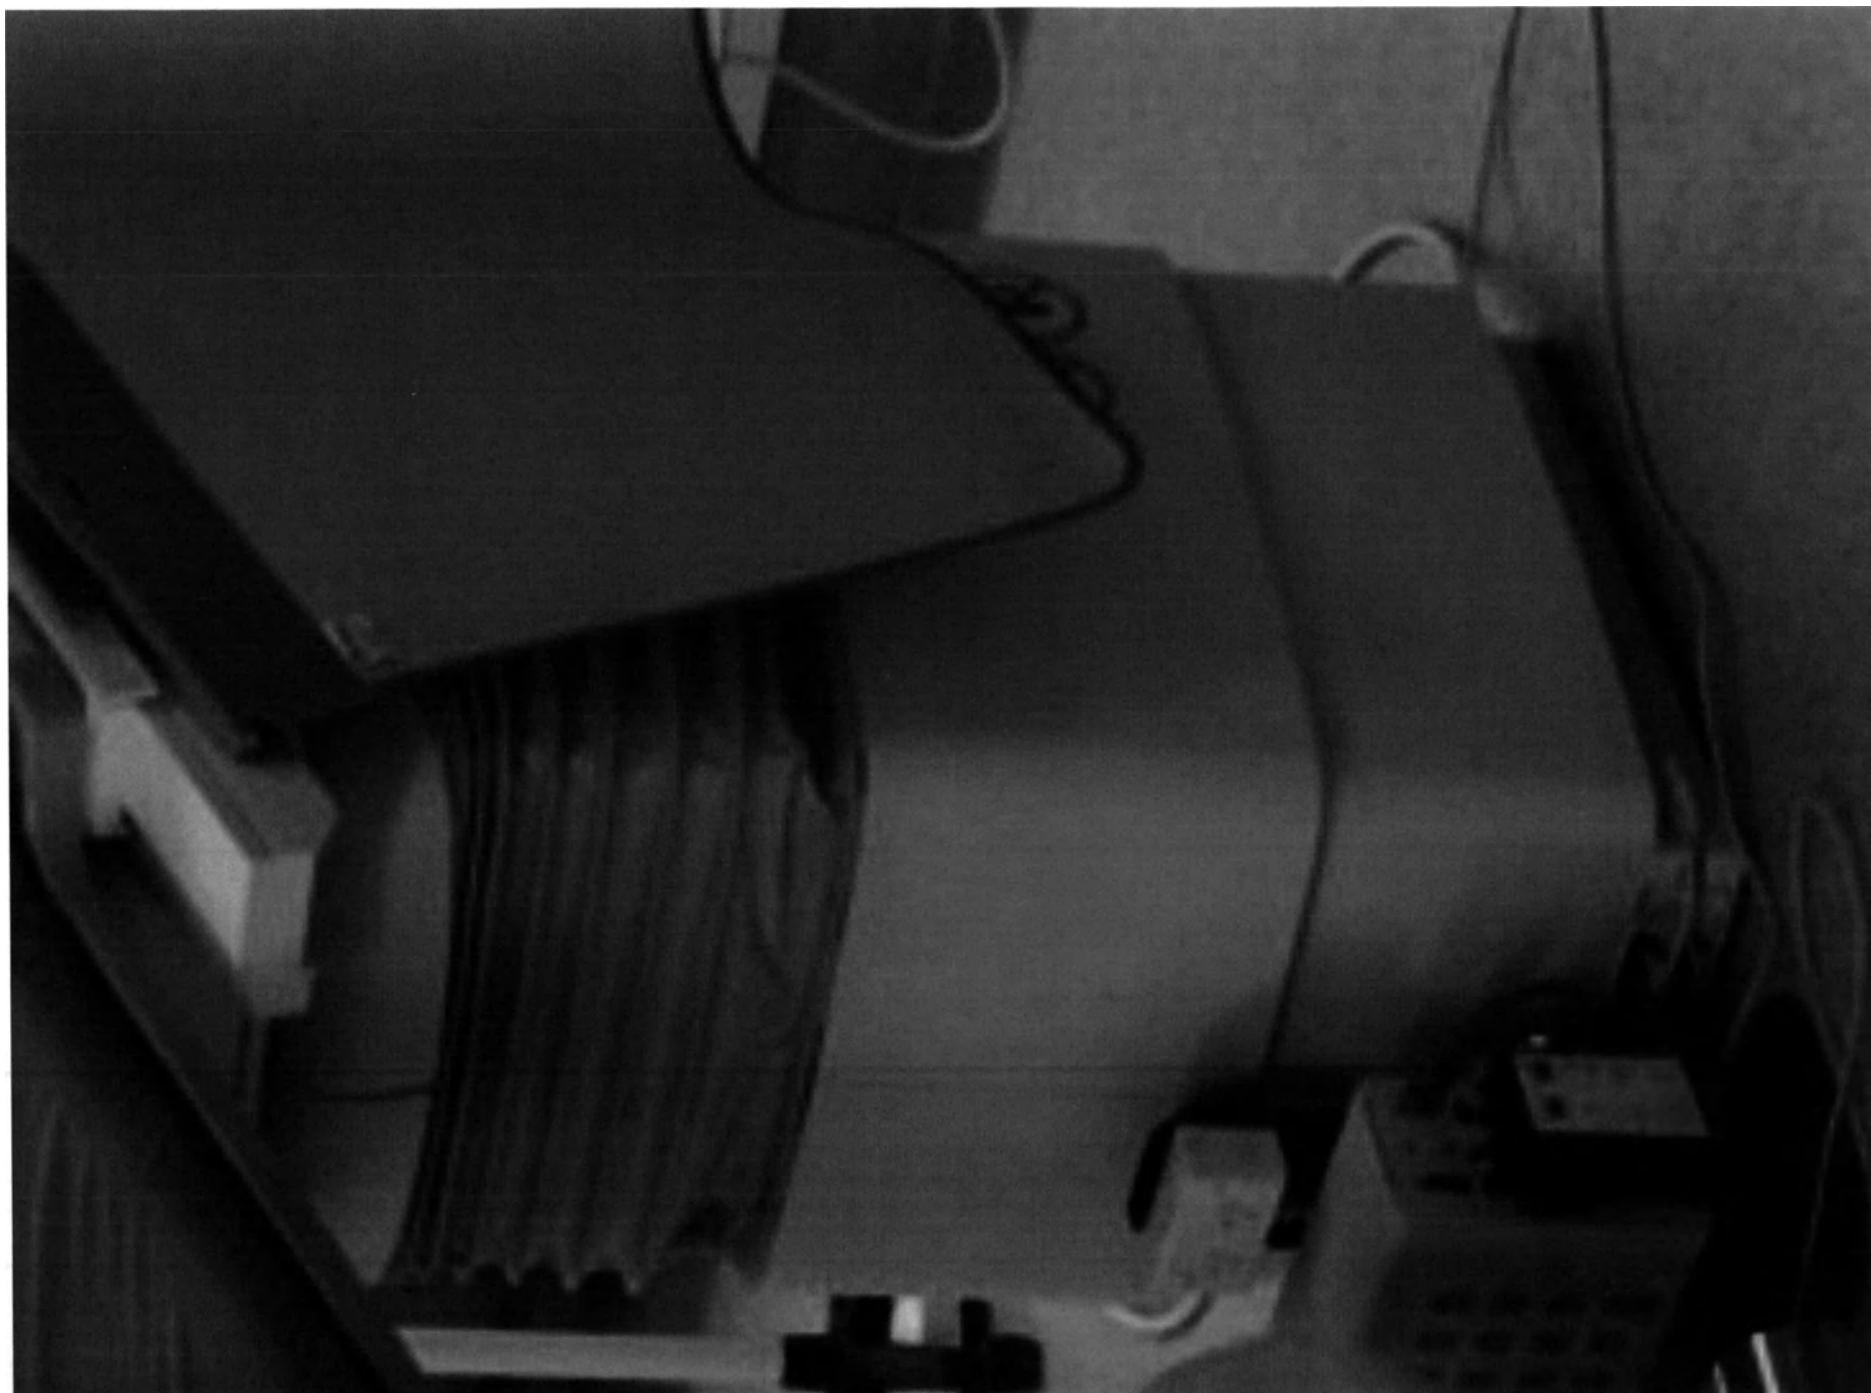



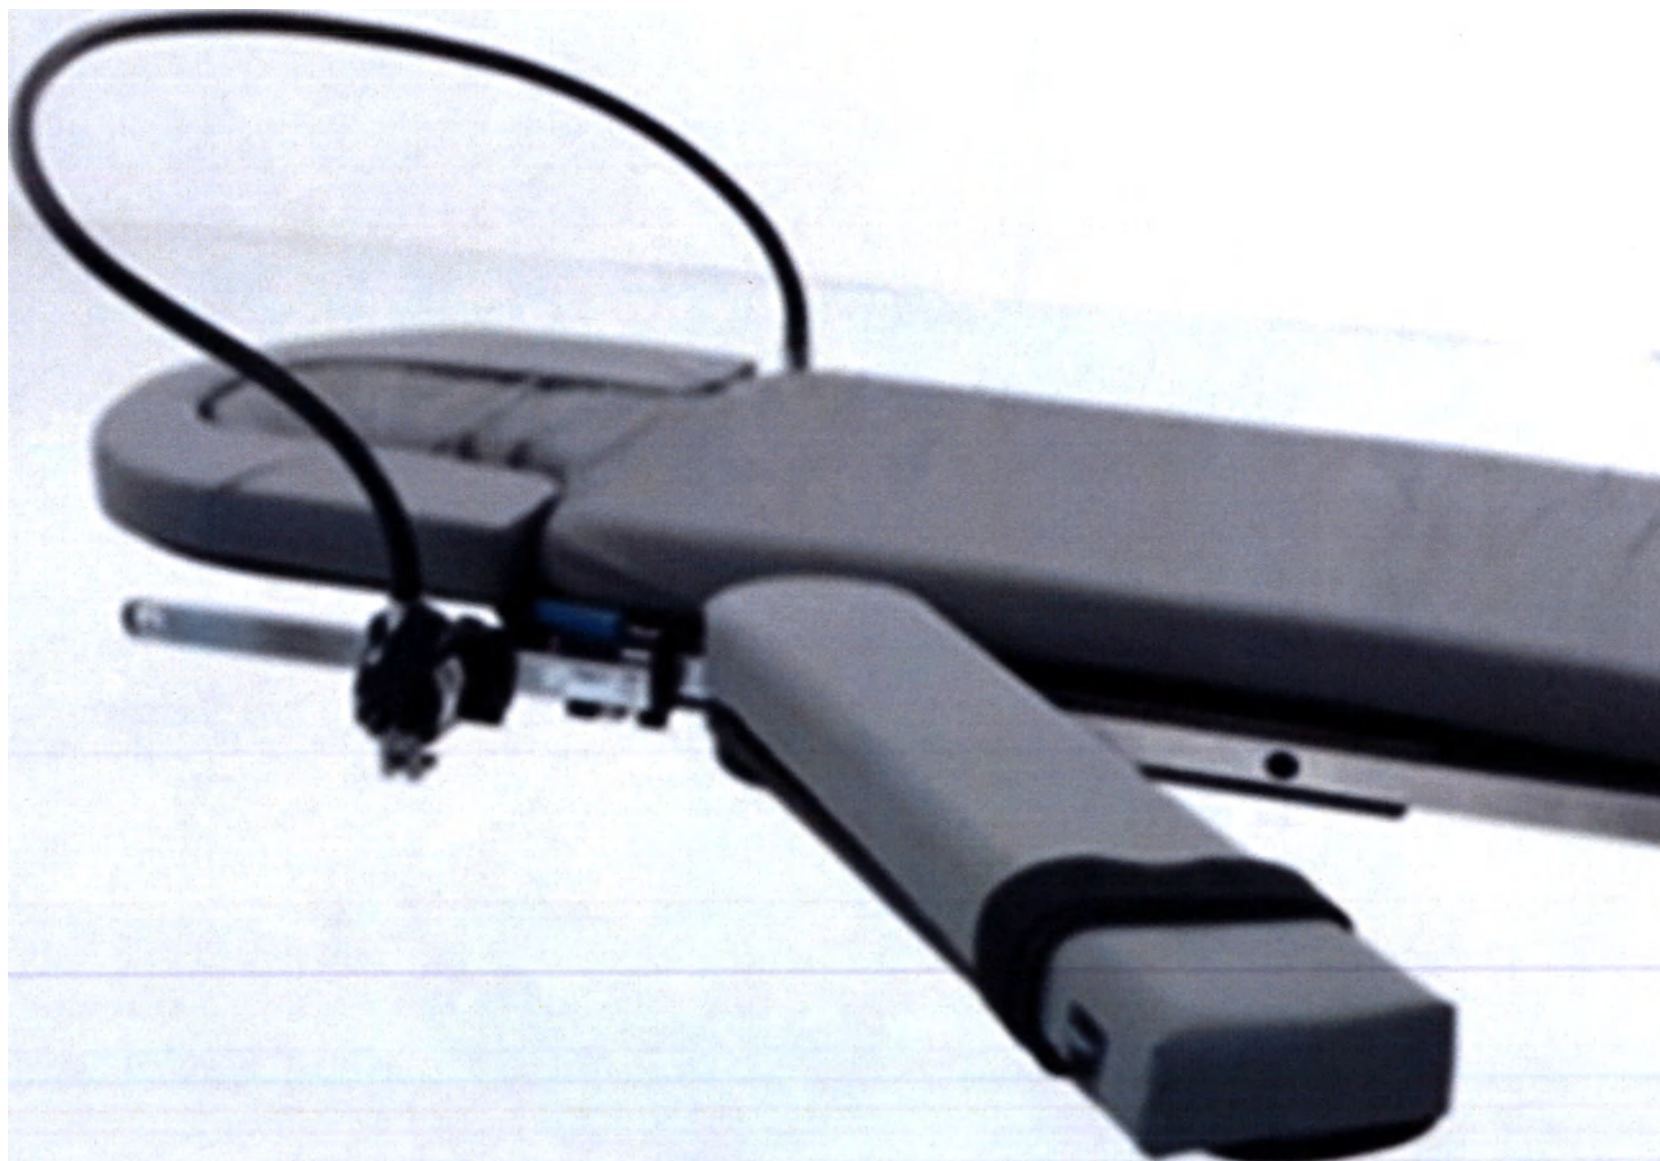



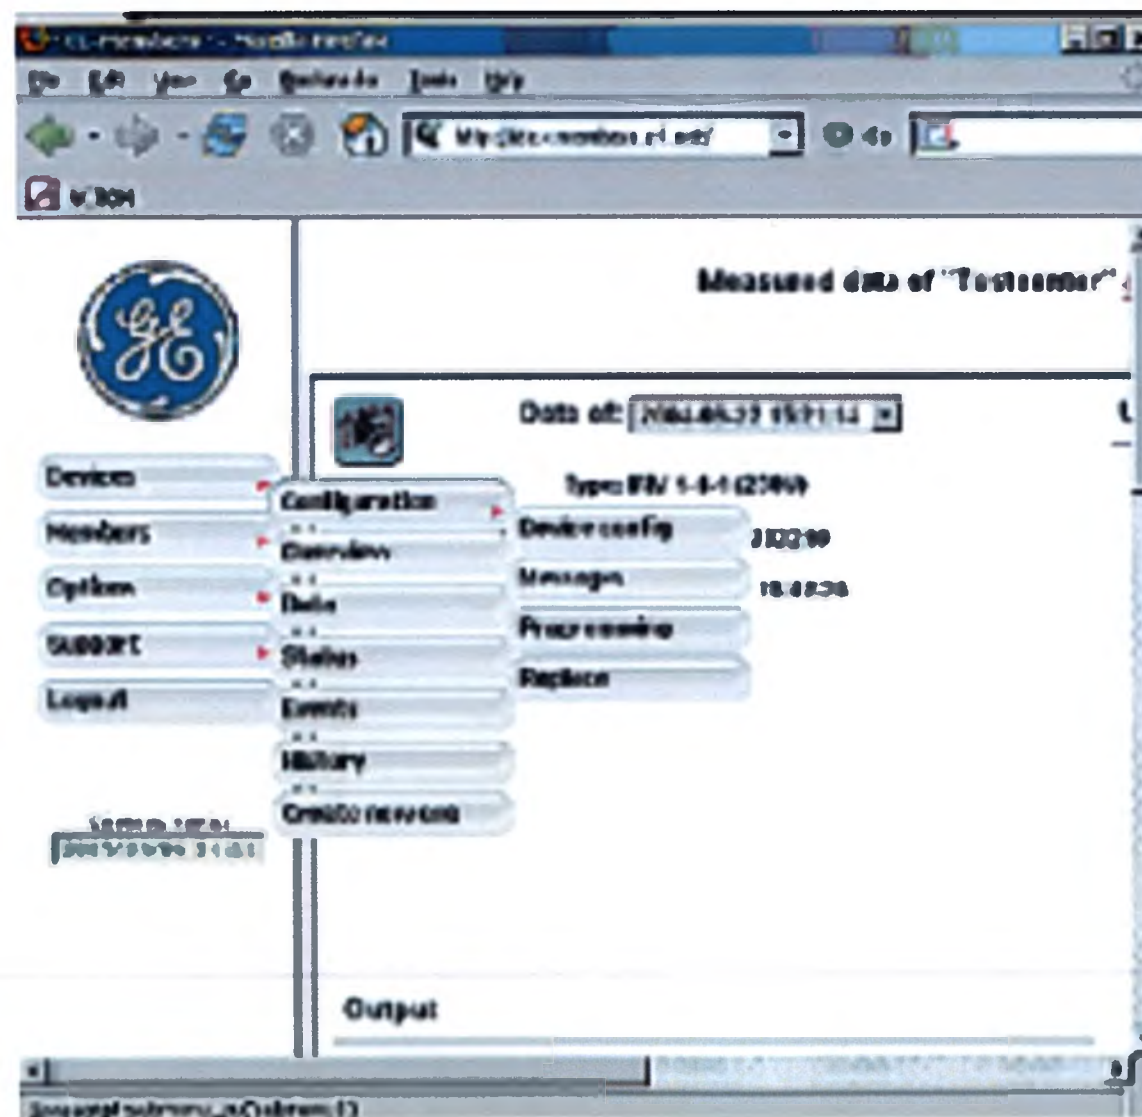












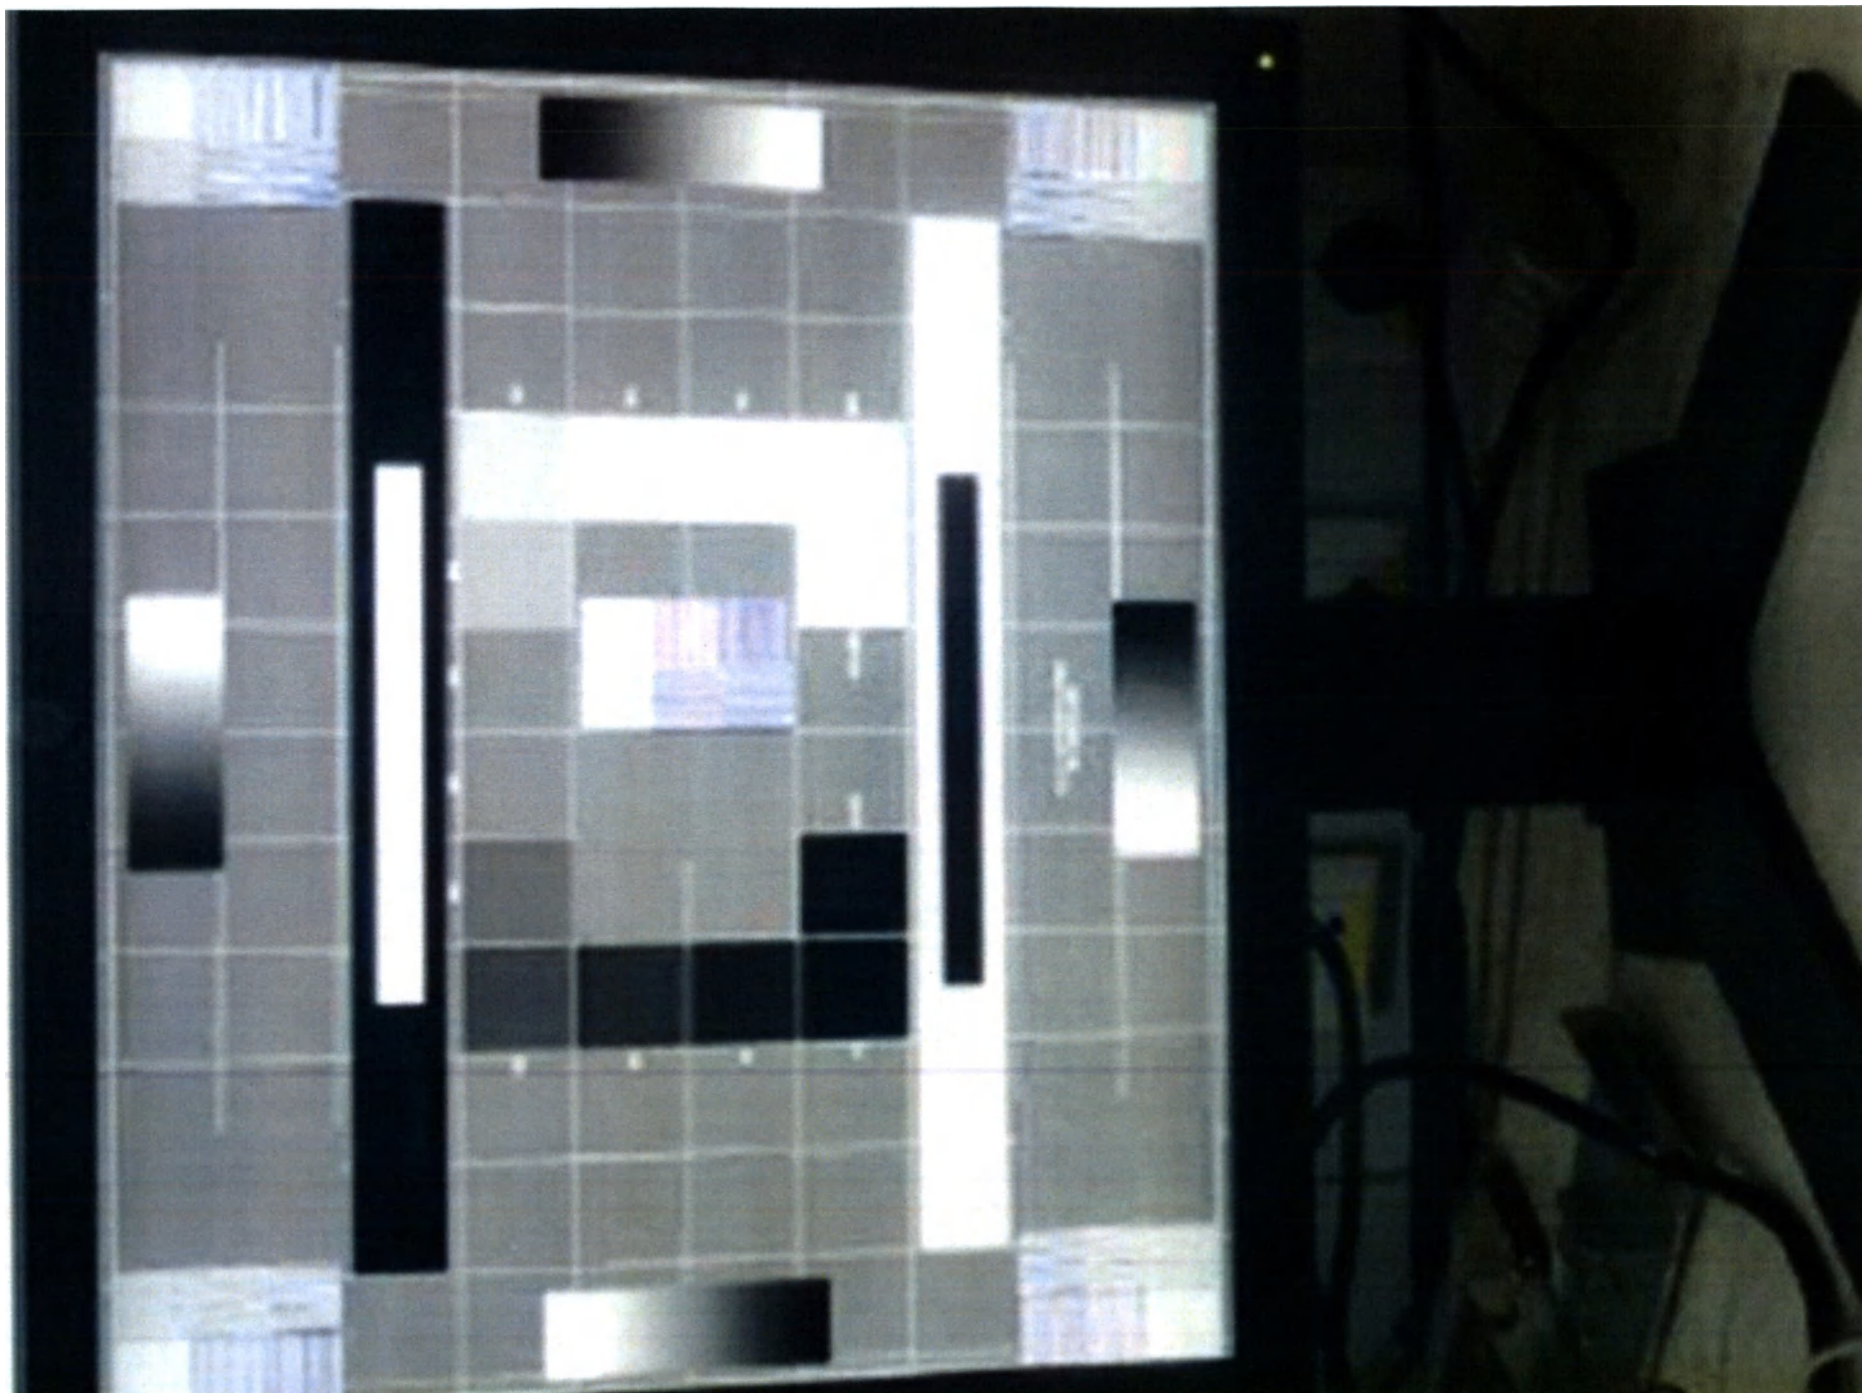


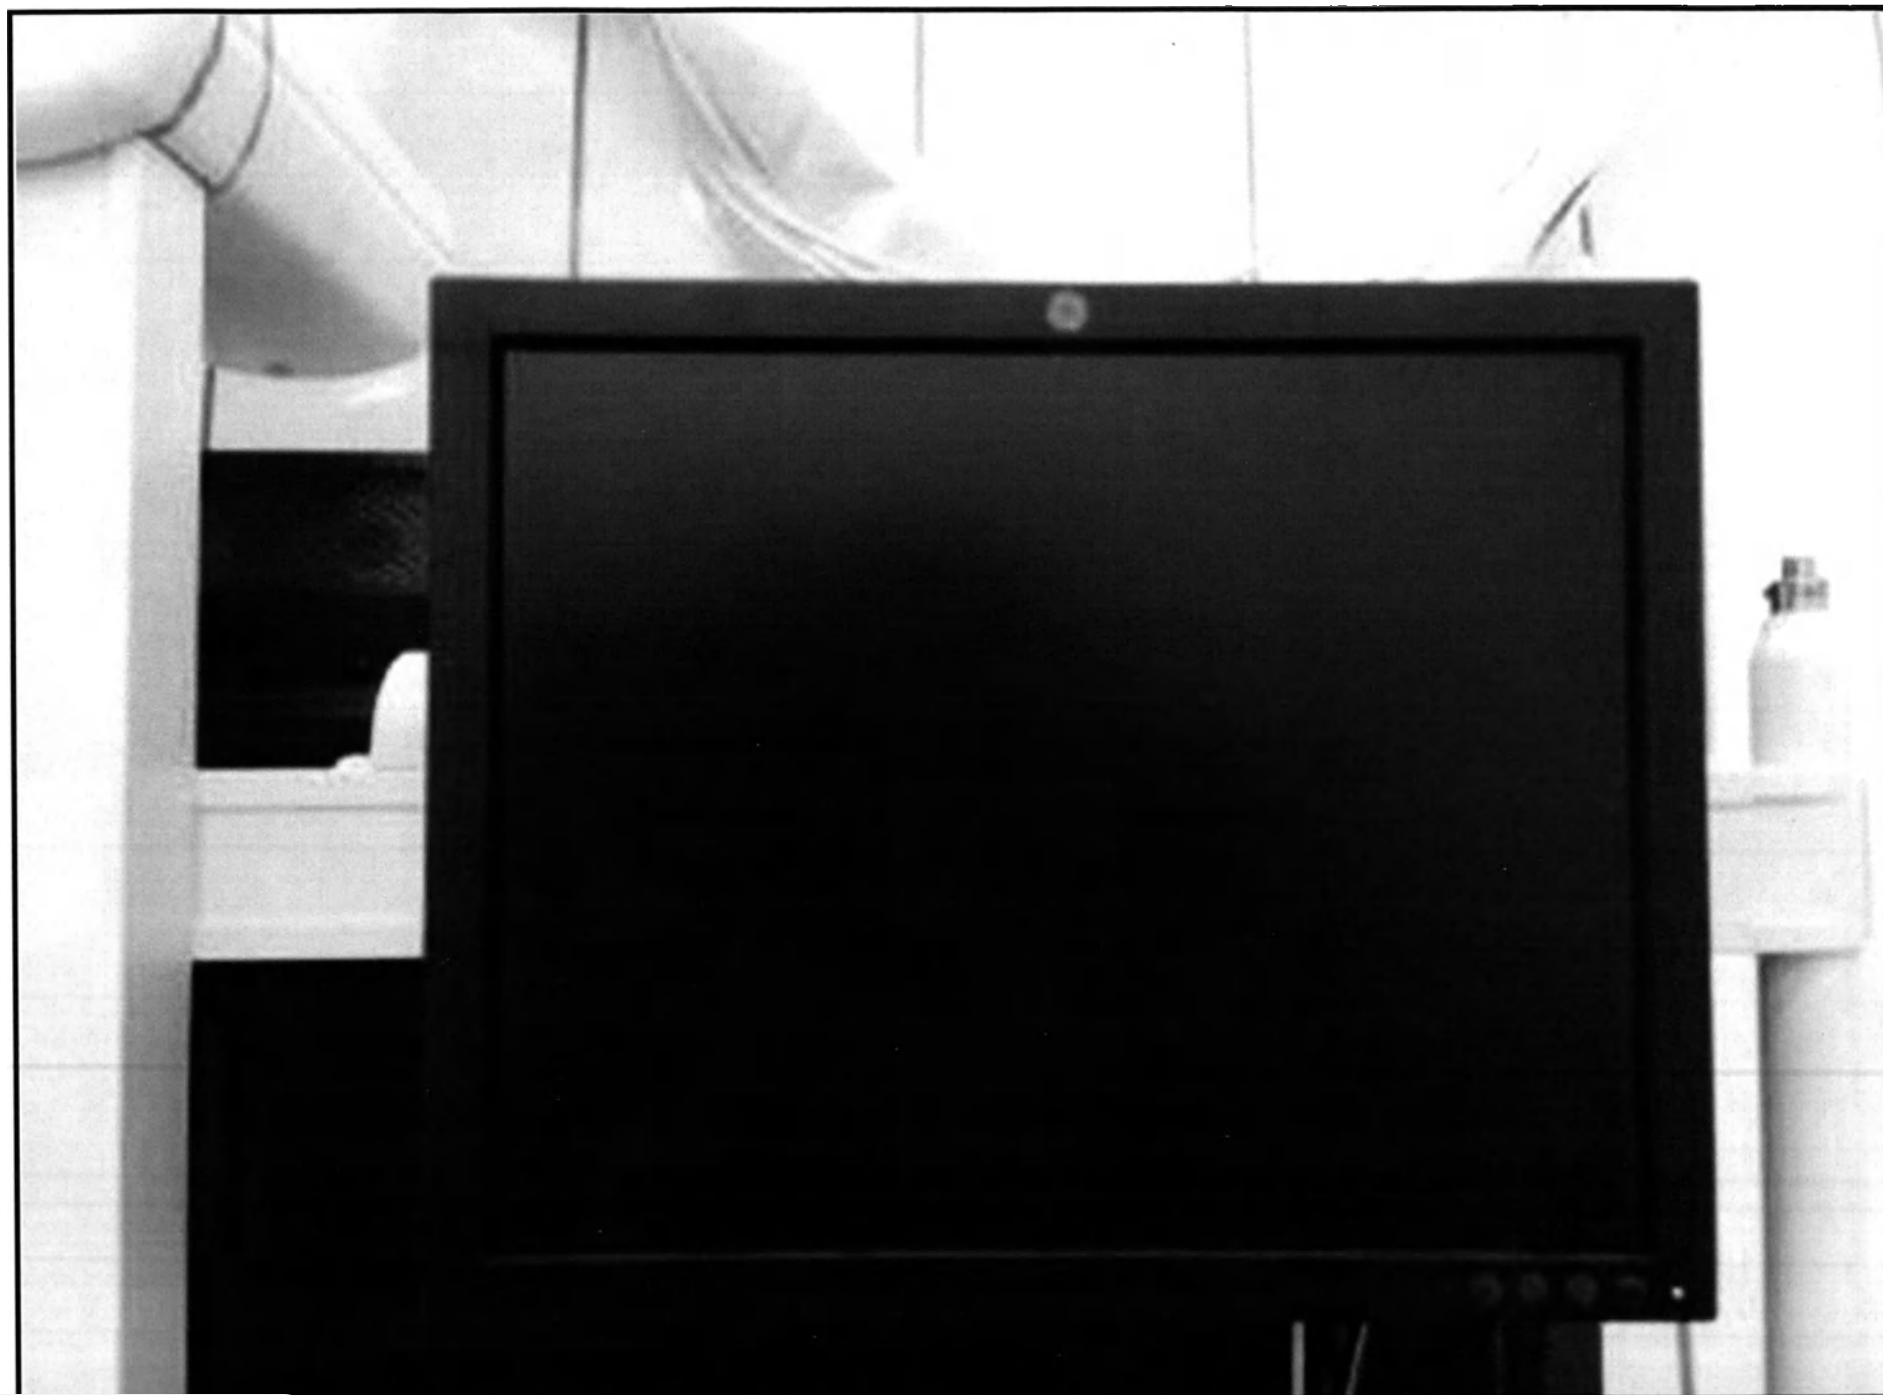





36. Медицинский монитор для вывода субтрагированного и несубтрагированного референсного изображения (не более 2 шт.). 47

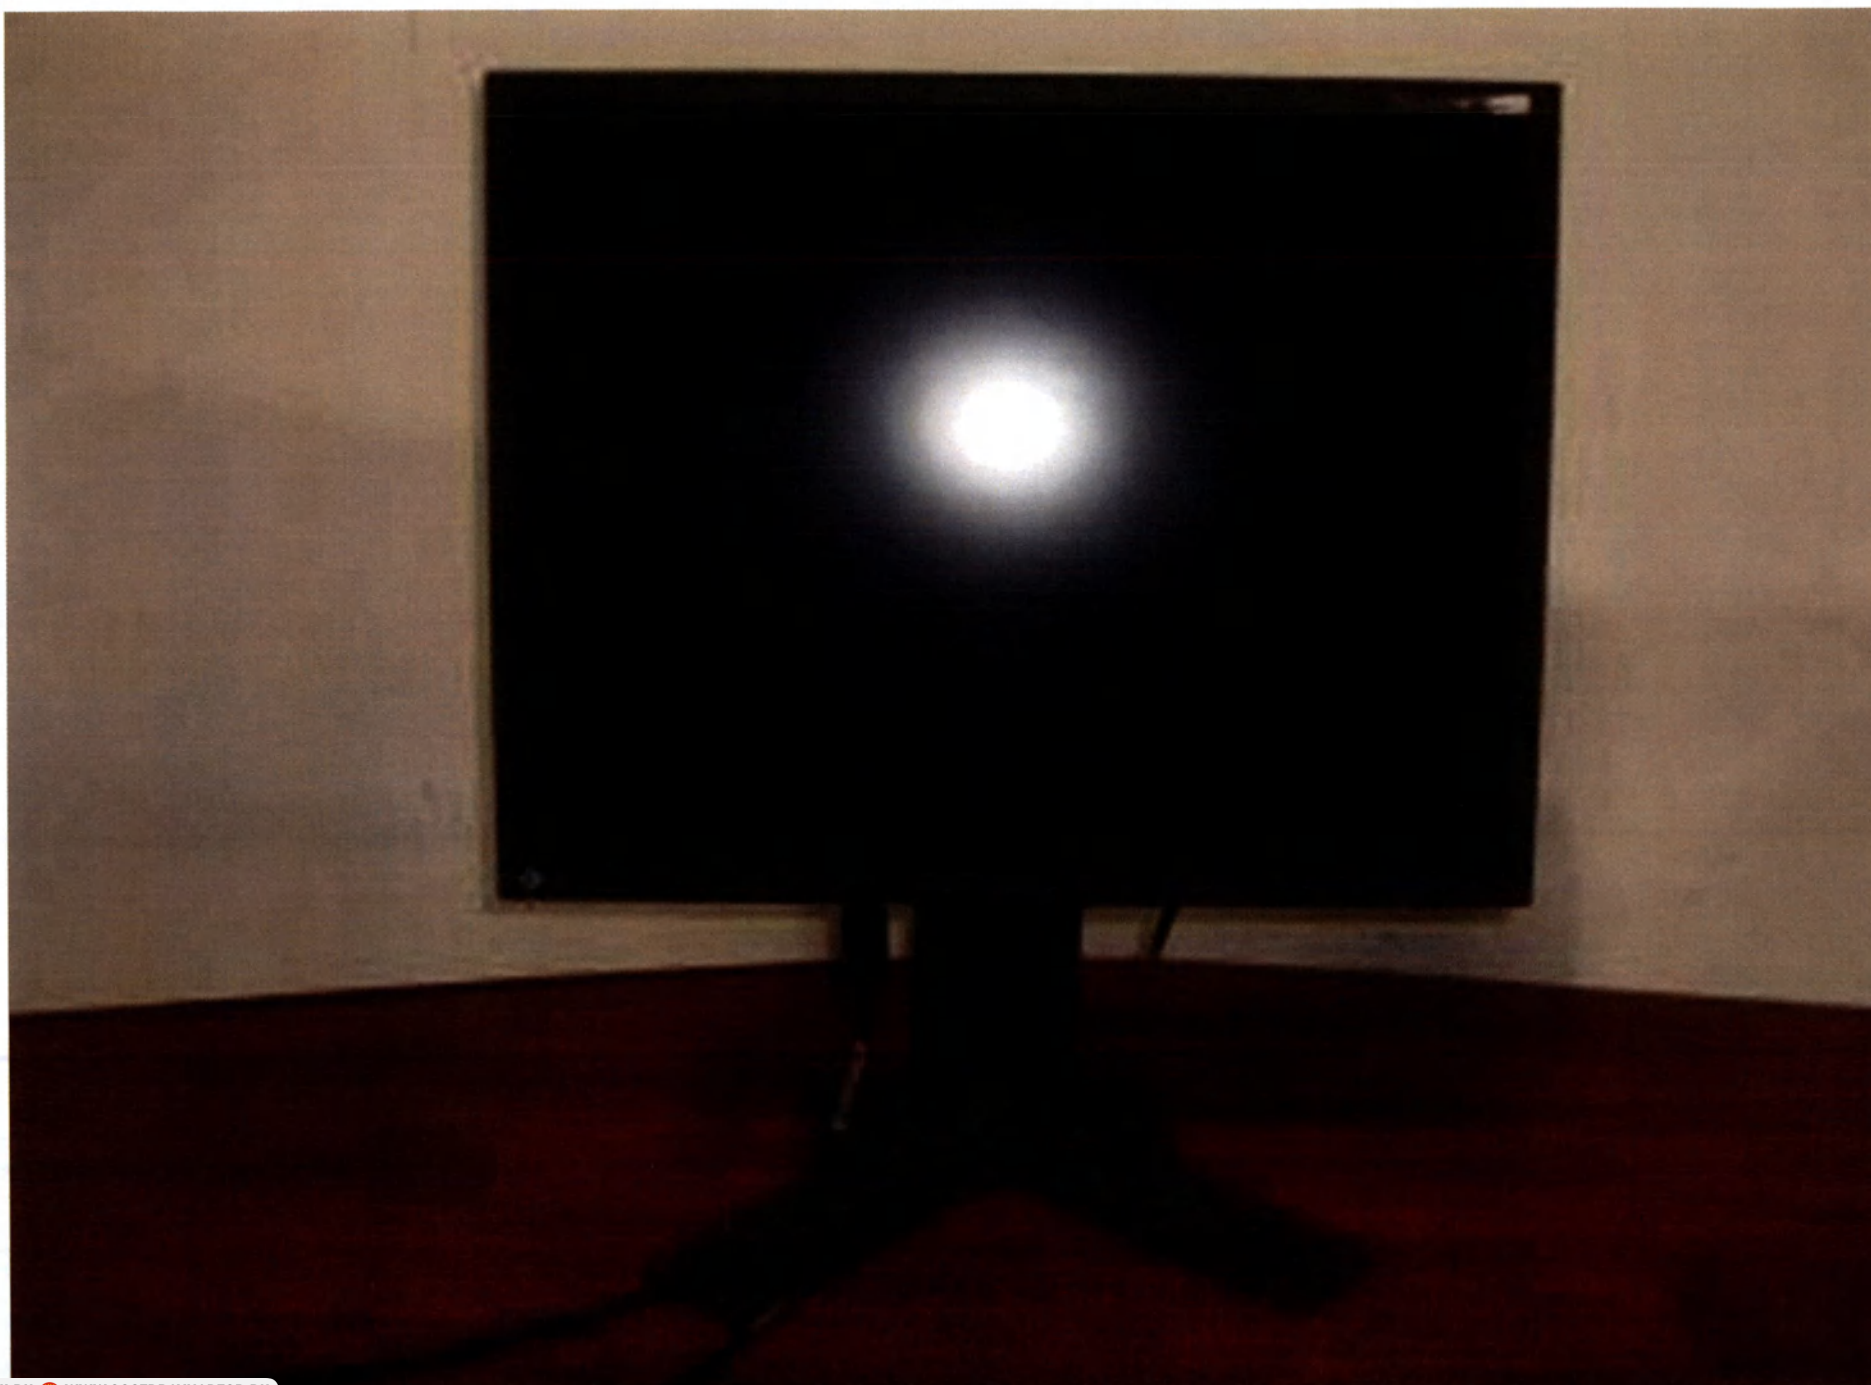


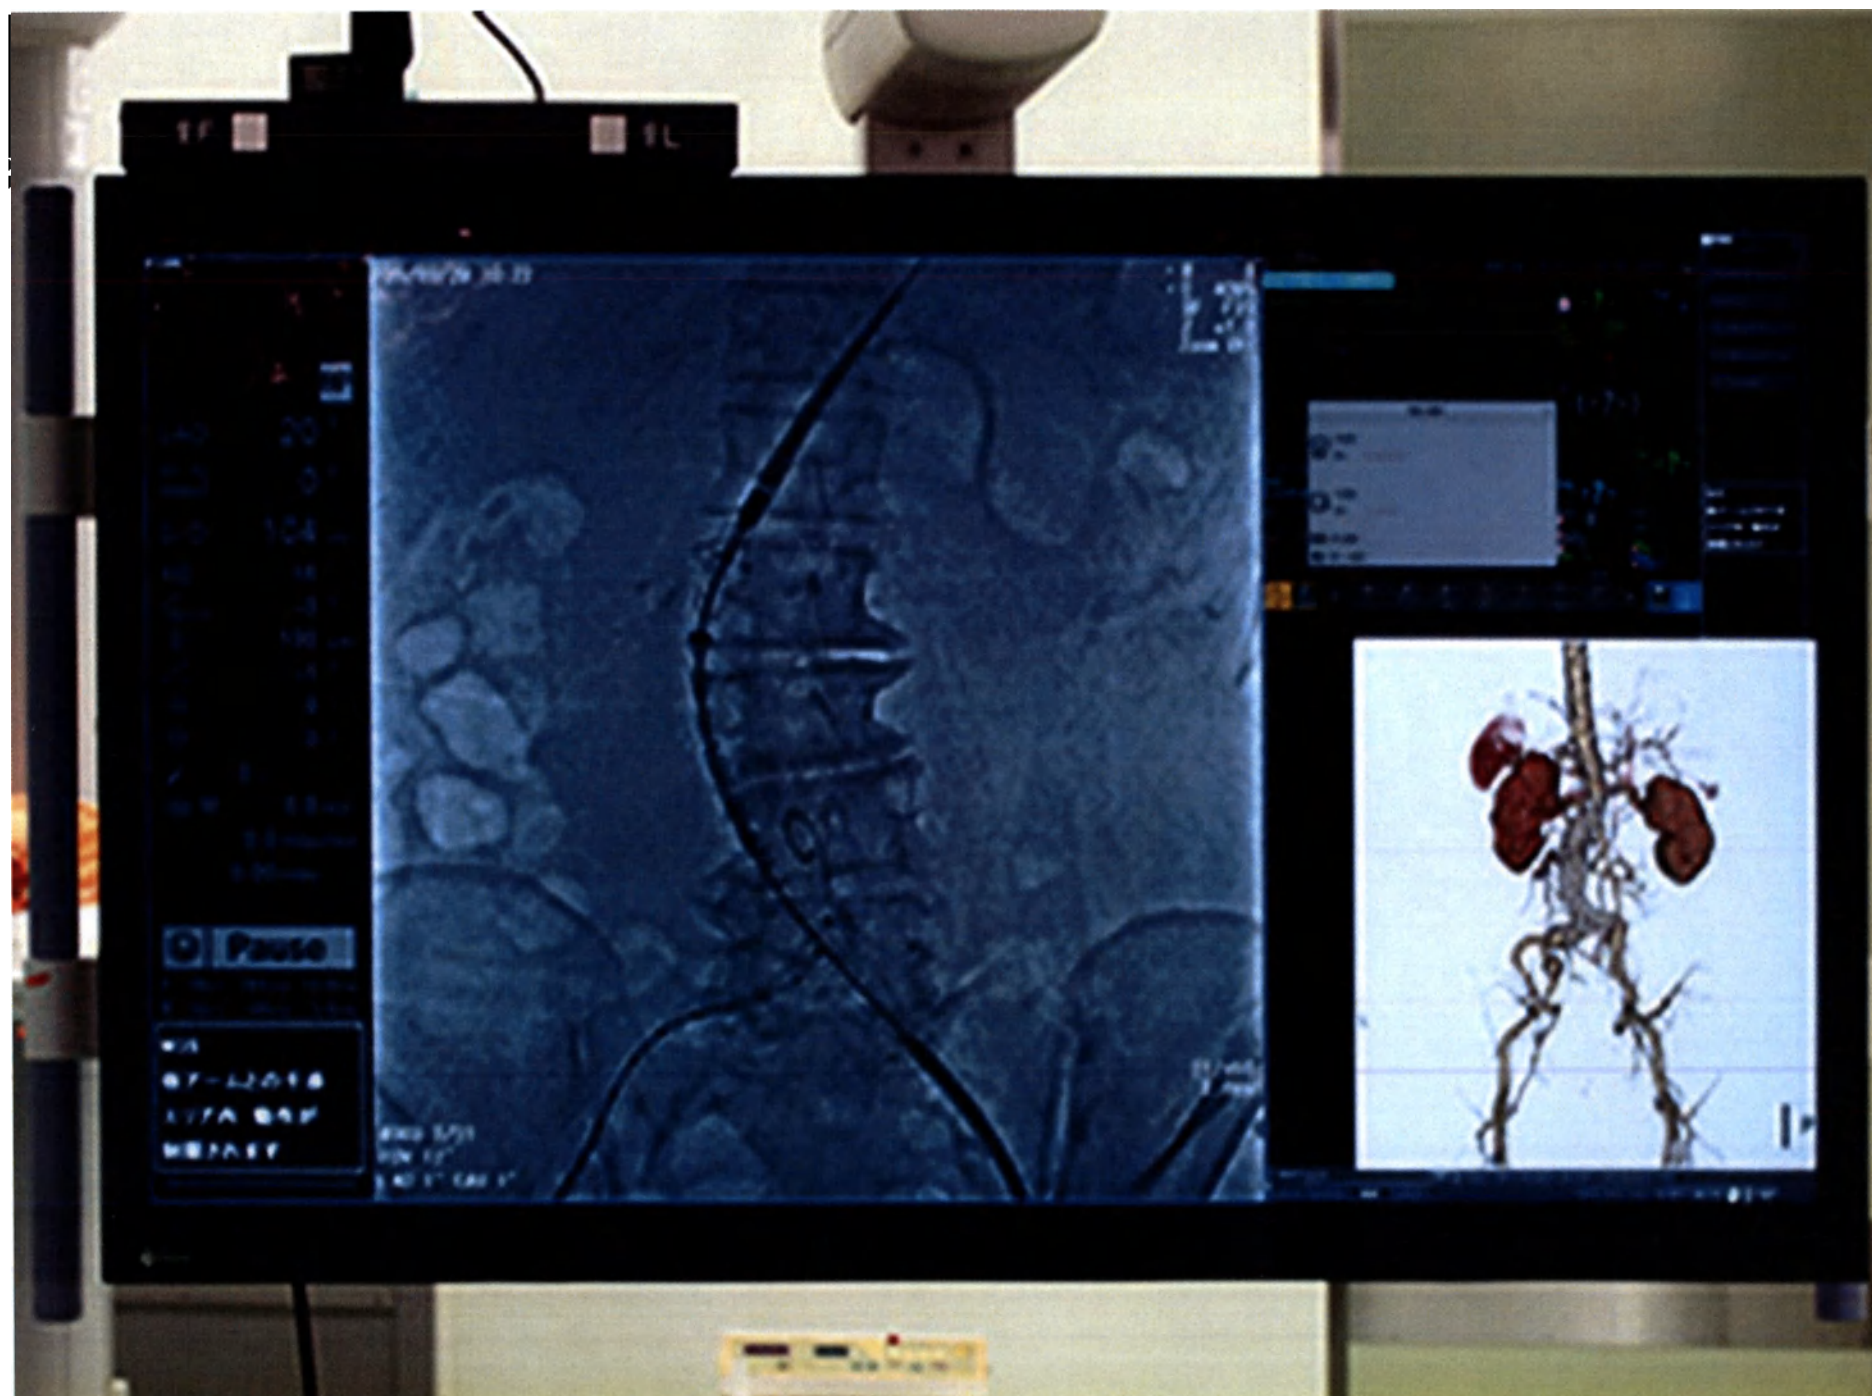




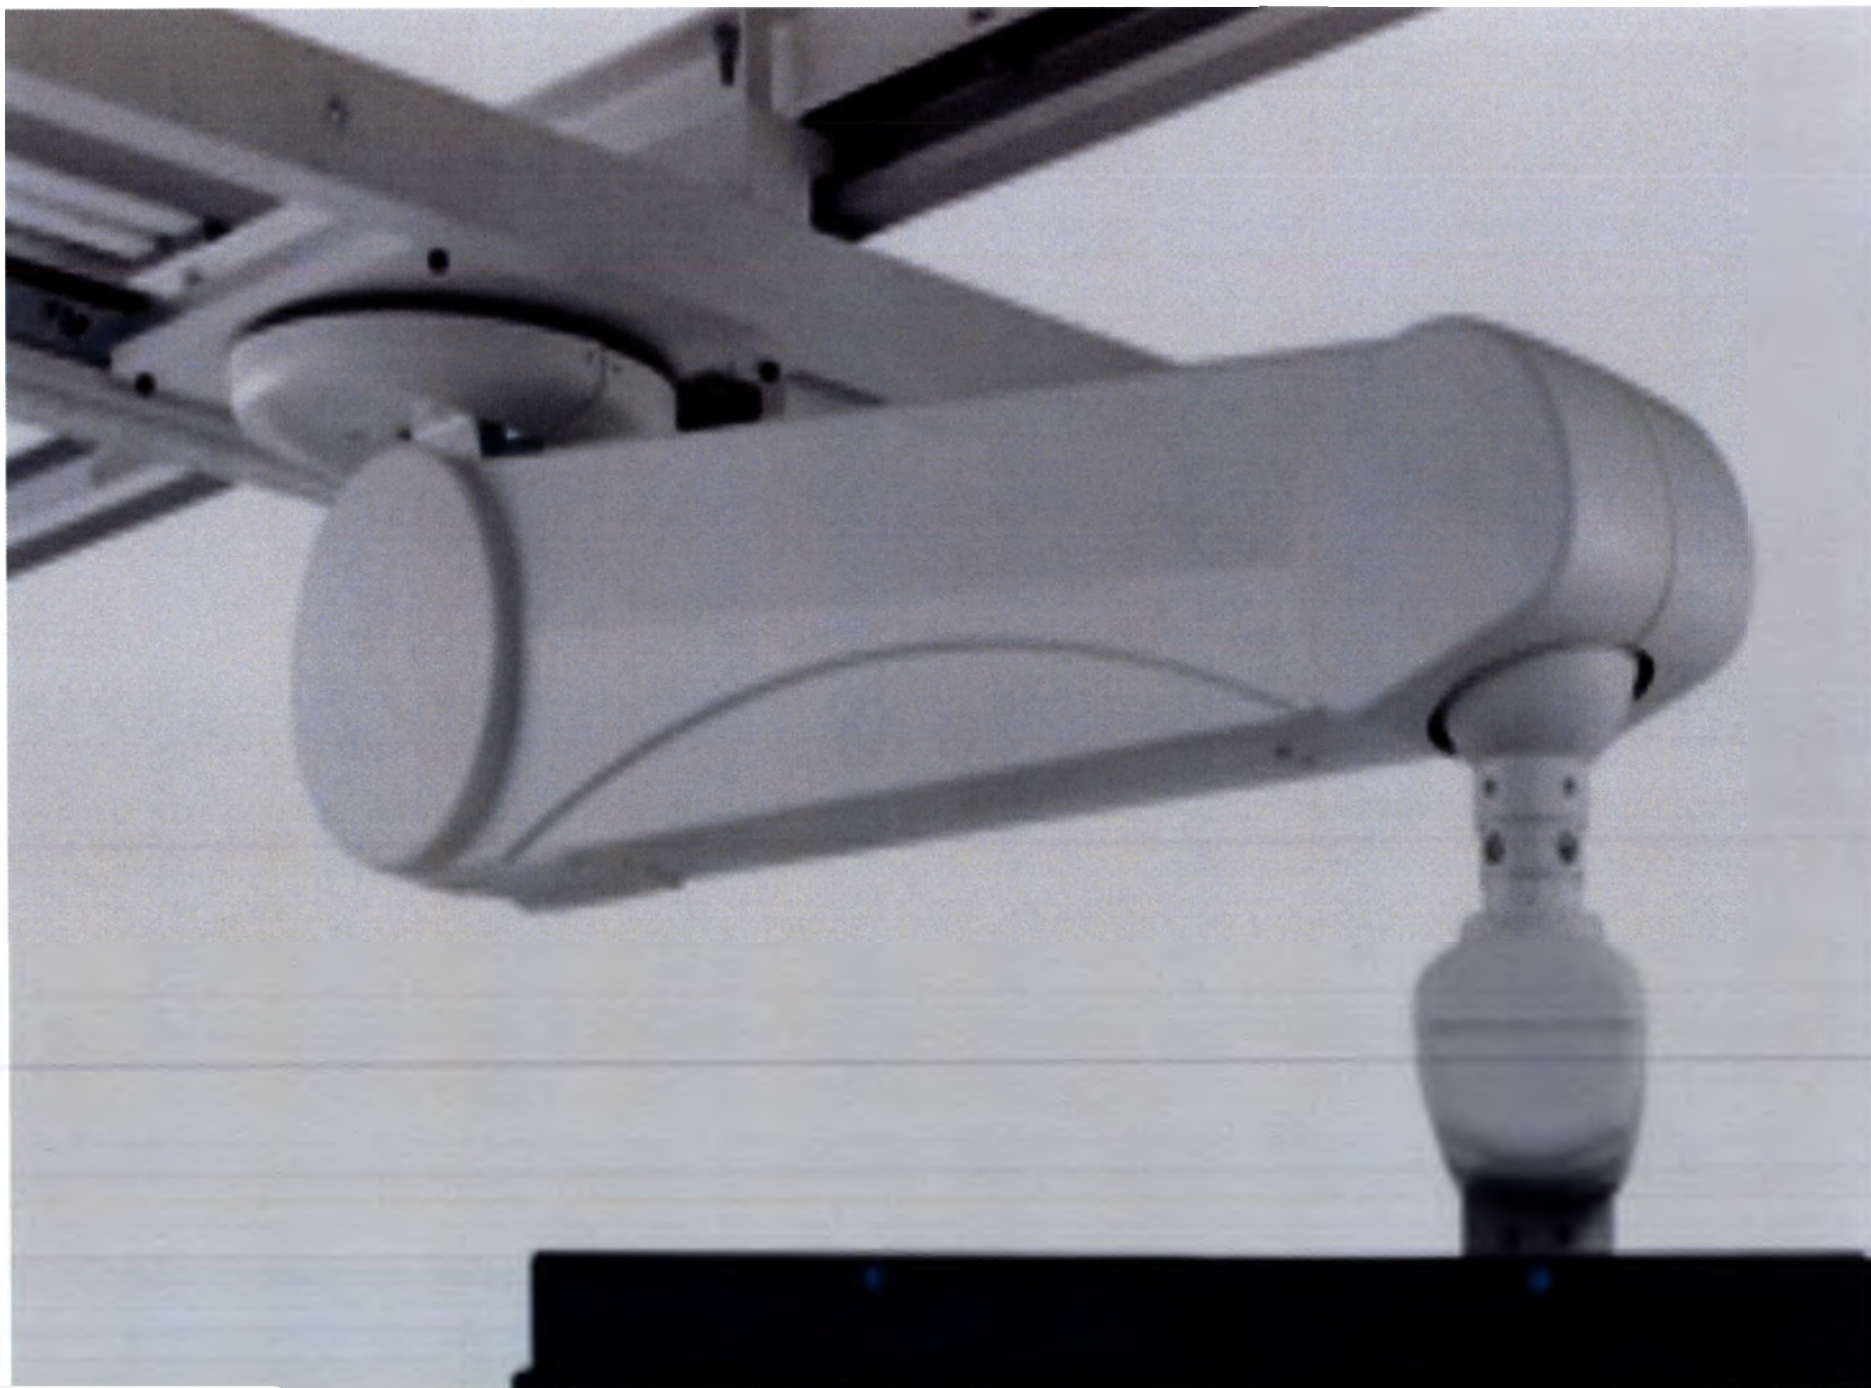

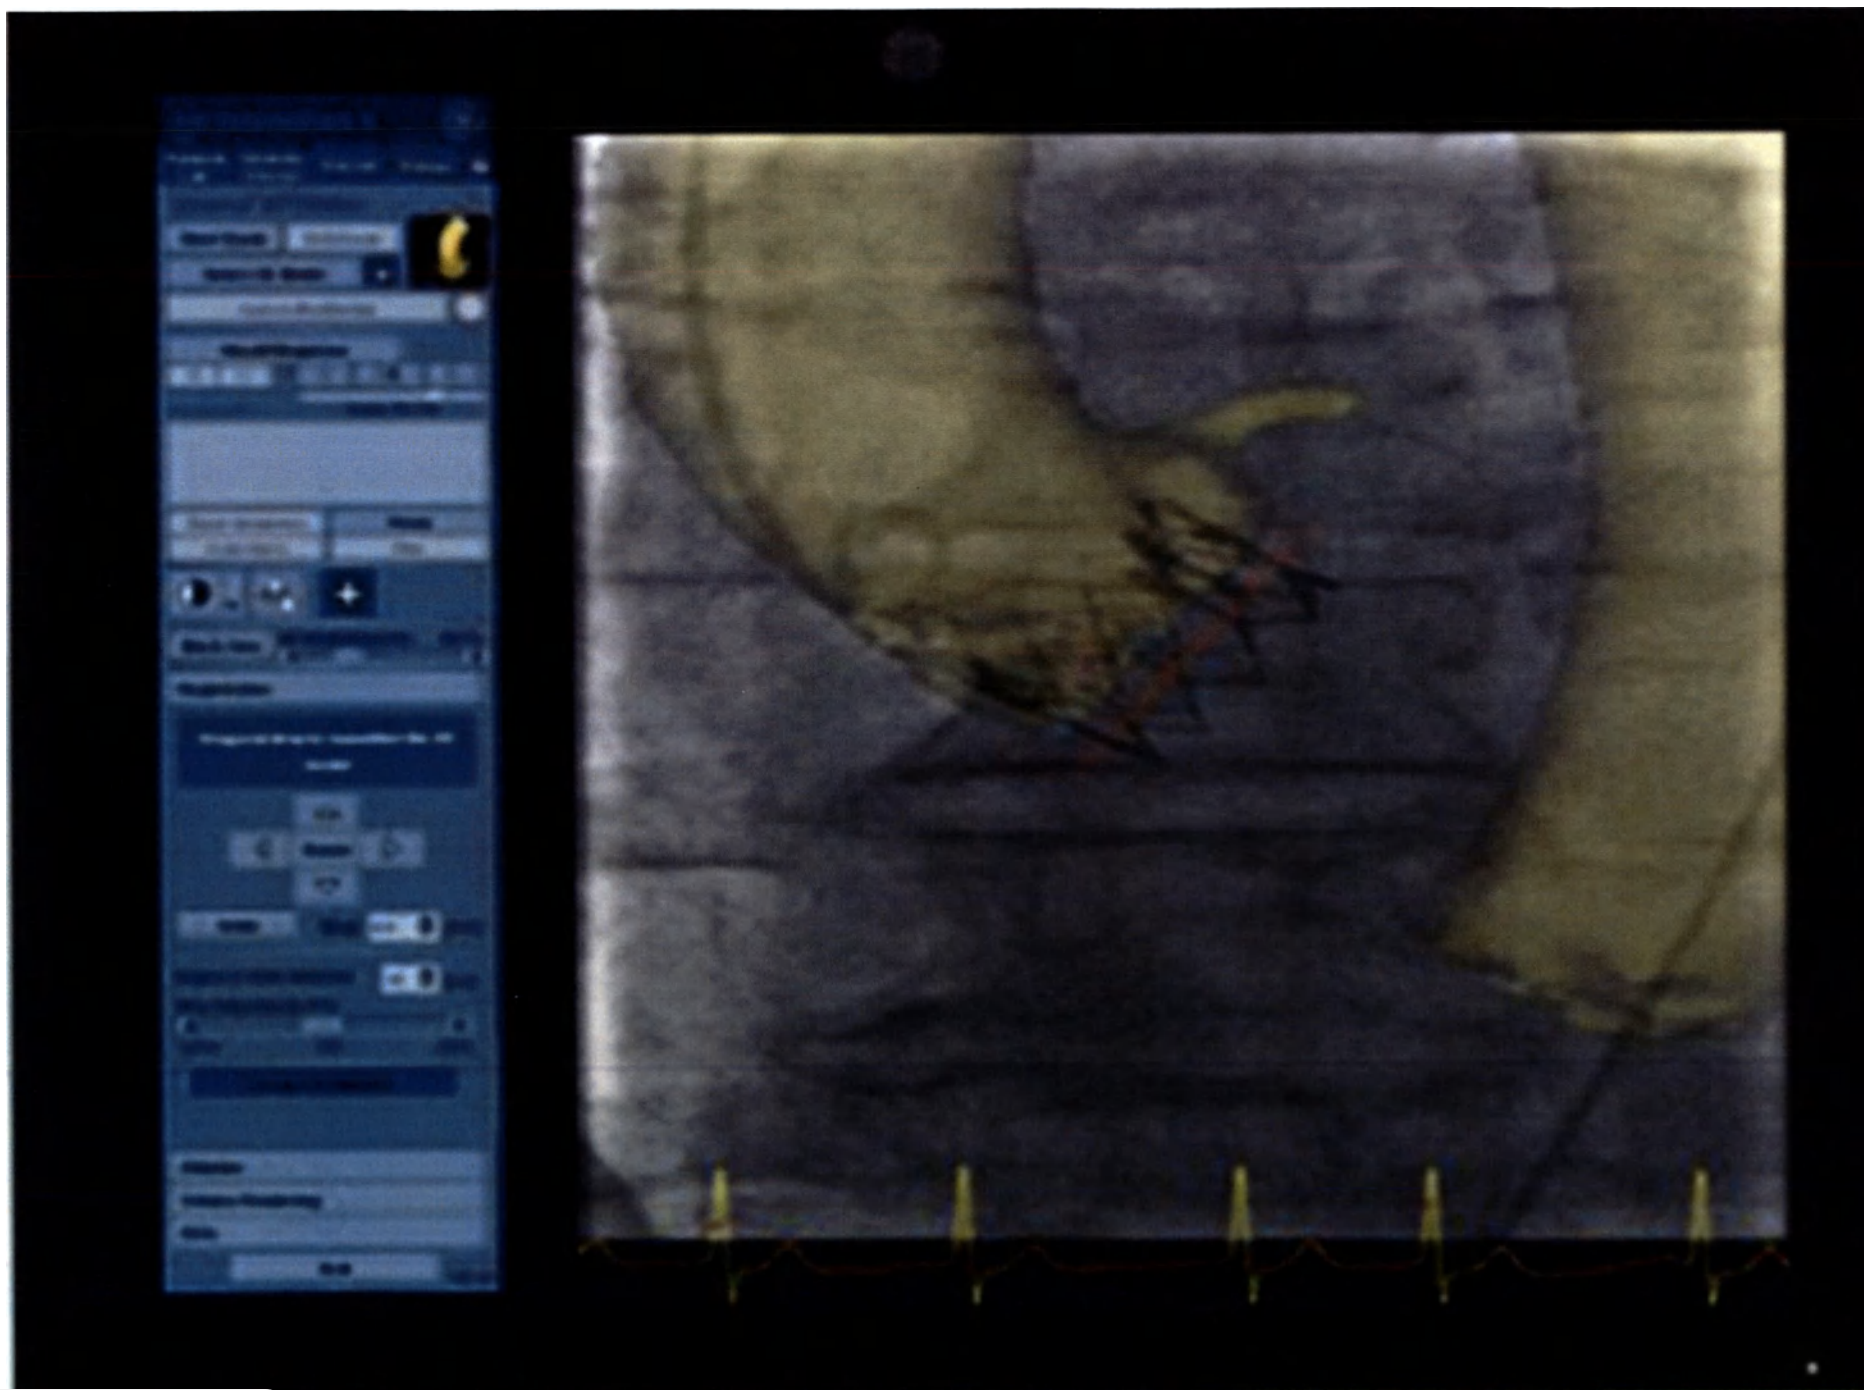


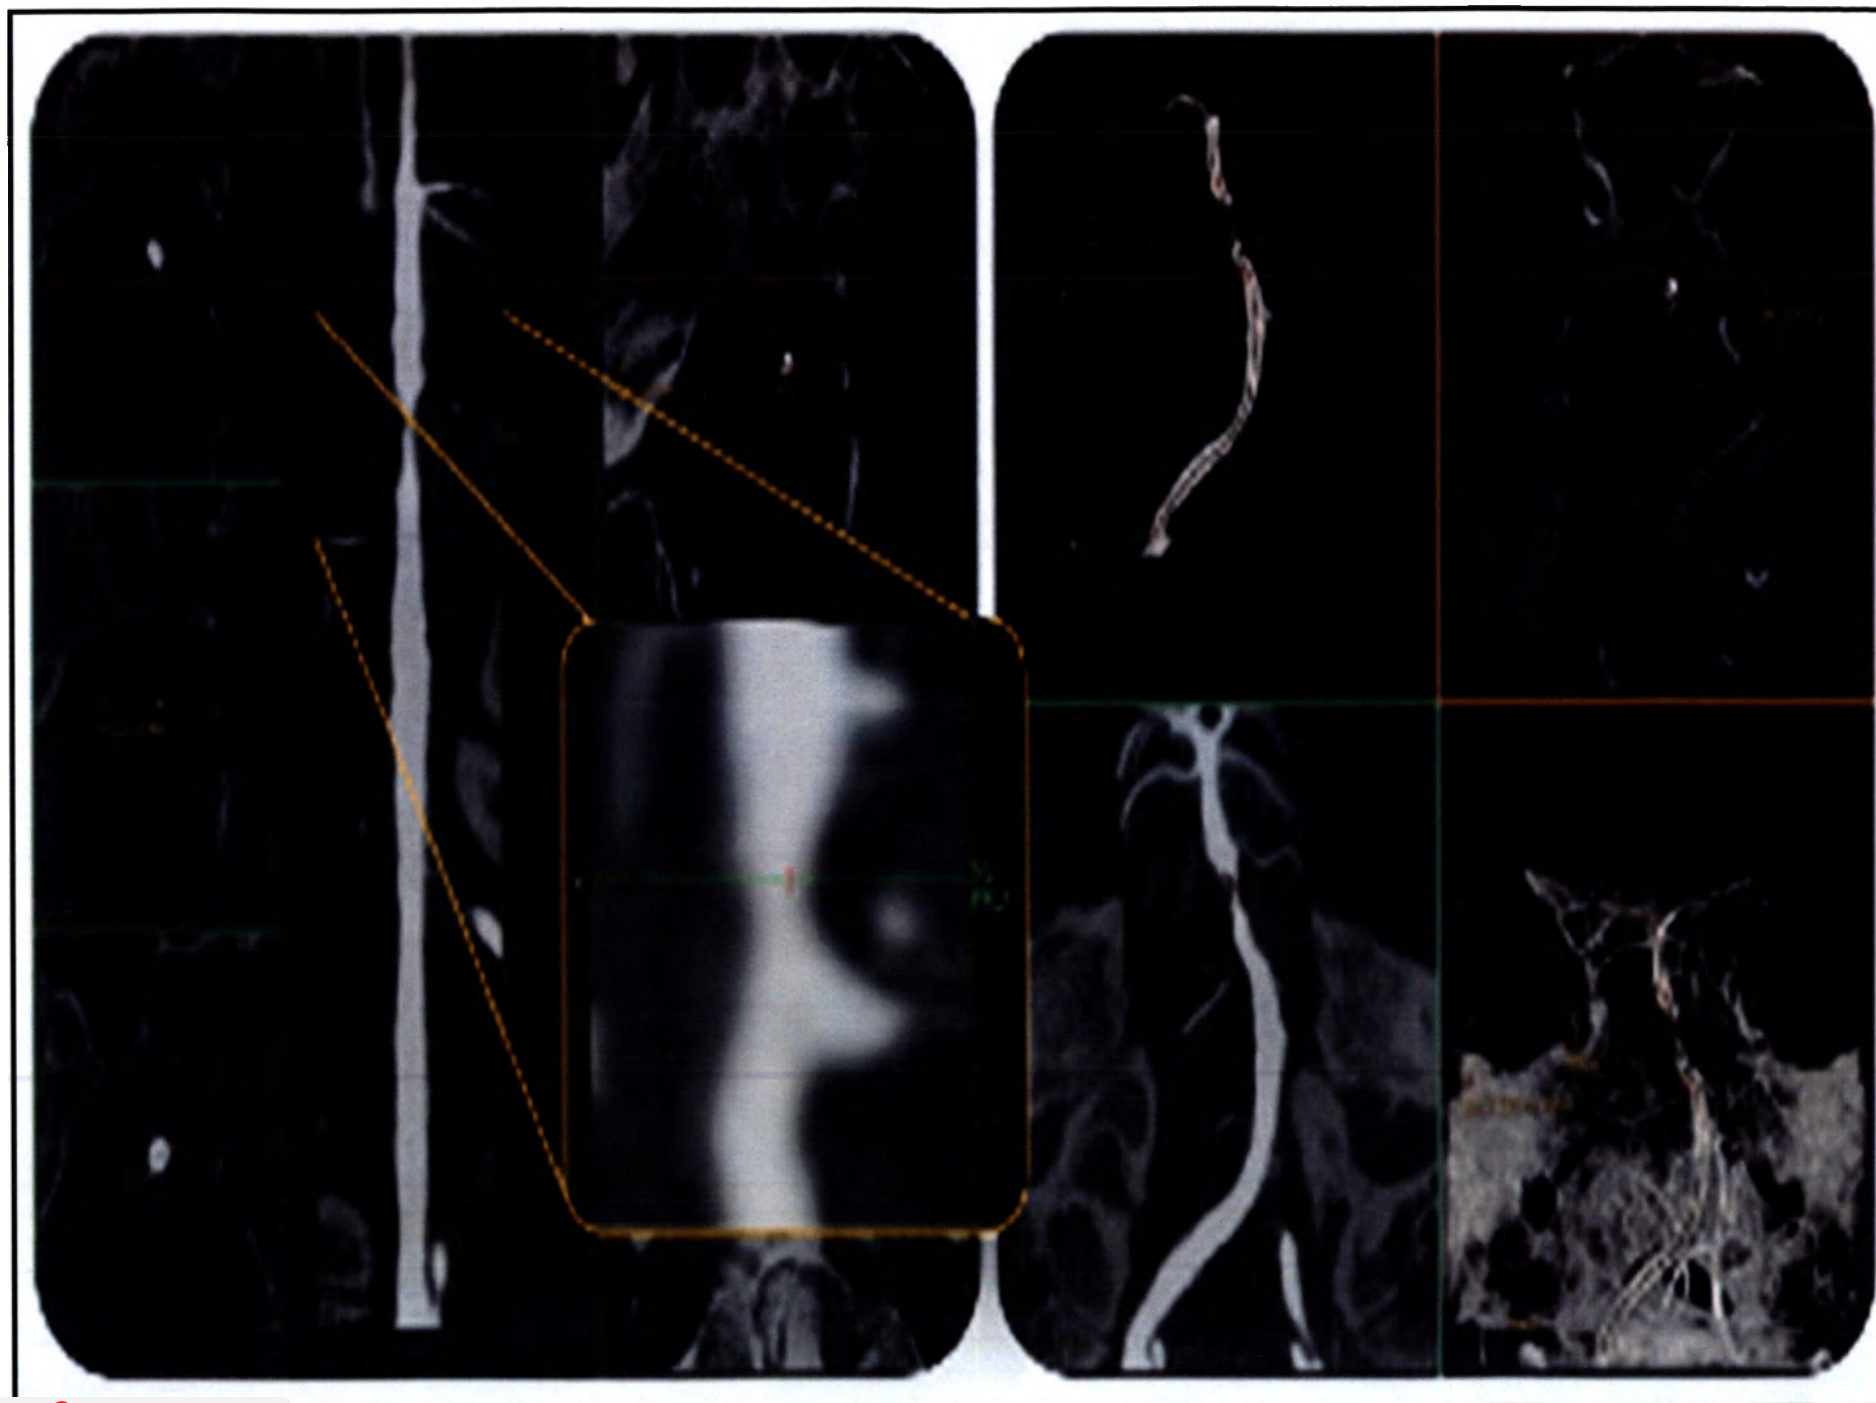

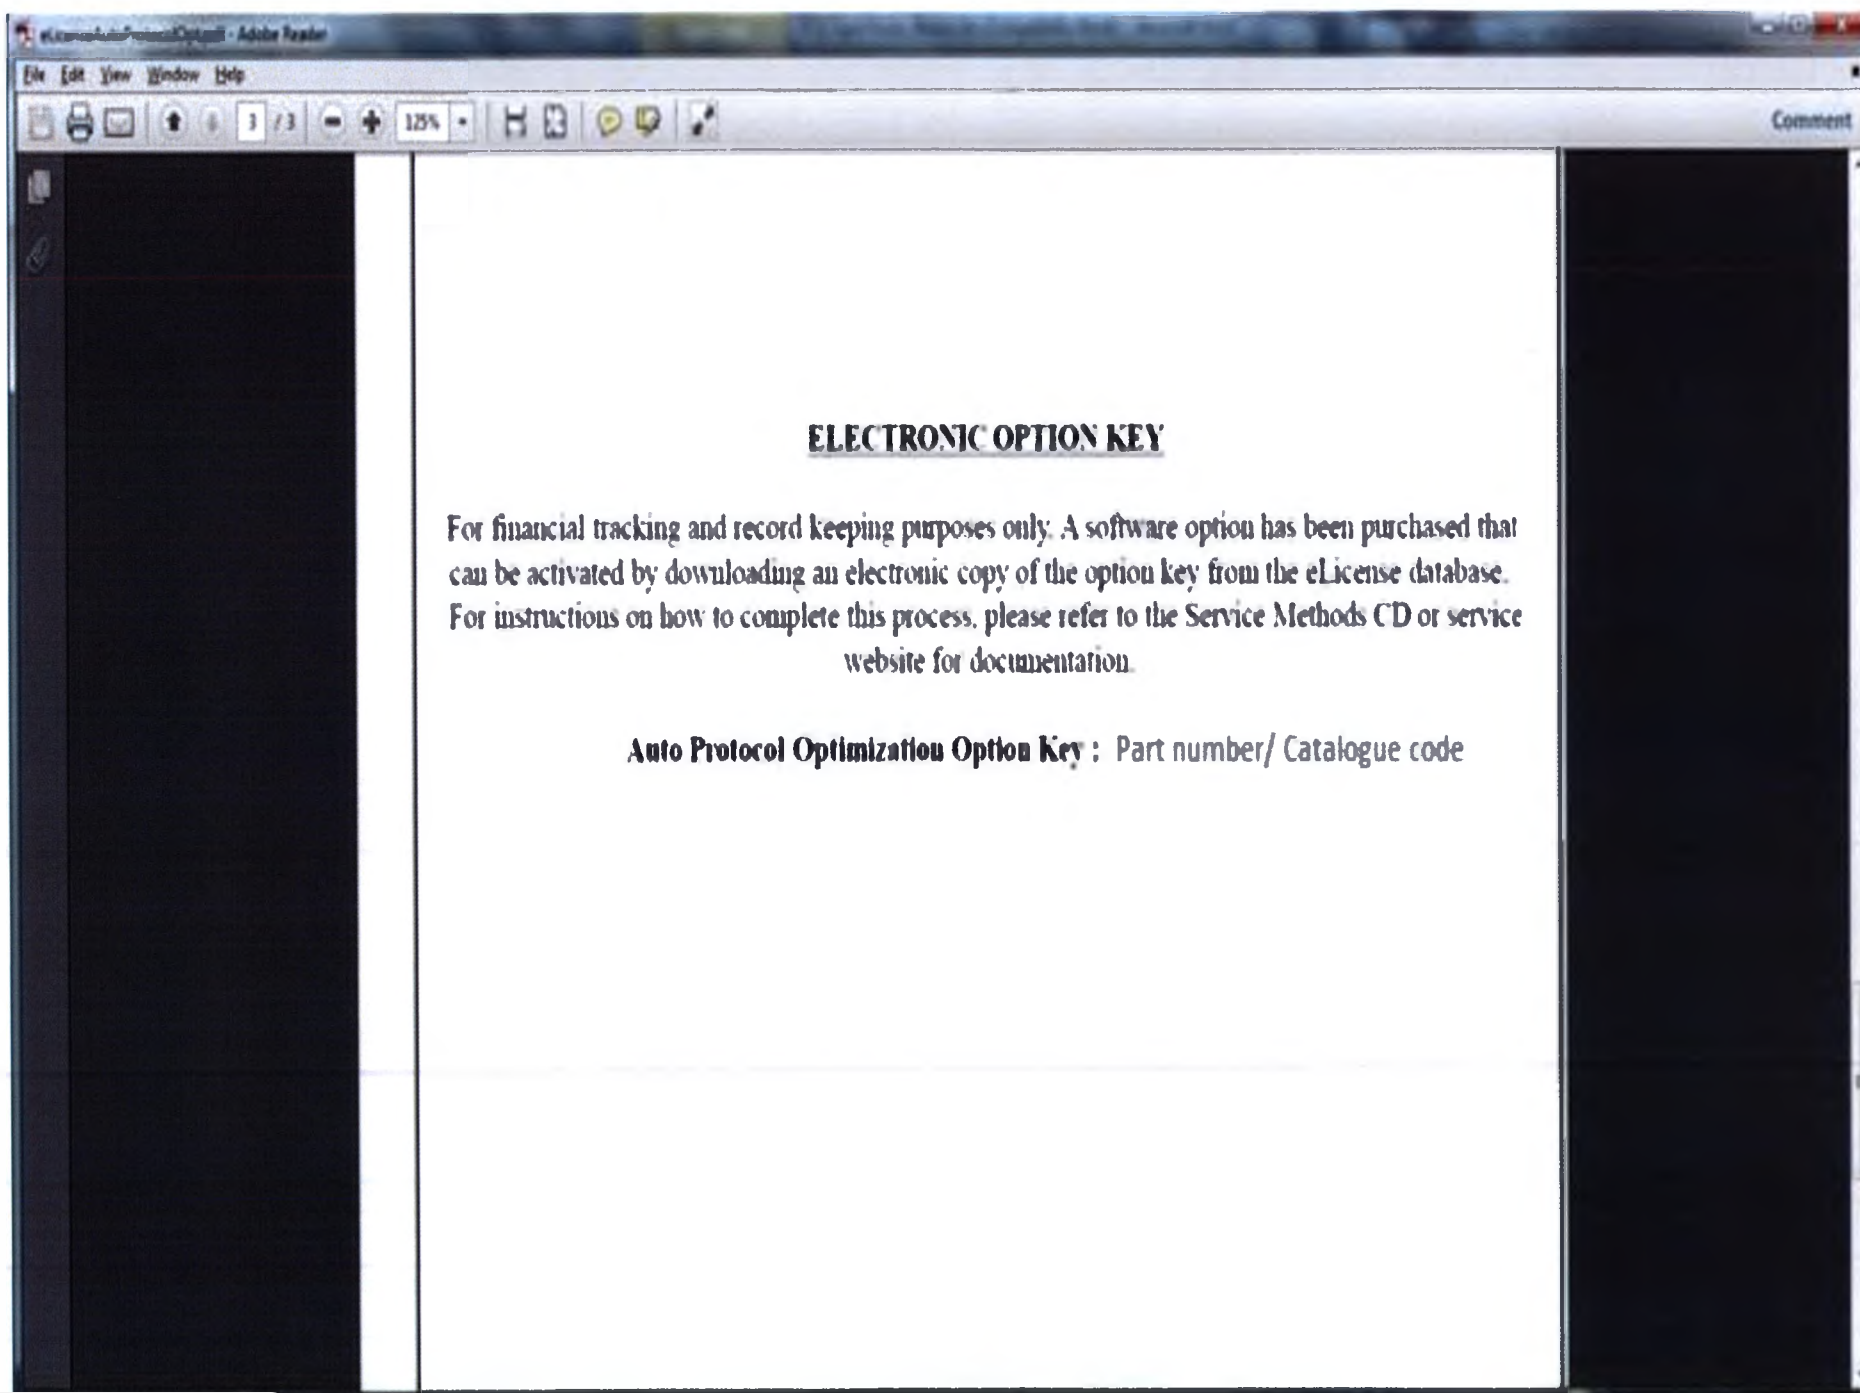






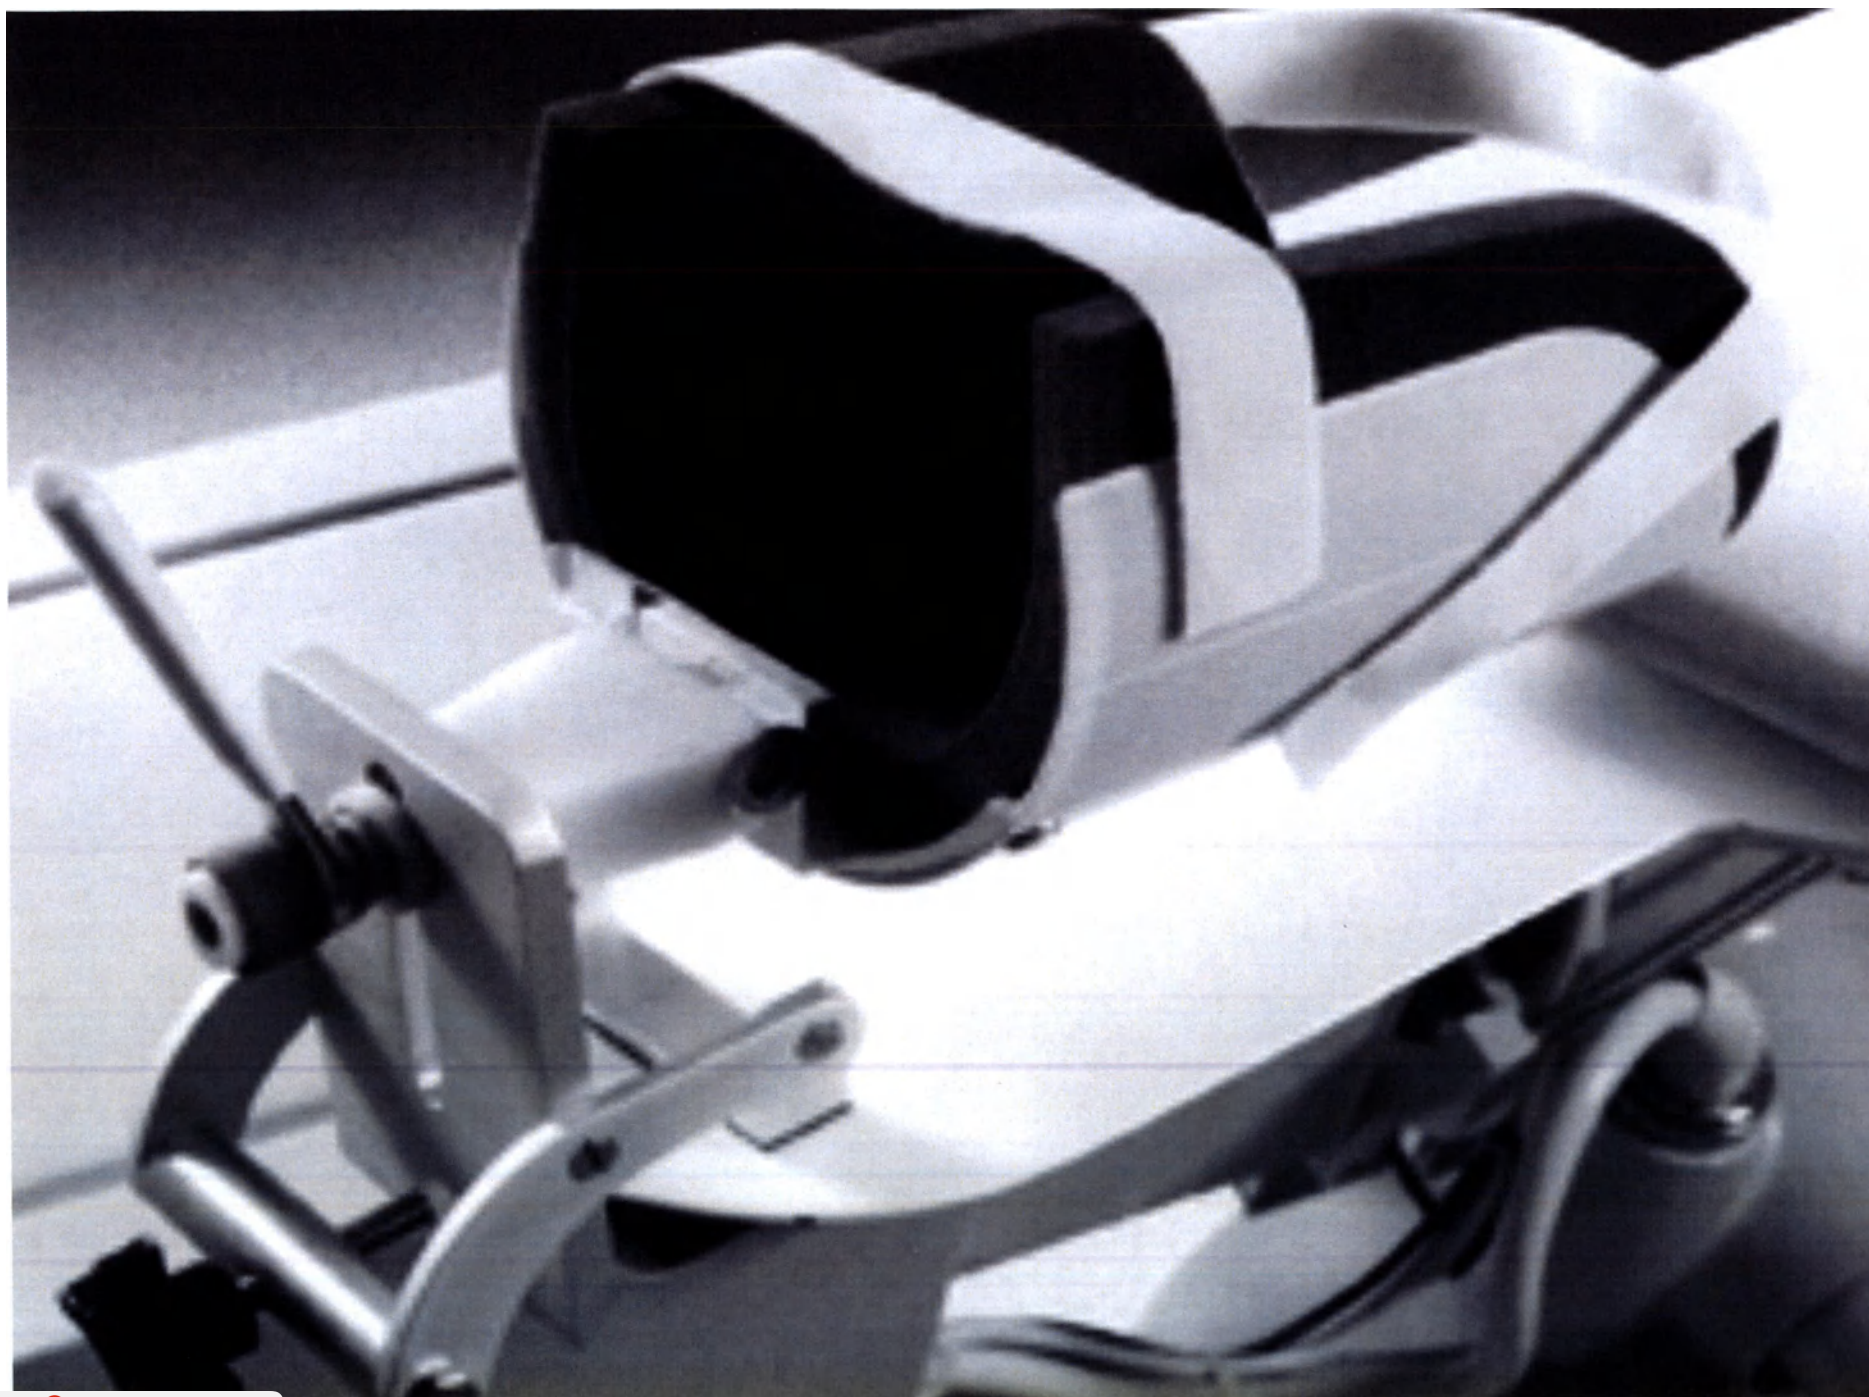






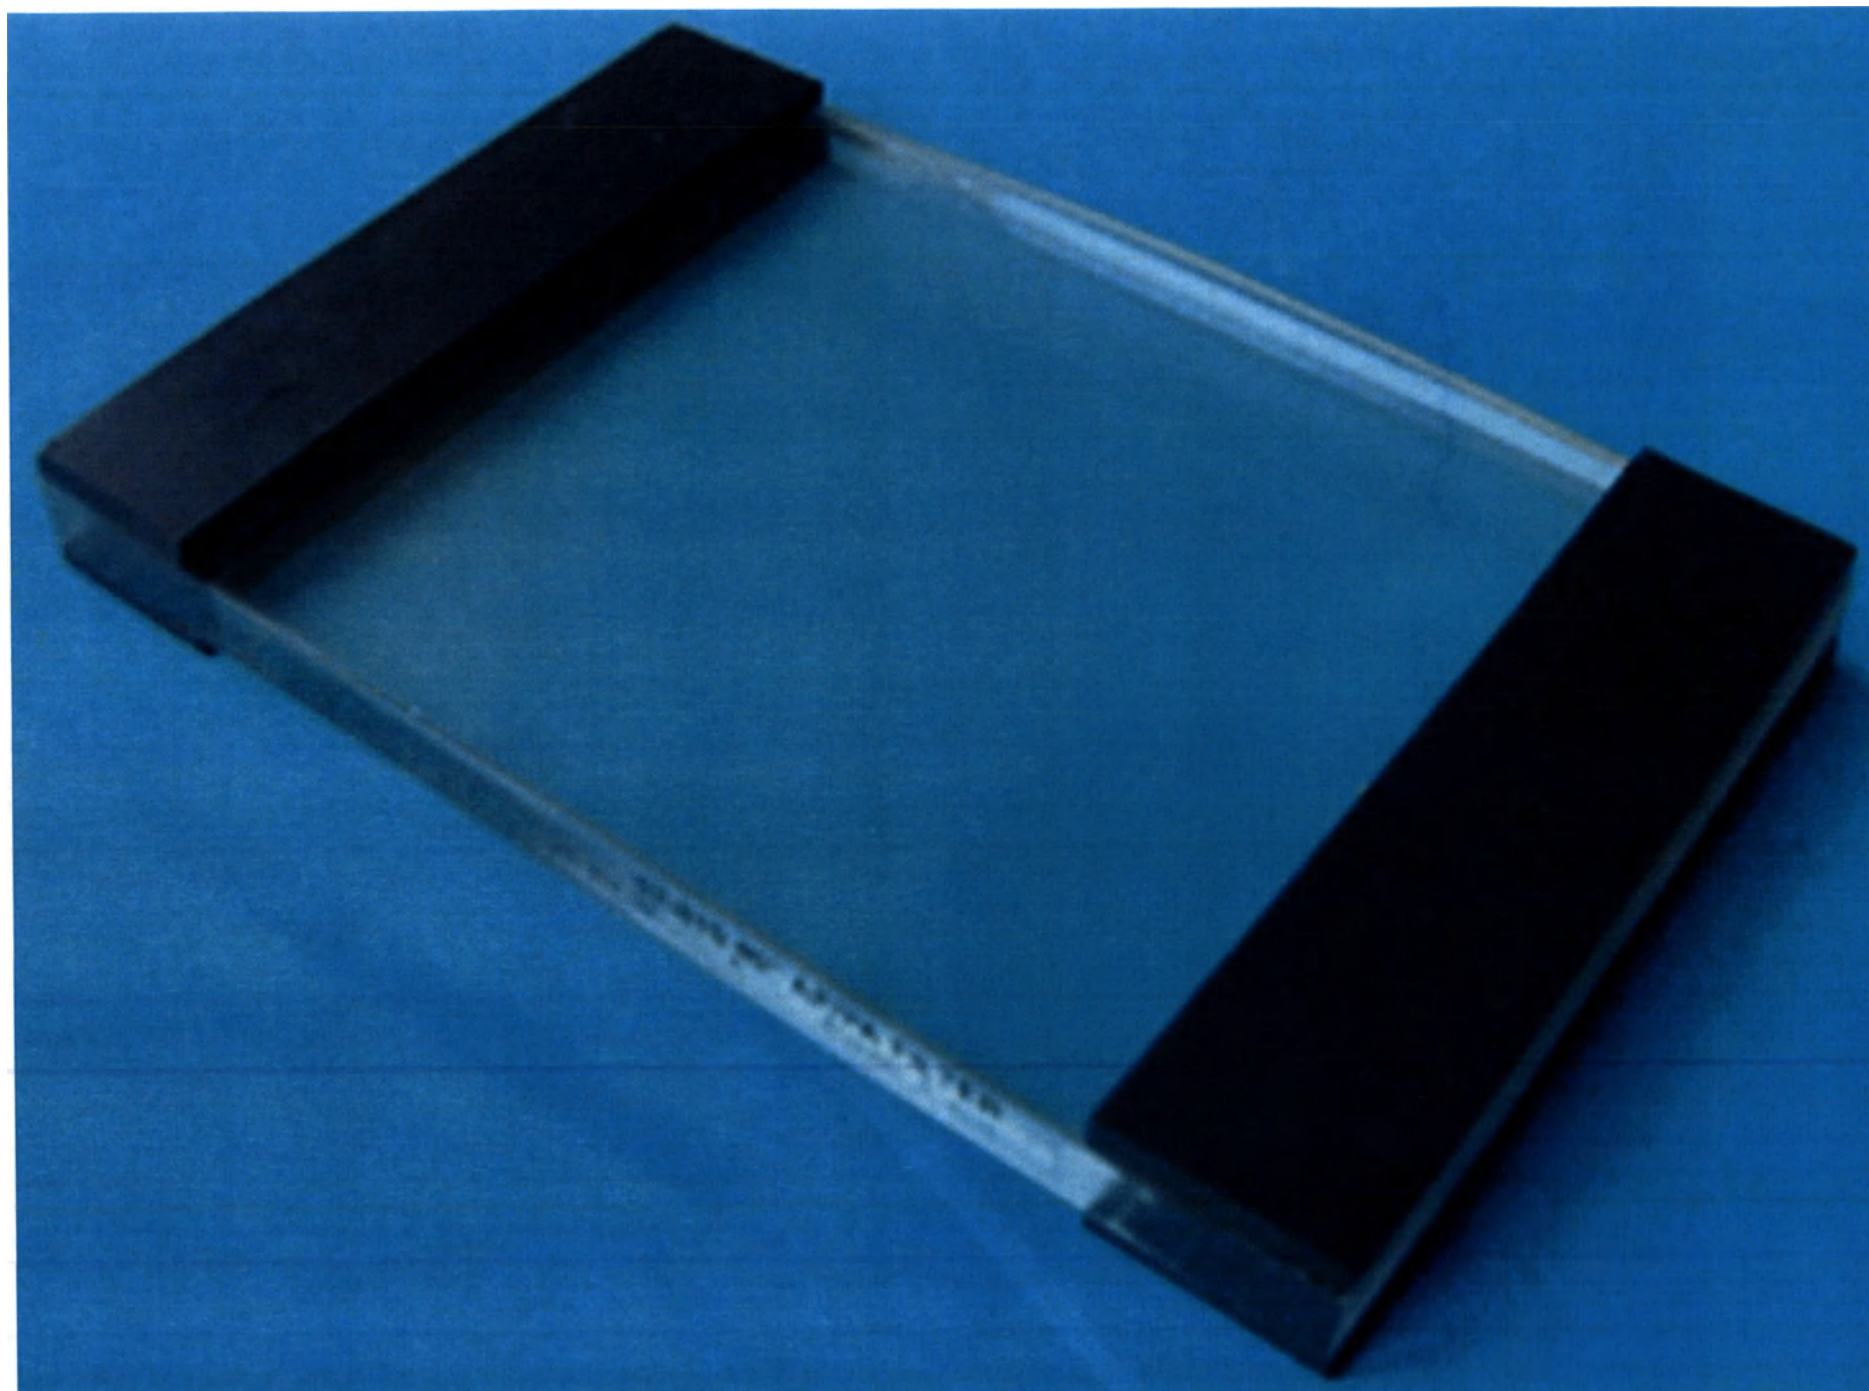




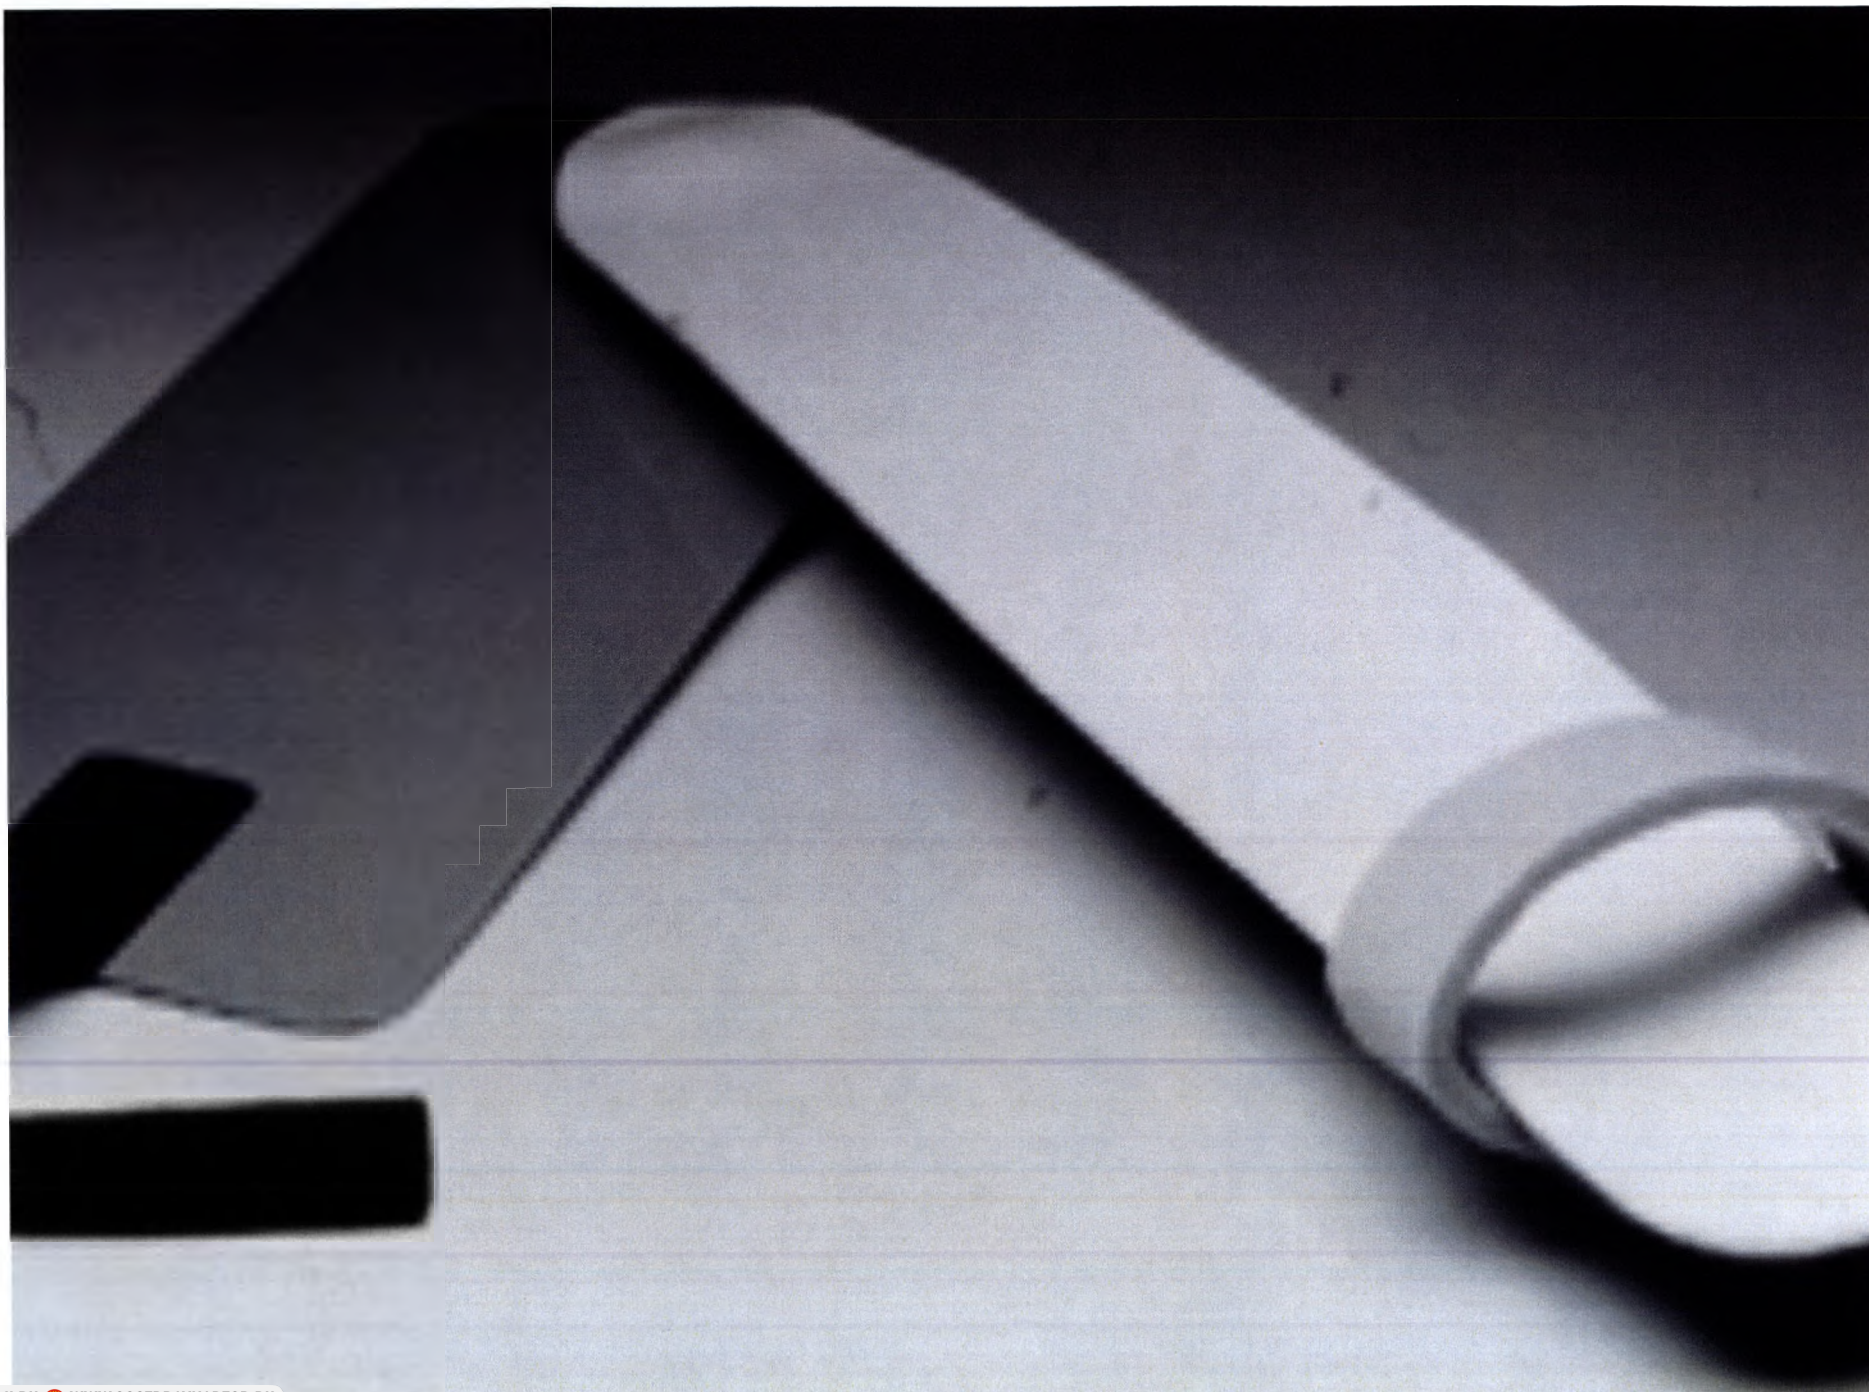







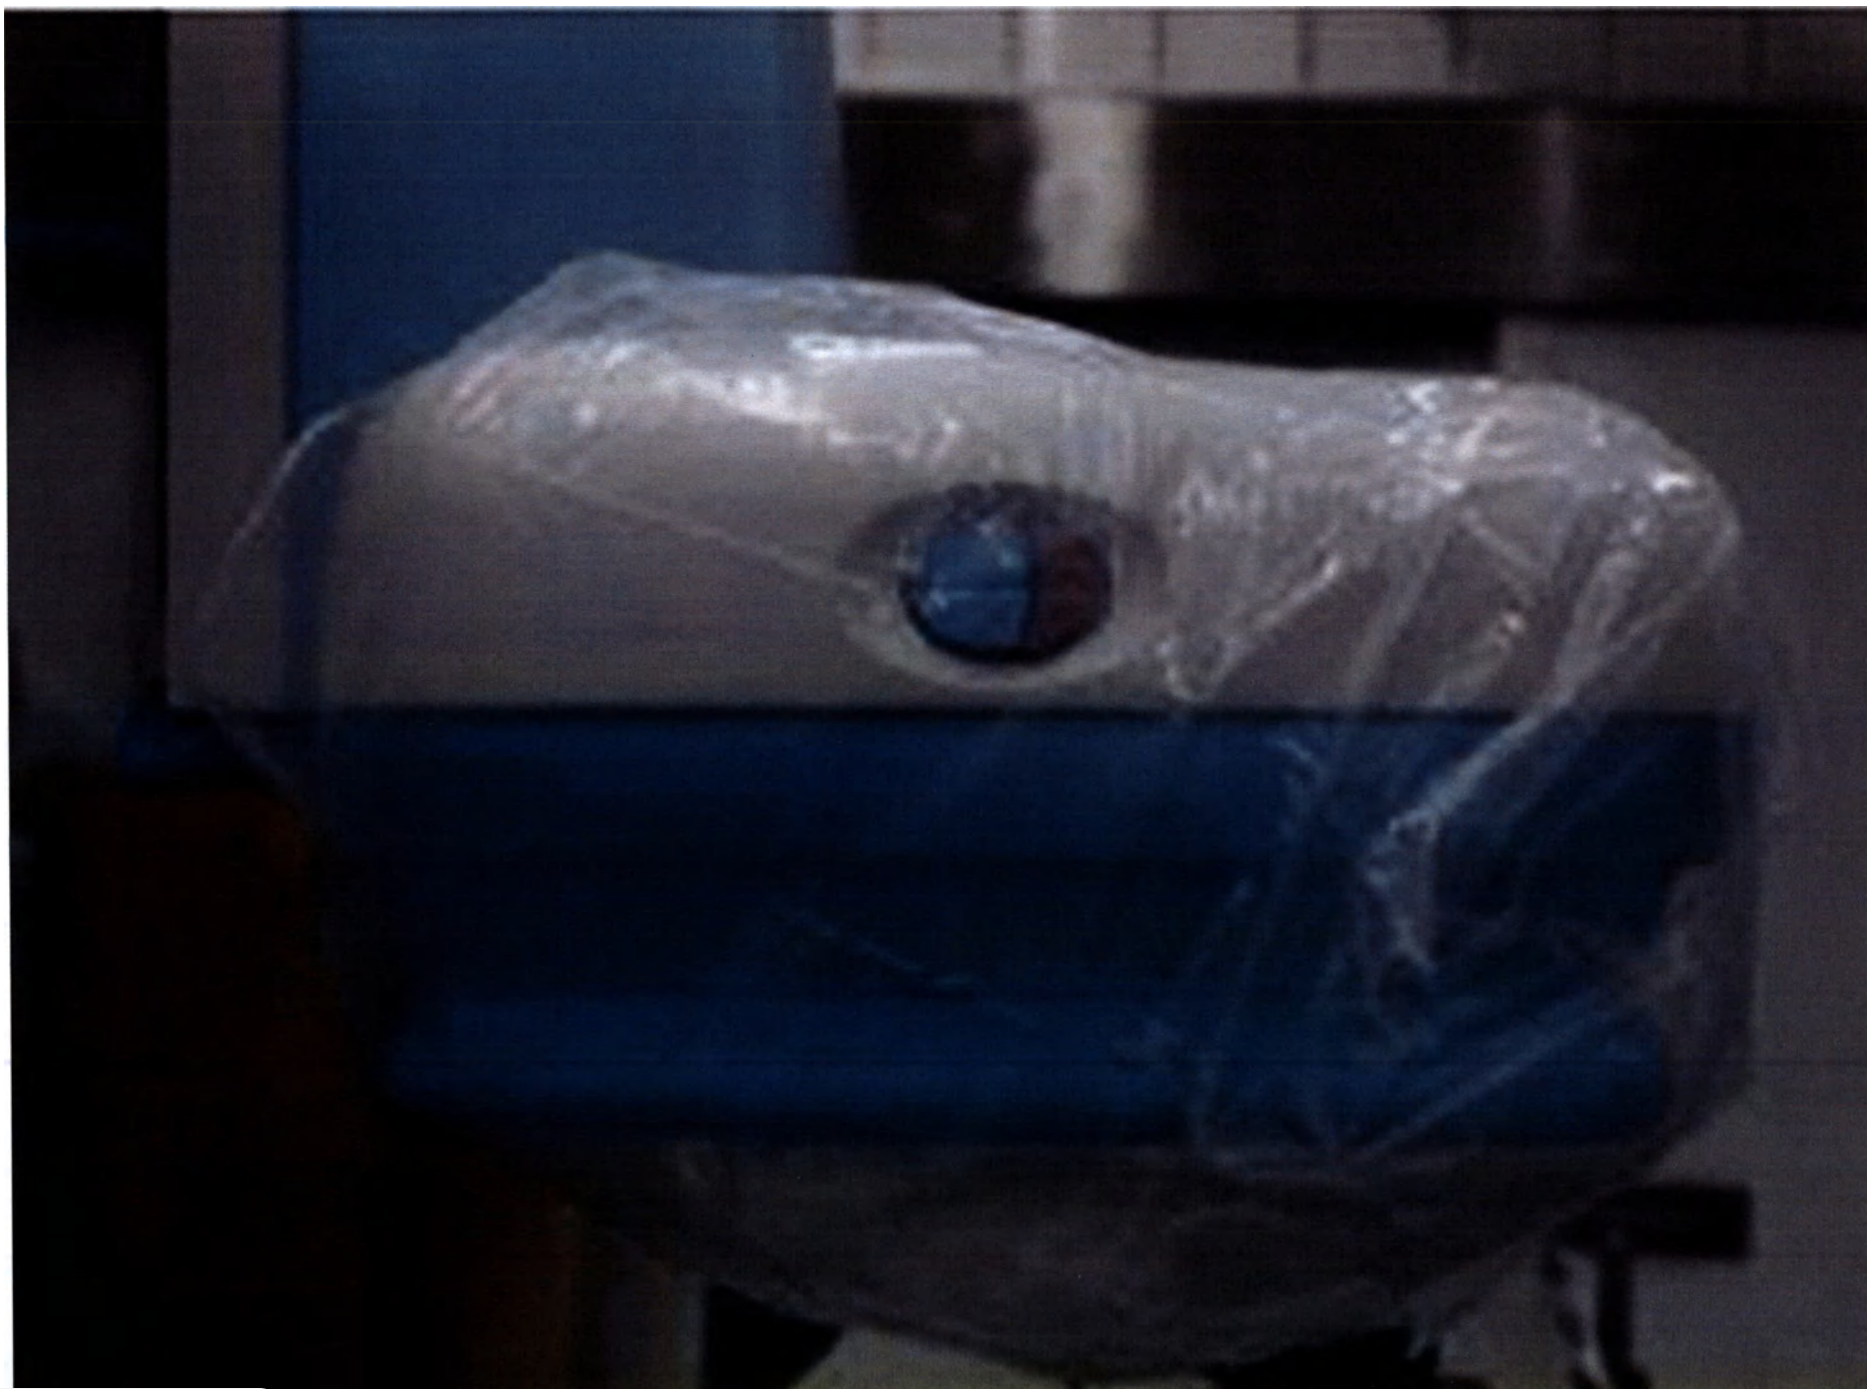



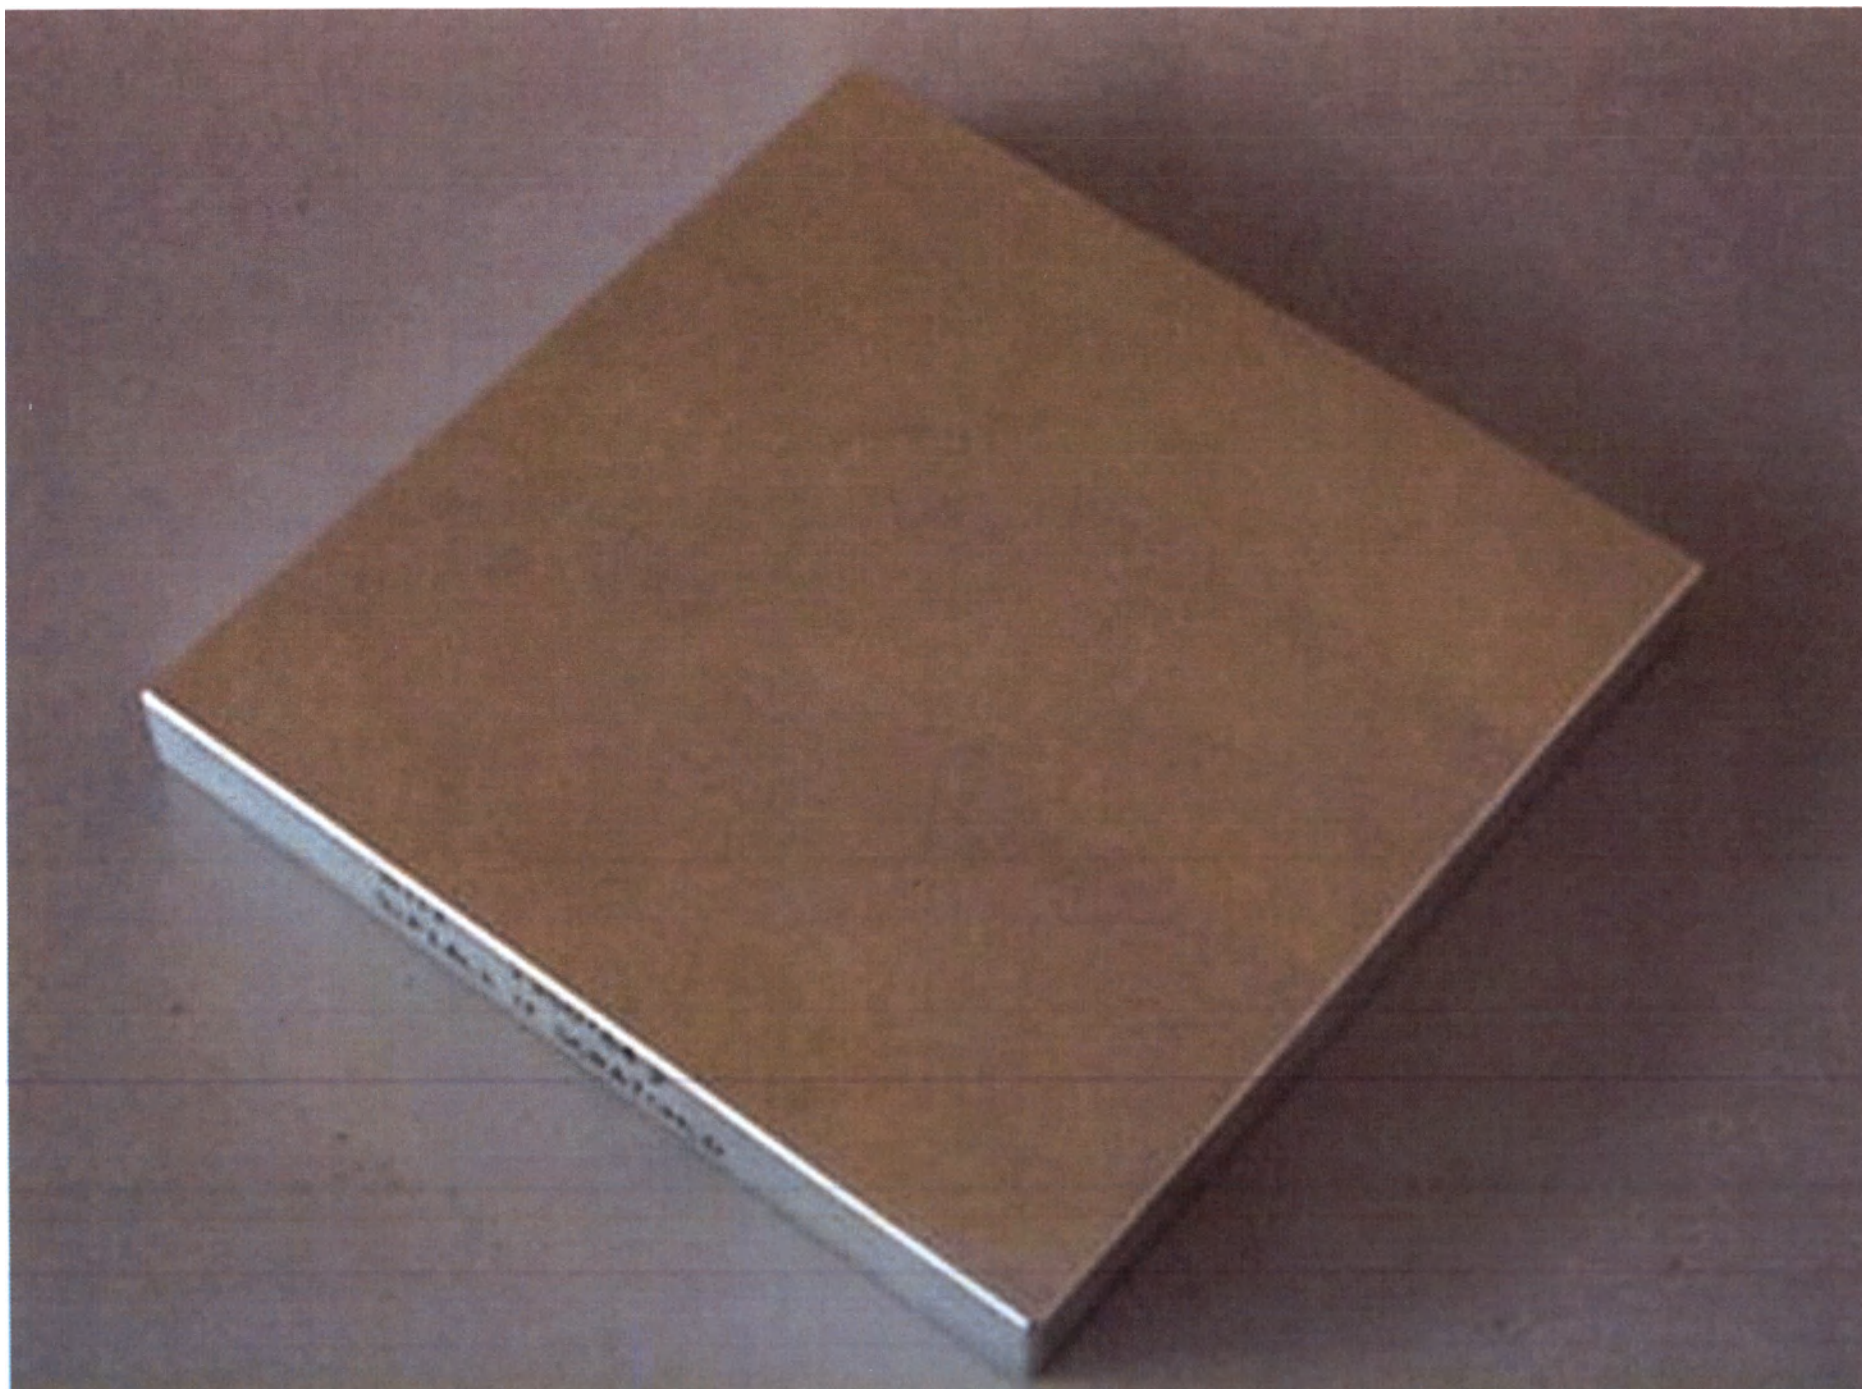


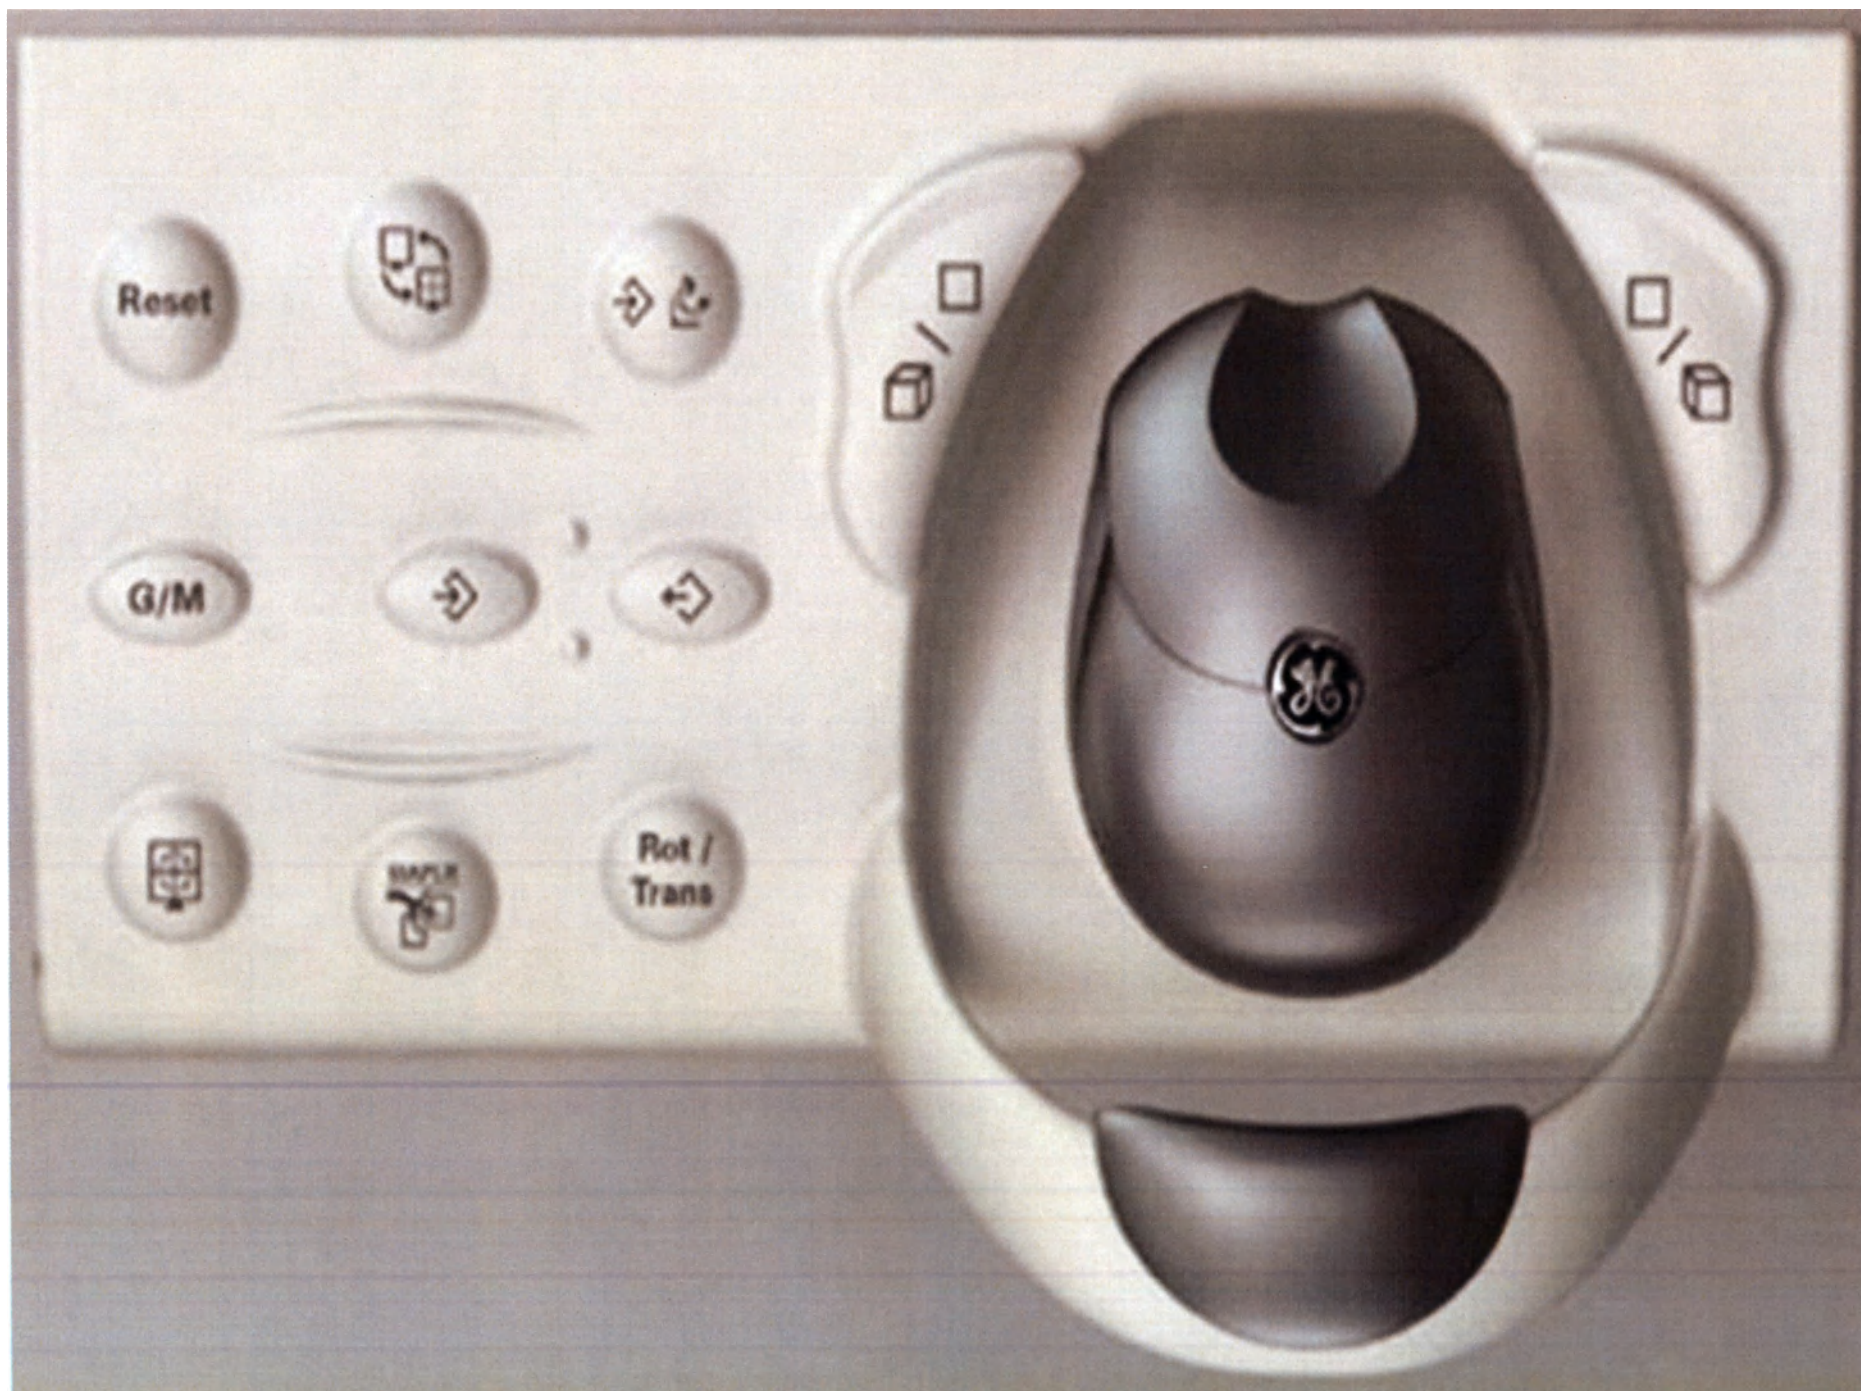







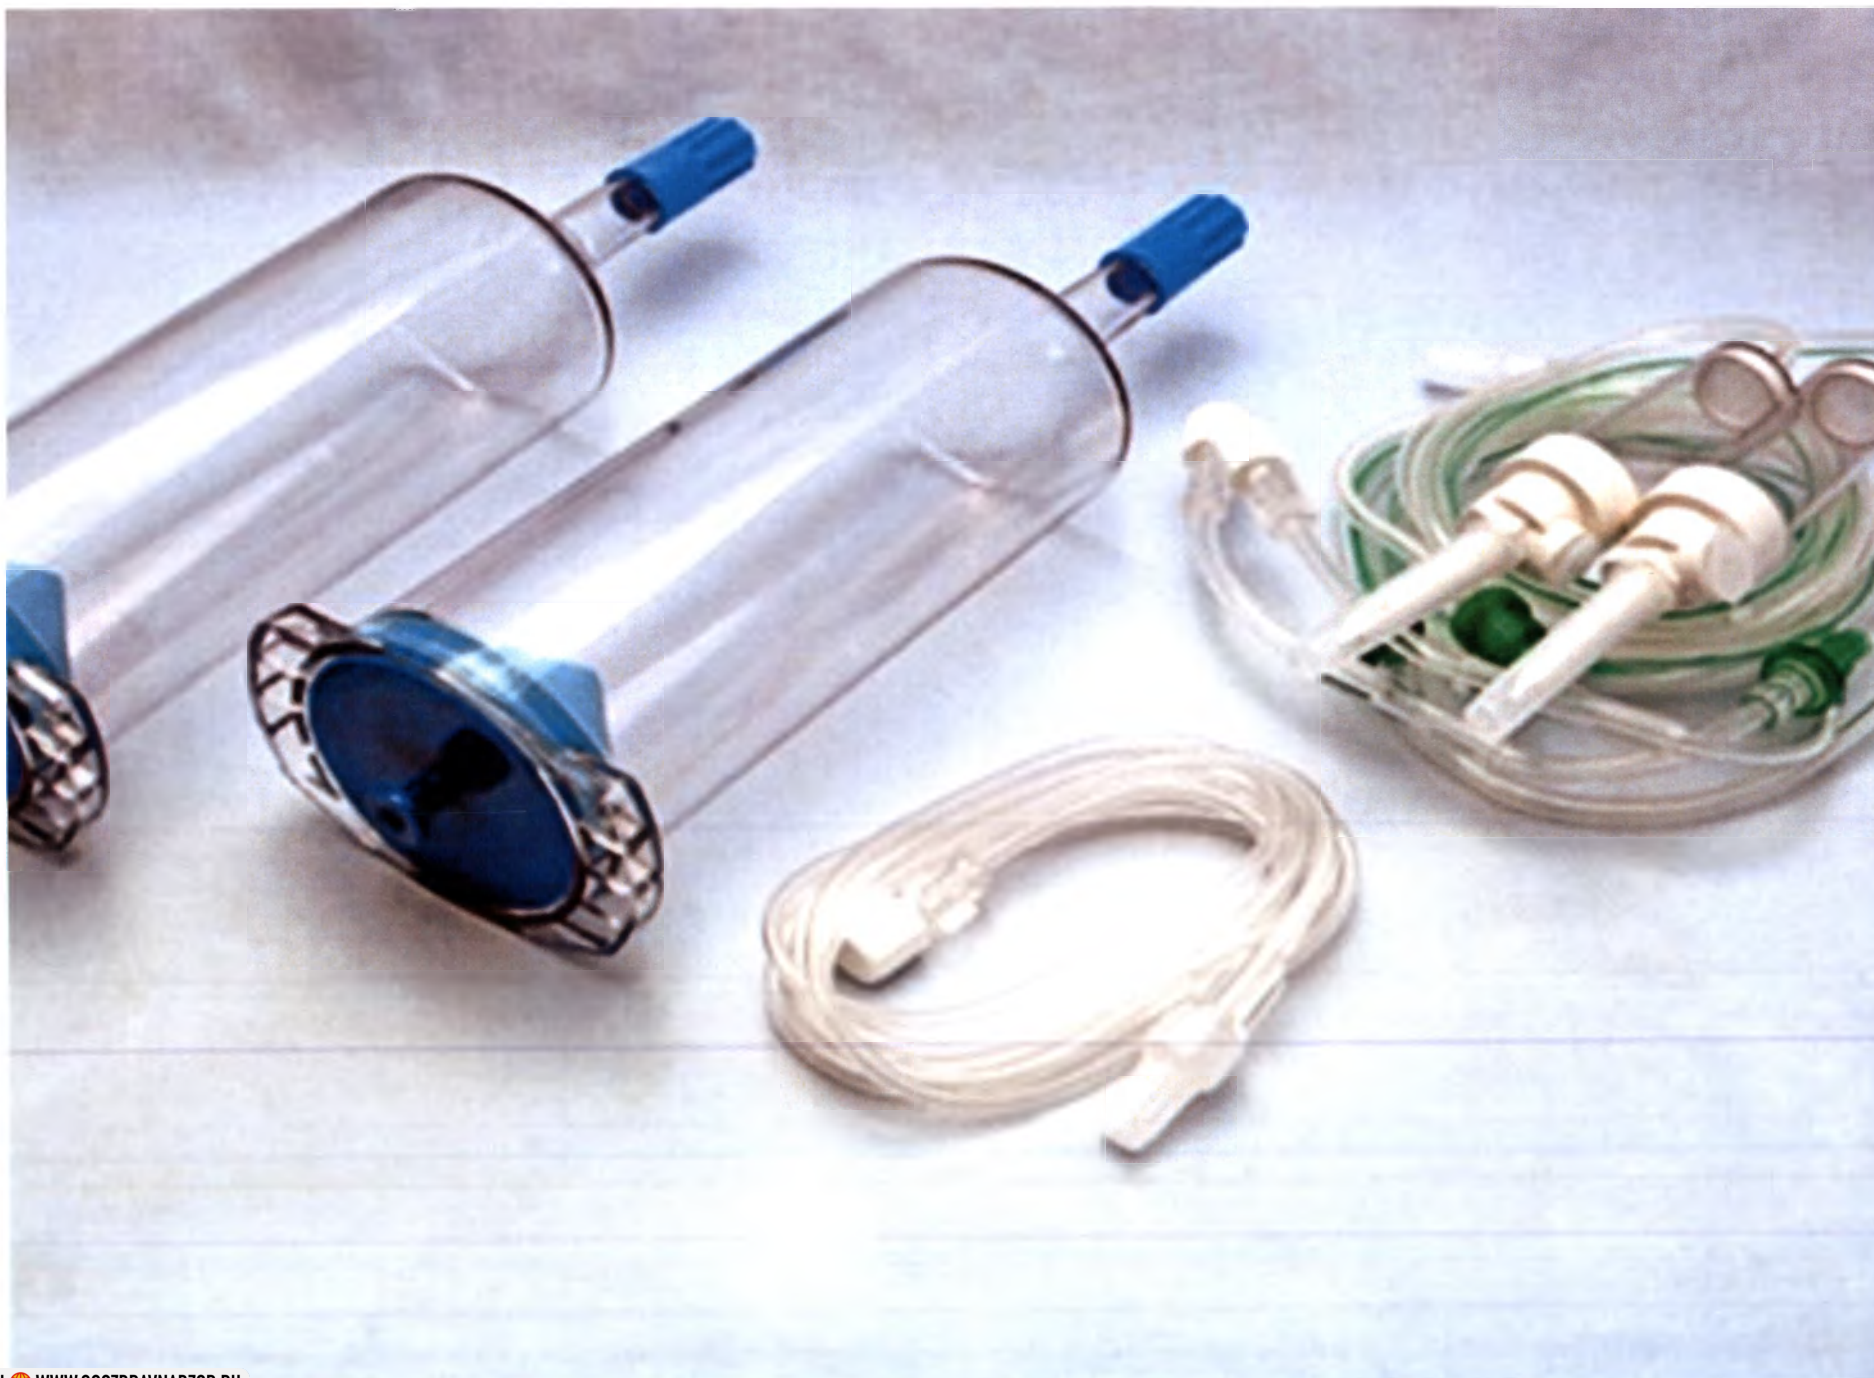




























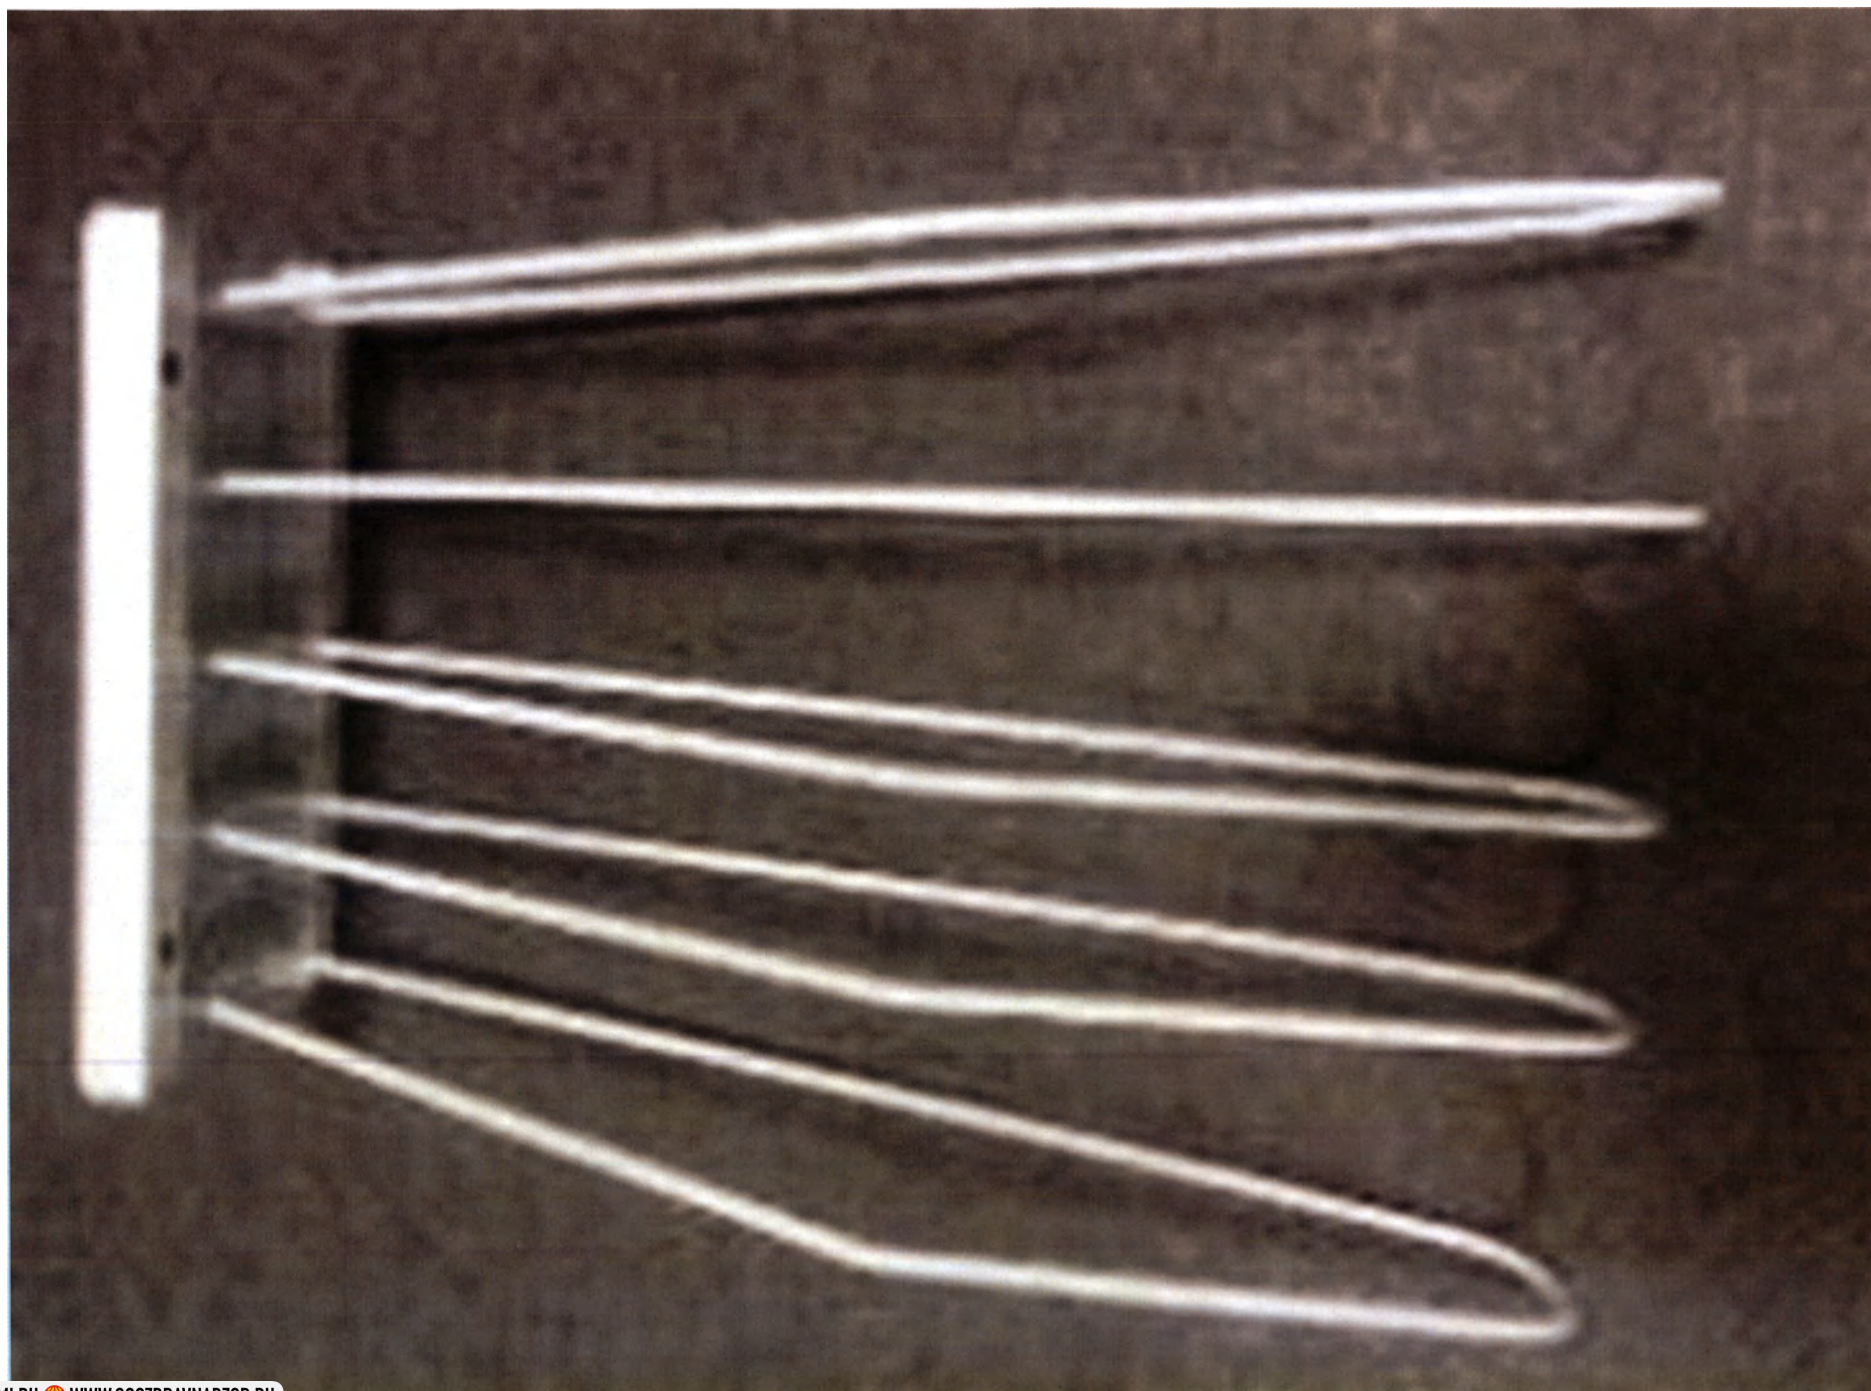




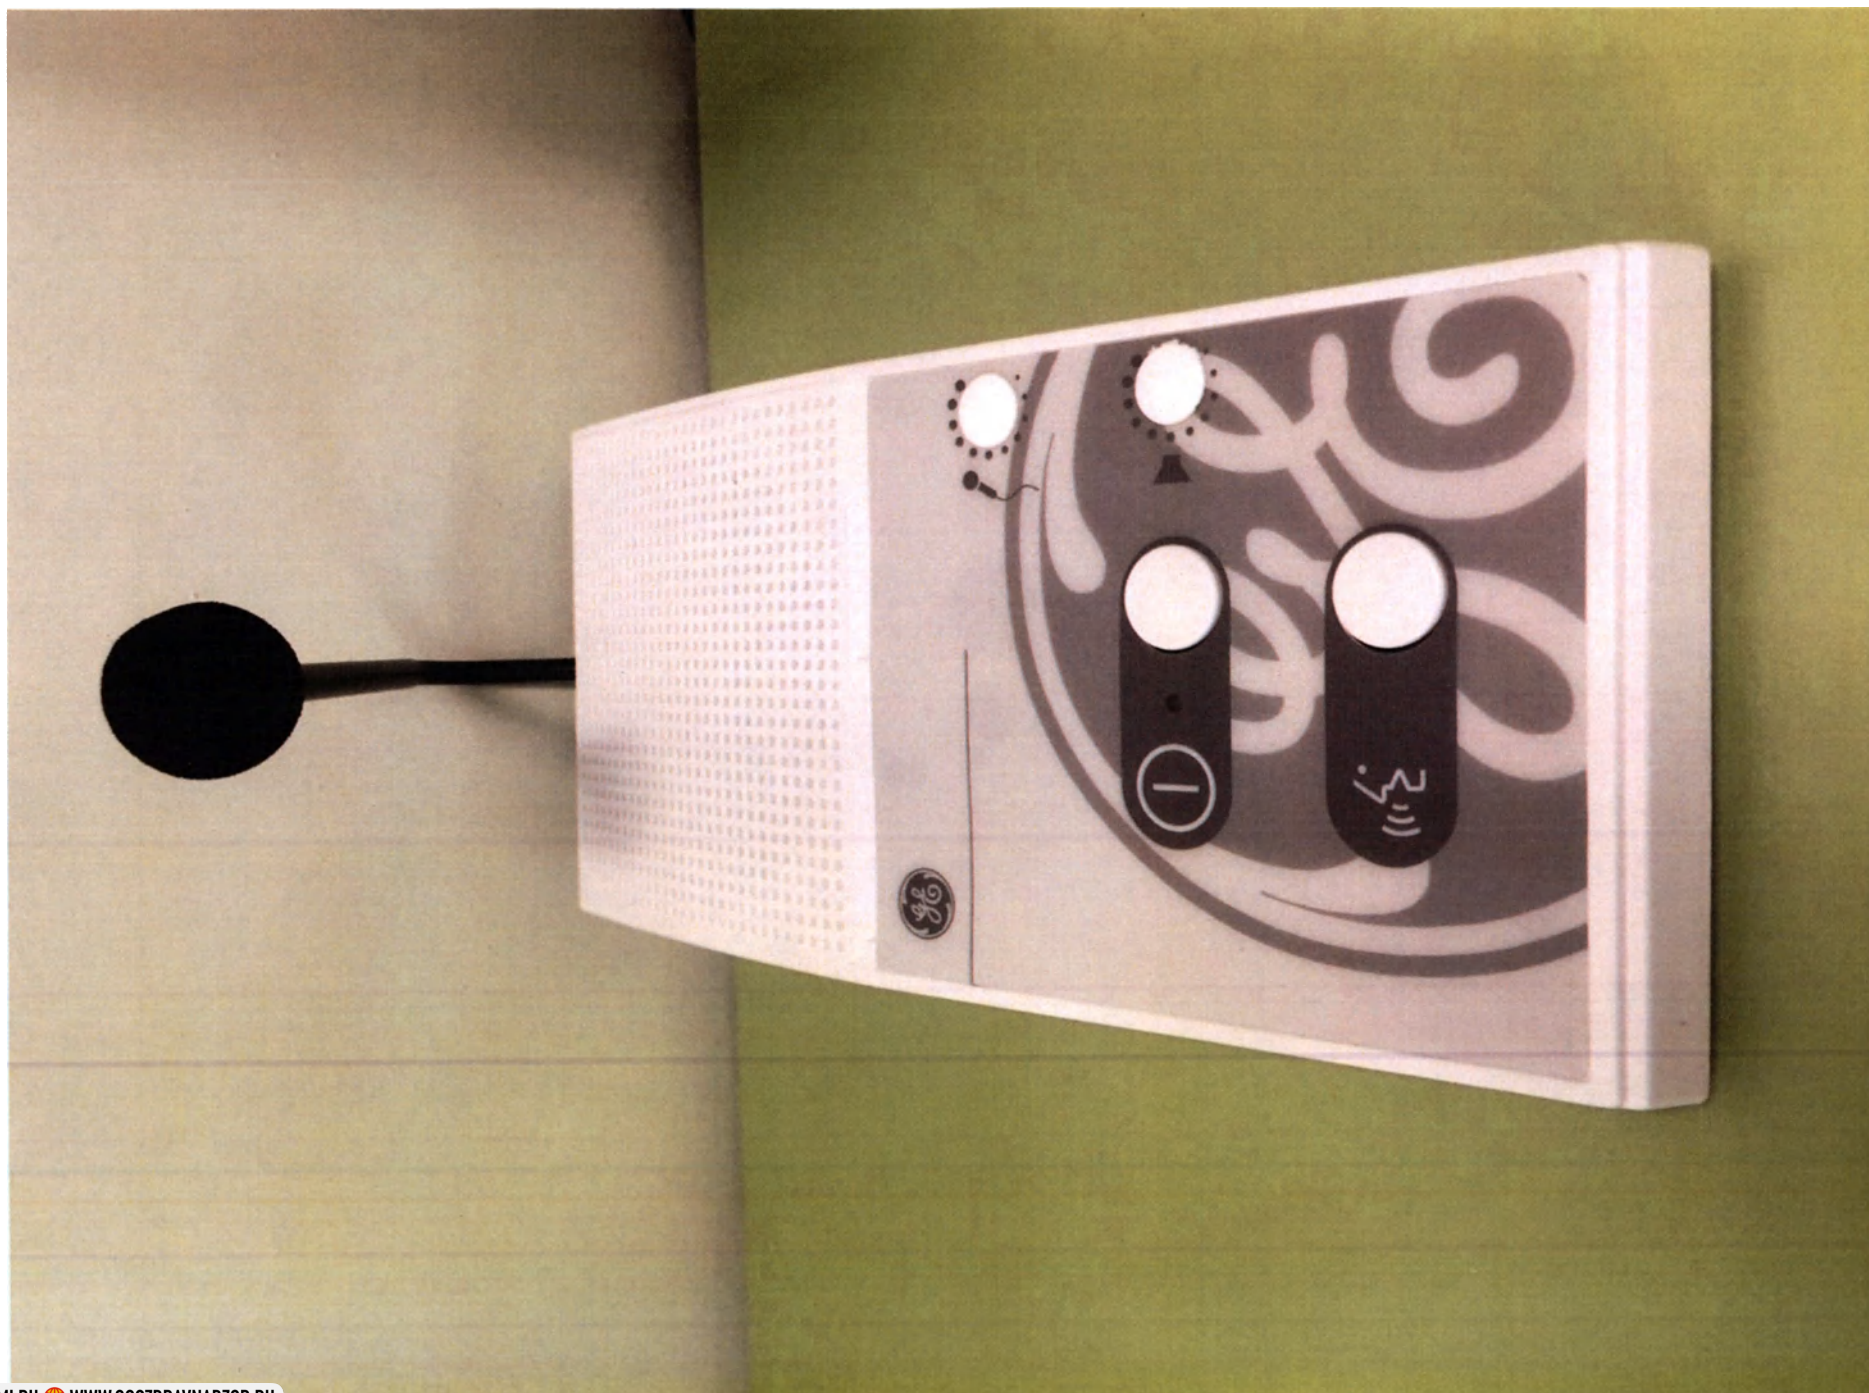





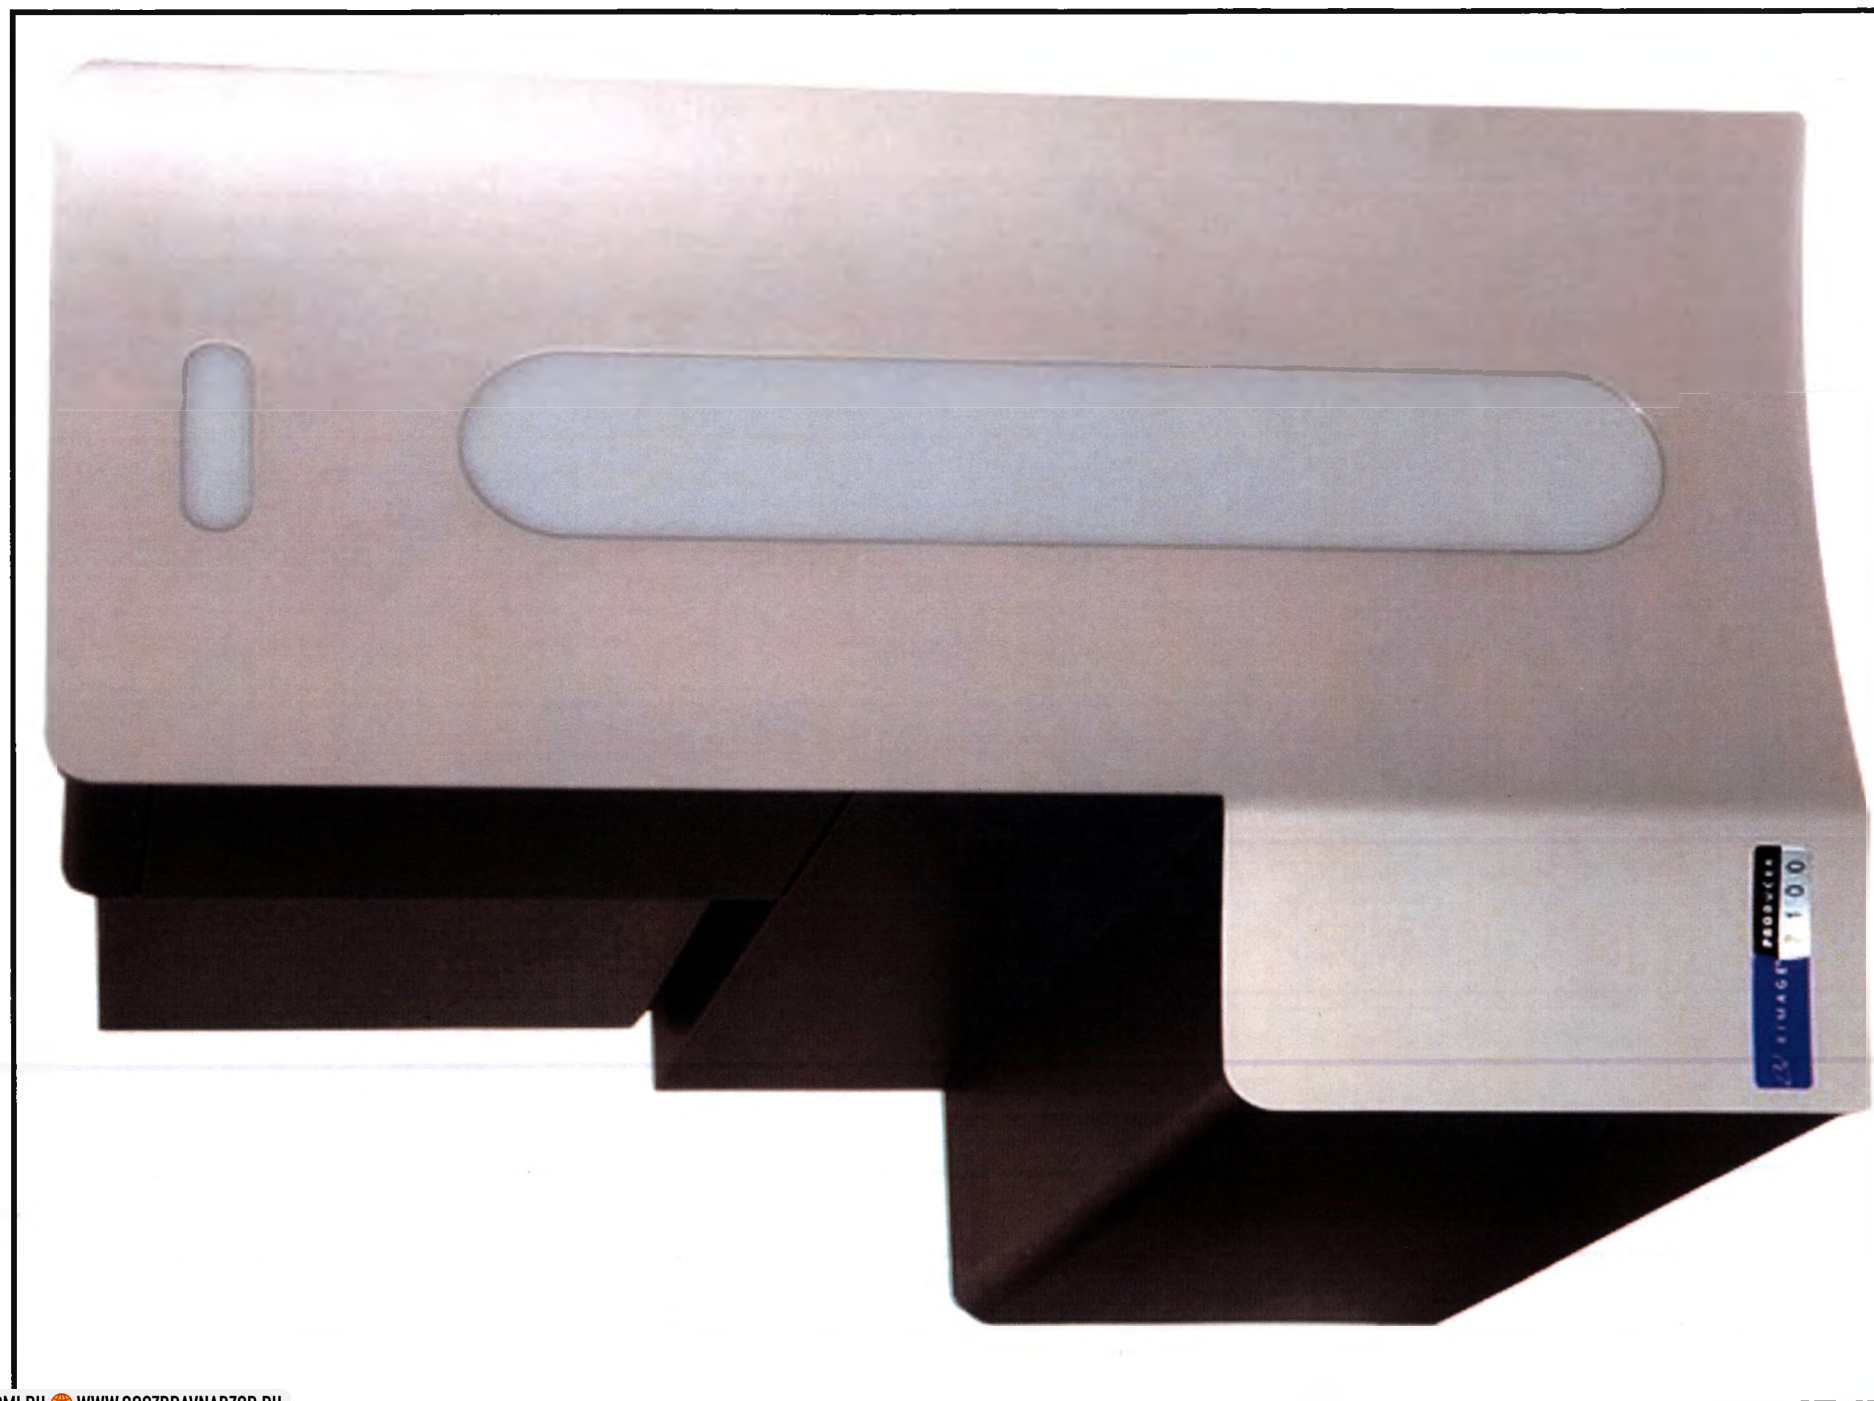





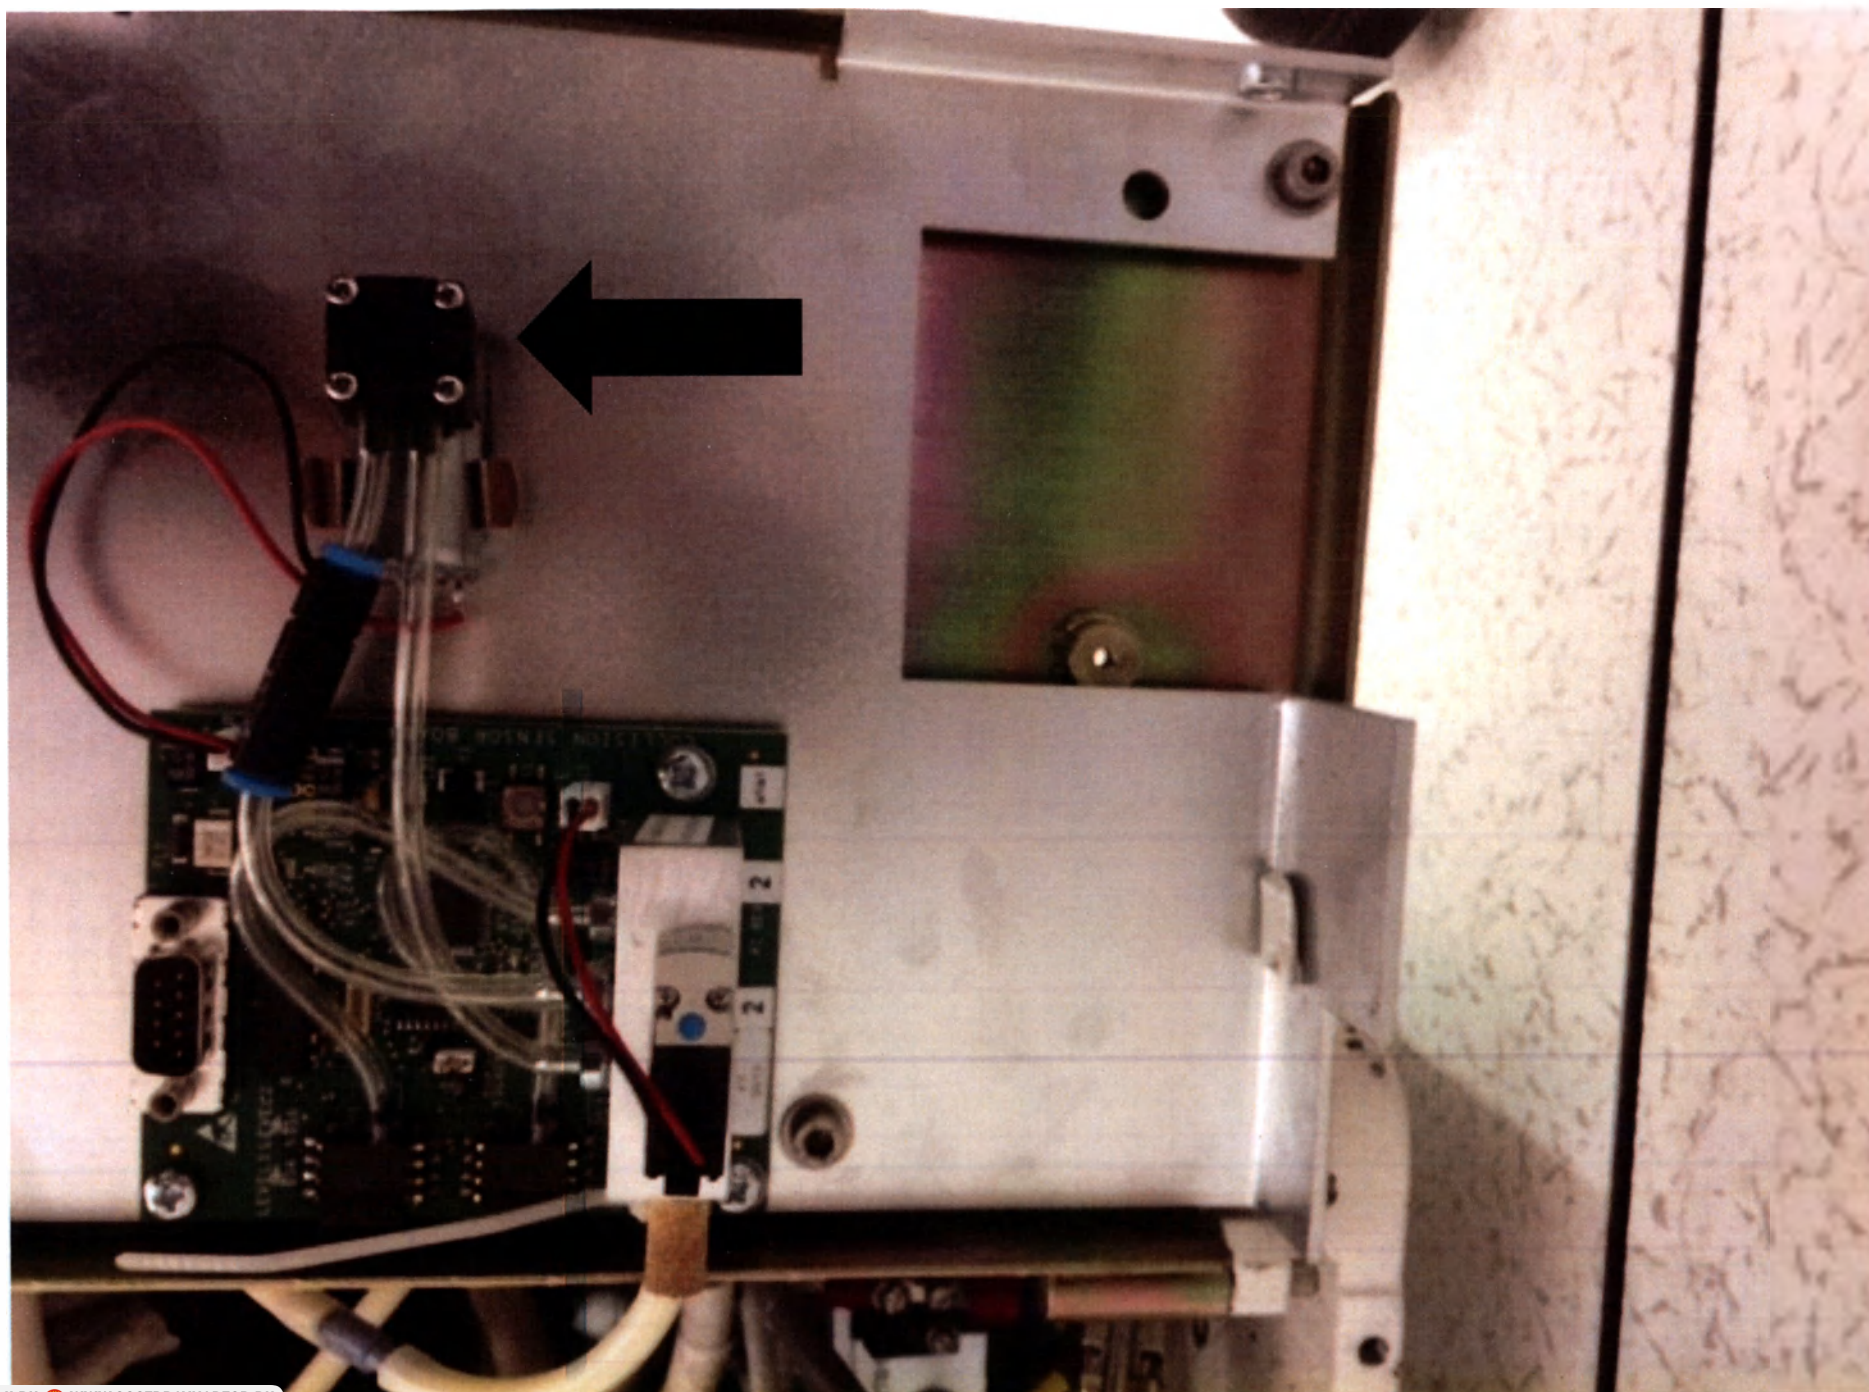


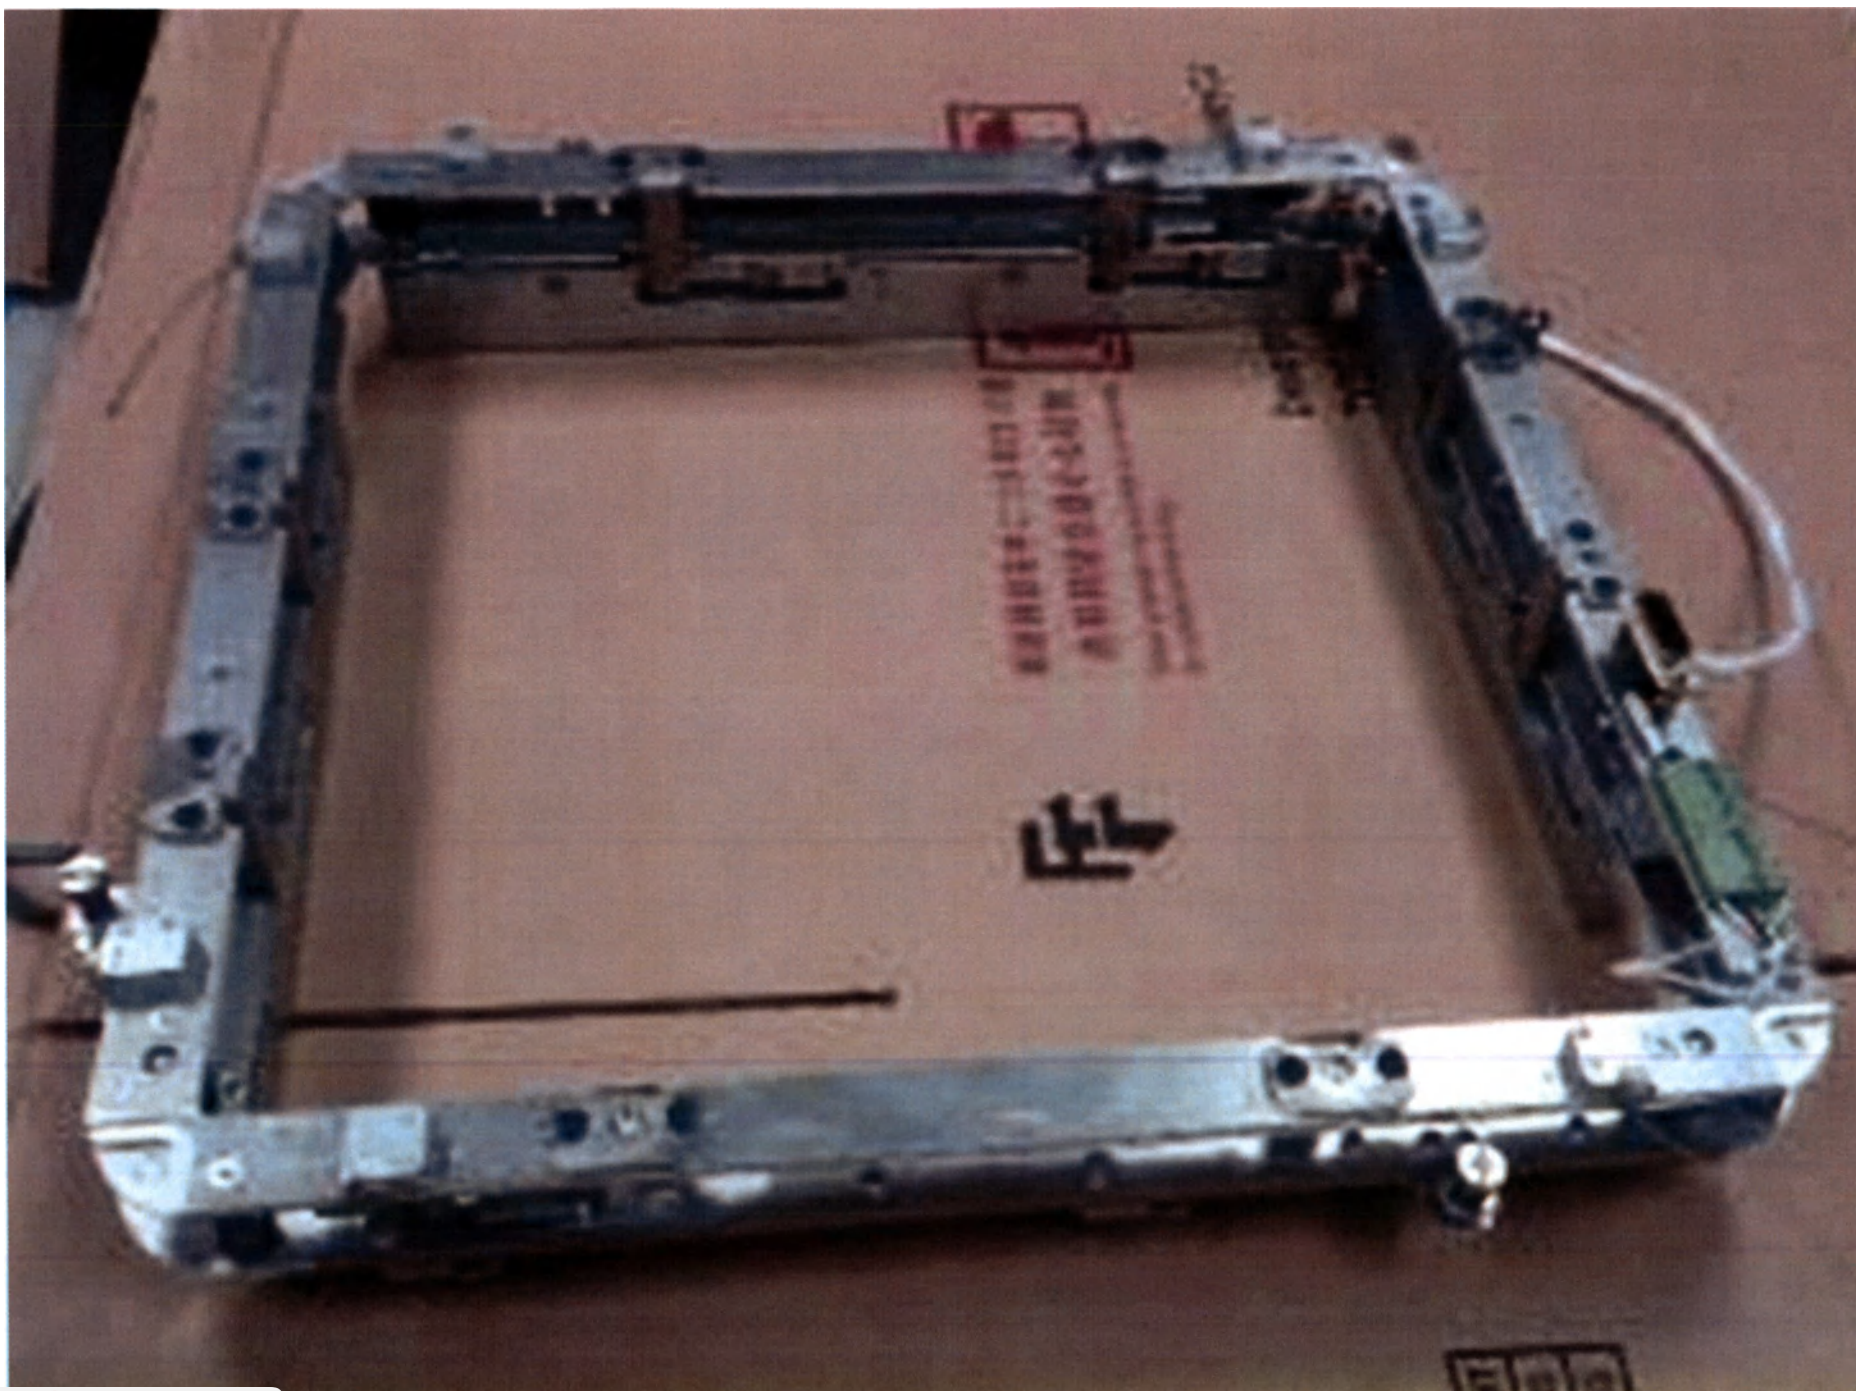


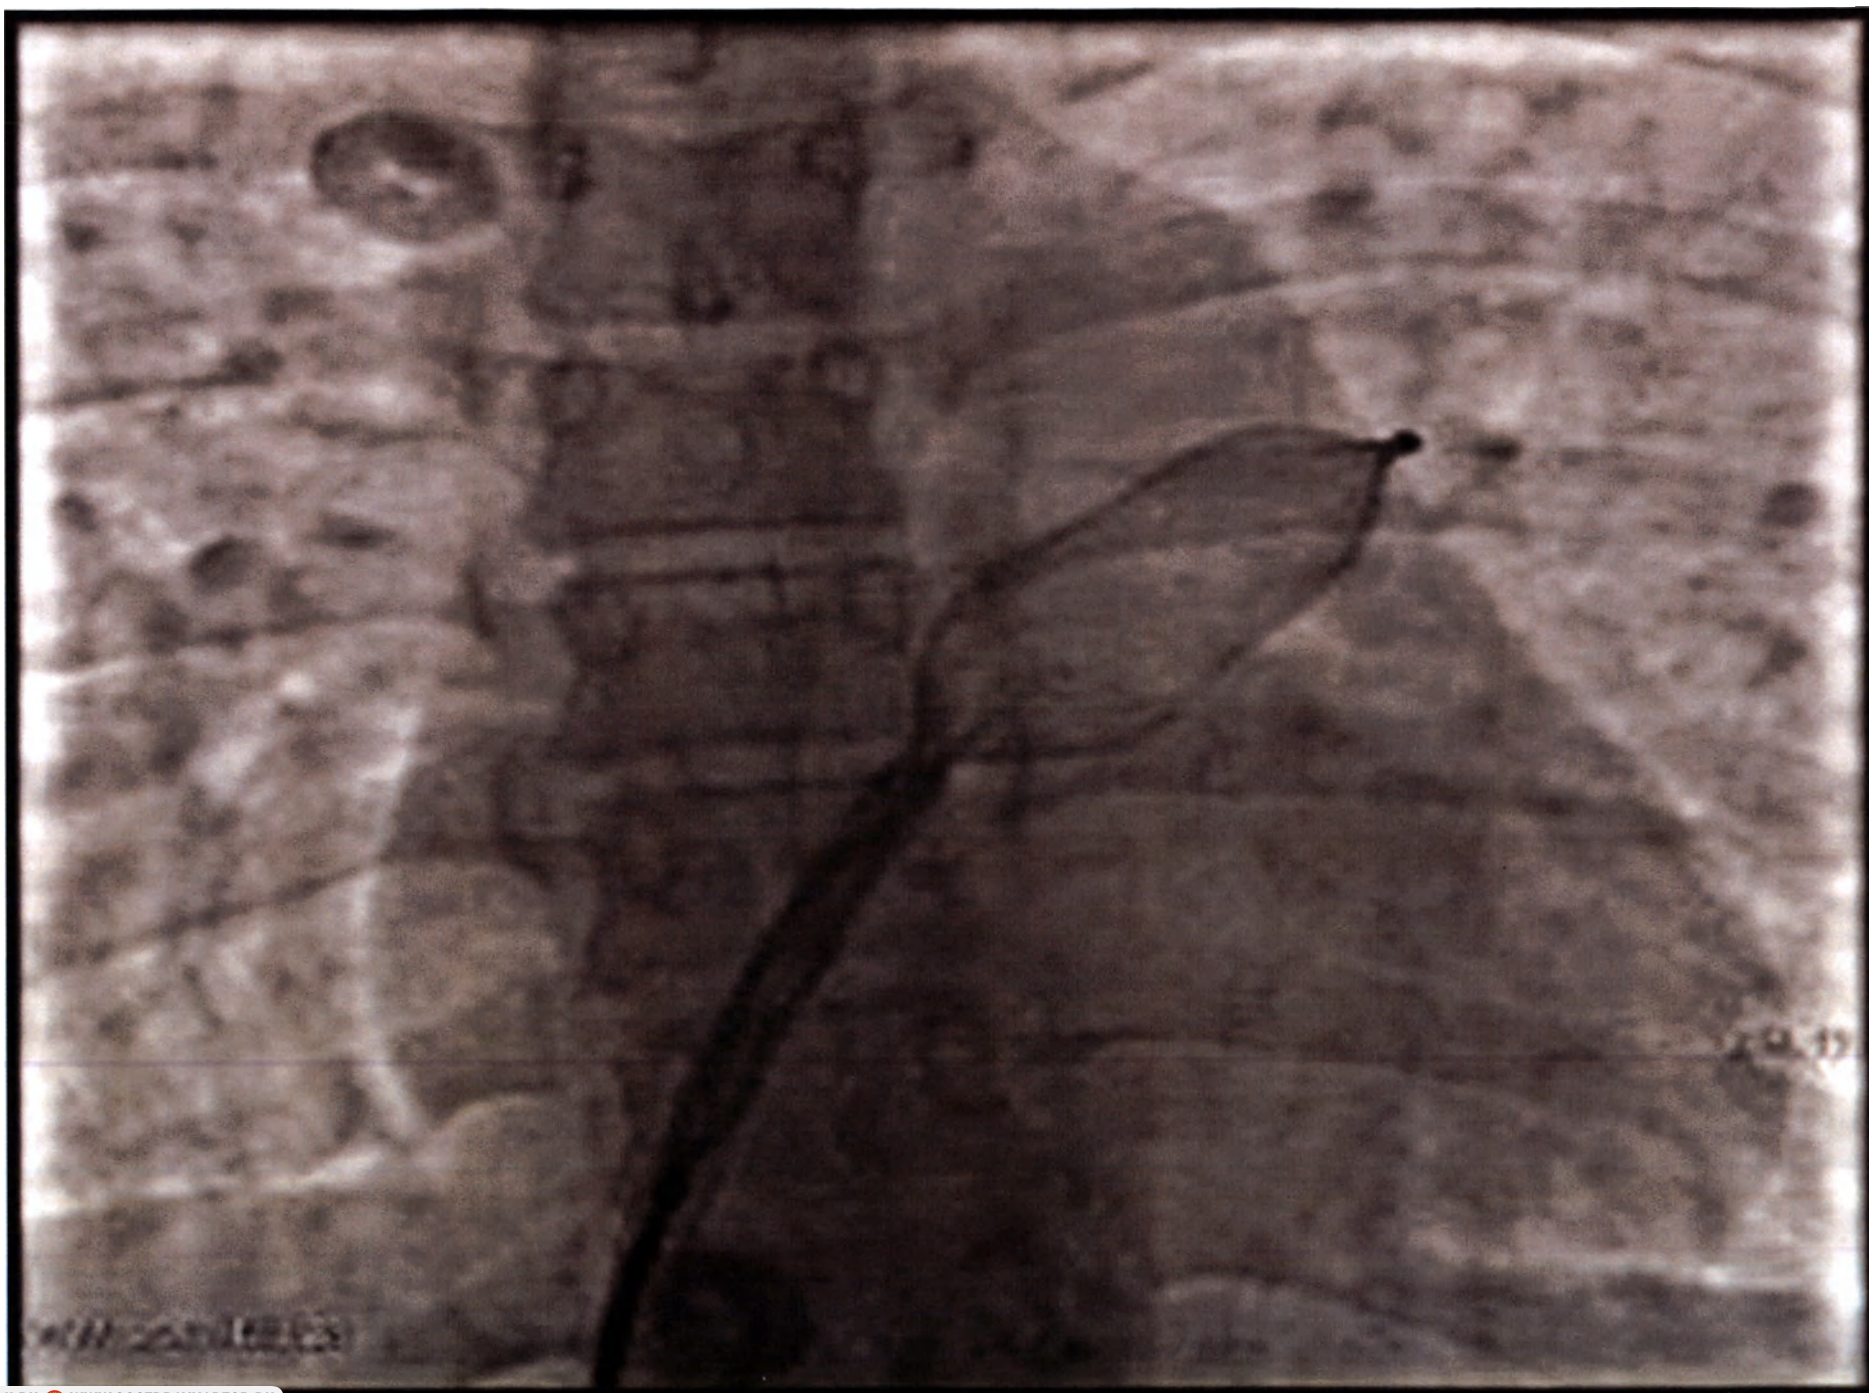


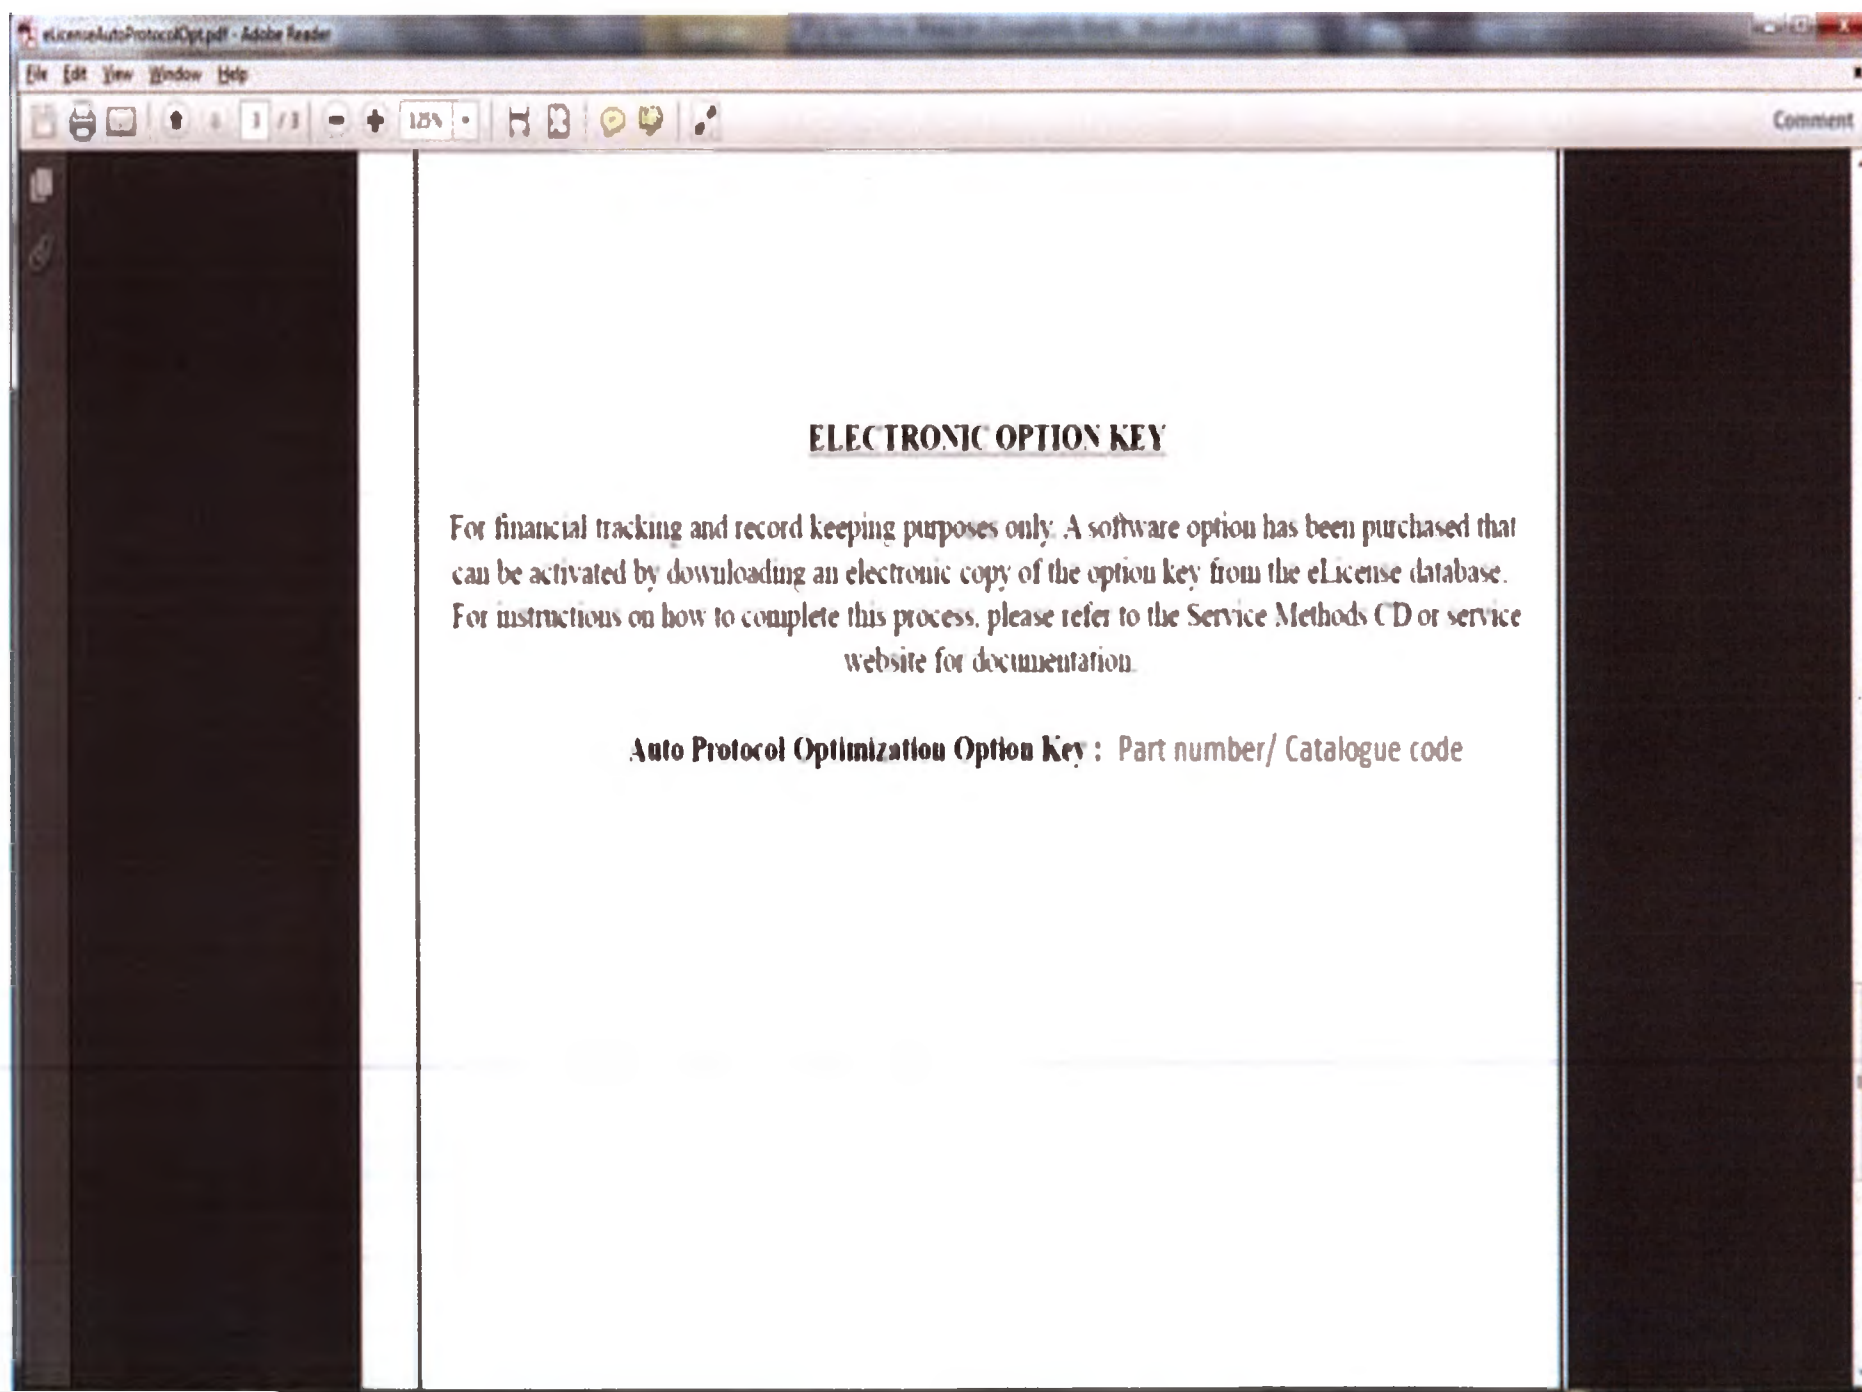


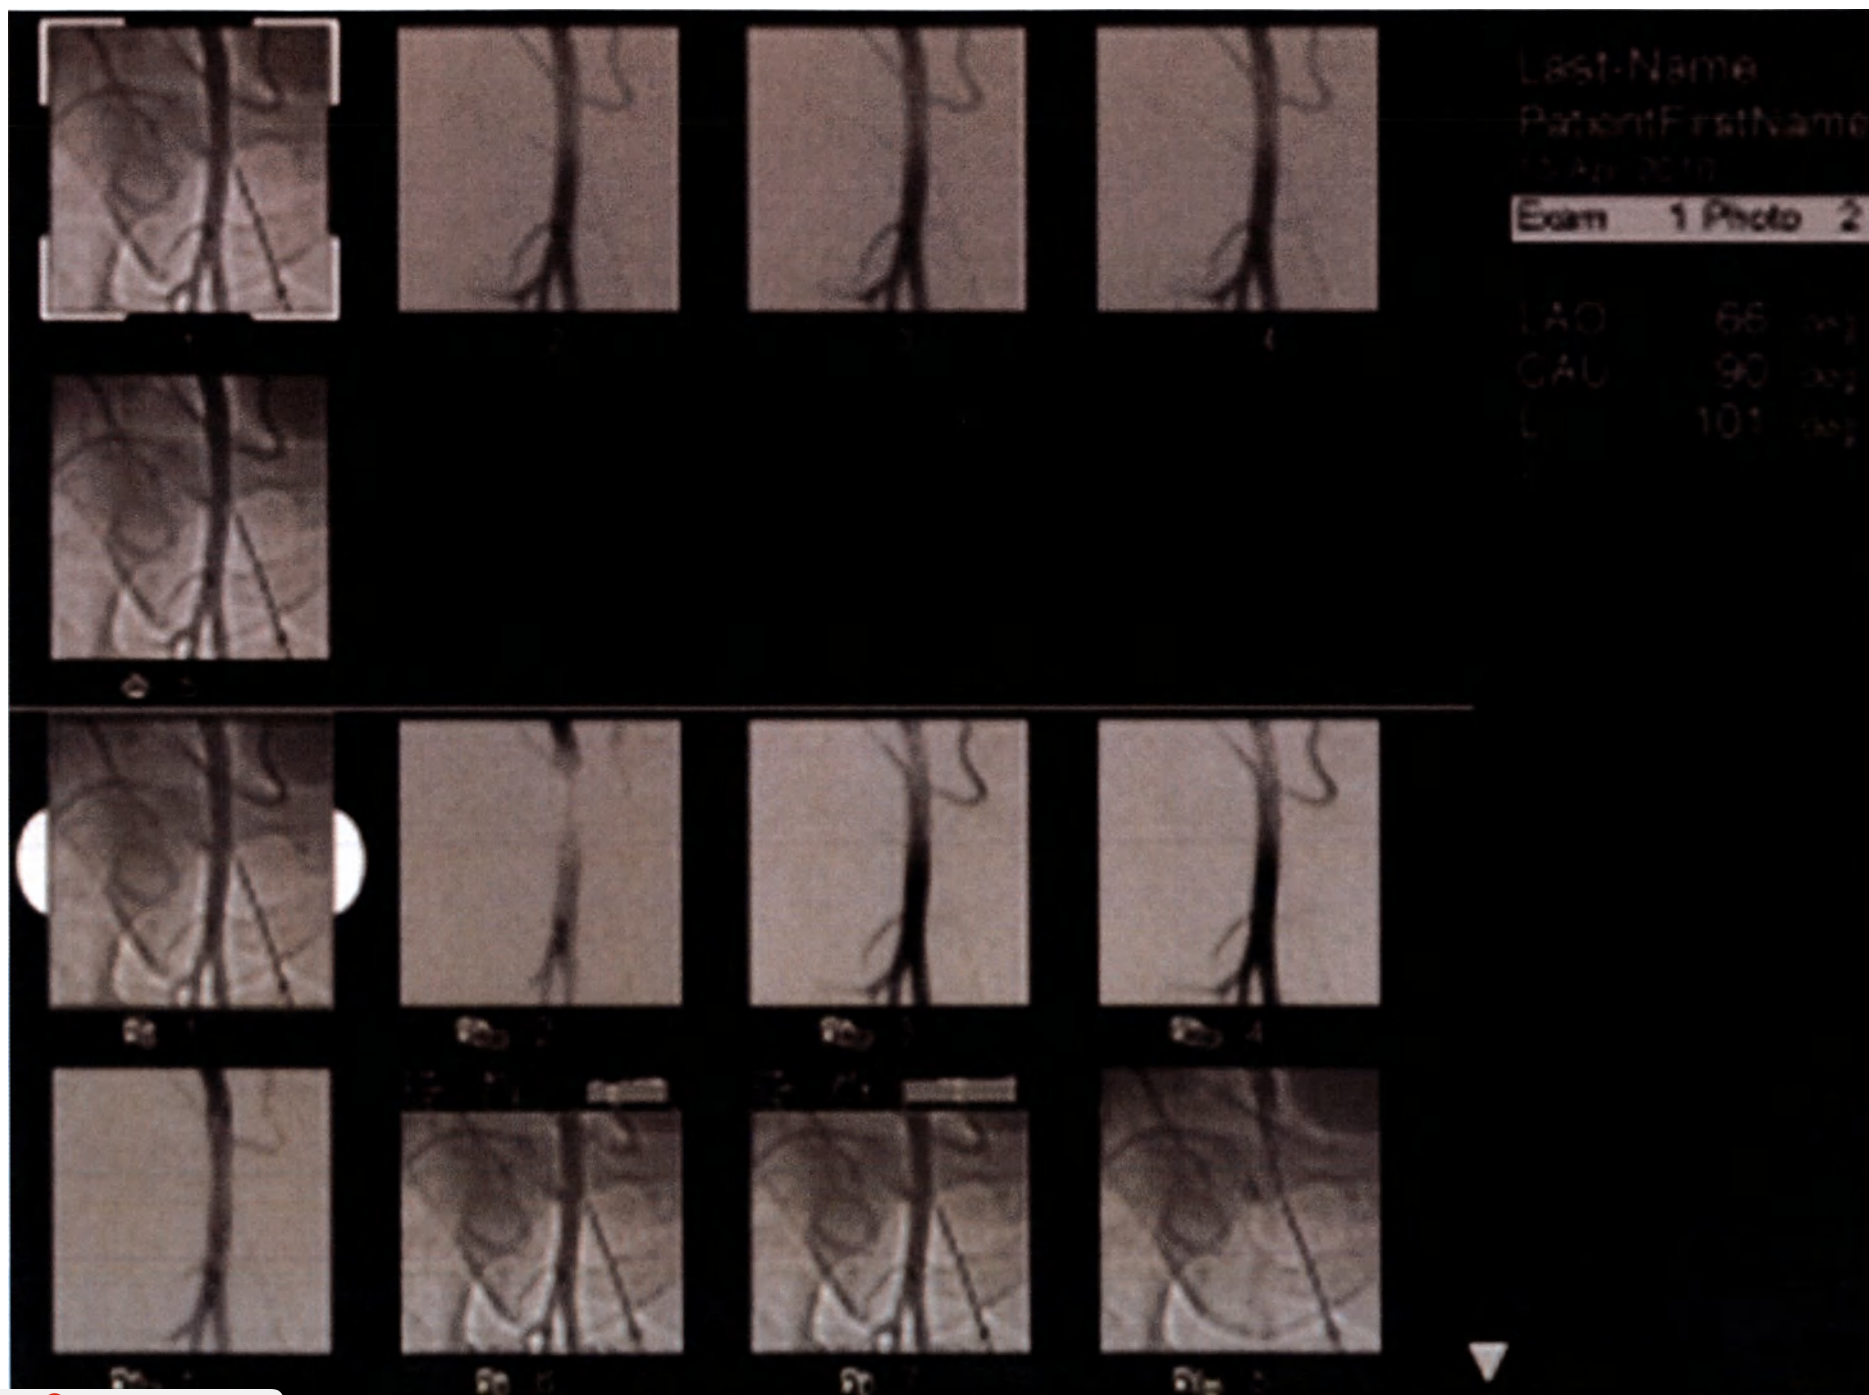


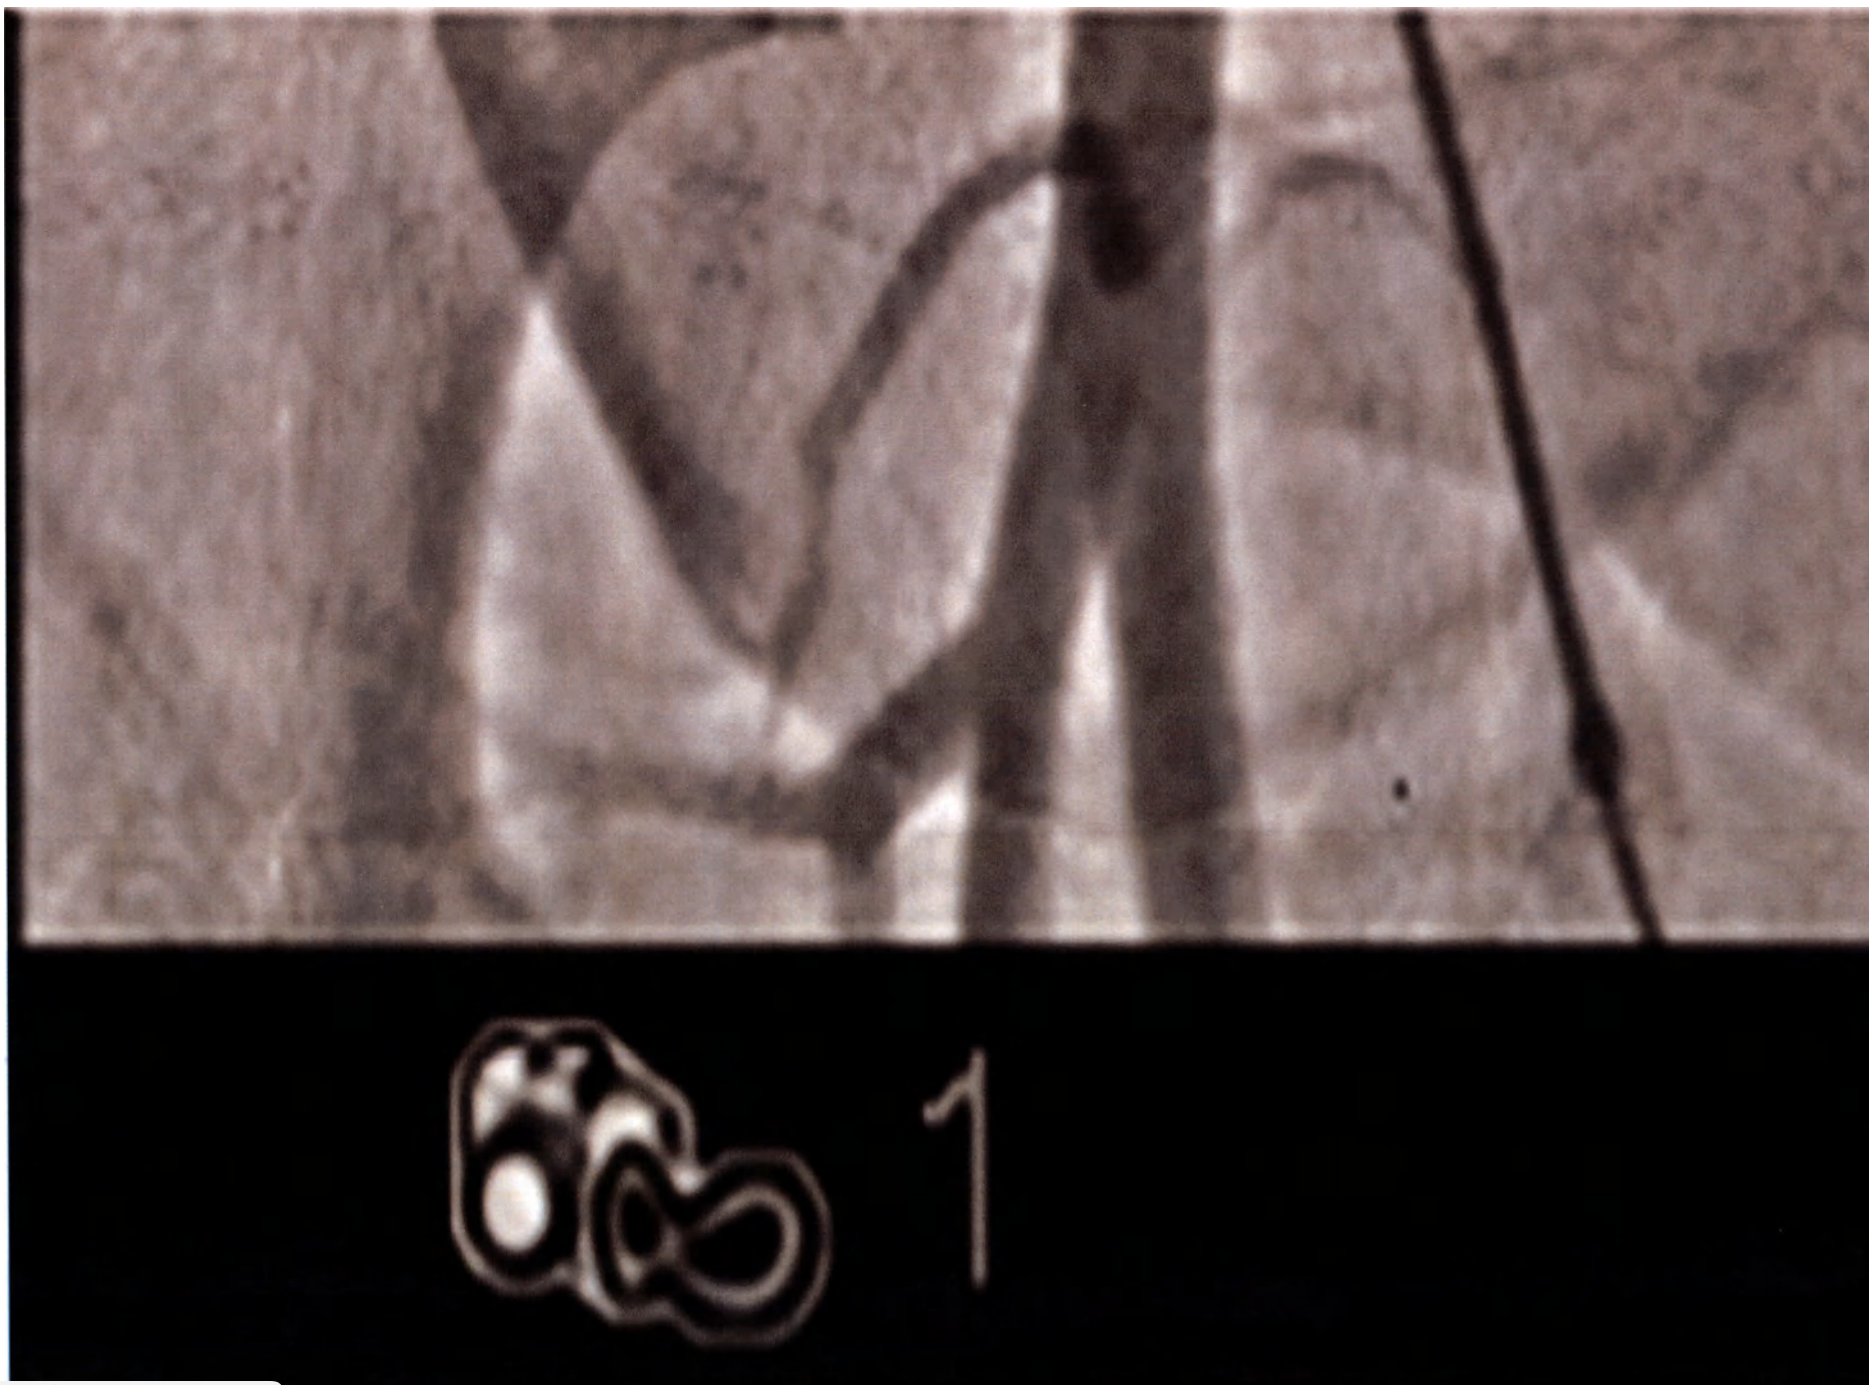


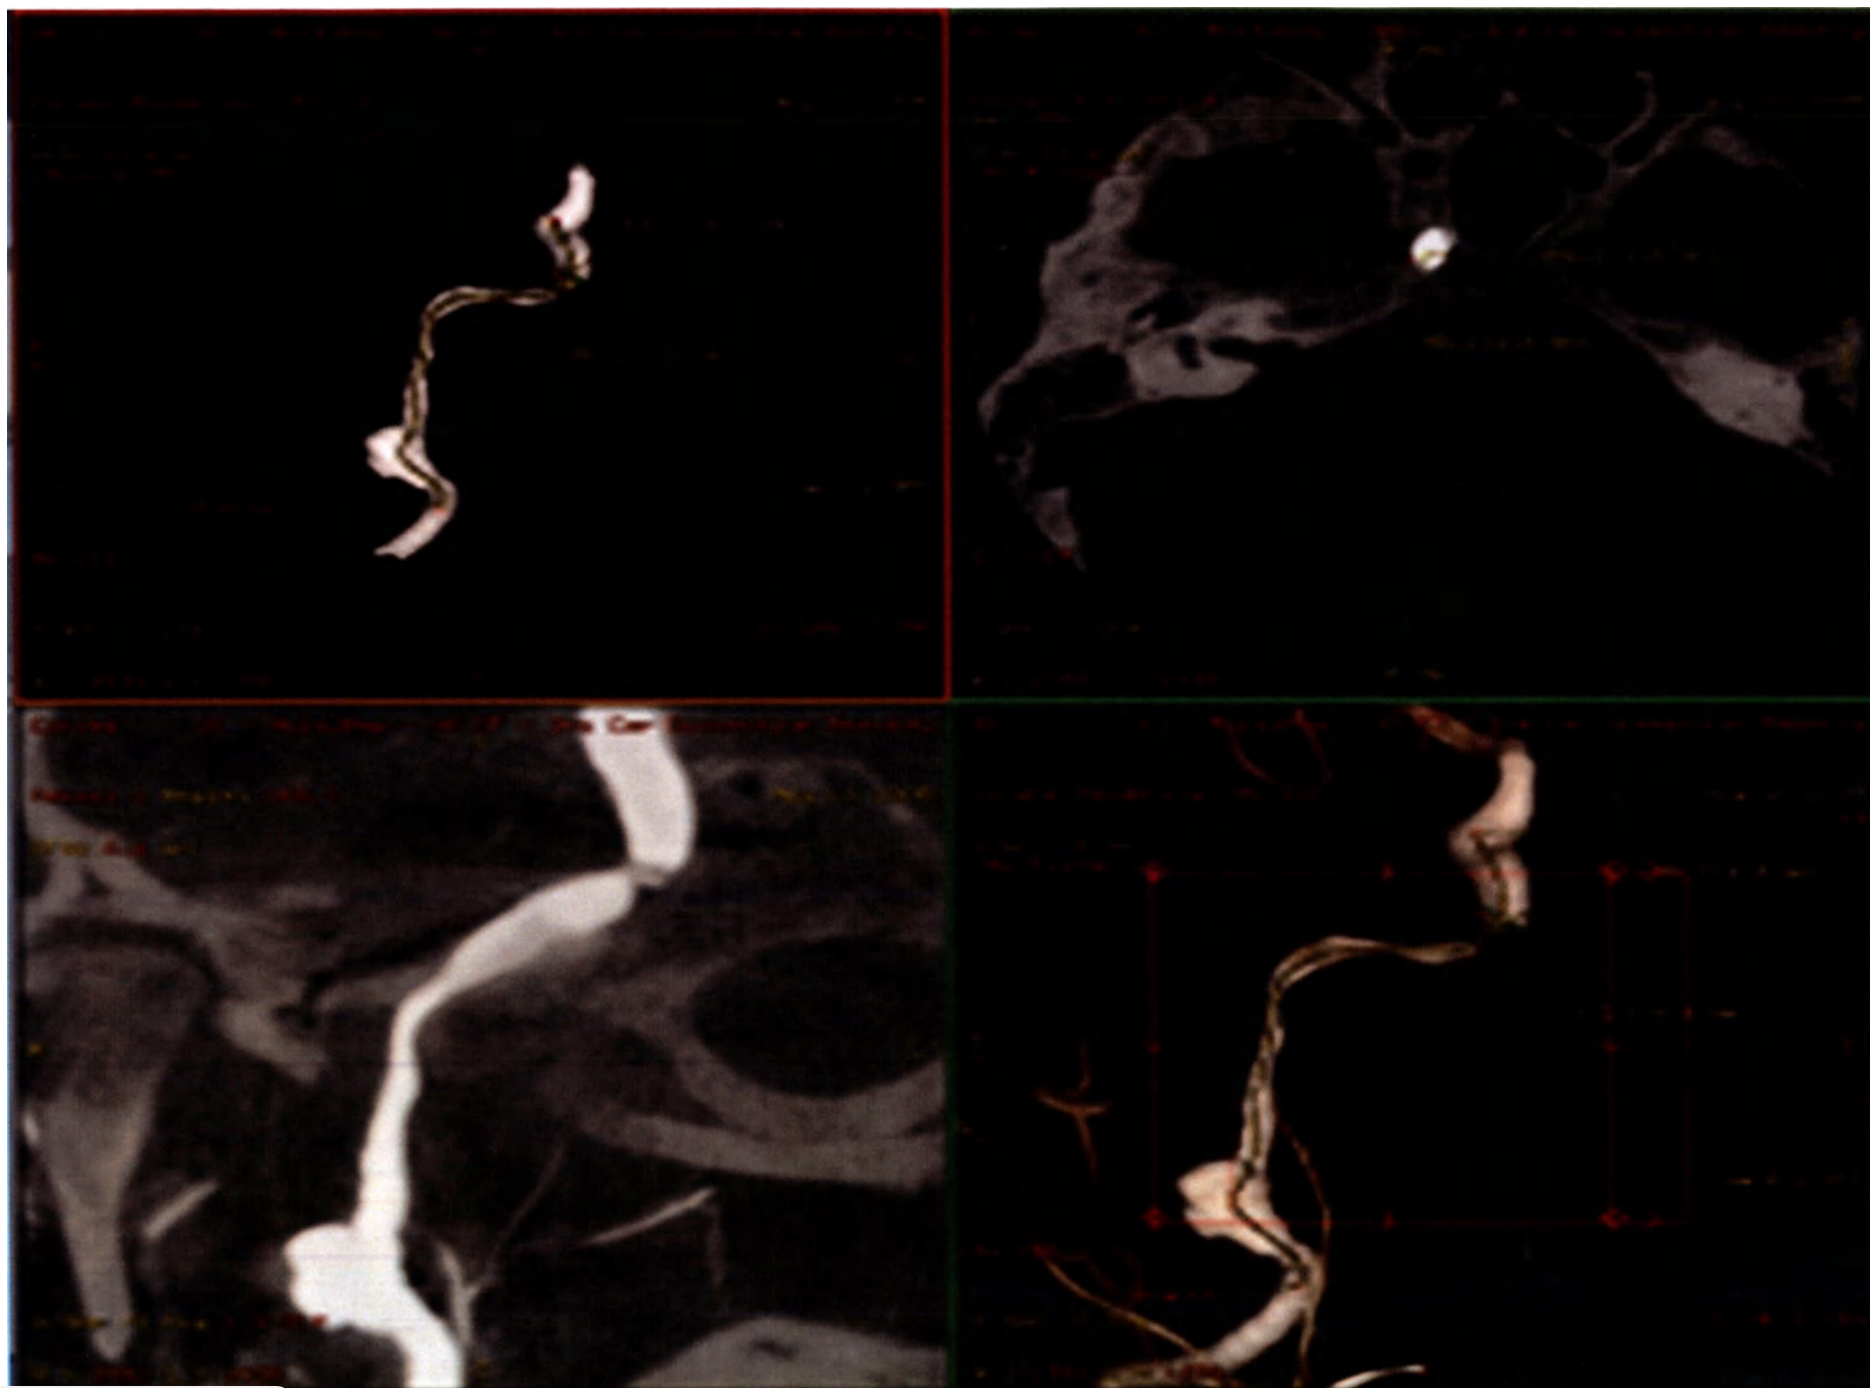


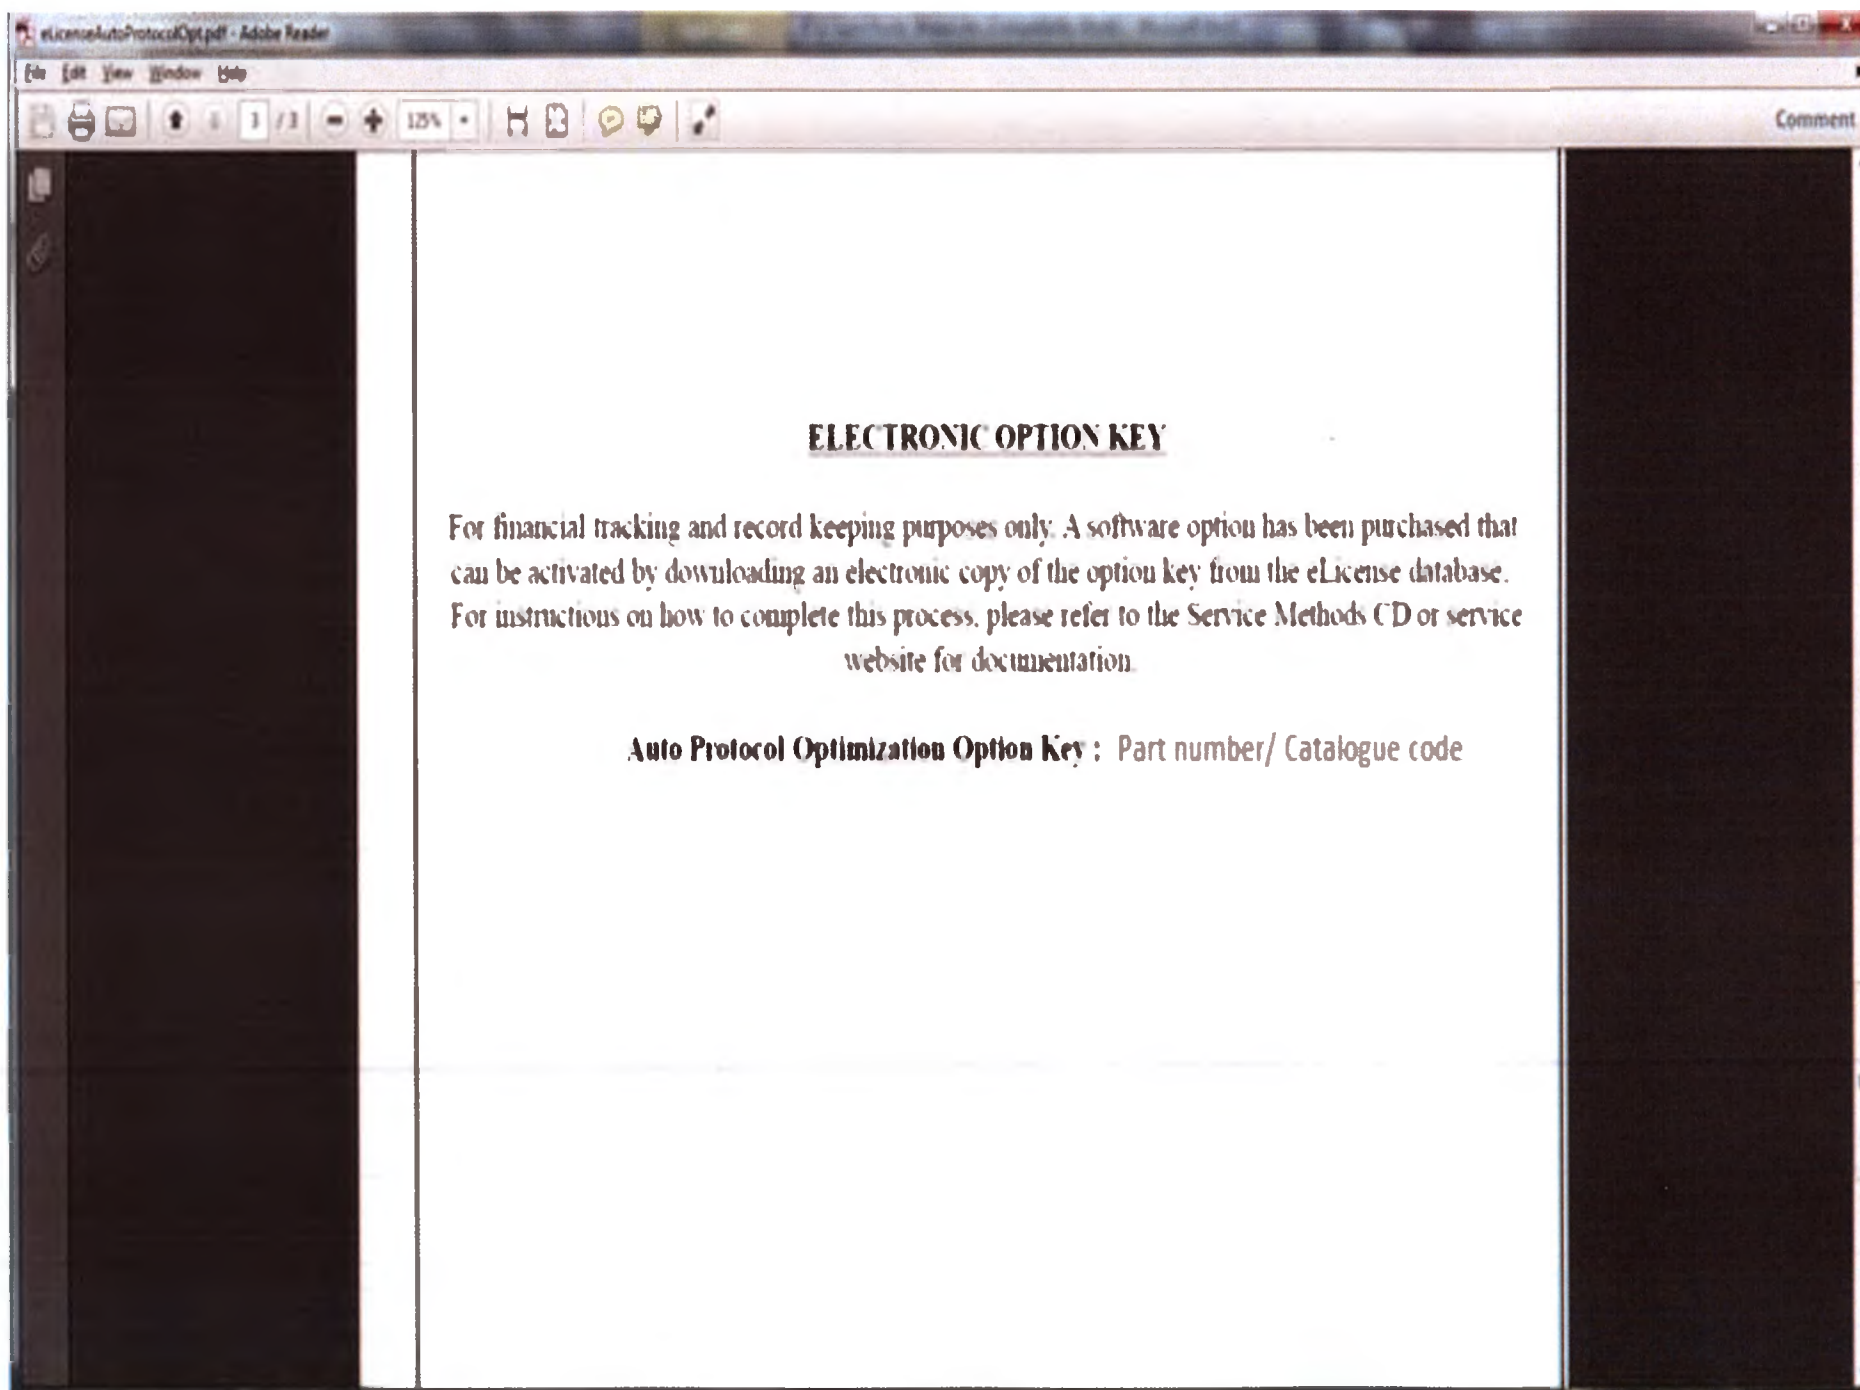


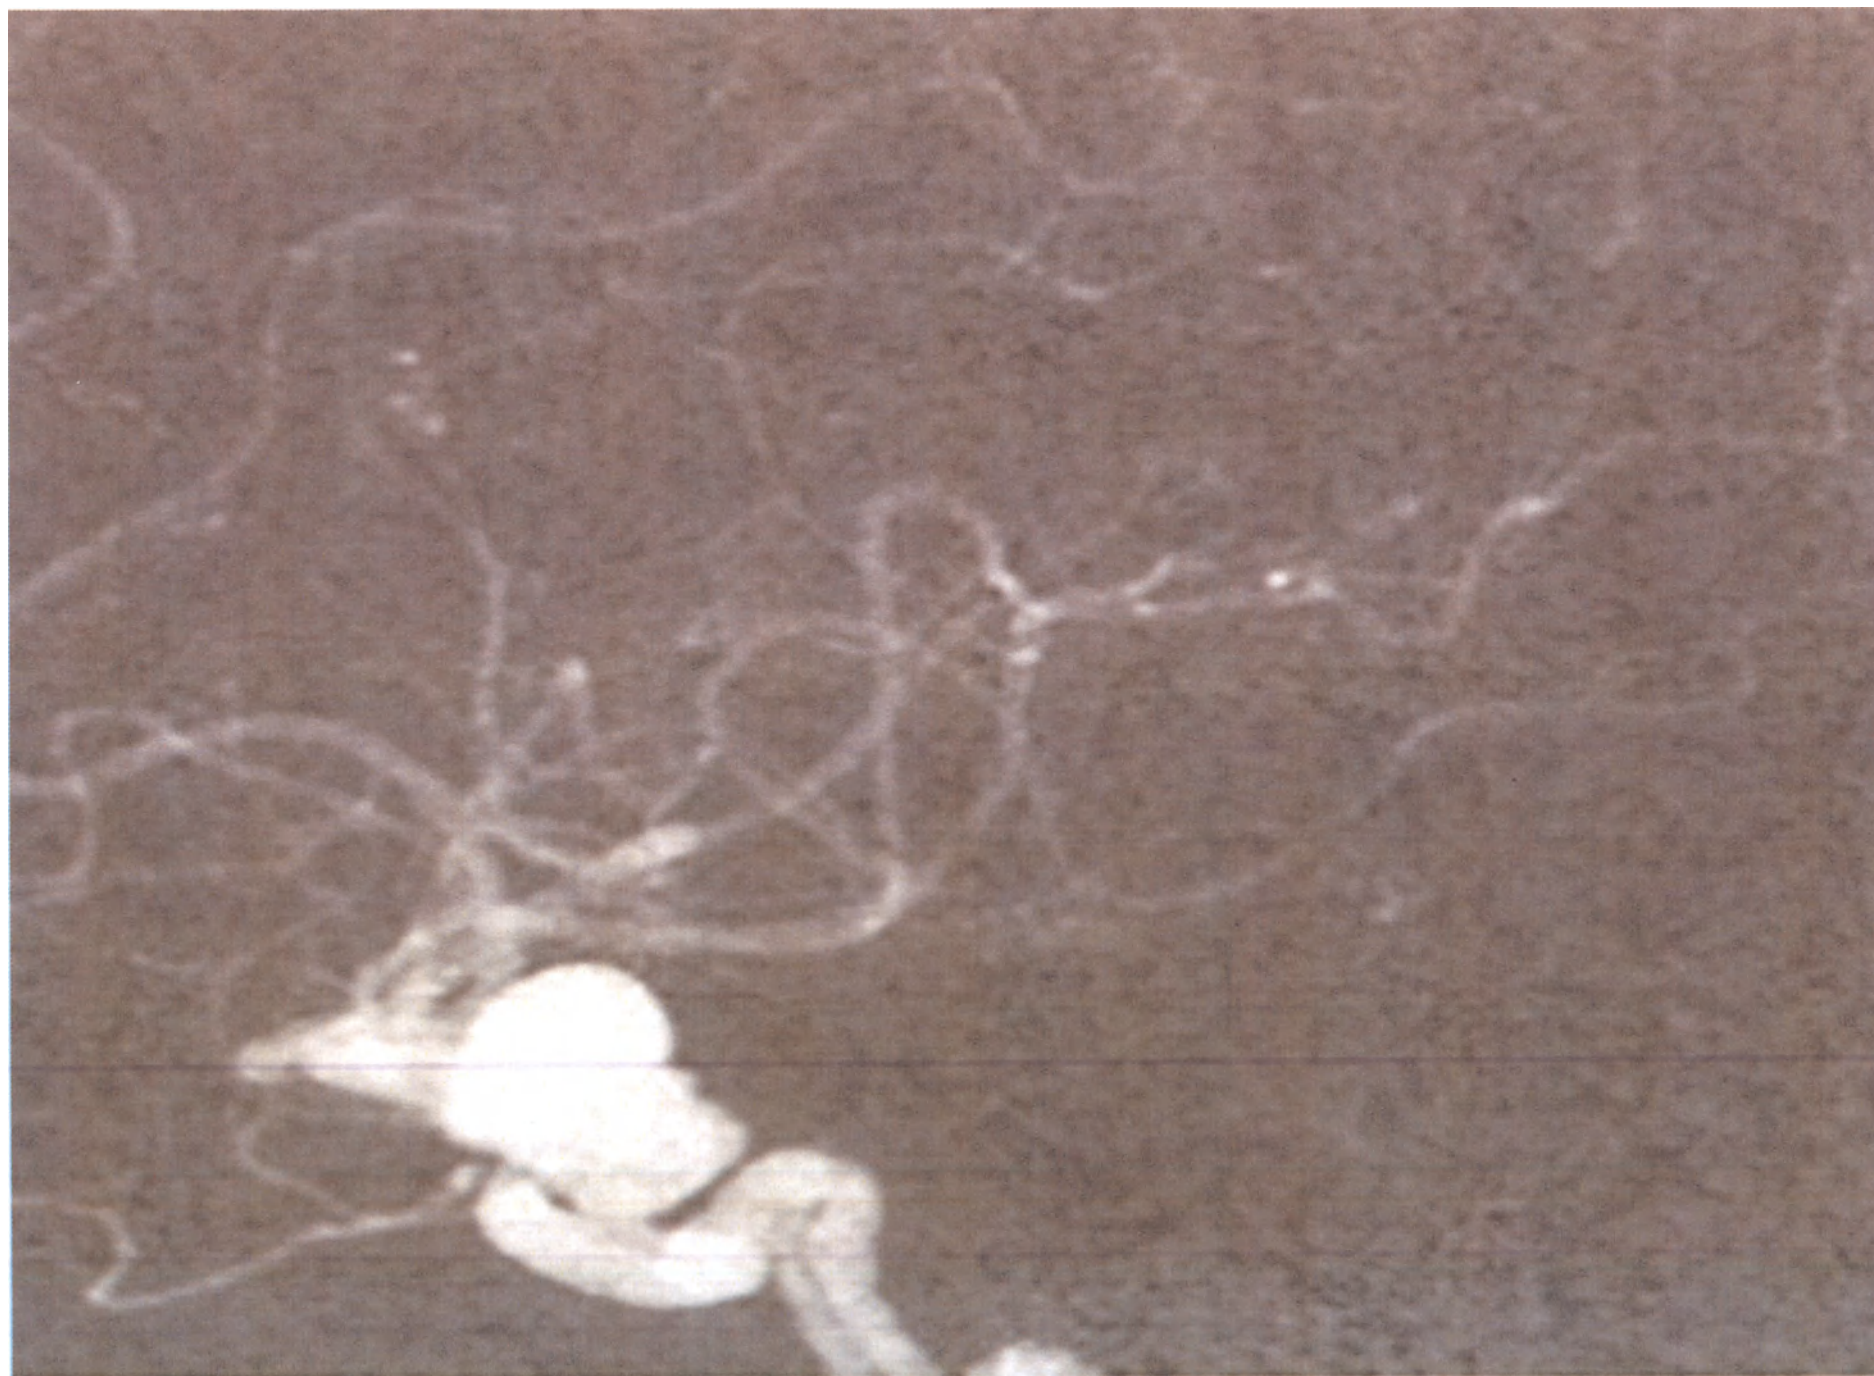


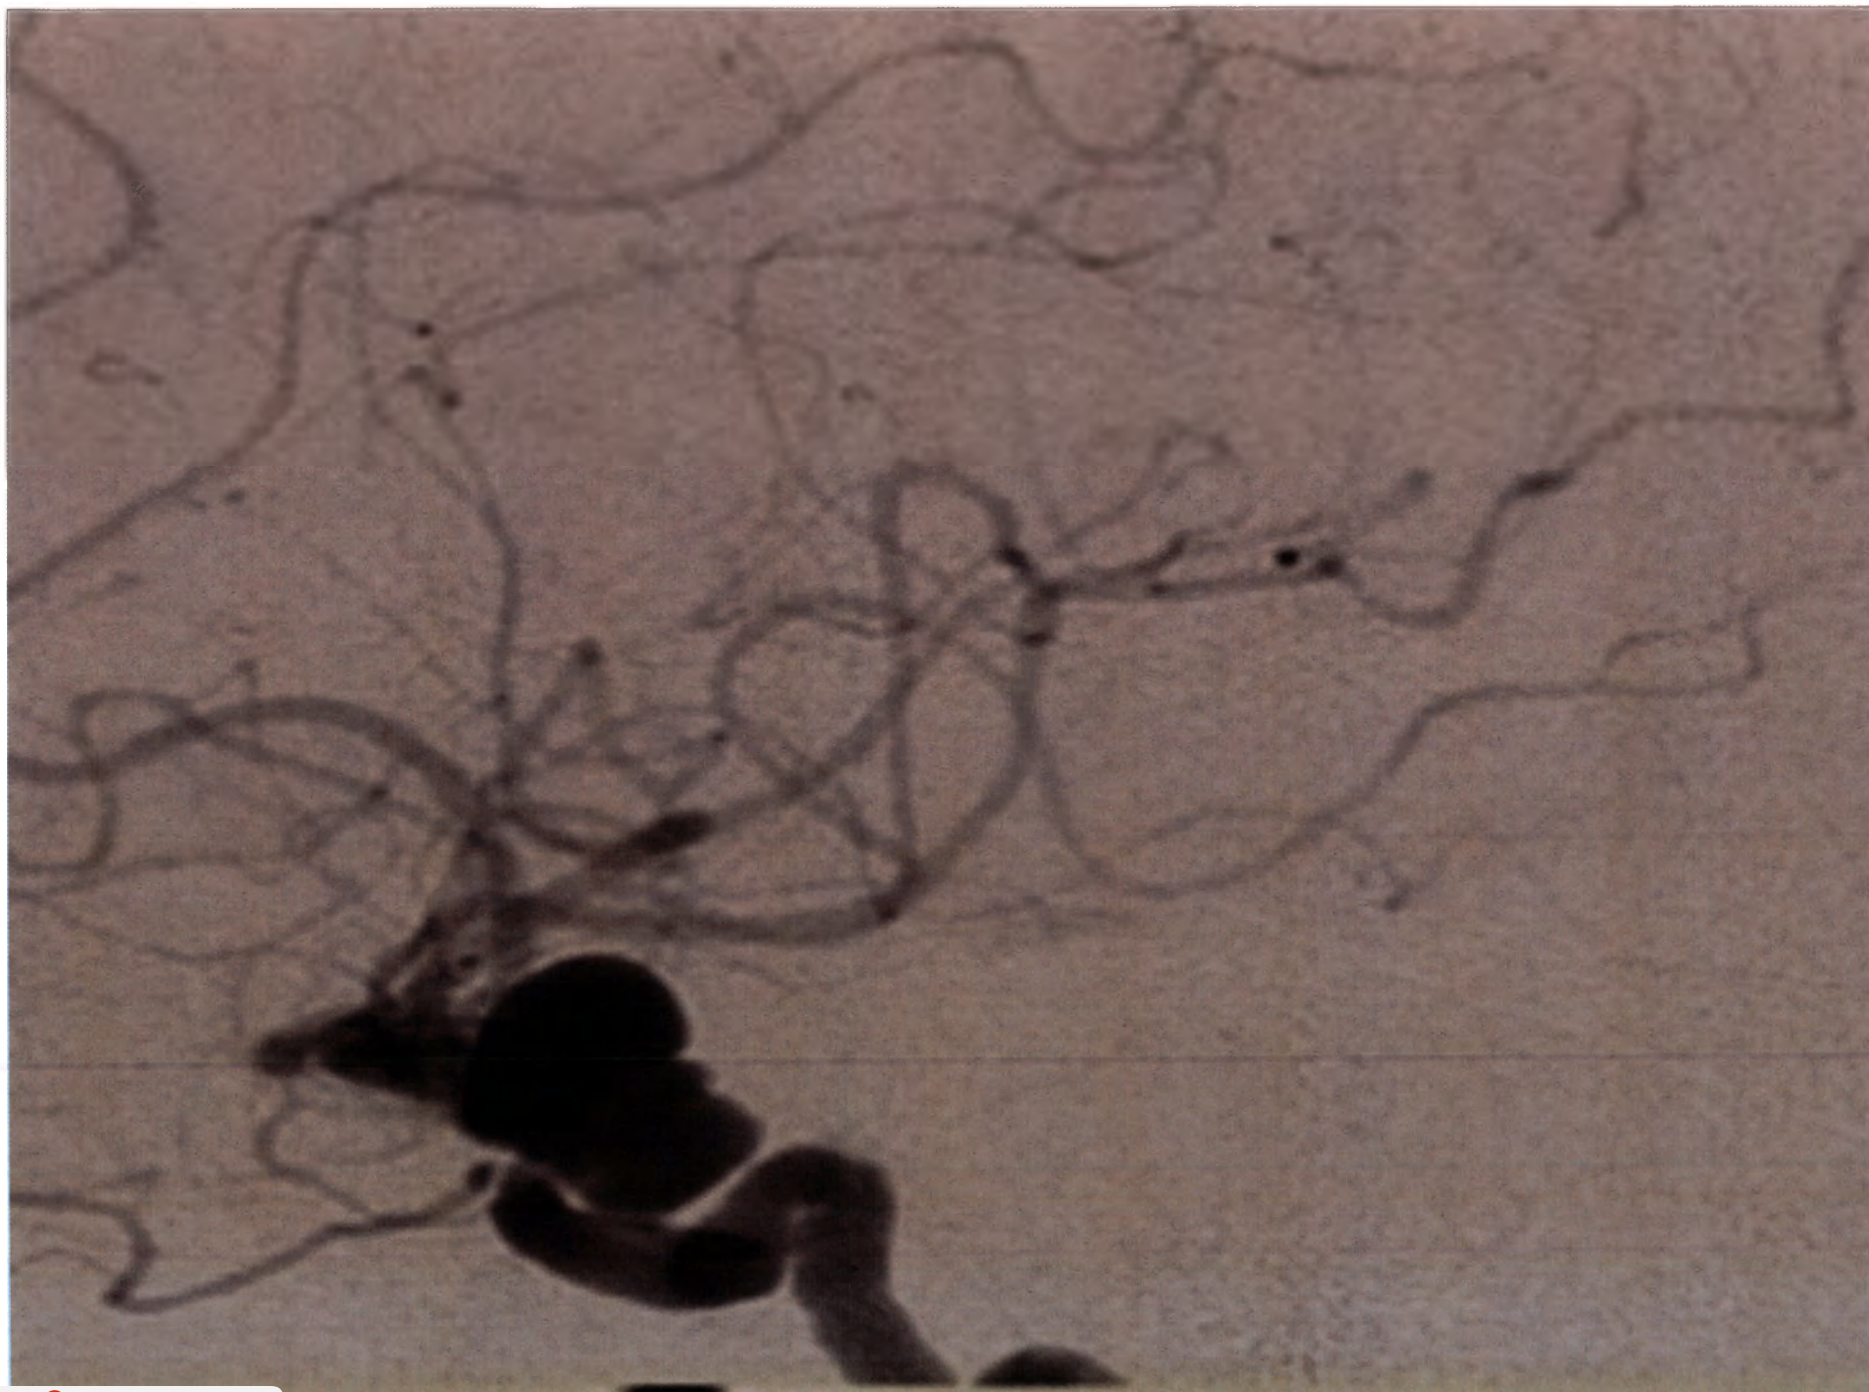


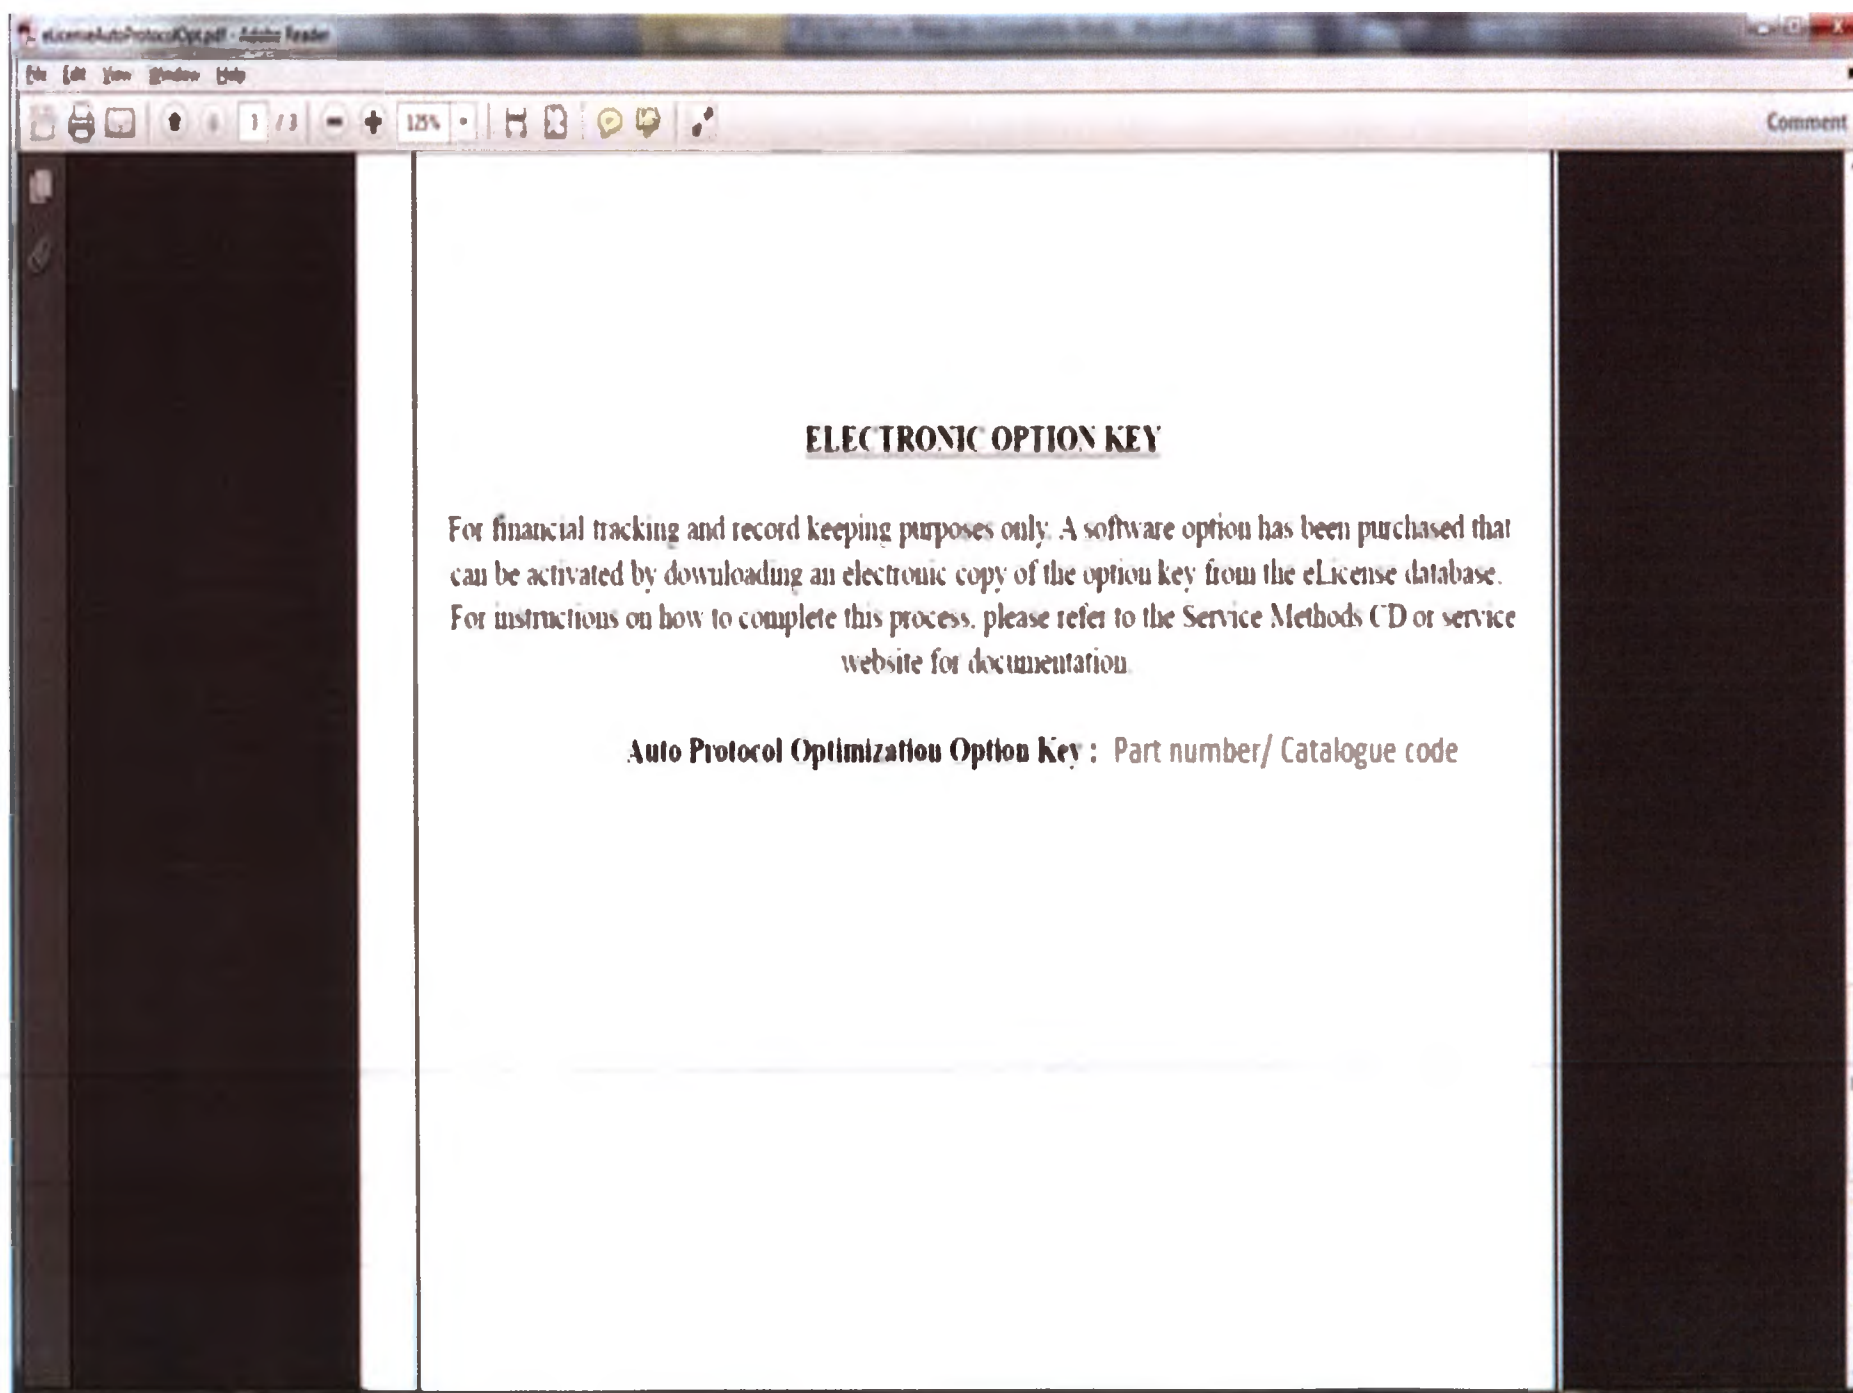

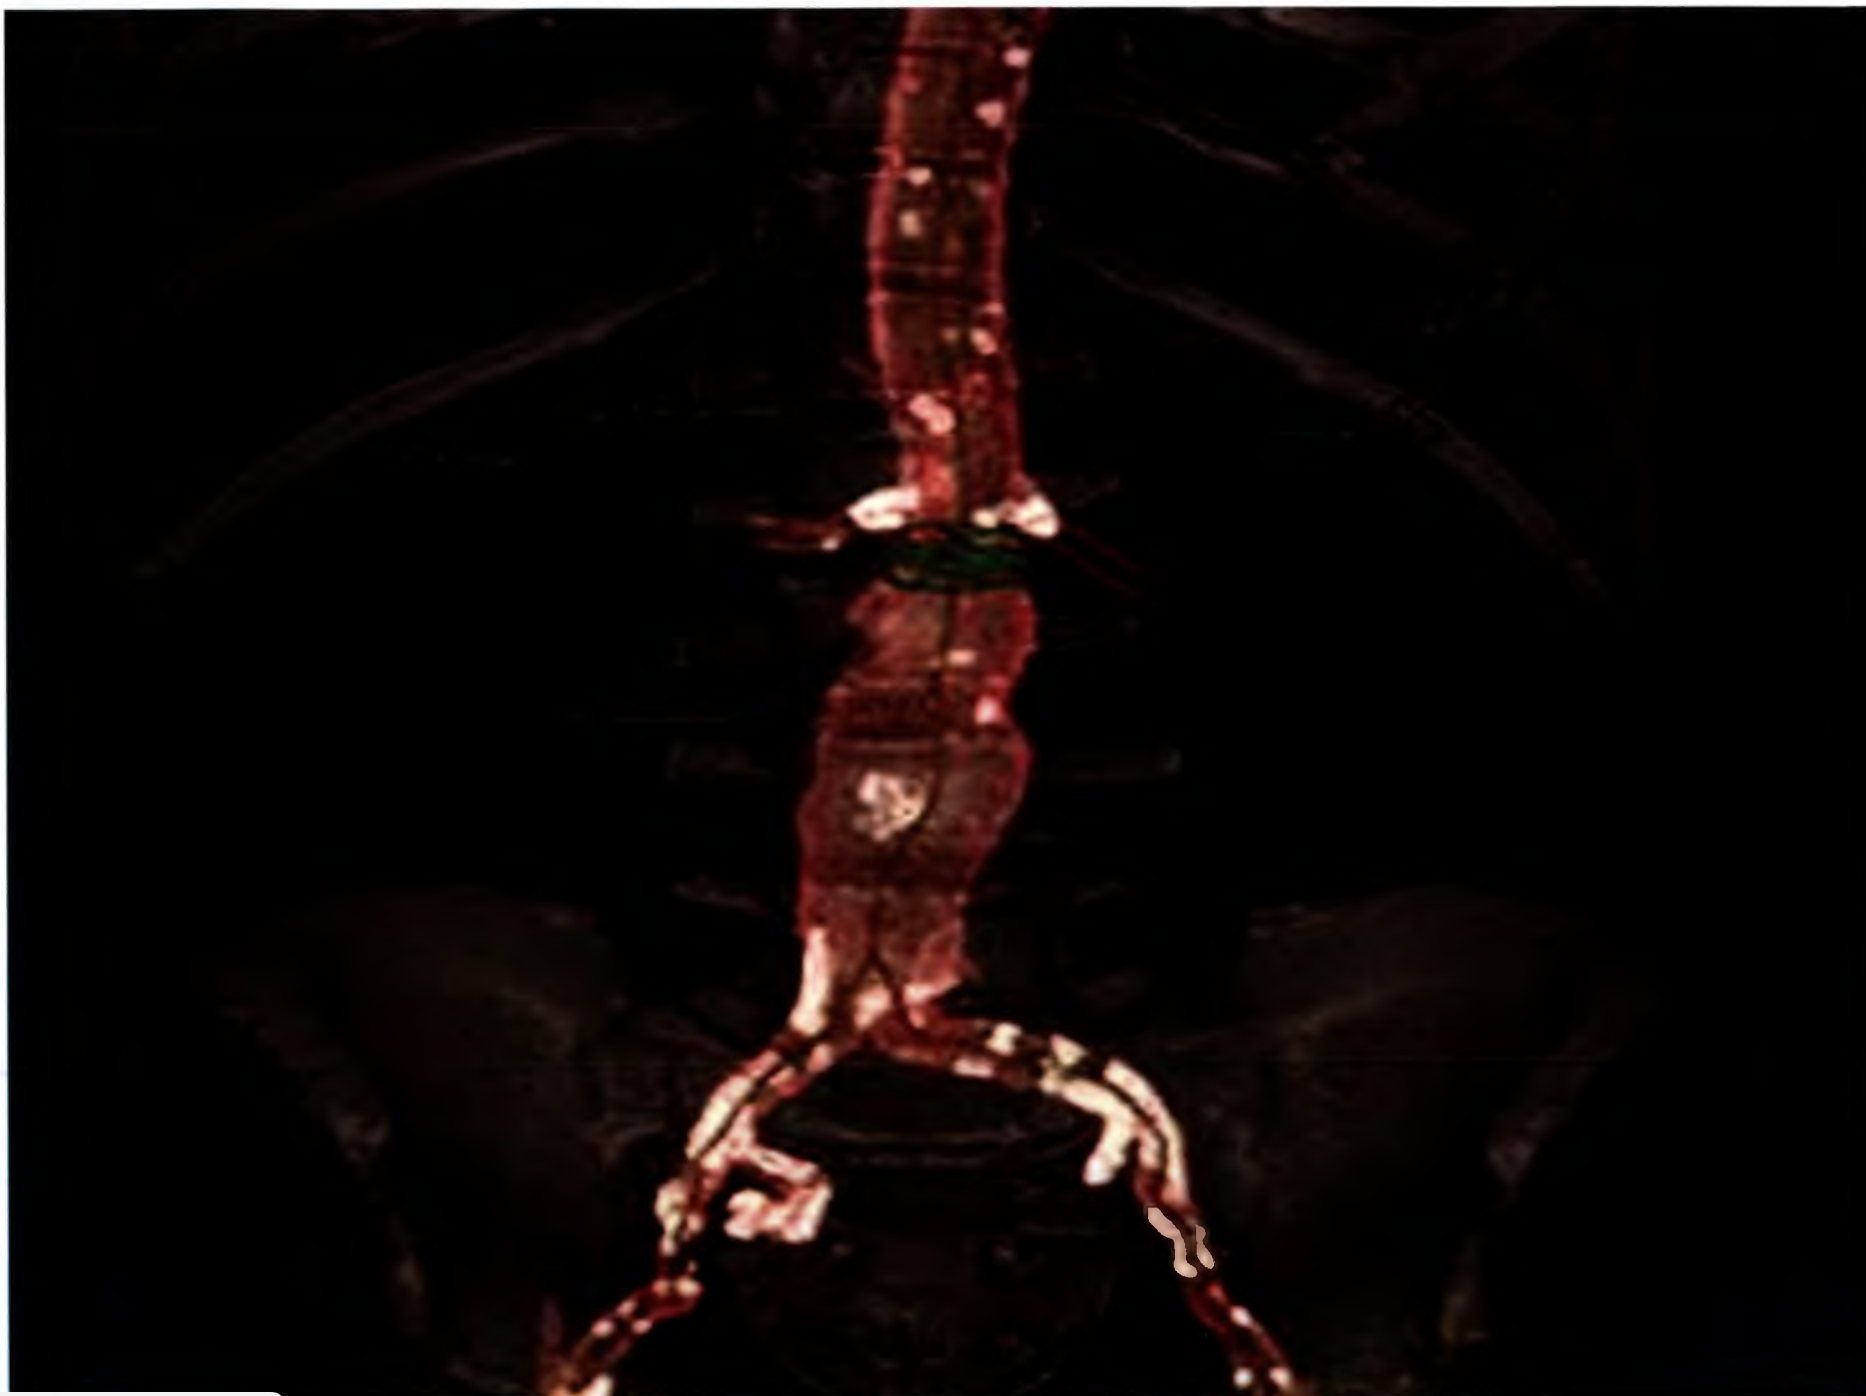

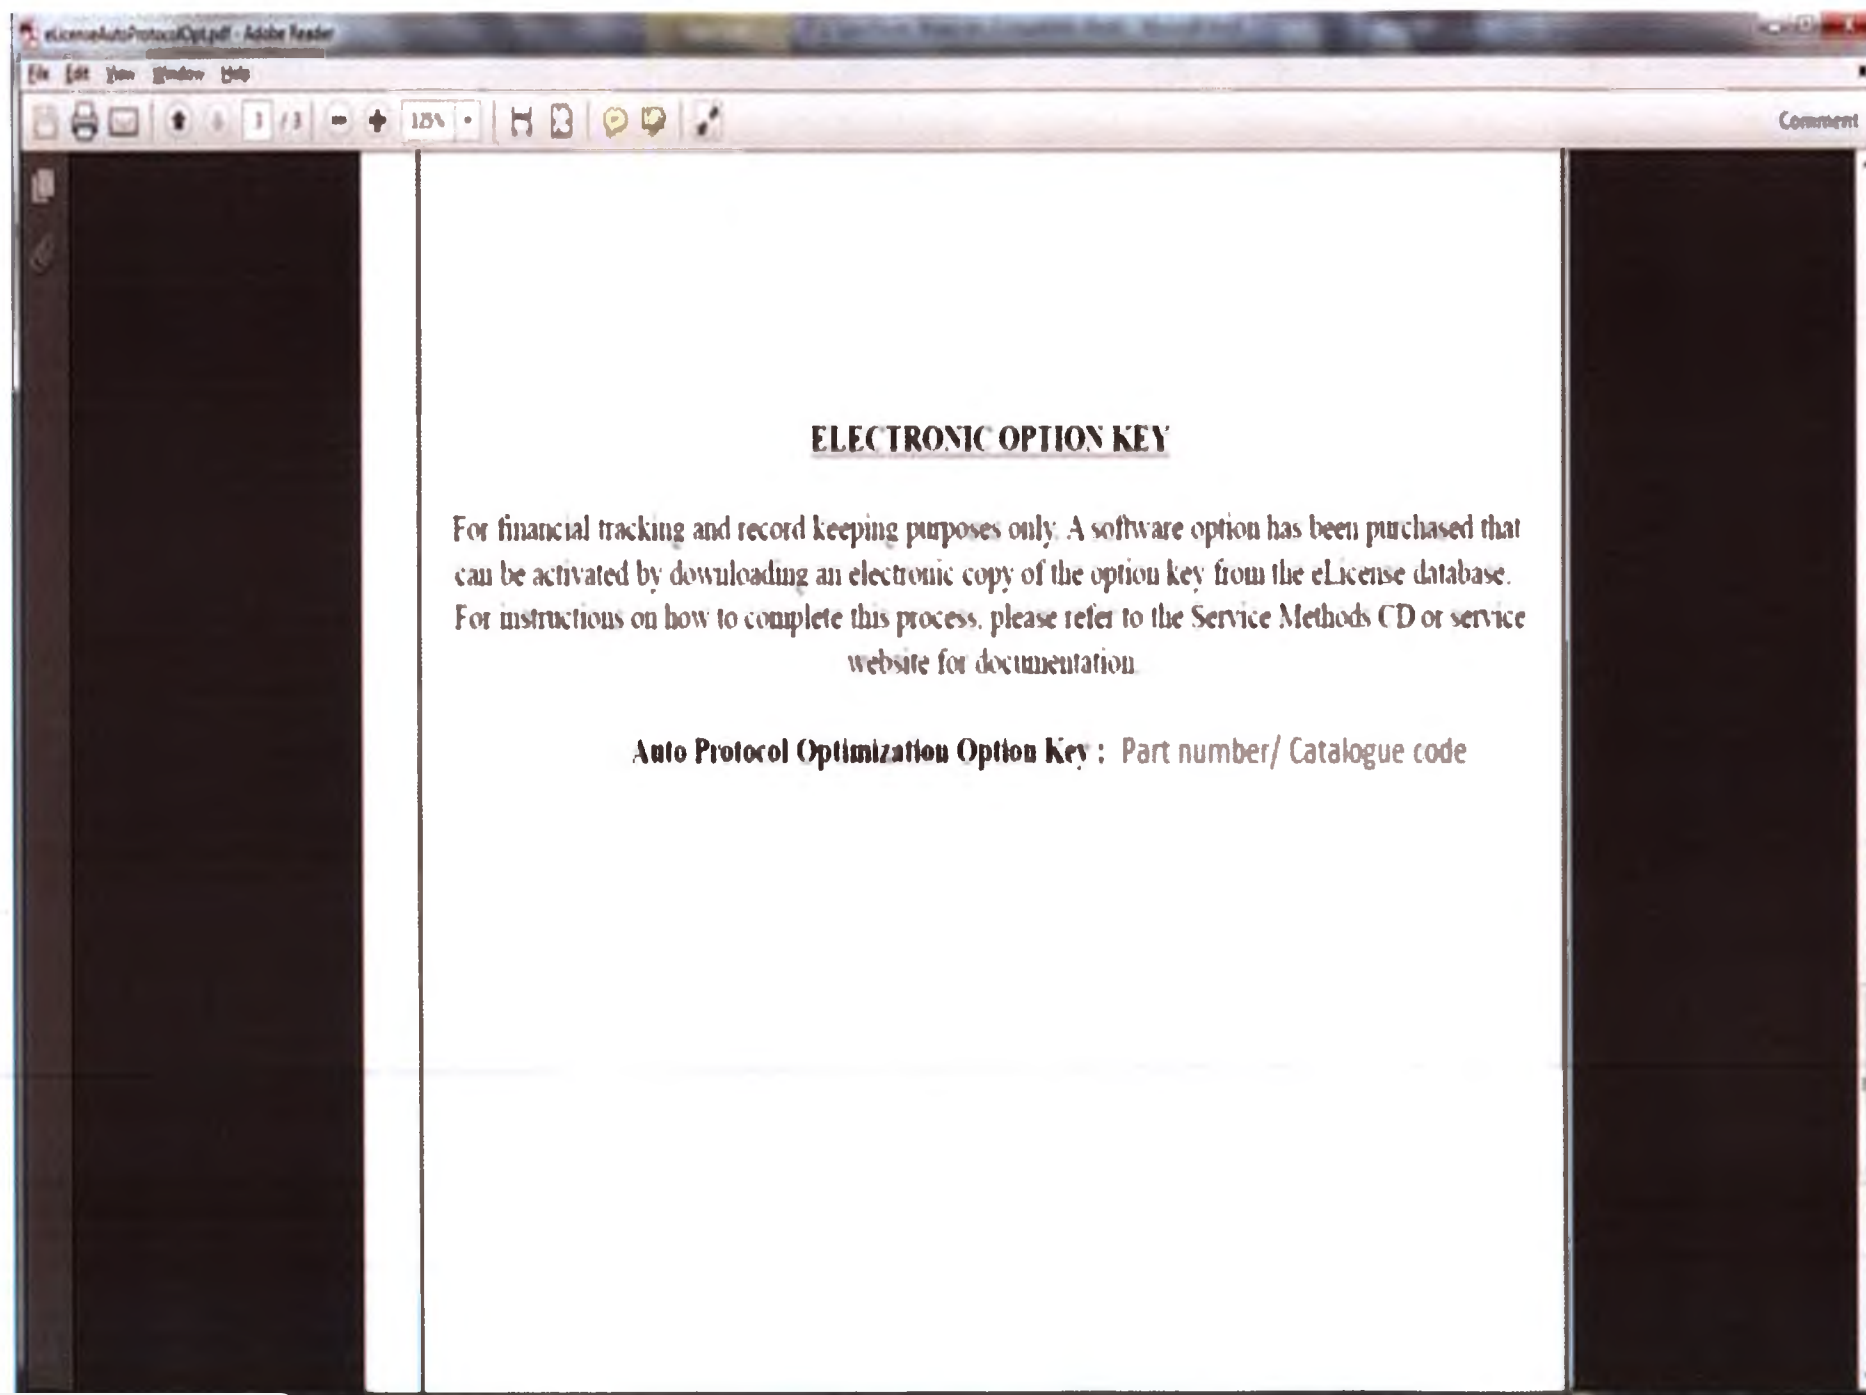


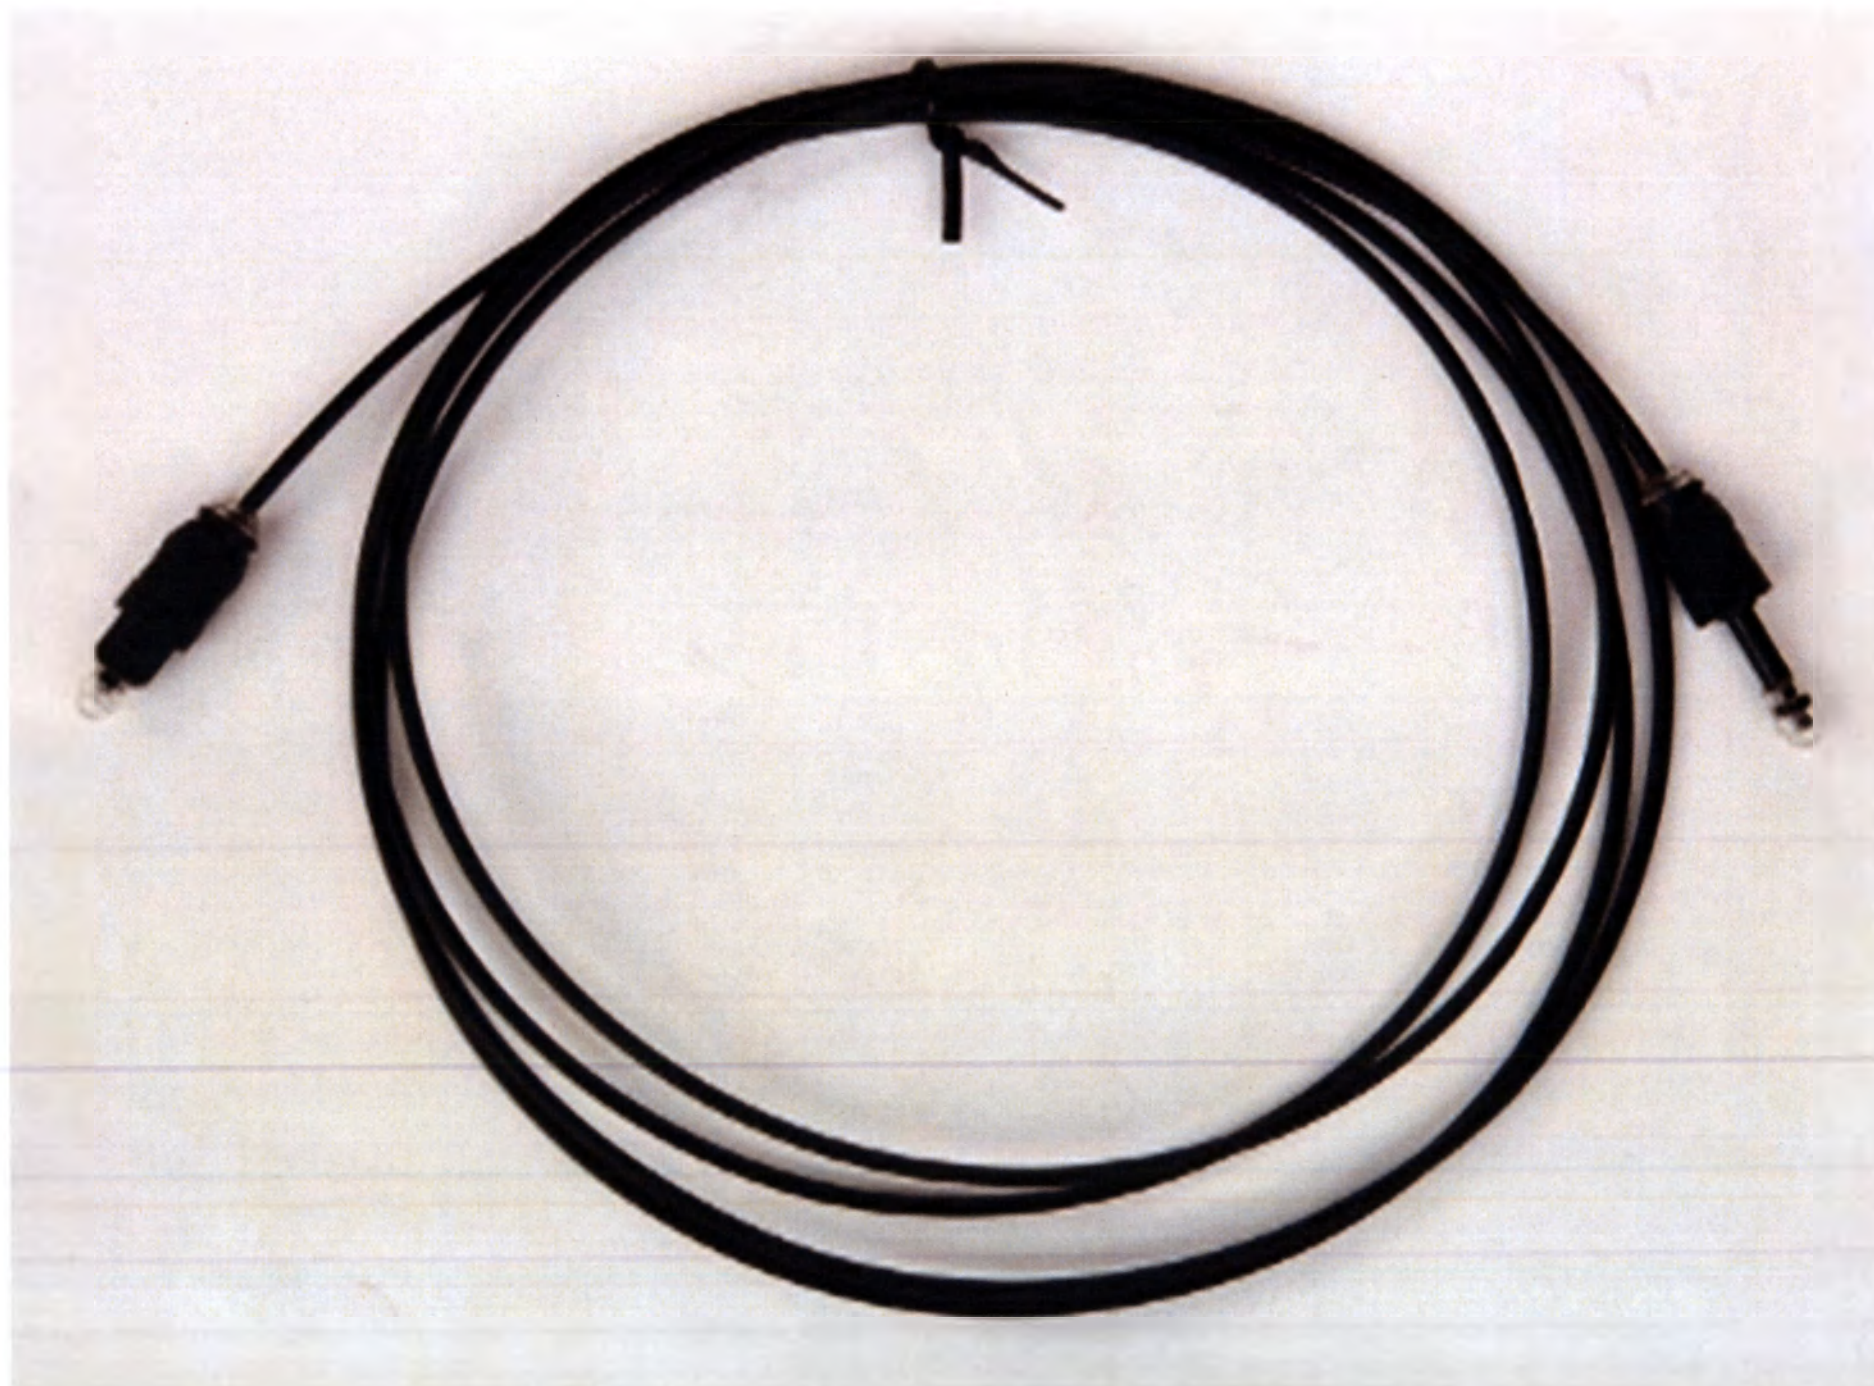

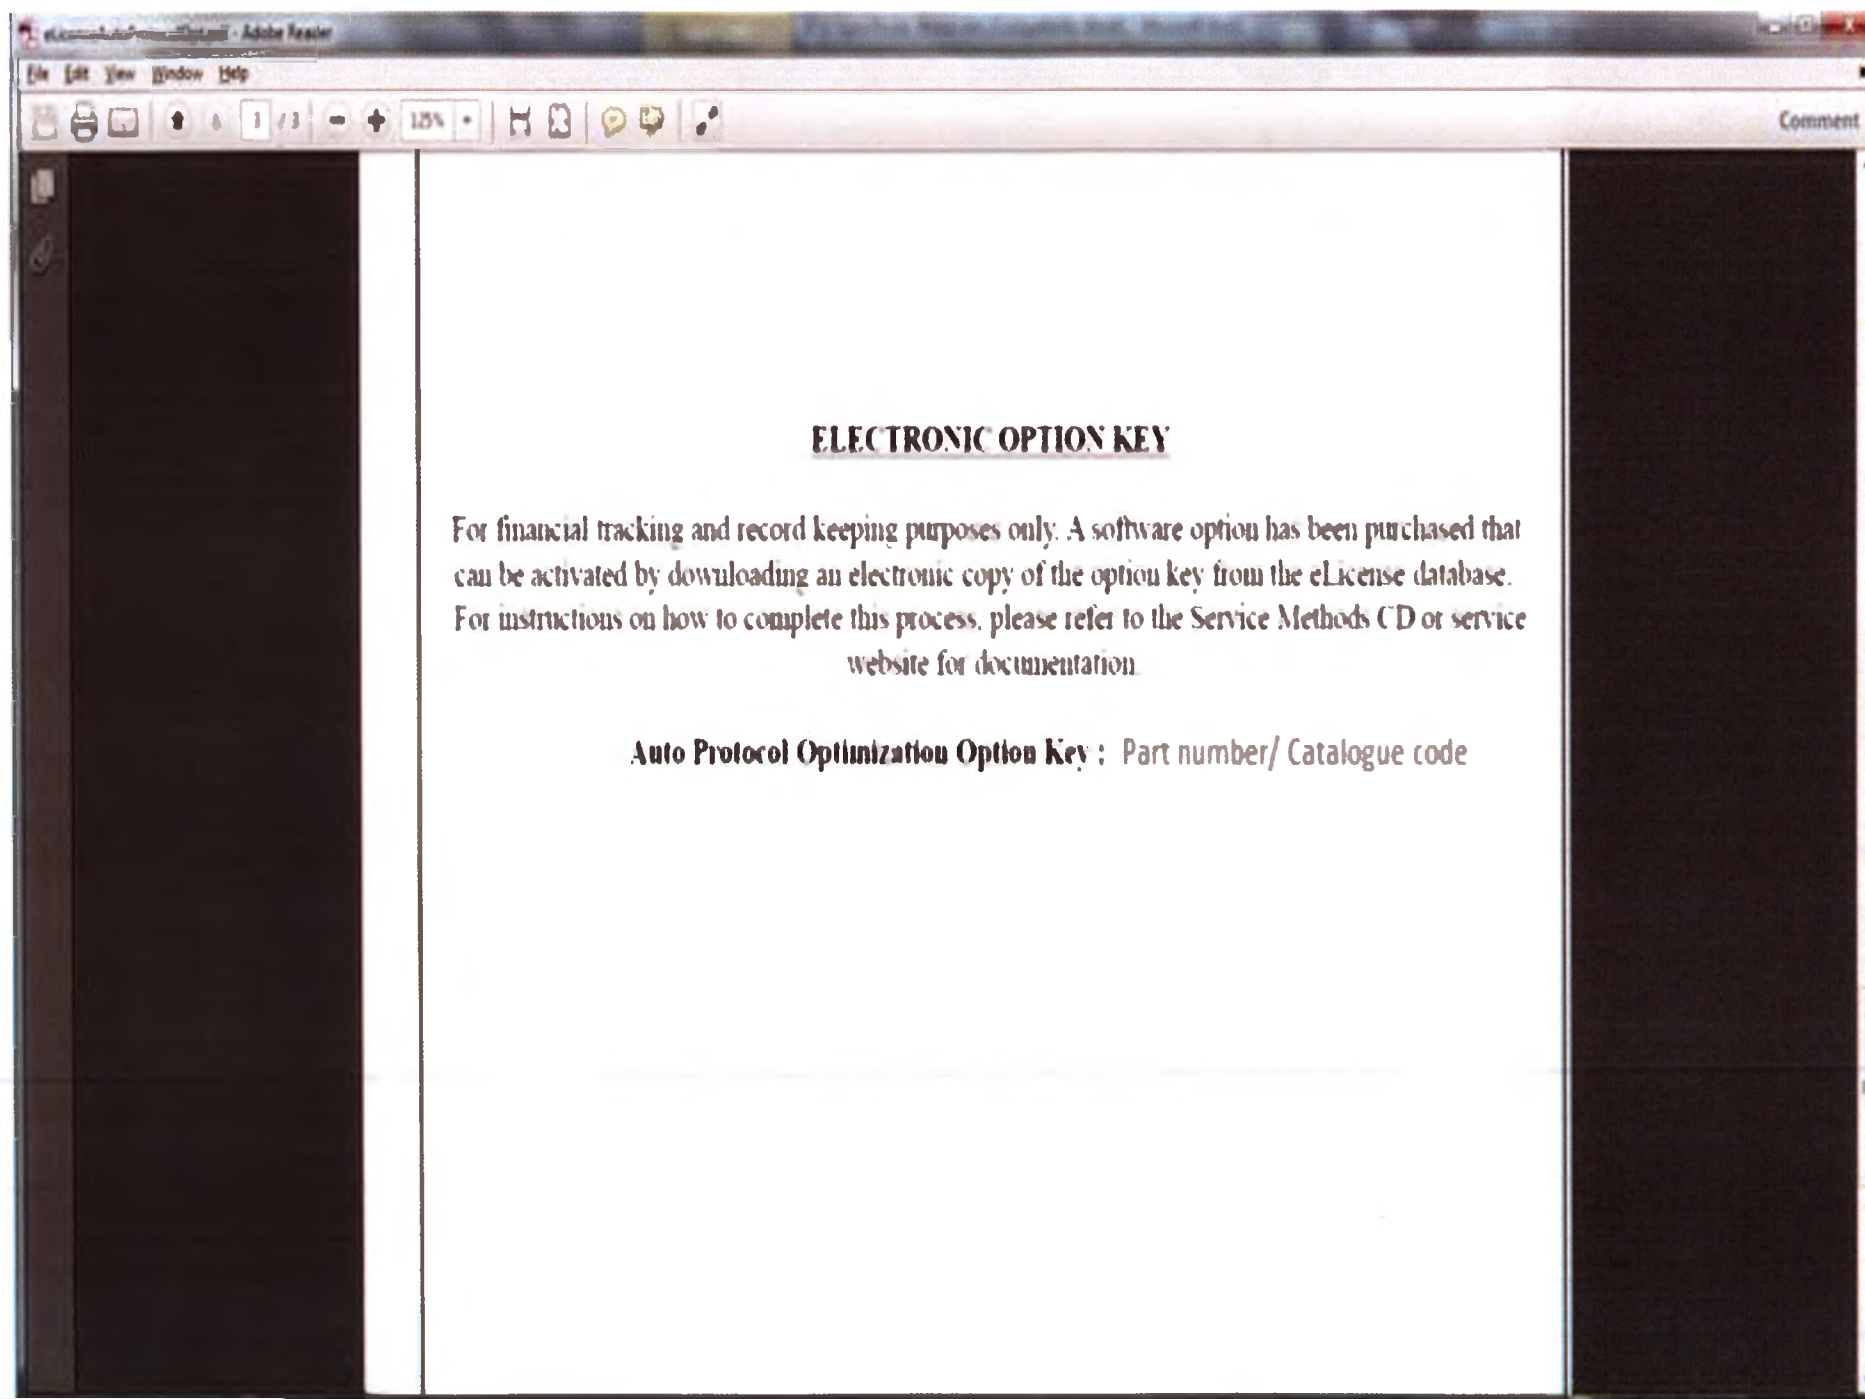







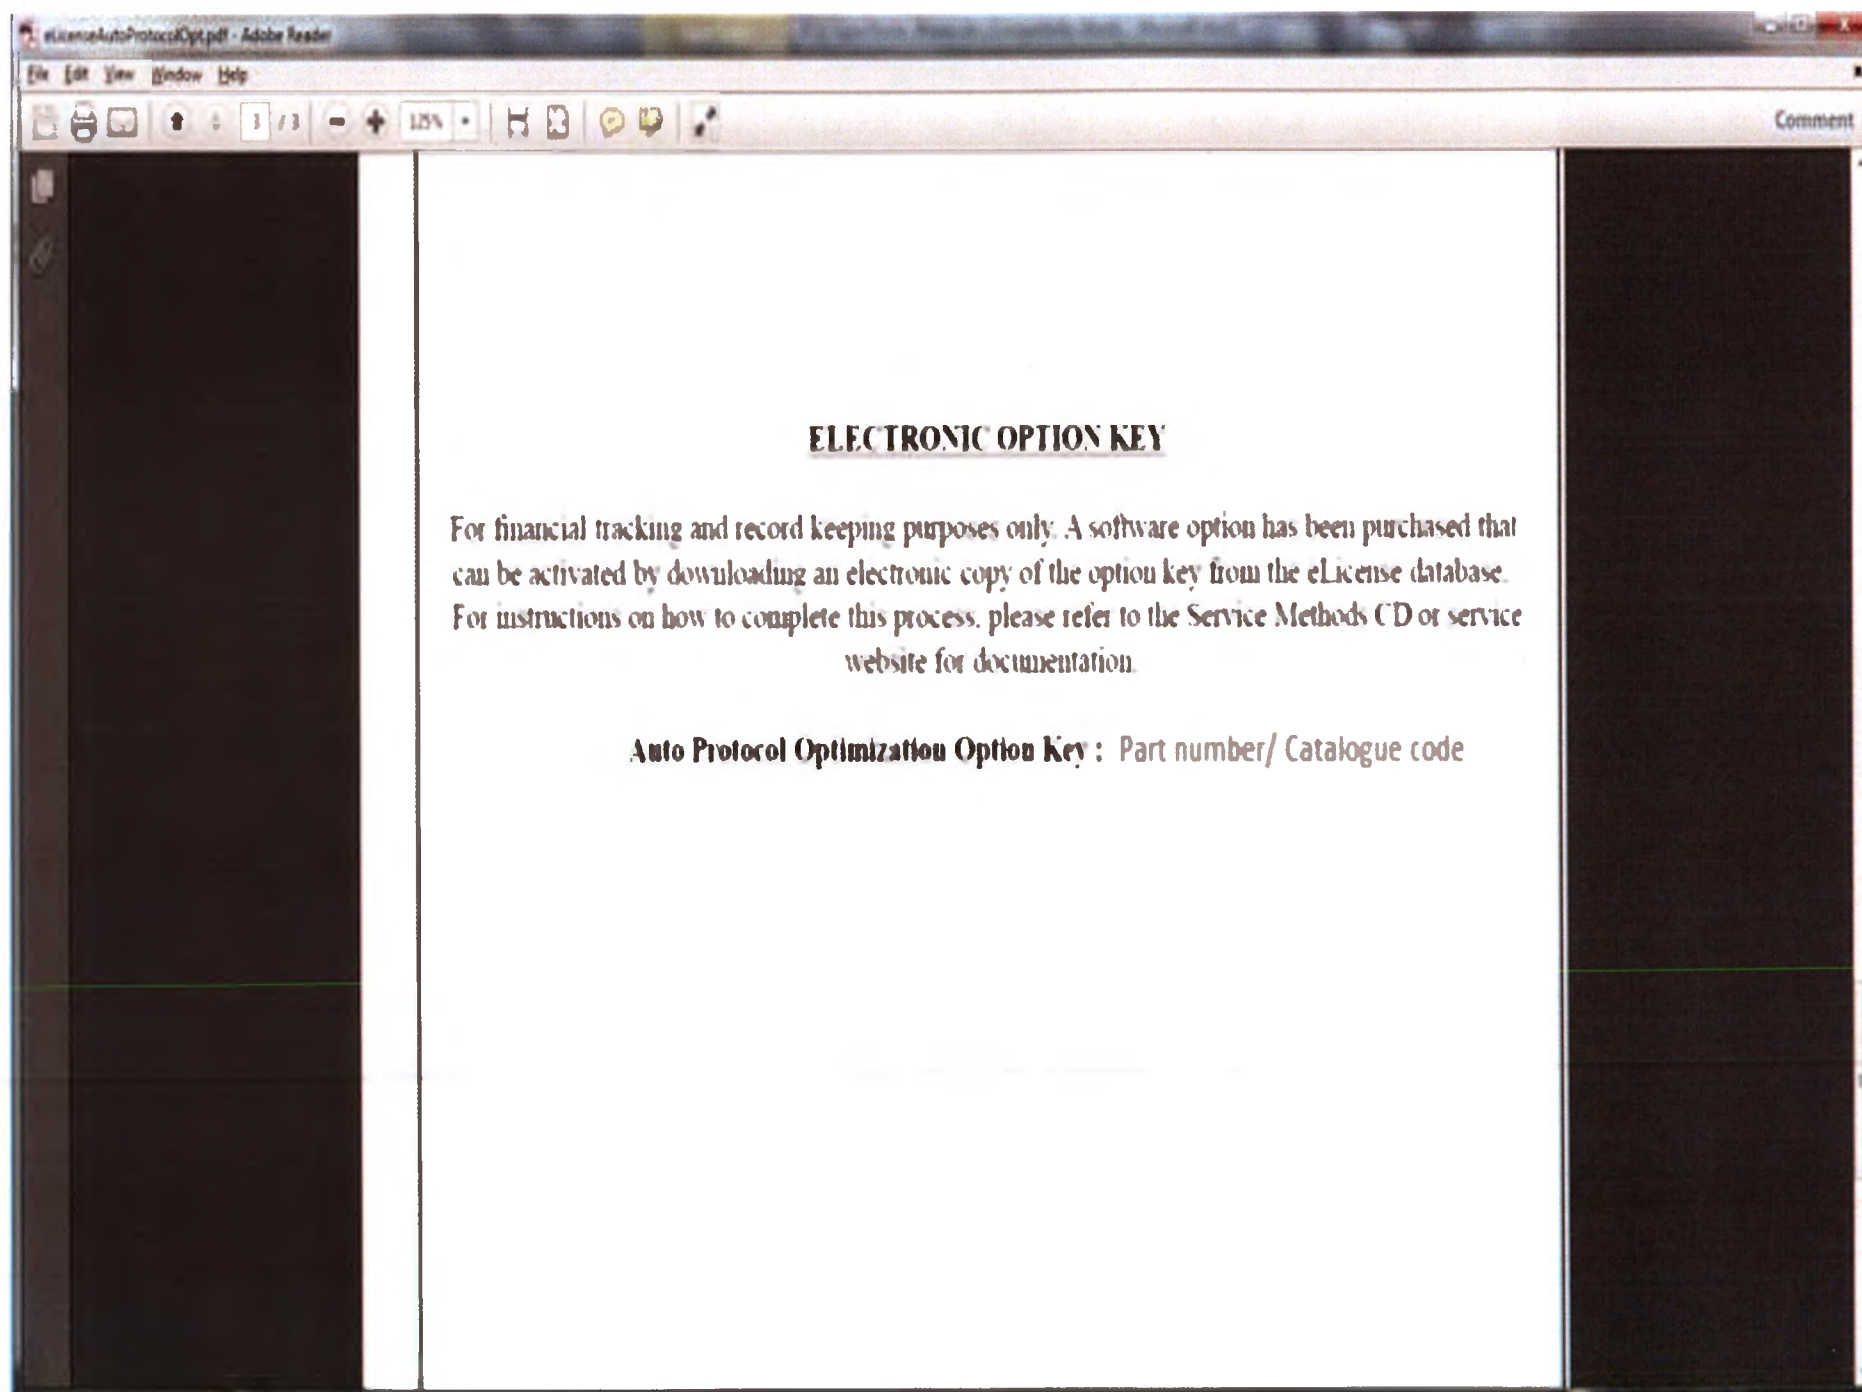





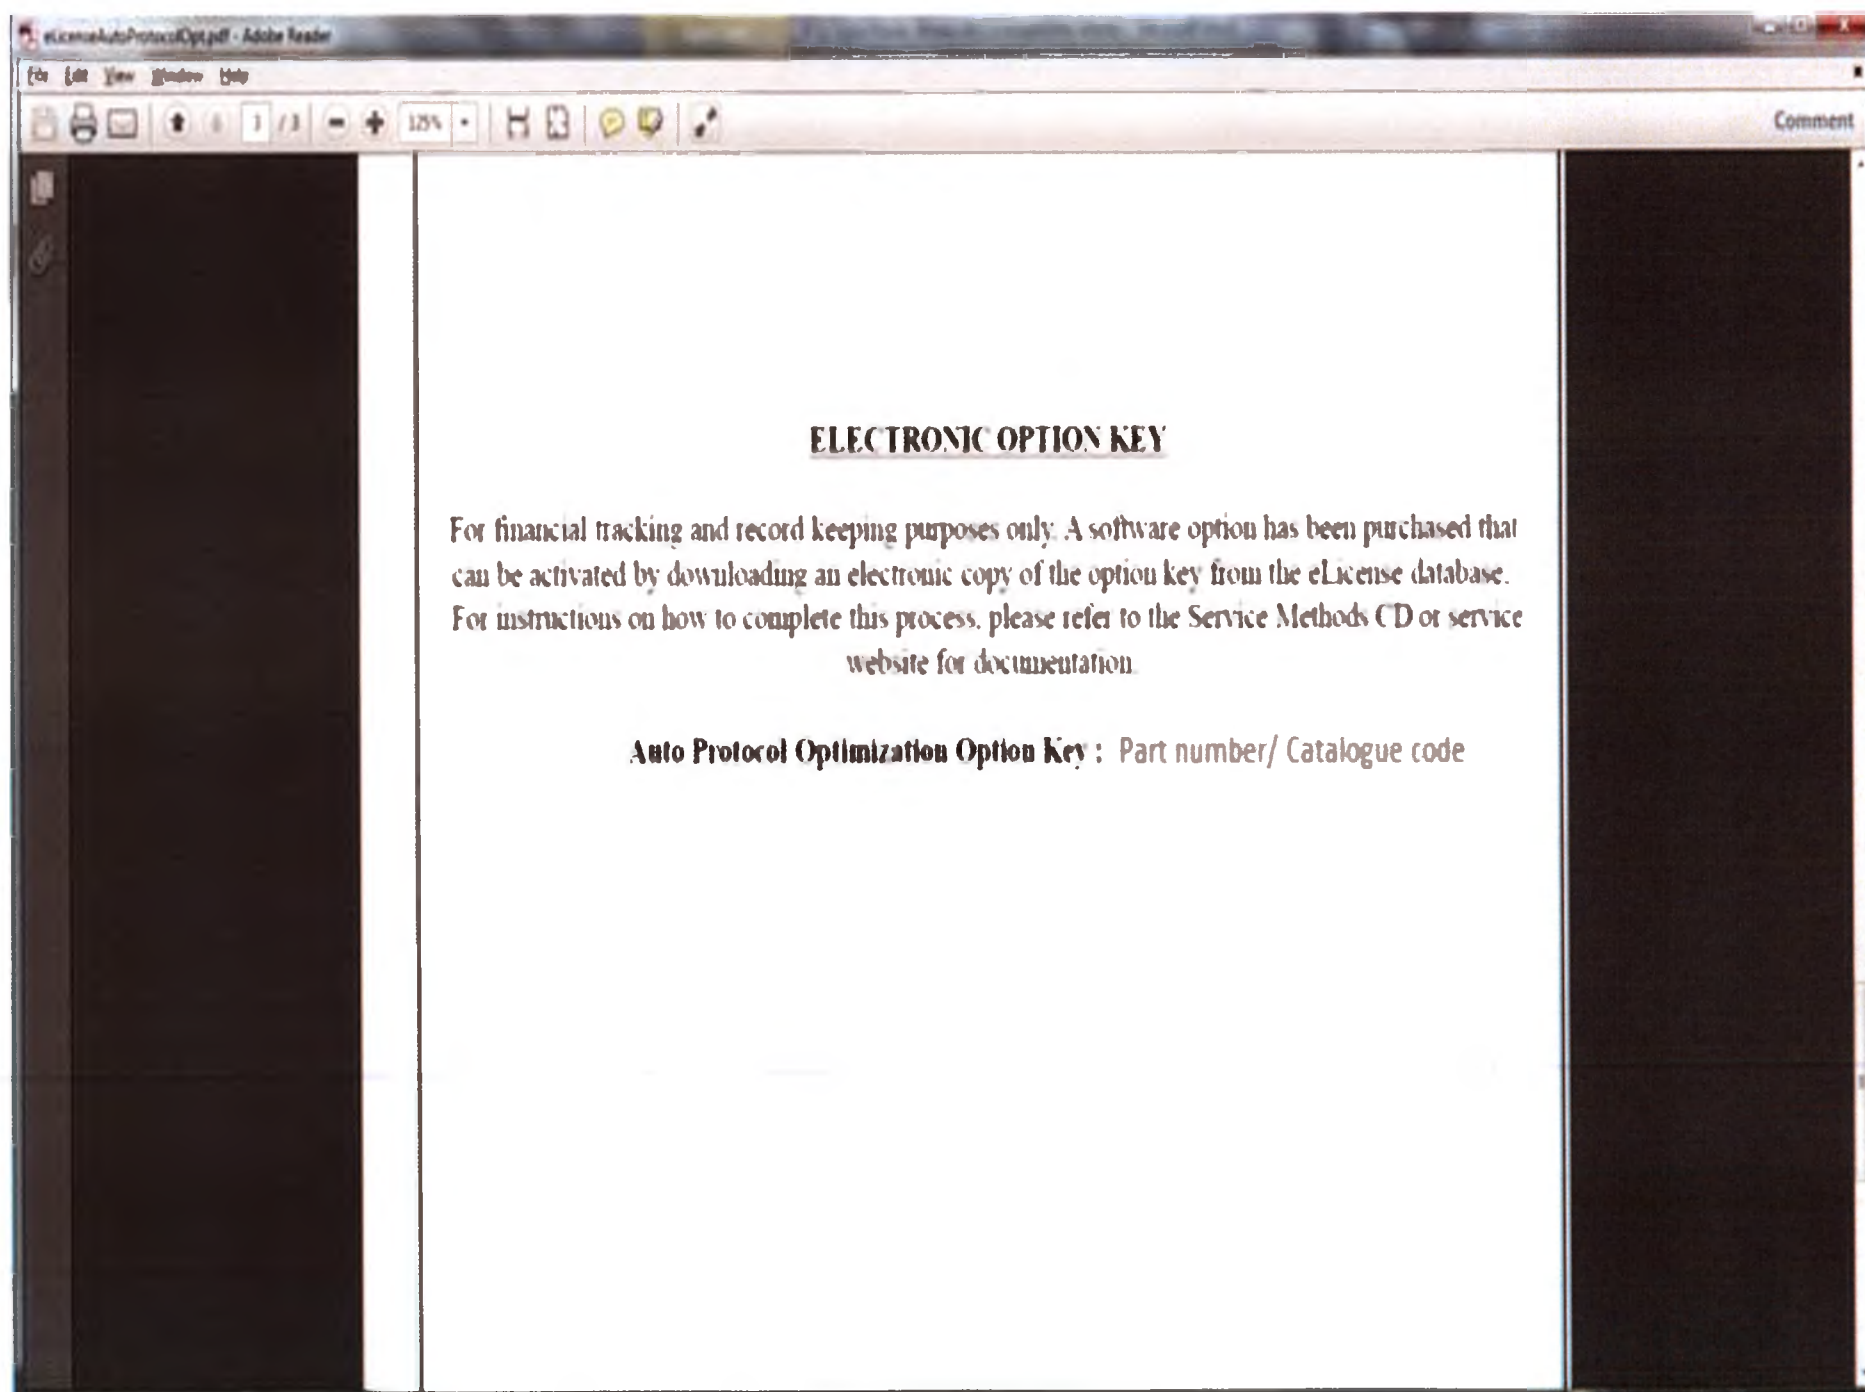





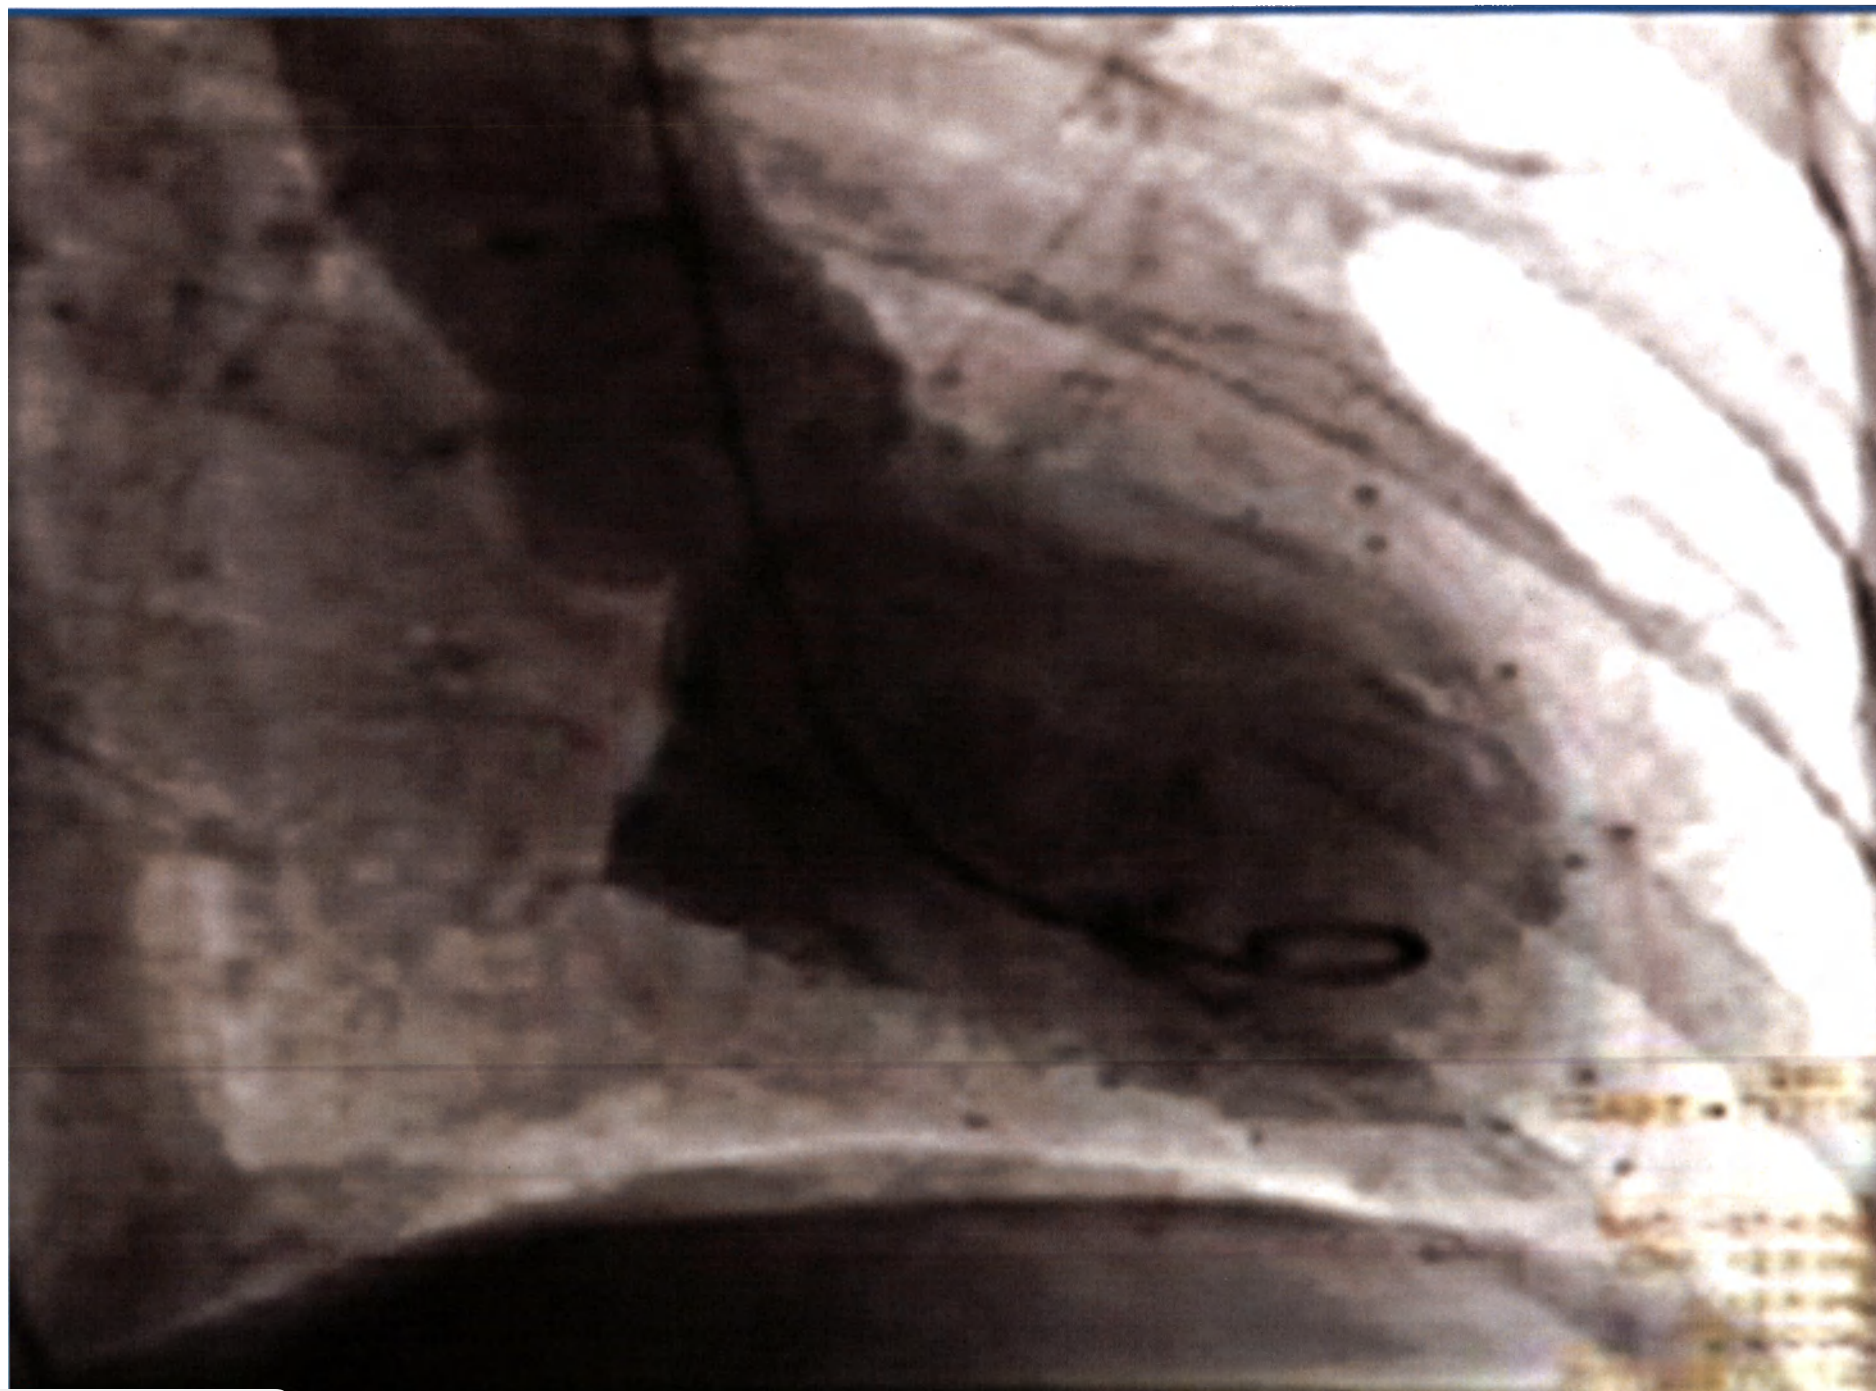


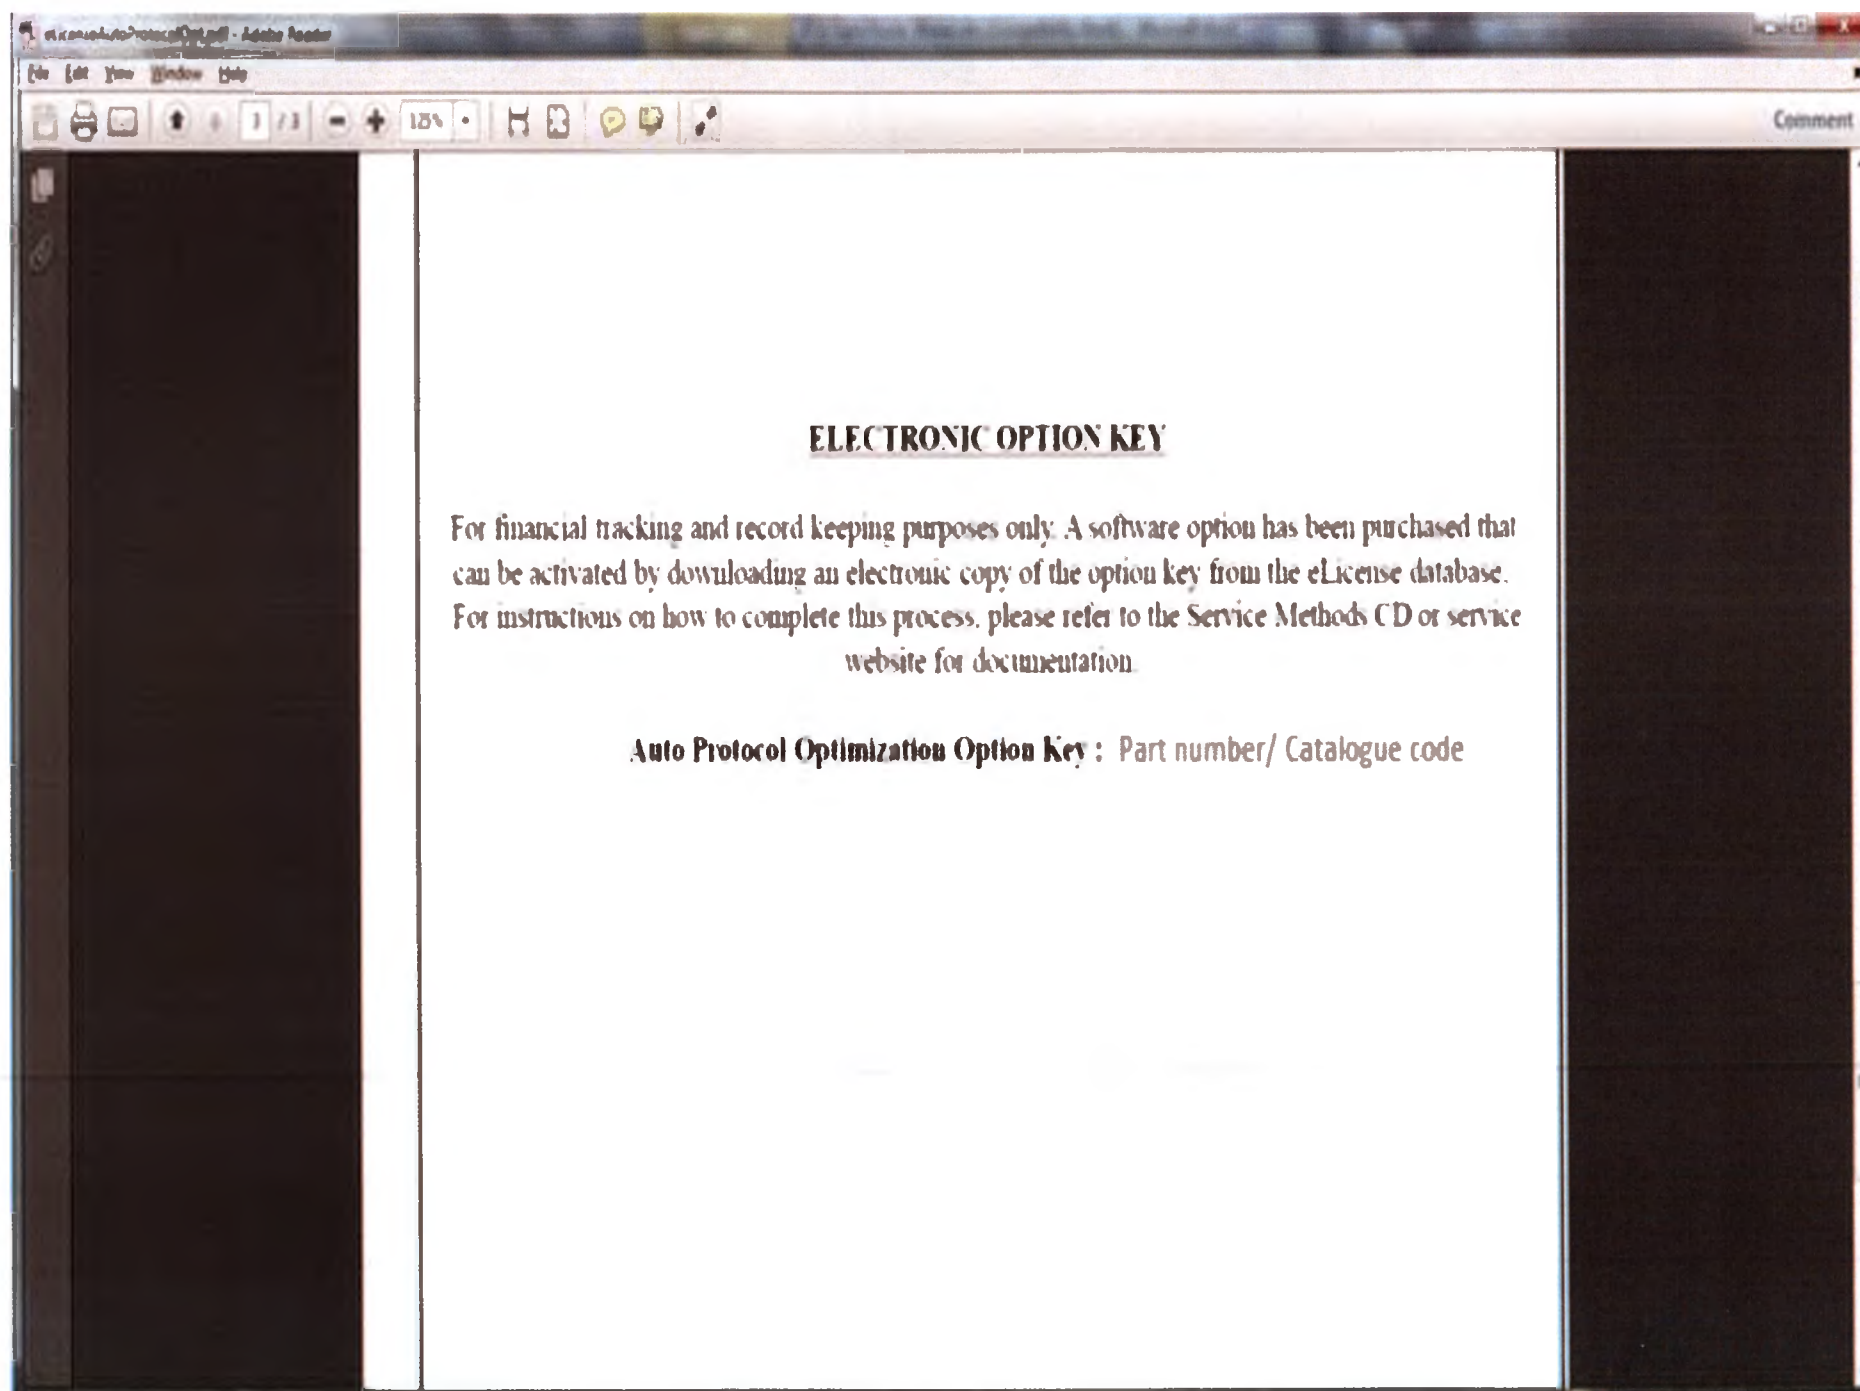


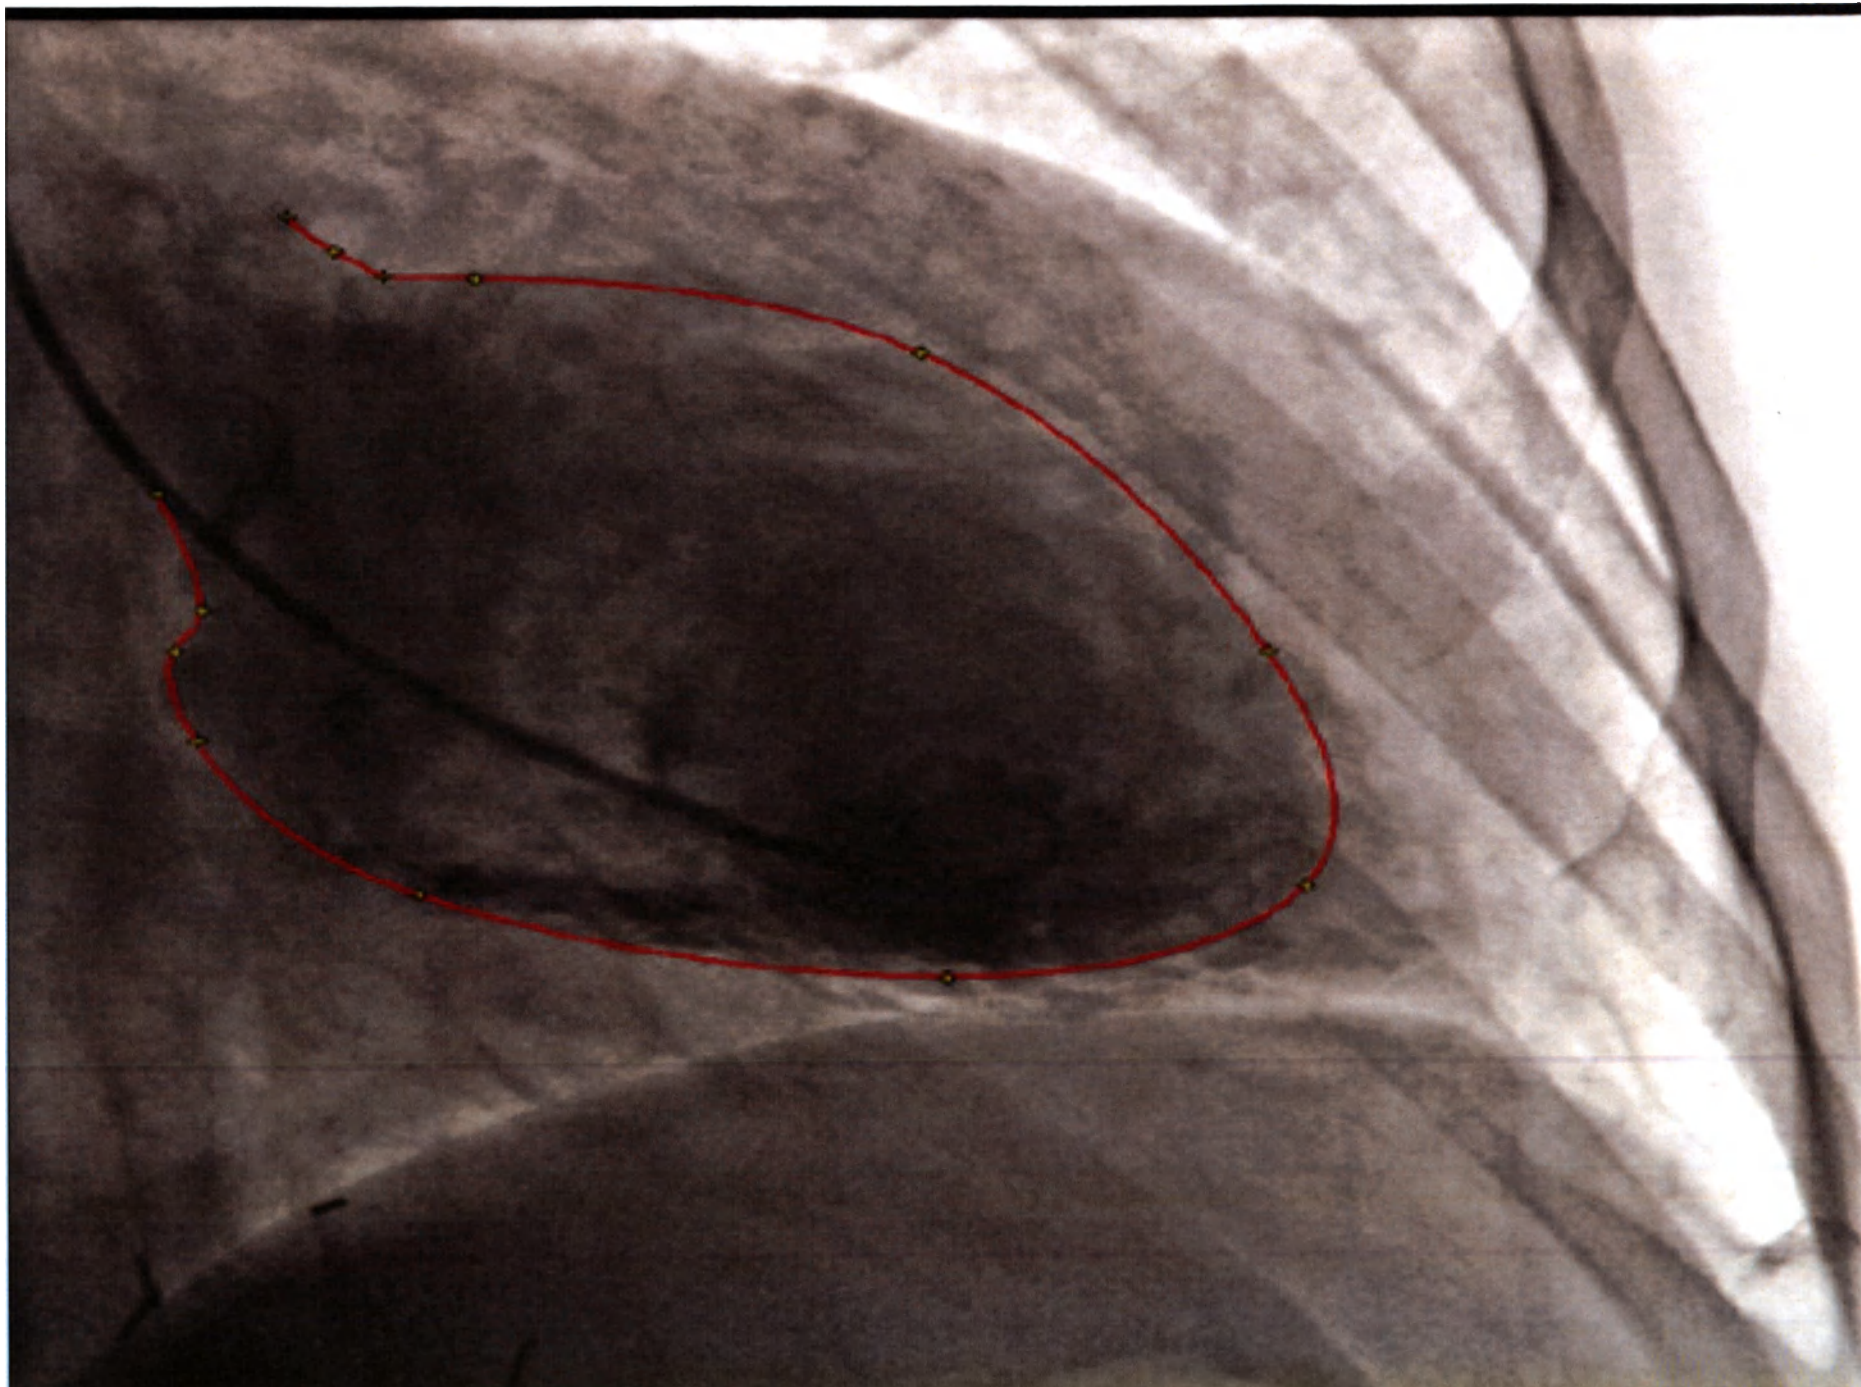


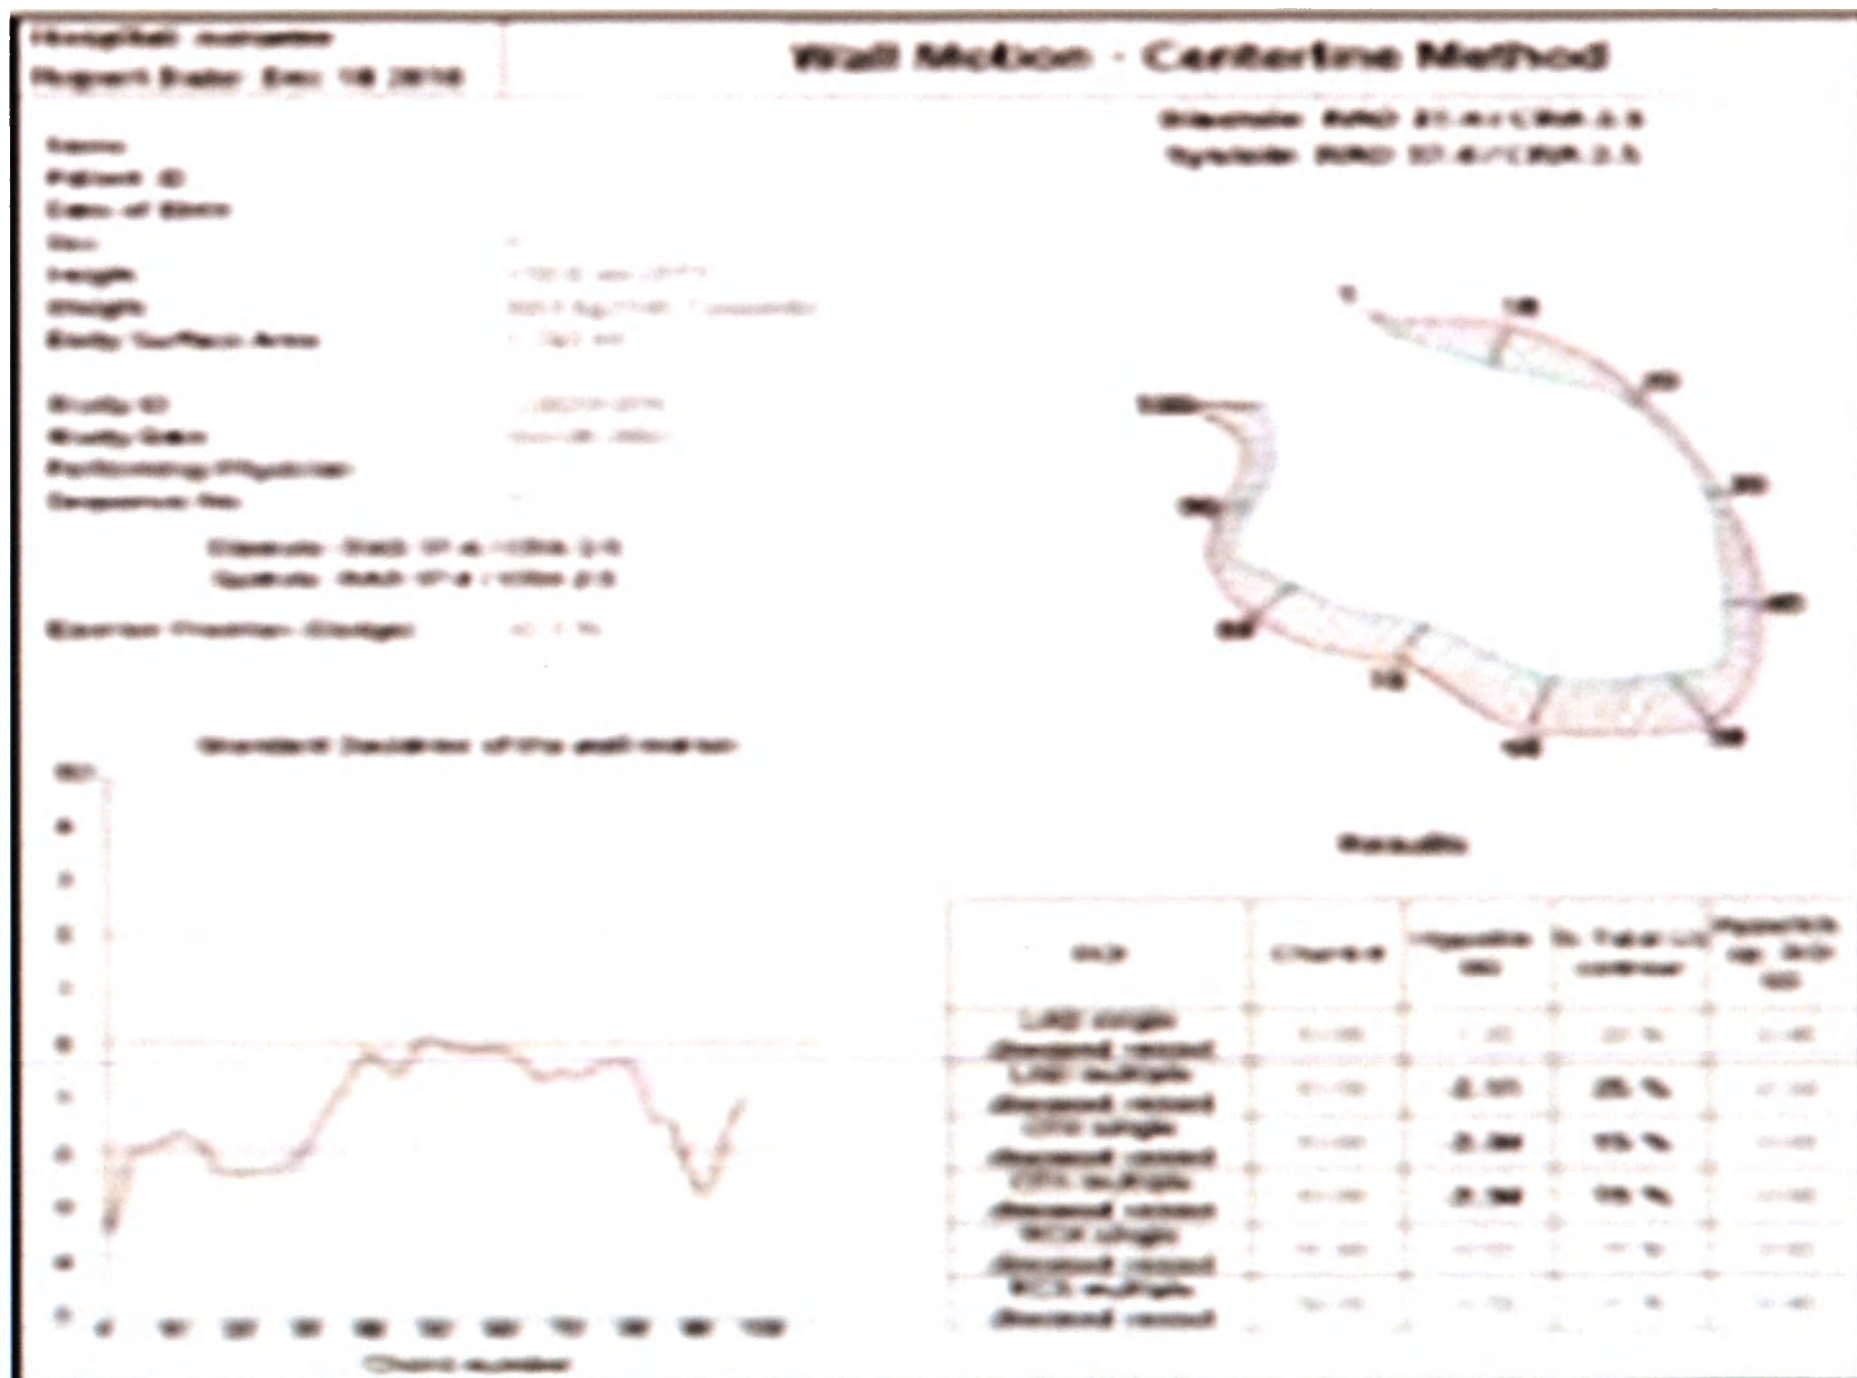


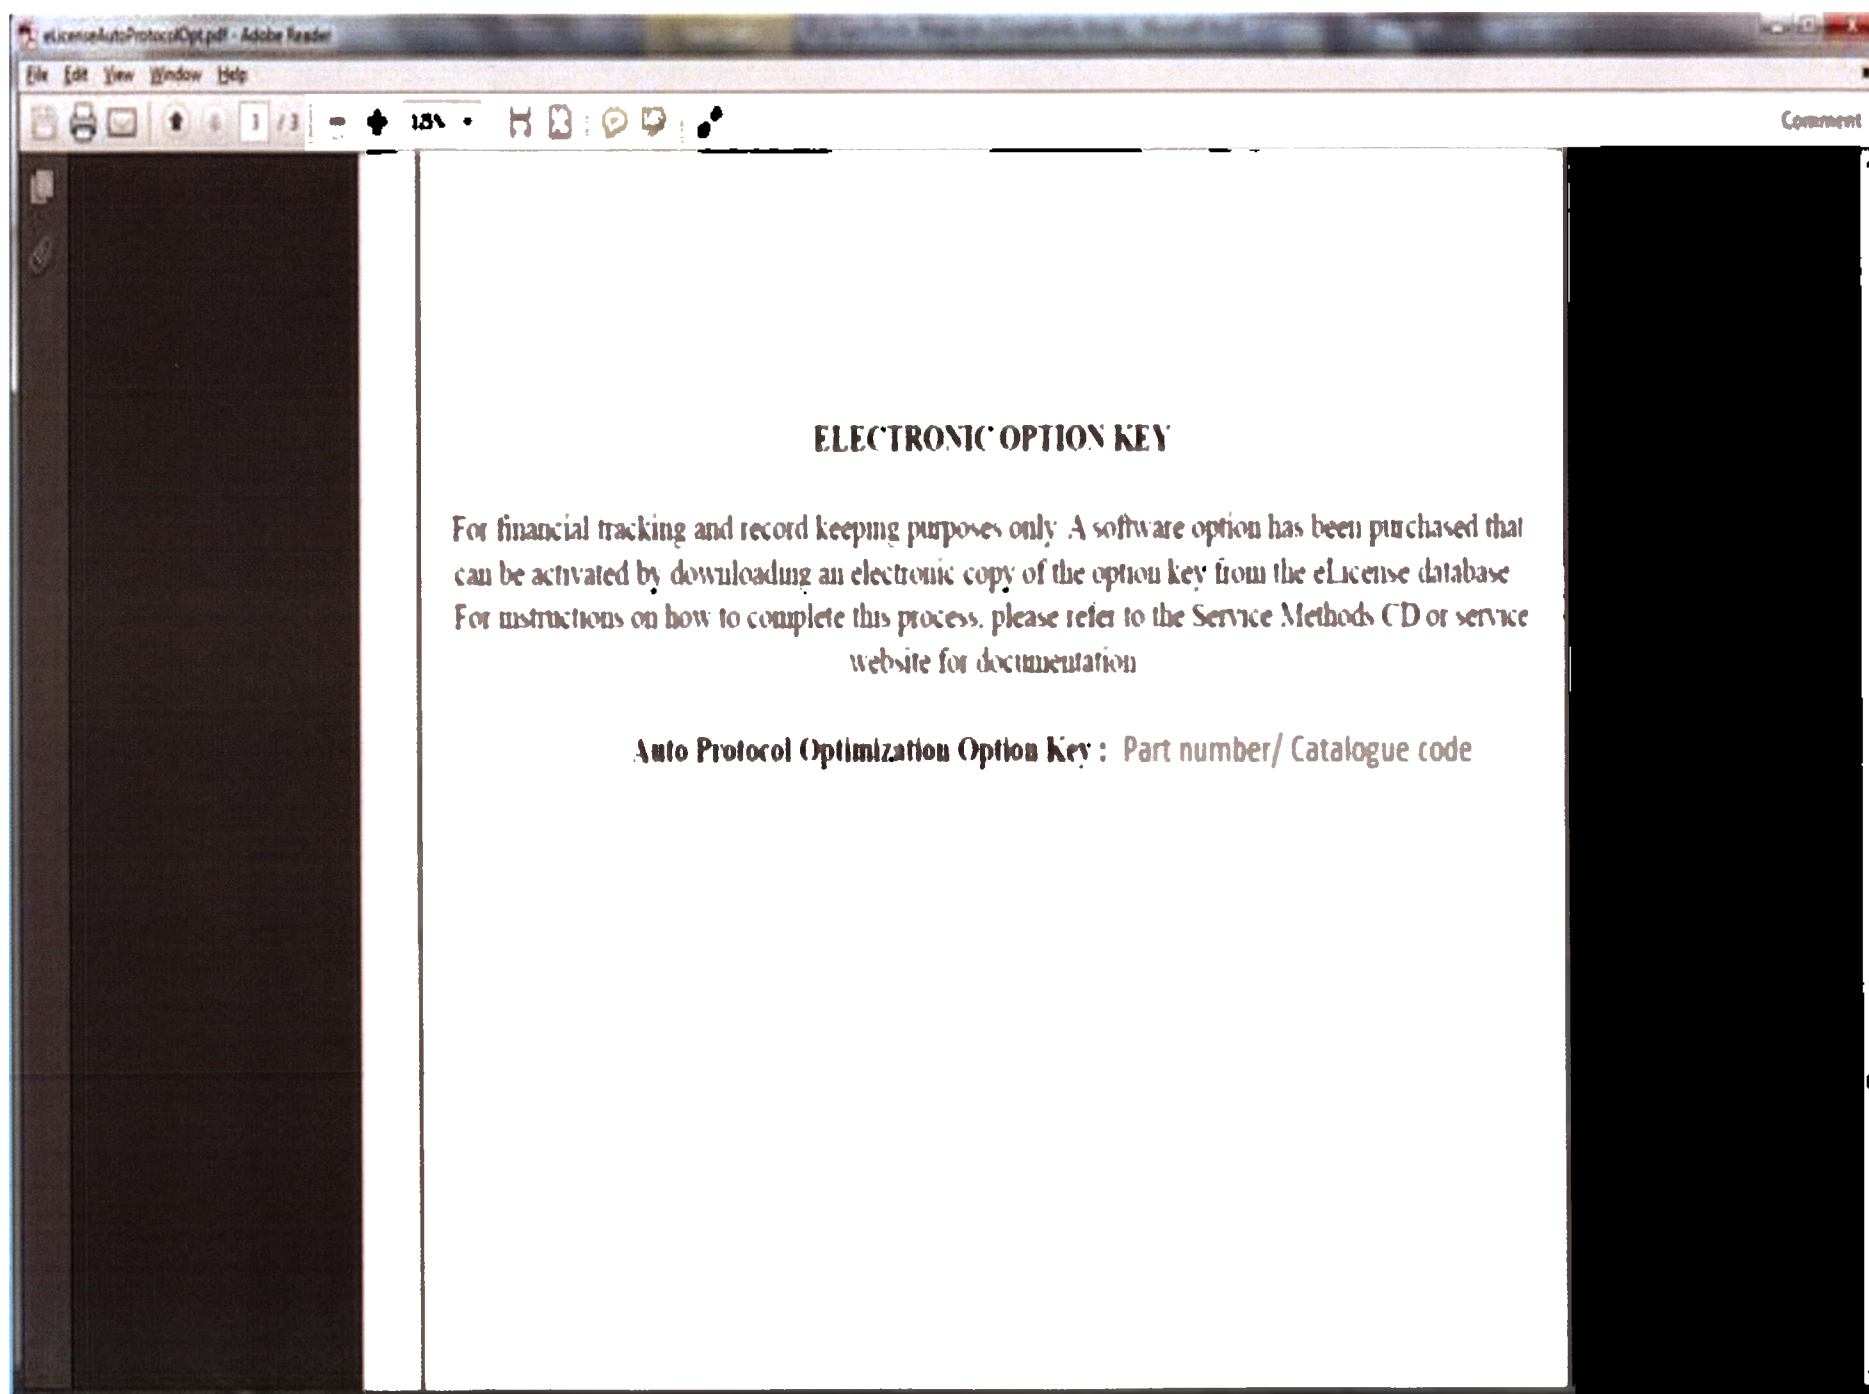


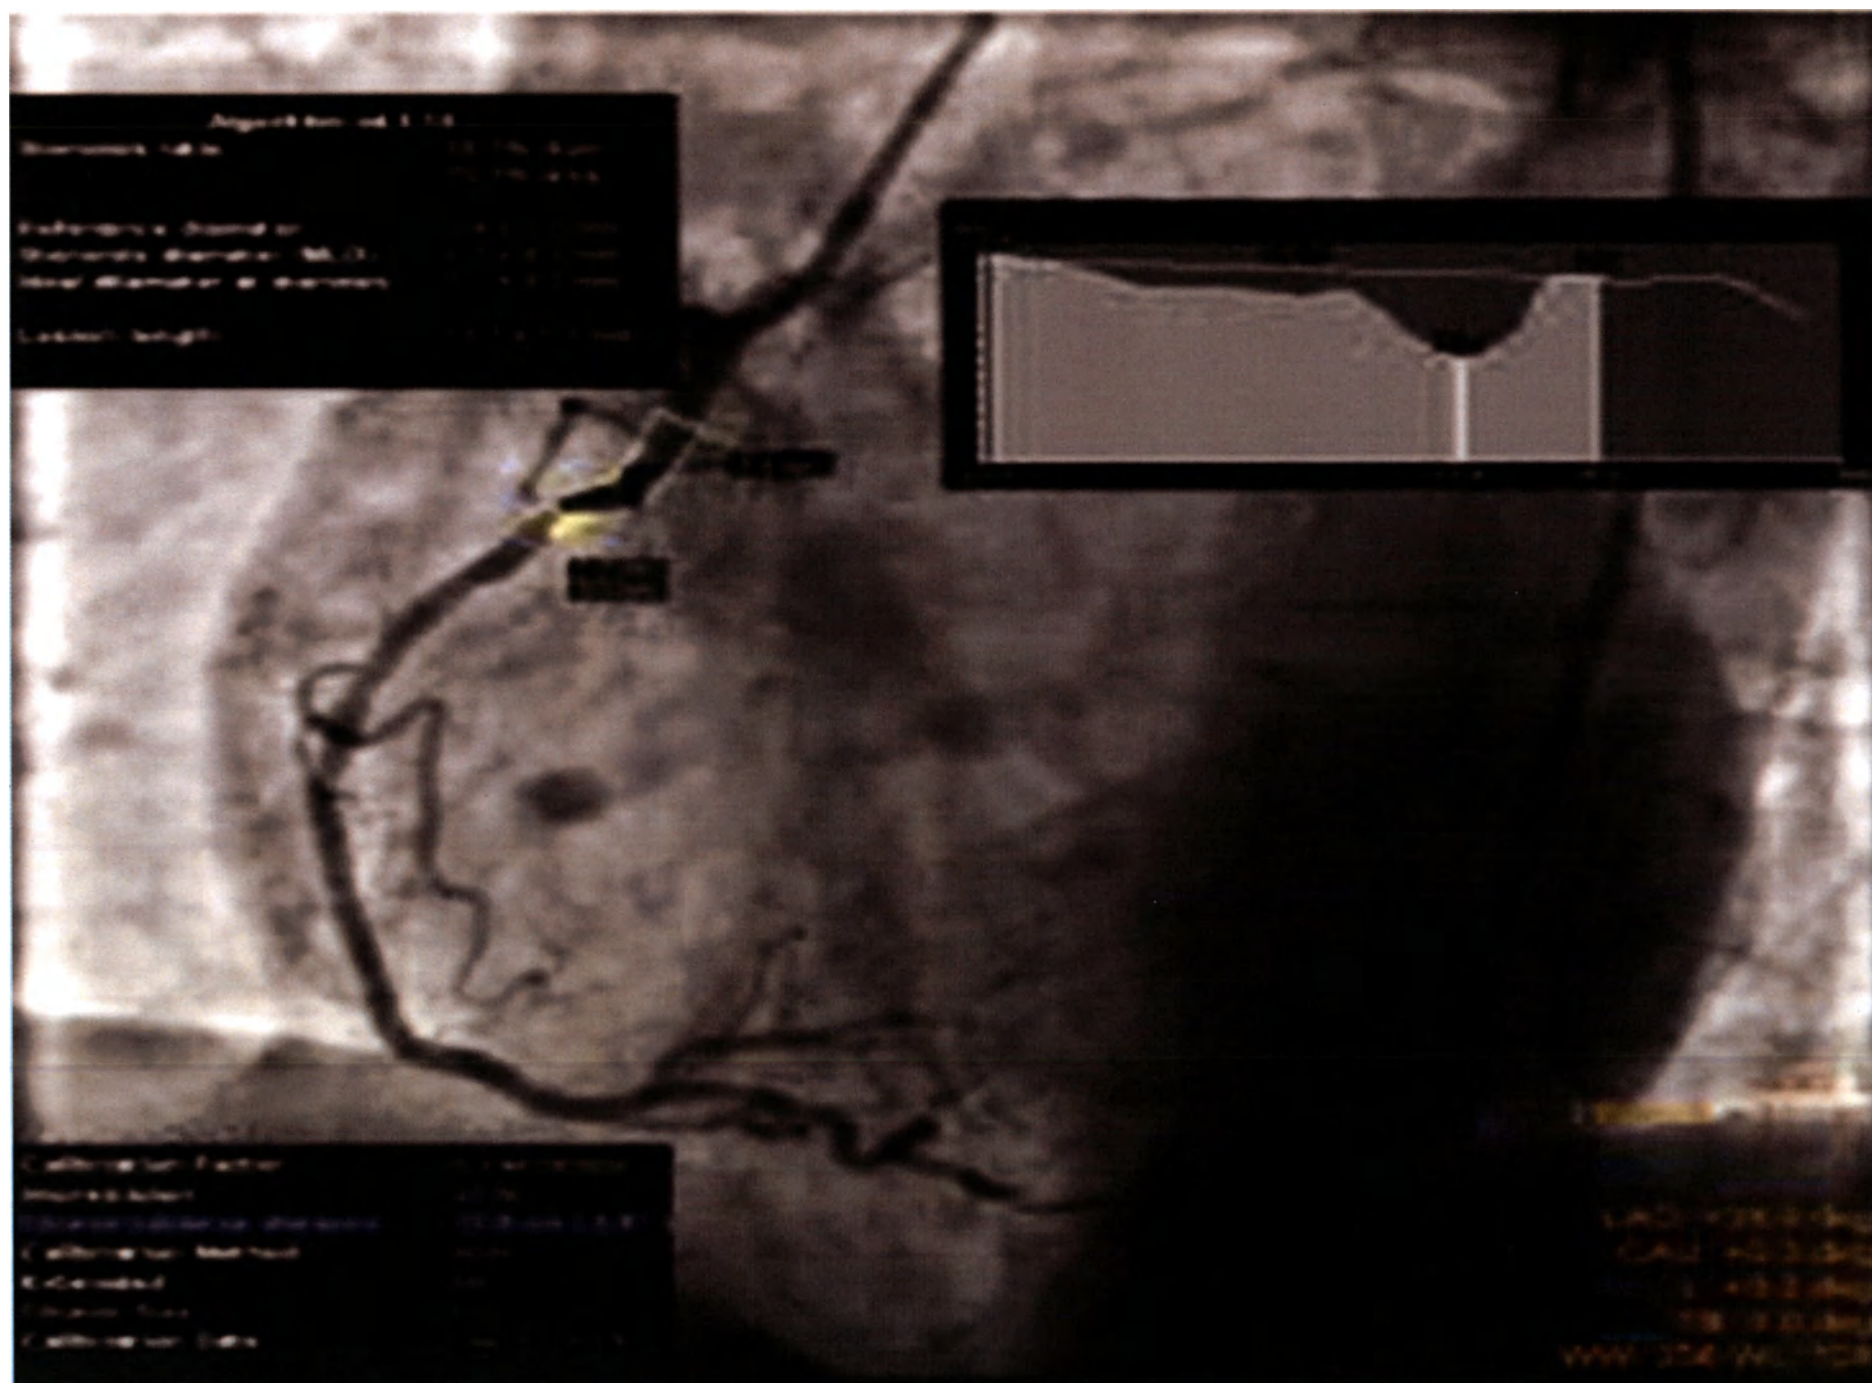

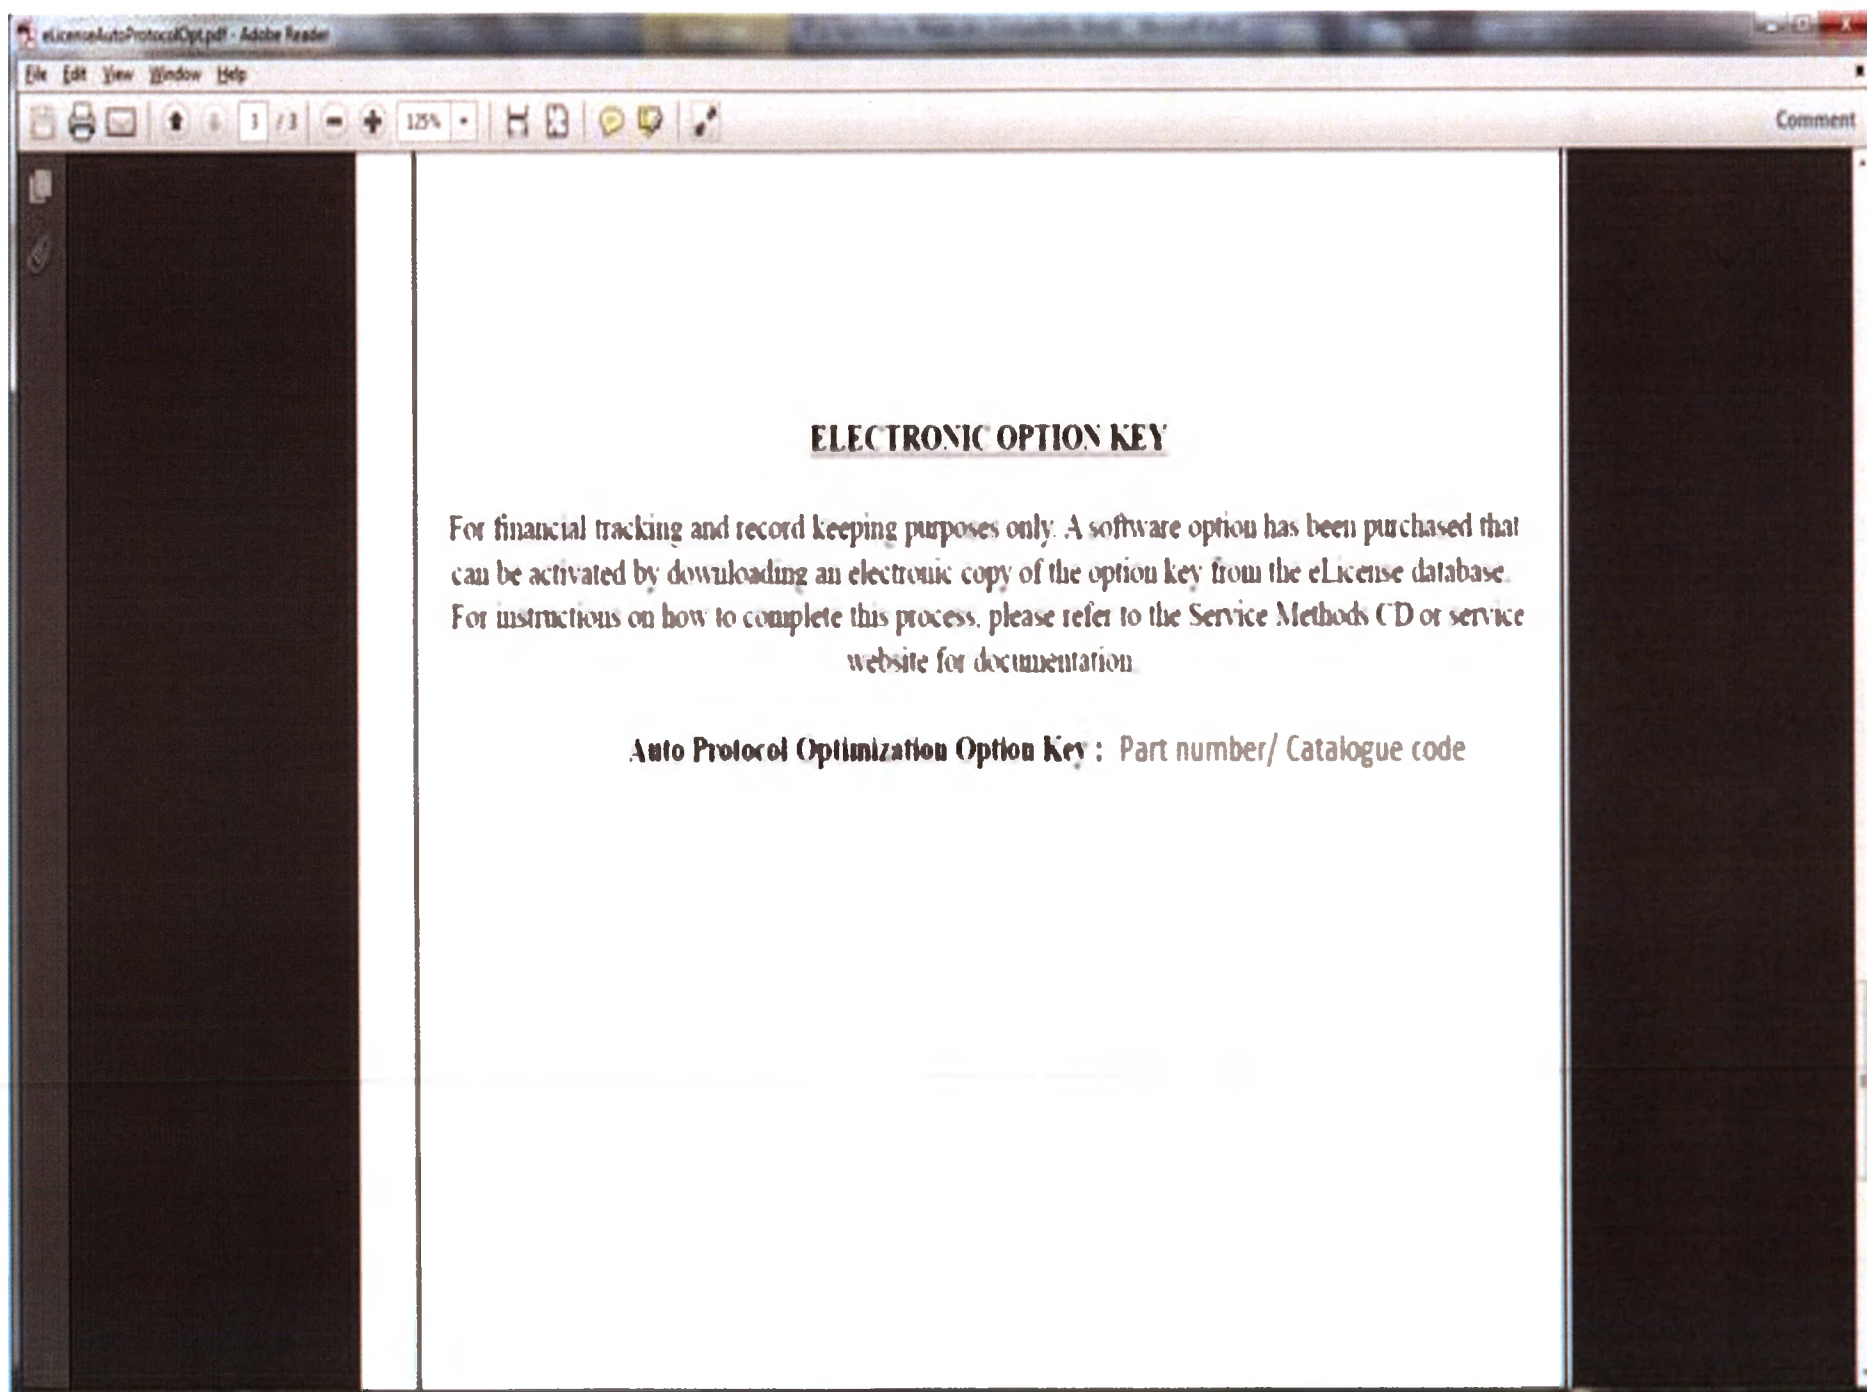


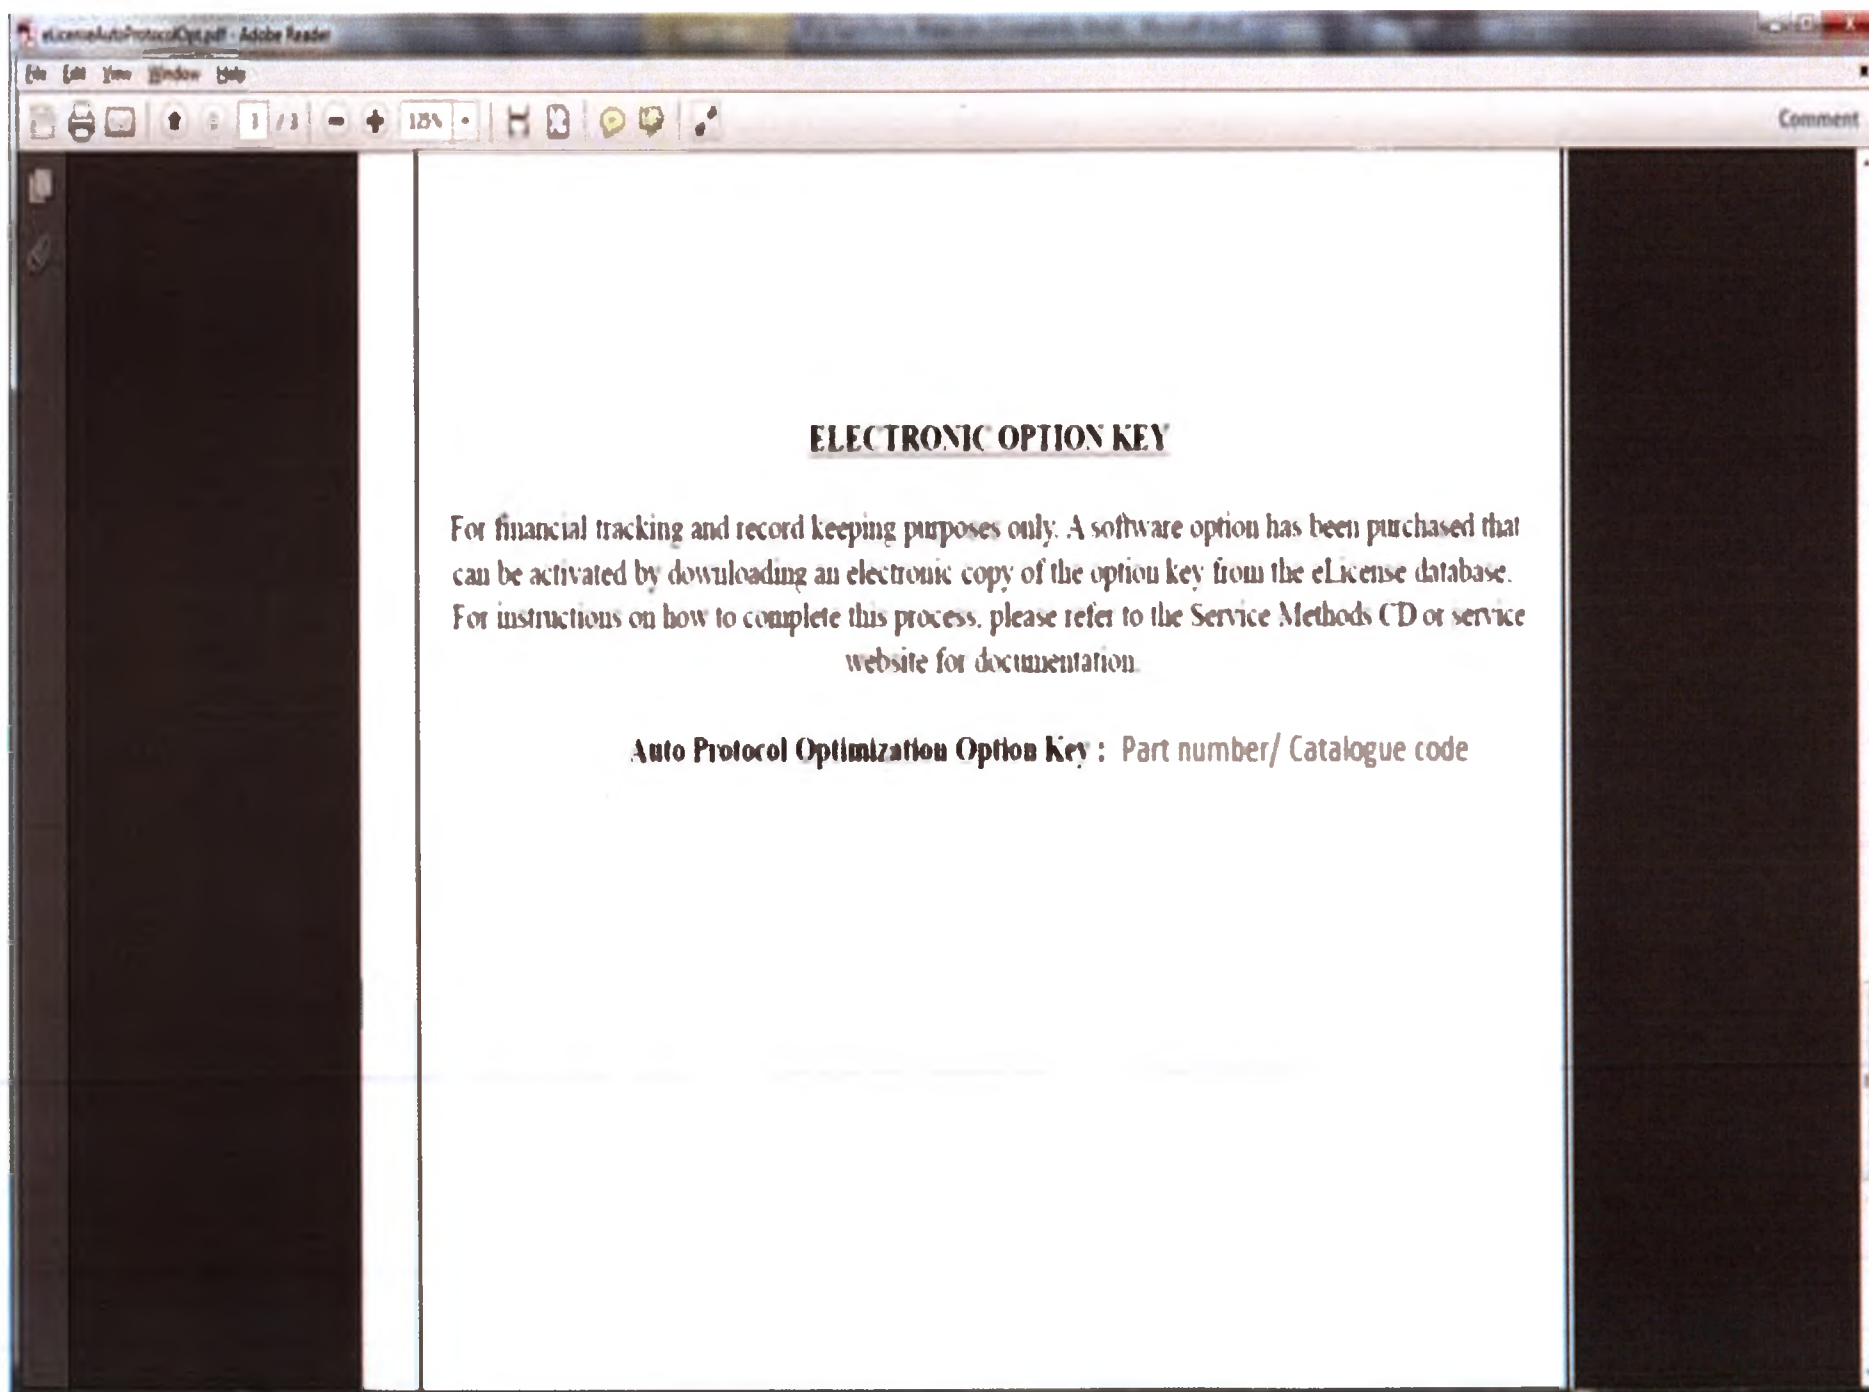


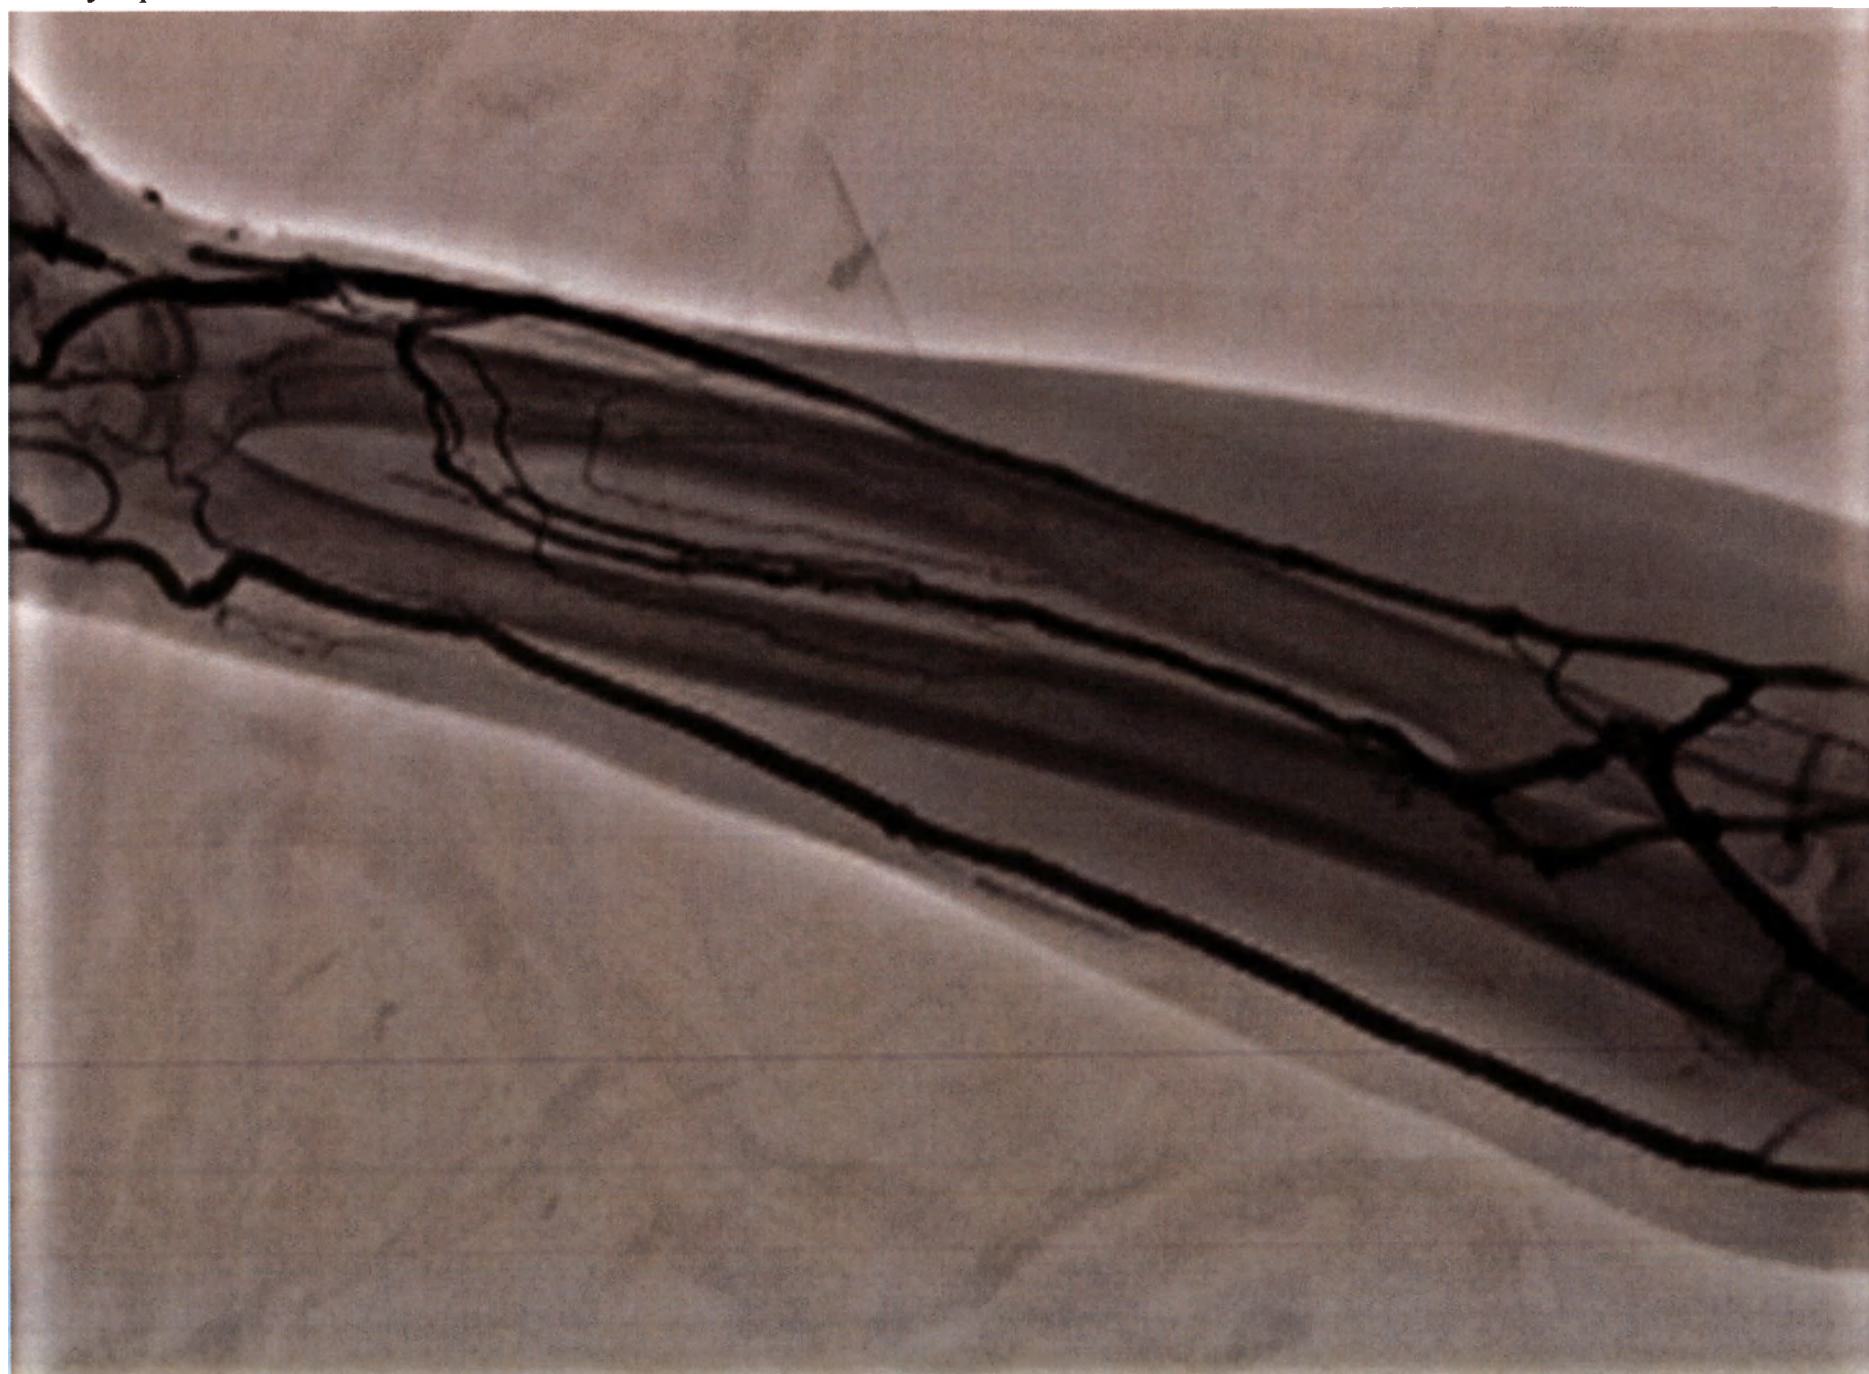


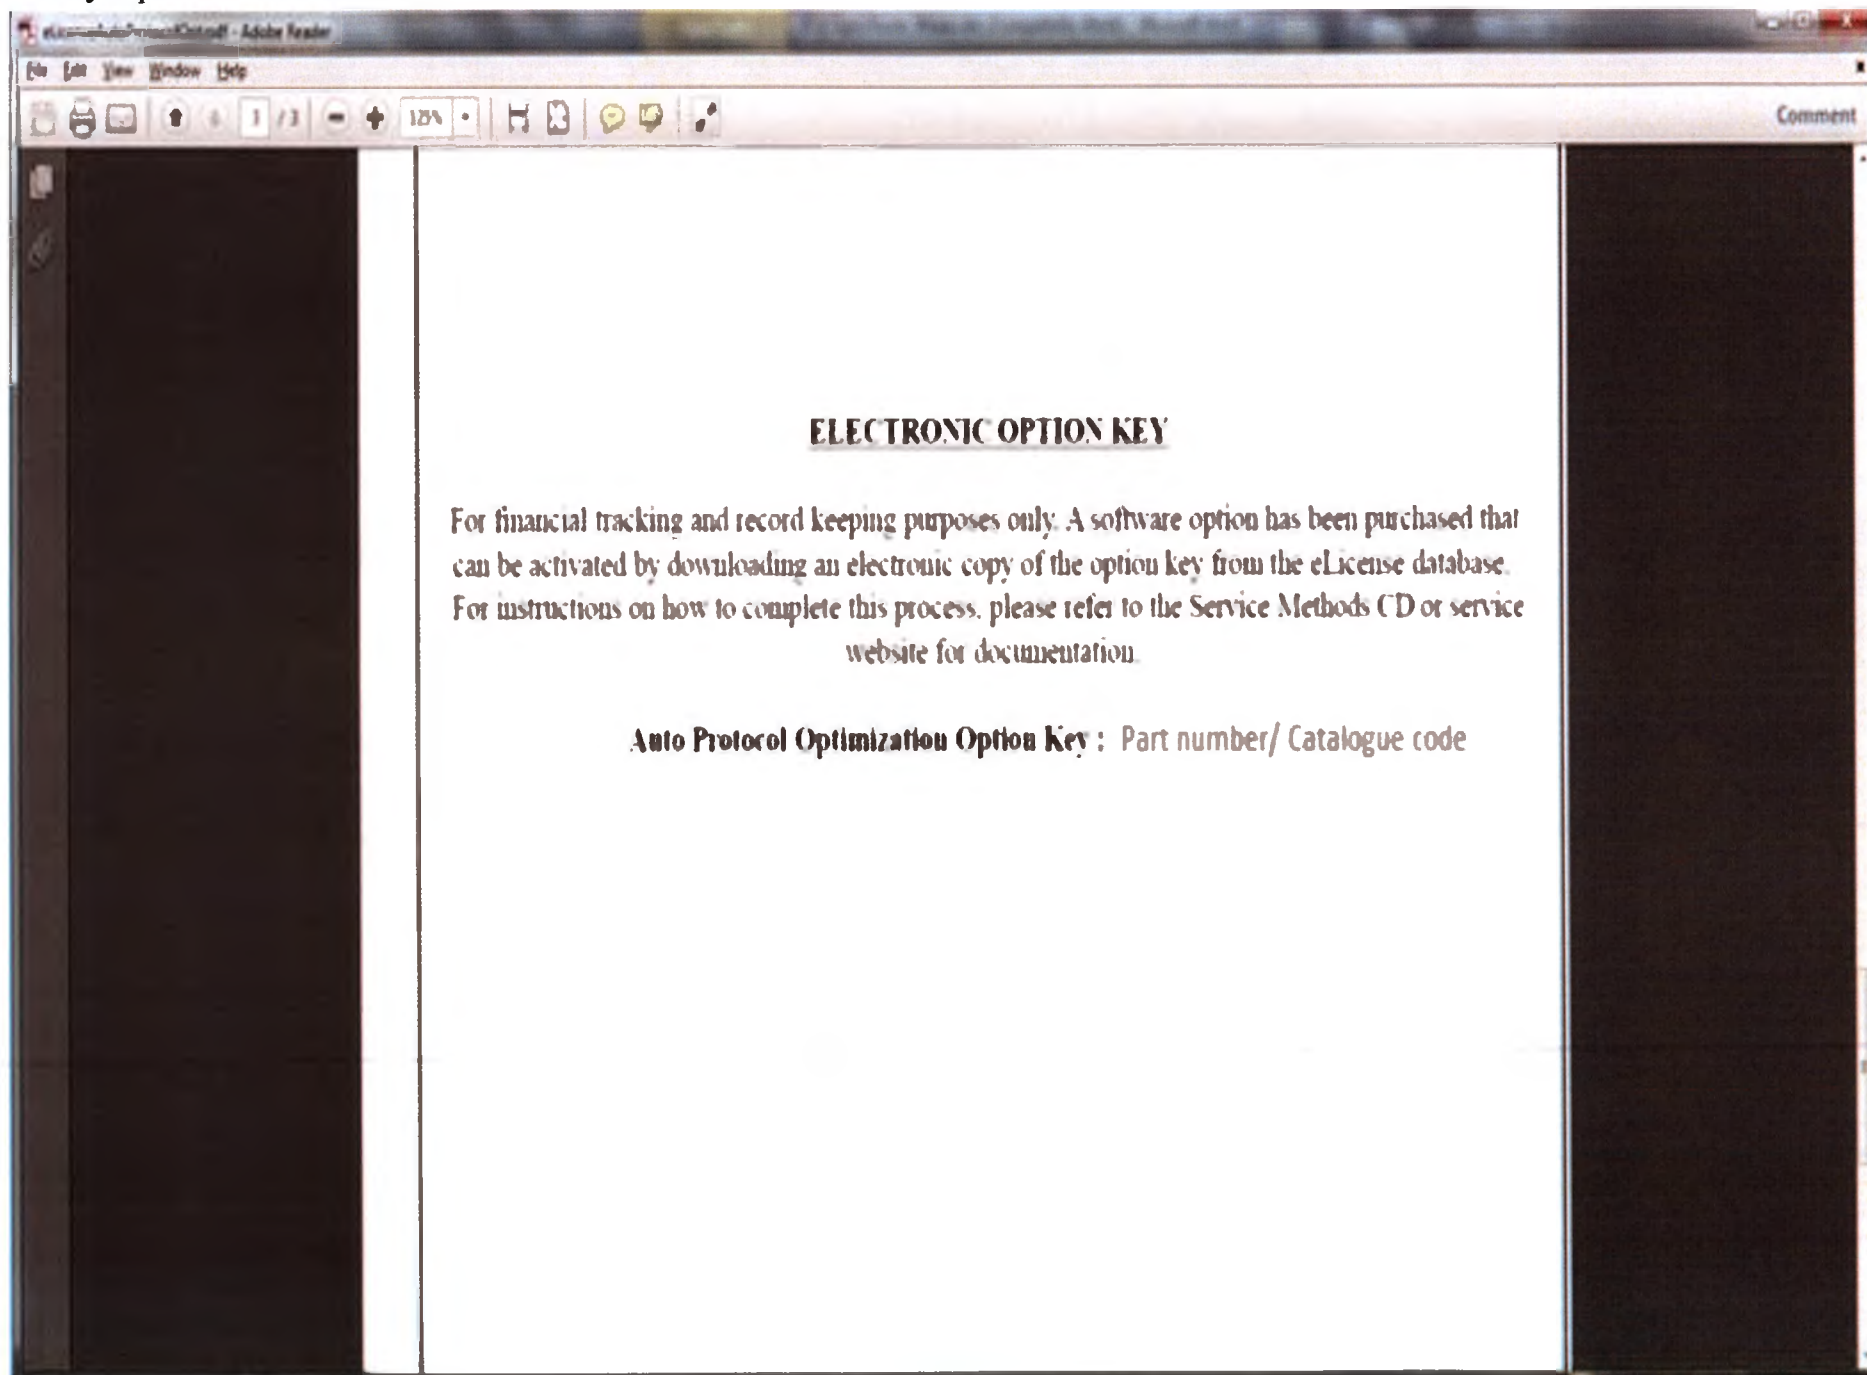


88.Модуль BREEZE для отслеживания контрастного вещества на всем протяжении сосуда при его одномерном заполне- 121
нии.

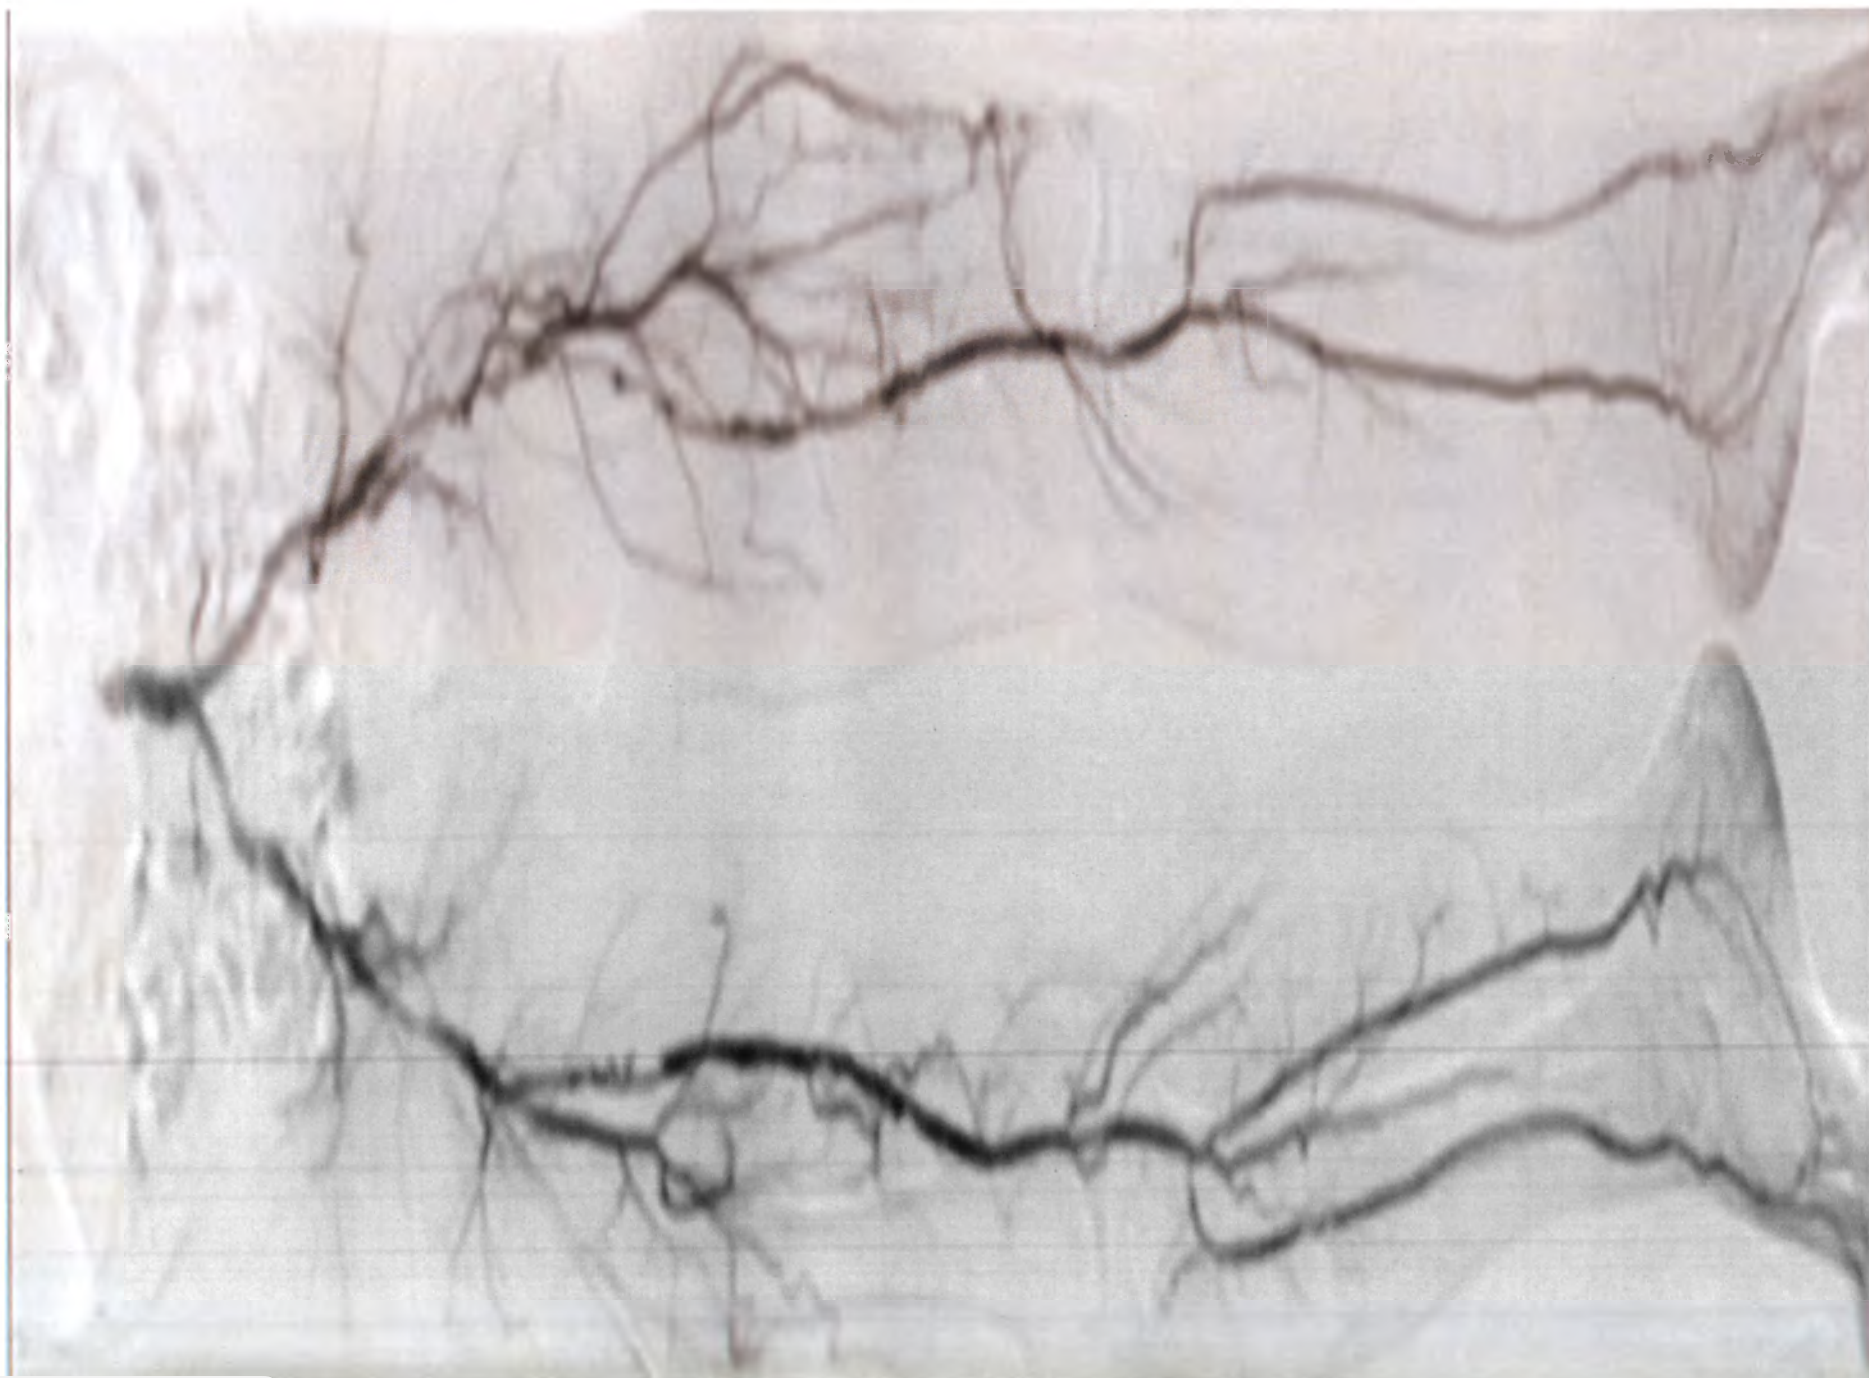


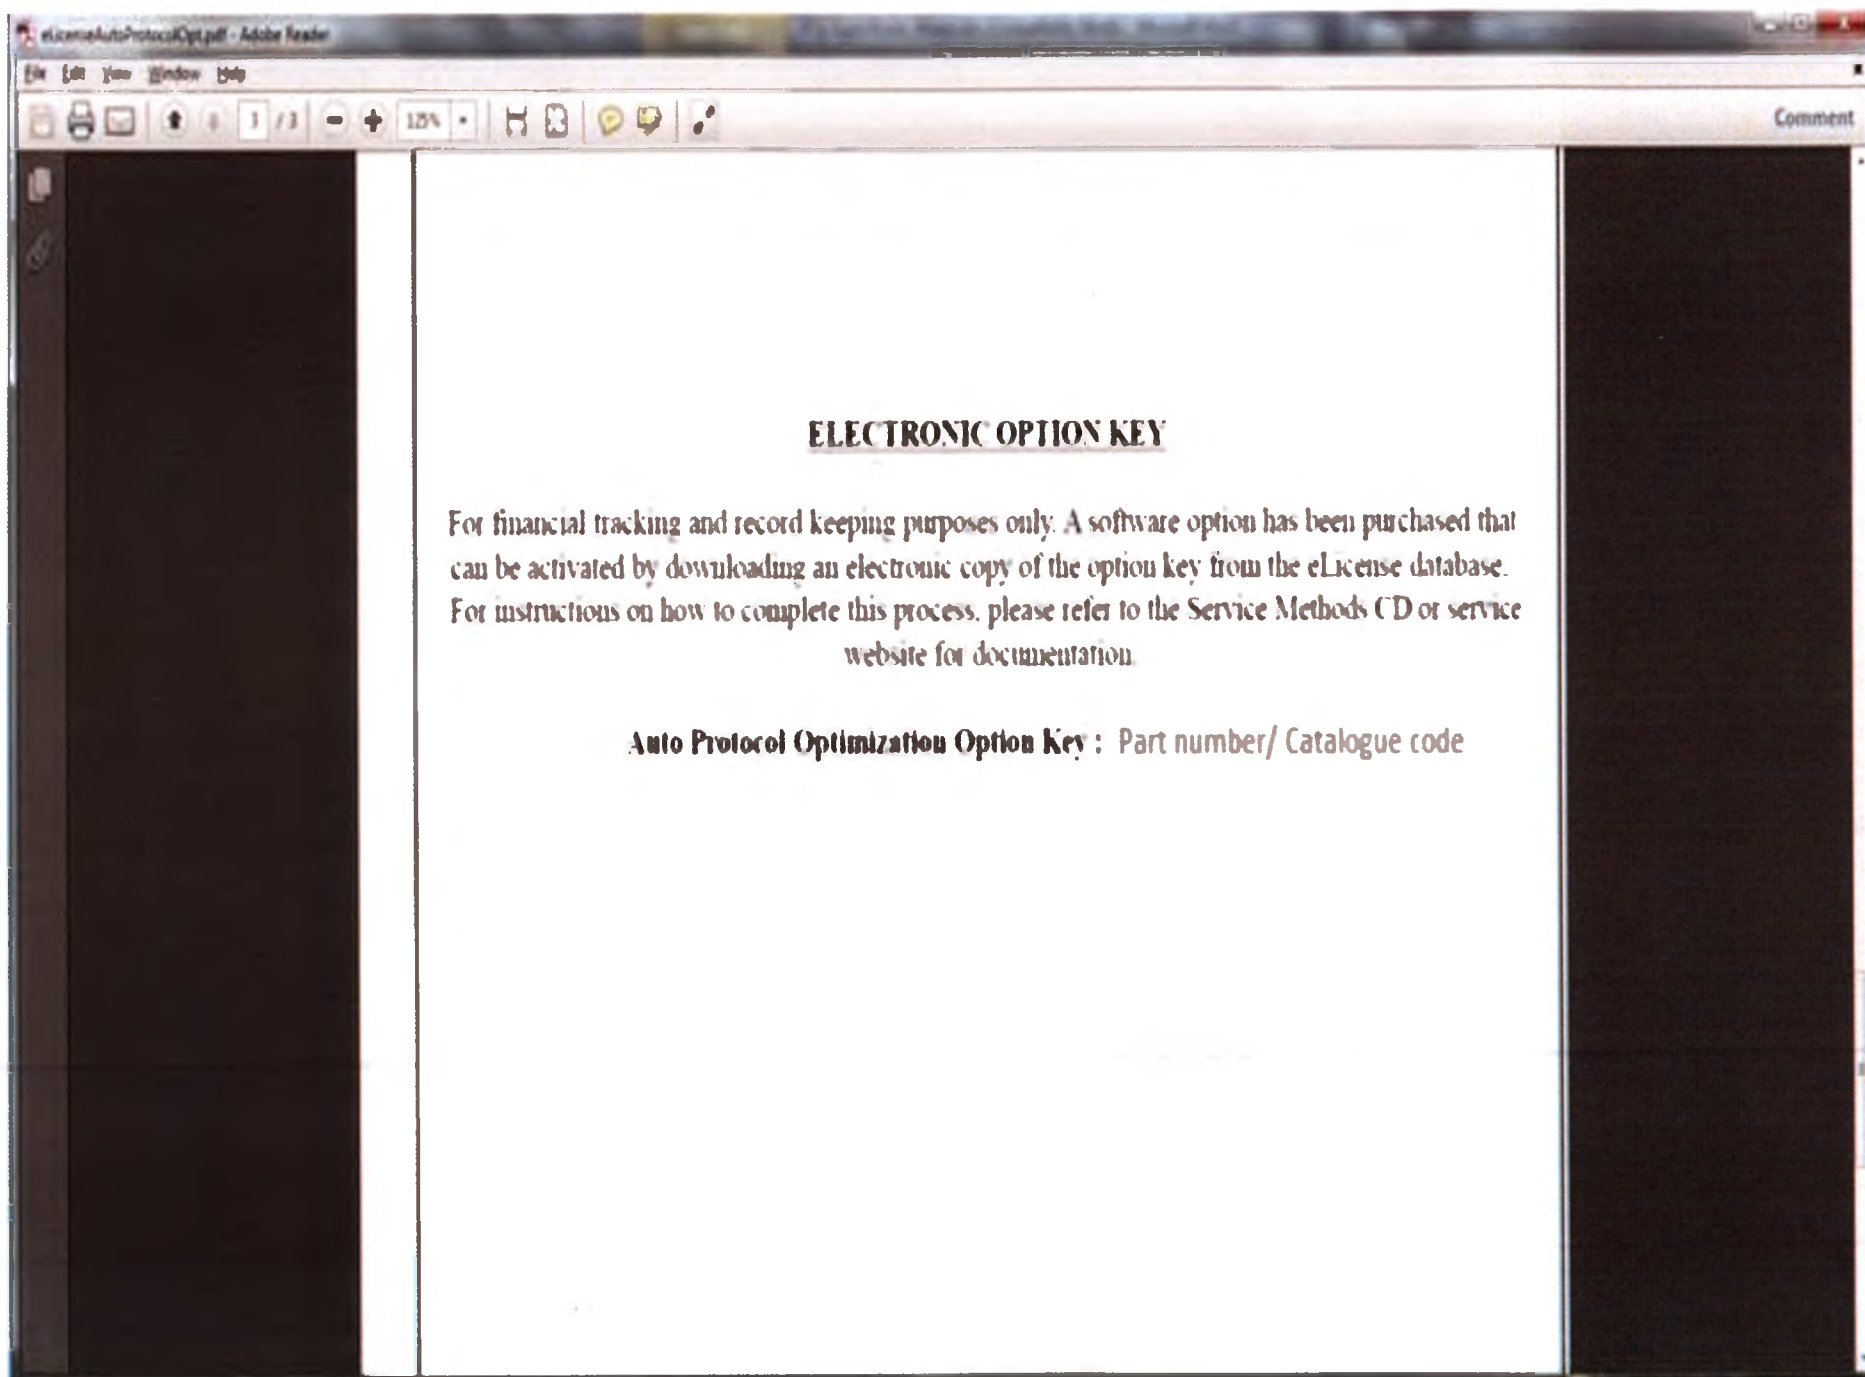


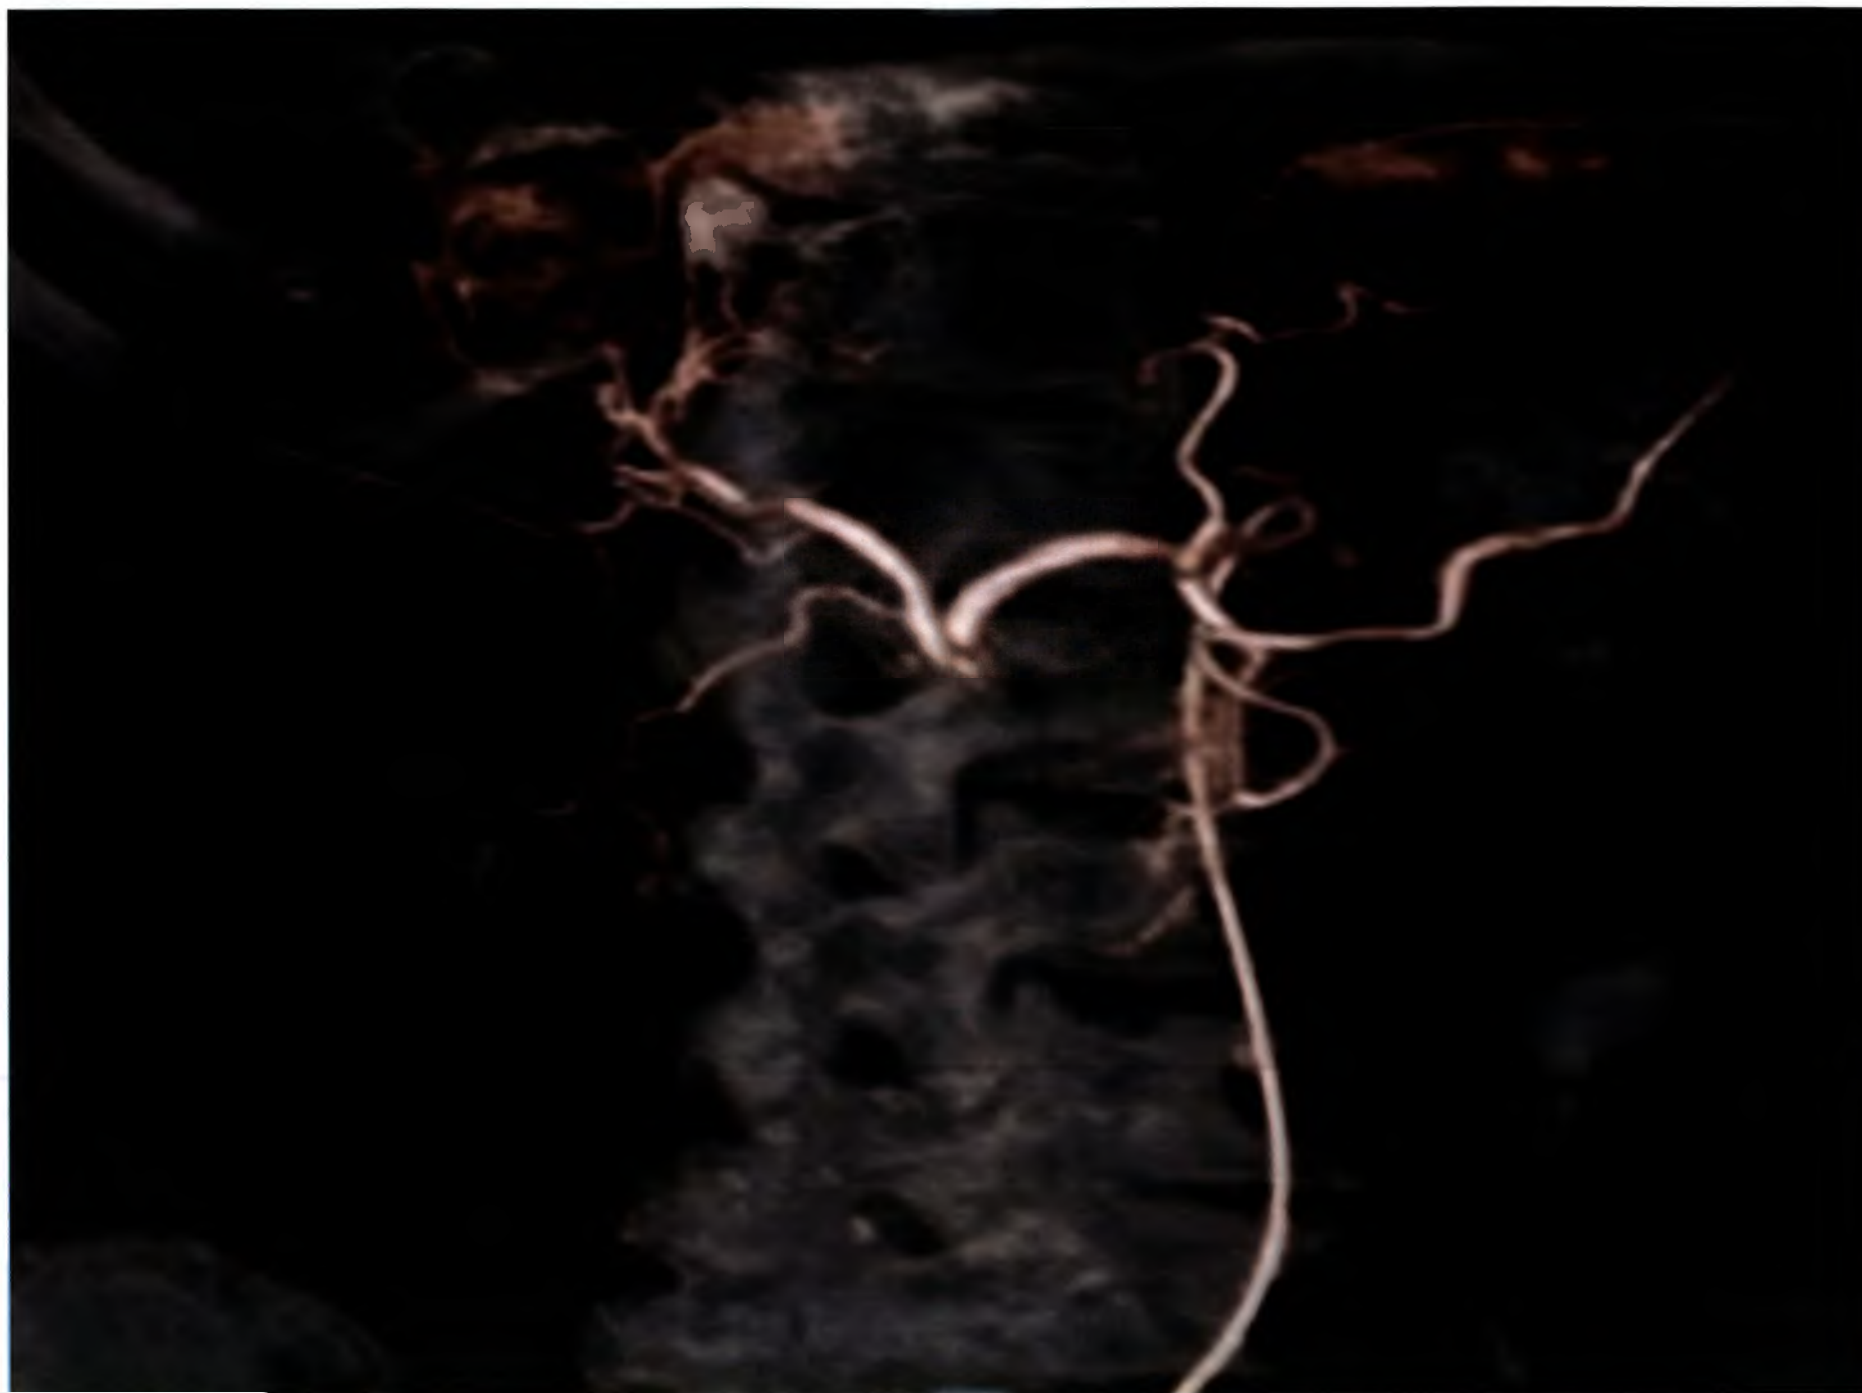





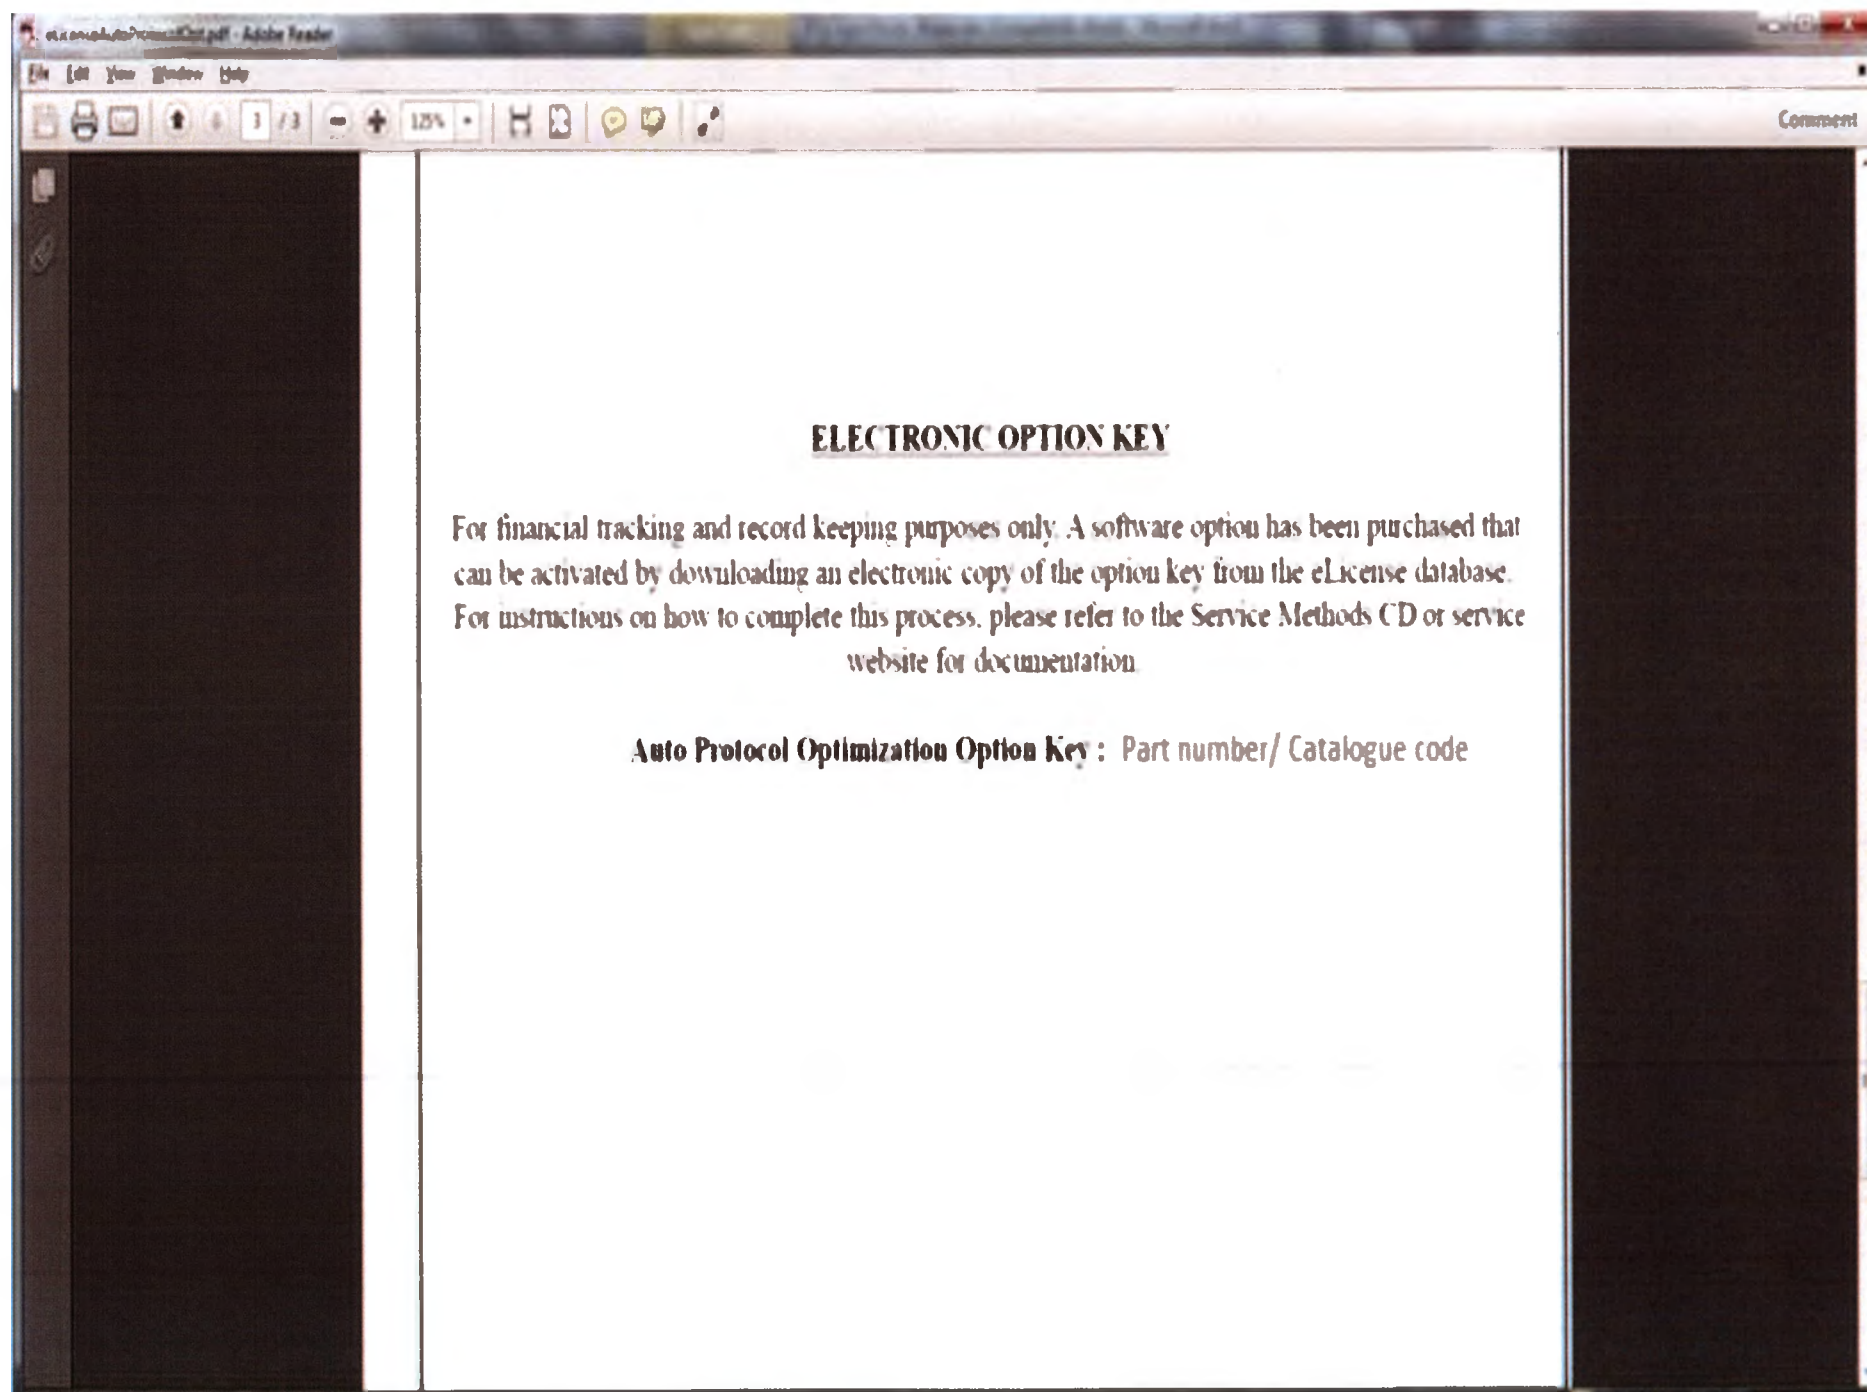


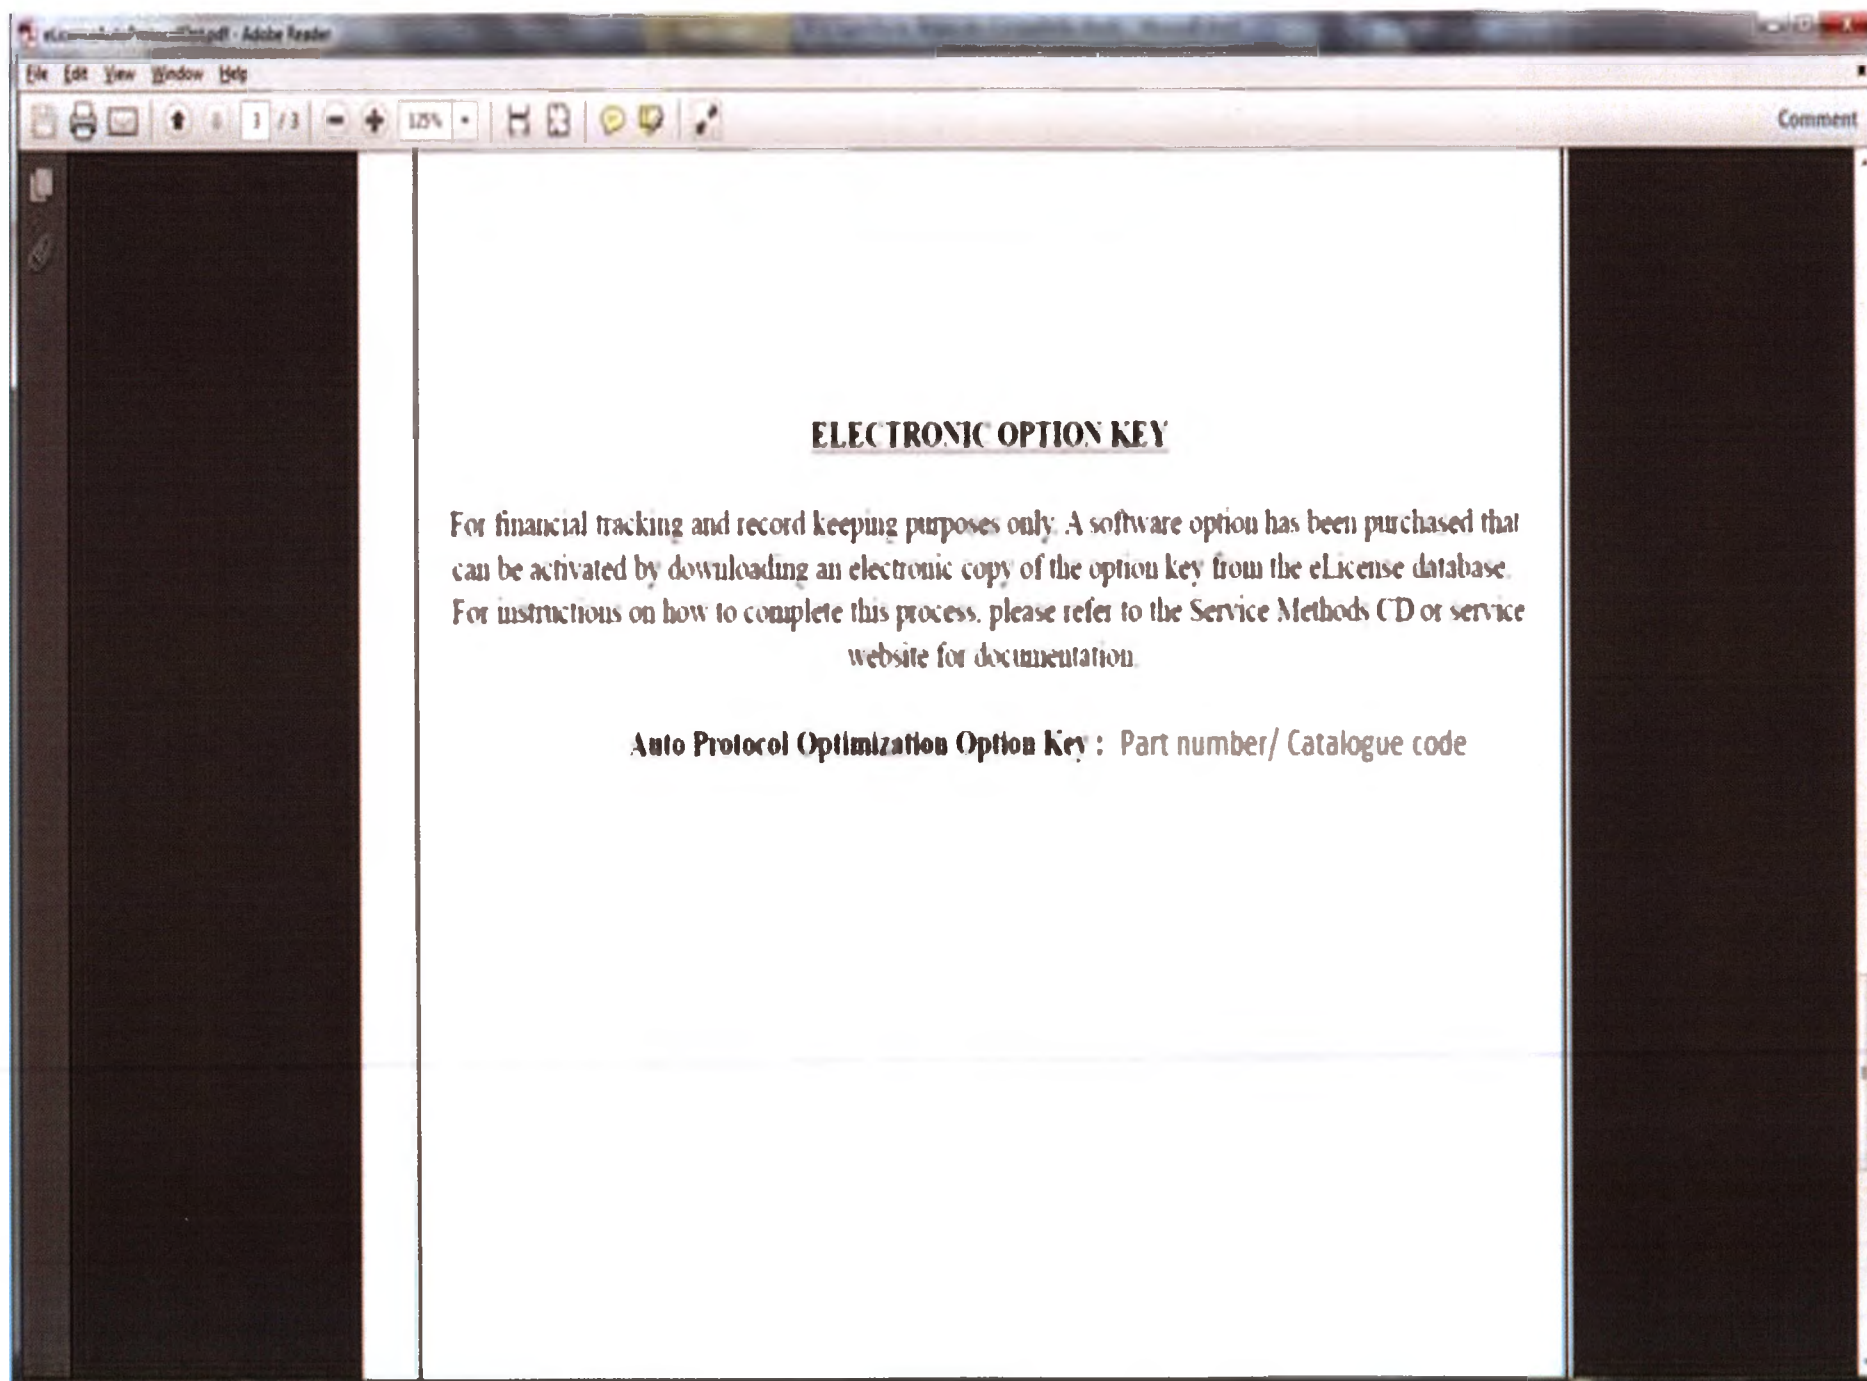


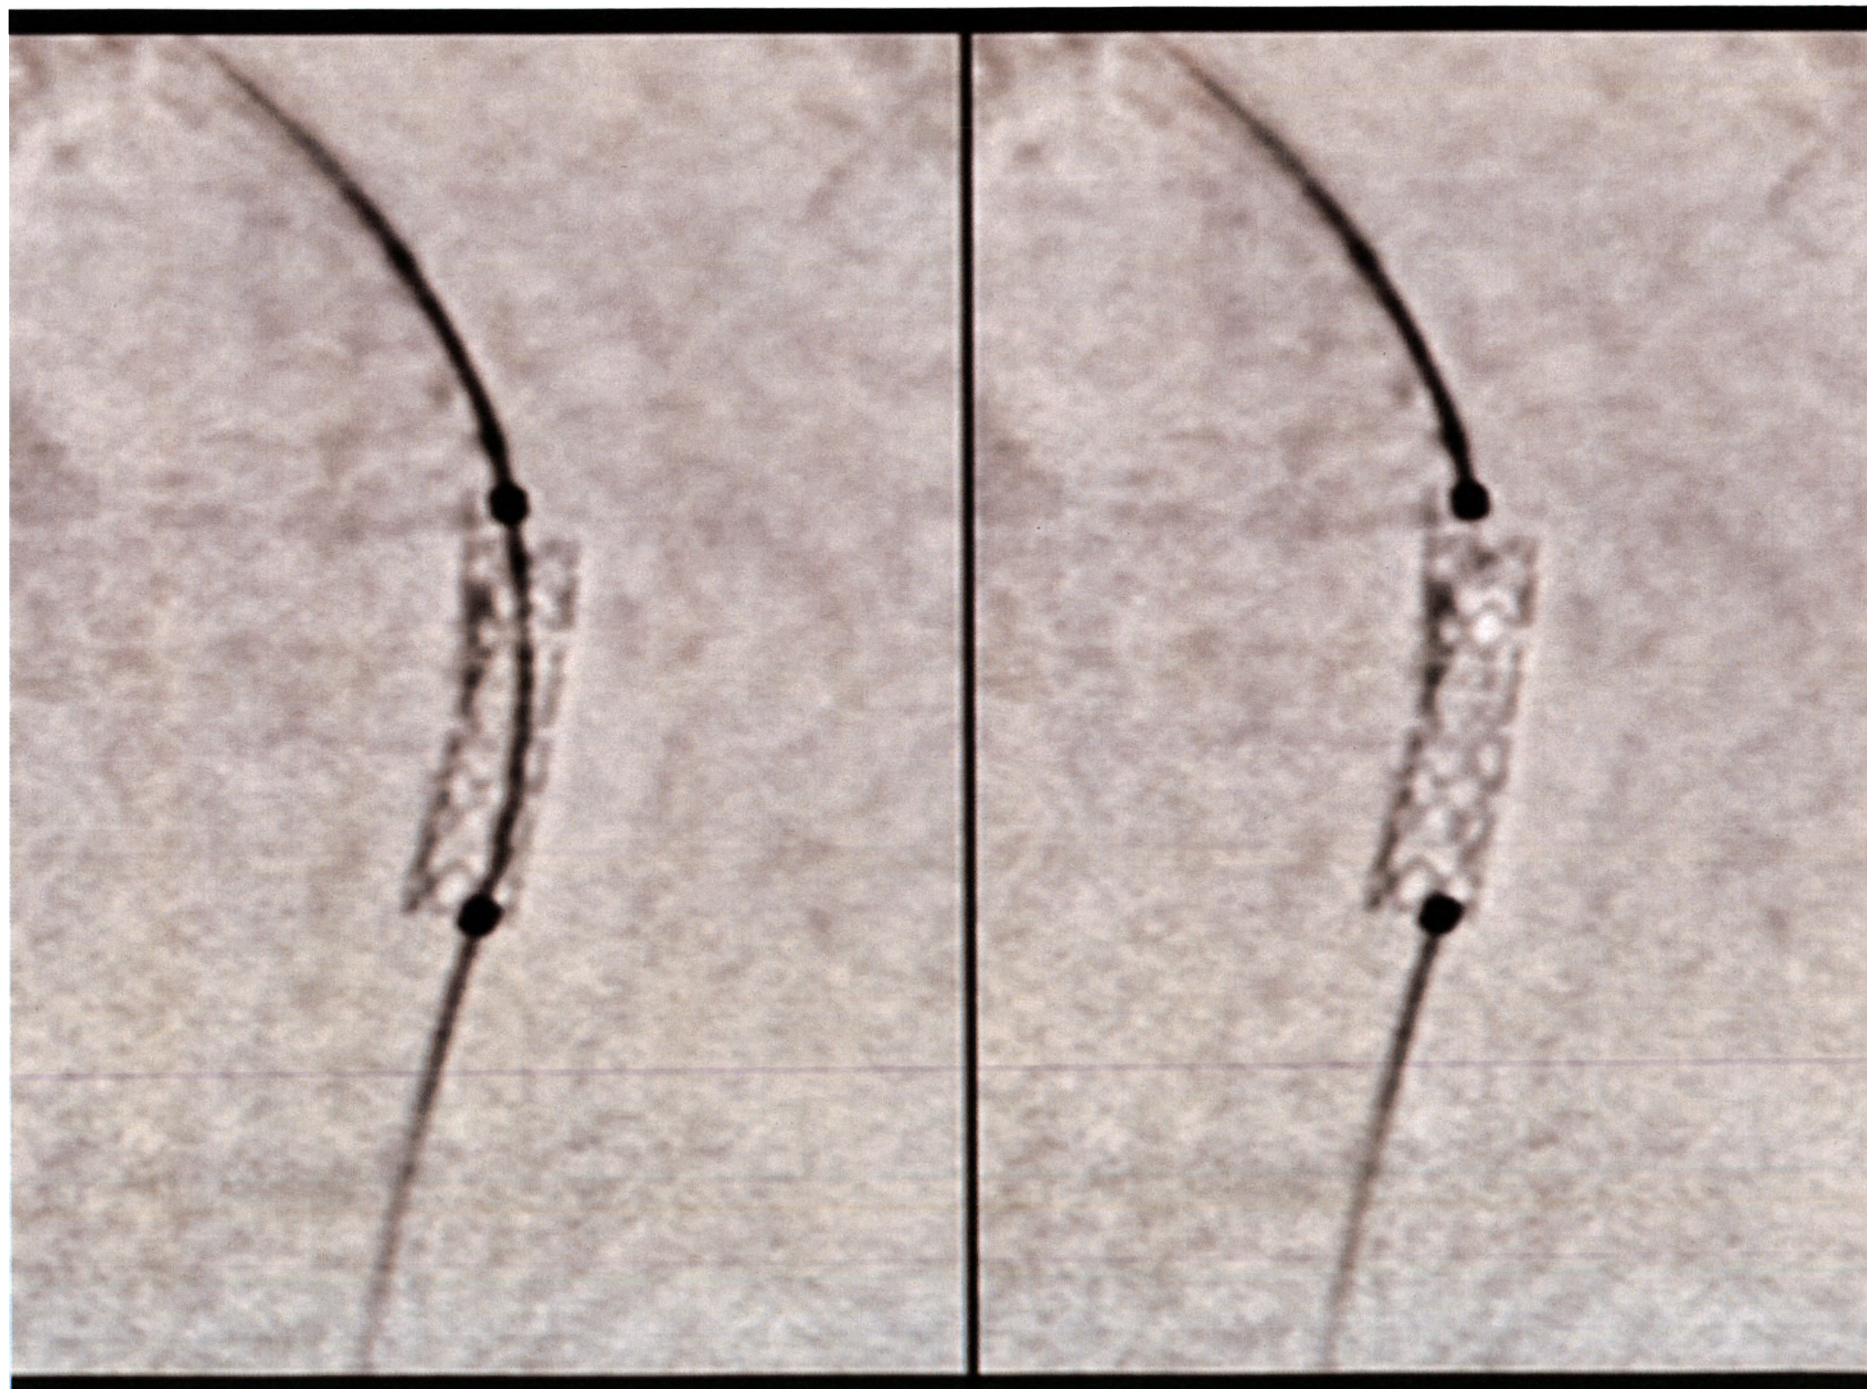


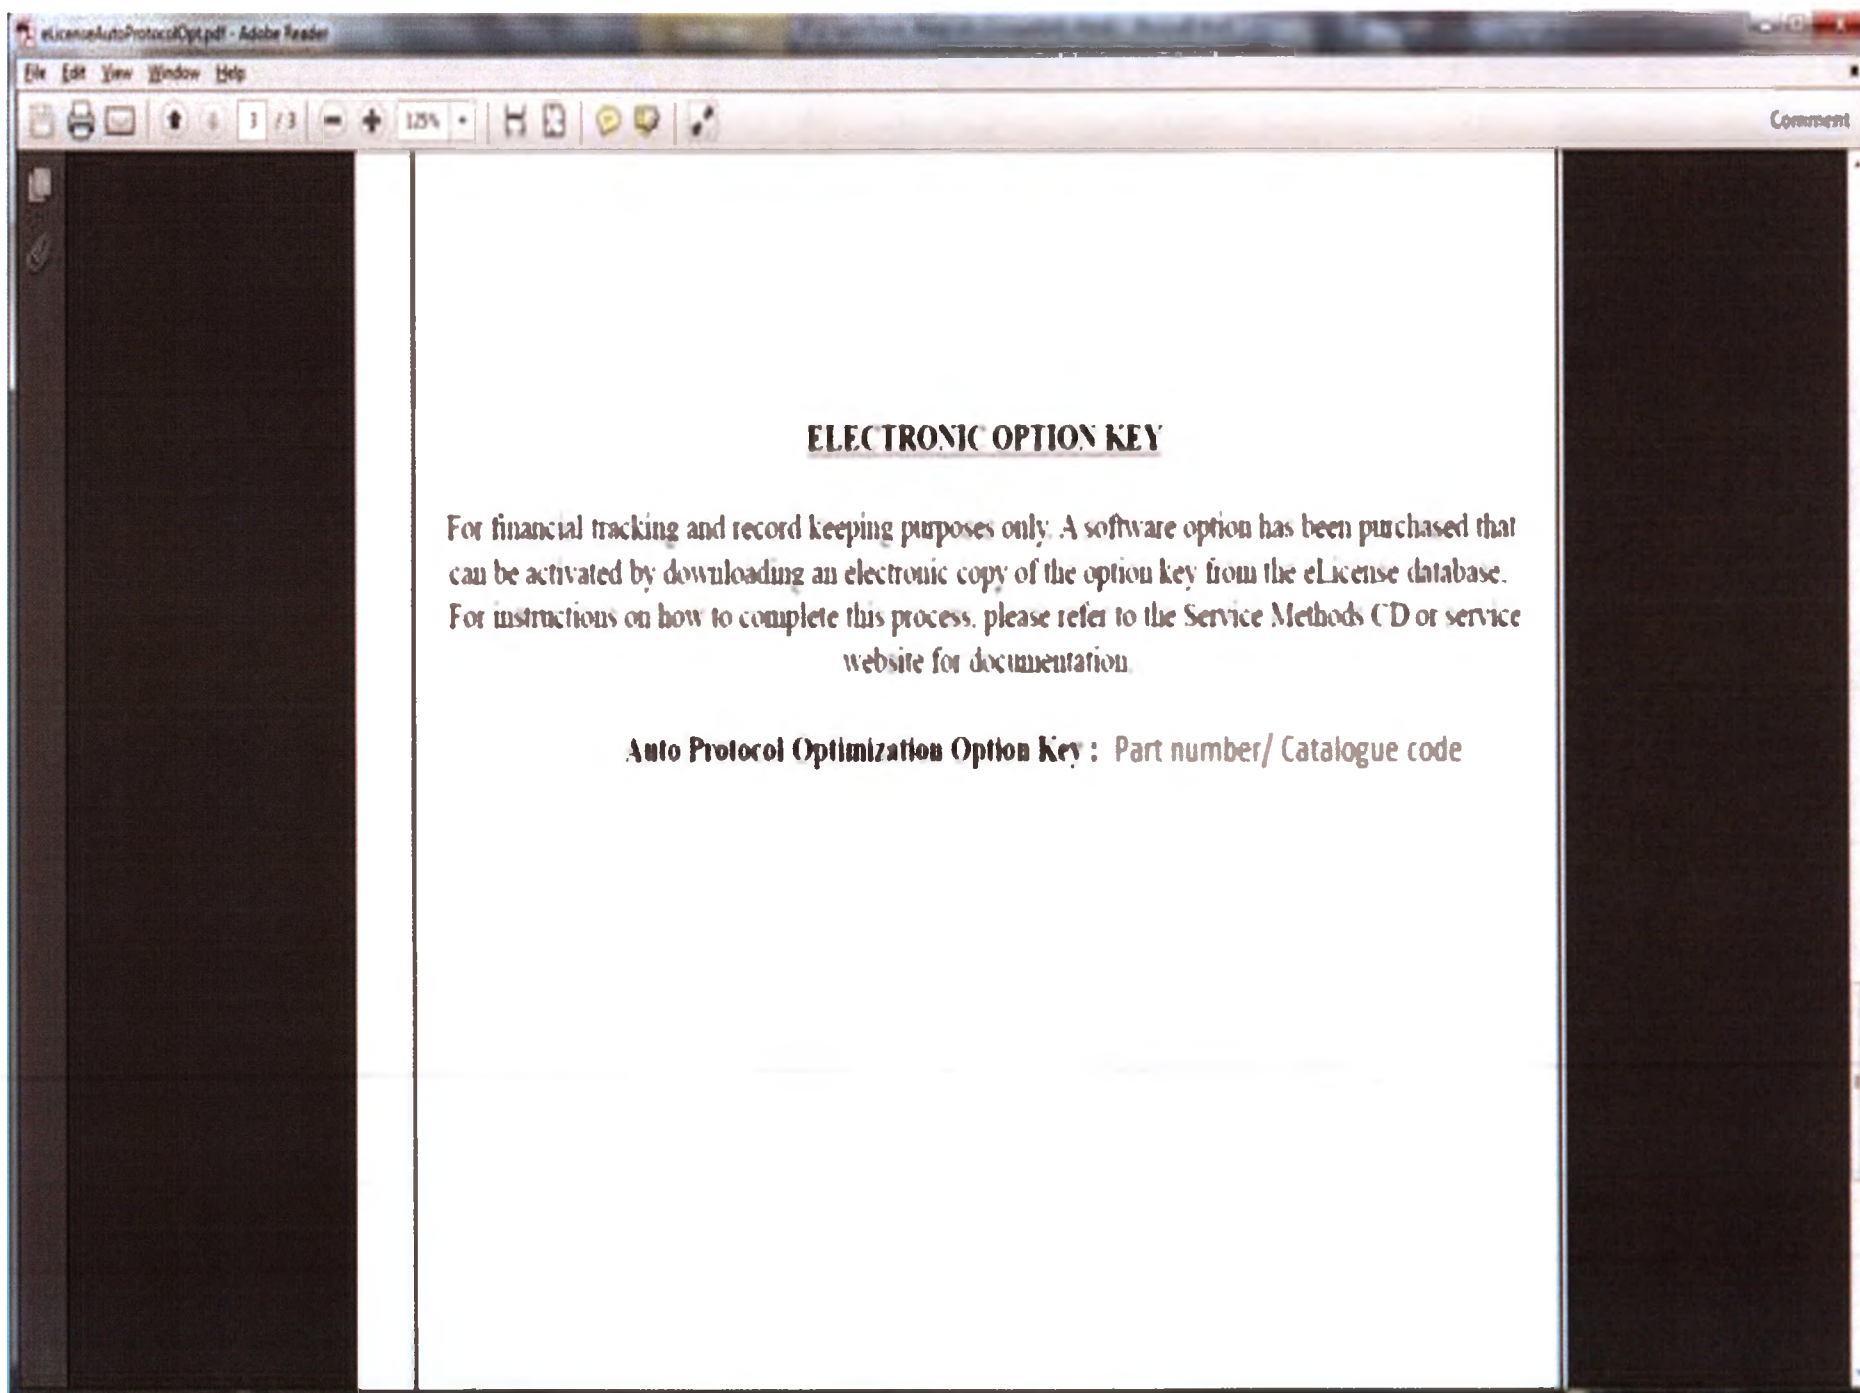


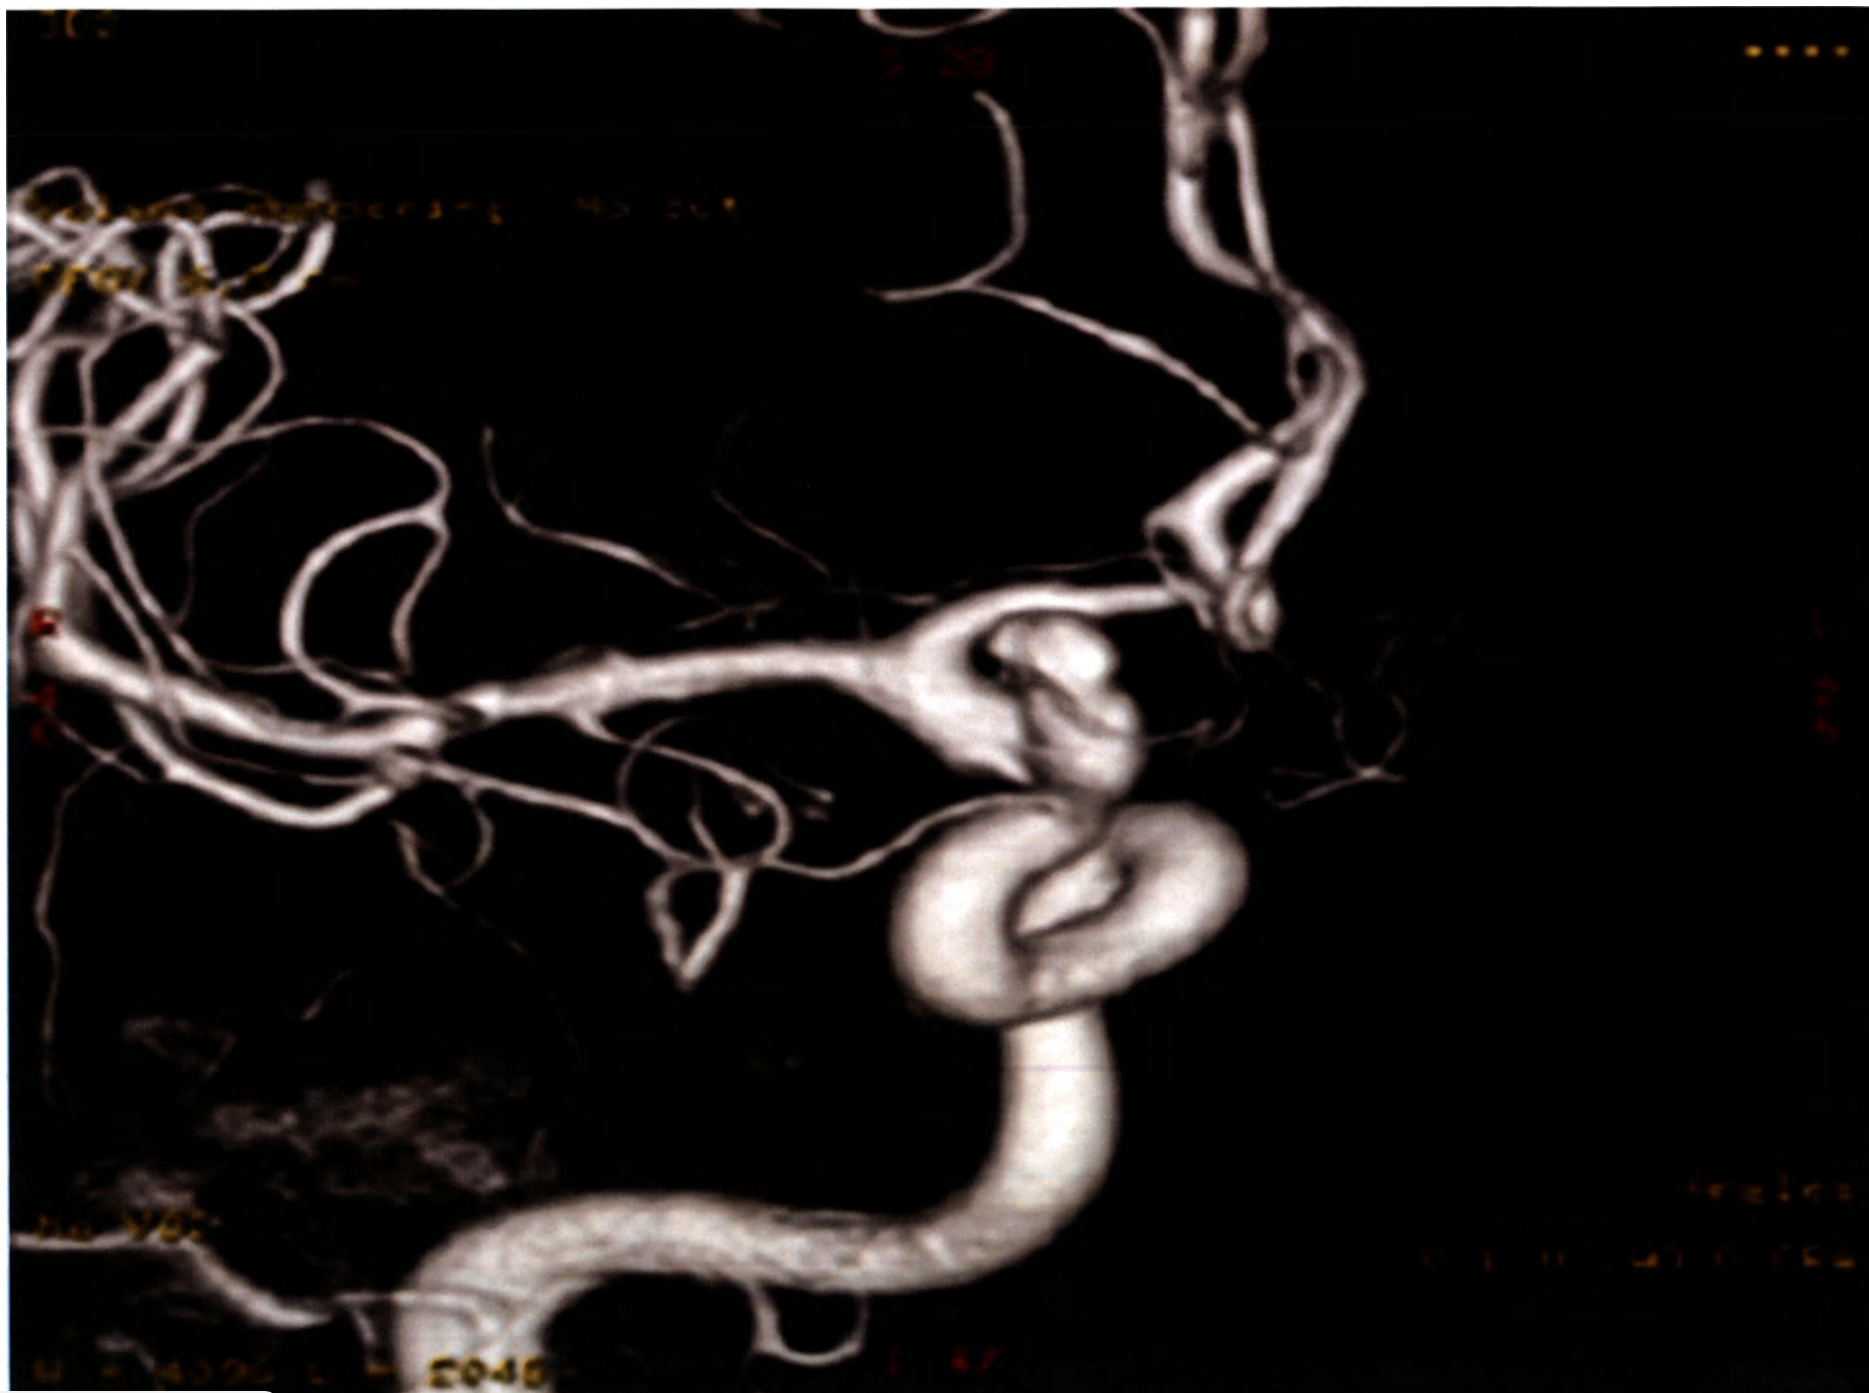


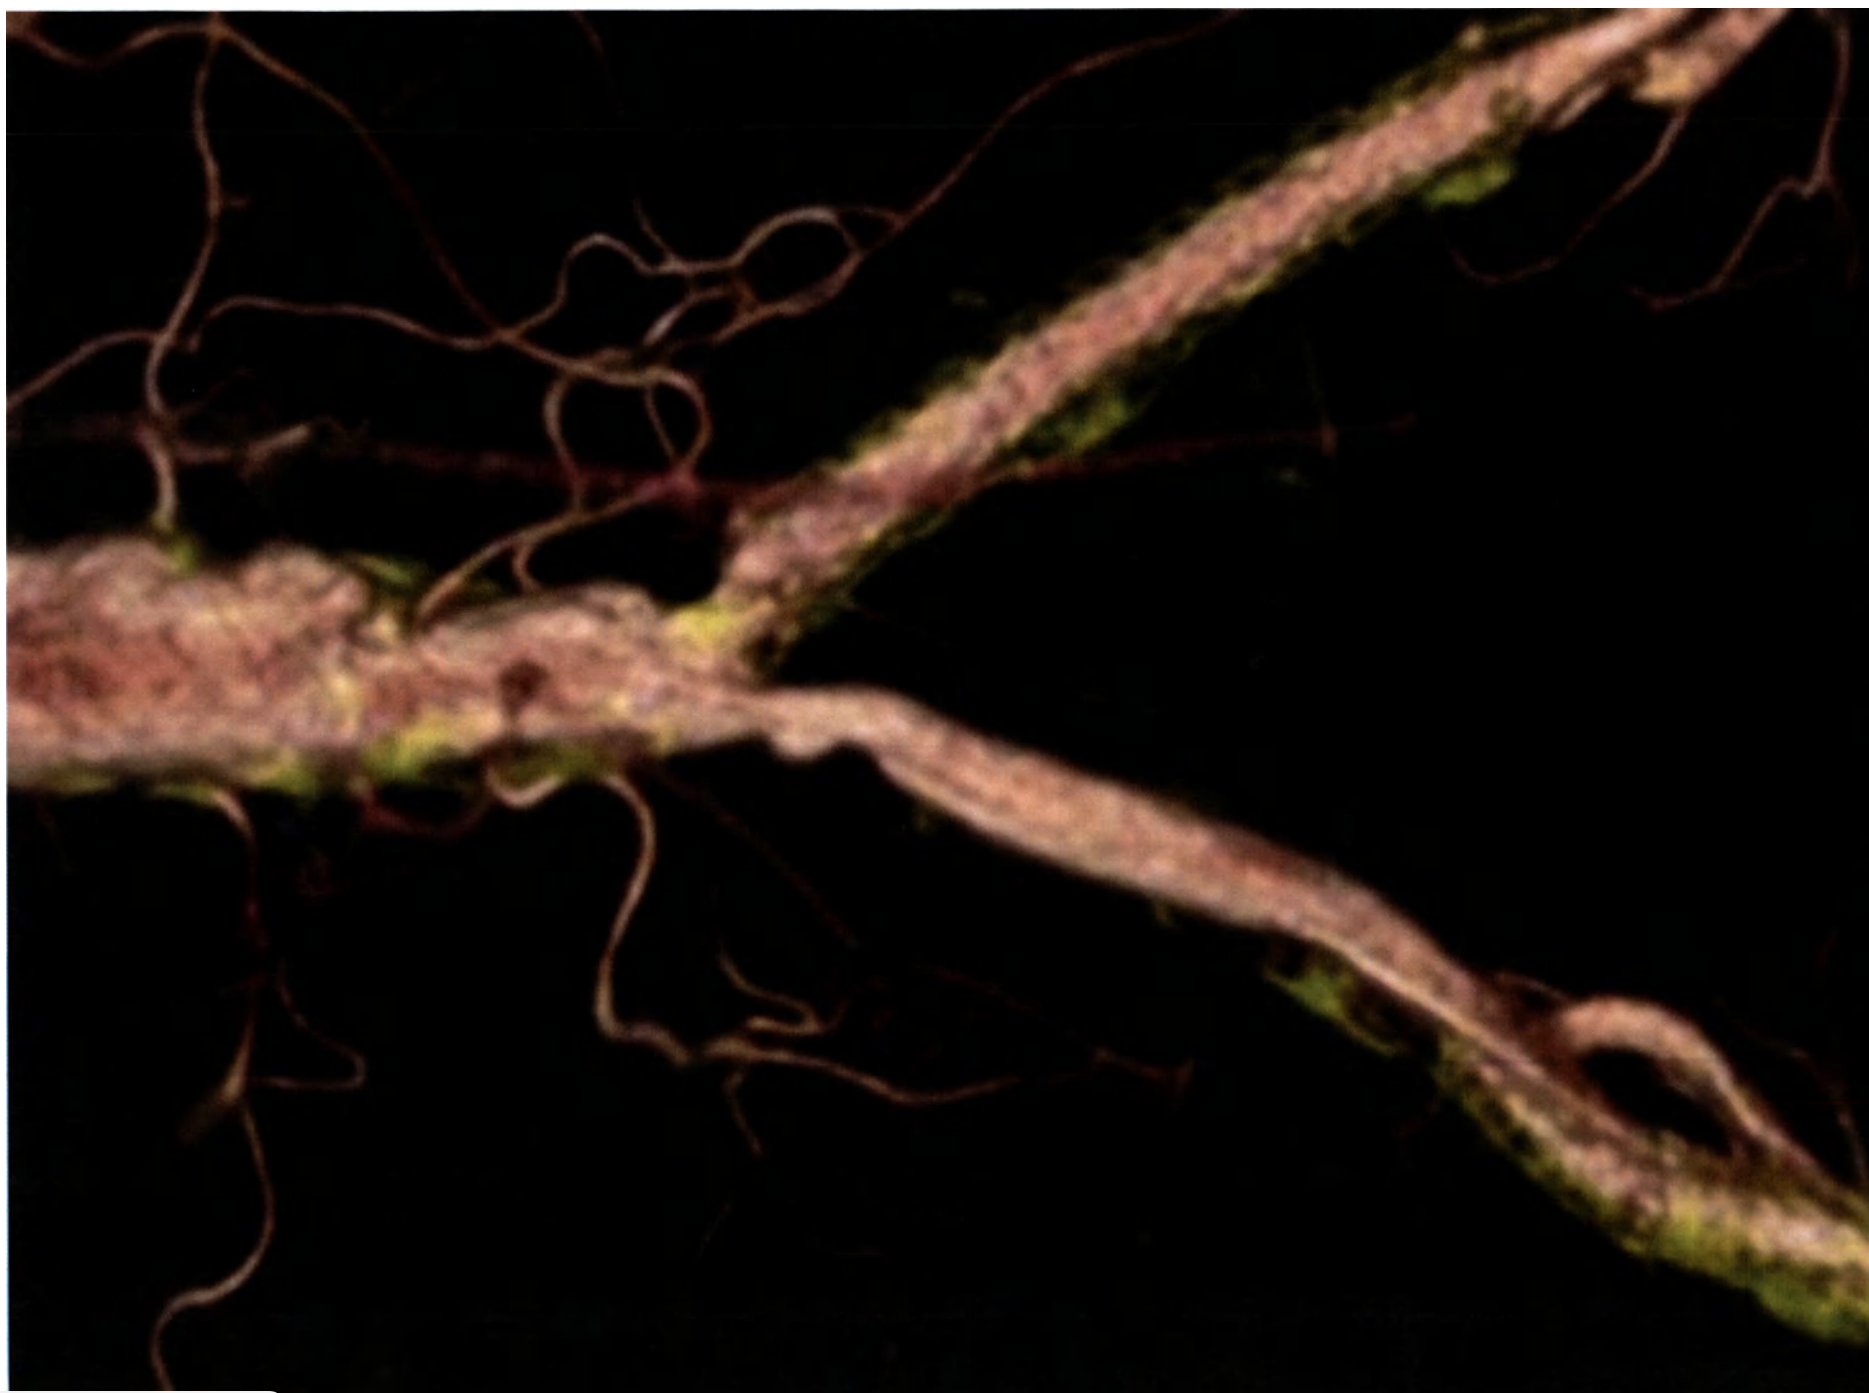


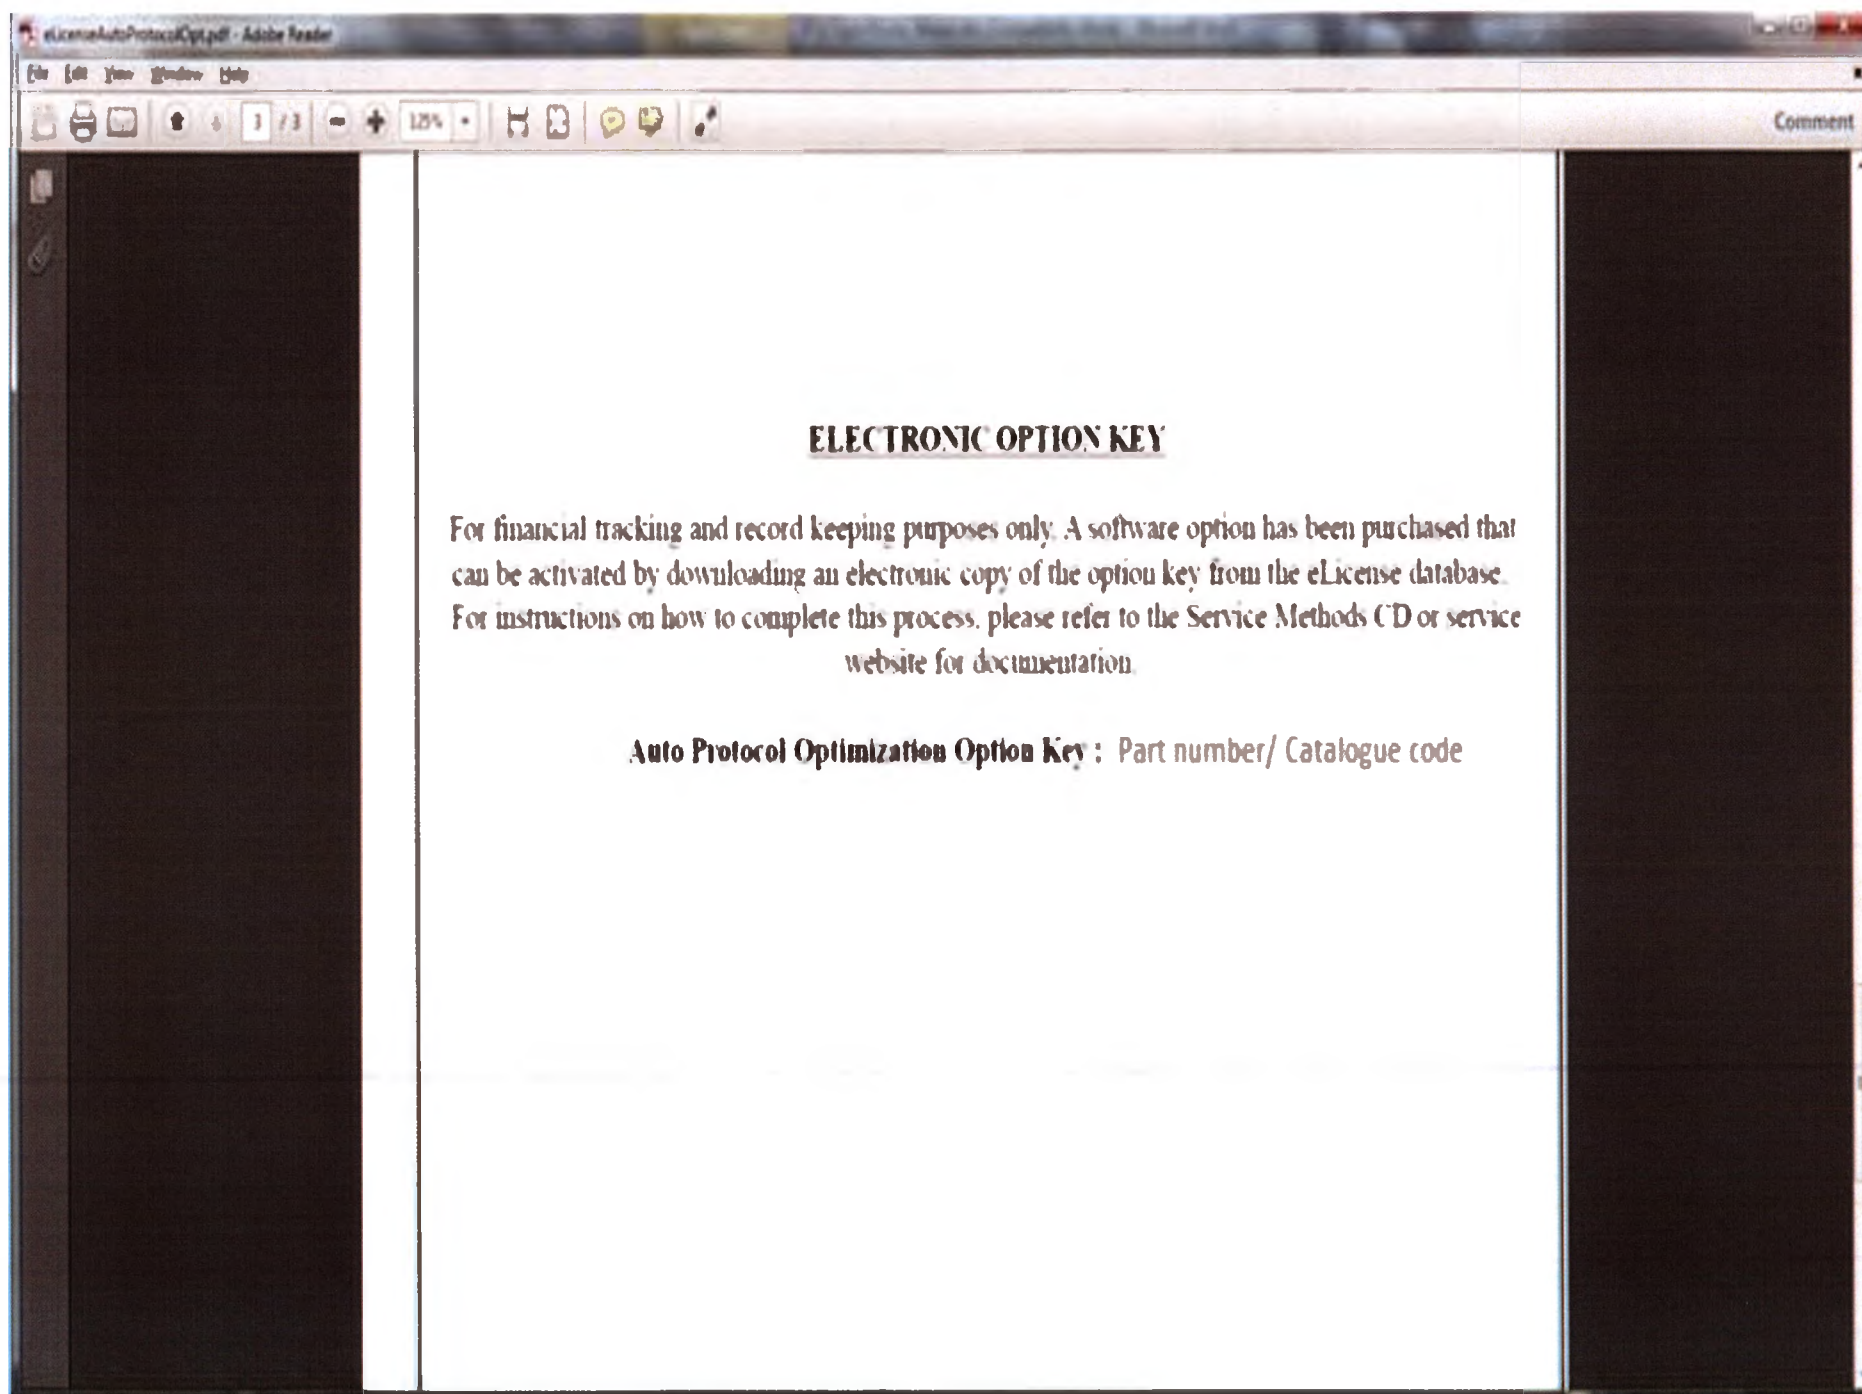


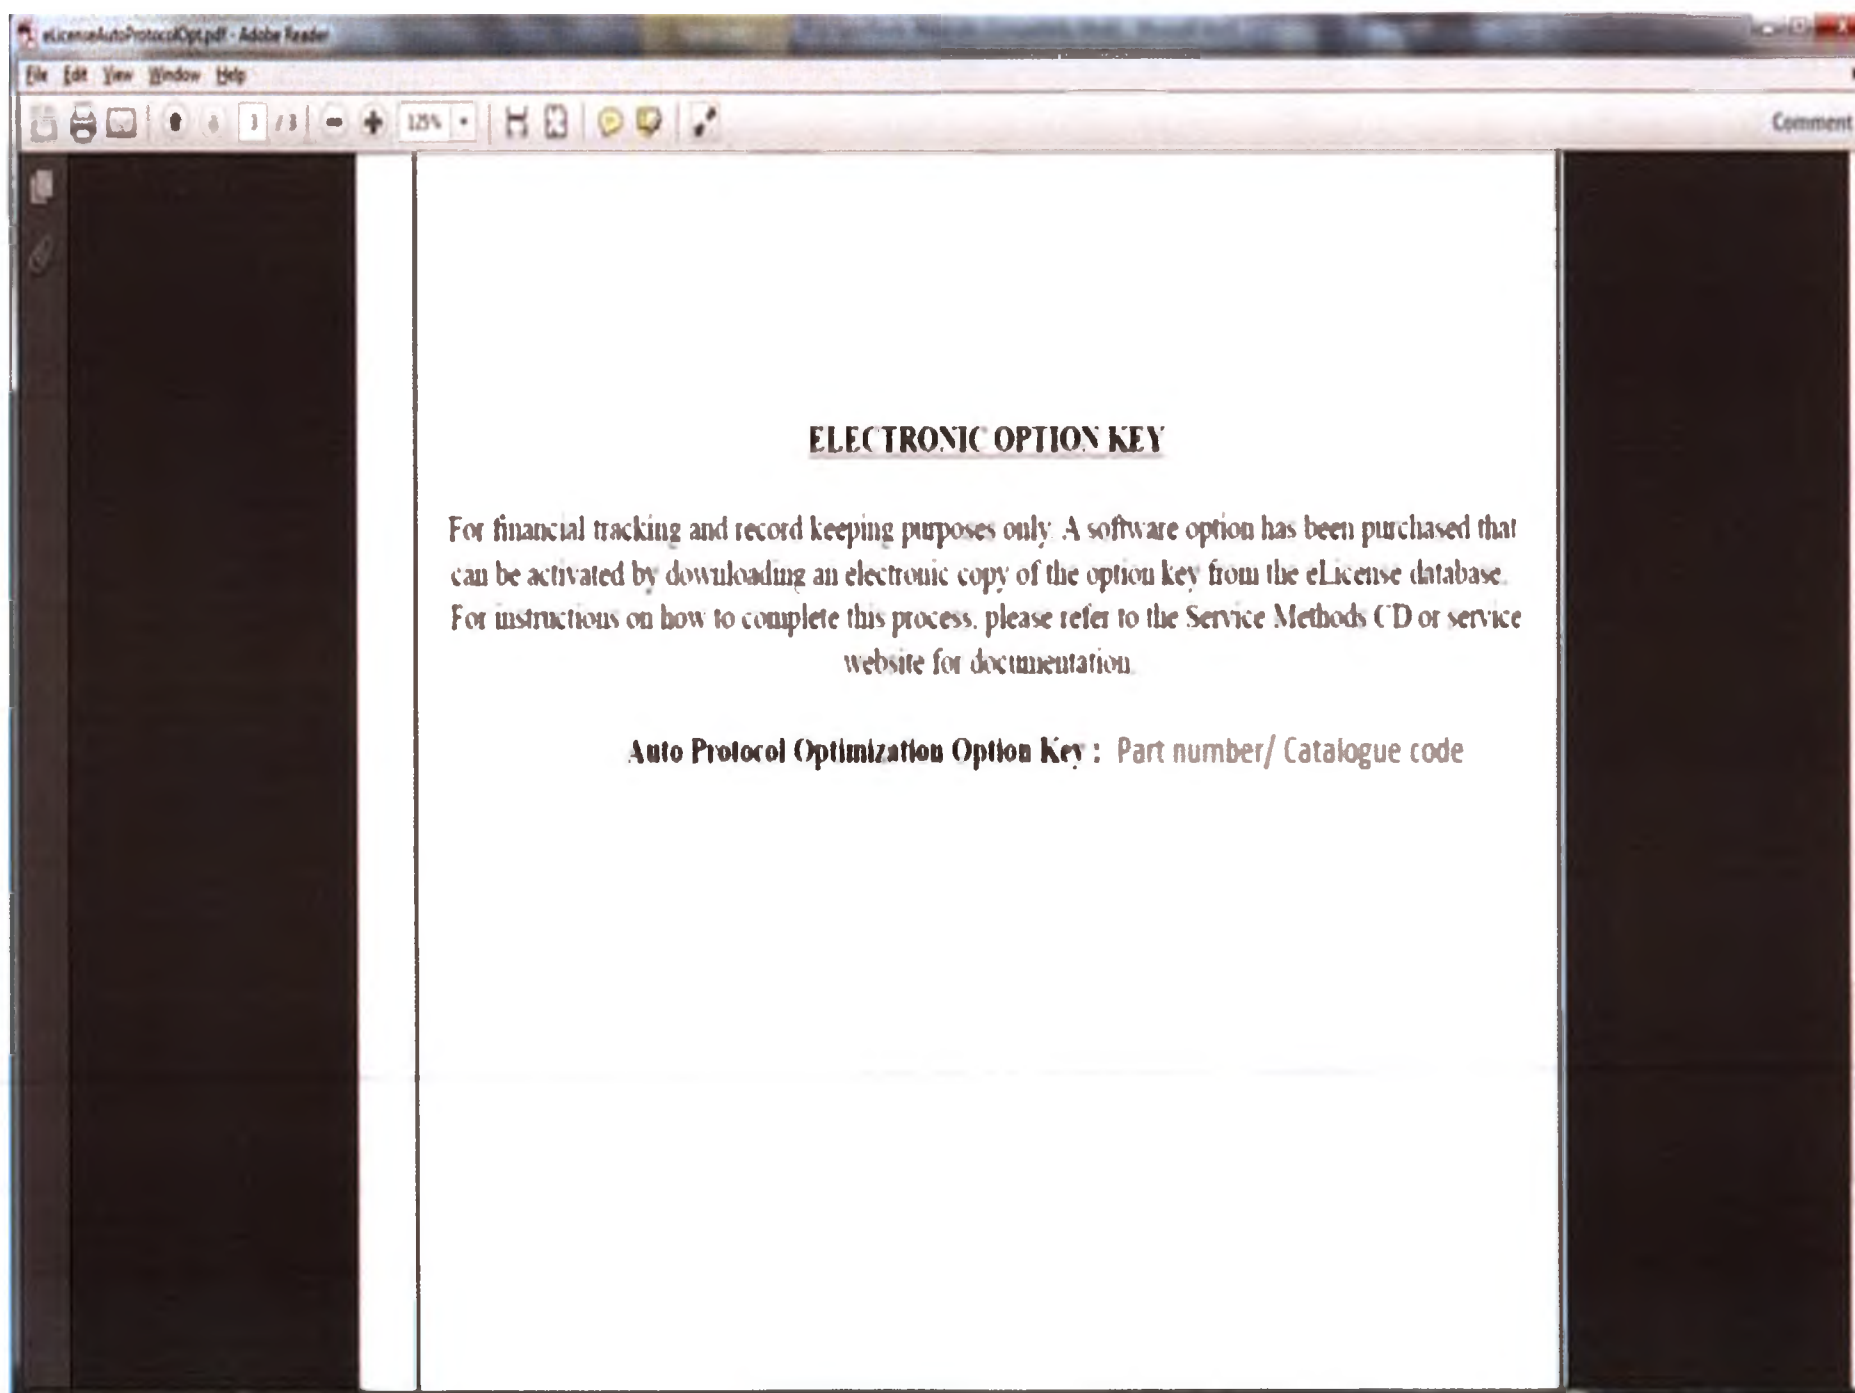


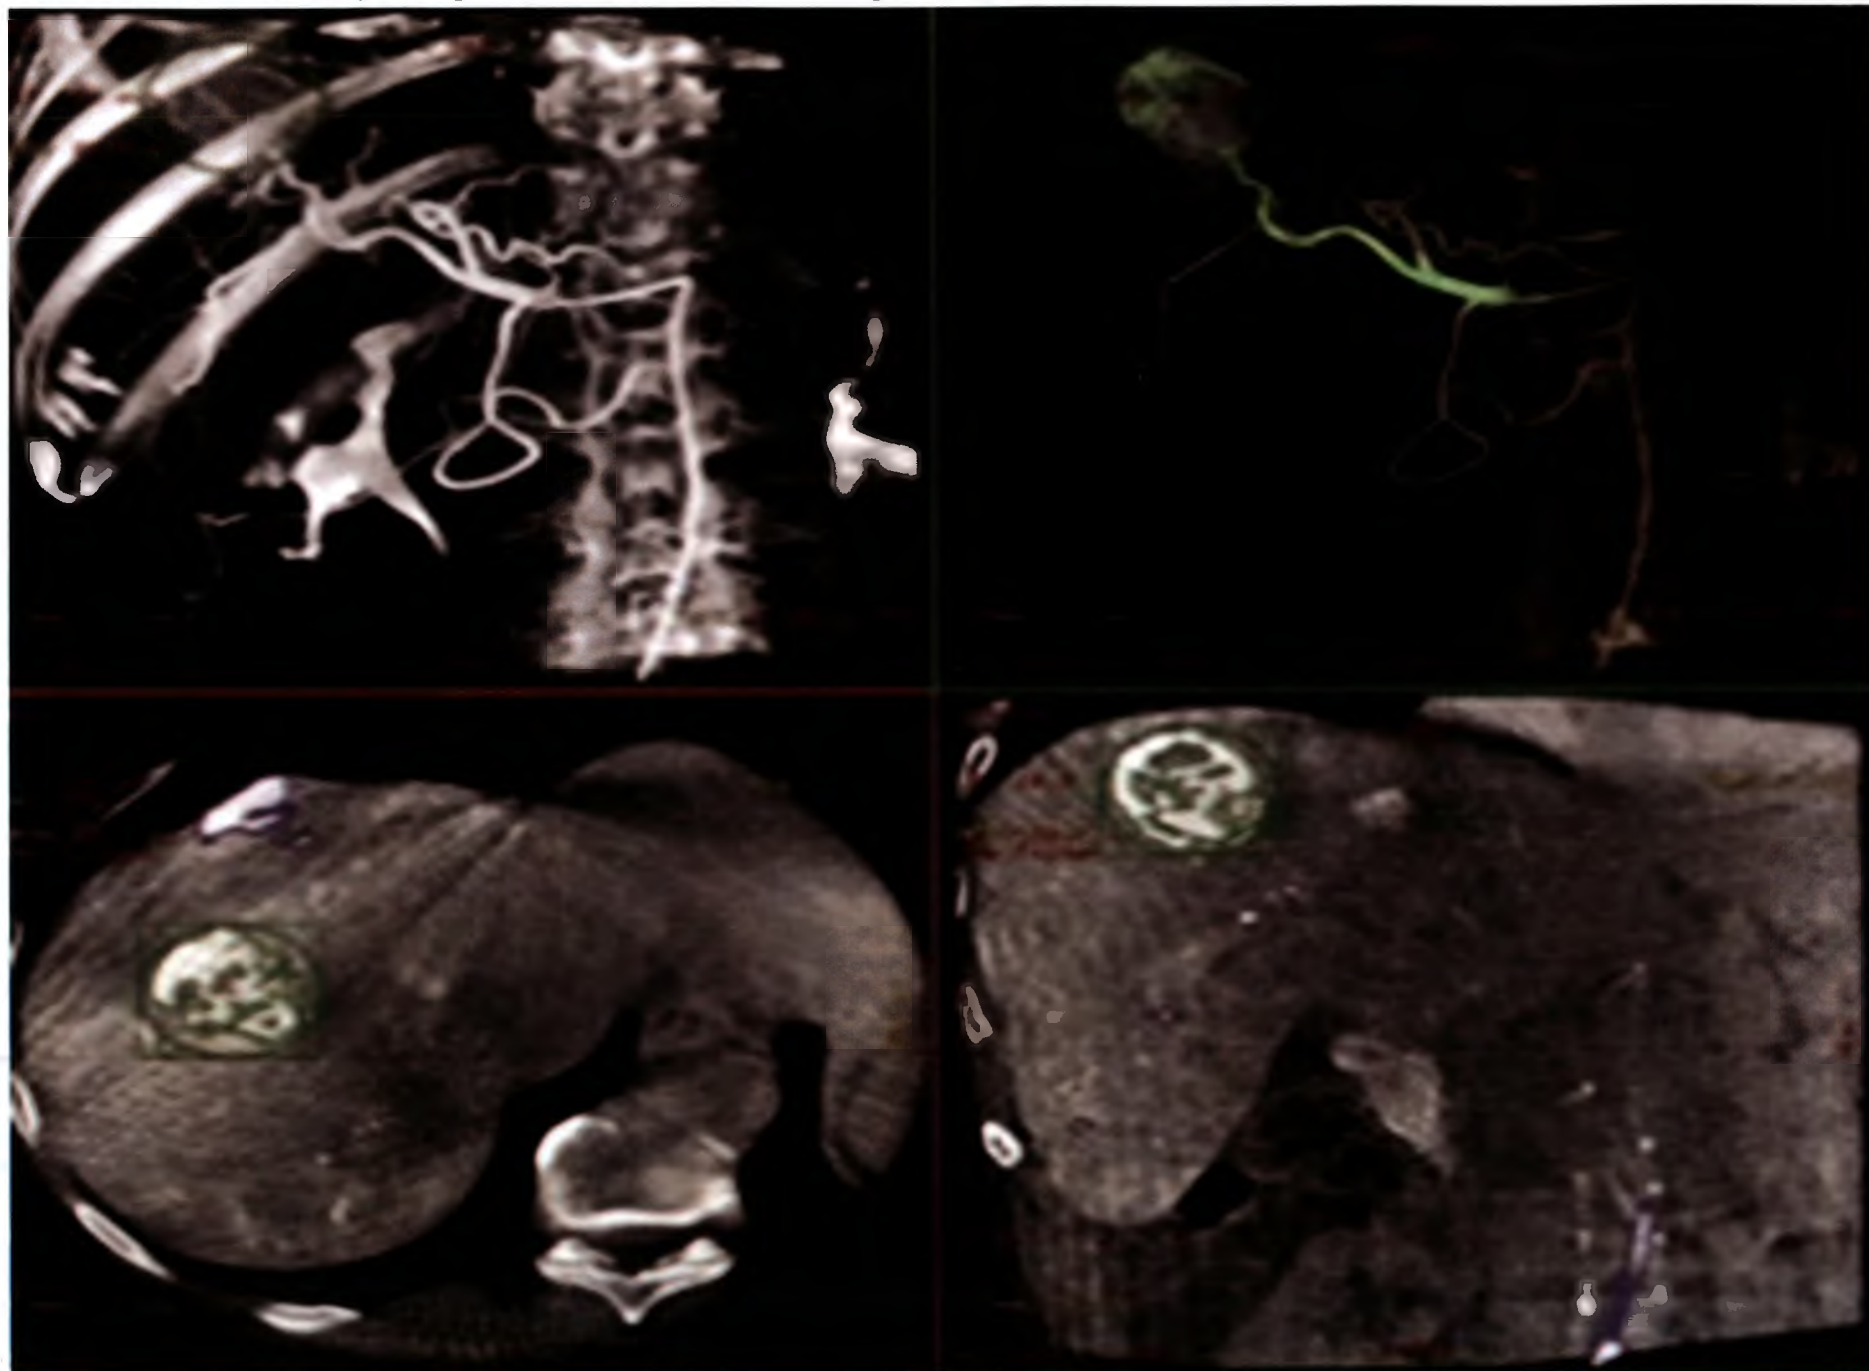


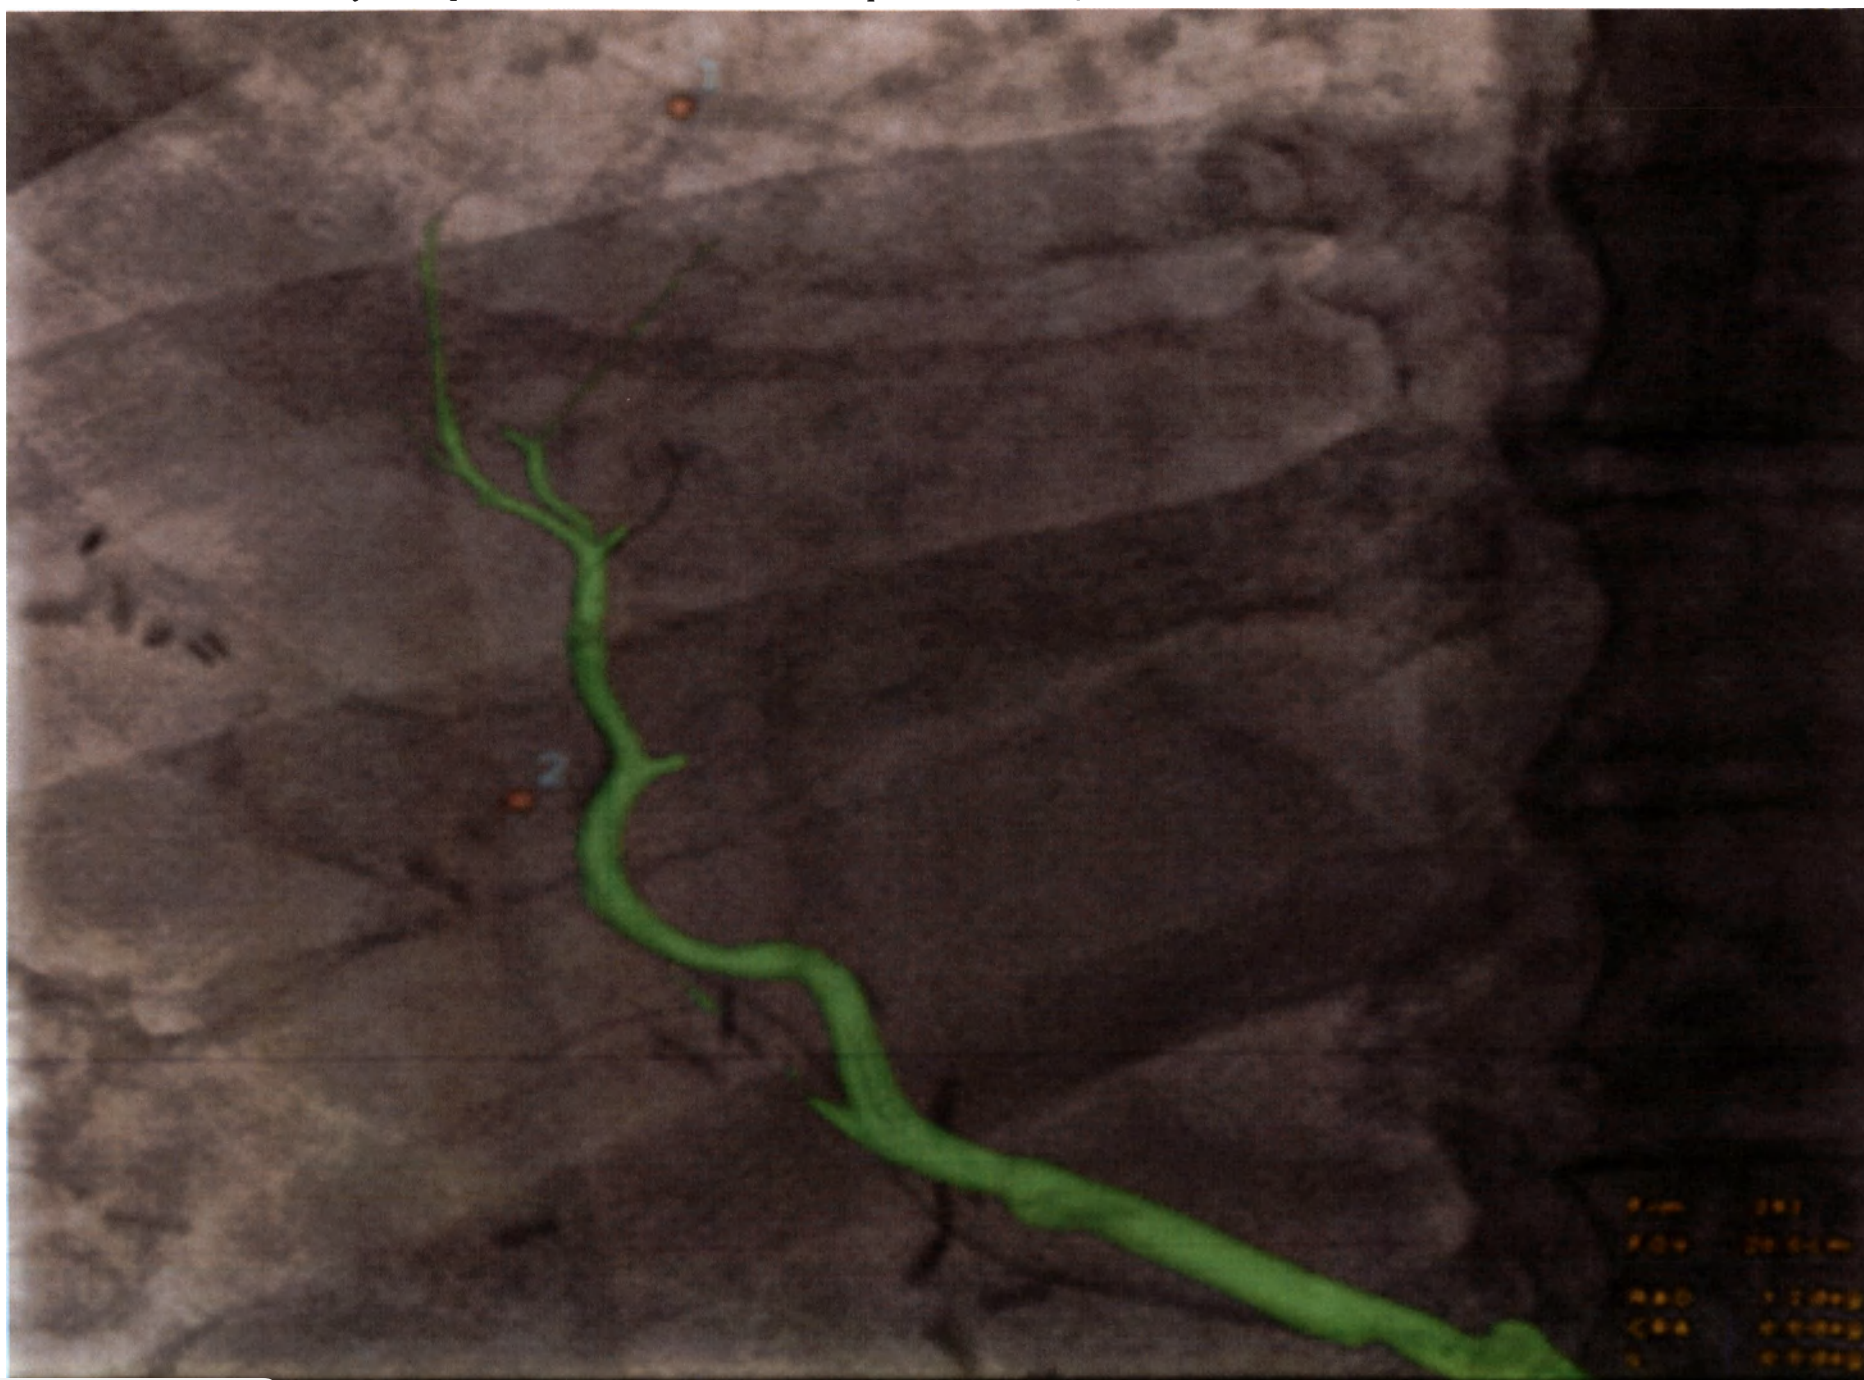


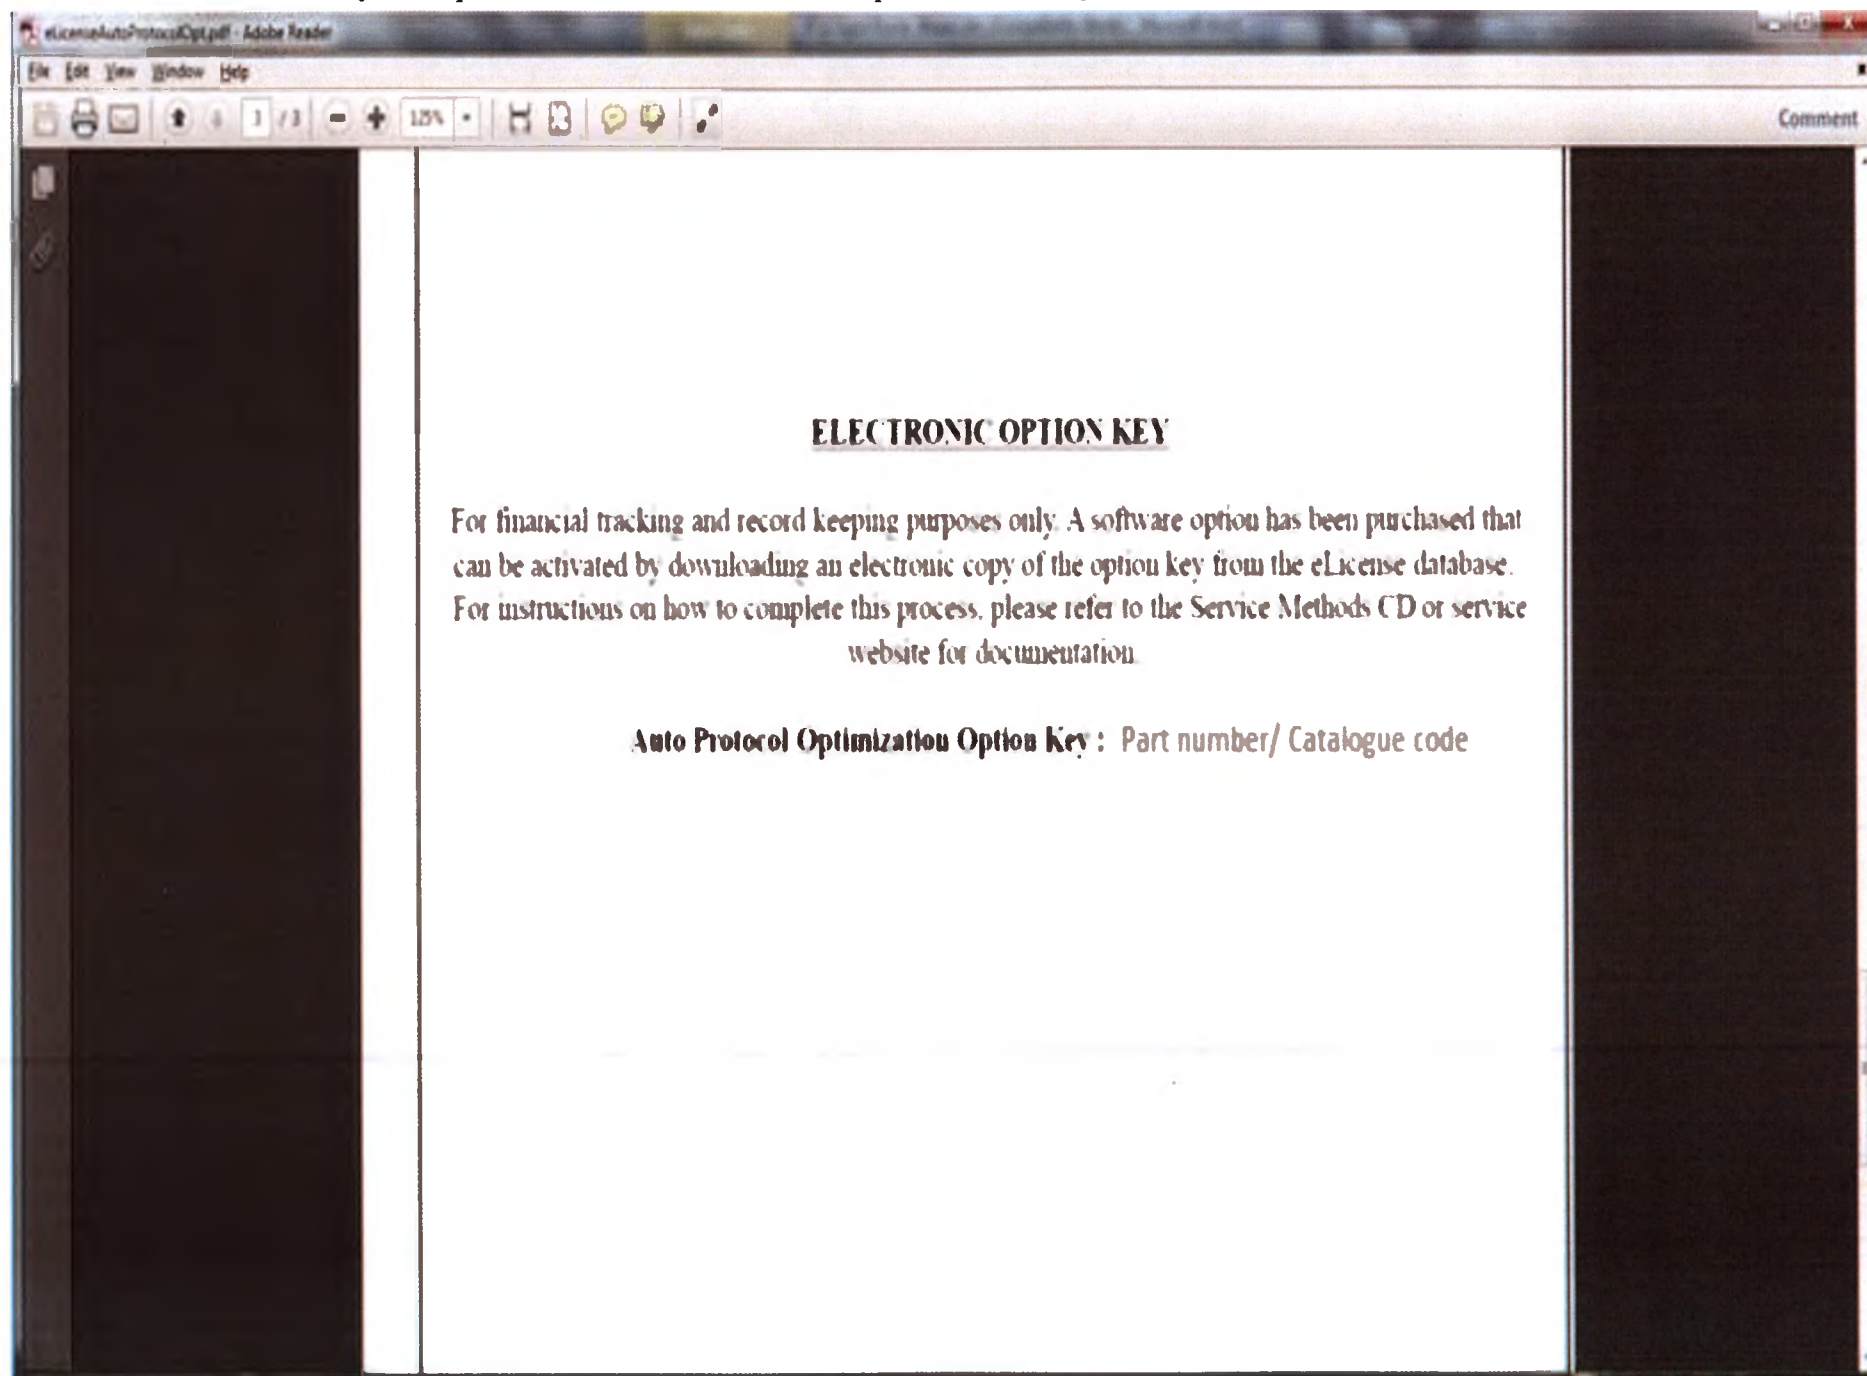


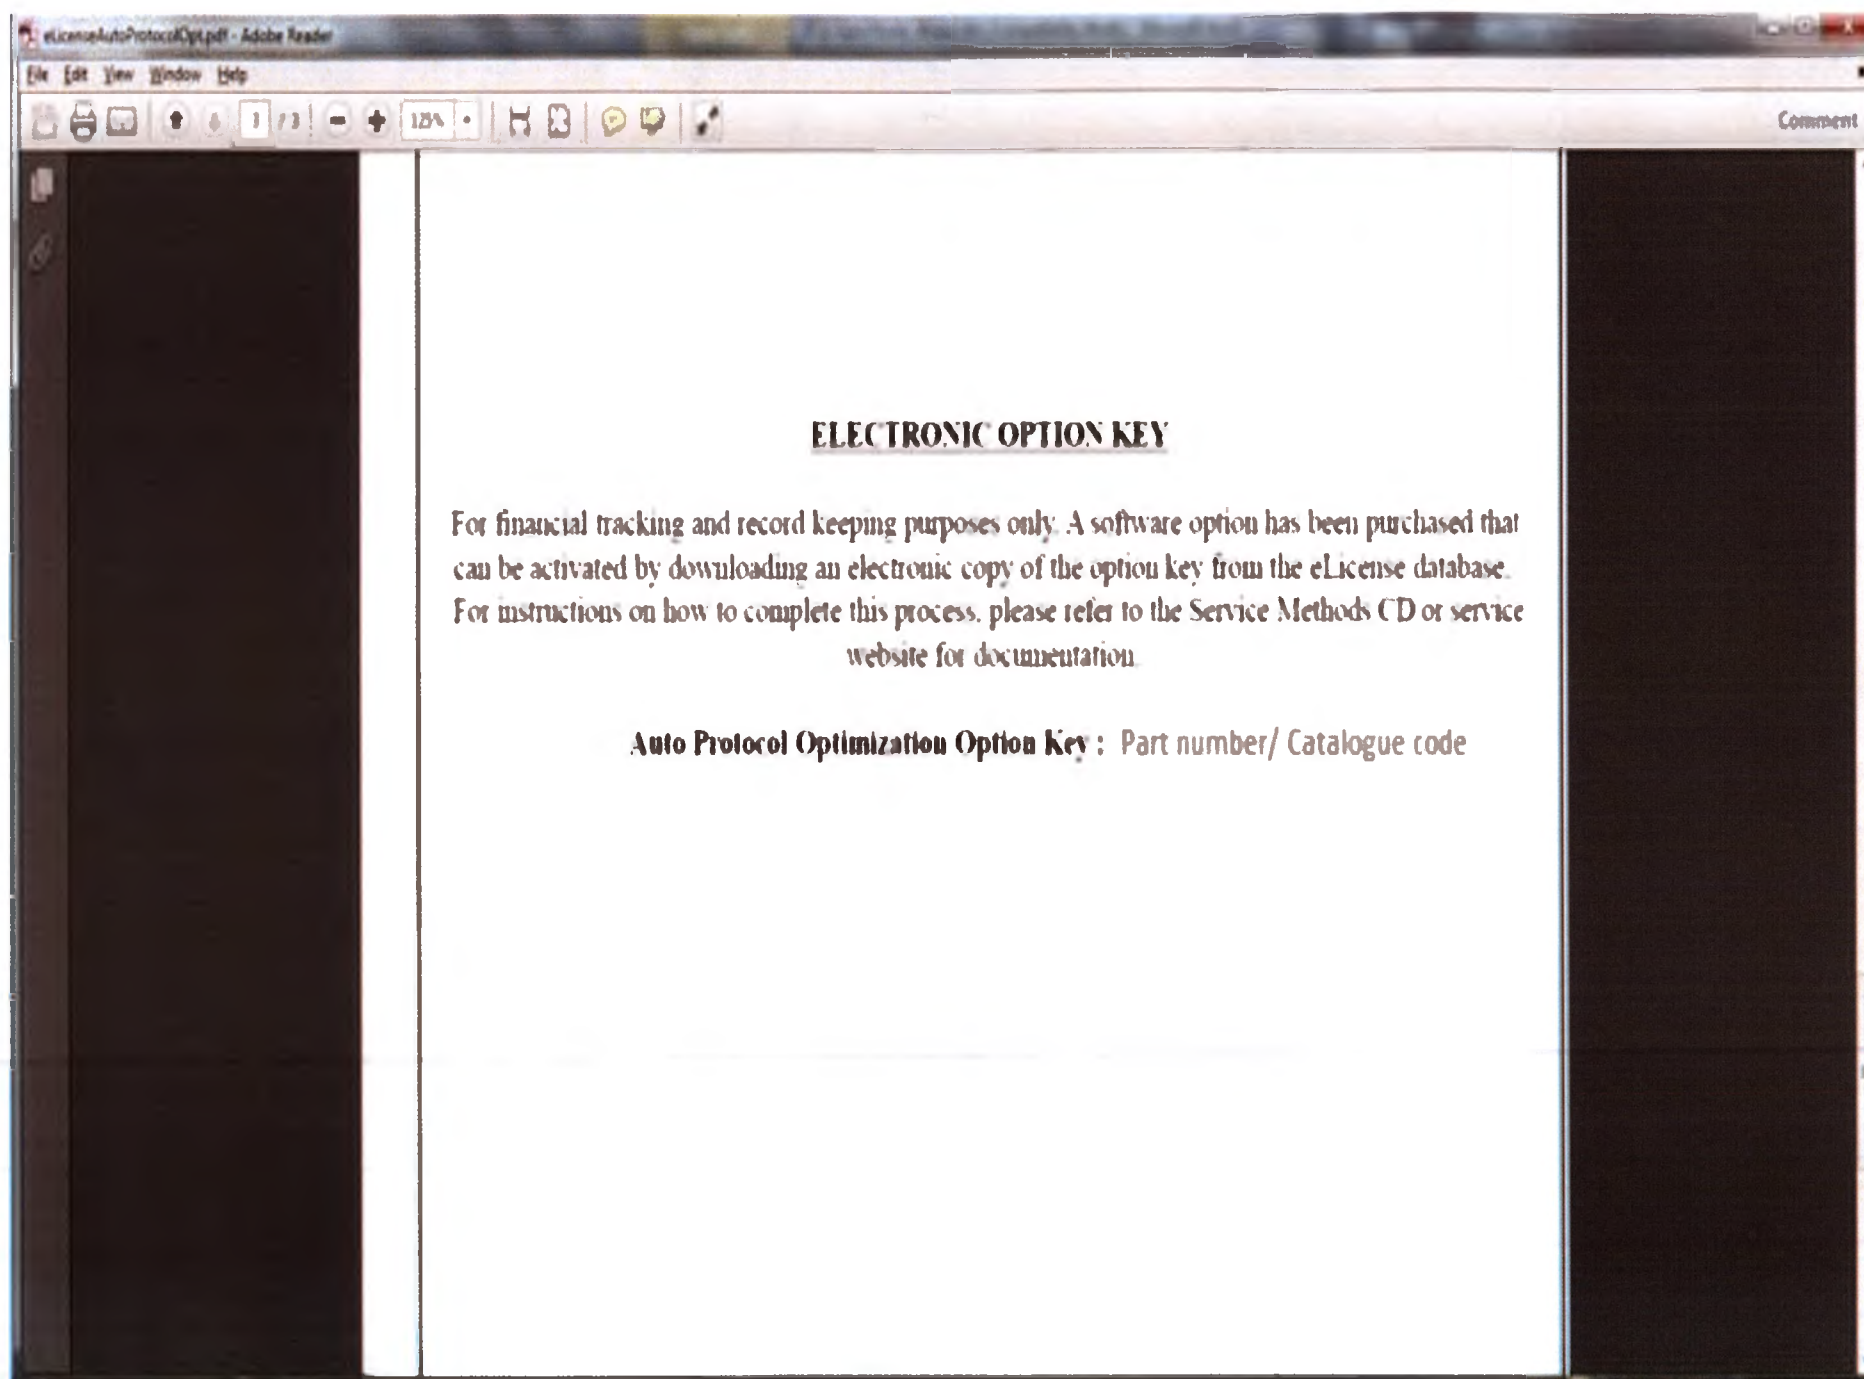


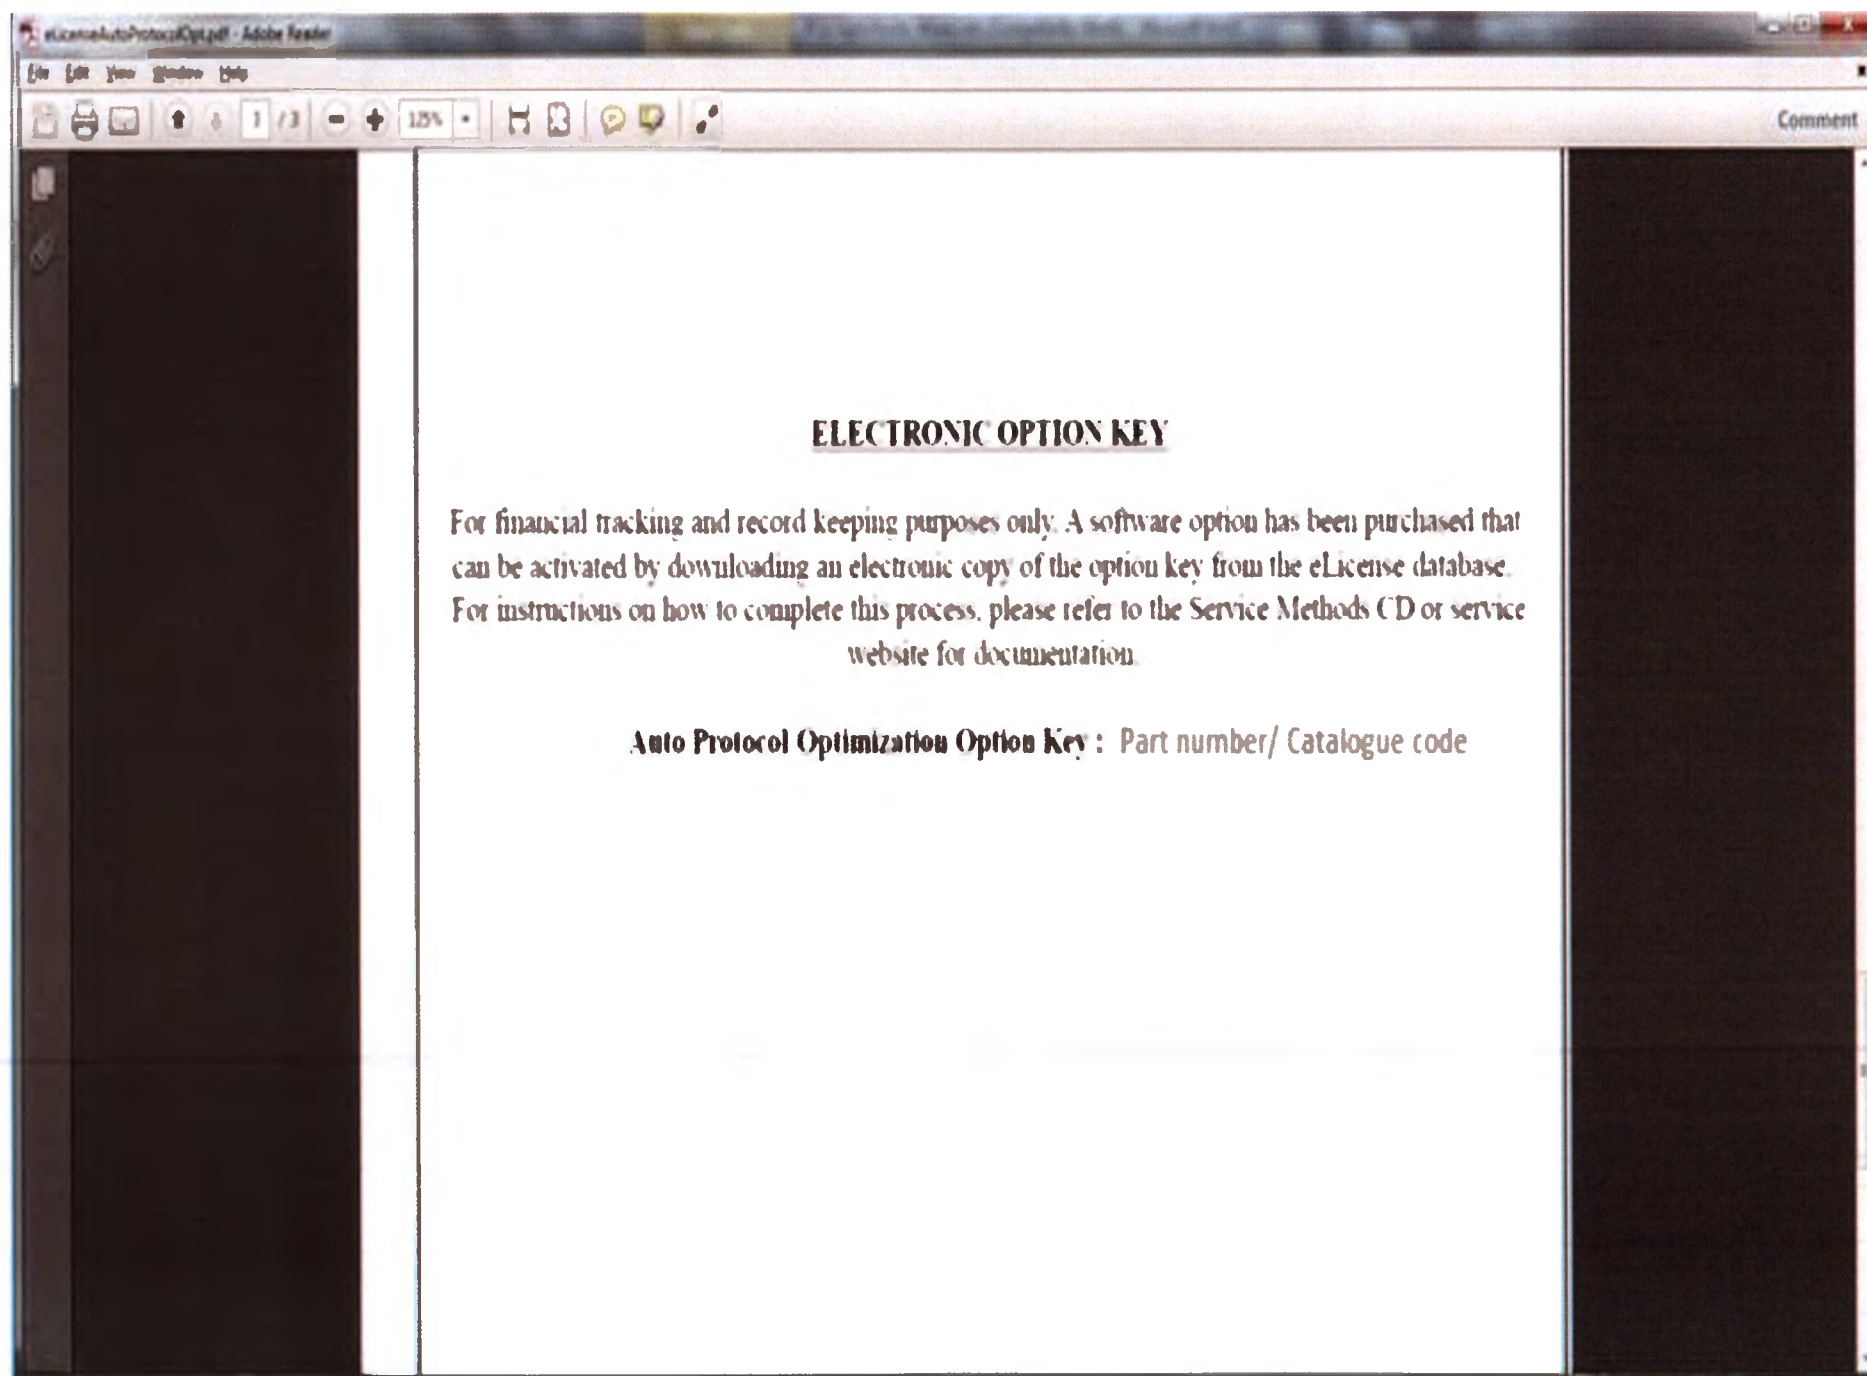


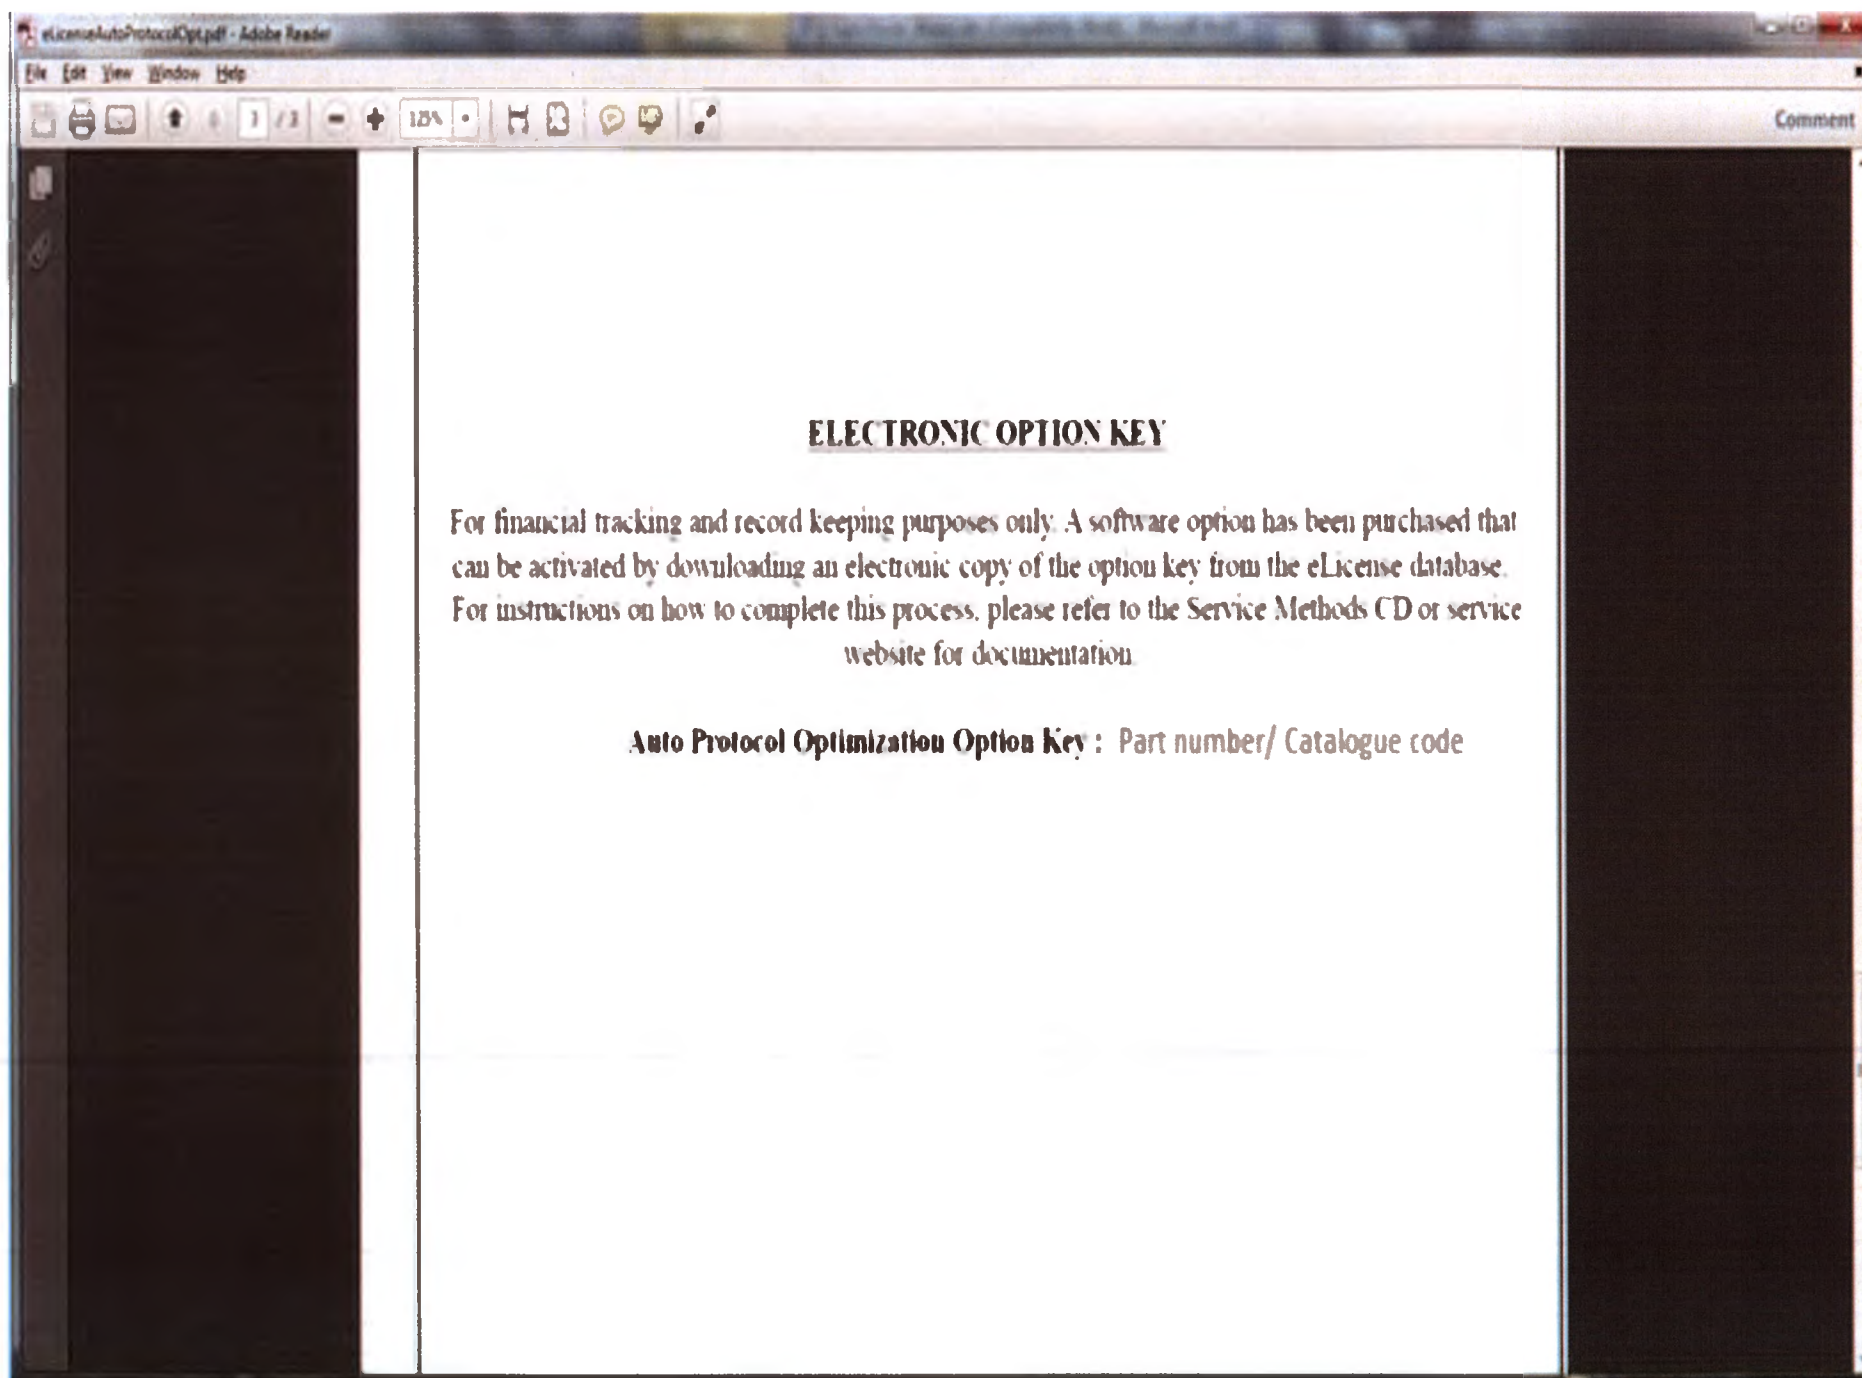


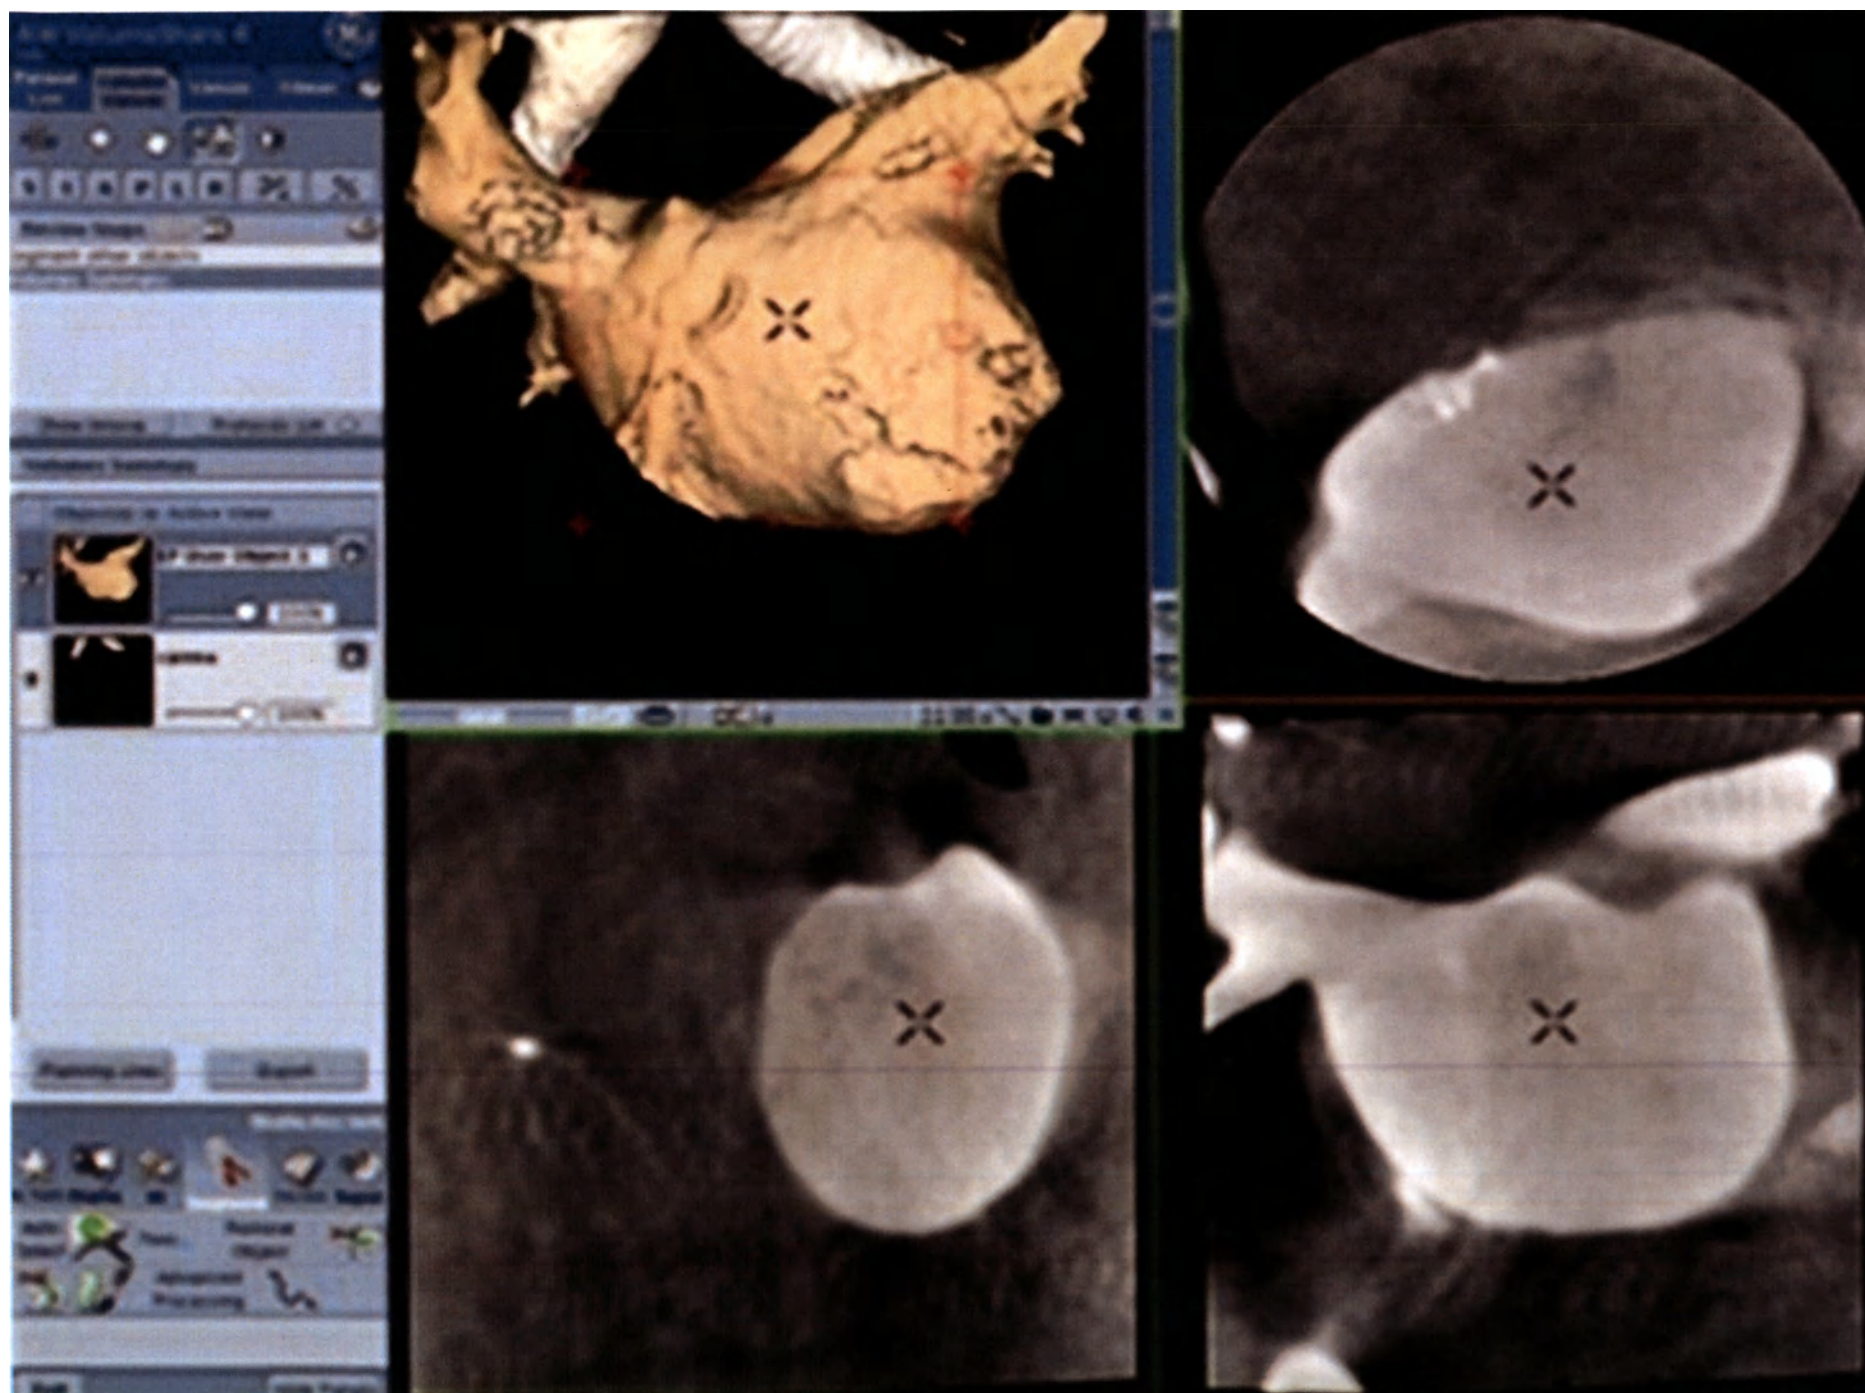


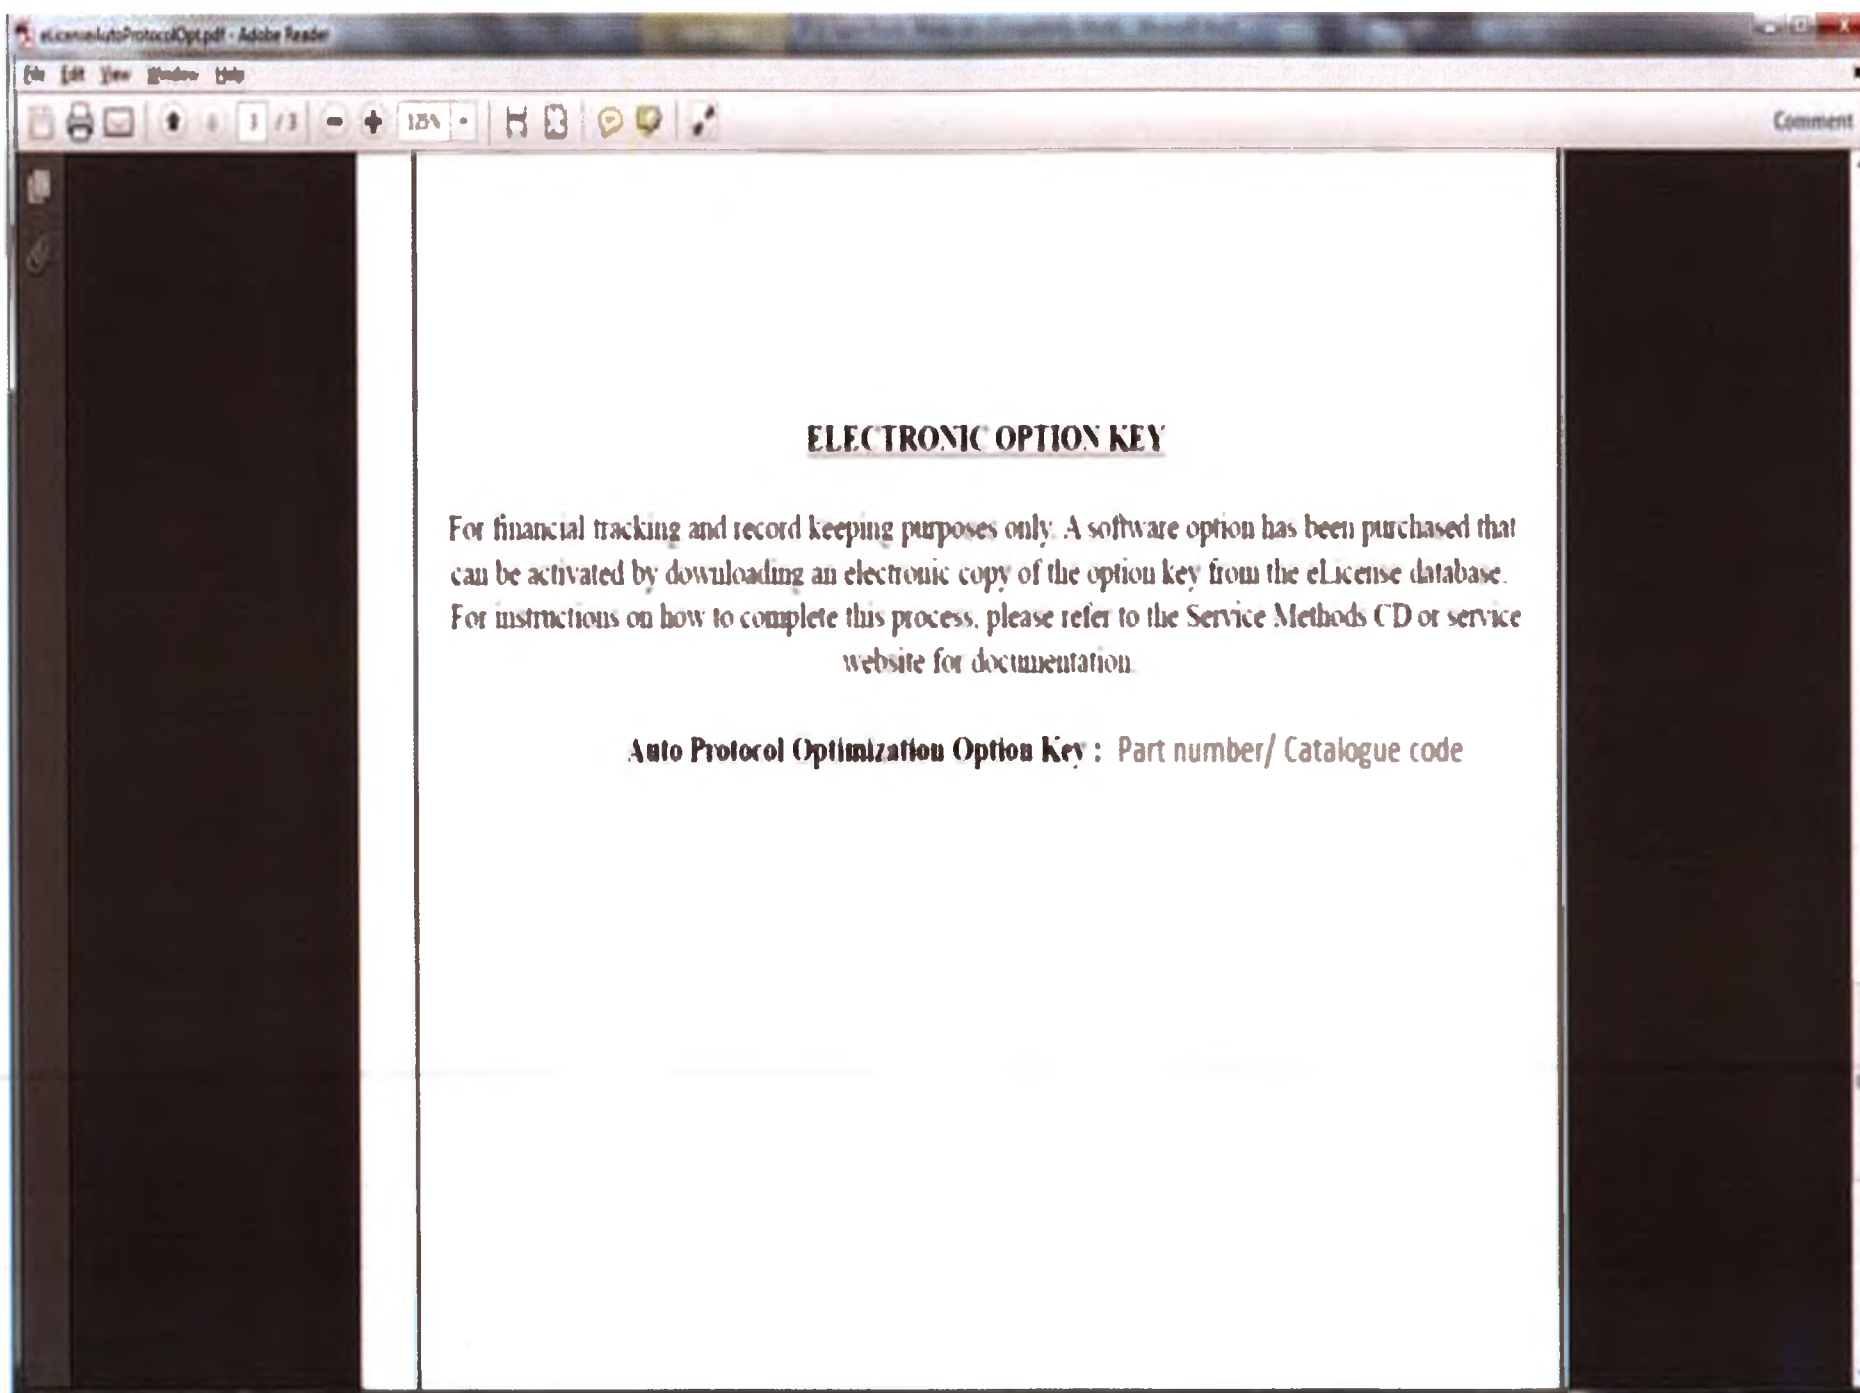


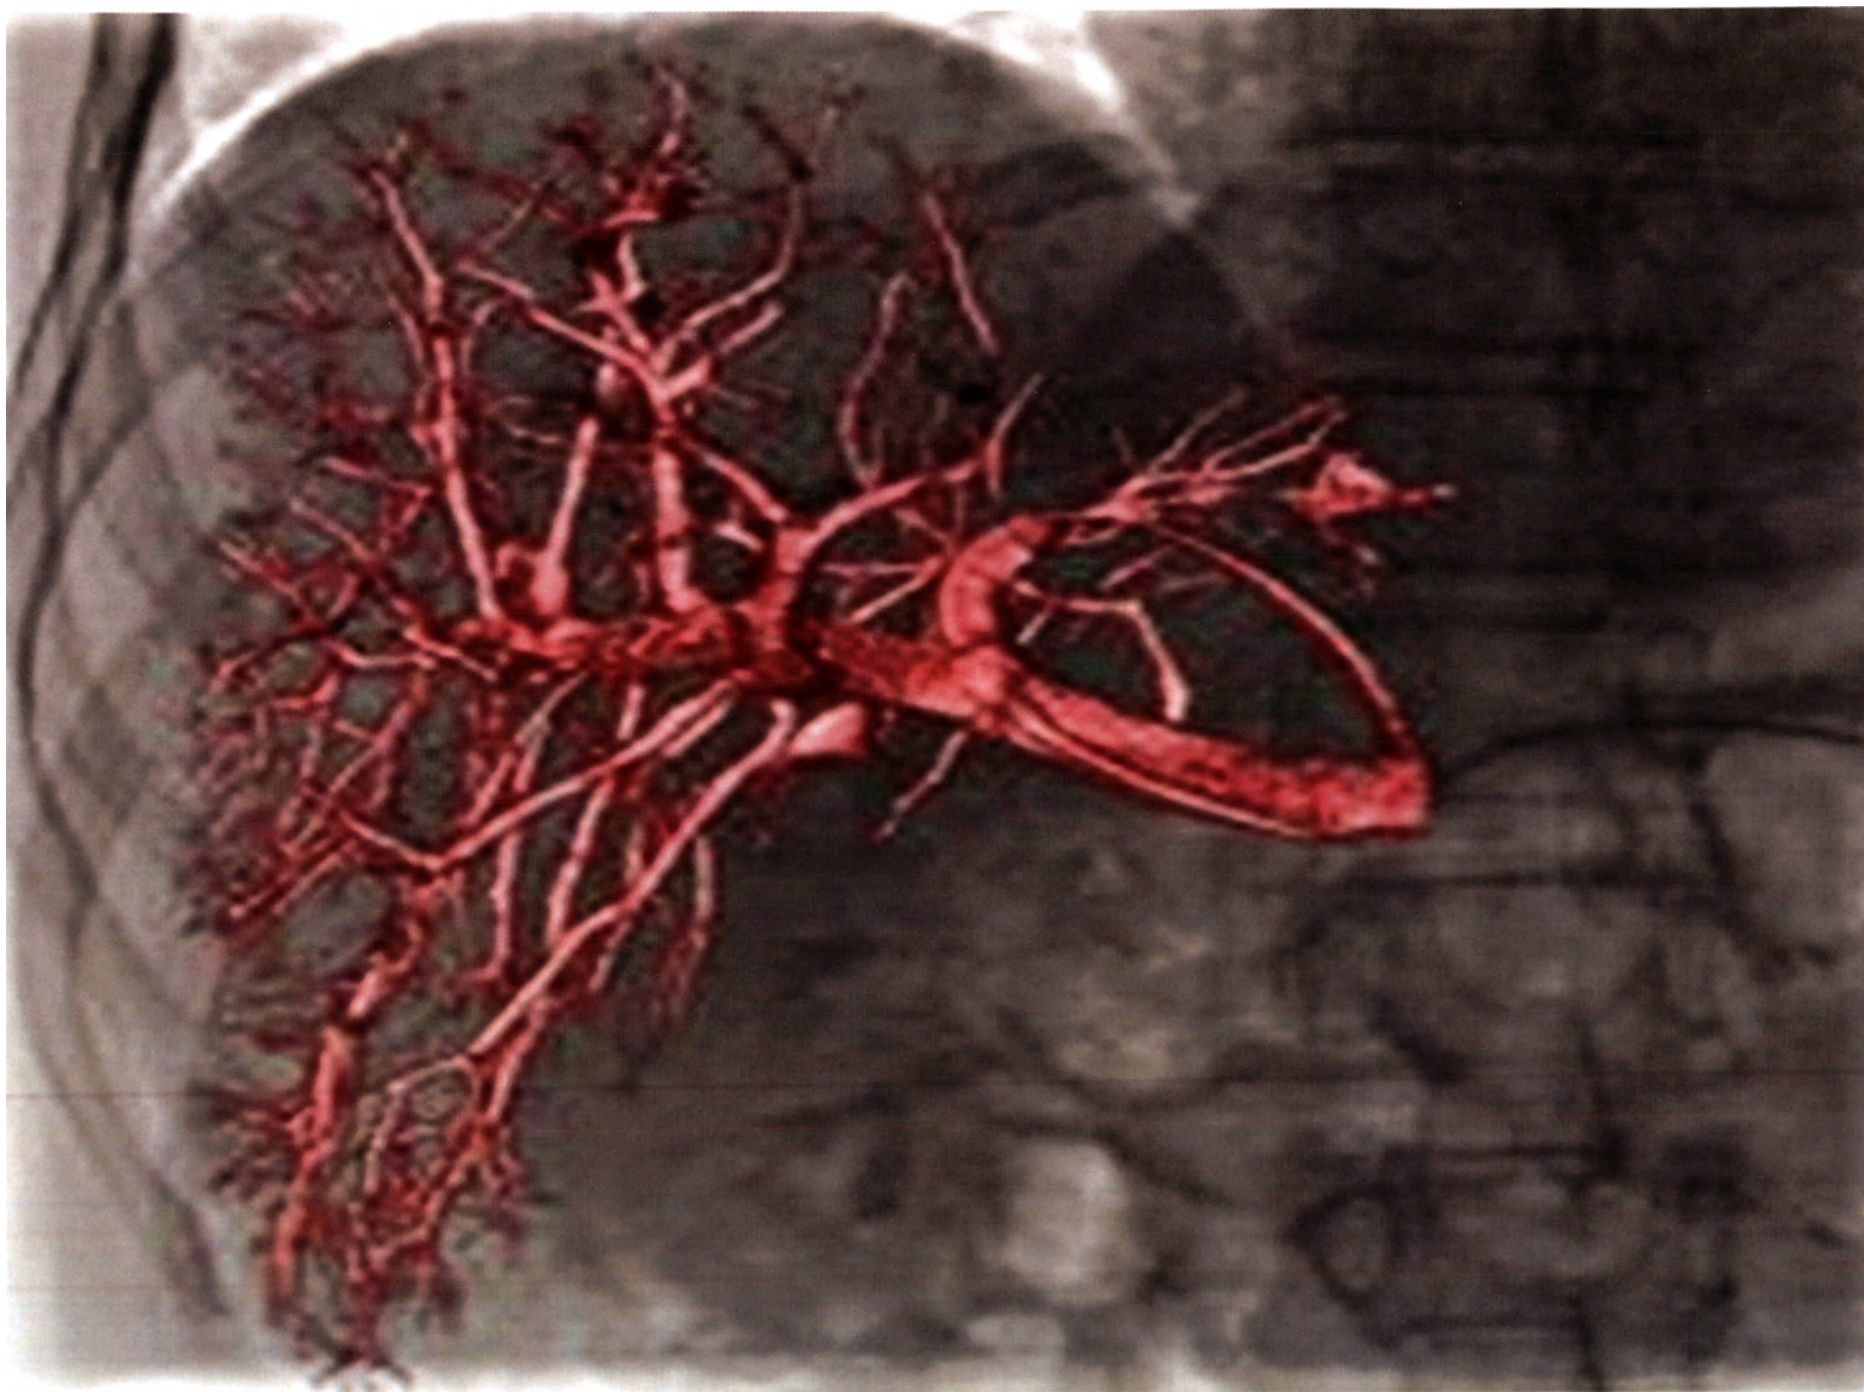


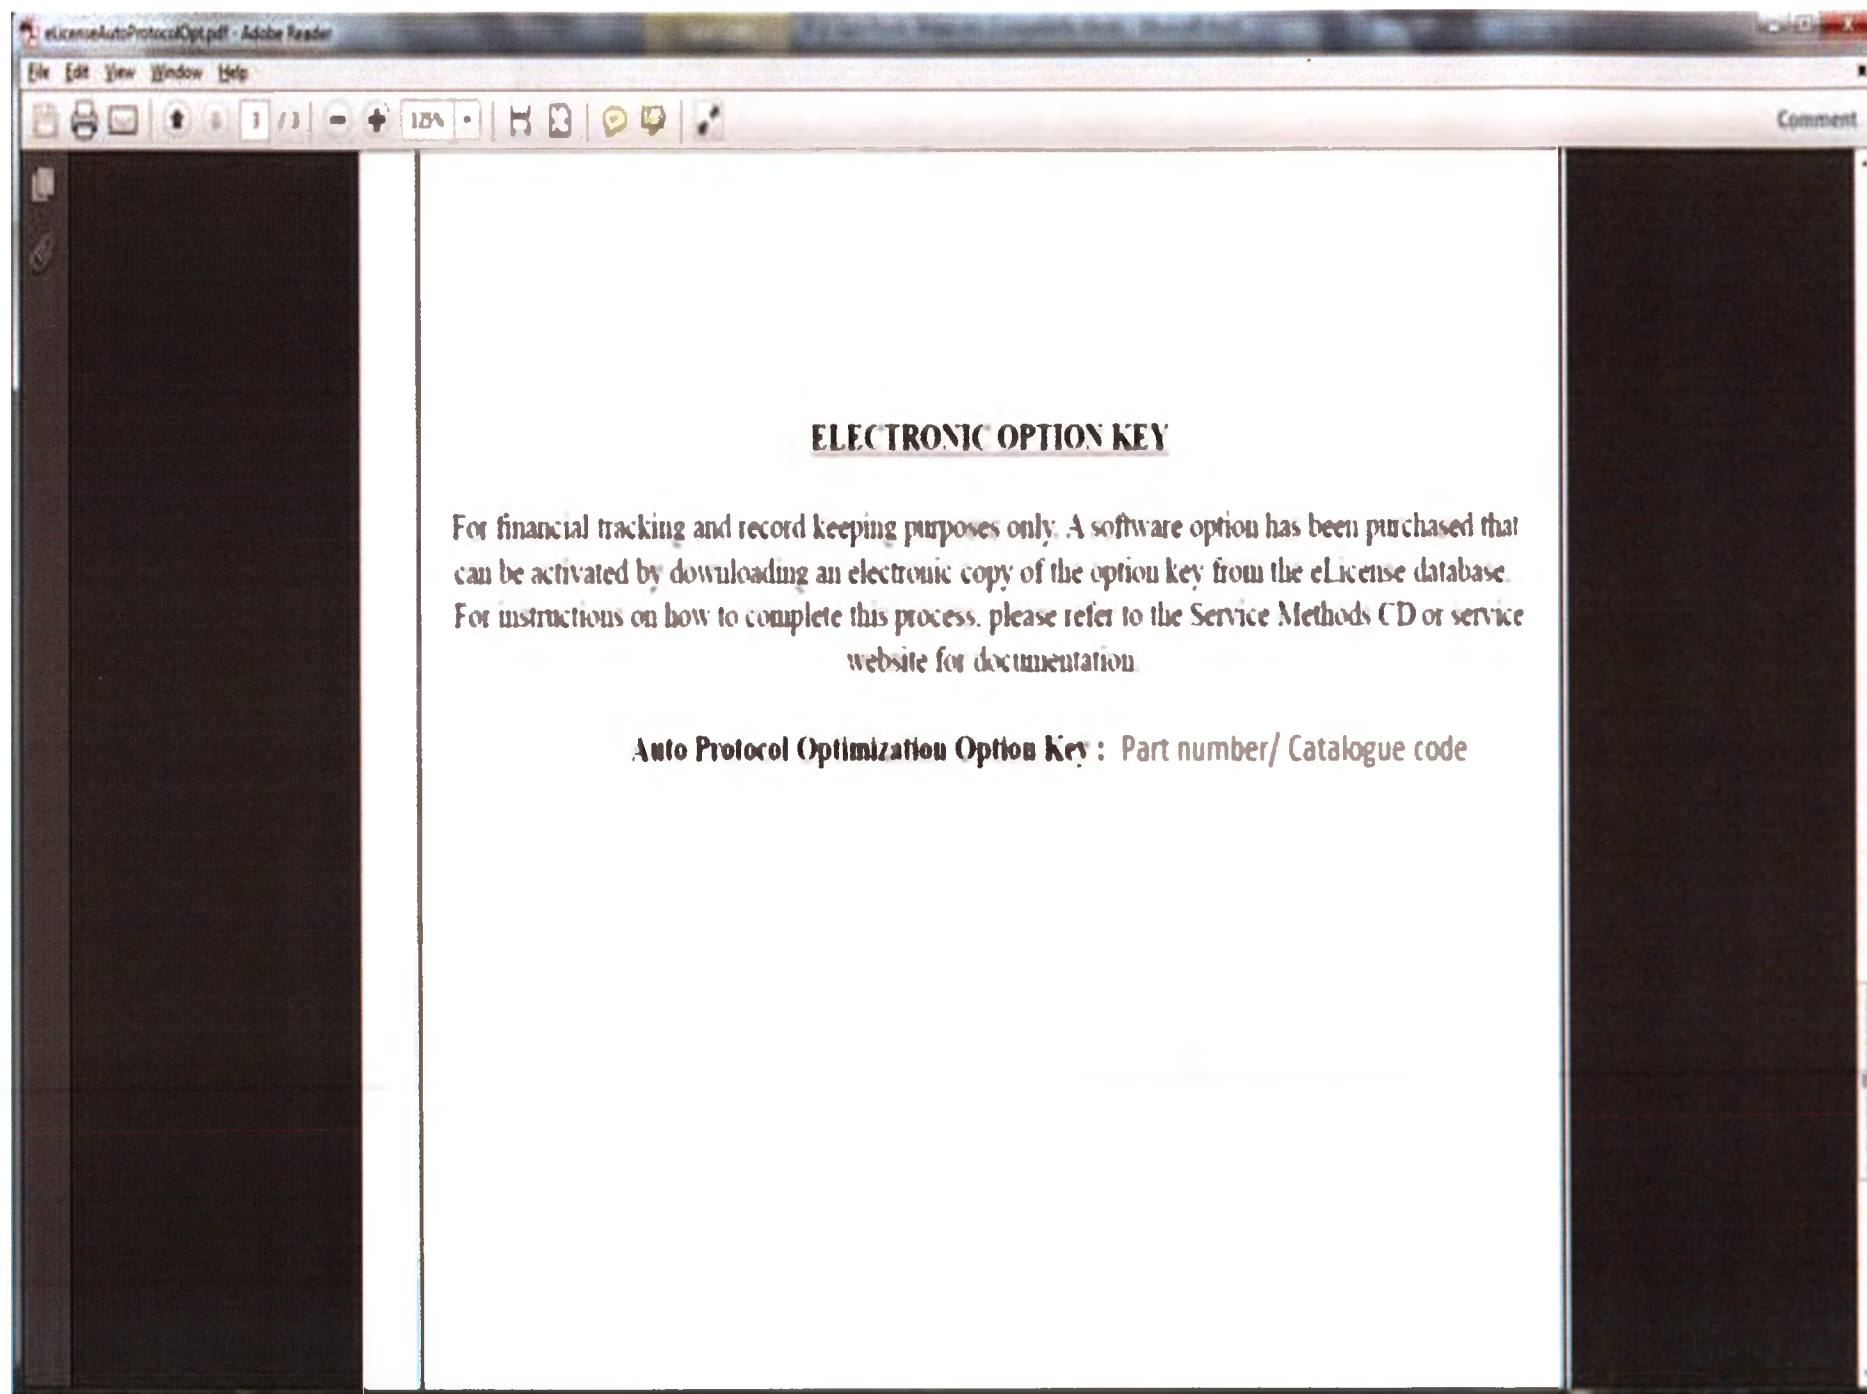


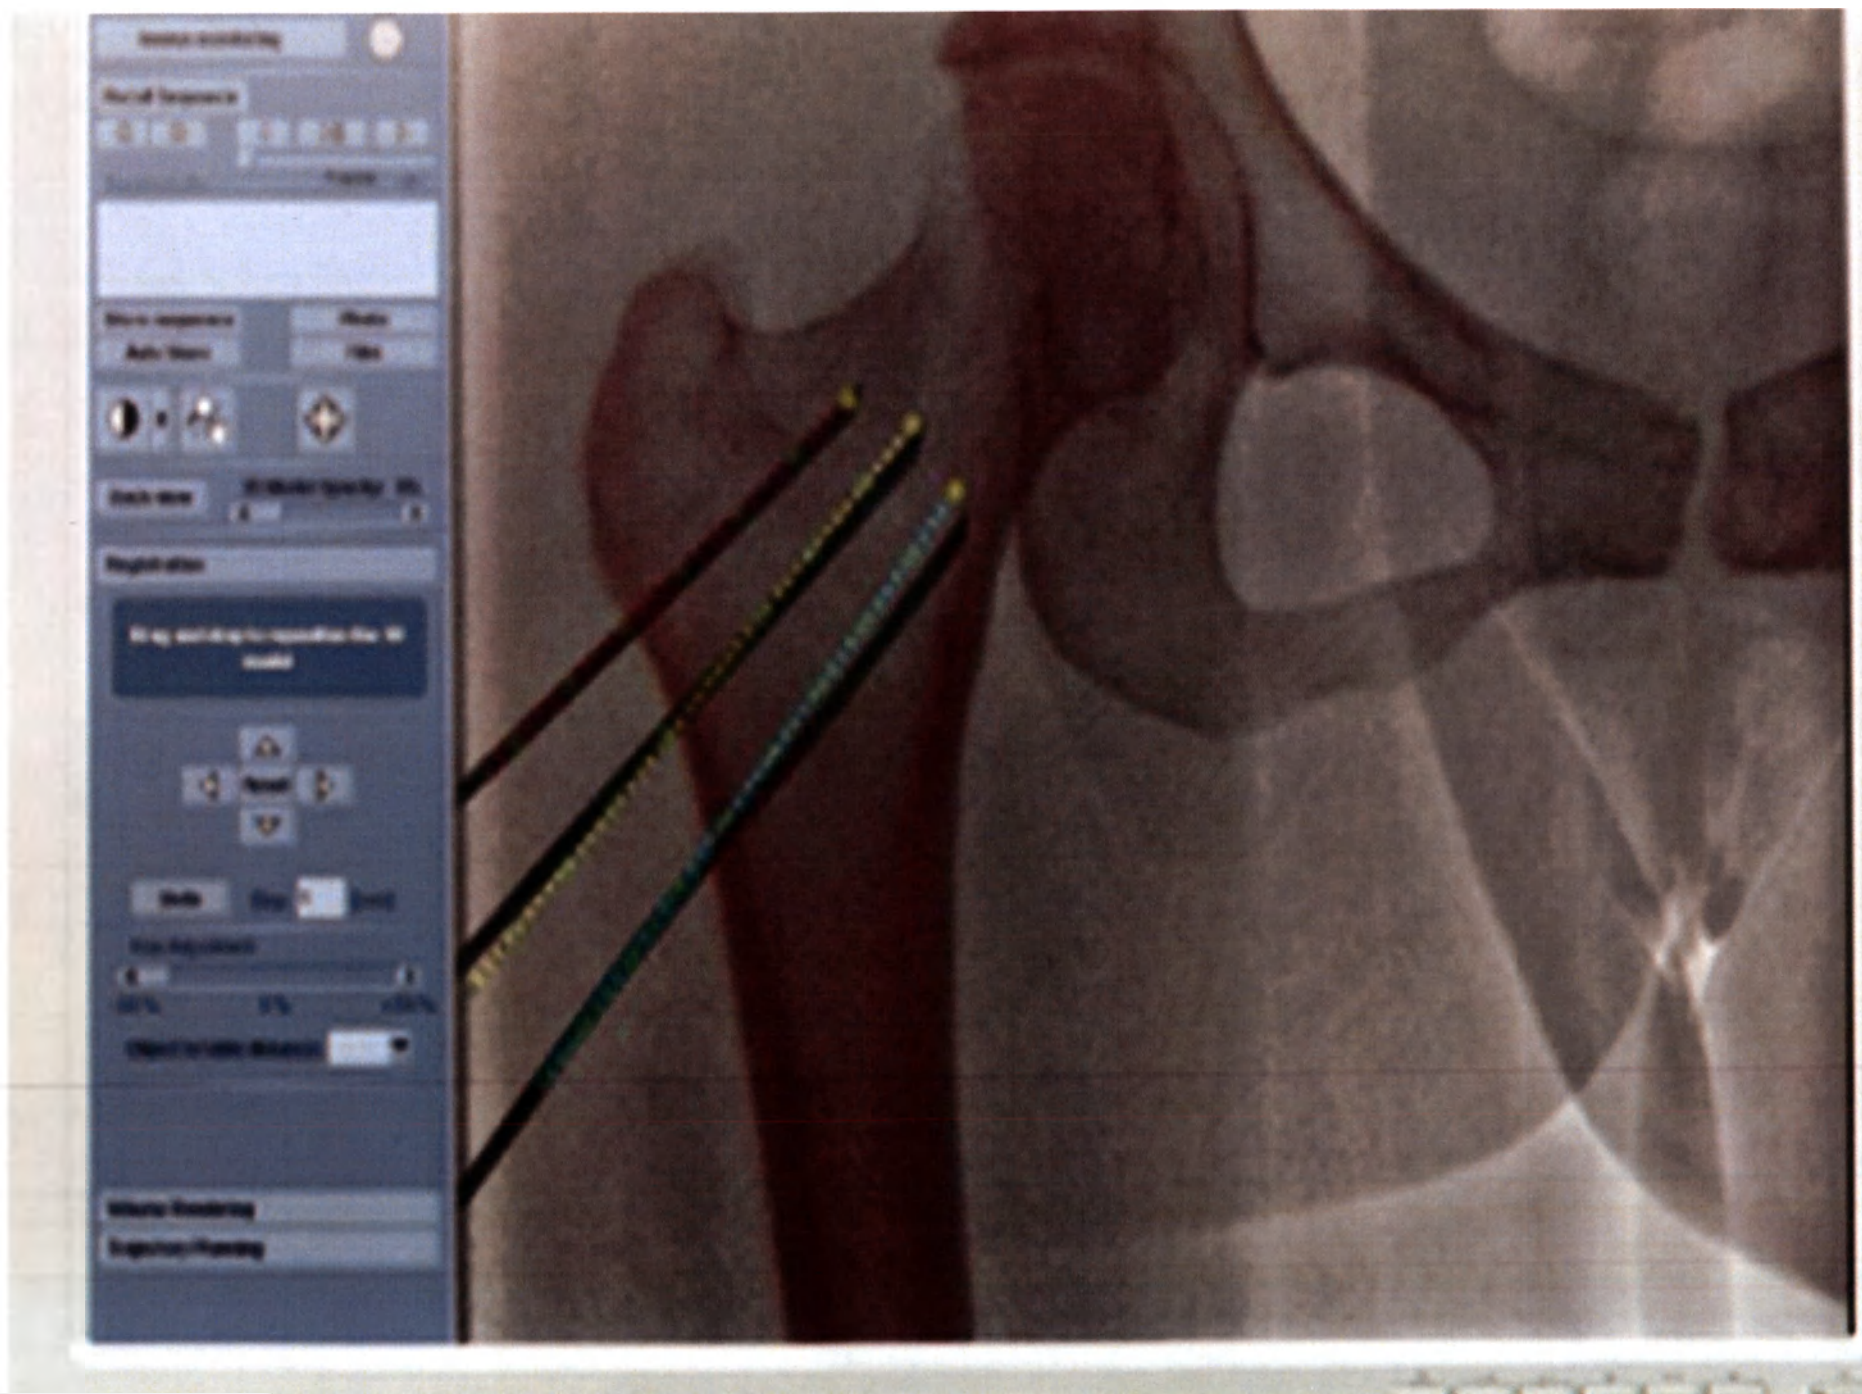

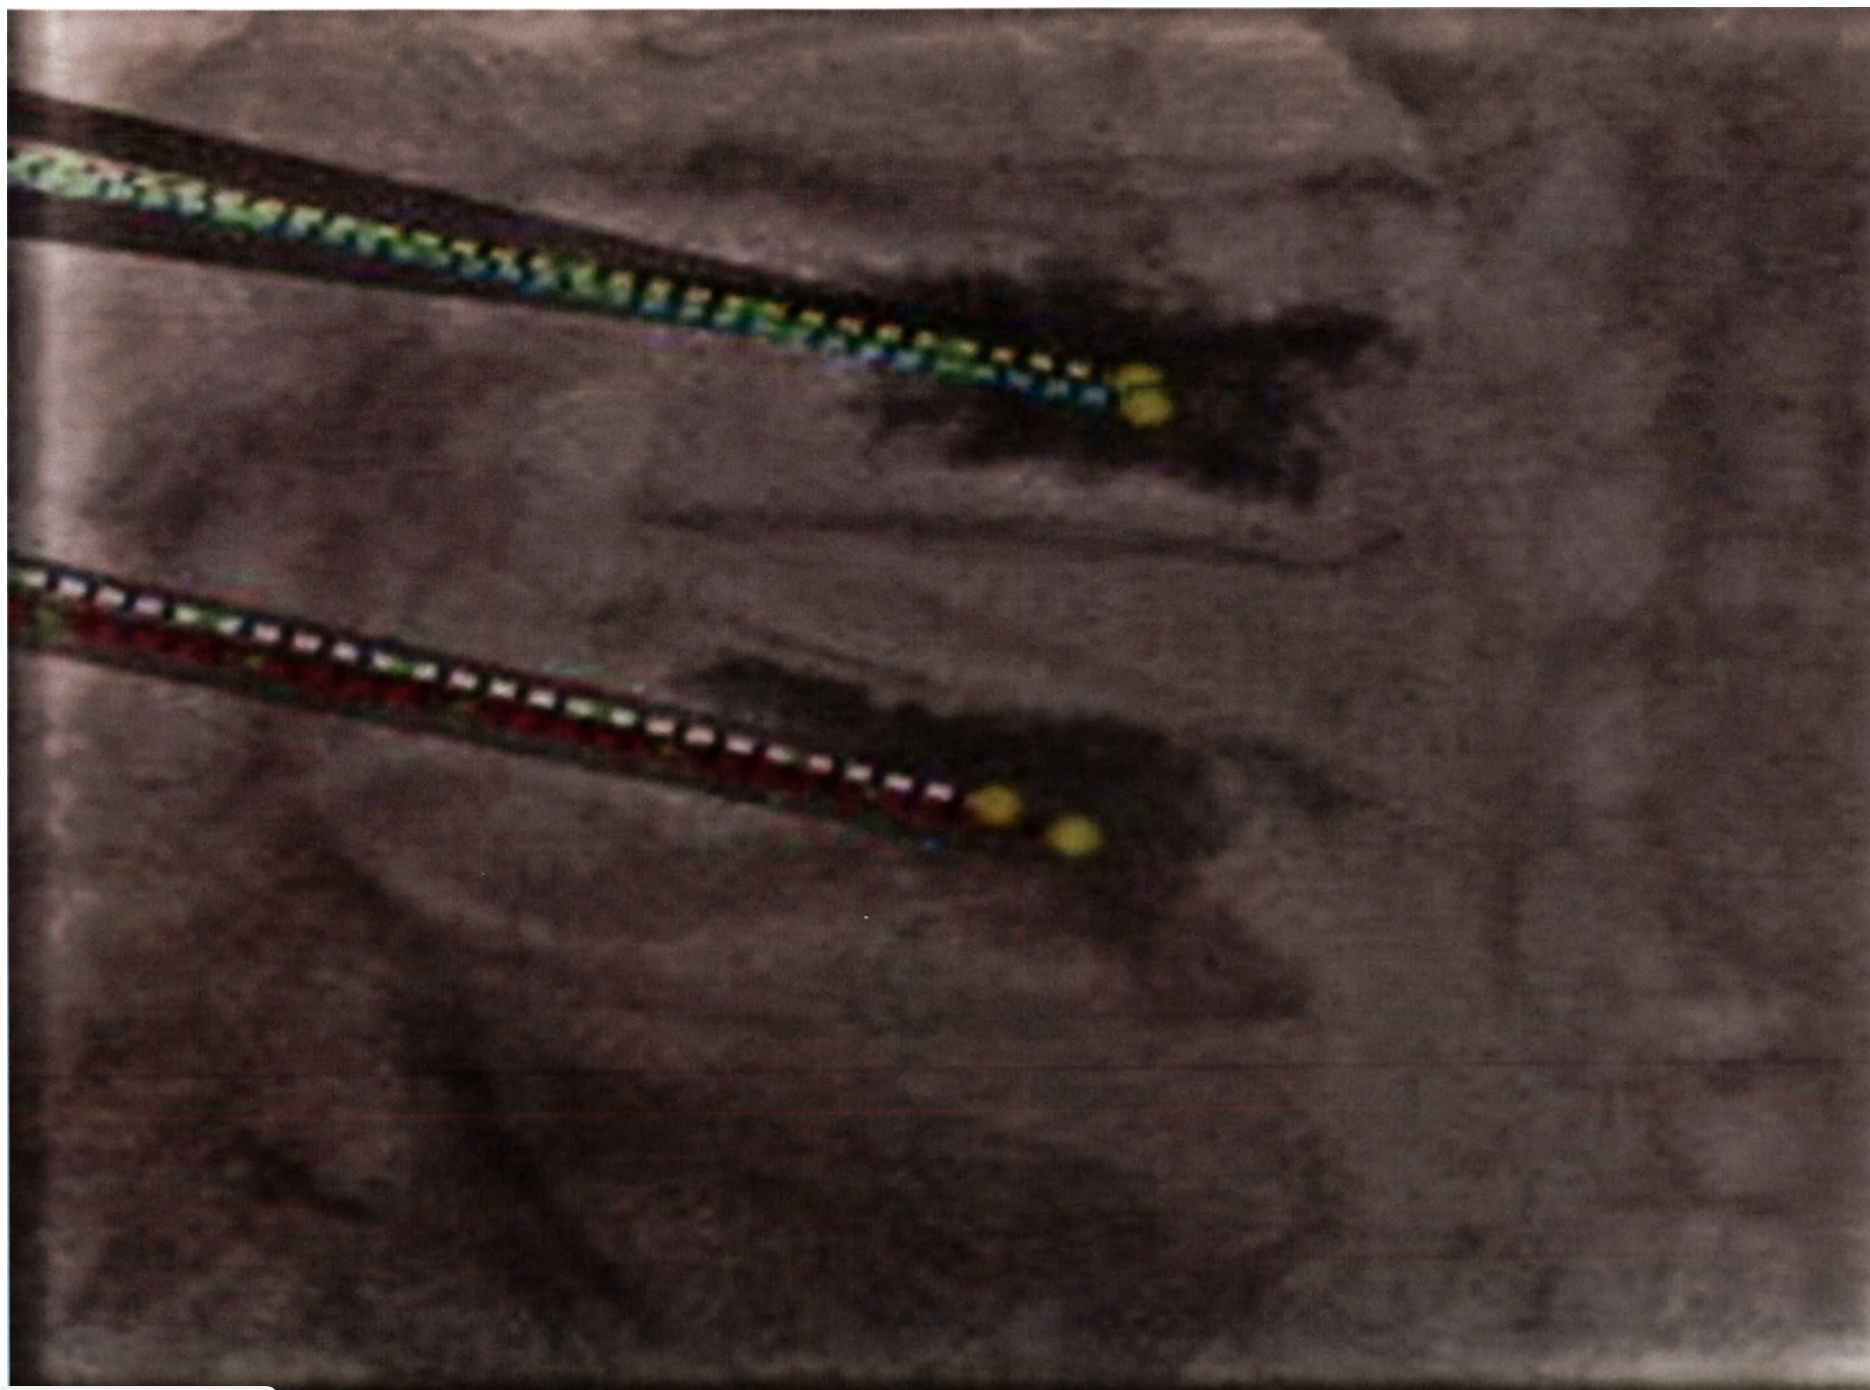

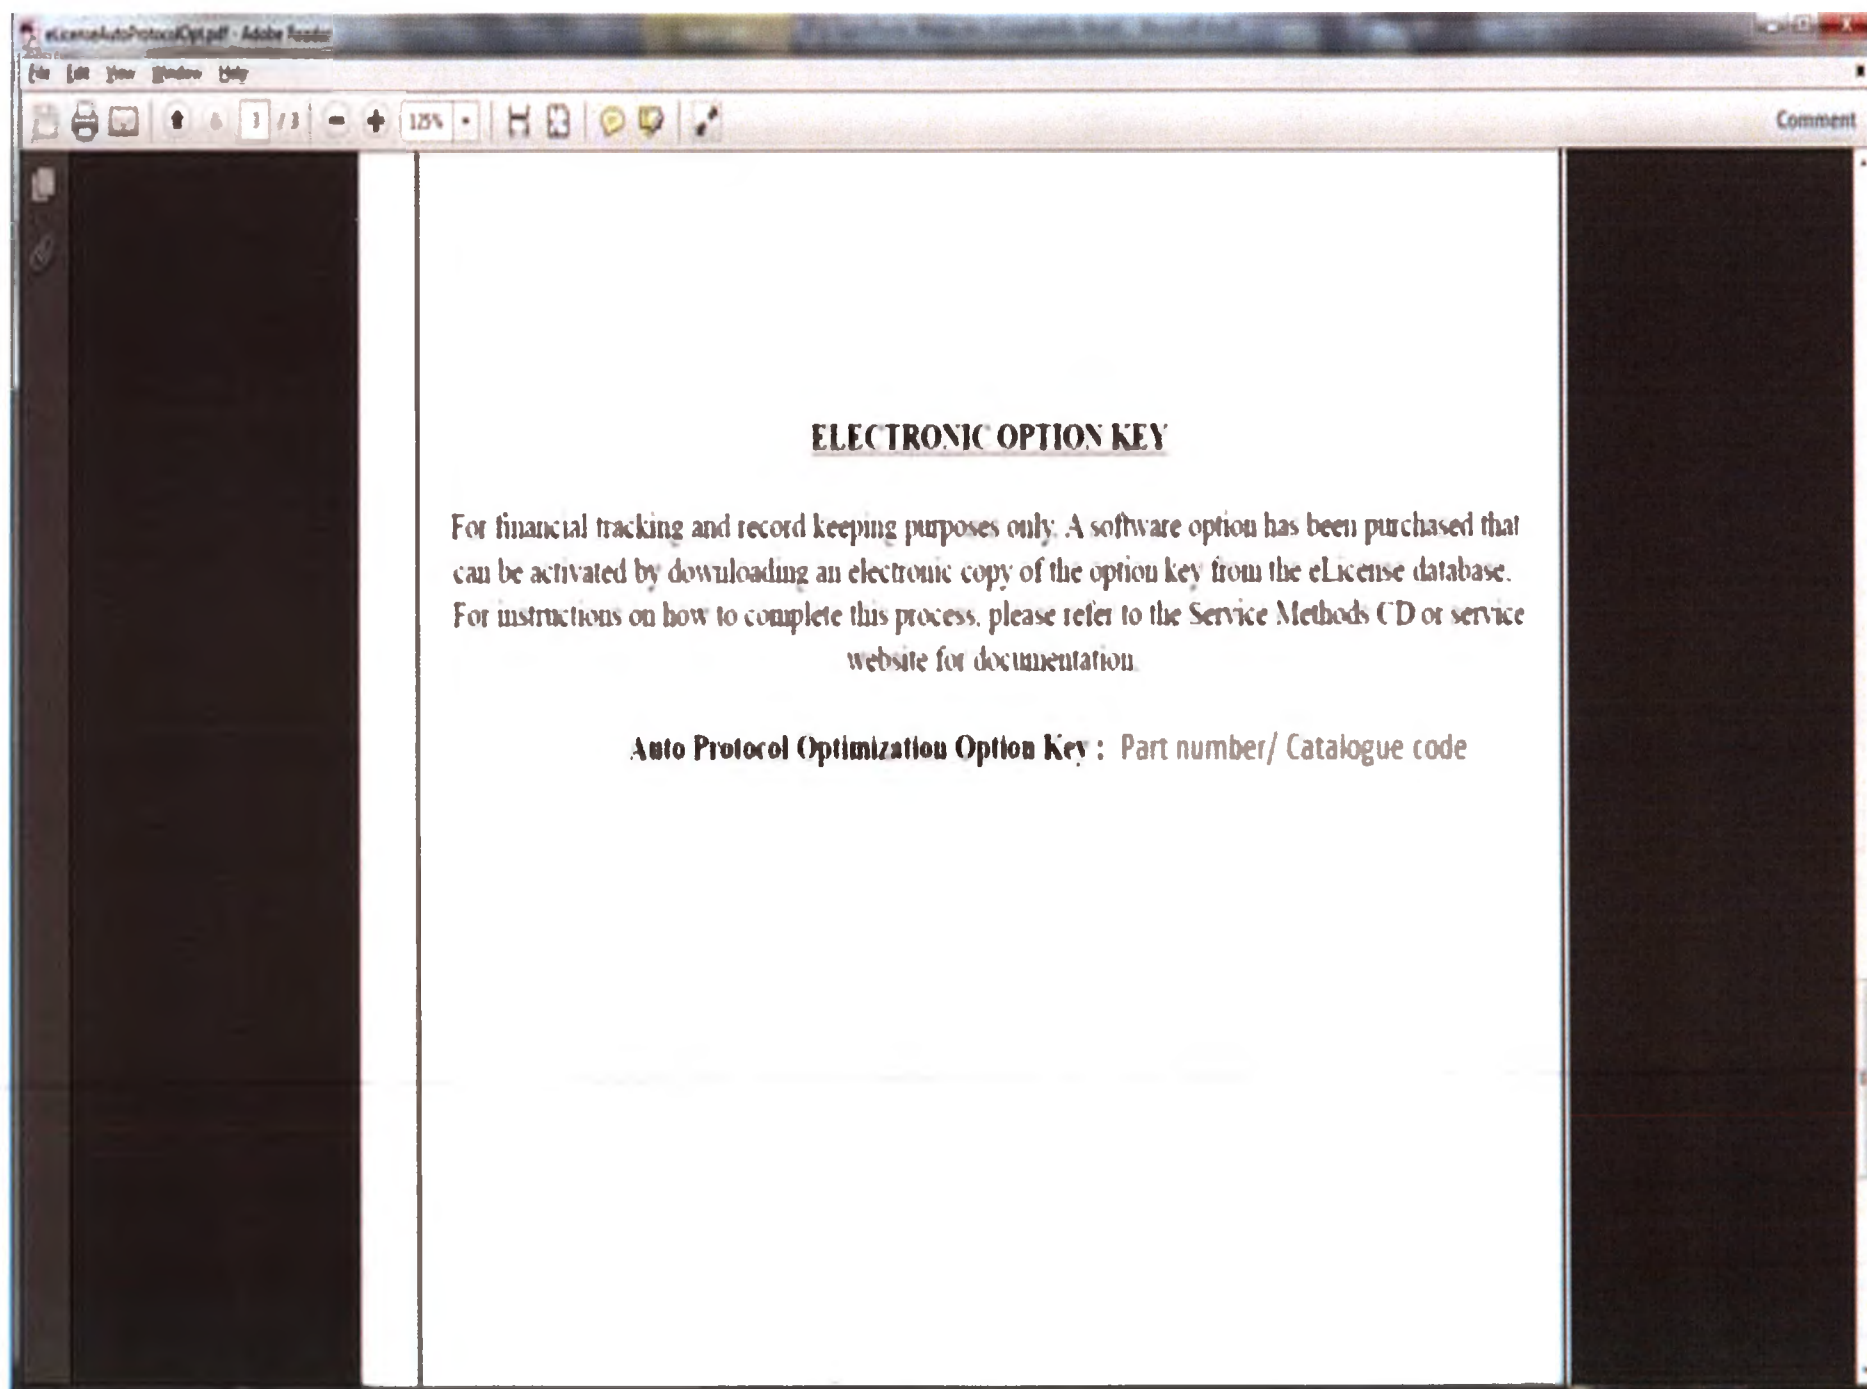


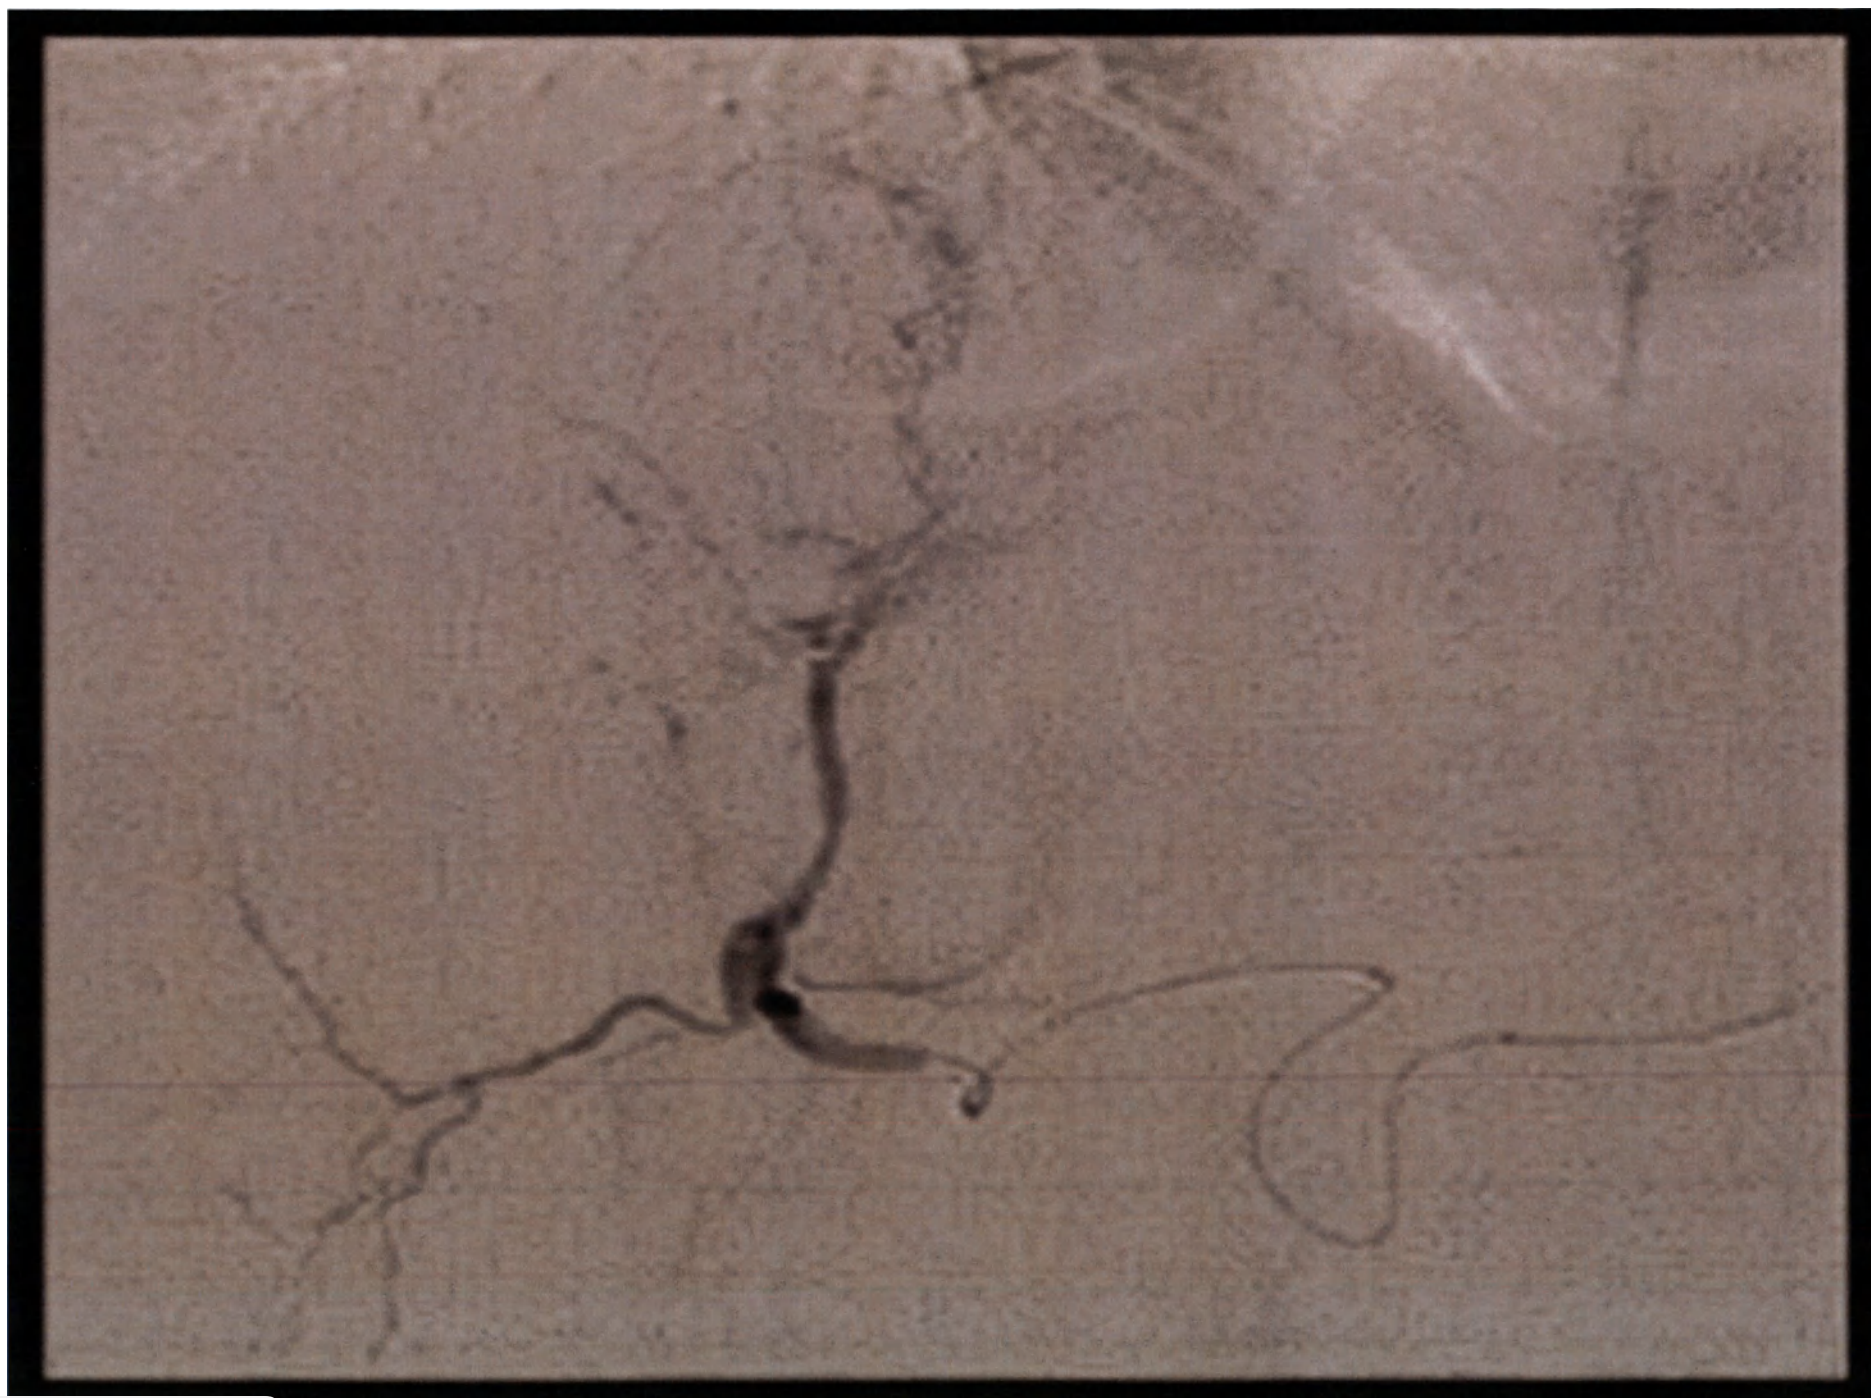

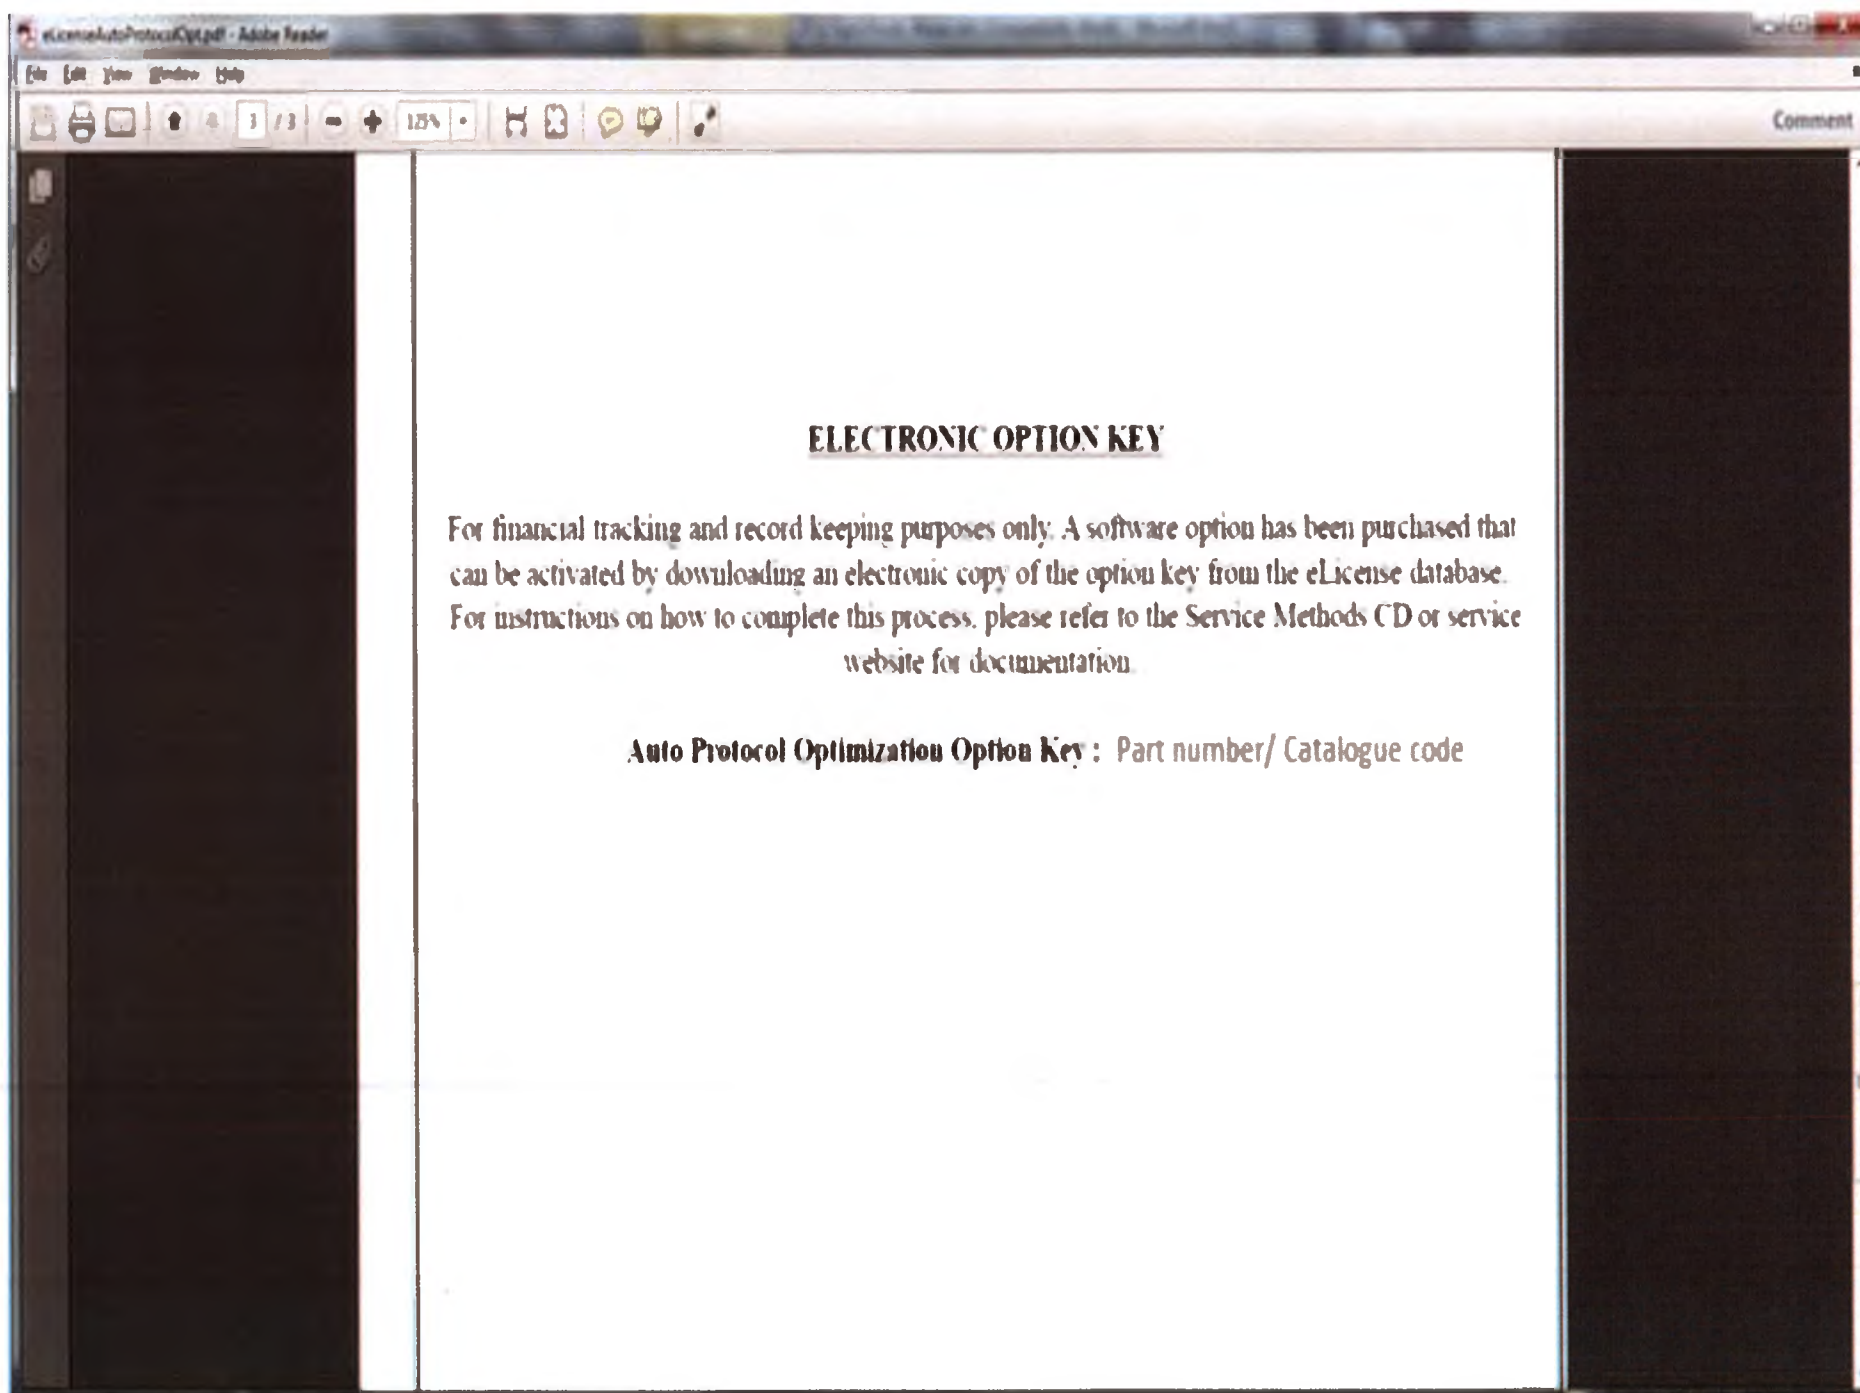





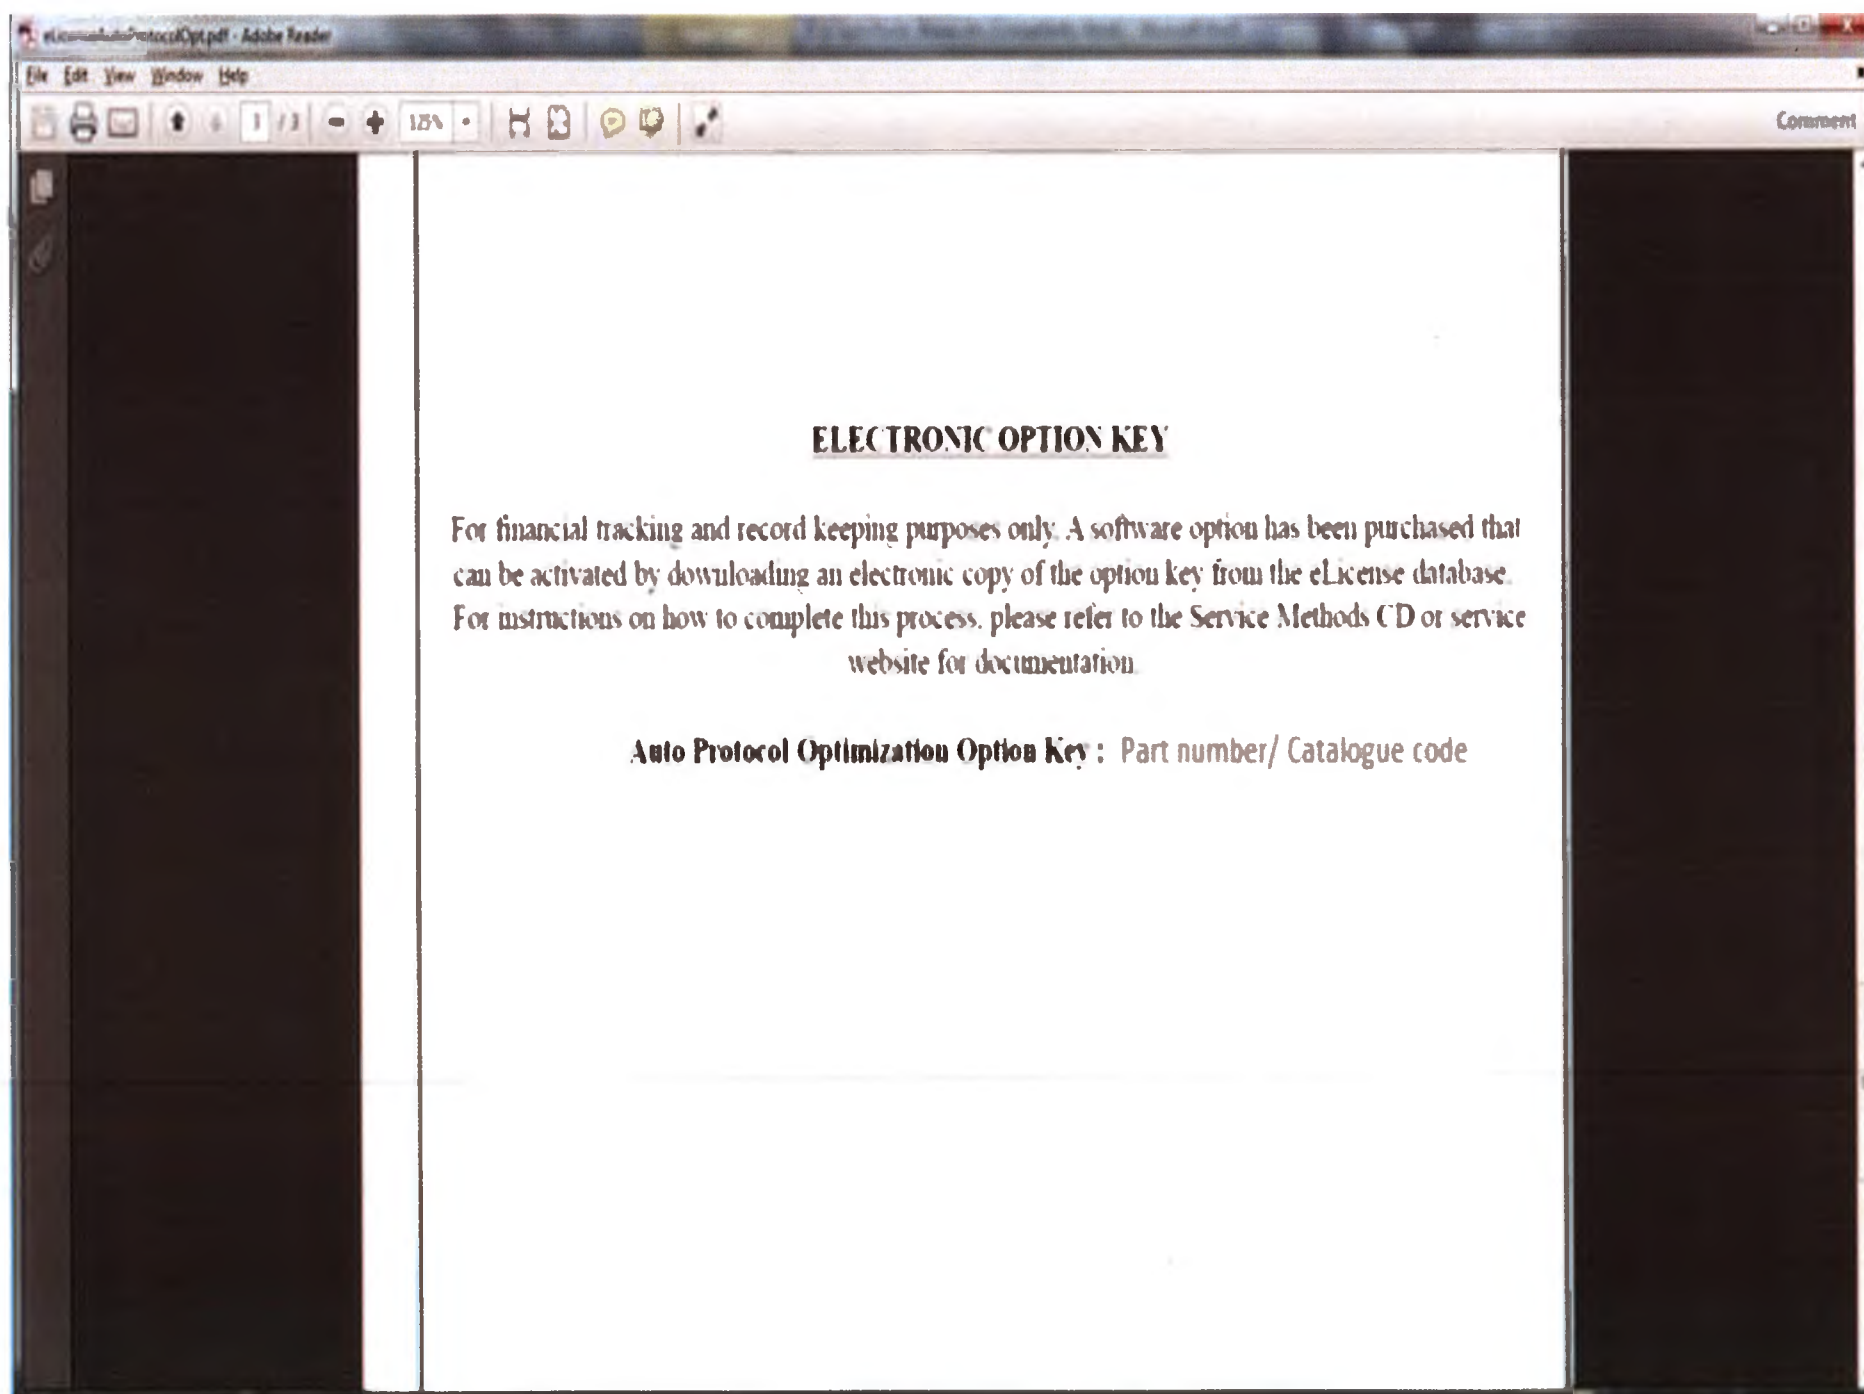














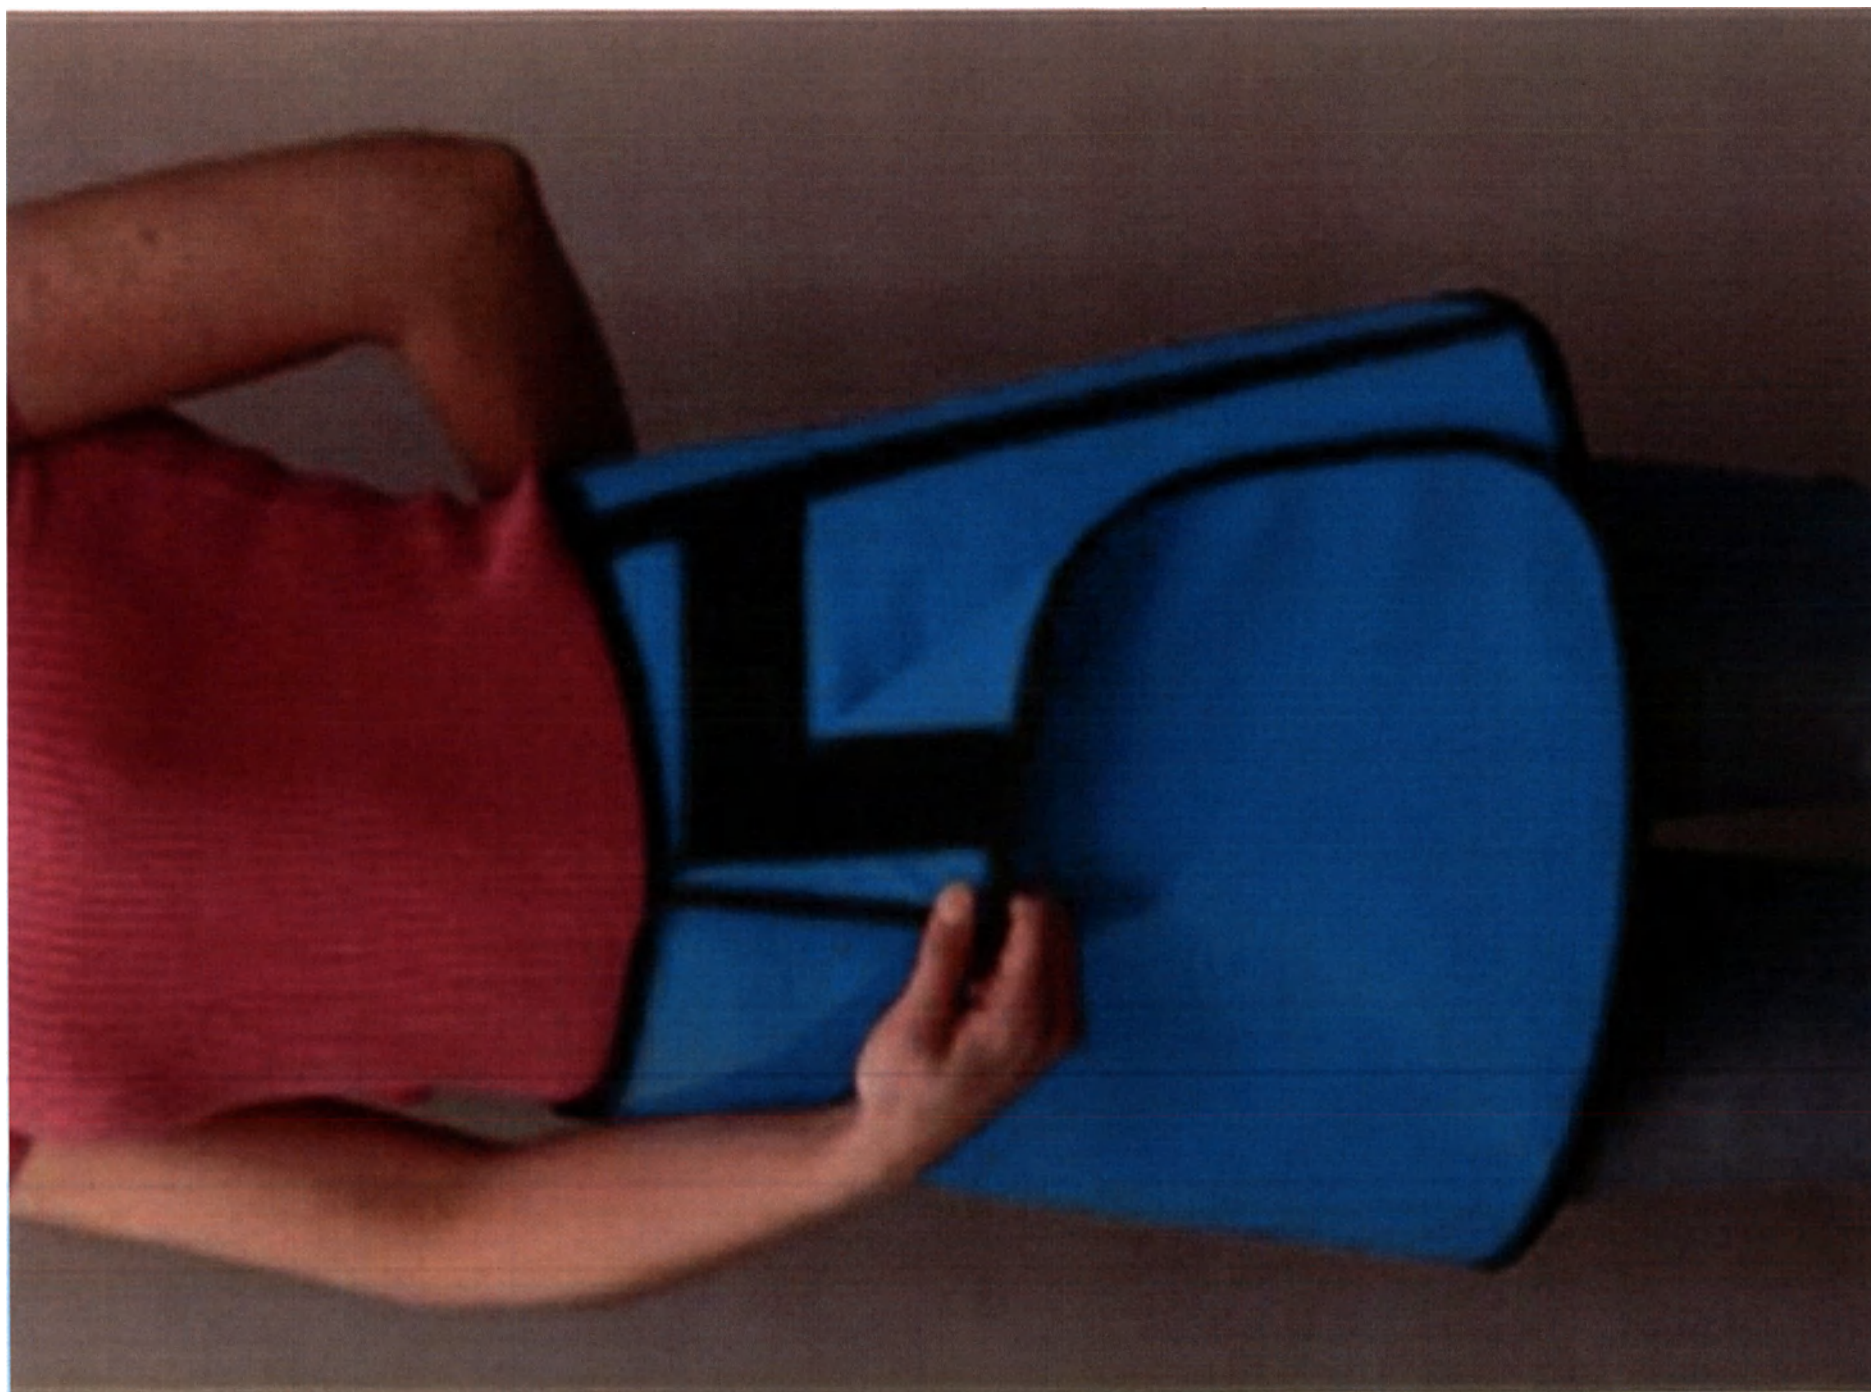










113. Опция расширения в высоту экрана для защиты нижней части тела от рентгеновского излучения, монтируемого к столу.

162

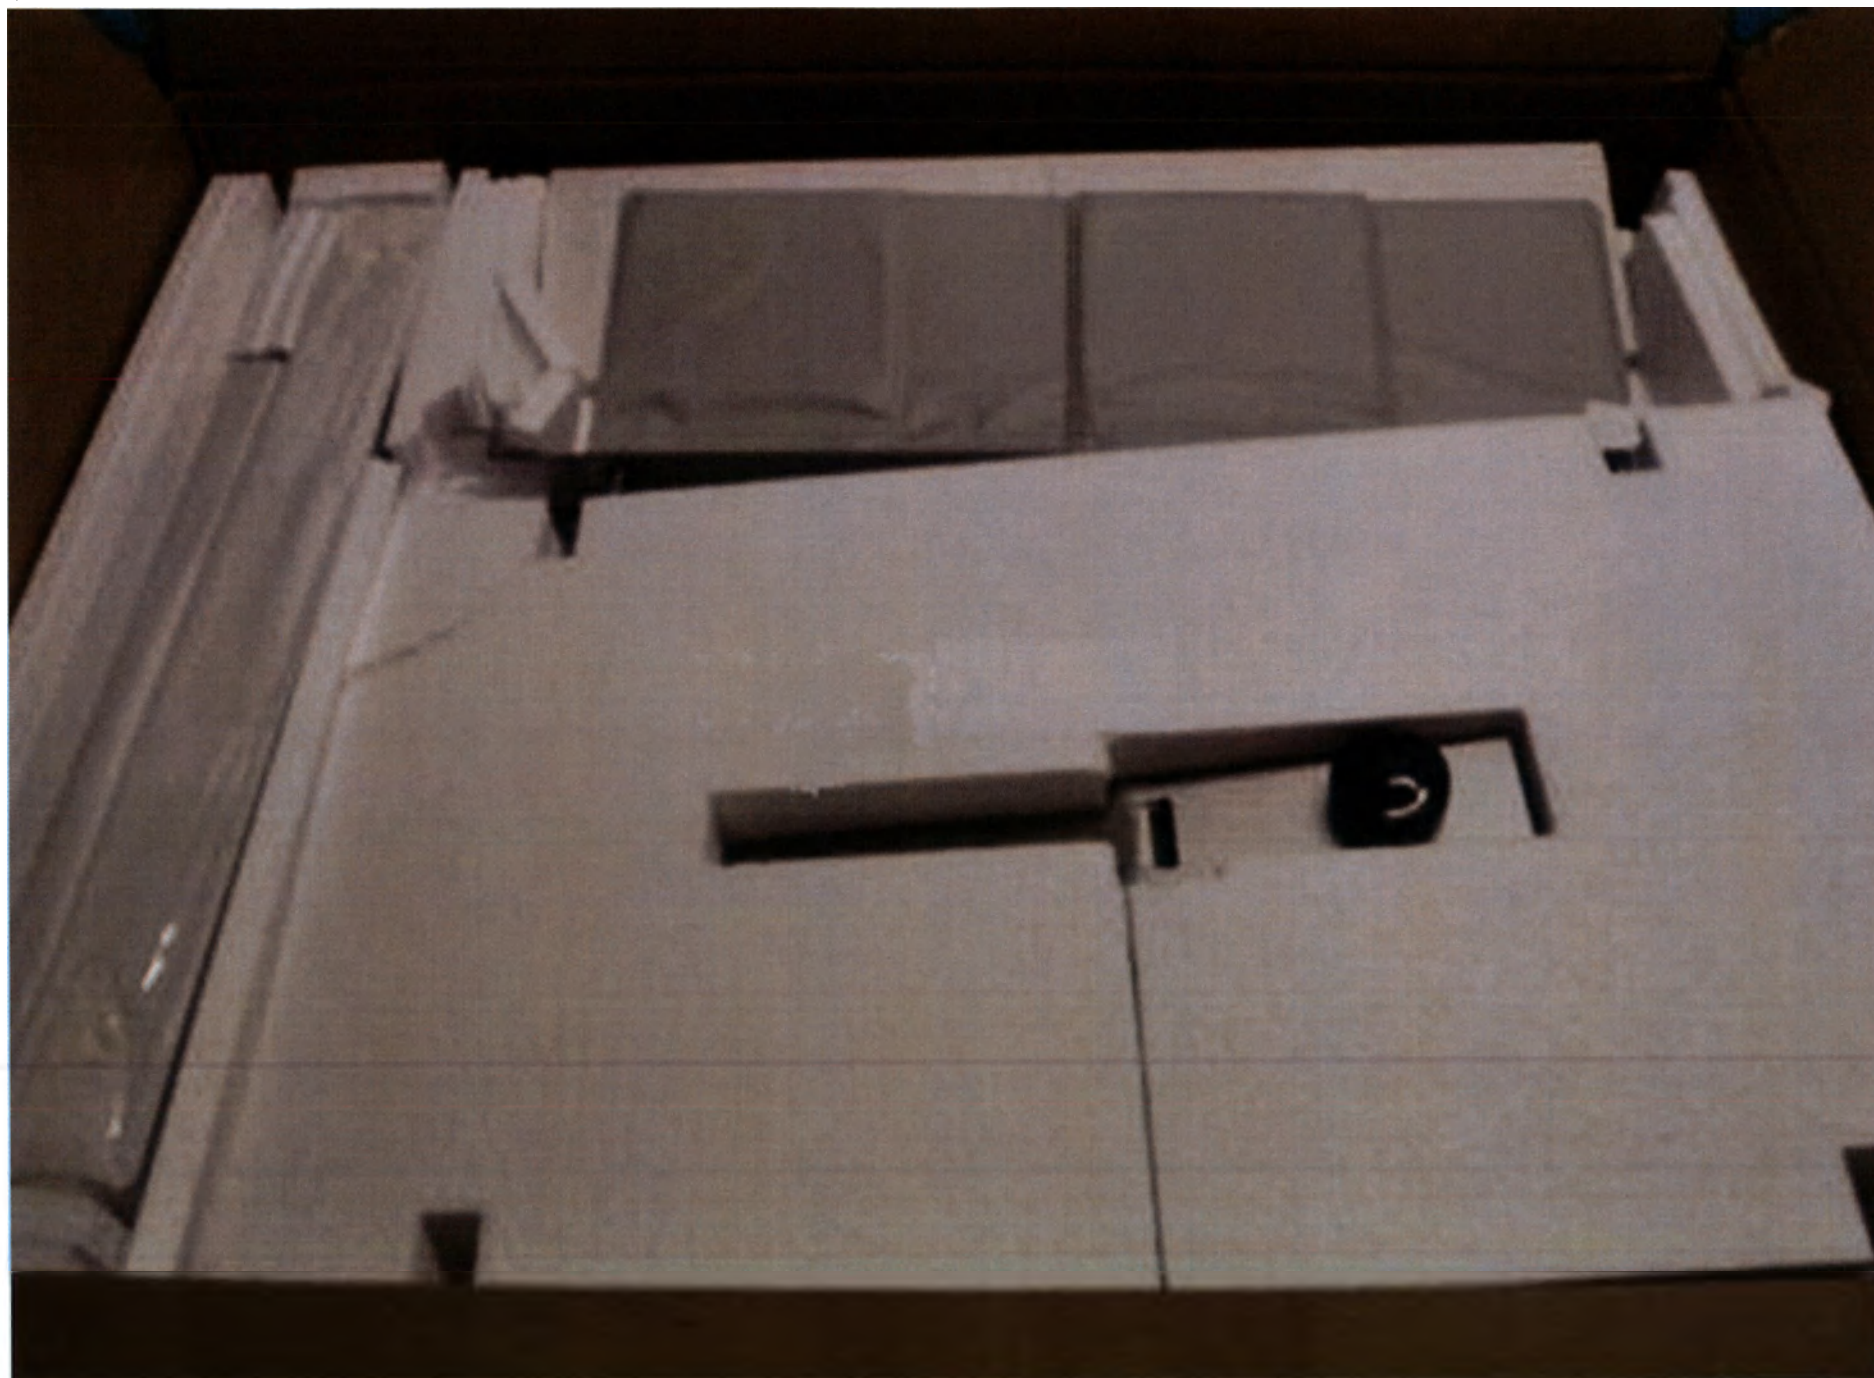












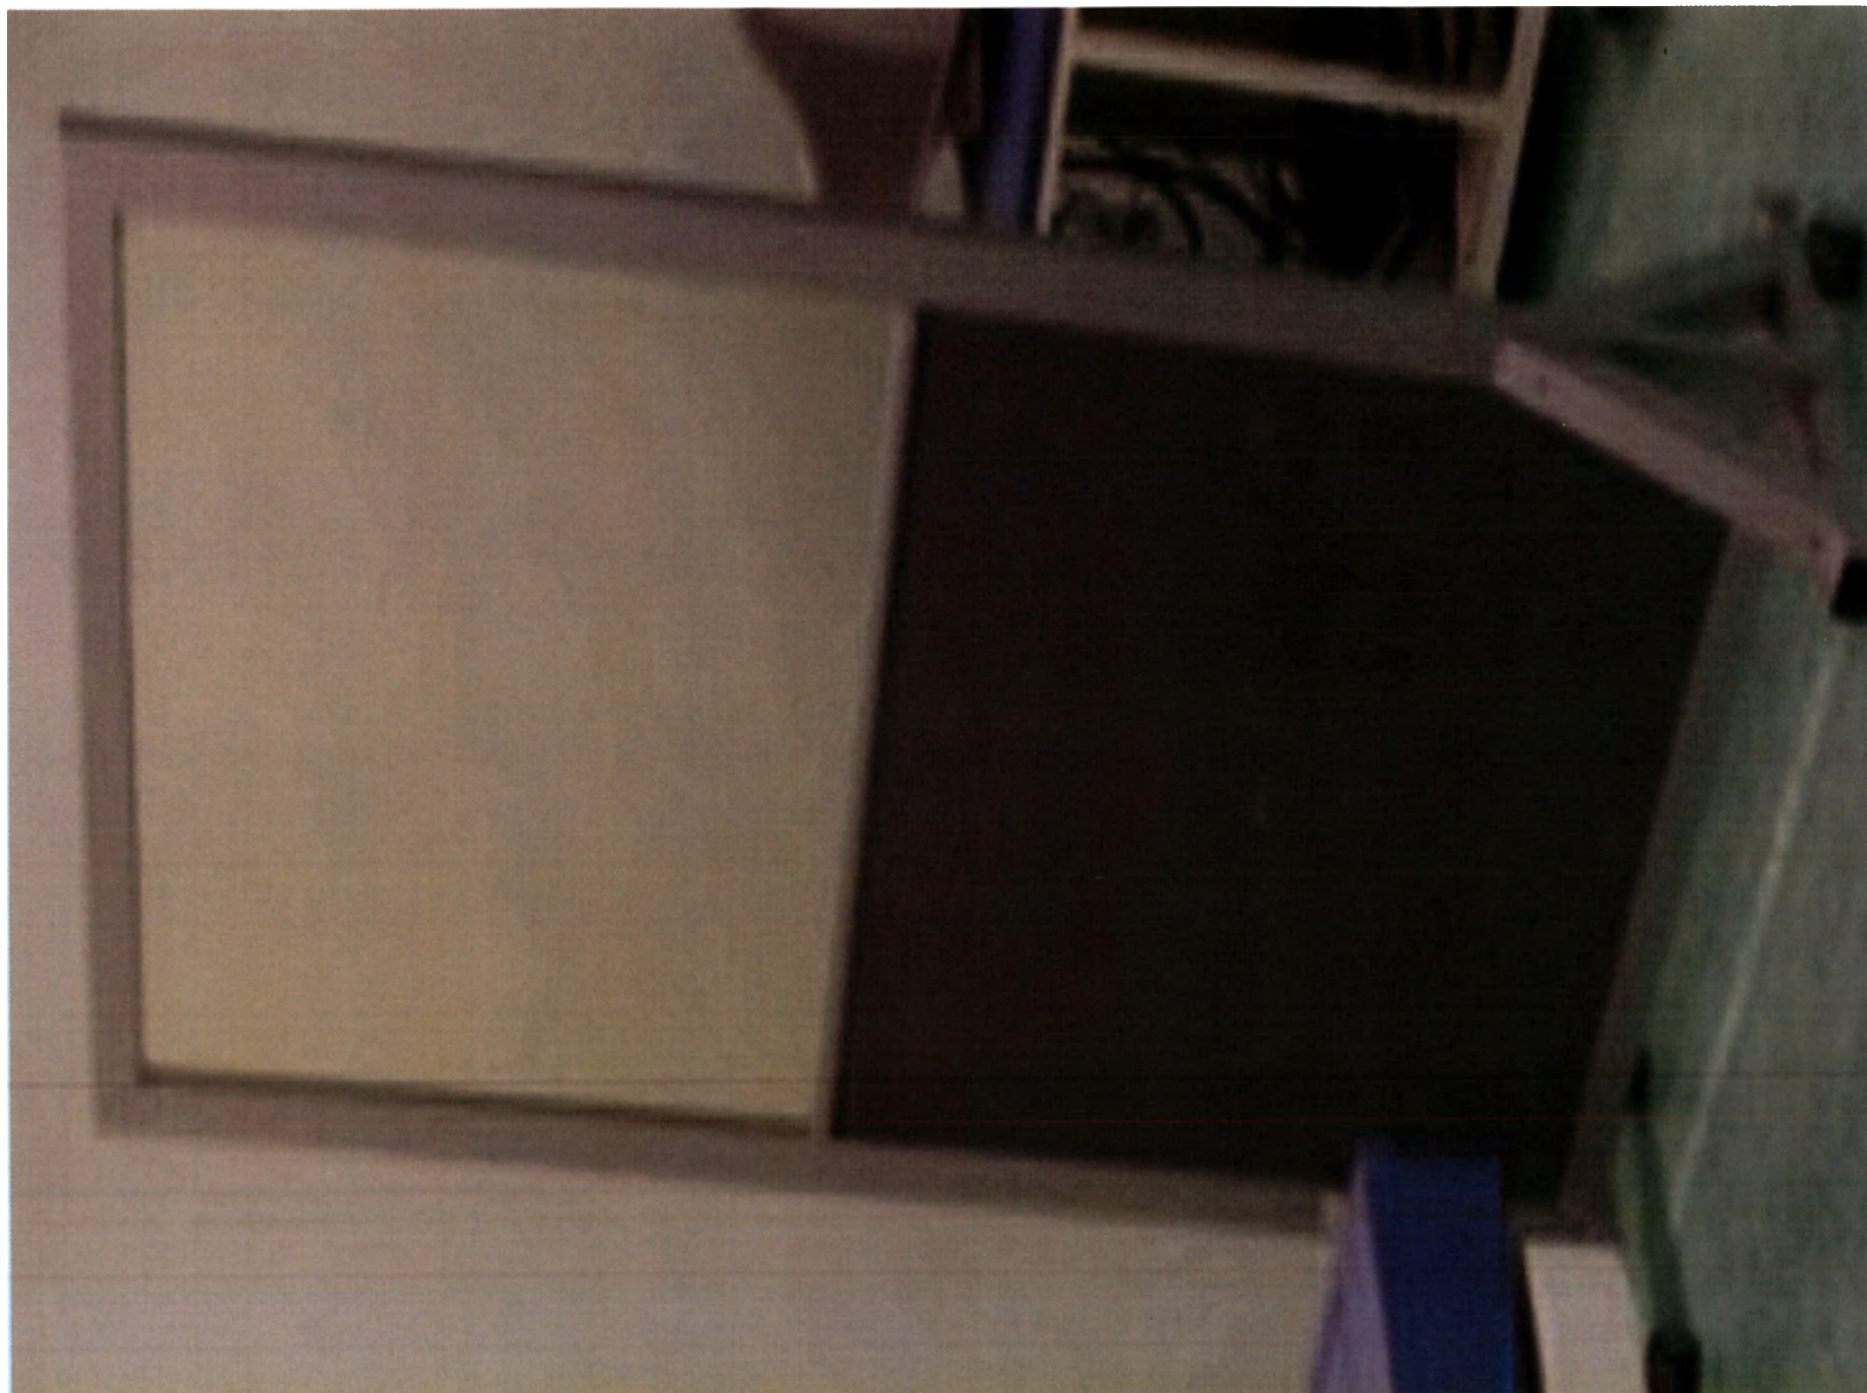

119.Рентгенозащитная ширма потолочного крепления в комплекте со светильником высокой интенсивности потолочного крепления.¹⁶⁸

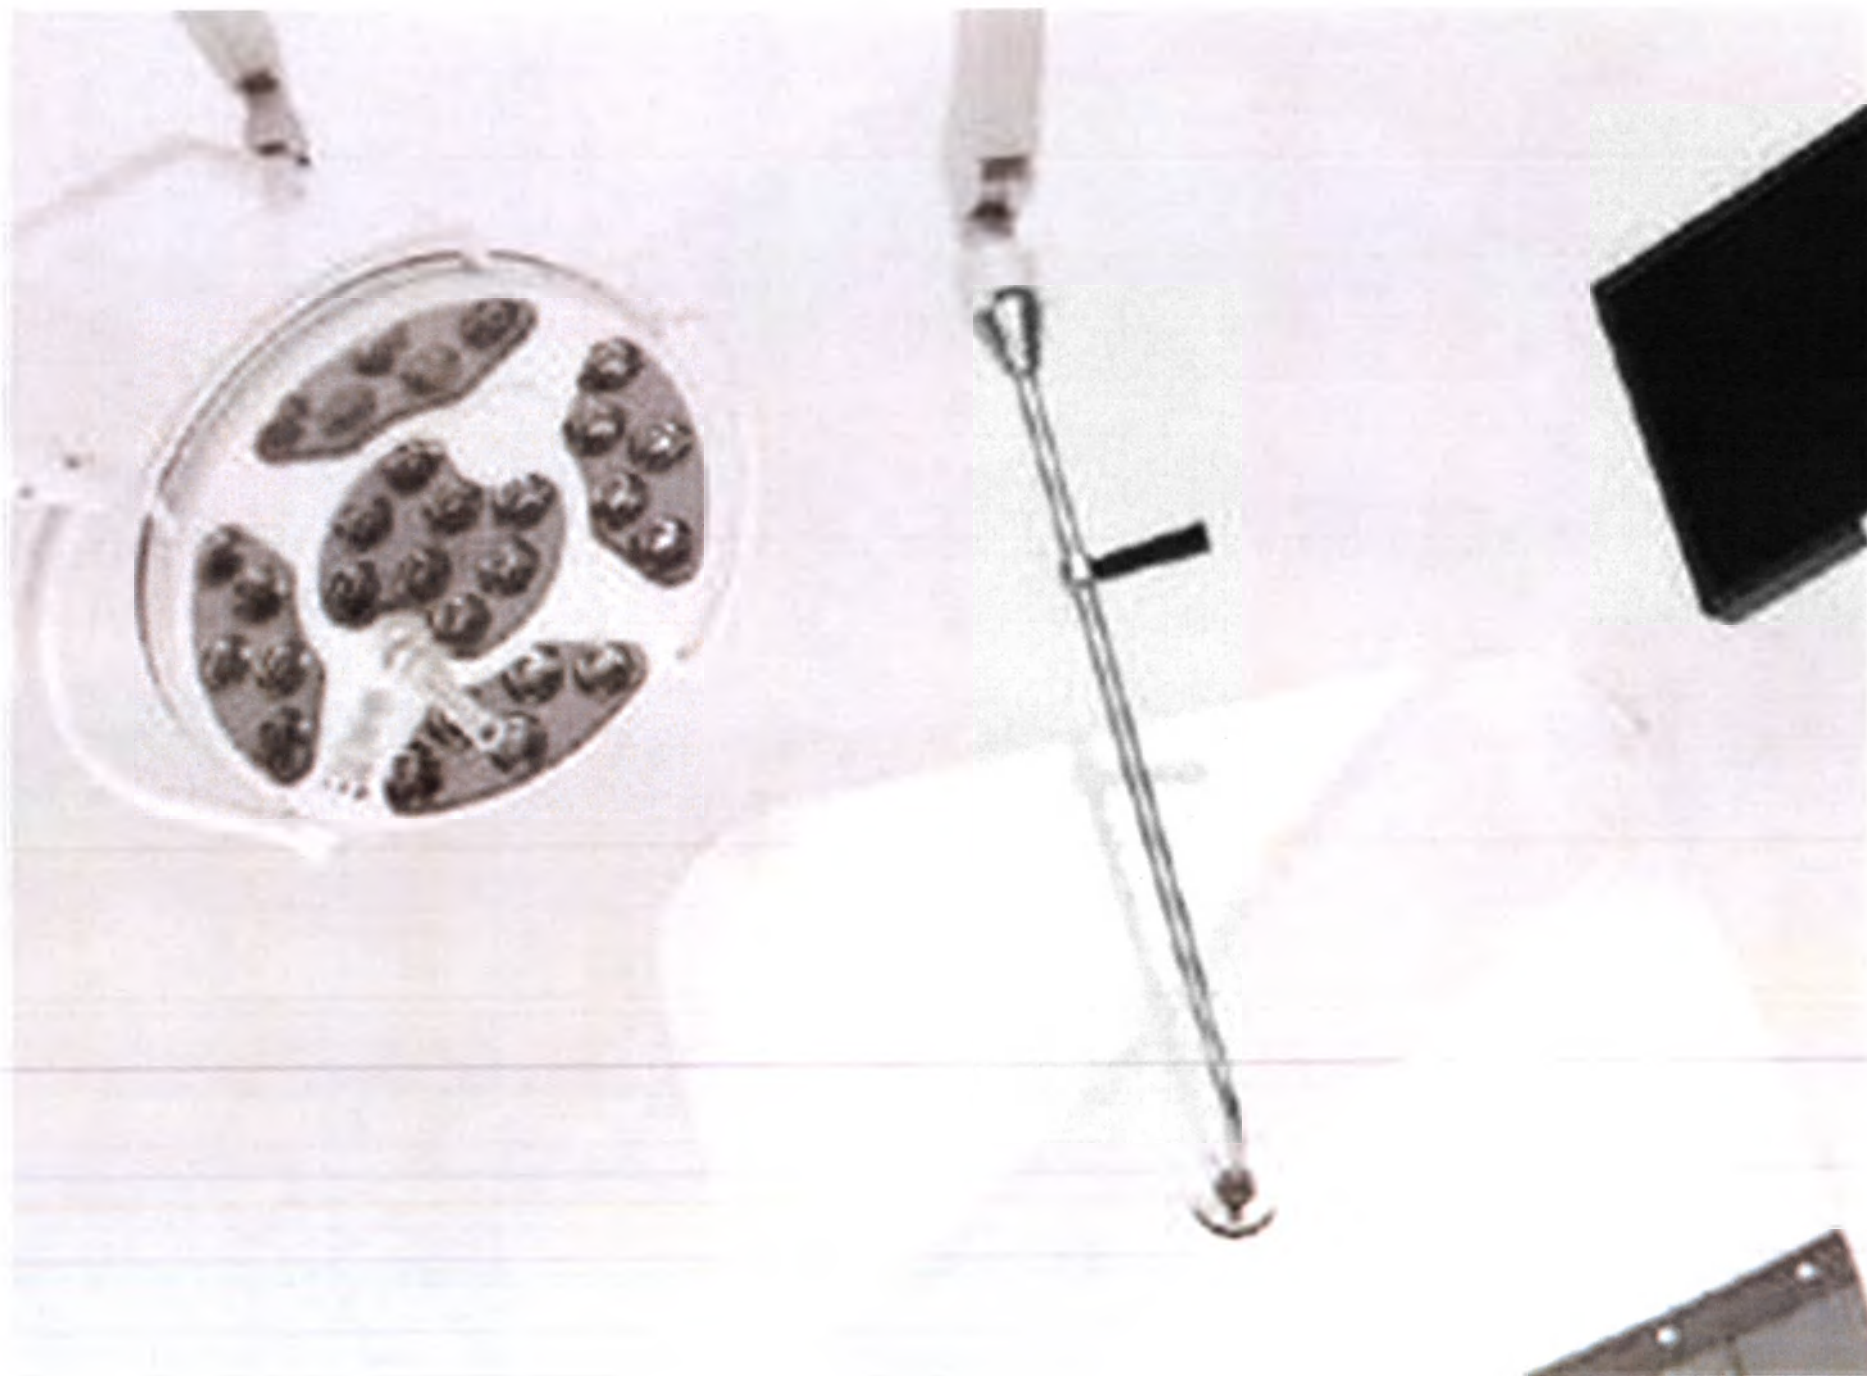

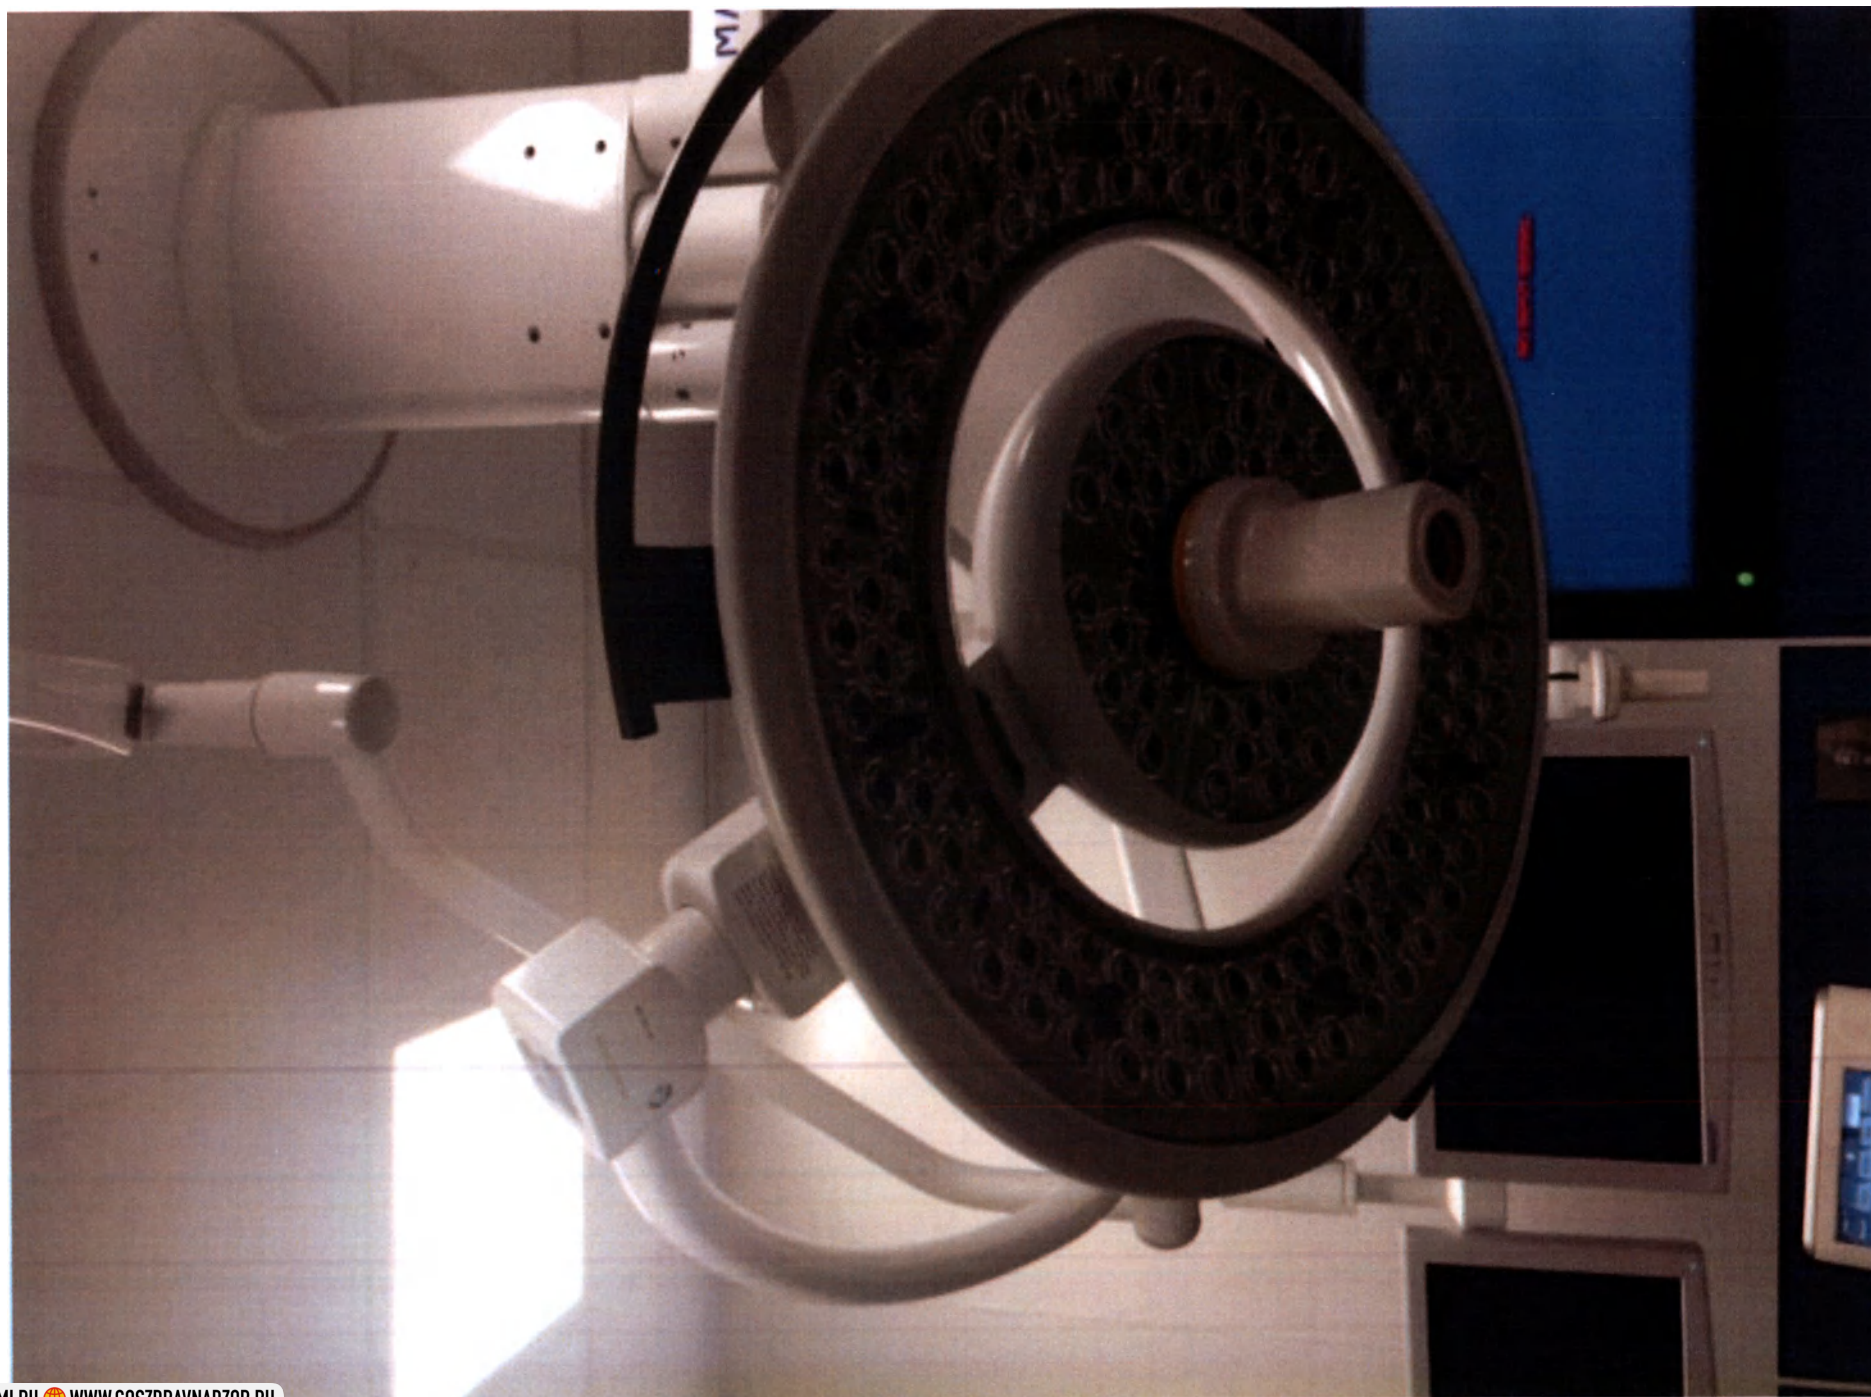















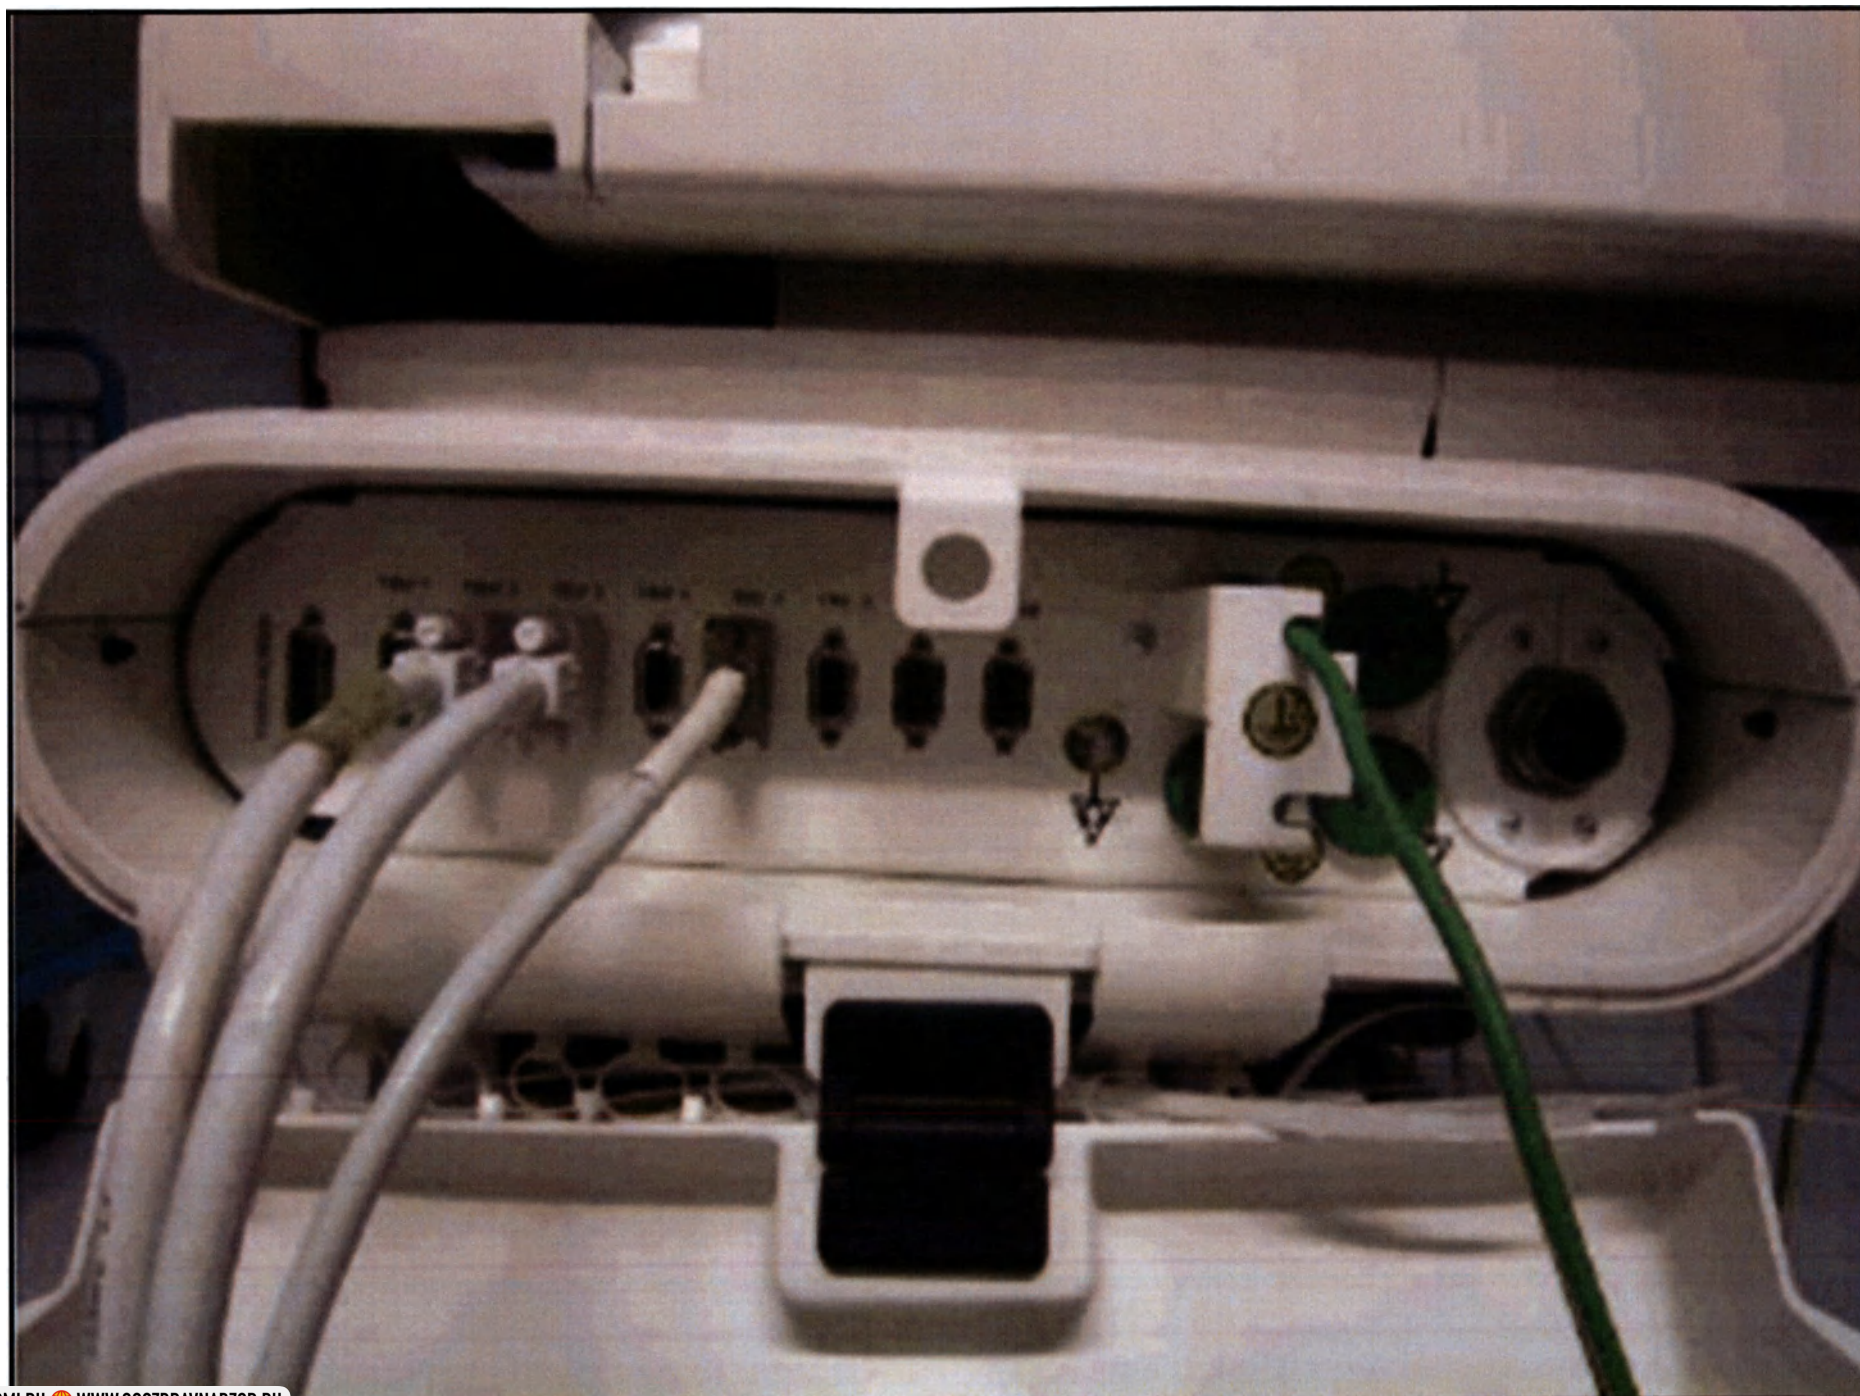



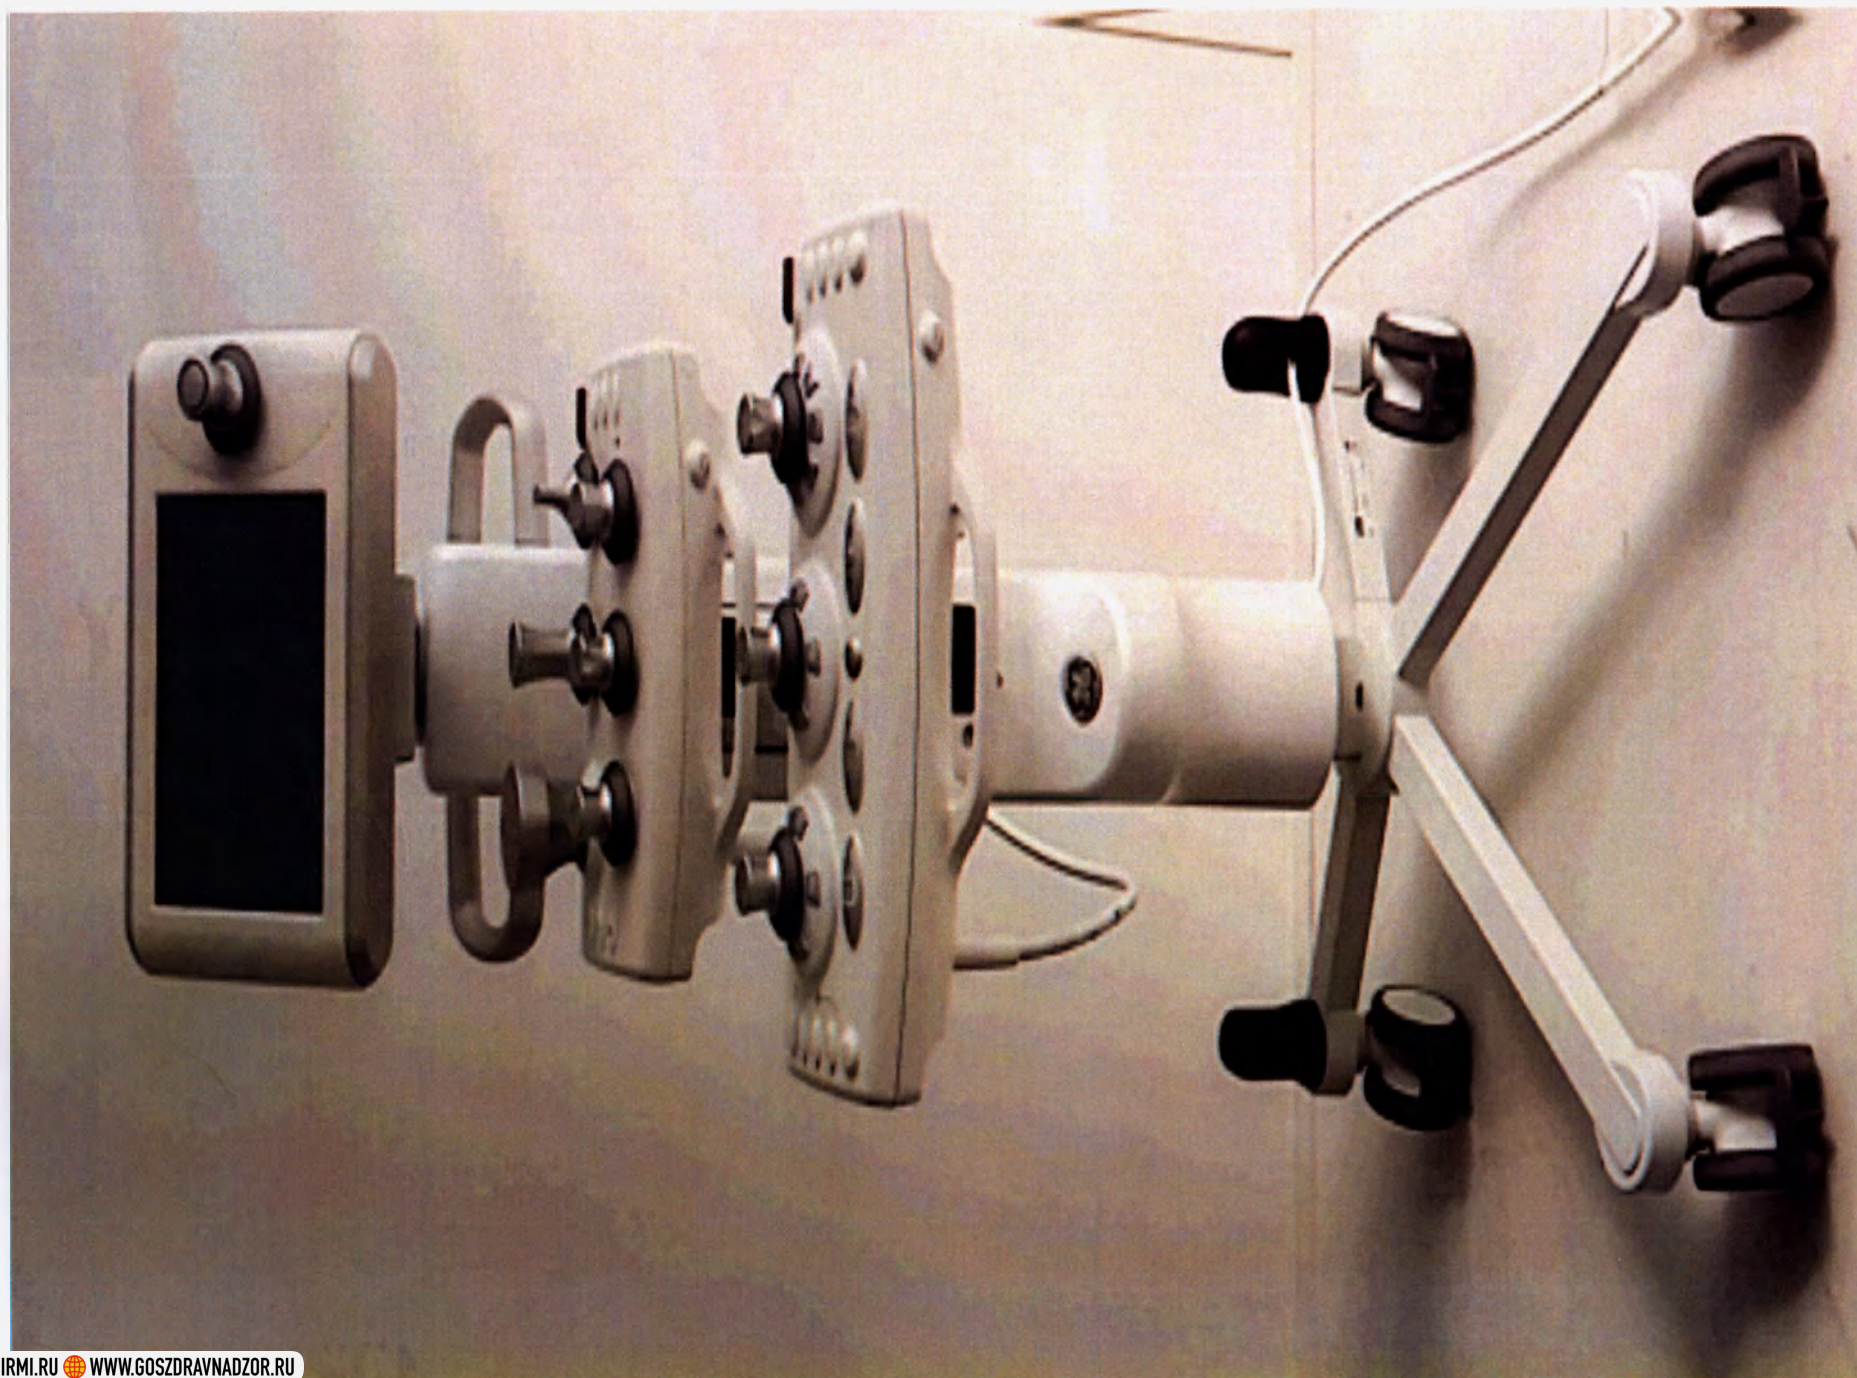

ПРО ИТОИ
СКИЛЛЕНО
ПЕ.АТЬ 178 Л.

