

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов



2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты
в сыворотке (плазме) крови и моче
энзиматическим колориметрическим методом
«МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-064-94568735-2018**

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

REF В 12.03

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

Реагент №1: 2 x 40 мл
Реагент №2: 1 x 20 мл
Калибратор: 1 x 1,5 мл

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

LOT

Серия: 0101



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку дом 55, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 2 x 40 ml

R2: 1 x 20 ml

Calibrator: 1 x 1,5 ml

LOT

0101



2024.10



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 55 A 194356
St. Petersburg, Russia

EMERGO EUROPE
Philipsweg 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

EC REP

K2 НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 40 мл

Реагент №2: 1 x 20 мл

Калибратор: 1 x 1,5 мл

Сериясы: 0101

Шығарылған күні: 2023.04

Дейін жарамды: 2024.10

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
55-й лит. А

только in vitro диагностическому применению



12032304170101

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.03
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
40 мл
LOT 0101
Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностического применения
CE Vital Development

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.03
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
40 мл
LOT 0101
Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностического применения
CE Vital Development

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.03
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
20 мл
LOT 0101
Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностического применения
CE Vital Development

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
1,5 мл
357 мкмоль/л
LOT 0317
Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностического применения
CE Vital Development

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

REF B 12.13

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

Реагент №1: 2 x 100 мл
Реагент №2: 1 x 50 мл
Калибратор: 1 x 1,5 мл

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

LOT Серия: 0101 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку дом 56, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 2 x 100 ml
R2: 1 x 50 ml
Calibrator: 1 x 1,5 ml

LOT 0101

2024.10

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, St. A, 194356
St. Petersburg, Russia

EVERSO EUROPE
Rijnsebaanweg 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

K2 НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862


Қан сарысуындағы (плазмадағы) және неселтегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 100 мл
Реагент №2: 1 x 50 мл
Калибратор: 1 x 1,5 мл

Сериясы: 0101
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.10

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

только для in vitro диагностики



12132304170101

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.13

100 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
только для энзиматического анализа

CE



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.13

100 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
только для энзиматического анализа

CE



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

50 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
только для энзиматического анализа

CE



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
только для энзиматического анализа

CE



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

REF B 12.23

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

Реагент №1: 2 x 200 мл
Реагент №2: 2 x 50 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

LOT Серия: 0101



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку дом 55, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 2 x 200 ml

R2: 2 x 50 ml

Calibrator: 2 x 1,5 ml

LOT 0101



2024.10

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 55 A, 194356
St. Petersburg, Russia

EMERGO EUROPE
P.O. Box 22, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

K2 НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-064-94568735-2018
10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 2 x 200 мл

Реагент №2 : 2 x 50 мл

Калибратор: 2 x 1,5 мл

Сериясы: 0101

Шығарылған күні: 2023.04

Дейін жарамды: 2024.10

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
55-й, Литера А

тек in vitro диагностикасына арналған




12232304170101

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.23

200 мл



LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.23

200 мл



LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE




МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.23

50 мл



LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE




МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.23

50 мл



LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE



REF В 12.73-1.150


МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

Реагент №1: 4 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 22 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл



LOT Серия: 0101 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 4 x 40 ml
R2: 2 x 22 ml
Calibrator: 2 x 1,5 ml

LOT 0101

2024.10

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

EMERGO EUROPE
Prilasseprecht 20 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

EC REP

KZ НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 40мл
Реагент №2: 2 x 22 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

Сериясы: 0101
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.10

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасына арналған



92702110080083



МК 1

МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.150

РЕАГЕНТ 2

22 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

CE

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.150

РЕАГЕНТ 2

22 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

CE

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.150

КАЛИБРАТОР

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.150

КАЛИБРАТОР

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей


REF В 12.713-1.150

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

Реагент №1: 4 x 40 мл
Реагент №2: 4 x 12 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл



LOT Серия: 0101 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 4 x 40 ml
R2: 4 x 12 ml
Calibrator: 2 x 1,5 ml

LOT 0101

2024.10

Vital Development Corporation
Dorogaya Kamennaya 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 40 мл
Реагент №2: 4 x 12 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

Сериясы: 0101
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.10

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

tex in vitro диагностикасына арналған



92742209130094



МК

МК

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ REF В 12.713-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
tex in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ REF В 12.713-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл



LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
tex in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
tex in vitro диагностикасына арналған

CE

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
tex in vitro диагностикасына арналған

CE

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.150

РЕАГЕНТ 2 12 мл



LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
tex in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.150

РЕАГЕНТ 2 12 мл



LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
tex in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.150

РЕАГЕНТ 2 12 мл



LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
tex in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.150

РЕАГЕНТ 2 12 мл



LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
tex in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF В 12.73-1.200

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

Реагент №1: 4 x 20 мл
Реагент №2: 4 x 5 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

LOT

Серия: 0101



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 4 x 20 ml

R2: 4 x 5 ml

Calibrator: 2 x 1,5 ml

LOT 0101

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuki, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2024.10

EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

ECIREP

KZ НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 20 мл
Реагент №2: 4 x 5 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

Сериясы: 0101
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.10

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", АО "Ресей"
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56-й, Литера А

тек in vitro диагностикасына арналған



CE



92712204110089



МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

CE

МК 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МК 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.200

РЕАГЕНТ 2

5 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МК 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МК 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.200

РЕАГЕНТ 2

5 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.200

РЕАГЕНТ 2

5 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.200

РЕАГЕНТ 2

5 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

КАЛИБРАТОР

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF В 12.713-1.200

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочево
кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче
энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

Реагент №1: 8 x 20 мл

Реагент №2: 8 x 5 мл

Калибратор: 2 x 1,5 мл

LOT

Серия:



Дата выпуска:



Годен до:

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 8 x 20 ml

R2: 8 x 5 ml

Calibrator: 2 x 1,5 ml

LOT 0101



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2024.10

EVERGO EUROPE
Pinssesteegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

EC/REP

KZ НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының
концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен
анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 8 x 20 мл

Реагент №2 : 8 x 5 мл

Калибратор: 2 x 1,5 мл

Сериясы: 0101

Шығарылған күні: 2023.04

Дейін жарамды: 2024.10

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



91262209130094



МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200

20 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
Витал Девелопмент Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 1



МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200

20 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
Витал Девелопмент Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 1



МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200

20 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
Витал Девелопмент Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 1



МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200

20 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
Витал Девелопмент Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 1



МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200

20 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
Витал Девелопмент Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 1



МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200

20 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
Витал Девелопмент Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 1



МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200

20 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
Витал Девелопмент Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 1



МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200

20 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
Витал Девелопмент Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 1



МК 1

МК 2

МК 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

5 мл

LOT 0101

Годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

Тек іп. вiтo диагностикасына арналған

Витал Де Корпорэйшн, Россия

Витал Де Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

5 мл

LOT 0101

Годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

Тек іп. вiтo диагностикасына арналған

Витал Де Корпорэйшн, Россия

Витал Де Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

5 мл

LOT 0101

Годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

Тек іп. вiтo диагностикасына арналған

Витал Де Корпорэйшн, Россия

Витал Де Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

5 мл

LOT 0101

Годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

Тек іп. вiтo диагностикасына арналған

Витал Де Корпорэйшн, Россия

Витал Де Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

5 мл

LOT 0101

Годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

Тек іп. вiтo диагностикасына арналған

Витал Де Корпорэйшн, Россия

Витал Де Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

5 мл

LOT 0101

Годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

Тек іп. вiтo диагностикасына арналған

Витал Де Корпорэйшн, Россия

Витал Де Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

Годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

Тек іп. вiтo диагностикасына арналған

Витал Де Корпорэйшн, Россия

Витал Де Корпорэйшн АҚ Ресей

КАЛИБРАТОР

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

Годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

Тек іп. вiтo диагностикасына арналған

Витал Де Корпорэйшн, Россия

Витал Де Корпорэйшн АҚ Ресей

КАЛИБРАТОР

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

5 мл

LOT 0101

Годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

Тек іп. вiтo диагностикасына арналған

Витал Де Корпорэйшн, Россия

Витал Де Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.713-1.200
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

5 мл

LOT 0101

Годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

Тек іп. вiтo диагностикасына арналған

Витал Де Корпорэйшн, Россия

Витал Де Корпорэйшн АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 2


REF B 12.73-1.300

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

Реагент №1: 3 x 52 мл
Реагент №2: 3 x 15 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл



LOT

Серия: 0101



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 3 x 52 ml
R2: 3 x 15 ml

Calibrator: 2 x 1,5 ml

LOT 0101



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuki 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2024.10

IVD

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-064-94568735-2018
10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 3 x 52 мл
Реагент №2 : 3 x 15 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

Сериясы: 0101
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.10

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасына арналған



92722209130084



MK 1

MK 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.73-1.300

РЕАГЕНТ 1 52 мл



LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

MK 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.73-1.300

РЕАГЕНТ 1 52 мл



LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.73-1.300

РЕАГЕНТ 1 52 мл



LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.73-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.73-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.73-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.73-1.300

КАЛИБРАТОР 1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

Годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР

КАЛИБРАТОР


REF В 12.713-1.300

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

Реагент №1: 6 x 52 мл
Реагент №2: 6 x 15 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл



LOT Серия: 0101 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 6 x 52 ml
R2: 6 x 15 ml
Calibrator: 2 x 1,5 ml

LOT 0101



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2024.10

IVD

ECIREP

EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

K2 НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-064-94568735-2018
10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 6 x 52 мл
Реагент №2 : 6 x 15 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

Сериясы: 0101
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.10

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасына арналған



91272209130094

CE



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.300

1 52 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған



CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.300


1 52 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған



CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.300

1 52 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған



CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.300

1 52 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған



CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.300

1 52 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған



CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.300

1 52 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған



CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл

LOT 0101


Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

Толқас для in vitro диагностикасы арналған

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0101


Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

Толқас для in vitro диагностикасы арналған

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0101


Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

Толқас для in vitro диагностикасы арналған

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0101


Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

Толқас для in vitro диагностикасы арналған

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0101


Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

Толқас для in vitro диагностикасы арналған

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.300

РЕАГЕНТ 2 15 мл



LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

Толқас для in vitro диагностикасы арналған

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

КАЛИБРАТОР
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
1,5 мл
357 мкмоль/л
LOT 0317
Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02
Толқас для in vitro диагностикасы арналған
Витал

КАЛИБРАТОР
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
1,5 мл
357 мкмоль/л
LOT 0317
Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02
Толқас для in vitro диагностикасы арналған
Витал

REF В 12.73-1.420

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

Реагент №1: 2 x 72 мл
Реагент №2: 2 x 20 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

LOT Серия: 0101



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 2 x 72 ml

R2: 2 x 20 ml

Calibrator: 2 x 1,5 ml

LOT 0101



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

ECIREP

EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018

10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 2 x 72 мл

Реагент №2 : 2 x 20 мл

Калибратор: 2 x 1,5 мл

Сериясы: 0101

Шығарылған күні: 2023.04

Дейін жарамды: 2024.10

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасына арналған



CE



92732207130092



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.420

72 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған



CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.420

72 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған



CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.73-1.420

20 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.73-1.420

20 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

КАЛИБРАТОР

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF В 12.713-1.420

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018

РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

Реагент №1: 4 x 72 мл

Реагент №2: 4 x 20 мл

Калибратор: 2 x 1,5 мл

LOT

Серия: 0101



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 4 x 72 ml

R2: 4 x 20 ml

Calibrator: 2 x 1,5 ml

LOT 0101



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2024.10

IVD

EC/REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018

10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 72 мл

Реагент №2: 4 x 20 мл

Калибратор: 2 x 1,5 мл

Сериясы: 0101

Шығарылған күні: 2023.04

Дейін жарамды: 2024.10

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасына арналған



91282209130094



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.420

1 72 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.420

1 72 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

годен до: 2025.02

Дейін жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.420

1 72 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.420

2 20 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.420

2 20 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.420

1 72 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.420

2 20 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.420

2 20 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF B 12.723-1.420

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом


ТУ 21.20.23-064-94568735-2018

РЭН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

Реагент №1: 6 x 72 мл

Реагент №2: 6 x 20 мл

Калибратор: 3 x 1,5 мл



LOT

Серия: 0101



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 6 x 72 ml

R2: 6 x 20 ml

Calibrator: 3 x 1,5 ml

LOT 0101



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuki 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2024.10



EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

EC REP

KZ НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018

10.12.2018 ж. РЭН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 6 x 72 мл

Реагент №2 : 6 x 20 мл

Калибратор: 3 x 1,5 мл

Сериясы: 0101

Шығарылған күні: 2023.04

Дейін жарамды: 2024.10

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасына арналған



12042206130091



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.723-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ

MK

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.723-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ

MK

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.723-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ

MK

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.723-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ

MK

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF B 12.723-1.420

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ

РЕАГЕНТ 1 72 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10

Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ

**МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ**

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.723-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

25°C 8°C

LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

Толық ала ішкі диагностика
тек ішкі диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

**МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ**

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.723-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

25°C 8°C

LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

Толық ала ішкі диагностика
тек ішкі диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

**МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ**

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.723-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

25°C 8°C

LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

Толық ала ішкі диагностика
тек ішкі диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

**МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ**

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.723-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

25°C 8°C

LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

Толық ала ішкі диагностика
тек ішкі диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

**МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ**

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.723-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

25°C 8°C

LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

Толық ала ішкі диагностика
тек ішкі диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

**МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ**

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.723-1.420

РЕАГЕНТ 2 20 мл

25°C 8°C

LOT 0101

Годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

Толық ала ішкі диагностика
тек ішкі диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

Толық ала ішкі диагностика
тек ішкі диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

Толық ала ішкі диагностика
тек ішкі диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

Годен до: 2025.02
Дейін жарамды: 2025.02

Толық ала ішкі диагностика
тек ішкі диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF В 12.73-1.600

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

Реагент №1: 4 x 68 мл
Реагент №2: 4 x 20 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

LOT

Серия: 0101



Дата выпуска: 2023.04



Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 4 x 68 мл

R2: 4 x 20 мл

Calibrator: 2 x 1,5 мл

LOT

0101



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 56 A-194356
St. Petersburg, Russia

2024.10

EMERGO EUROPE
Prilazhennost 20, 2014 AP
The Netherlands

IVD

ECIREP

KZ НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 68 мл
Реагент №2: 4 x 20 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

Сериясы: 0101
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.10

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

только для in vitro диагностики



CE



12041803400040



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.600

1 68 мл

РЕАГЕНТ

LOT

0101

Годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.600

1 68 мл

РЕАГЕНТ

LOT

0101

Годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.600

1 68 мл

РЕАГЕНТ

LOT

0101

Годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-1.600

1 68 мл

РЕАГЕНТ

LOT

0101

Годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

LOT 0317

Годен до: 2025.02

Дейн жарамды: 2025.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

CE

Vital

Development

CORPORATION

SAINT-PETERSBURG, RUSSIA

194356

DOROGA V KAMENKUYU, DOM 56, LITERA A

2023.04

2024.10

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

REF В 12.713-1.600

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018

Реагент №1: 6 x 68 мл
Реагент №2: 6 x 20 мл
Калибратор: 3 x 1,5 мл

LOT Серия: 0101 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2024.10
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литер А

только для in vitro диагностики

UK URIC ACID-VITAL

R1: 6 x 68 ml

R2: 6 x 20 ml

Calibrator: 3 x 1,5 ml

LOT 0101

2024.10

2024.10

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuki 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

ECIREP

ENISO 13590:2014 AP
The Netherlands

KZ НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-064-94568735-2018
10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 6 x 68 мл
Реагент №2: 6 x 20 мл
Калибратор: 3 x 1,5 мл

Сериясы: 0101
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.10
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-й, литер А

тек in vitro диагностикасына арналған



12041803400040

МК

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.600

1 68 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МК

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.600

1 68 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МК

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.600

1 68 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МК

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.600

1 68 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МК

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.600

1 68 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.713-1.600

1 68 мл

РЕАГЕНТ

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейін жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасына арналған



CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.600
20 МЛ
LOT 0101
ГОДЕН ДО: 2024.10
ДӘЛІЛ ЖАРҒАН: 2024.10
ТӨРКЕ ДА: 10-0101
ТМ 10-0101 ДАЙЫНДАҒАН АРНАҒА
Витал Девелопмент
Корпорациясы, Россия
"Витал Девелопмент"
Корпорациясы" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.600
20 МЛ
LOT 0101
ГОДЕН ДО: 2024.10
ДӘЛІЛ ЖАРҒАН: 2024.10
ТӨРКЕ ДА: 10-0101
ТМ 10-0101 ДАЙЫНДАҒАН АРНАҒА
Витал Девелопмент
Корпорациясы, Россия
"Витал Девелопмент"
Корпорациясы" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.600
20 МЛ
LOT 0101
ГОДЕН ДО: 2024.10
ДӘЛІЛ ЖАРҒАН: 2024.10
ТӨРКЕ ДА: 10-0101
ТМ 10-0101 ДАЙЫНДАҒАН АРНАҒА
Витал Девелопмент
Корпорациясы, Россия
"Витал Девелопмент"
Корпорациясы" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.600
20 МЛ
LOT 0101
ГОДЕН ДО: 2024.10
ДӘЛІЛ ЖАРҒАН: 2024.10
ТӨРКЕ ДА: 10-0101
ТМ 10-0101 ДАЙЫНДАҒАН АРНАҒА
Витал Девелопмент
Корпорациясы, Россия
"Витал Девелопмент"
Корпорациясы" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.600
20 МЛ
LOT 0101
ГОДЕН ДО: 2024.10
ДӘЛІЛ ЖАРҒАН: 2024.10
ТӨРКЕ ДА: 10-0101
ТМ 10-0101 ДАЙЫНДАҒАН АРНАҒА
Витал Девелопмент
Корпорациясы, Россия
"Витал Девелопмент"
Корпорациясы" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.713-1.600
20 МЛ
LOT 0101
ГОДЕН ДО: 2024.10
ДӘЛІЛ ЖАРҒАН: 2024.10
ТӨРКЕ ДА: 10-0101
ТМ 10-0101 ДАЙЫНДАҒАН АРНАҒА
Витал Девелопмент
Корпорациясы, Россия
"Витал Девелопмент"
Корпорациясы" АҚ Ресей

КАЛИБРАТОР
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
1,5 МЛ
367 МИКОМЛ/Л
LOT 0317
ГОДЕН ДО: 2025.02
ДӘЛІЛ ЖАРҒАН: 2025.02
ТӨРКЕ ДА: 10-0317
ТМ 10-0317 ДАЙЫНДАҒАН АРНАҒА
Витал Девелопмент
Корпорациясы, Россия
"Витал Девелопмент"
Корпорациясы" АҚ Ресей

КАЛИБРАТОР
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
1,5 МЛ
367 МИКОМЛ/Л
LOT 0317
ГОДЕН ДО: 2025.02
ДӘЛІЛ ЖАРҒАН: 2025.02
ТӨРКЕ ДА: 10-0317
ТМ 10-0317 ДАЙЫНДАҒАН АРНАҒА
Витал Девелопмент
Корпорациясы, Россия
"Витал Девелопмент"
Корпорациясы" АҚ Ресей

КАЛИБРАТОР
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
1,5 МЛ
367 МИКОМЛ/Л
LOT 0317
ГОДЕН ДО: 2025.02
ДӘЛІЛ ЖАРҒАН: 2025.02
ТӨРКЕ ДА: 10-0317
ТМ 10-0317 ДАЙЫНДАҒАН АРНАҒА
Витал Девелопмент
Корпорациясы, Россия
"Витал Девелопмент"
Корпорациясы" АҚ Ресей


REF В 12.73-2.200

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочево-
й кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче
энзиматическим колориметрическим методом

Реагент №1: 4 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 20 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.



LOT Серия: 0101 Дата выпуска: 2023.04 Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литер А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 4 x 40 мл
R2: 2 x 20 мл
Calibrator: 2 x 1,5 мл

LOT 0101
2024.10

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

EC REP

KZ НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-064-94568735-2018
10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының
концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен
анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 4 x 40 мл
Реагент №2 : 2 x 20 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

Сериясы: 0101
Шығарылған күні: 2023.04
Дейін жарамды: 2024.10

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-й, литер А

тек in vitro диагностикасына арналған



97202207130092



МК 1

МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-2.200

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-2.200

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МК 1

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-2.200

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

REF В 12.73-2.200

РЕАГЕНТ 1 40 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.73-2.200

РЕАГЕНТ 2 20 мл



LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
REF В 12.73-2.200

РЕАГЕНТ 2 20 мл



LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

CE

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
1,5 мл
357 мкмоль/л
LOT 0317
годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
1,5 мл
357 мкмоль/л
LOT 0317
годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасына арналған

REF В 12.73-2.300

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018
РЗН 2018/7862 от 10.12.2018 г.

Реагент №1: 6 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 32 мл
Калибратор: 2 x 1,5 мл

LOT Серия: 0101



Дата выпуска: 2023.04

Годен до: 2024.10

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK URIC ACID-VITAL

R1: 6 x 40 ml

R2: 2 x 32 ml

Calibrator: 2 x 1,5 ml

LOT 0101



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2024.10

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands

IVD

EC REP

KZ НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-064-94568735-2018

10.12.2018 ж. РЗН 2018/7862

Қан сарысуындағы (плазмадағы) және несептегі несеп қышқылының концентрациясын бойынша энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 6 x 40 мл

Реагент №2 : 2 x 32 мл

Калибратор: 2 x 1,5 мл

Сериясы: 0101

Шығарылған күні: 2023.04

Дейін жарамды: 2024.10

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

только для in vitro диагностики



12041803400040



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.73-2.300

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
только для диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.73-2.300

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
только для диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.73-2.300

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
только для диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.73-2.300

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
только для диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.73-2.300

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
только для диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.73-2.300

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
только для диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
1,5 мл
357 мкмоль/л
LOT 0317
годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02
только для in vitro диагностики
только для диагностики

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ
1,5 мл
357 мкмоль/л
LOT 0317
годен до: 2025.02
Дейн жарамды: 2025.02
только для in vitro диагностики
только для диагностики

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.73-2.300

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 2 32 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
только для диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ REF В 12.73-2.300

НЕСЕП ҚЫШҚЫЛЫ-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 2 32 мл

LOT 0101

годен до: 2024.10
Дейн жарамды: 2024.10

только для in vitro диагностики
только для диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 2 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.





«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов










2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ



**Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты
в сыворотке (плазме) крови и моче
энзиматическим колориметрическим методом
«МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-064-94568735-2018**

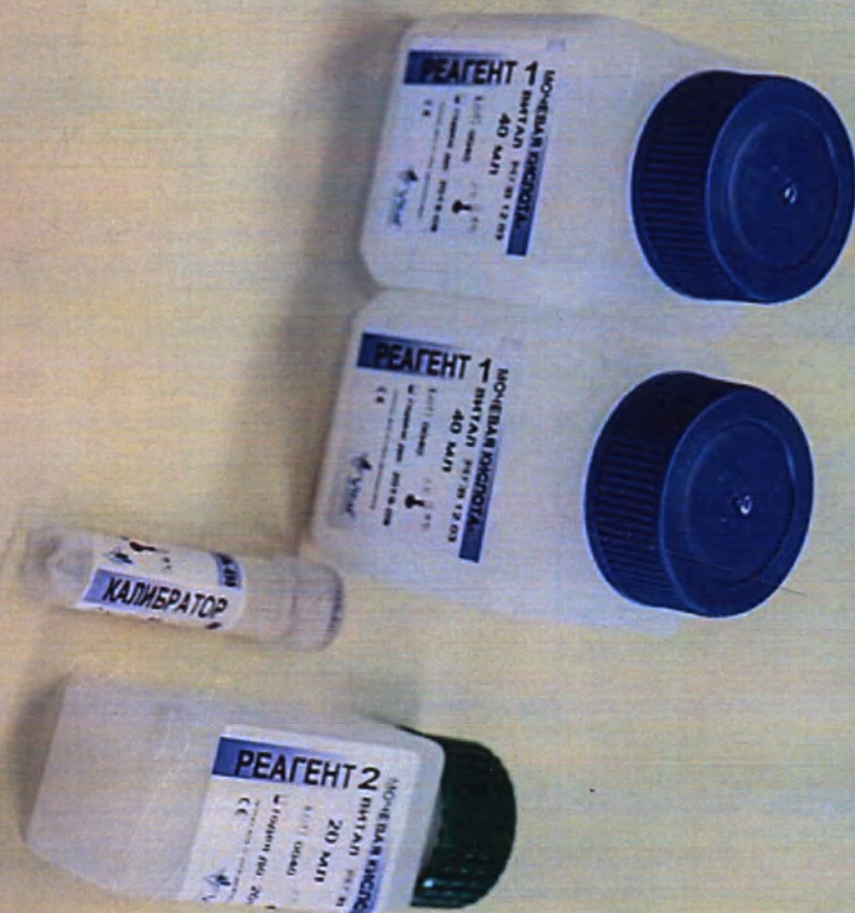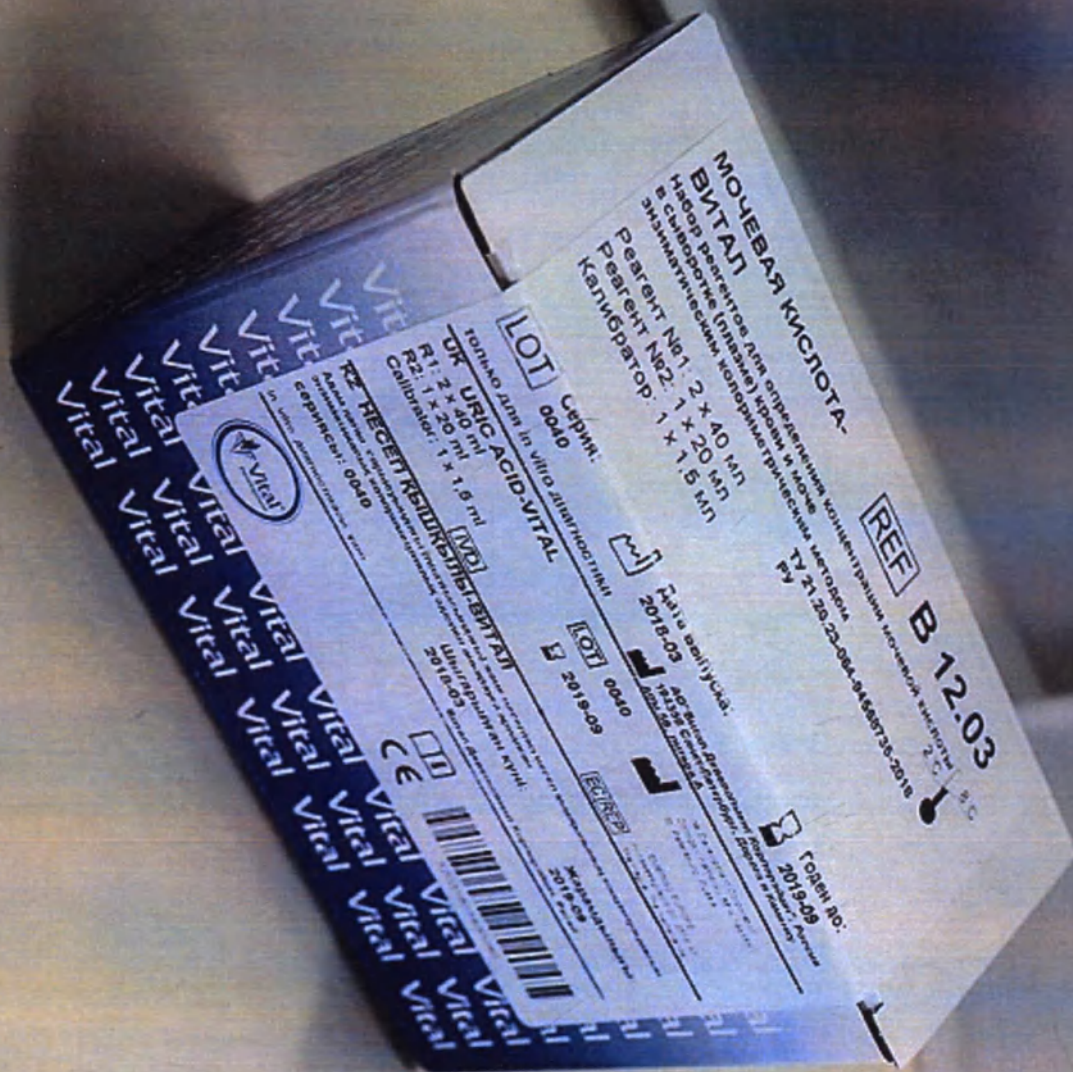

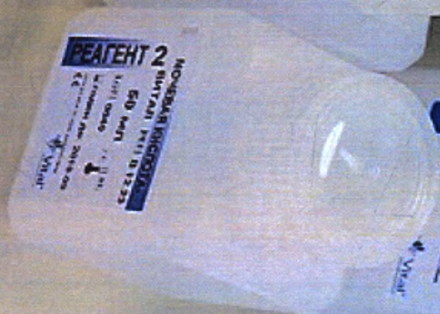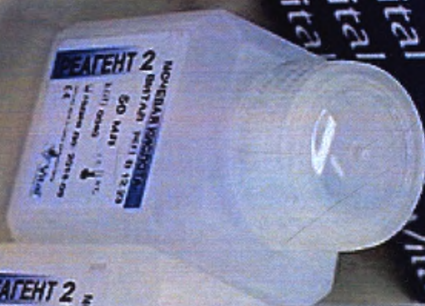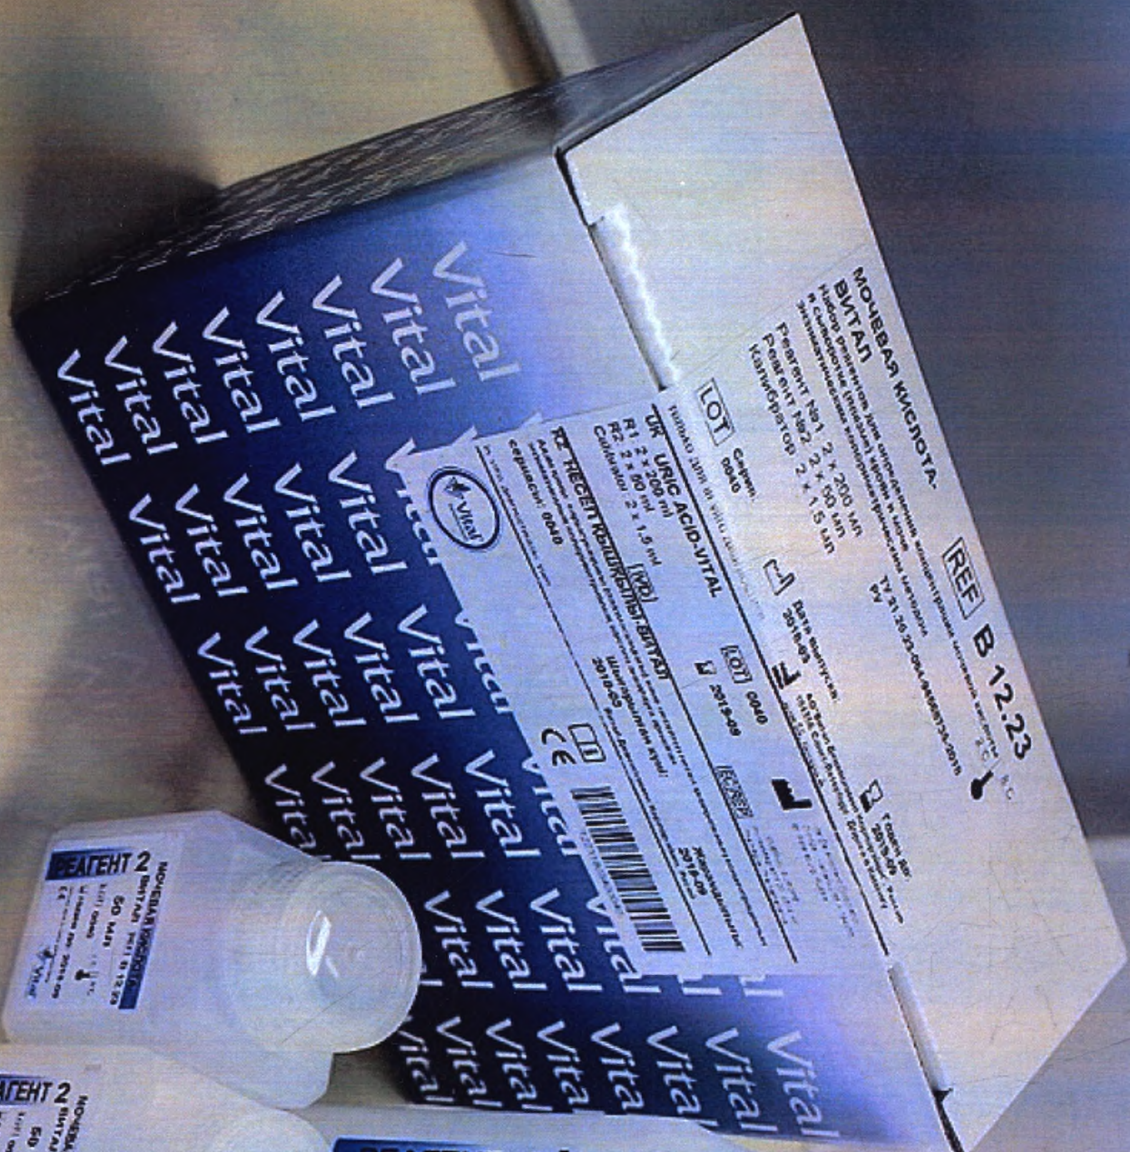


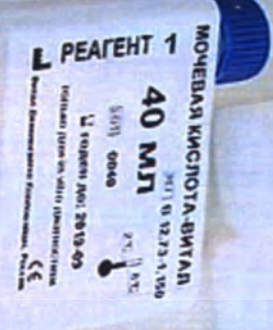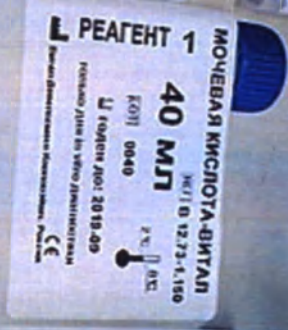
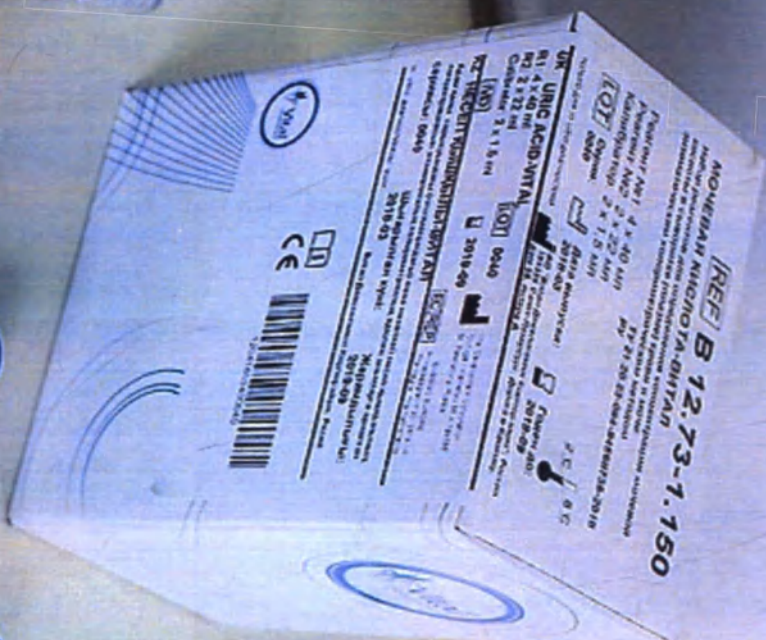


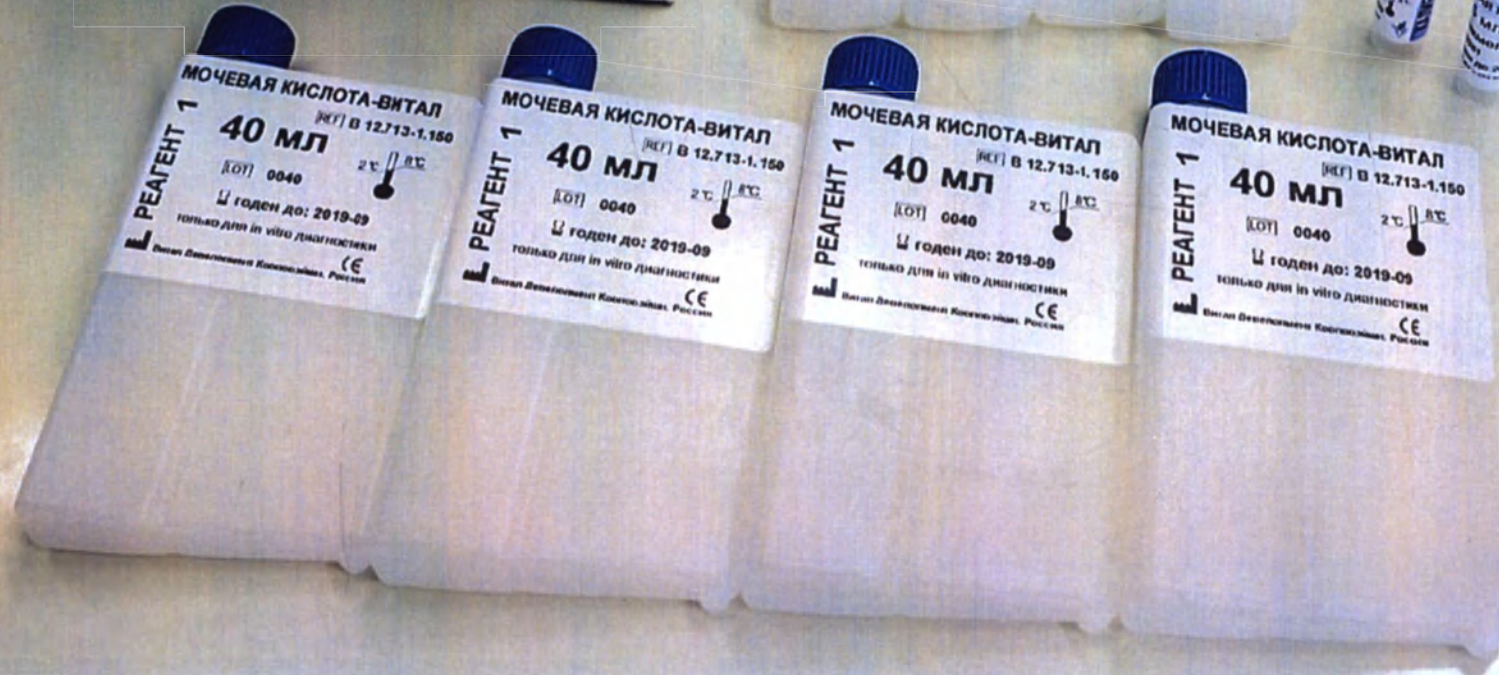

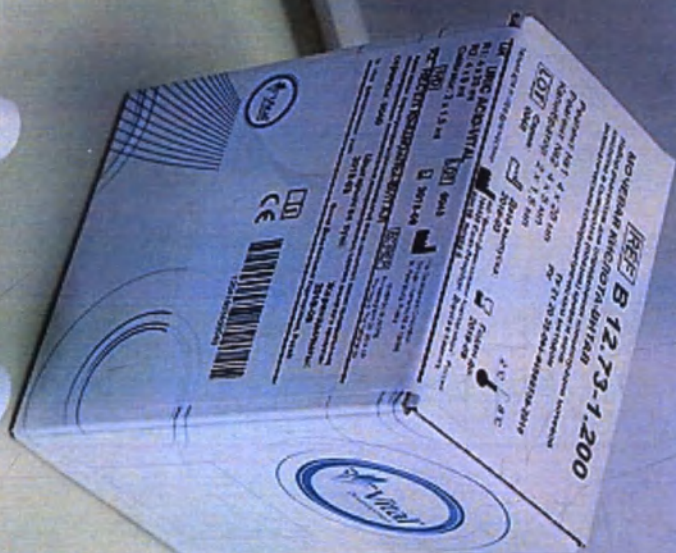

8

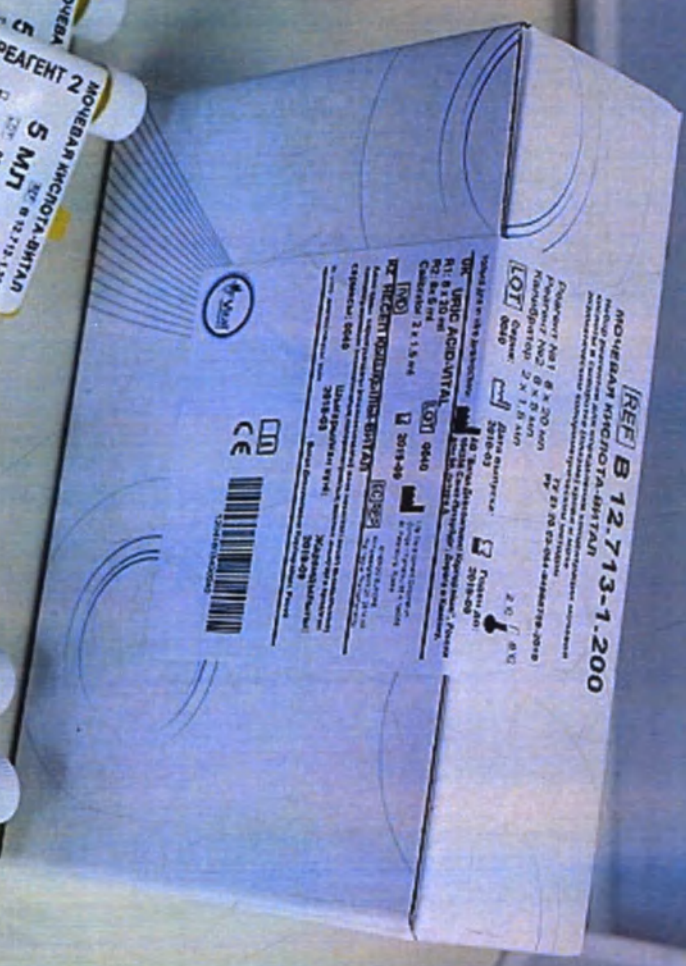

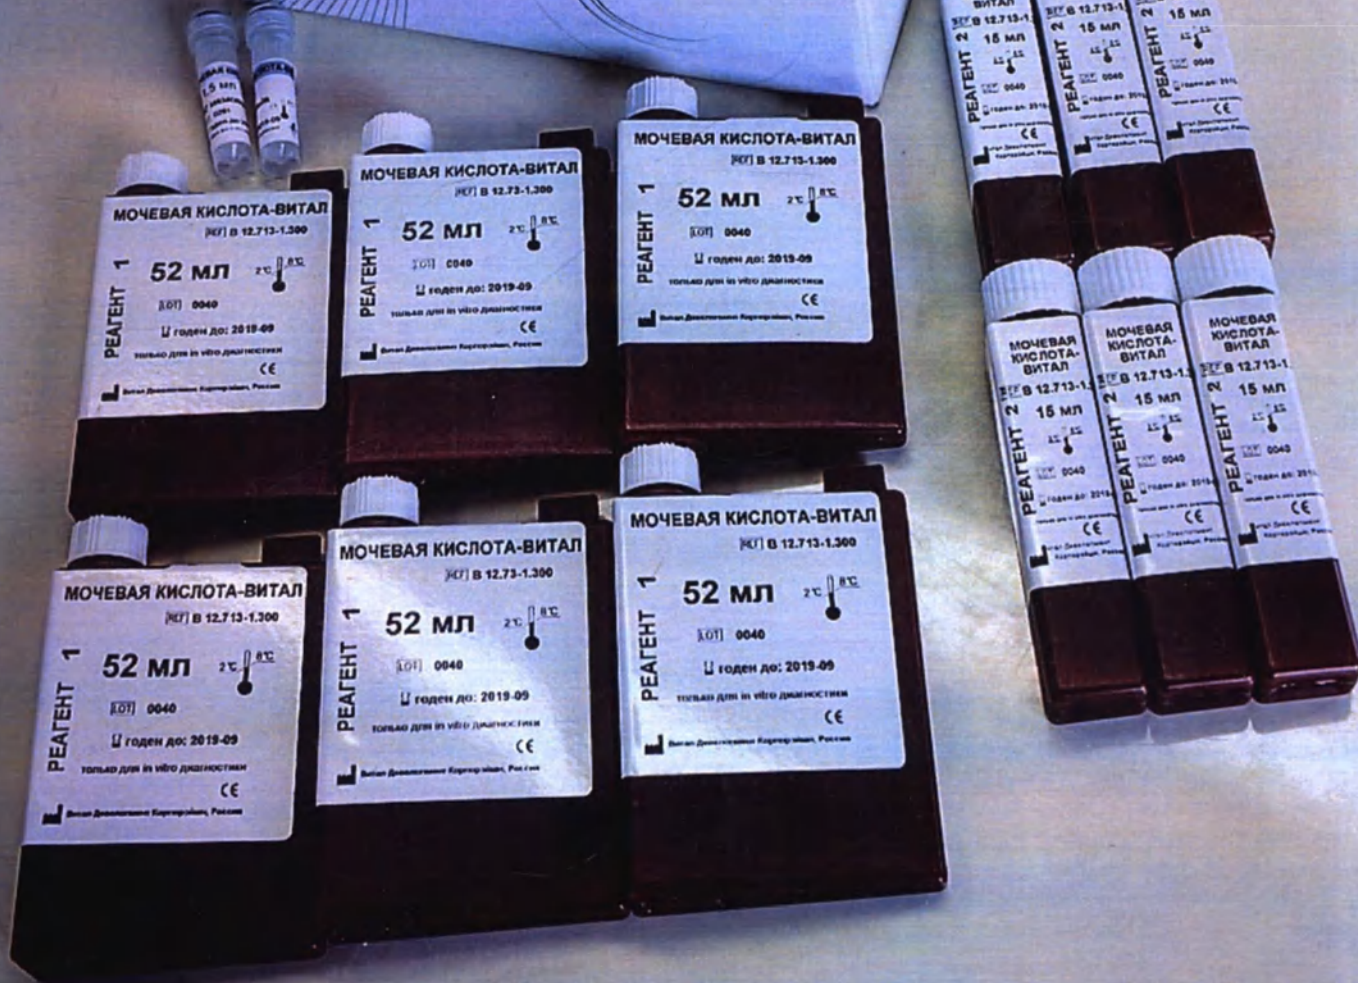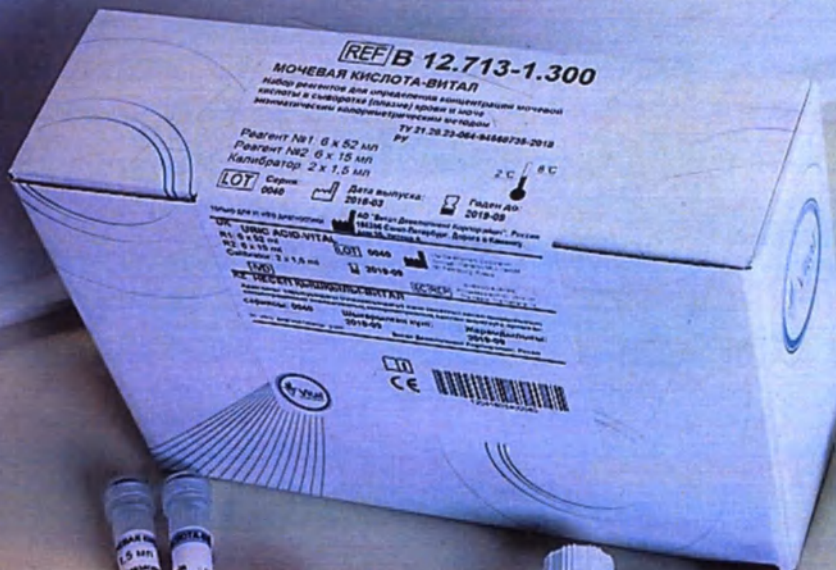

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
REF B 12.73-1.420
РЕАГЕНТ
72 МЛ
LOT 0040
Упаковка: 2019-09
Исходный код: 2019-09
CE

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
REF B 12.73-1.420
РЕАГЕНТ
72 МЛ
LOT 0040
Упаковка: 2019-09
Исходный код: 2019-09
CE

REF B 12.73-1.420
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
Модуль реагентов для определения мочевины и креатинина (глюкоза) методом диффузии в мембране с использованием оптического измерения
ТВ 21 20-06-9458735-2018
РЕАГЕНТ №1: 2 x 72 мл
РЕАГЕНТ №2: 2 x 20 мл
КОМПОНЕНТ: 2 x 1,5 мл
LOT 0040
Дата выпуска: 2019-09
Годен до: 2019-09
Упаковка: 2019-09
Исходный код: 2019-09
CE


РЕАГЕНТ 2
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
REF B 12.73-1.420
20 МЛ
LOT 0040
Упаковка: 2019-09
Исходный код: 2019-09
CE

РЕАГЕНТ 2
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
REF B 12.73-1.420
20 МЛ
LOT 0040
Упаковка: 2019-09
Исходный код: 2019-09
CE

КАЛИБРАТОР
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ
1,5 мл
257
LOT 0040
Упаковка: 2019-09
Исходный код: 2019-09
CE

[illegible][illegible]

3

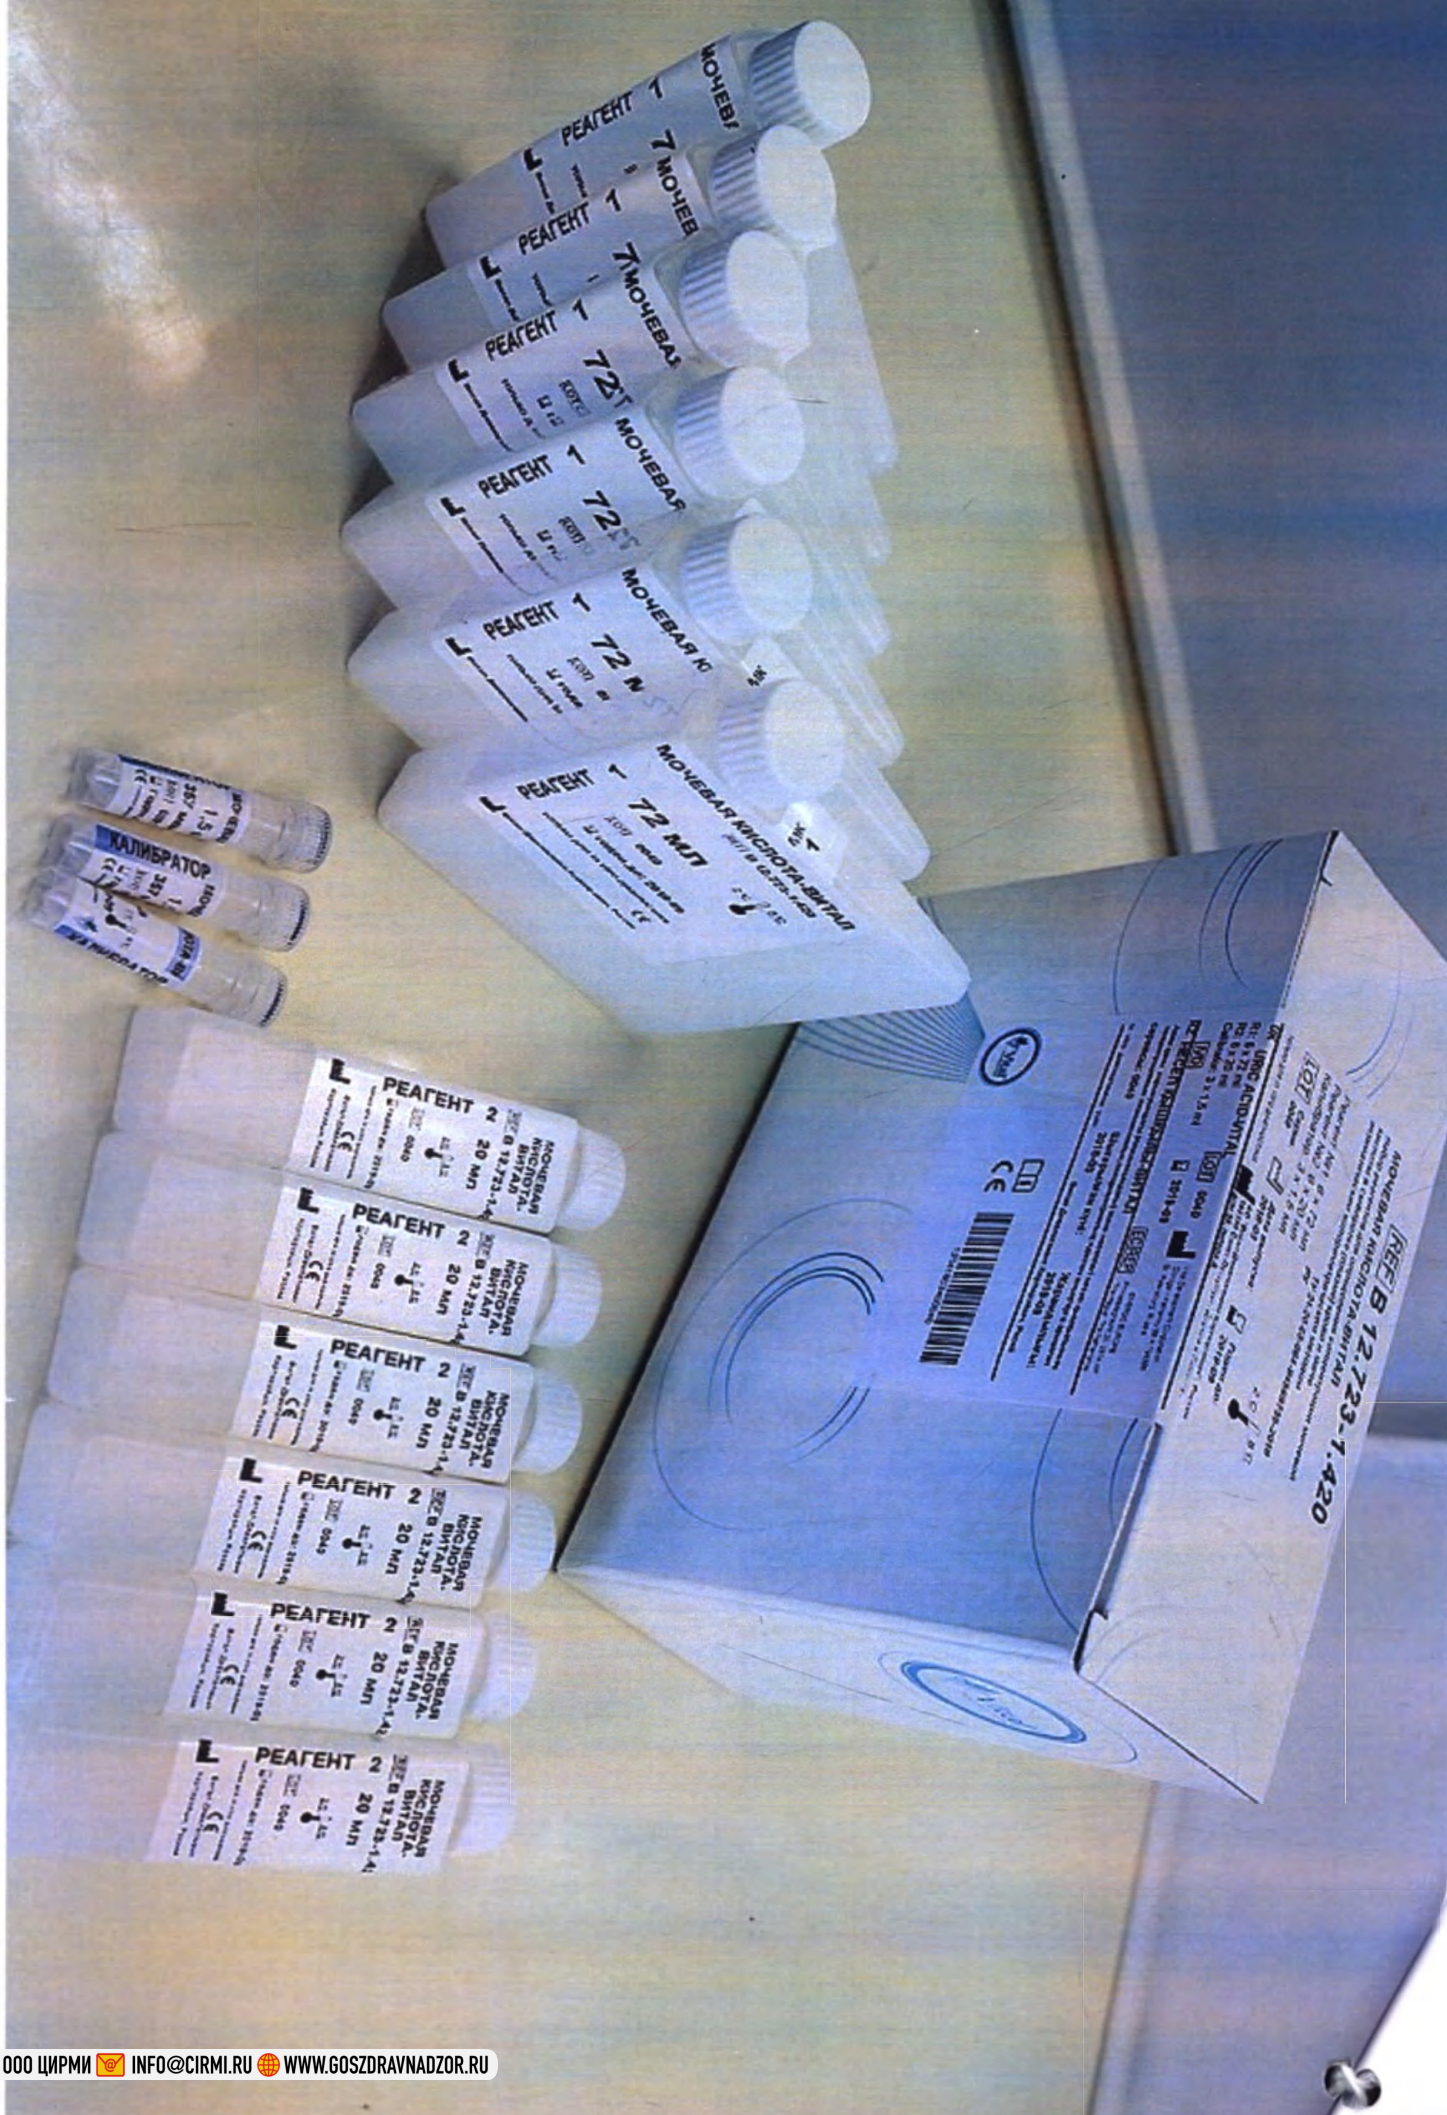

REF B 12.73-1.600

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Реагент №1 4 x 60 мл
Реагент №2 4 x 20 мл
Калибратор 2 x 1,5 мл

LOT 0040

Дата выпуска: 2018-03

Гарантия: 2019-09

УК: UNIC ACID-VITAL

Р1: 4.15.15.15.15

Р2: 4.1.20.15.15

Calibrator: 2 x 1,5 ml

Срок годности: 2018-05

Место производства: Россия

CE

LOT 0040

2018-09

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Реагент №1 4 x 60 мл

Реагент №2 4 x 20 мл

Калибратор 2 x 1,5 мл

LOT 0040

Дата выпуска: 2018-03

Гарантия: 2019-09

УК: UNIC ACID-VITAL

Р1: 4.15.15.15.15

Р2: 4.1.20.15.15

Calibrator: 2 x 1,5 ml

Срок годности: 2018-05

Место производства: Россия

CE

LOT 0040

2018-09

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Реагент №1 4 x 60 мл

Реагент №2 4 x 20 мл

Калибратор 2 x 1,5 мл

LOT 0040

Дата выпуска: 2018-03

Гарантия: 2019-09

REF B 12.73-1.600

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Реагент №1 4 x 60 мл

Реагент №2 4 x 20 мл

Калибратор 2 x 1,5 мл

LOT 0040

Дата выпуска: 2018-03

Гарантия: 2019-09

УК: UNIC ACID-VITAL

Р1: 4.15.15.15.15

Р2: 4.1.20.15.15

Calibrator: 2 x 1,5 ml

Срок годности: 2018-05

Место производства: Россия

CE

LOT 0040

2018-09

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Реагент №1 4 x 60 мл

Реагент №2 4 x 20 мл

Калибратор 2 x 1,5 мл

LOT 0040

Дата выпуска: 2018-03

Гарантия: 2019-09

УК: UNIC ACID-VITAL

Р1: 4.15.15.15.15

Р2: 4.1.20.15.15

Calibrator: 2 x 1,5 ml

Срок годности: 2018-05

Место производства: Россия

CE

LOT 0040

2018-09




МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

Реагент №1 4 x 60 мл

Реагент №2 4 x 20 мл

Калибратор 2 x 1,5 мл

LOT 0040

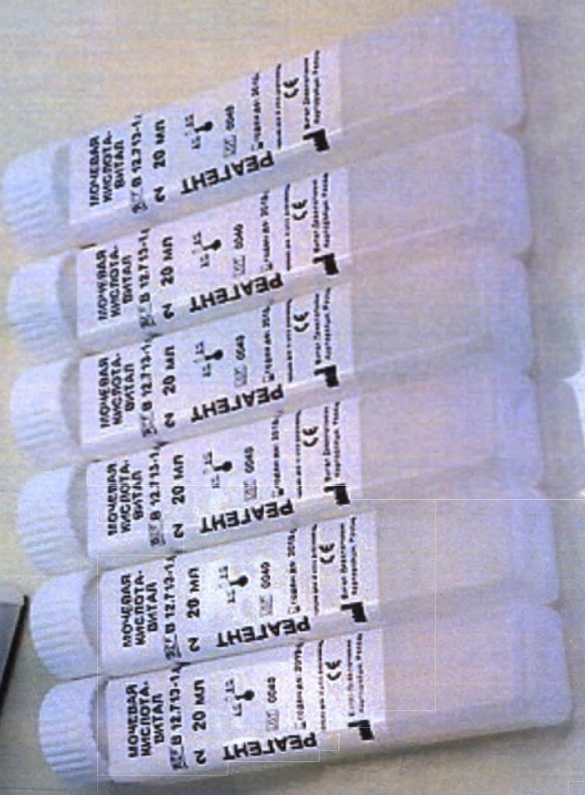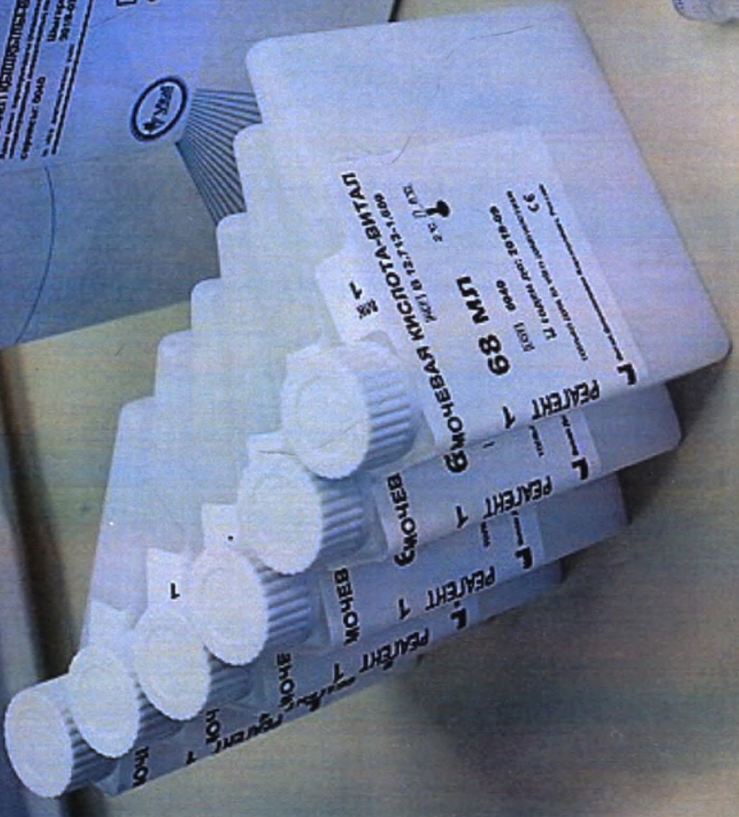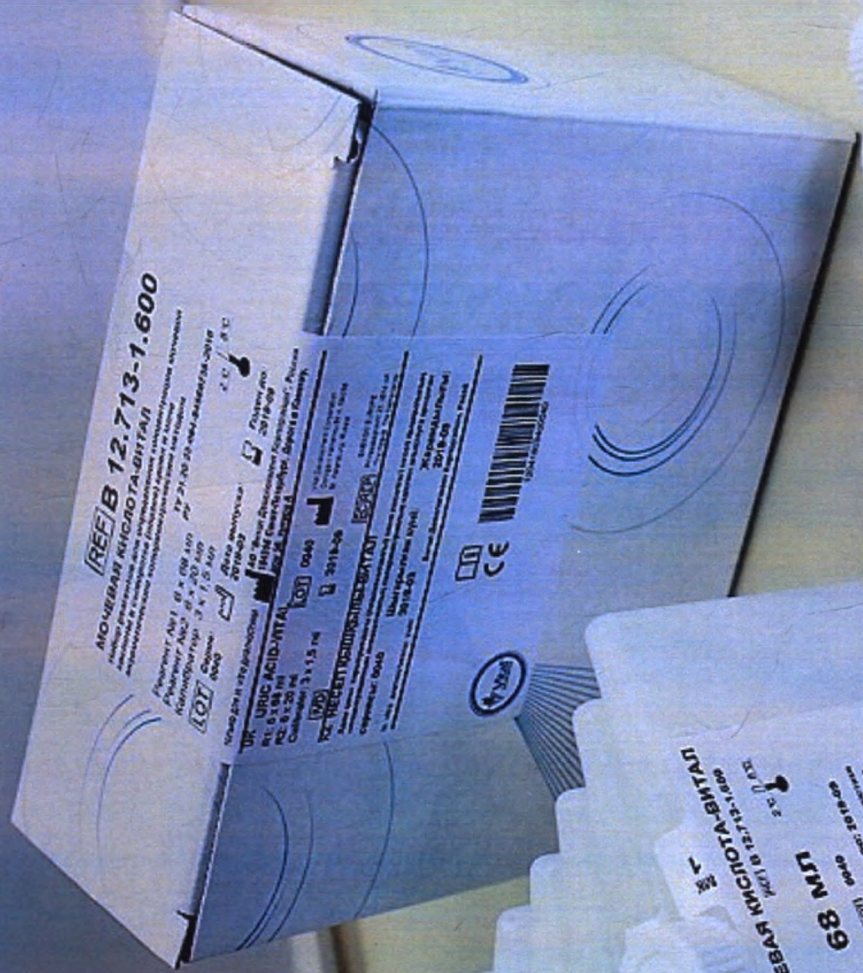





**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



Всего

14

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.