


ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Трейдомед Инвест»



Сутягин С.А.
2018 г.

**Фотографические изображения
на медицинское изделие**
«Система лазерная офтальмологическая Cuslo G6 с принадлежностями»

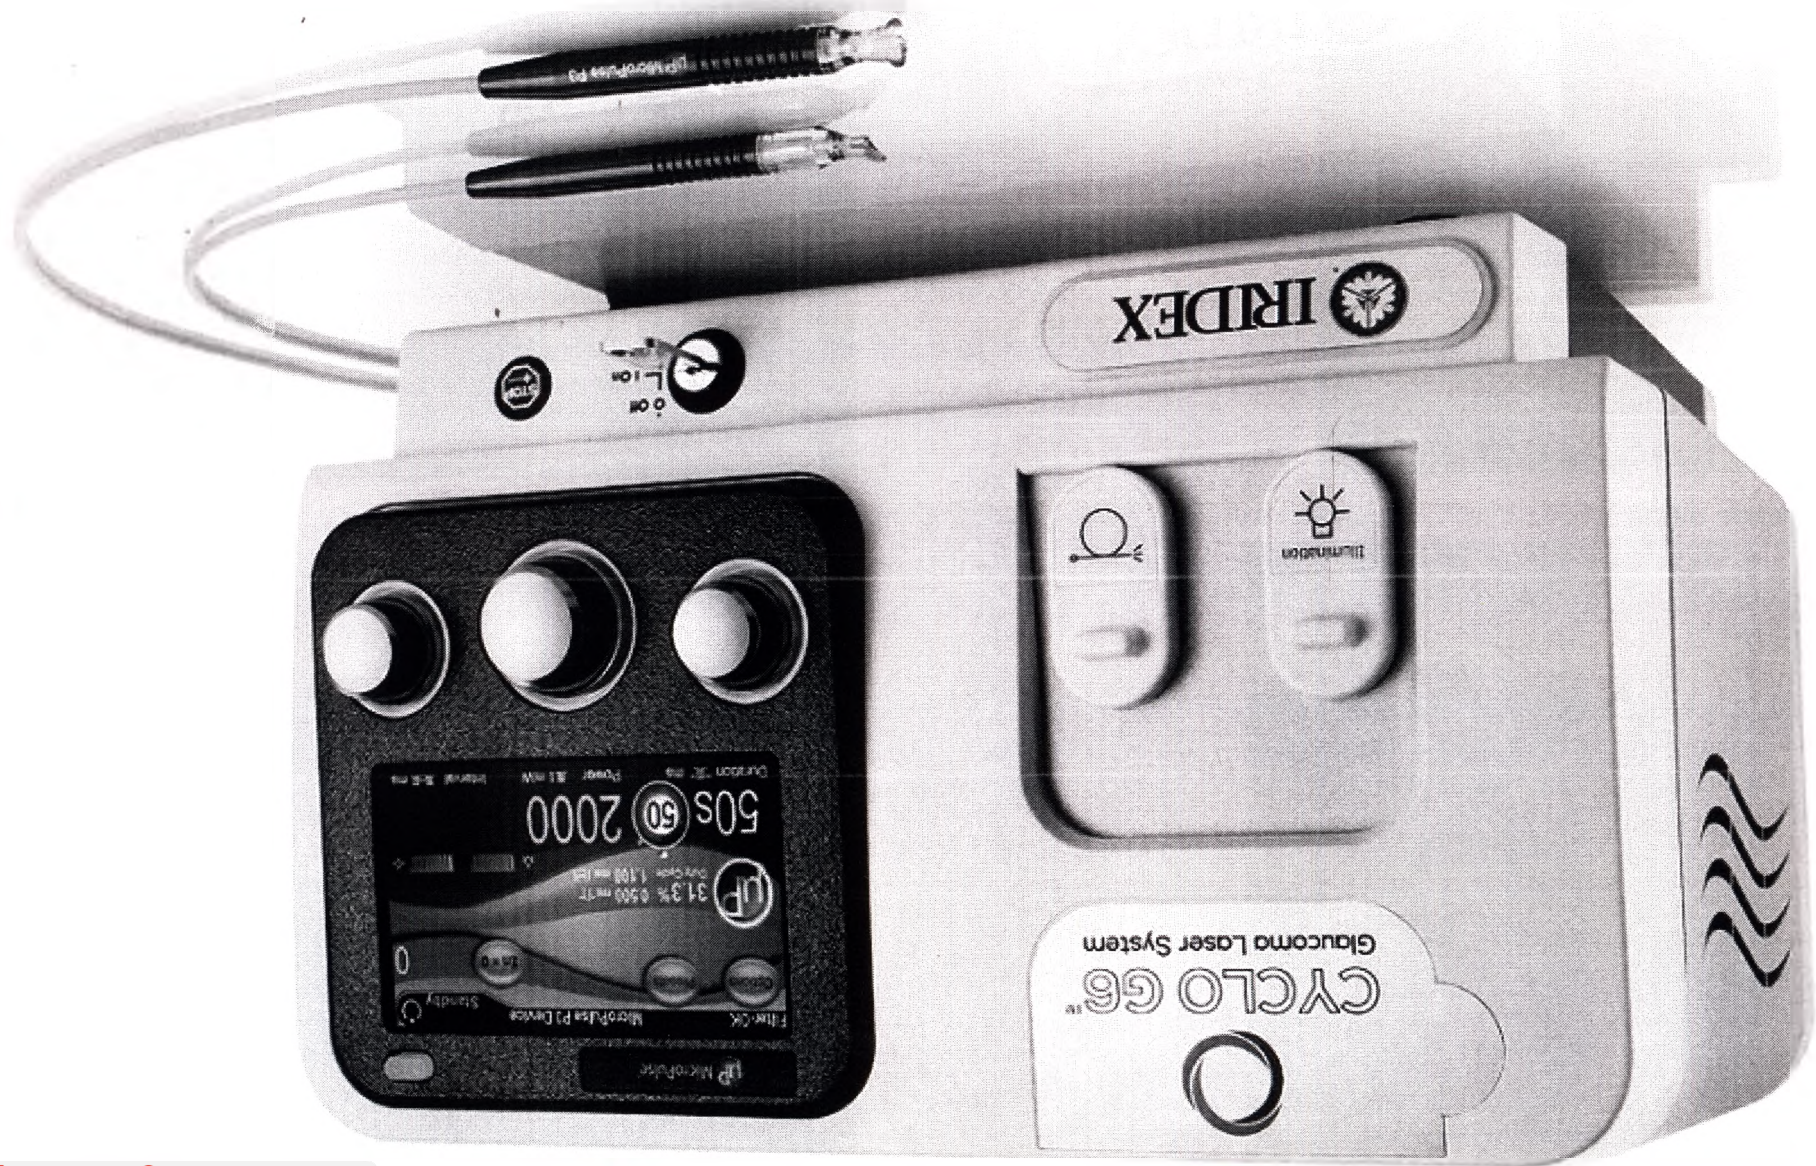



2. Сетевой кабель питания.




3. Ключи включения/выключения – 2 шт.




5. Знак лазерной опасности.




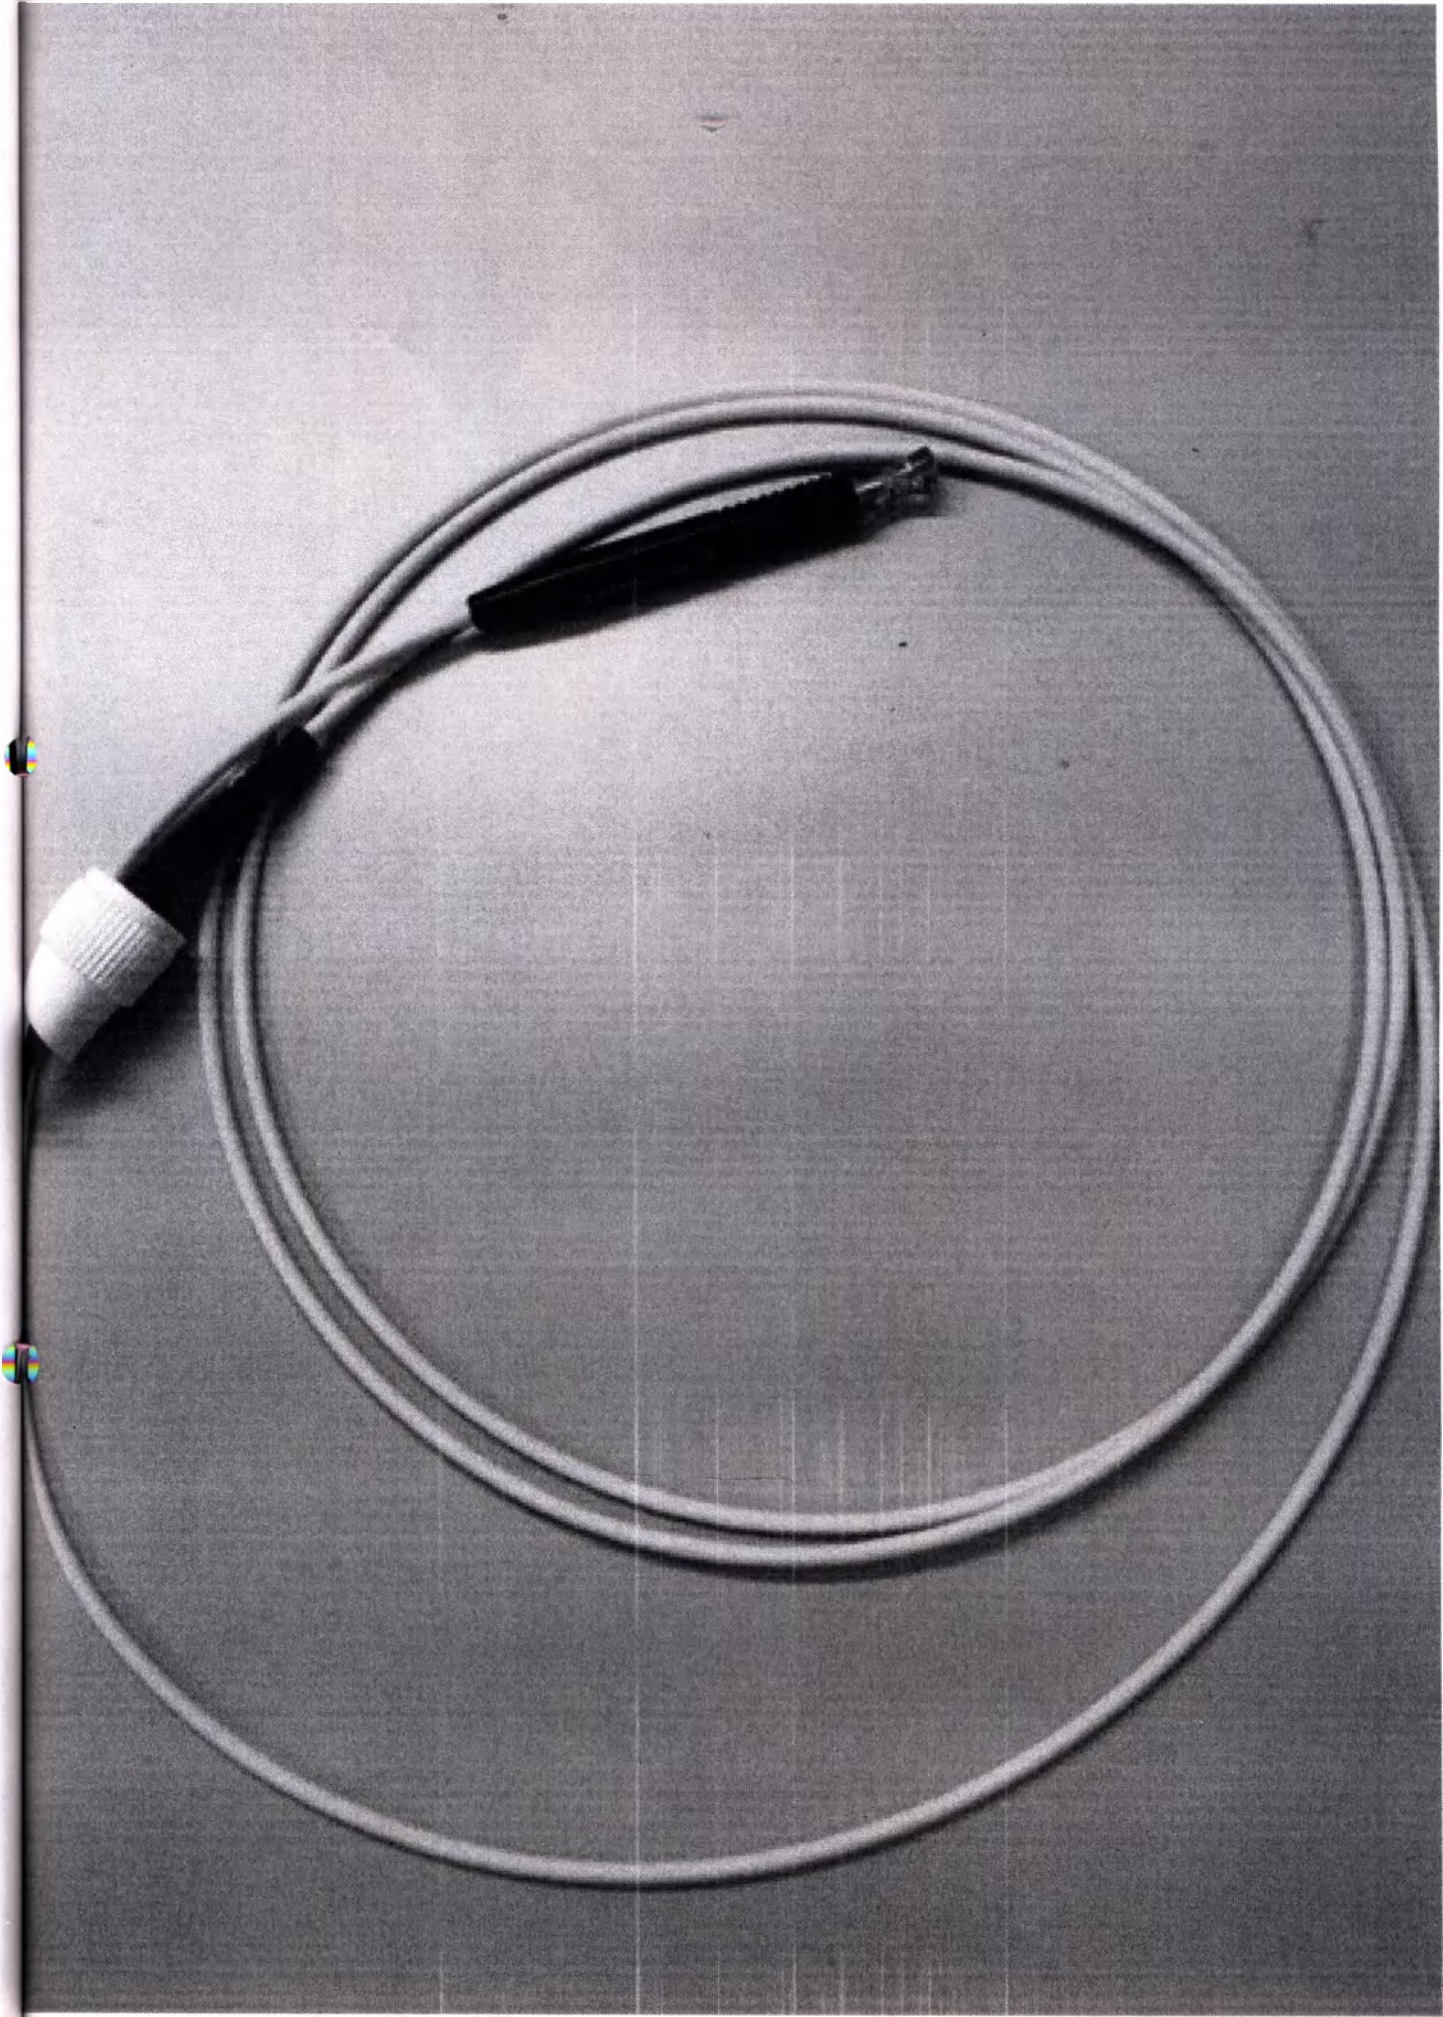







7. Зонд одноразовый MicroPulse P3, 6 шт./уп. (при необходимости).

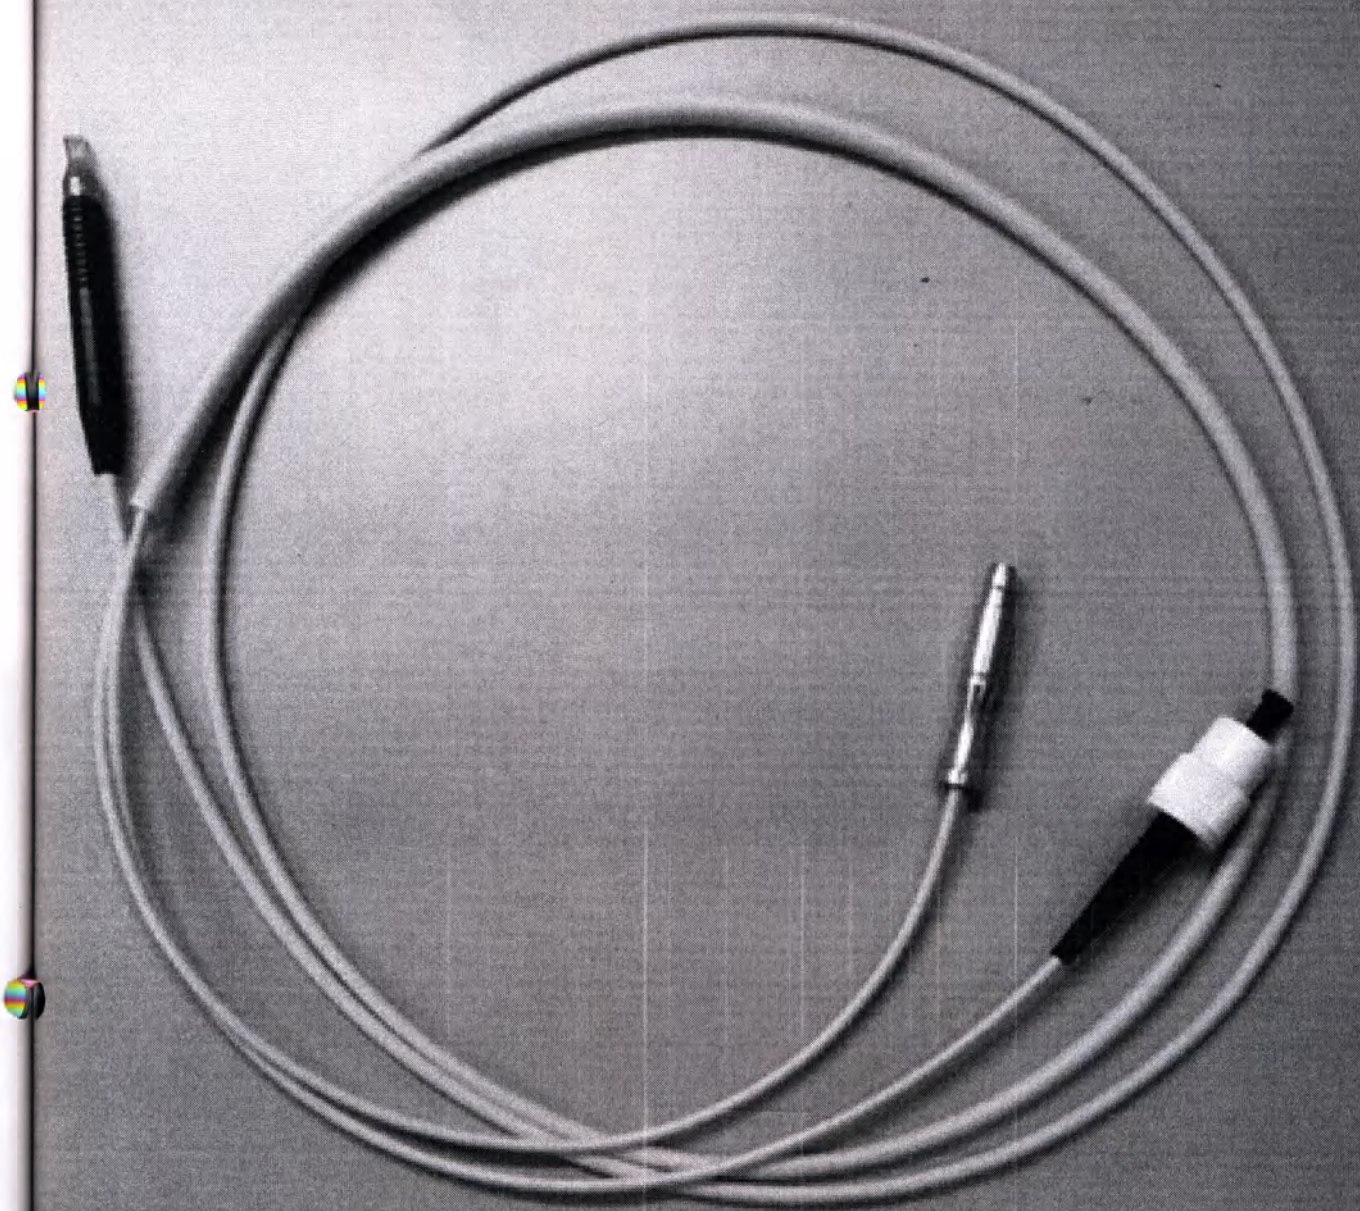


8. Зонд одноразовый G-Probe с освещением, 6 шт./уп. (при необходимости).

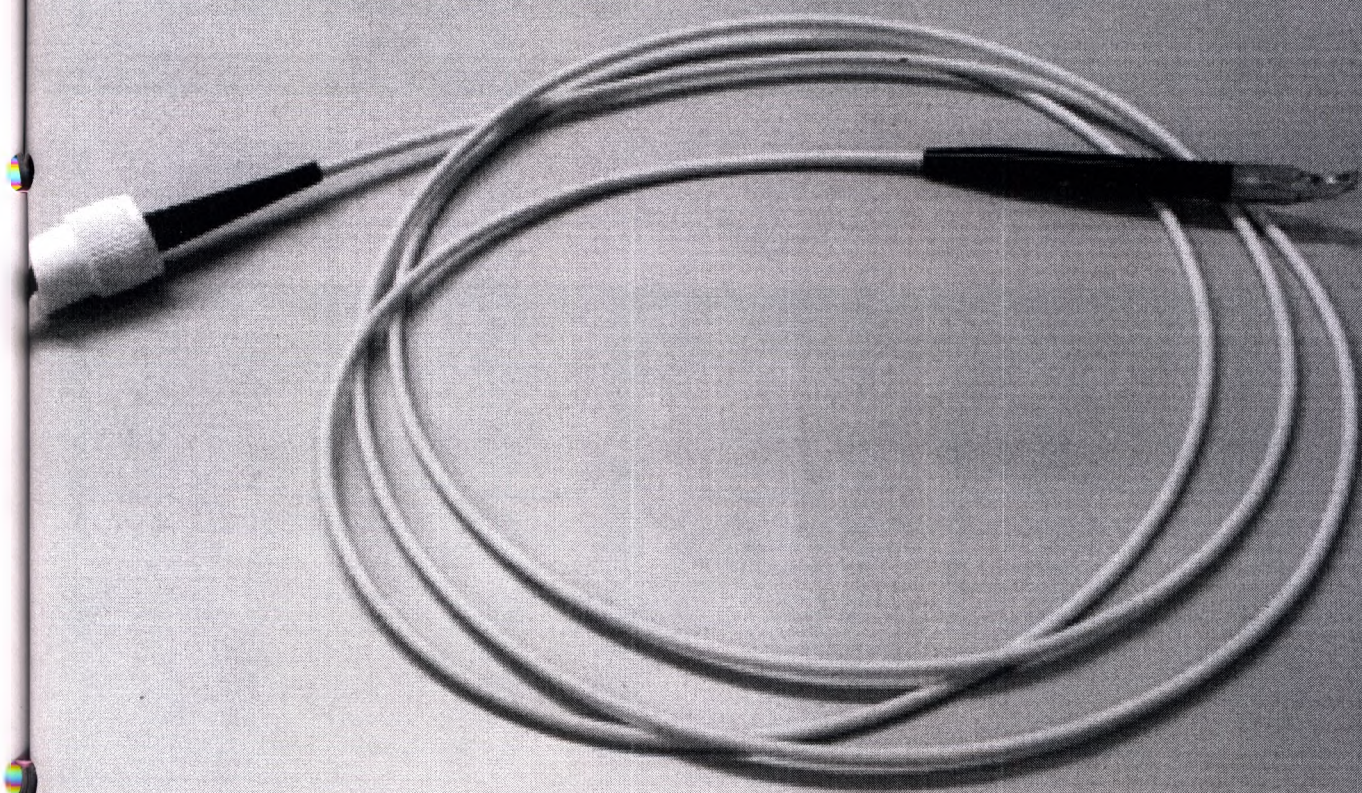


9. Зонд одноразовый G-Probe RFID. 6 шт./уп. (при необходимости).

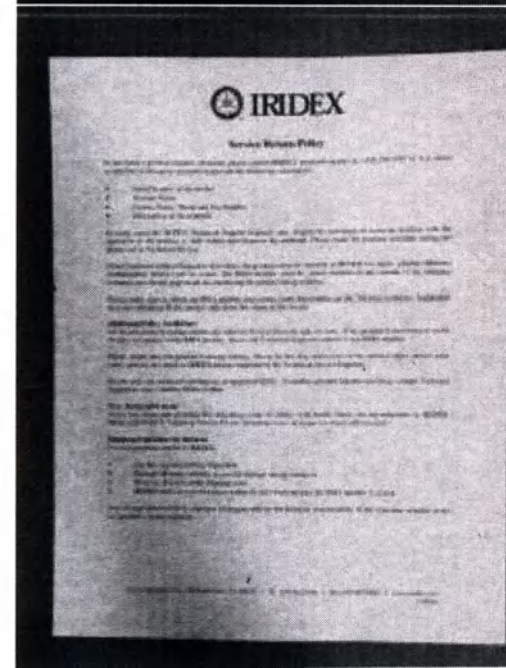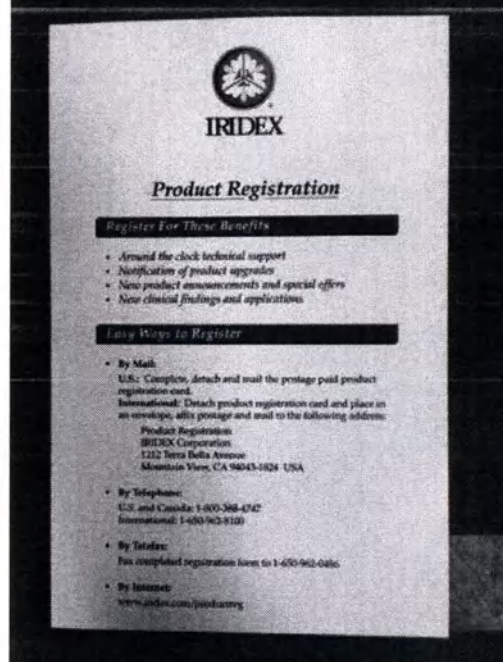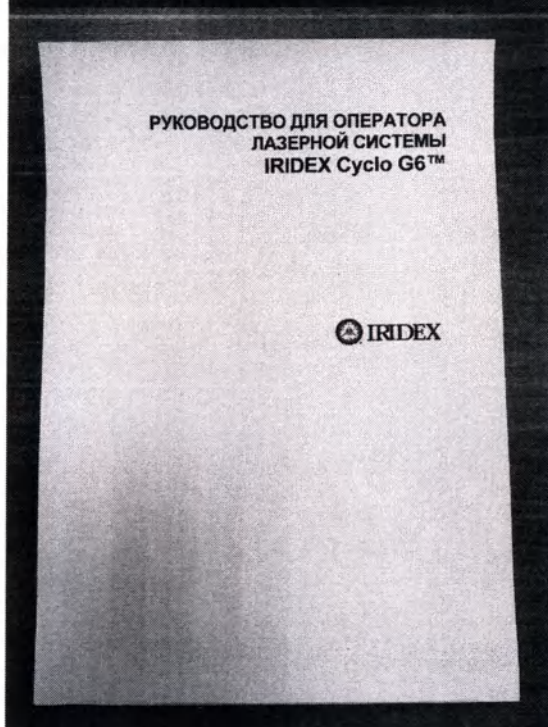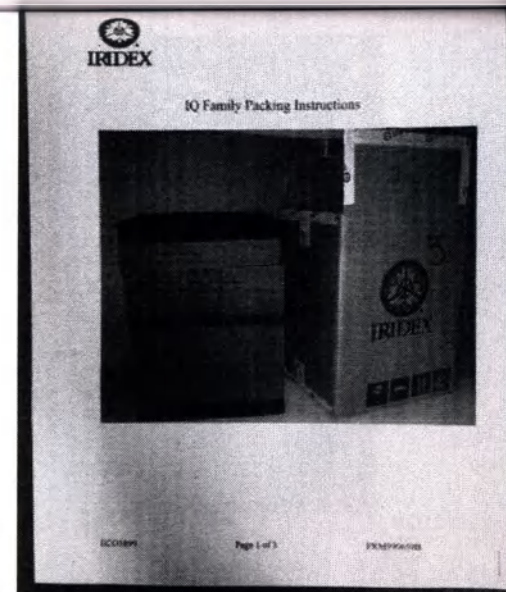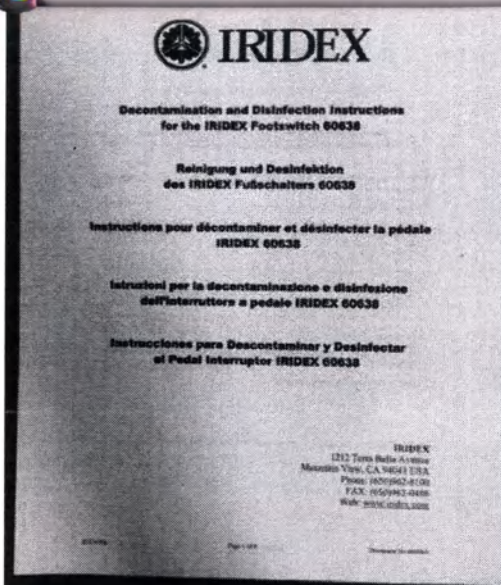
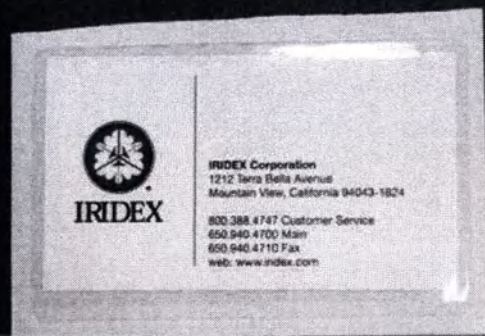


10. Руководство для оператора на бумажном 11. Комплект сопроводительной документации на бумажном носителе и/или на CD диске.

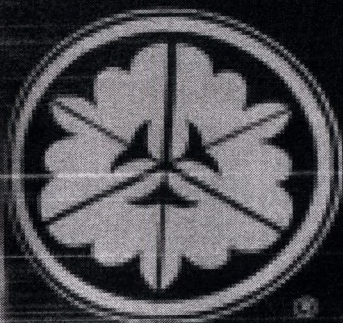

IRIDEX

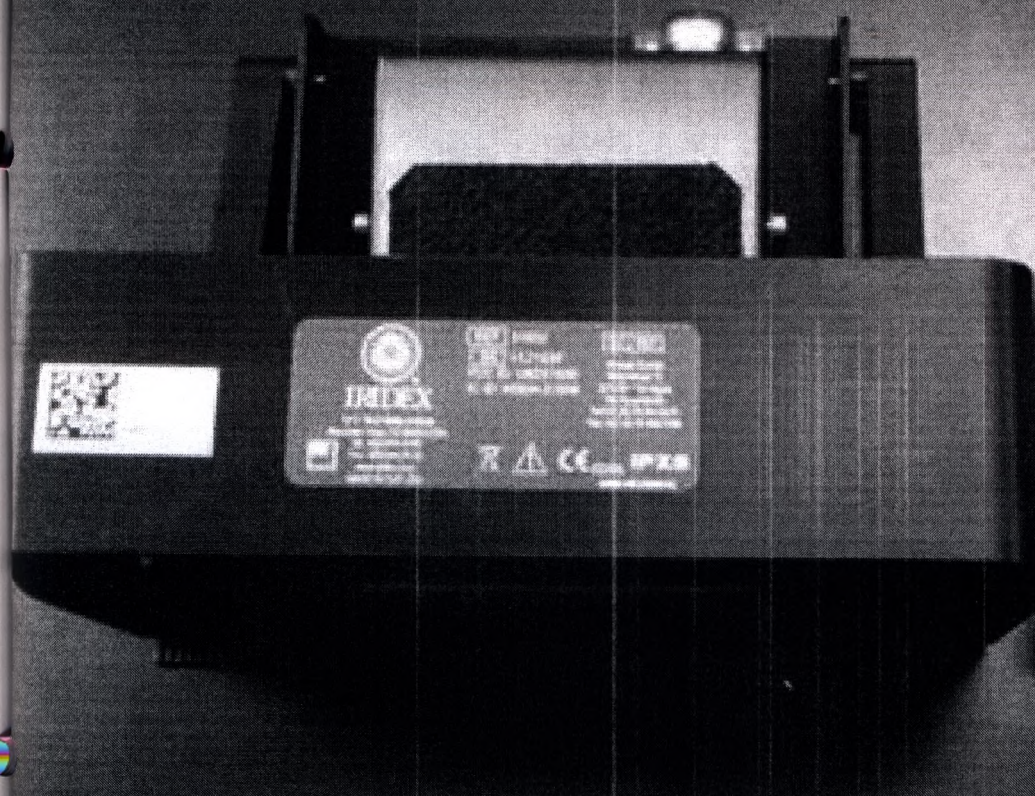

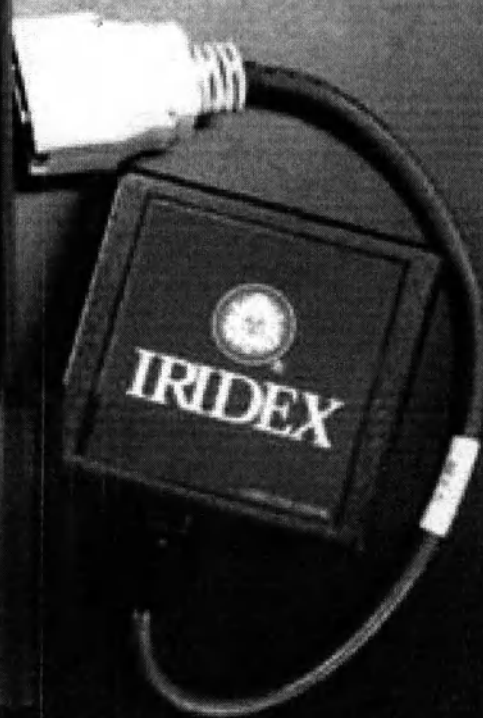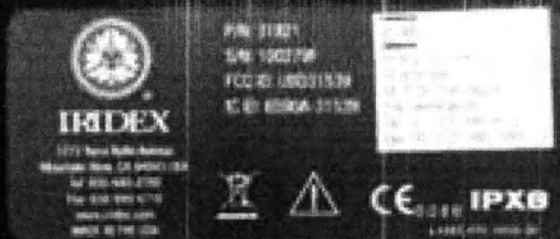

11 листов

