

ООО «Смит энд Нефью»

Юр.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнический пер, 1
эт.9, пом.1, комн.1

Почт.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнический пер, 1

Т: + 7 495 755 55 03
www.smith-nephew.com
info.russia@smith-nephew.com

SmithNephew

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела регистрации и качества
ООО «Смит энд Нефью»
Дихаев Д. Н.



2021 г.

Фотографические изображения упаковки и макета маркировки медицинского
изделия
«Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся»

Smith & Nephew LLC

Legal address: 1, 2nd Syromyatnichesky Lane, 9 floor, prem.1, room 1, Moscow, 105120, Russia
Post address: 1, 2nd Syromyatnichesky Lane, Moscow, 105120, Russia

Артикул: 72203704

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор HEALICOIL REGENESORB 4.75 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2
(голубая и бело-голубая)

Размер: 4,75 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman
Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г.

Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



[illegible]

Артикул: 72203705

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор HEALICOIL REGENESORB 4.75 мм с 1 лентой ULTRATAPE (голубая) и
1 нитью ULTRABRAID #2 (черно-белая)

Размер: 4,75 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.



Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman
Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г.

Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить

Рис. 3. Фиксатор HEALICOIL REGENESORB 4.75 мм с 1 лентой ULTRATAPE (бело-голубая) и 1 нитью ULTRABRAID #2 (голубая)



Артикул: 72203697

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор HEALICOIL REGENESORB 4.75 мм с 1 лентой ULTRATAPE (бело-
голубая) и 1 нитью ULTRABRAID #2 (голубая)

Размер: 4,75 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - $965,2 \pm 12,7$ мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman
Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г.
Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от $+0^{\circ}\text{C}$ до $+32^{\circ}\text{C}$

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



Рис. 4. Фиксатор HEALICOIL REGENESORB 5.5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (голубая и бело-голубая)



Артикул: 72203706

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор HEALICOIL REGENESORB 5.5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2
(голубая и бело-голубая)

Размер: 5,5 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - $965,2 \pm 12,7$ мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г.

Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию


Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



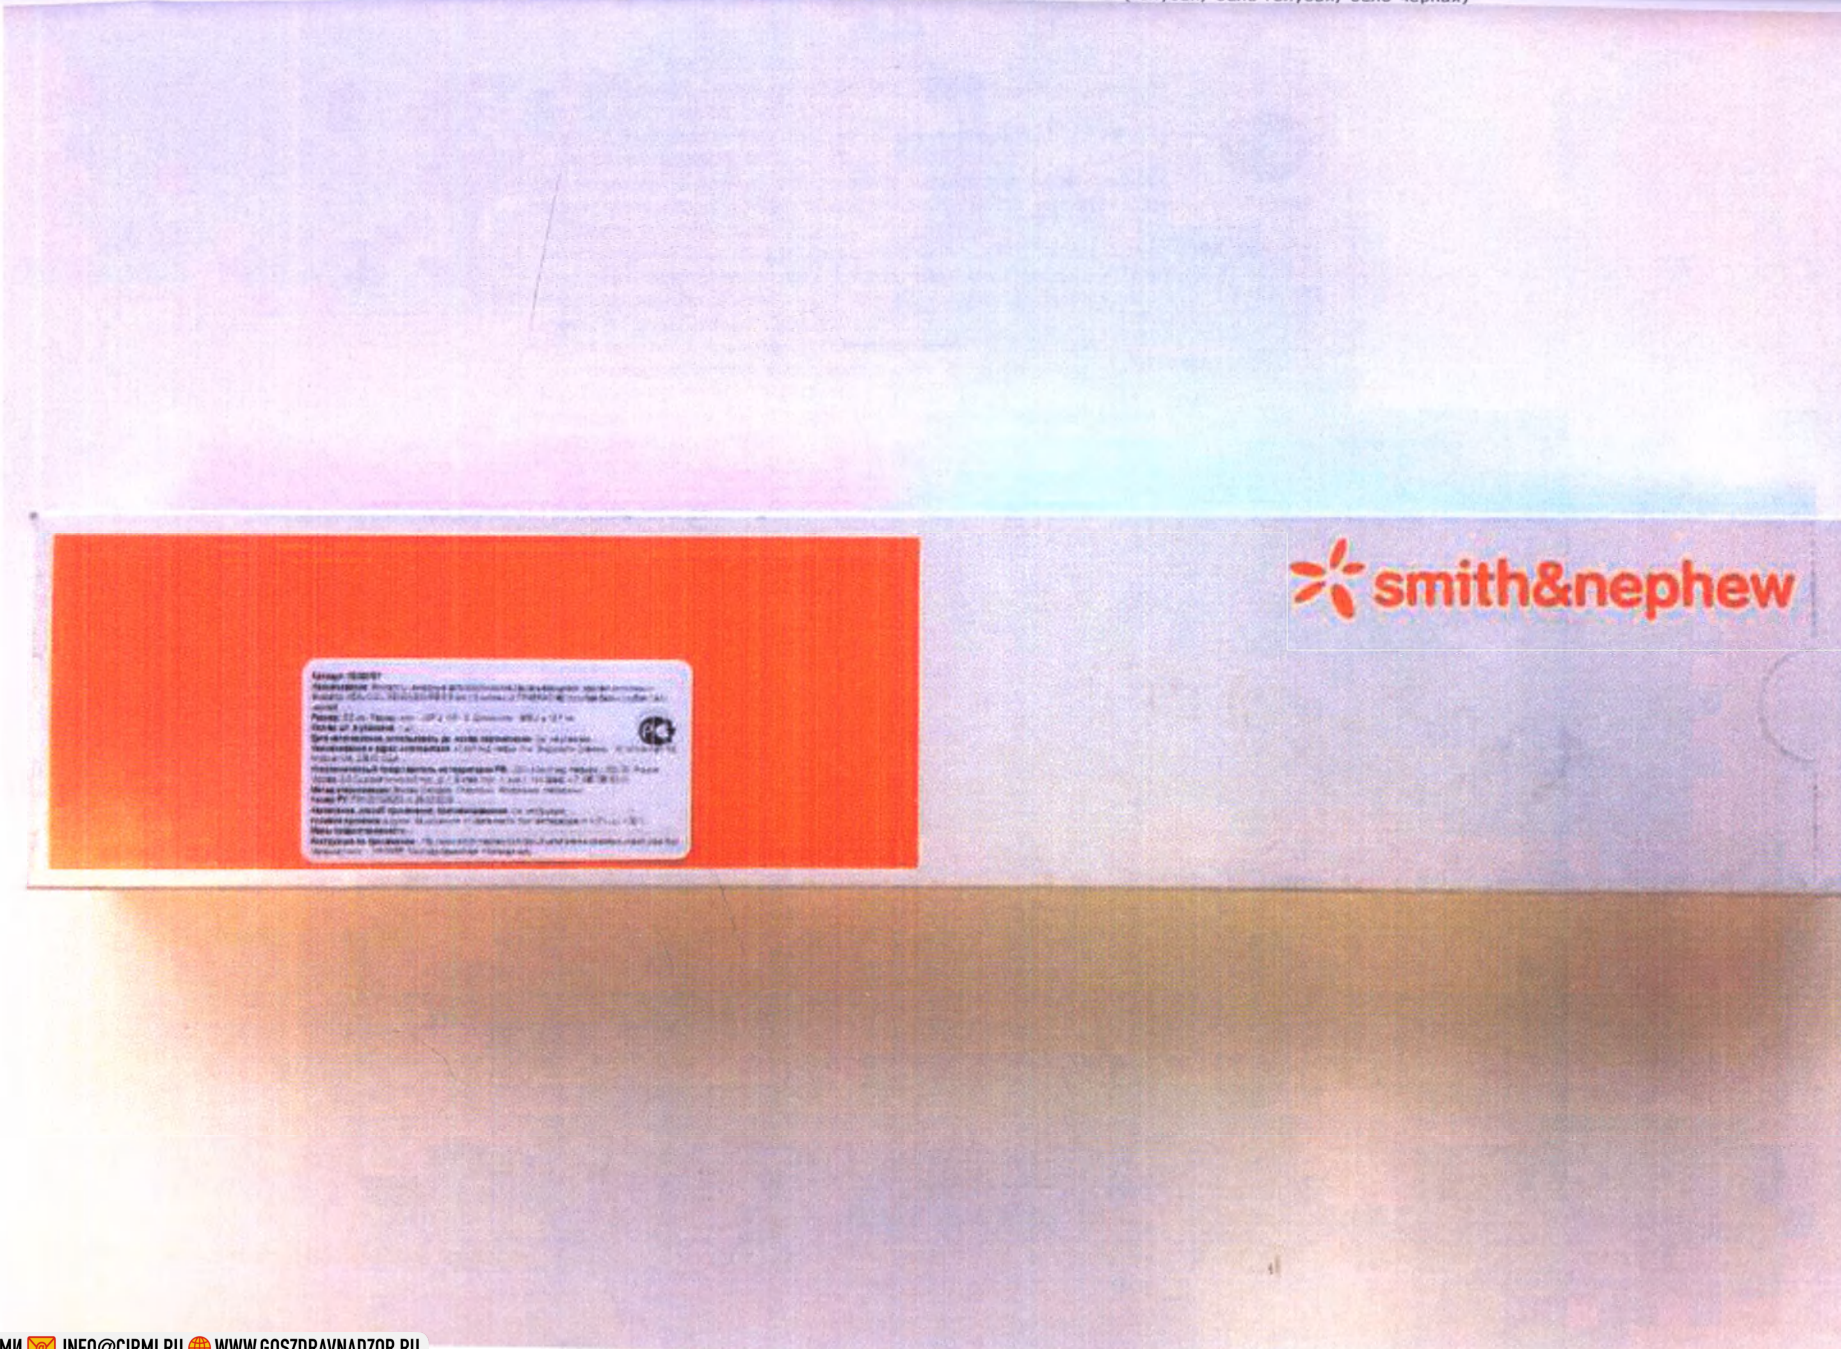

Артикул: 72203707

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор HEALICOIL REGENESORB 5.5 мм с 3 нитями ULTRABRAID #2
(голубая, бело-голубая, бело-черная)

Размер: 5, 5 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - $965,2 \pm 12,7$ мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.



Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г.

Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1, тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию


Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от $+0^{\circ}\text{C}$ до $+32^{\circ}\text{C}$

Меры предосторожности: См.инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/>

Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - $965,2 \pm 12,7$ мм

Рис. 6. Фиксатор HEALICOIL REGENESORB 5.5 мм с 1 лентой ULTRATAPE (голубая) и с 1 нитью ULTRABRAID #2 (бело-черная)

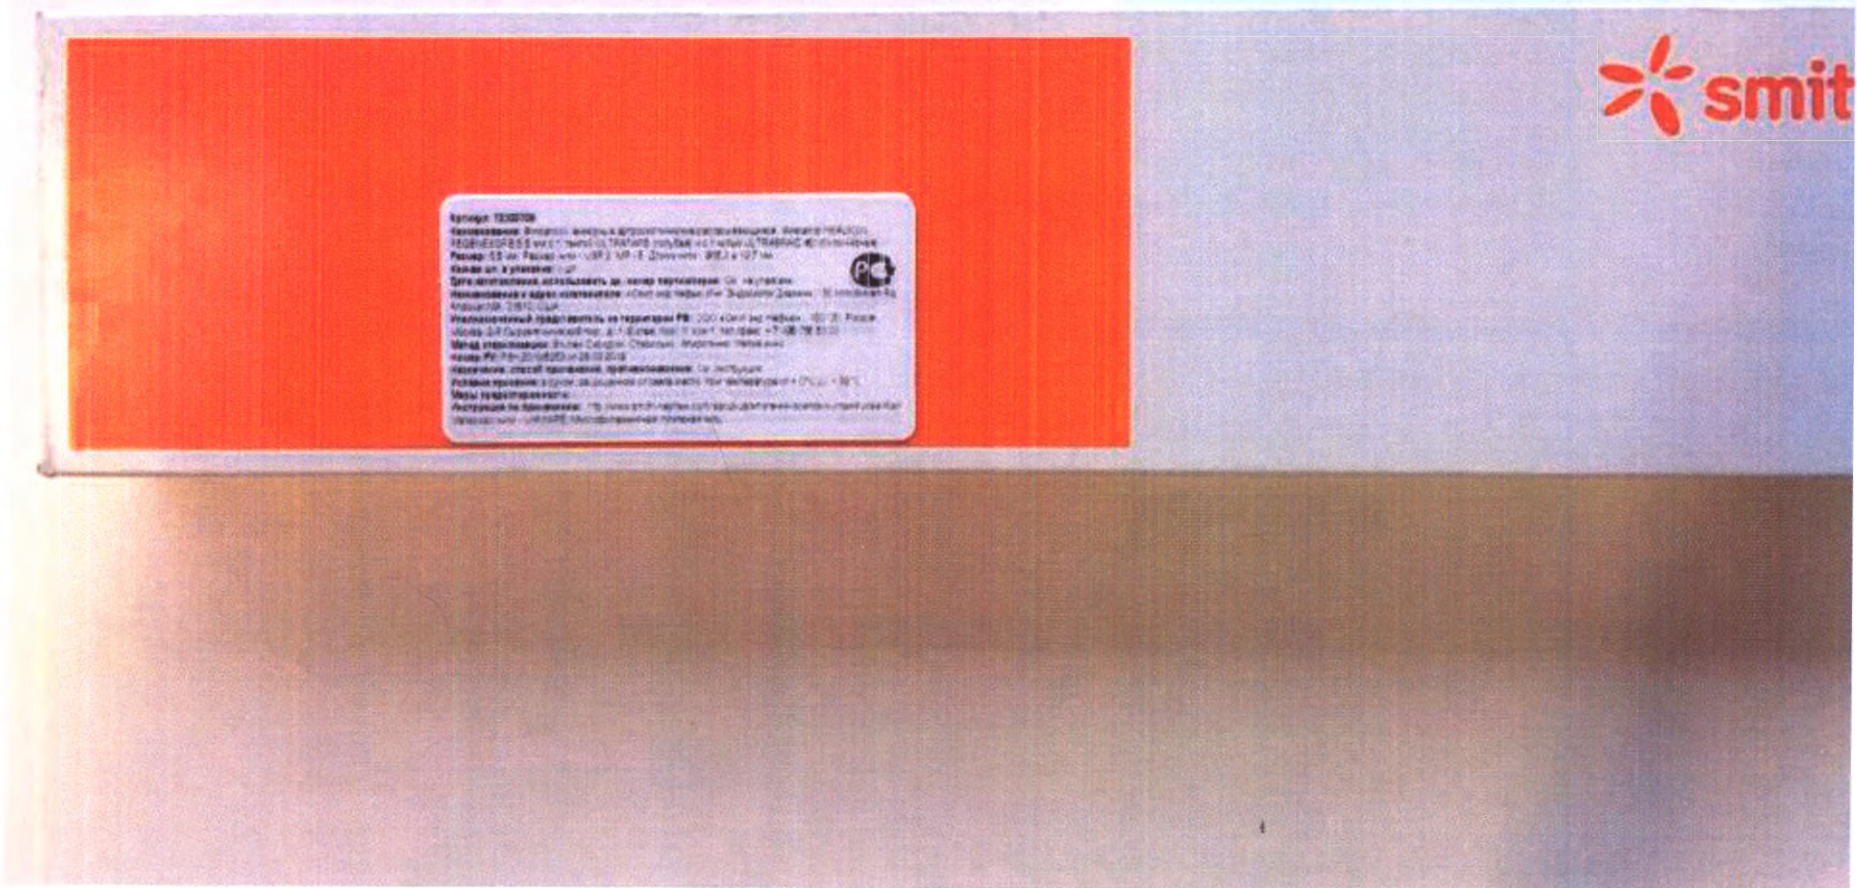

Артикул: 72203708

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся, вариант исполнения: Фиксатор HEALICOIL REGENESORB 5.5 мм с 1 лентой ULTRATAPE (голубая) и с 1 нитью ULTRABRAID #2 (бело-черная)

Размер: 5,5 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



Рис. 7. Фиксатор HEALICOL REGENESORB 5.5 мм с 1 лентой ULTRATAPE (бело-голубая) и с 1 нитью ULTRABRAID #2 (голубая)

Артикул: 72203801

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся, вариант исполнения: Фиксатор HEALICOIL REGENESORB 5,5 мм с 1 лентой ULTRATAPE (бело-голубая) и с 1 нитью ULTRABRAID #2 (голубая)

Размер: 5,5 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.



Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019


Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить

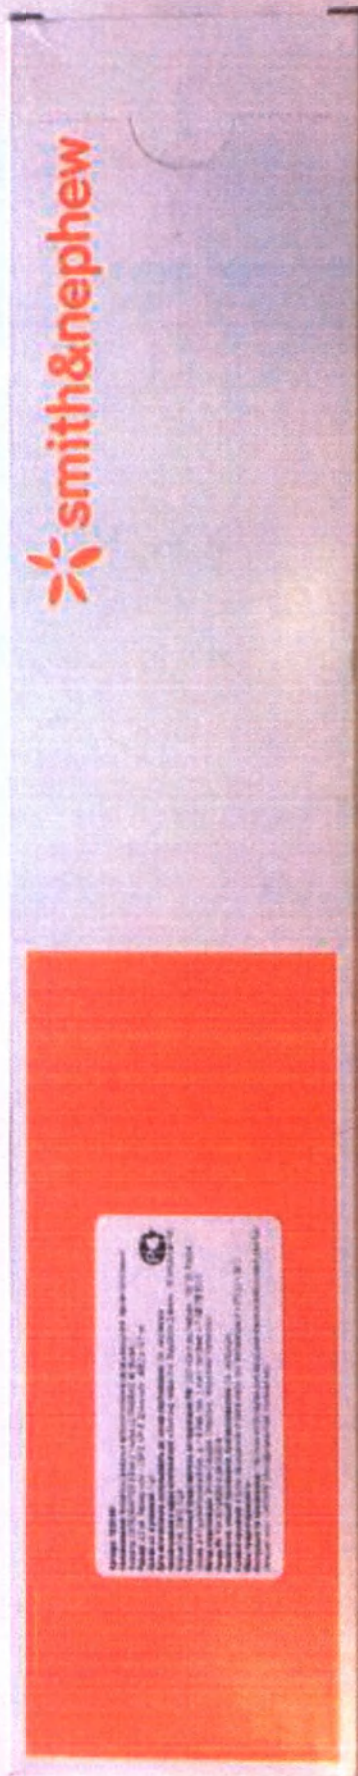

Артикул: 72201991

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор OSTEORAPTOR 2.3 мм с 1 нитью ULTRABRAID #2 (белая)

Размер: 2,3 мм. Размер нити - USP 2. MP -5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



Артикул: 72201992

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор OSTEO RAPTOR 2.3 мм с 1 нитью ULTRABRAID #2
(бело-черная)

Размер: 2,3 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - $965,2 \pm 12,7$ мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г.

Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Алирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C


Меры предосторожности: См.инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



Рис. 10. Фиксатор OSTEORAPTOR 2.3 мм с 1 нитью ULTRA BraID #2 (бело-голубая)

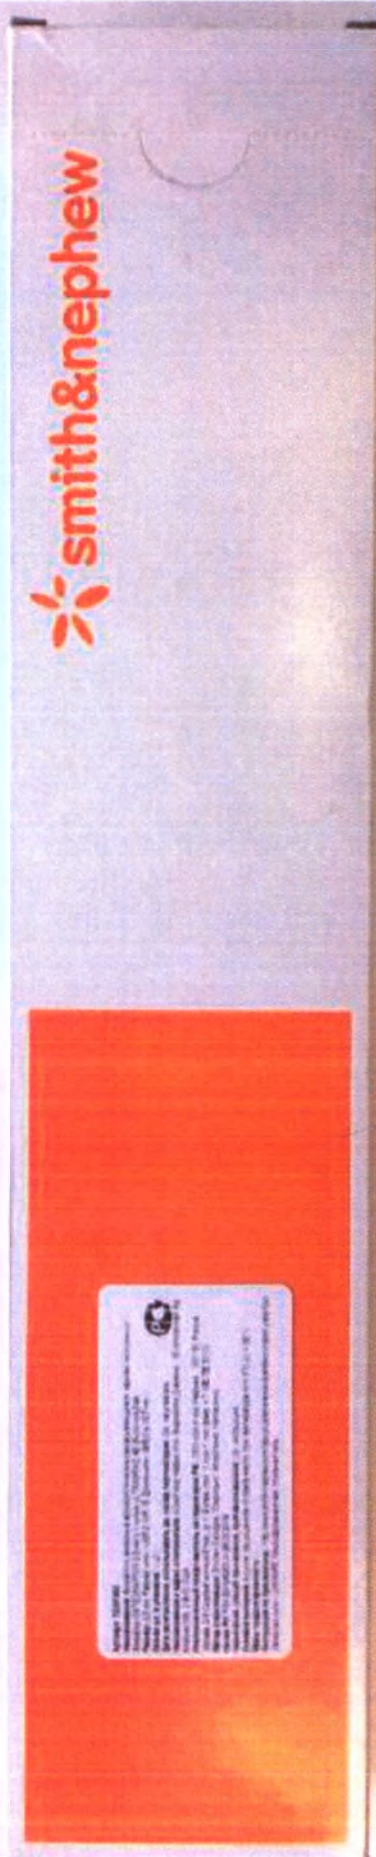

Артикул: 72201993

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор OSTEORAPTOR 2.3 мм с 1 нитью ULTRABRAID #2
(бело-голубая)

Размер: 2,3 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить





Артикул: 72202165

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор OSTEORAPTOR 2.9 мм с 1 нитью ULTRABRAID #2 (белая)

Размер: 2,9 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



Внимание! При использовании фиксатора OSTEONATOR 2.9 мм с штифом из титанового сплава необходимо соблюдать следующие правила:

- 1. Фиксатор OSTEONATOR 2.9 мм с штифом из титанового сплава предназначен для фиксации переломов трубчатых костей.
- 2. Фиксатор OSTEONATOR 2.9 мм с штифом из титанового сплава не должен использоваться для фиксации переломов трубчатых костей, если не соблюдены все правила.
- 3. Фиксатор OSTEONATOR 2.9 мм с штифом из титанового сплава не должен использоваться для фиксации переломов трубчатых костей, если не соблюдены все правила.
- 4. Фиксатор OSTEONATOR 2.9 мм с штифом из титанового сплава не должен использоваться для фиксации переломов трубчатых костей, если не соблюдены все правила.
- 5. Фиксатор OSTEONATOR 2.9 мм с штифом из титанового сплава не должен использоваться для фиксации переломов трубчатых костей, если не соблюдены все правила.
- 6. Фиксатор OSTEONATOR 2.9 мм с штифом из титанового сплава не должен использоваться для фиксации переломов трубчатых костей, если не соблюдены все правила.
- 7. Фиксатор OSTEONATOR 2.9 мм с штифом из титанового сплава не должен использоваться для фиксации переломов трубчатых костей, если не соблюдены все правила.
- 8. Фиксатор OSTEONATOR 2.9 мм с штифом из титанового сплава не должен использоваться для фиксации переломов трубчатых костей, если не соблюдены все правила.
- 9. Фиксатор OSTEONATOR 2.9 мм с штифом из титанового сплава не должен использоваться для фиксации переломов трубчатых костей, если не соблюдены все правила.
- 10. Фиксатор OSTEONATOR 2.9 мм с штифом из титанового сплава не должен использоваться для фиксации переломов трубчатых костей, если не соблюдены все правила.

 smith&nephew

Артикул: 72201994

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор OSTEORAPTOR 2.9 мм с 1 нитью ULTRABRAID #2 (белс ---белс)

Размер: 2,9 мм.Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См.инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



 **ООО ЦПМИ**  **INFO@CPMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

Артикул: 72201995

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся, вариант исполнения: Фиксатор OSTEORAPTOR 2.9 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (белая и белоголубая)

Размер: 2,9 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - $965,2 \pm 12,7$ мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г.

Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить





smith & nephew

[illegible]

Артикул: 72201996

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся, вариант исполнения: Фиксатор OSTEORAPTOR 2.9 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (белая и черная)

Размер: 2,9 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - $965,2 \pm 12,7$ мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



Рис. 15. Фиксатор остеопороза изогнутого типа с 3-м и 4-м типами фиксации (варианты)



Артикул: 72203290

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся, вариант исполнения: Фиксатор OSTEORAPTOR CURVED 2.3 мм с 1 нитью ULTRABRAID #2 (бело-голубая)

Размер: 2,3 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - $965,2 \pm 12,7$ мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Артикул: 72203291

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор OSTEORAPTOR CURVED 2.3 мм с 1 нитью ULTRABRAID #2 (бело-
черная)

Размер: 2,3 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman
Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г.
Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



Артикул: 72203423

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся, вариант исполнения: Фиксатор OSTEO RAPTOR CURVED 2.9 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (голубая и бело-голубая)

Размер: 2,9 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



Артикул: 72202597

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор TWINFIX Ultra HA 4.5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (белая и бело-голубая)

Размер: 4,5 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятницкий пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию


Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить





Адрес: 125080, Москва, Ленинградский проспект, д. 125, стр. 1
Телефон: (495) 740-0000
Факс: (495) 740-0001
E-mail: info@smit.ru
Сайт: www.smit.ru
Информация о продукции и услугах доступна на сайте
См. также: www.smit.ru/about-us
См. также: www.smit.ru/products
См. также: www.smit.ru/services
См. также: www.smit.ru/partners
См. также: www.smit.ru/press
См. также: www.smit.ru/contacts

Артикул: 72202624

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор TWINFIX Ultra HA 4.5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (бело-голубая и
бело-черная)

Размер: 4,5 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman
Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г.
Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: [http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-
operate/europe/russia/ifu/](http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/)

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить





Артикул: 72202602

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор TWINFIX Ultra HA 5,5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (белая и бело-голубая).

Размер: 5,5 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию


Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См.инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



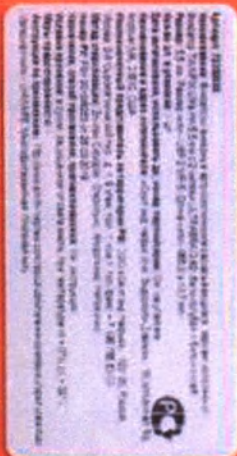

Артикул: 72202626

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор TWINFIX Ultra HA 5.5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (бело-голубая и
бело-черная)

Размер: 5,5 мм. Размер нити - USP 2.MP-5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman
Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г.
Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: [http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-
operate/europe/russia/ifus/](http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/)

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



Артикул: 72202603

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор TWINFIX Ultra HA 5.5 мм с 3 нитями ULTRABRAID #2 (белая, бело-голубая, бело-черная)

Размер: 5,5 мм. Размер нити - USP 2. MP- 5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: [http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-](http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/)

[operate/europe/russia/ifus/](http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/)

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



 smith&nephew

Внимание! В связи с переходом на новую систему маркировки
продукции, начиная с 01.01.2015 года, все изделия, имеющие
маркировку, должны быть снабжены новой маркировкой.
Внимание! В связи с переходом на новую систему маркировки,
начиная с 01.01.2015 года, все изделия, имеющие маркировку,
должны быть снабжены новой маркировкой. В противном
случае продукция не будет принята к использованию.
Внимание! В связи с переходом на новую систему маркировки,
начиная с 01.01.2015 года, все изделия, имеющие маркировку,
должны быть снабжены новой маркировкой. В противном
случае продукция не будет принята к использованию.

Артикул: 72202608

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор TWINFIX Ultra HA 6.5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (белая и бело-голубая)

Размер: 6,5 мм. Размер нити - USP 2.MP-5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятницкий пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию


Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



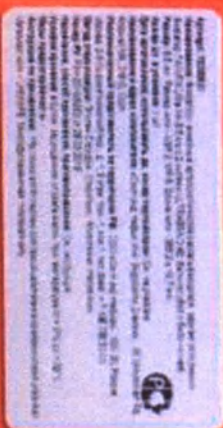

Артикул: 72202631

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор TWINFIX Ultra HA 6.5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (бело-голубая и
бело-черная).

Размер: 6,5 мм. Размер нити - USP 2. MP-5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman
Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г.
Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: [http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-
operate/europe/russia/rfus/](http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/rfus/)

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить





Артикул: 72202610

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся, вариант исполнения: Фиксатор TWINFIX Ultra HA 6.5 мм с 3 нитями ULTRABRAID #2 (белая, бело-голубая, бело-черная).

Размер: 6,5 мм. Размер нити - USP 2. MP - 5. Длина нити - $965,2 \pm 12,7$ мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



Артикул: 72202612

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор TWINFIX Ultra HA 4.5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (голубая и
бело-голубая) и иглами

Размер: 4,5 мм. Размер нити - USP 2.MP-5. Длина нити - $965,2 \pm 12,7$ мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.



Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman
Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г.
Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком. 1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить

Артикул: 72202616

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор TWINFIX Ultra HA 5.5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (голубая и
бело-голубая) и иглами

Размер: 5,5 мм. Размер нити - USP 2, MP -5. Длина нити - $965,2 \pm 12,7$ мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman
Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, Россия, г.

Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



Артикул: 72202620

Наименование: Фиксаторы анкерные артроскопические рассасывающиеся,
вариант исполнения: Фиксатор TWINFIX Ultra HA 6.5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (голубая и
бело-голубая) и иглами

Размер: 6,5 мм. Размер нити - USP 2. MP -5. Длина нити - 965,2 ± 12,7 мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: «Смит энд Нефью Инк. Эндоскопи Дивижн», 150 Minuteman
Rd, Andover, MA, 01810, США

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г.
Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, 9 этаж, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Этилен Оксидом. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.

Номер РУ: РЗН 2019/8253 от 28.03.2019

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от + 0°C до + 32°C

Меры предосторожности: См. инструкцию

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ffus/>

Материал нити - UHMWPE. Многофиламентная, плетеная нить



Рис. 29. Фиксатор HEALICOIL REGENESORB 4.75 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (голубая и бело-голубая)



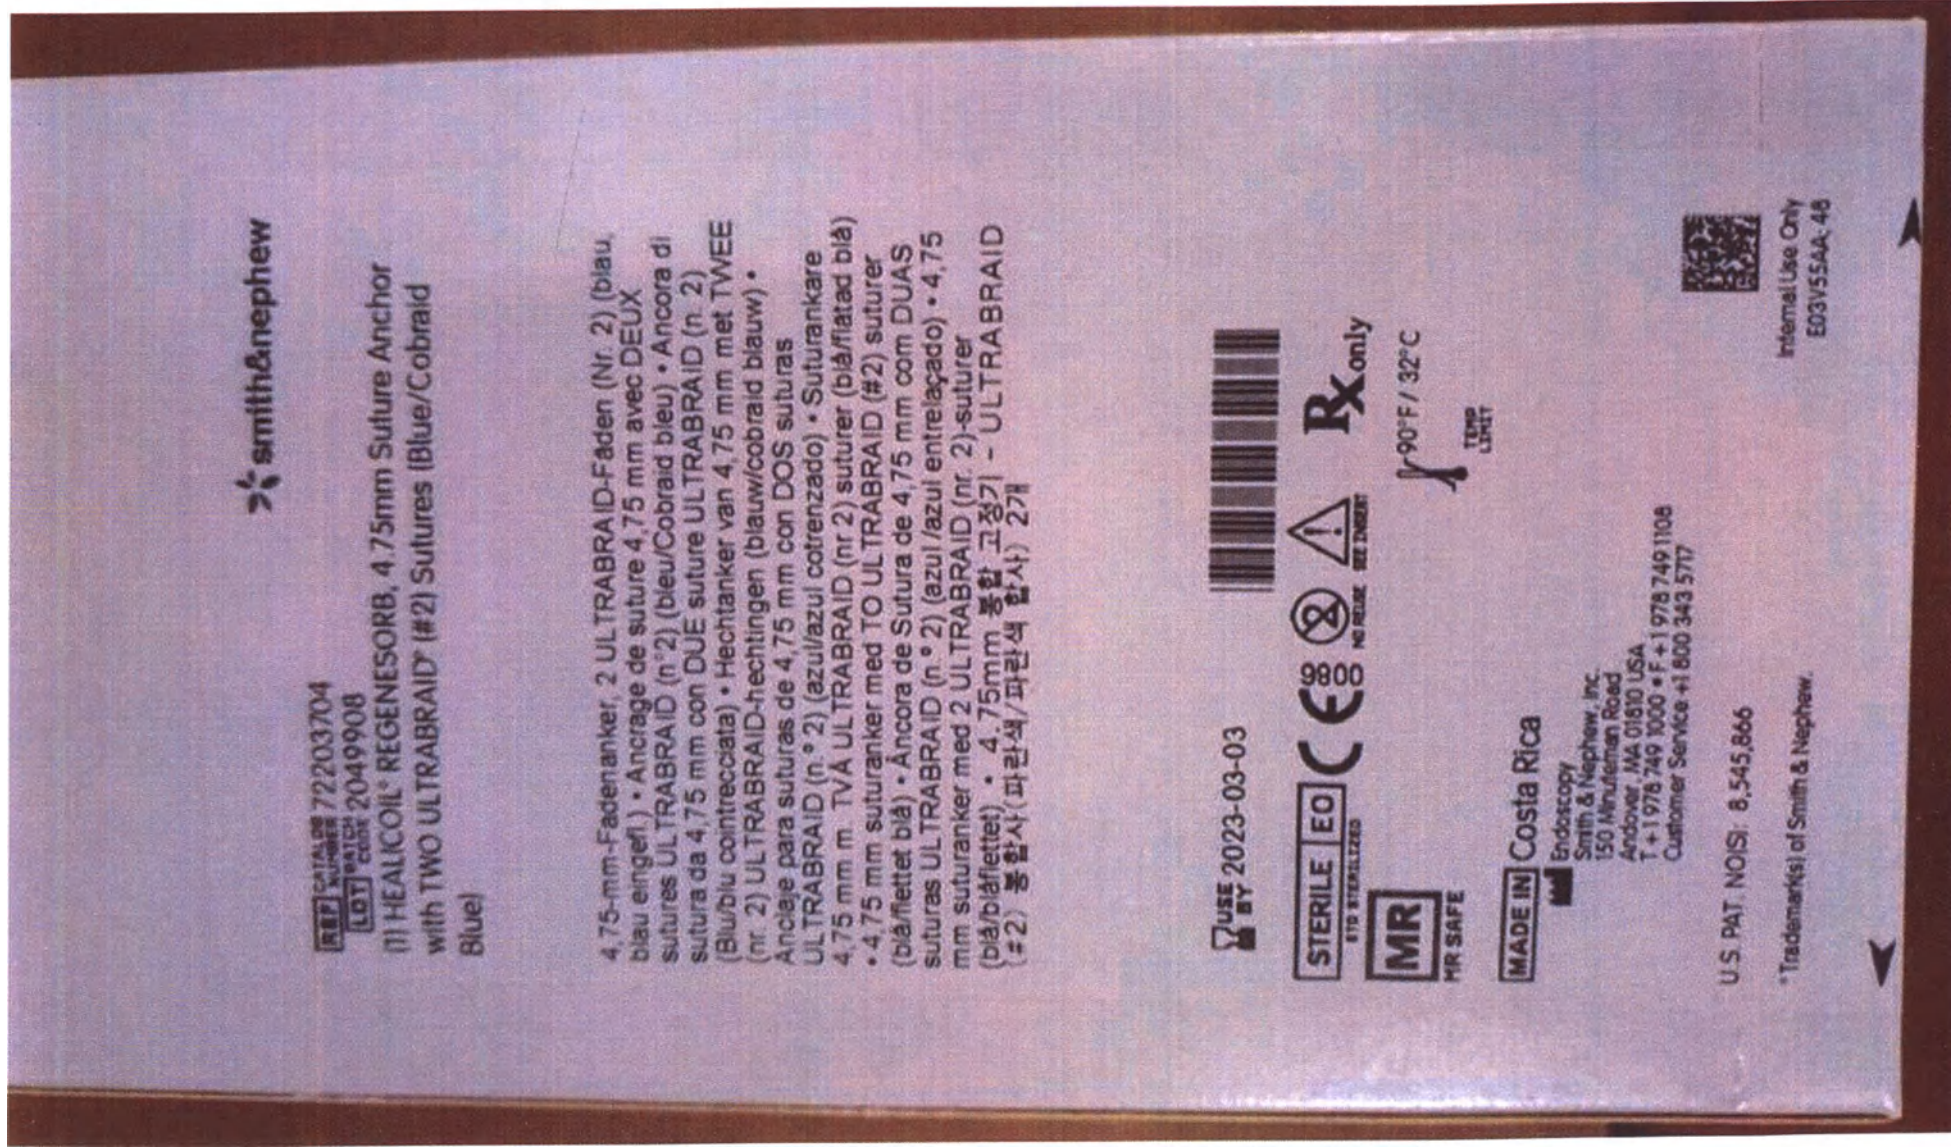


Рис. 30. Фиксатор HEALICOIL REGENESORB 5.5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (голубая и бело-голубая)

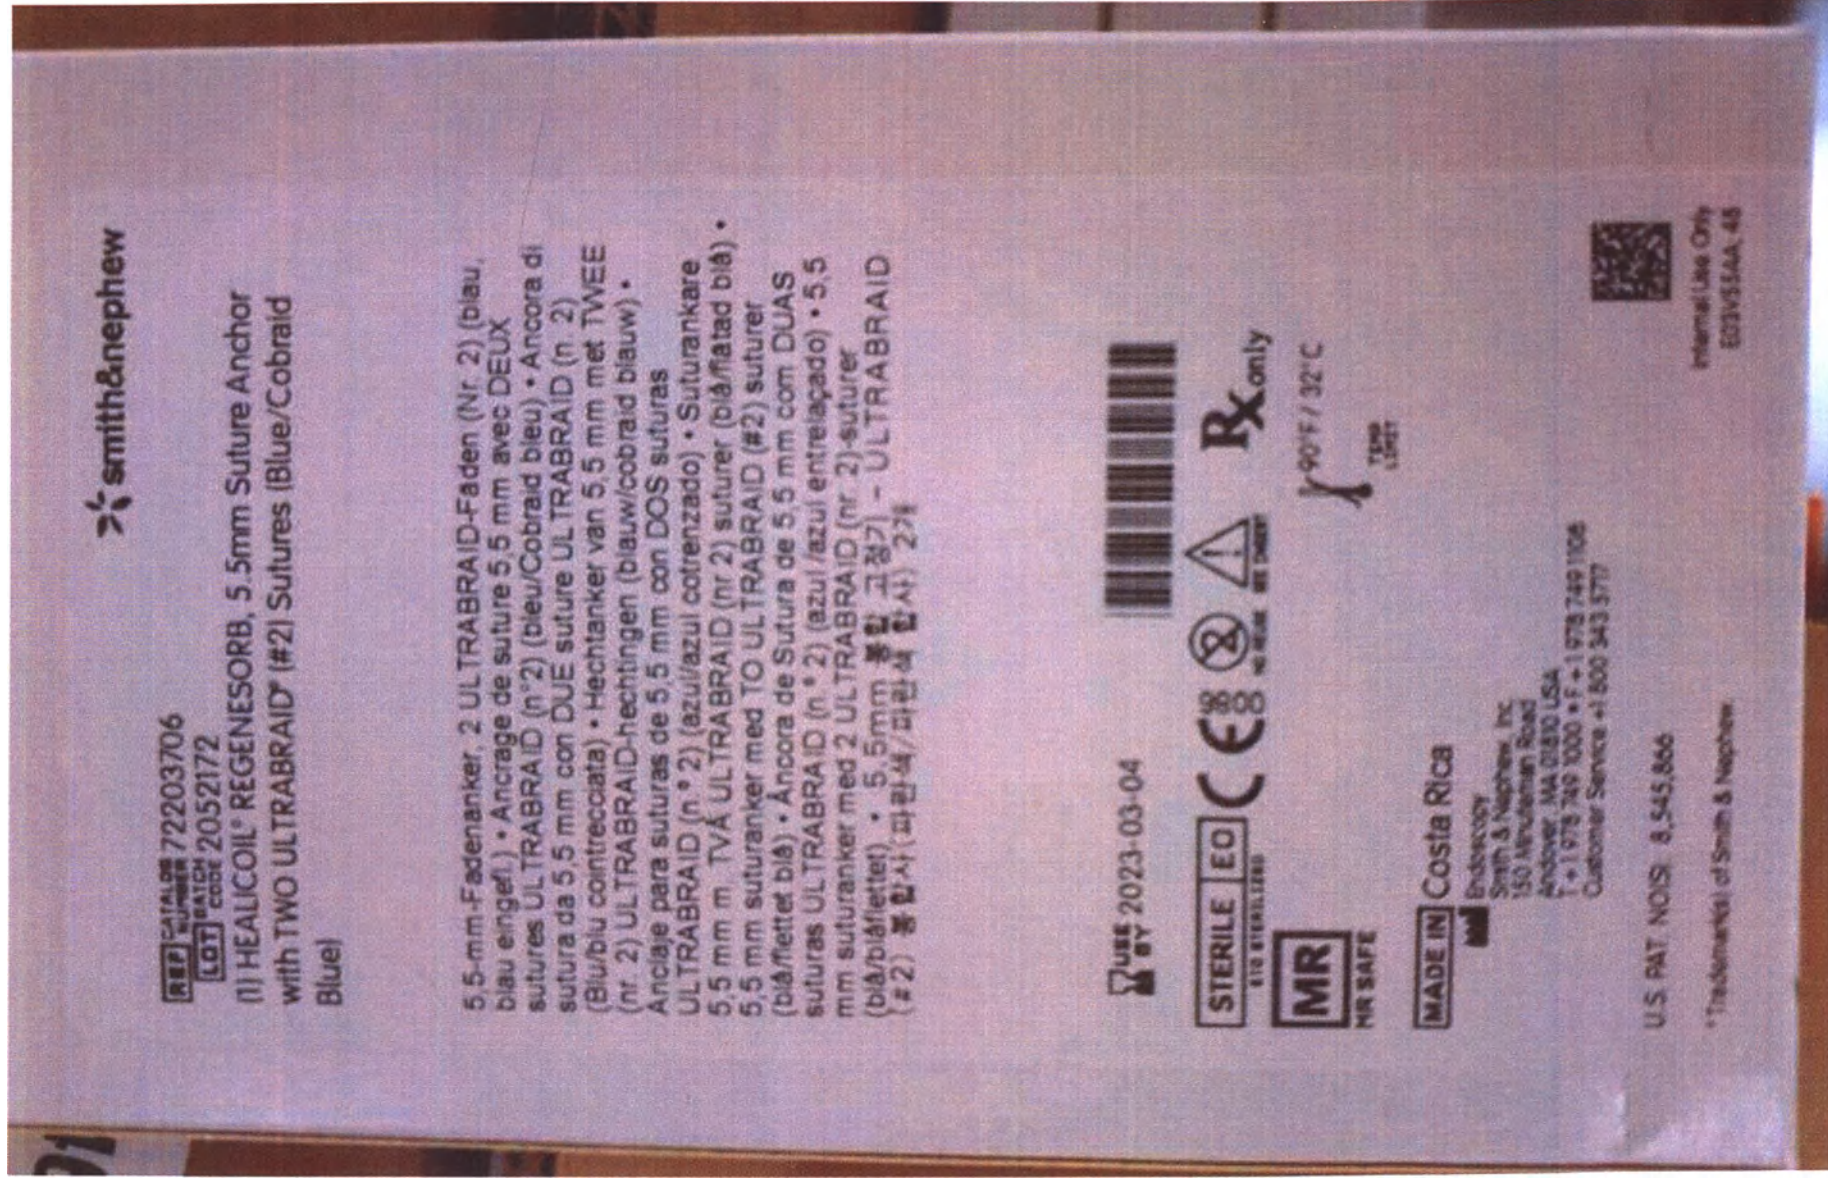



REF CATALOG NUMBER 72203707
LOT BATCH CODE 2052180

(1) HEALICOIL® REGENESORB, 5.5mm Suture Anchor
with THREE ULTRABRAID® (#2) Sutures (Blue/Cobraid
Blue/Cobraid Black)

5,5-mm-Fadenanker, 3 ULTRABRAID-Faden (Nr. 2) (blau,
blau eingefl., schwarz eingefl.) • Ancrage de suture 5,5 mm
avec TROIS sutures ULTRABRAID (n°2) (bleu/Cobraid
bleu/Cobraid noir) • Ancora di sutura da 5,5 mm con TRE
suture ULTRABRAID (n. 2) (Blu/blu cointrecciata/nera
cointrecciata) • Hechtanker van 5,5 mm met DRIE (nr.2)
ULTRABRAID-hechtingen (blauw/cobraid blauw/cobraid
zwart) • Anciaje para suturas de 5,5 mm con TRES suturas
ULTRABRAID (n.º 2)(azul/azul cotrenzado/negro cotrenzado)
• Suturankare 5,5 mm m. TRE ULTRABRAID (nr 2) suturer
(blå/flåttad blå/flåttad svart) • 5,5 mm suturanker med TRE
ULTRABRAID (#2) suturer (blå/flåttet blå/flåttet svart) •
Âncora de Sutura de 5,5 mm com TRÊS suturas
ULTRABRAID (n.º 2) (azul/azul entrelaçado/preto
entrelaçado) • 5,5 mm suturanker med 3 ULTRABRAID
2-suturer (blå/blåflåttet/sortflåttet) • 5,5mm 봉합사
ULTRABRAID (#2) 봉합사(파란색/파란색 합사/검
합사) 3개

USE BY 2023-03-04



STERILE EO
ETO STERILIZED



NO REUSE SEE INHERIT

R_x only

MR

MR SAFE

90°F / 32°C

TEMP
LIMIT

MADE IN Costa Rica


Endoscopy
Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810 USA
T +1 978 749 1000 • F +1 978 749 1108
Customer Service +1 800 343 5717

U.S. PAT. NO(S): 8,545,866

* Trademark(s) of Smith & Nephew.



Internal Use Only
E03V55AA; 48



REF CATALOG NUMBER 72201991
LOT BATCH CODE 2059251

(1) OSTEORAPTOR® 2.3 Suture Anchor
w/ONE ULTRABRAID® (#2) Suture (Blue)

2,3-Fadenanker mit EINEM ULTRABRAID-Faden (Nr. 2)
(bleu) • Ancrage de suture 2,3 avec UNE suture
ULTRABRAID (n°2) (bleu) • Ancora di sutura 2,3 con UNA
sutura ULTRABRAID (n. 2) (blu) • 2,3-hechtdraadanker met
ÉÉN (nr. 2) ULTRABRAID-hechtdraden (bl) • Ancraje para
sutura 2,3 con UNA sutura ULTRABRAID (n.º 2) (azul) • 2,3
suturaanker m/ÉN (nr. 2) ULTRABRAID-sutur (blá) • 2,3
Sutur Ankor, BİR ULTRABRAID (#2) Sutura (Mavi) •
Αγκιστρο ραμμάτων 2,3 με ΕΝΑ ράμμα ULTRABRAID (αφ. 2)
(Μπλε) • Ancora de sutura 2,3 c/UMA sutura ULTRABRAID
(n.º 2) (Azul) • 2,3 mm suturanker med EN ULTRABRAID-
sutur (nr. 2) (blå) • 2,3 봉합 고정기와 ULTRABRAID
(2번) 봉합사 (청색) 한 개

smith&nephew

USE BY 2025-08-11



STERILE EO
S10 STERILIZED



2797



MR
MR SAFE



Rx only

MADE IN Costa Rica


Endoscopy
Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810 USA
T +1 978 749 1000 • F +1 978 749 1108
Customer Service +1 800 343 5717



Trademarks of Smith & Nephew

Internal Use Only
E03V5.5AA.52

Рис. 32. Фиксатор OSTEORAPTOR 2.3 мм с 1 нитью ULTRABRAID #2 (белая)



REF CATALOG NUMBER 72201996

LOT BATCH CODE 2060711

(1) OSTEORAPTOR® 2.9 Suture Anchor
with two ULTRABRAID® (#2) Sutures (White & Cobraid
Black)

2,9-Fadenanker mit 2 ULTRABRAID-Faden (St. 2, weiß und
schwarz eingefl.) • Ancrage suture 2,9 avec 2 sutures
ULTRABRAID (no 2, blanc et co-braid noir) • Ancora per
sutura, 2,9 con 2 suture ULTRABRAID (n 2, bianco e
intrecciati neri) • 2,9 hechtdraadanker met 2x ULTRABRAID
(nr.2) hechtdr. (wit en zwart vervlochten) • Anclaje sutura 2,9
con 2 suturas ULTRABRAID (n o2, blanco y cotrenzada
negro) • 2,9 suturankare med två ULTRABRAID (nr 2)
suturer (vit och flatad svart) • 2,9 suturanker med to
ULTRABRAID (nr. 2) suturer (hvit og sammenflettet svart) •
Âncora sutura 2,9, 2 fios sutura ULTRABRAID (n o2, branco
e entrel preto) • 2,9 suturanker med to ULTRABRAID (nr. 2)
suturer (hvit og sammenflettet sort)

USE BY 2025-08-28



STERILE EO
ETO STERILIZED



2797



NO REUSE



CONSULT
INSTRUCTIONS



CAUTION

Rx only

MADE IN Costa Rica




Endoscopy
Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810 USA
T +1 978 749 1000 • F +1 978 749 1108
Customer Service +1 800 343 5717



*Trademark(s) of Smith & Nephew.

Internal Use Only
E03V55AA; 52



REF CATALOG NUMBER 72203290
LOT BATCH CODE 2059259

(1) OSTEORAPTOR® CURVED 2.3 Suture Anchor
w/ ONE 38" ULTRABRAID® (#2) Suture (cobraid blue)


Gebog 2.3-Fadnank m. ein 96,5-cm-ULTRABRAID-Fad.
(Nr. 2) (bl. eingefl.) • Ancr. sut. 2,3 courbe av. UNE sut.
96,5cm ULTRABRAID (n°2) (cobraid bleu) • Anc. sut. curva
2,3, c/1 sut. ULTRABRAID (2) 96,5cm (blu int.) • Geb. 2,3
hechtnkr m/1 96,5cm ULTRABRAID (nr. 2) hechting (cobr. bl.)
• Anclaje suturas 2,3 curvo c/UNA sutura ULTRABRAID (n.º
2) 96,5cm (azul cotrenz) • Bøjt suturankare 2,3 m/EN
96,5cm ULTRABRAID (nr 2) sutur (samflåttad blå) • Kurvet
2,3 suturanker m/EN 96,5cm ULTRABRAID-sutur (#2) (flettet
blå) • Ancora sutura curva 2,3 c/1 sutura 96,5cm
ULTRABRAID (n2) (azul entr.) • Buet 2,3 suturanker m/EN
96,5cm ULTRABRAID-sutur (nr. 2) (flet. blå)

smith&nephew

USE BY 2025-08-05



STERILE EO
ETO STERILIZED



MR
MR SAFE

Rx only

MADE IN Costa Rica

Endoscopy
Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810 USA
T +1 978 749 1000 • F +1 978 749 1108
Customer Service +1 800 343 5717



*Trademark(s) of Smith & Nephew.

Internal Use Only
E03V55AA.52

Рис. 34. Фиксатор OSTEORAPTOR CURVED 2.3 мм с 1 нитью ULTRABRAID #2 (бело-голубая)

Рис. 35. Фиксатор TWINFIX Ultra HA 5.5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (белая и бело-голубая)

 smith&nephew

REF CATALOG 72202602

LOT BATCH CODE 2058850

(1) TWINFIX® Ultra HA 5.5 mm Suture Anchor
w/TWO ULTRABRAID® (#2) sutures (white/ cobraid blue)

Fadenanker, 5.5mm, 2 ULTRABRAID-Faden (Nr. 2) (weiß/
blau eingefä.) • Ancrage suture 5.5mm, 2 sutures
ULTRABRAID (n°2) (blanc /bleu tressé) • Ancora sutura
5.5mm, due (2) suture ULTRABRAID (bianca/ intr. blu) •
5.5mm hchtank m. 2 (nr 2) ULTRABRAID-hchtngn (wit/ cobr
bl) • Ancloje suturas 5.5mm c/2 suturas ULTRABRAID (n° 2)
(blanco/ azul cotrenzado) • Suturaankare, 5.5mm, med två (nr
2) ULTRABRAID-suturer (vit/ flatad blå) • 5.5mm suturanker
med to (nr 2) ULTRABRAID-suturer (hvit/ flettet blå) •
Ancora sutura 5.5mm c/ dois fios sutura ULTRABRAID (n2)
(branco/ azul entrançado) • 5.5mm sut anker m. 2 (# 2)
ULTRABRAID sut. (hvid/ smn flet blå)

USE BY 2025-07-22



STERILE EO

CE

2797

NO REUSE

CONSULT INSTRUCTIONS



MR
MR SAFE

Rx only

MADE IN Costa Rica


Endoscopy

Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810 USA
T +1 978 749 1000 • F +1 978 749 1108
Customer Service +1 800 343 5717



Internal Use Only
EO3V55AA, 52

Trademarks of Smith & Nephew



REF CATALOG NUMBER 72202608
LOT BATCH CODE 50730486

(1) TWINFIX® Ultra HA 6.5 mm Suture Anchor
w/TWO ULTRABRAID® (#2) sutures (white/ cobraid blue)

Fadenanker, 6,5mm, 2 ULTRABRAID-Faden (Nr. 2) (weiß/
blau eingefli) • Ancrage suture 6,5mm, 2 sutures
ULTRABRAID (n°2) (blanc/ bleu tressé) • Ancora sutura
6,5mm, due (2) suture ULTRABRAID (bianco/ cobraid
blue) • Anclaje suturas 6,5mm c/2 suturas ULTRABRAID (n° 2)
(blanco/ azul cotrenzado) • Suturankare, 6,5mm med Nr. (nr.
2) ULTRABRAID-suturer (vit/ flätad blå) • 6,5mm suturanker
med to (nr. 2) ULTRABRAID-suturer (hvit/ flettet blå) •
Ancora sutura 6,5mm c/ dois fios sutura ULTRABRAID (n°2)
(branco/ azul entrançado) • 6,5mm sut anker m. 2 (# 2)
ULTRABRAID sut. (hvid/ smn flet. blå)

USE BY 2023-04-30



STERILE EO
ETO STERILIZED



Rx only



MADE IN USA

Endoscopy
Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810 USA
T +1 978 749 1000 • F +1 978 749 1108
Customer Service +1 800 343 5717




*Trademark(s) of Smith & Nephew

E03V55AA; 45

Рис. 37. Фиксатор TWINFIX Ultra HA 6,5 мм с 2 нитями ULTRABRAID #2 (белая и бело-голубая)

Рис. 38. Фиксатор TWINFIX Ultra HA 6.5 мм с 3 нитями ULTRABRAID #2 (белая, бело-голубая, бело-черная)





REF CATALOG NUMBER 72202620
LOT BATCH CODE 50649354

(1) TWINFIX® Ultra HA 6.5 mm Suture Anchor
w/TWO (#2) ULTRABRAID® Sutures (blue/ blue cobraid)
and Needles

Fadenanker, 6,5mm, mit ZWEI (Nr. 2) ULTRABRAID-Faden
(blau und blau eingef.) und Nadeln • Ancrage de suture
6,5mm avec DEUX (2) sutures ULTRABRAID (bleu/tressé
bleu) et aiguilles • Ancora per sutura da 6,5mm con DUE (2)
suture ULTRABRAID (intrecciato blu e blu) e aghi • 6,5mm-
hechtanker m. TWEE (nr. 2) ULTRABRAID-hechtingen
(blauw en co-braid bl) en naalden • Anclaje sutura 6,5mm
c/DOS suturas ULTRABRAID (n° 2) (azul y cotrenzado azul)
y agujas • Suturankare 6,5mm m TVA (nr 2) ULTRABRAID
suturer (blå och blå flatad) m nålar • 6,5mm suturanker med
TO (nr. 2) ULTRABRAID-suturer (blå og flettet blå) og nåler •
Âncora de sutura 6,5mm c/ DUAS suturas ULTRABRAID
(n2) (azul e azul entrançado) e agulhas • 6,5mm suturanker
med TO (nr. 2) ULTRABRAID-suturer (blå og blåflettet) og
nåle

USE BY 2022-02-24



STERILE EO
ETO STERILIZED



Rx only



MADE IN USA

Endoscopy
Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810 USA
T +1 978 749 1000 • F +1 978 749 1108
Customer Service +1 800 343 5717



Trademark(s) of Smith & Nephew

E03V55AA: 45

Всего прошито и пронумеровано:

67/лист 5 с.м.п. листов

Руководитель отдела регистрации и
качества

ООО «Смит энд Нефью»

Смит энд Нефью
Лихачев Д.Н.

