

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.

2018 г.

М.п.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Кровать функциональная для медицинских учреждений по ТУ 32.50.30-004-14692415-2018 в исполнениях»


Кровать функциональная для медицинских учреждений по ТУ 32.50.30-004-14692415-2018 в исполнении

КФ - «Техстрой 4.01»

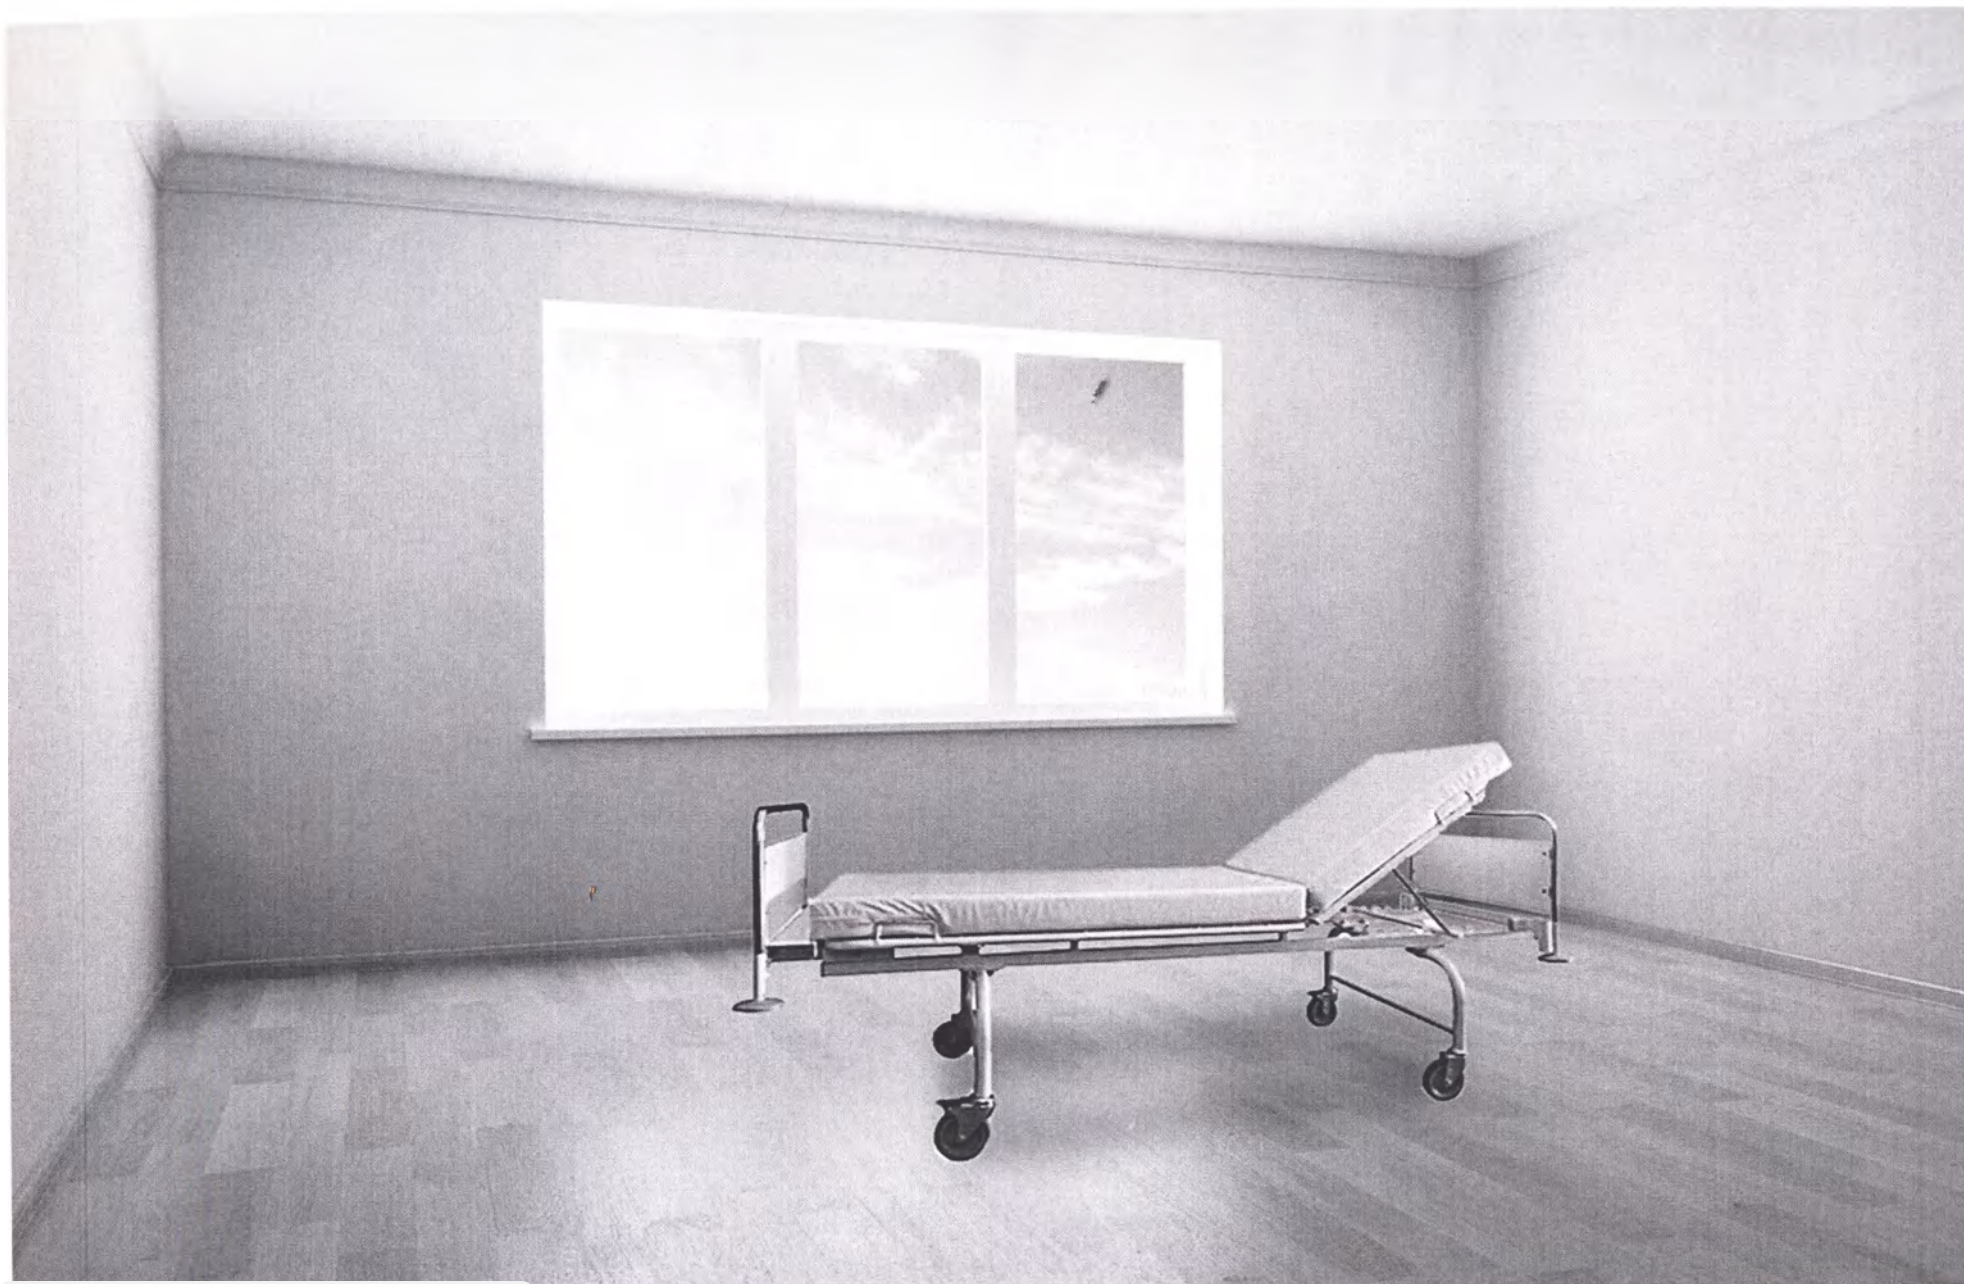





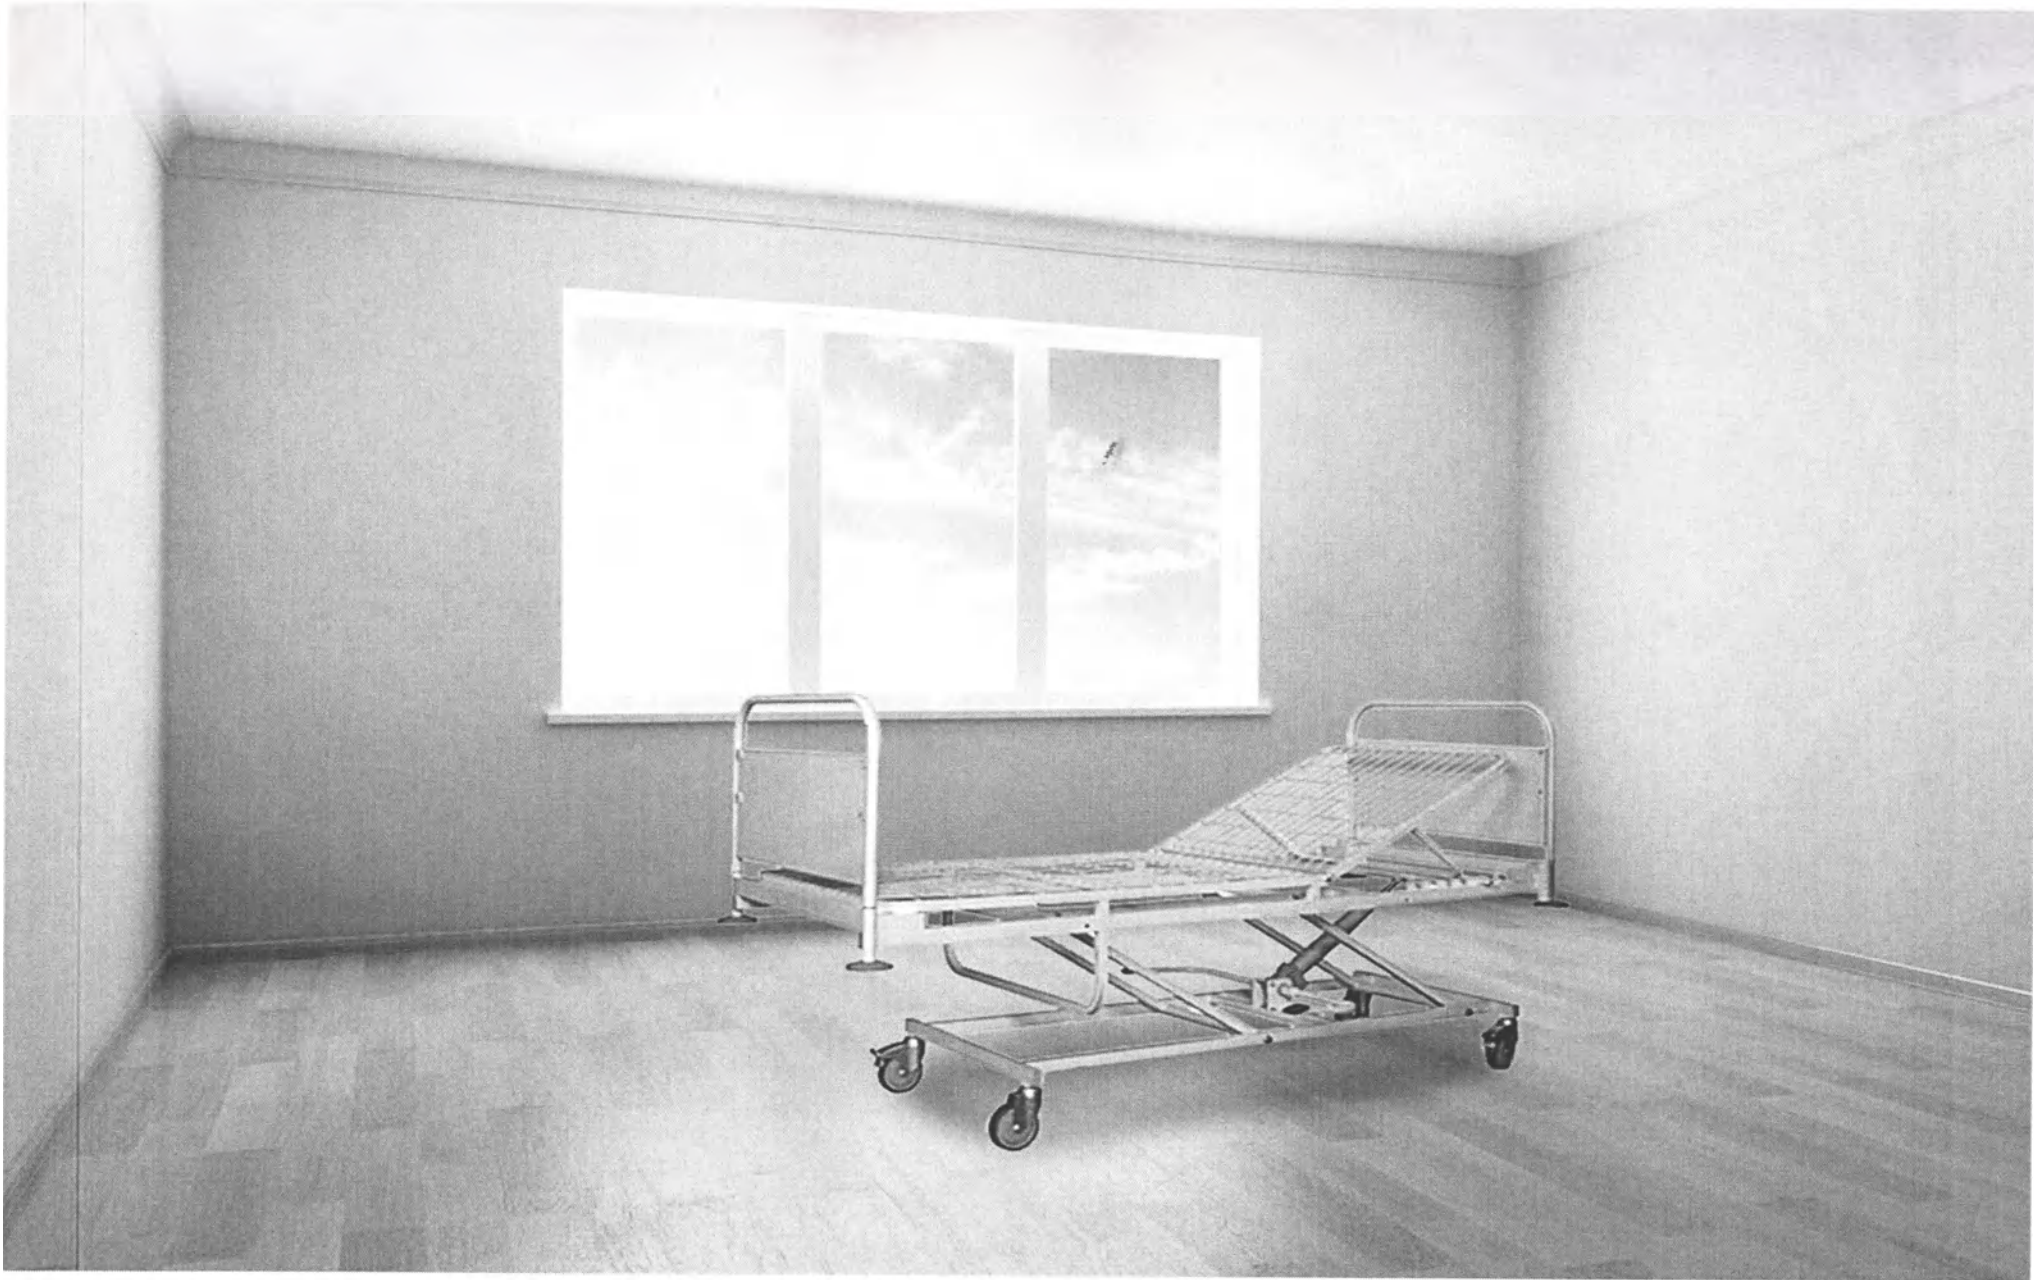

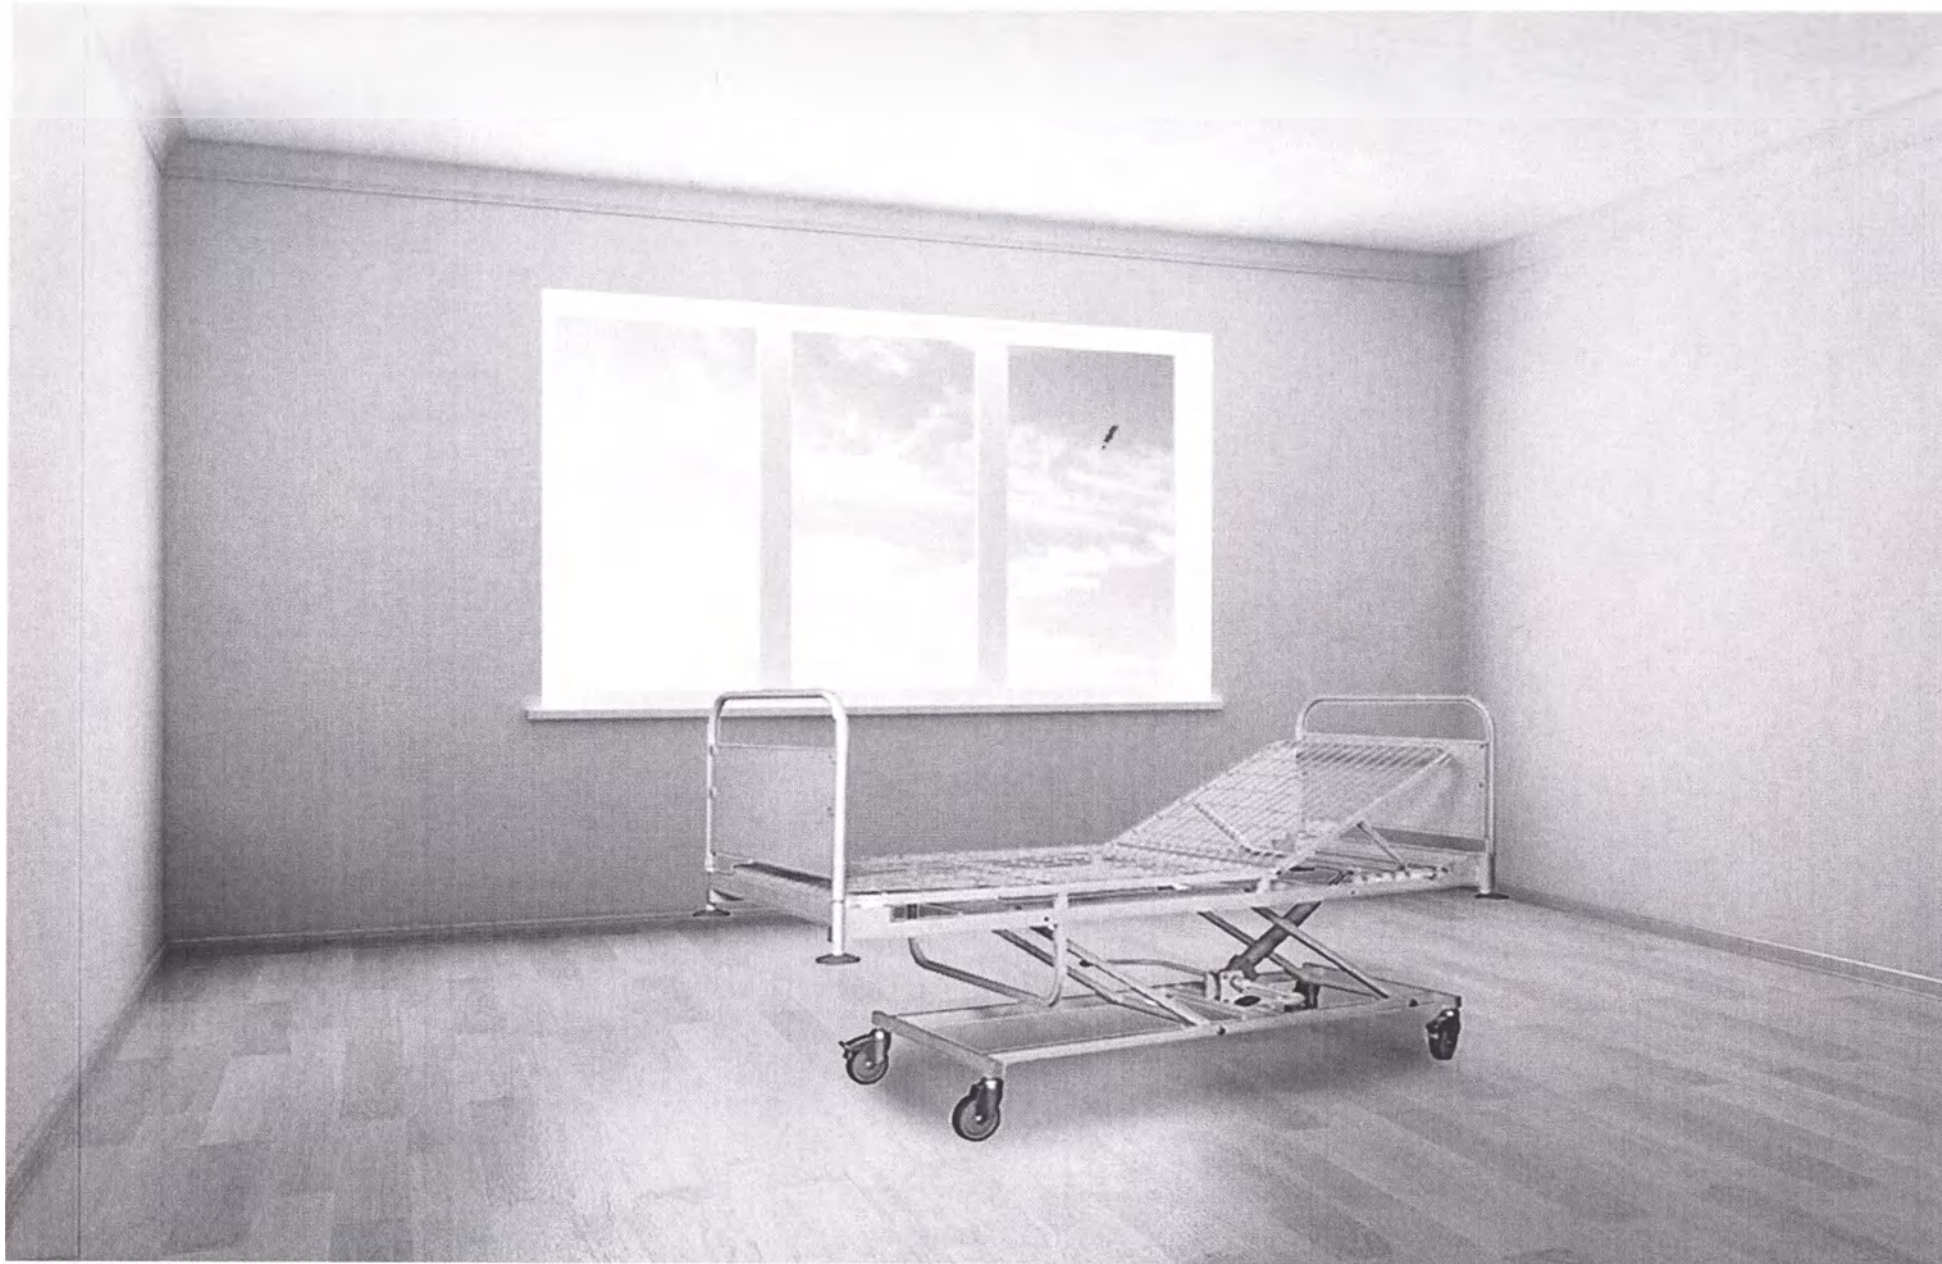

«Техстрой 4.07»; КФ - «Техстрой 4.08»; КФ - «Техстрой 4.12»; КФ - «Техстрой 4.13»

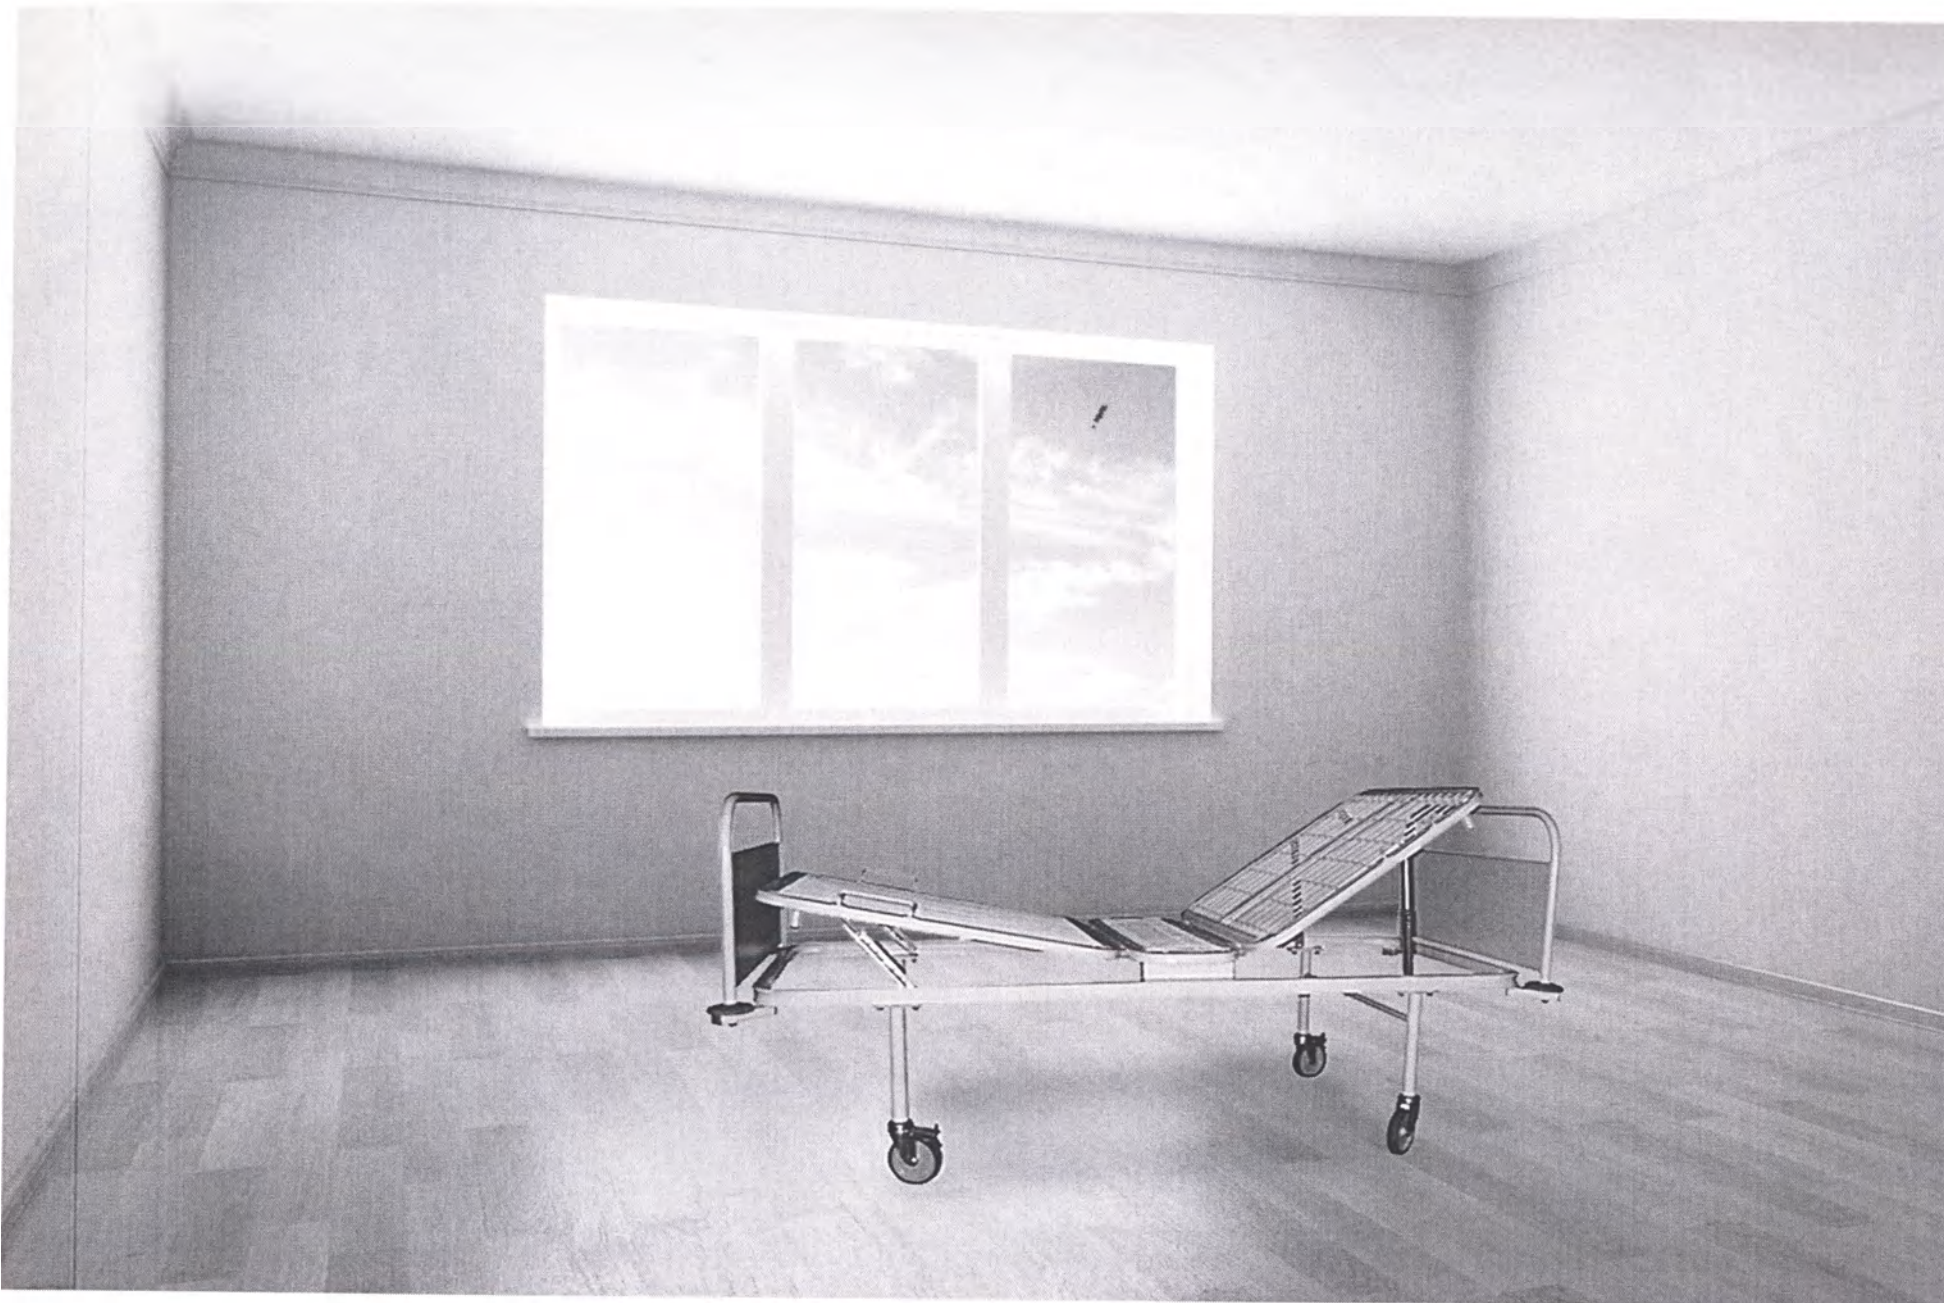


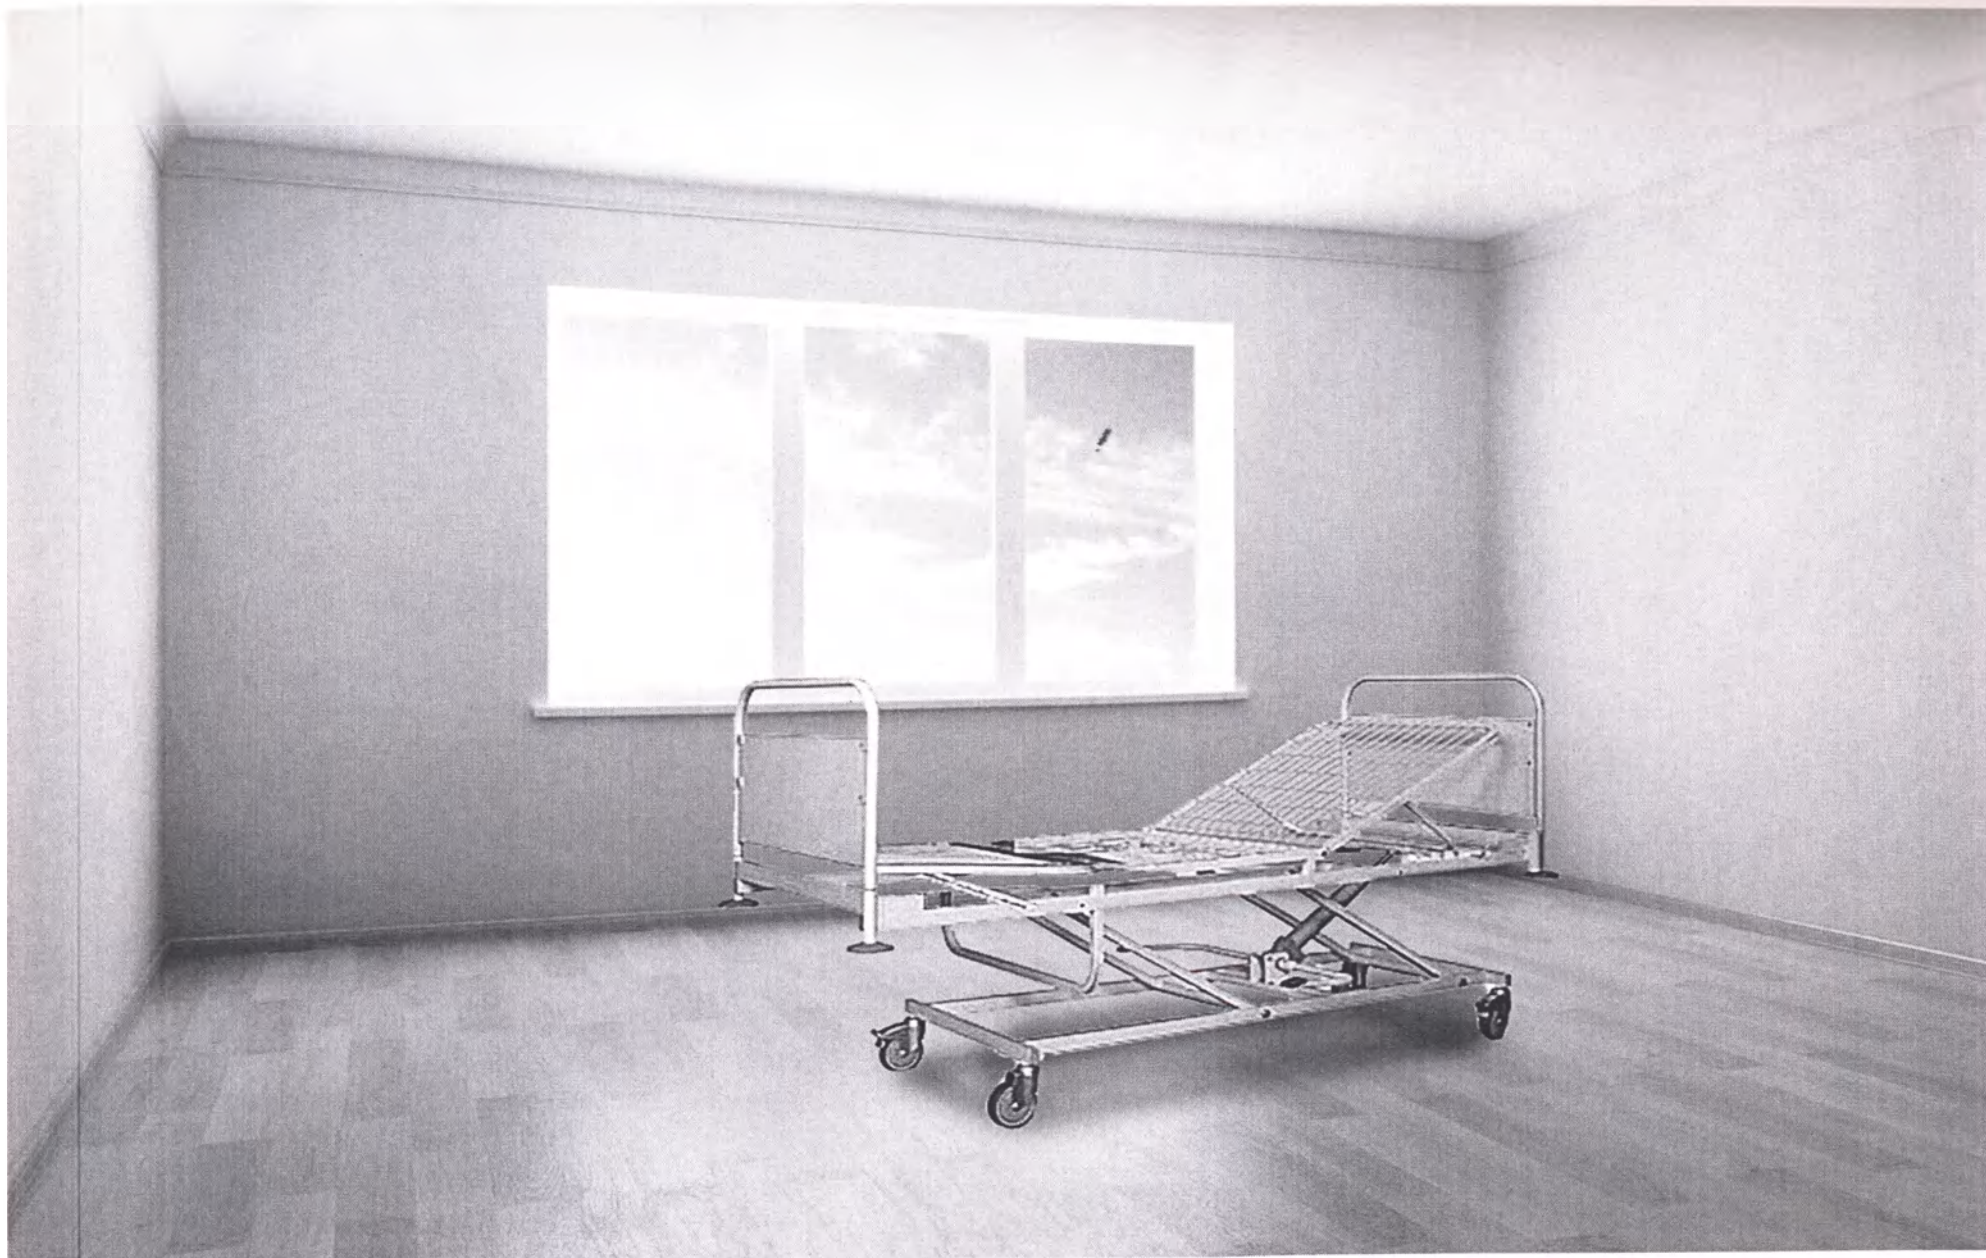






КФ - «Техстрой 4.14»; КФ - «Техстрой 4.15»; КФ - «Техстрой 4.16»




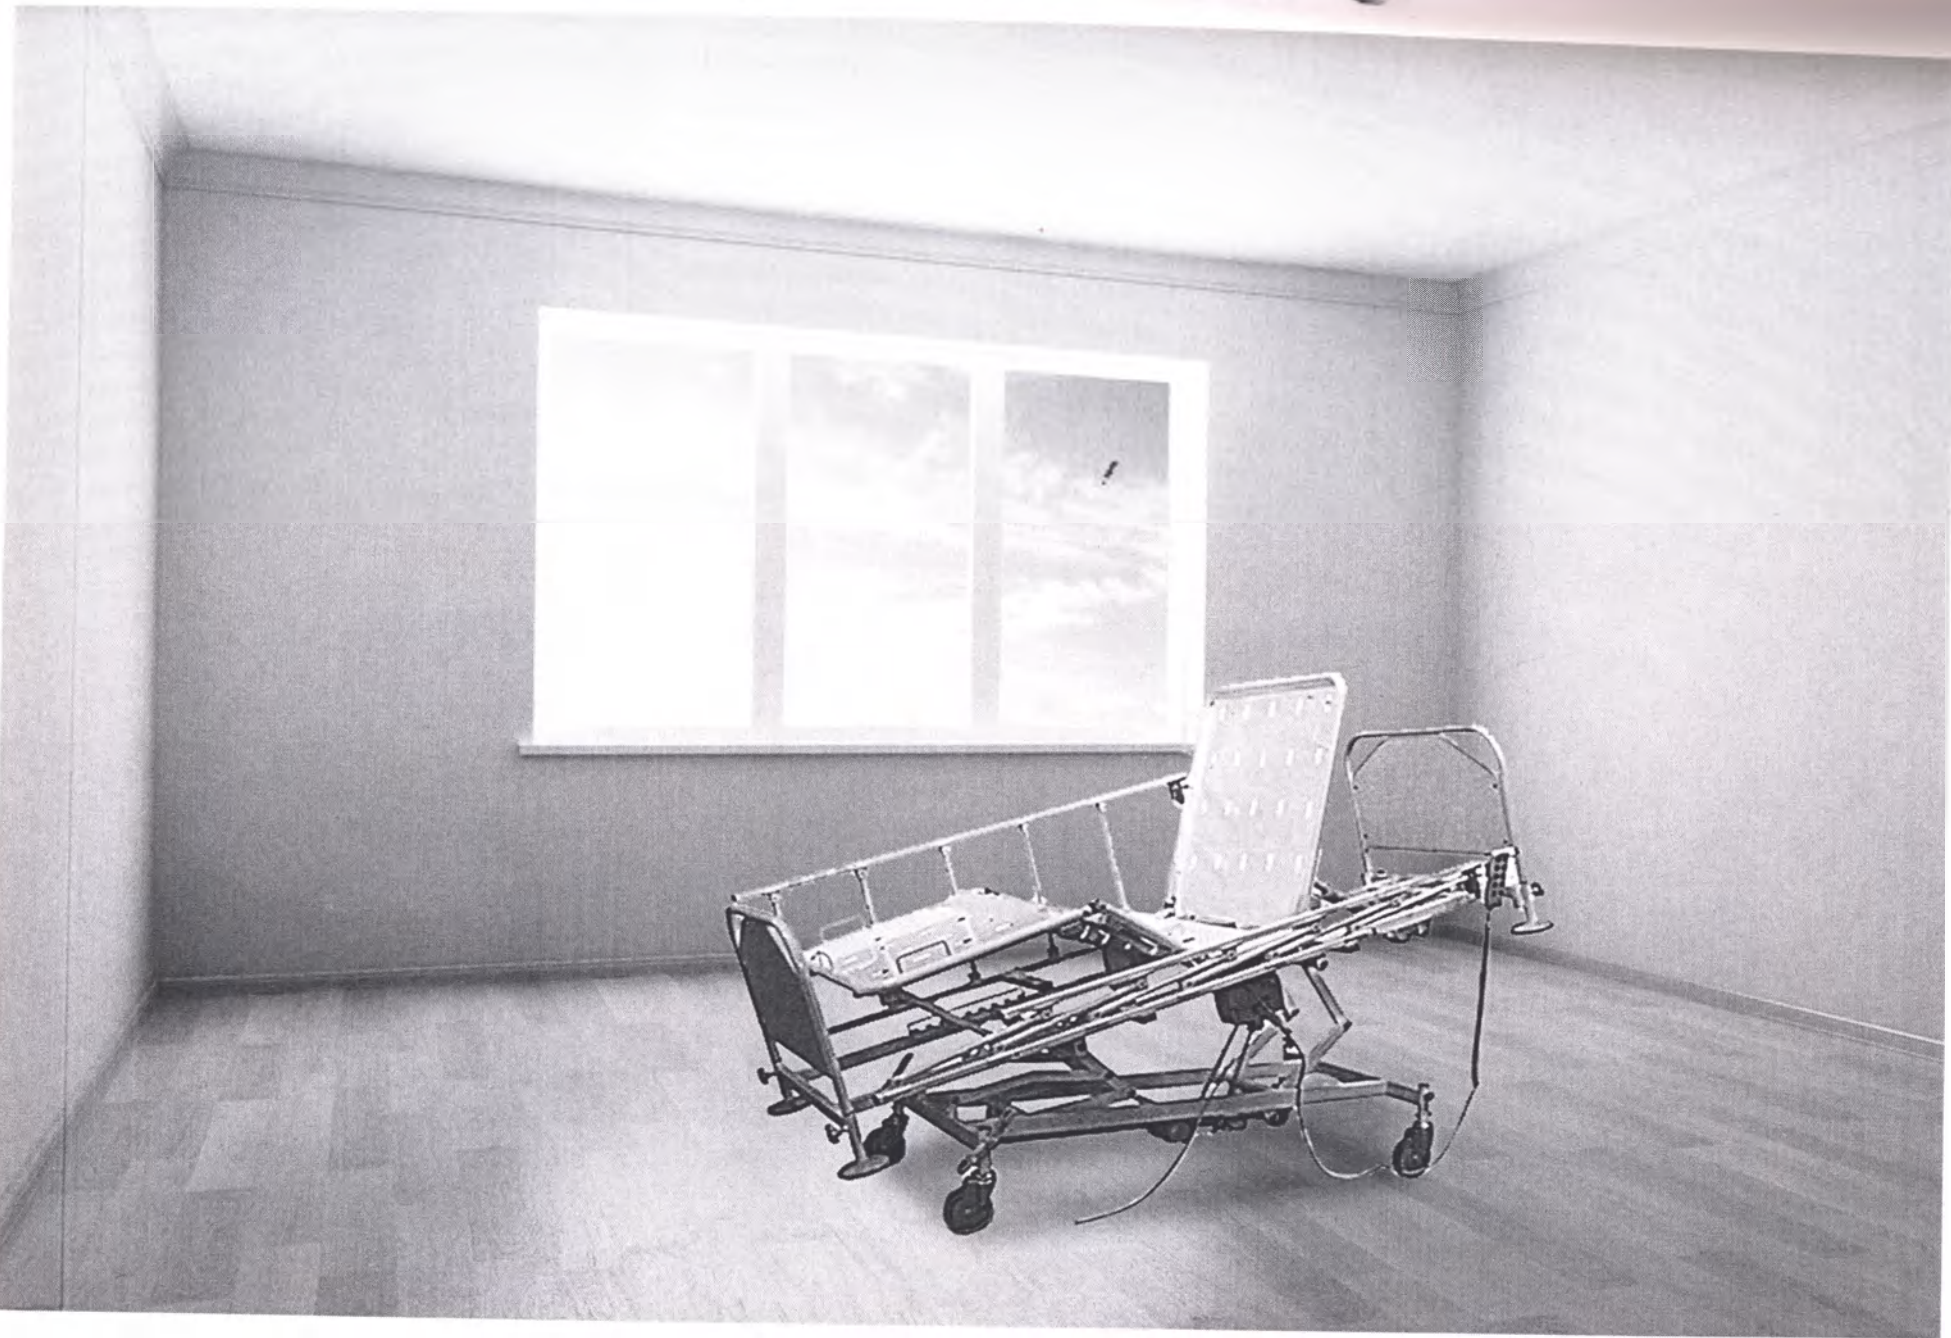


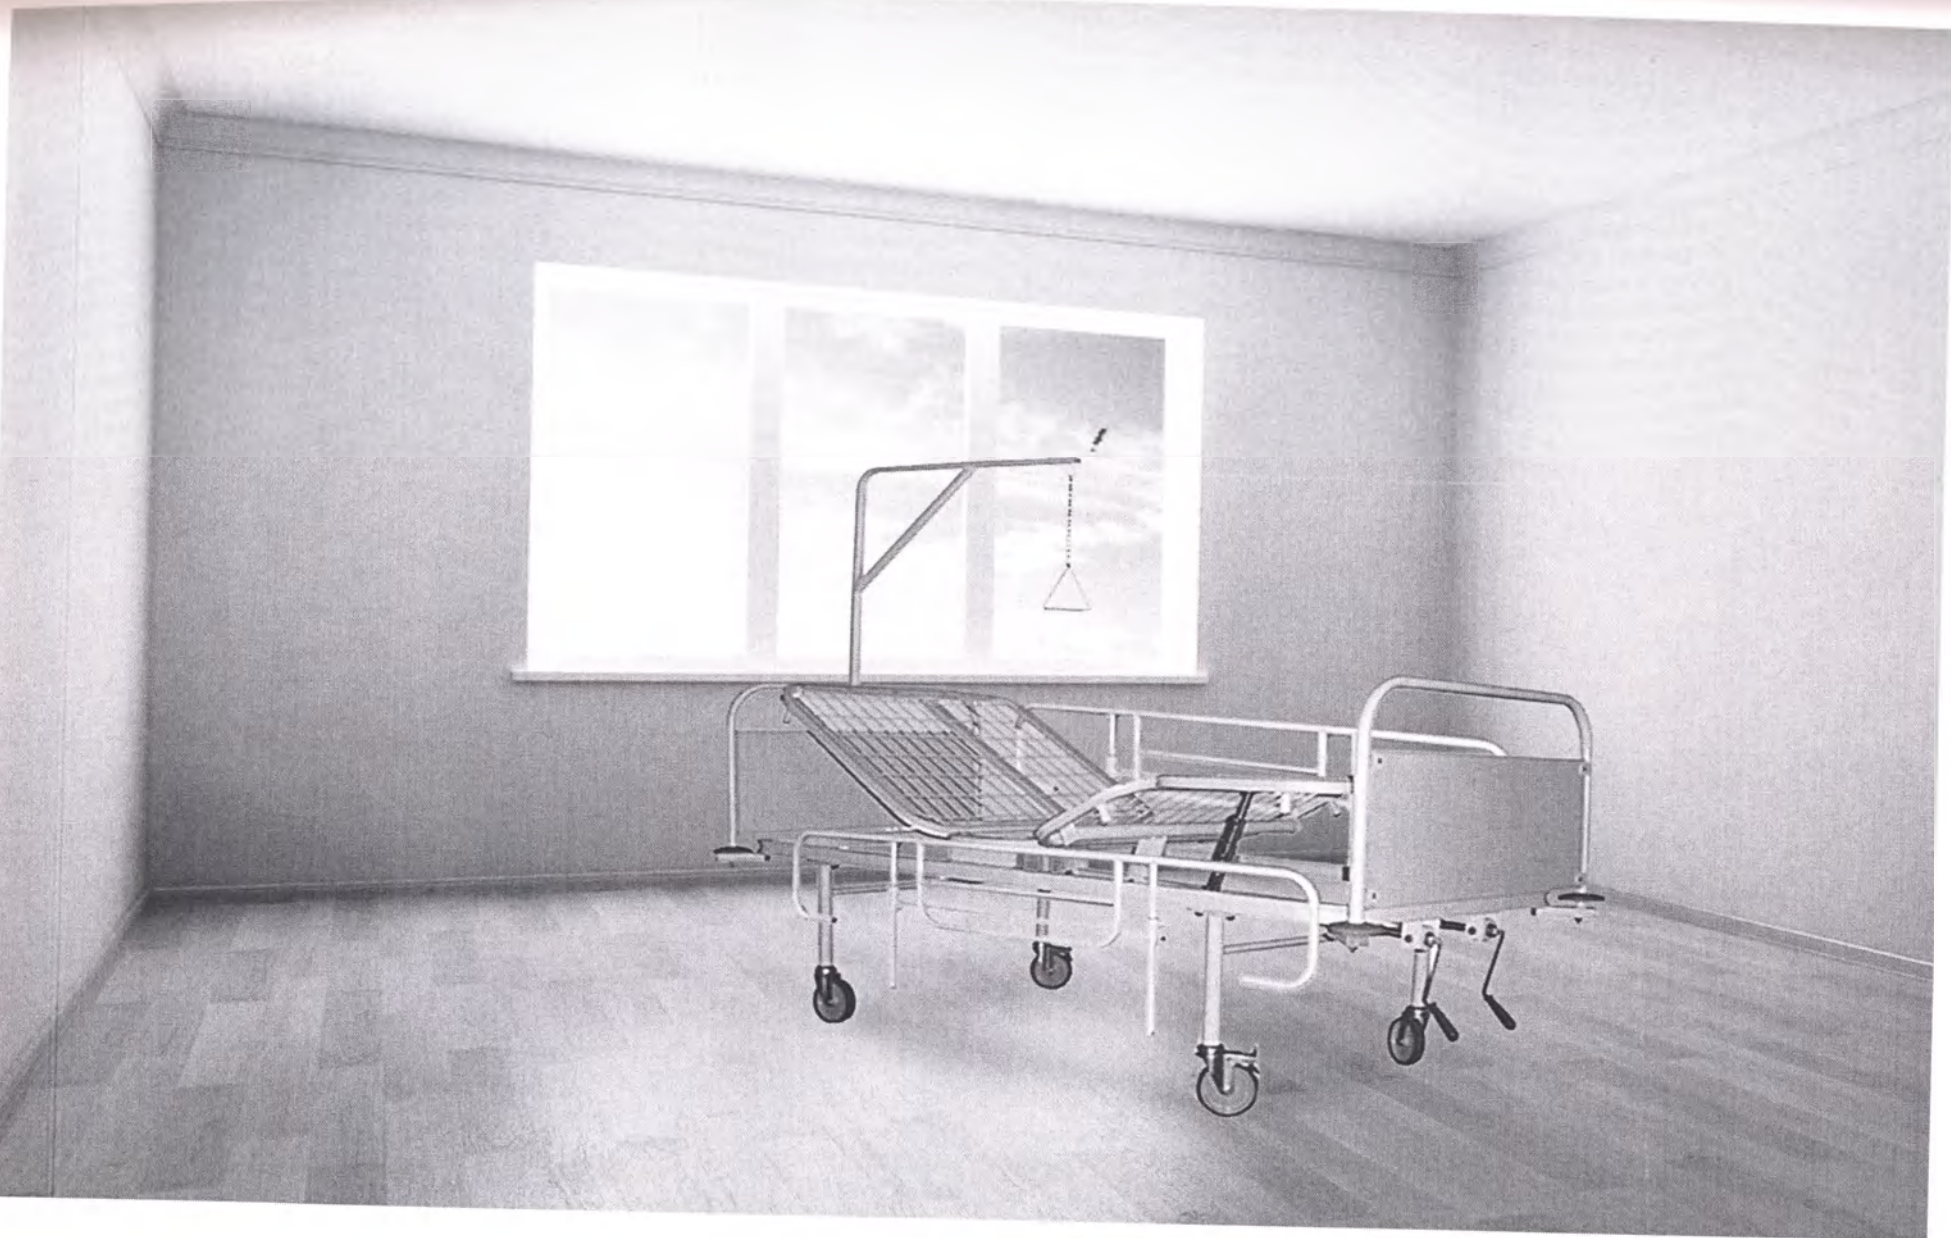


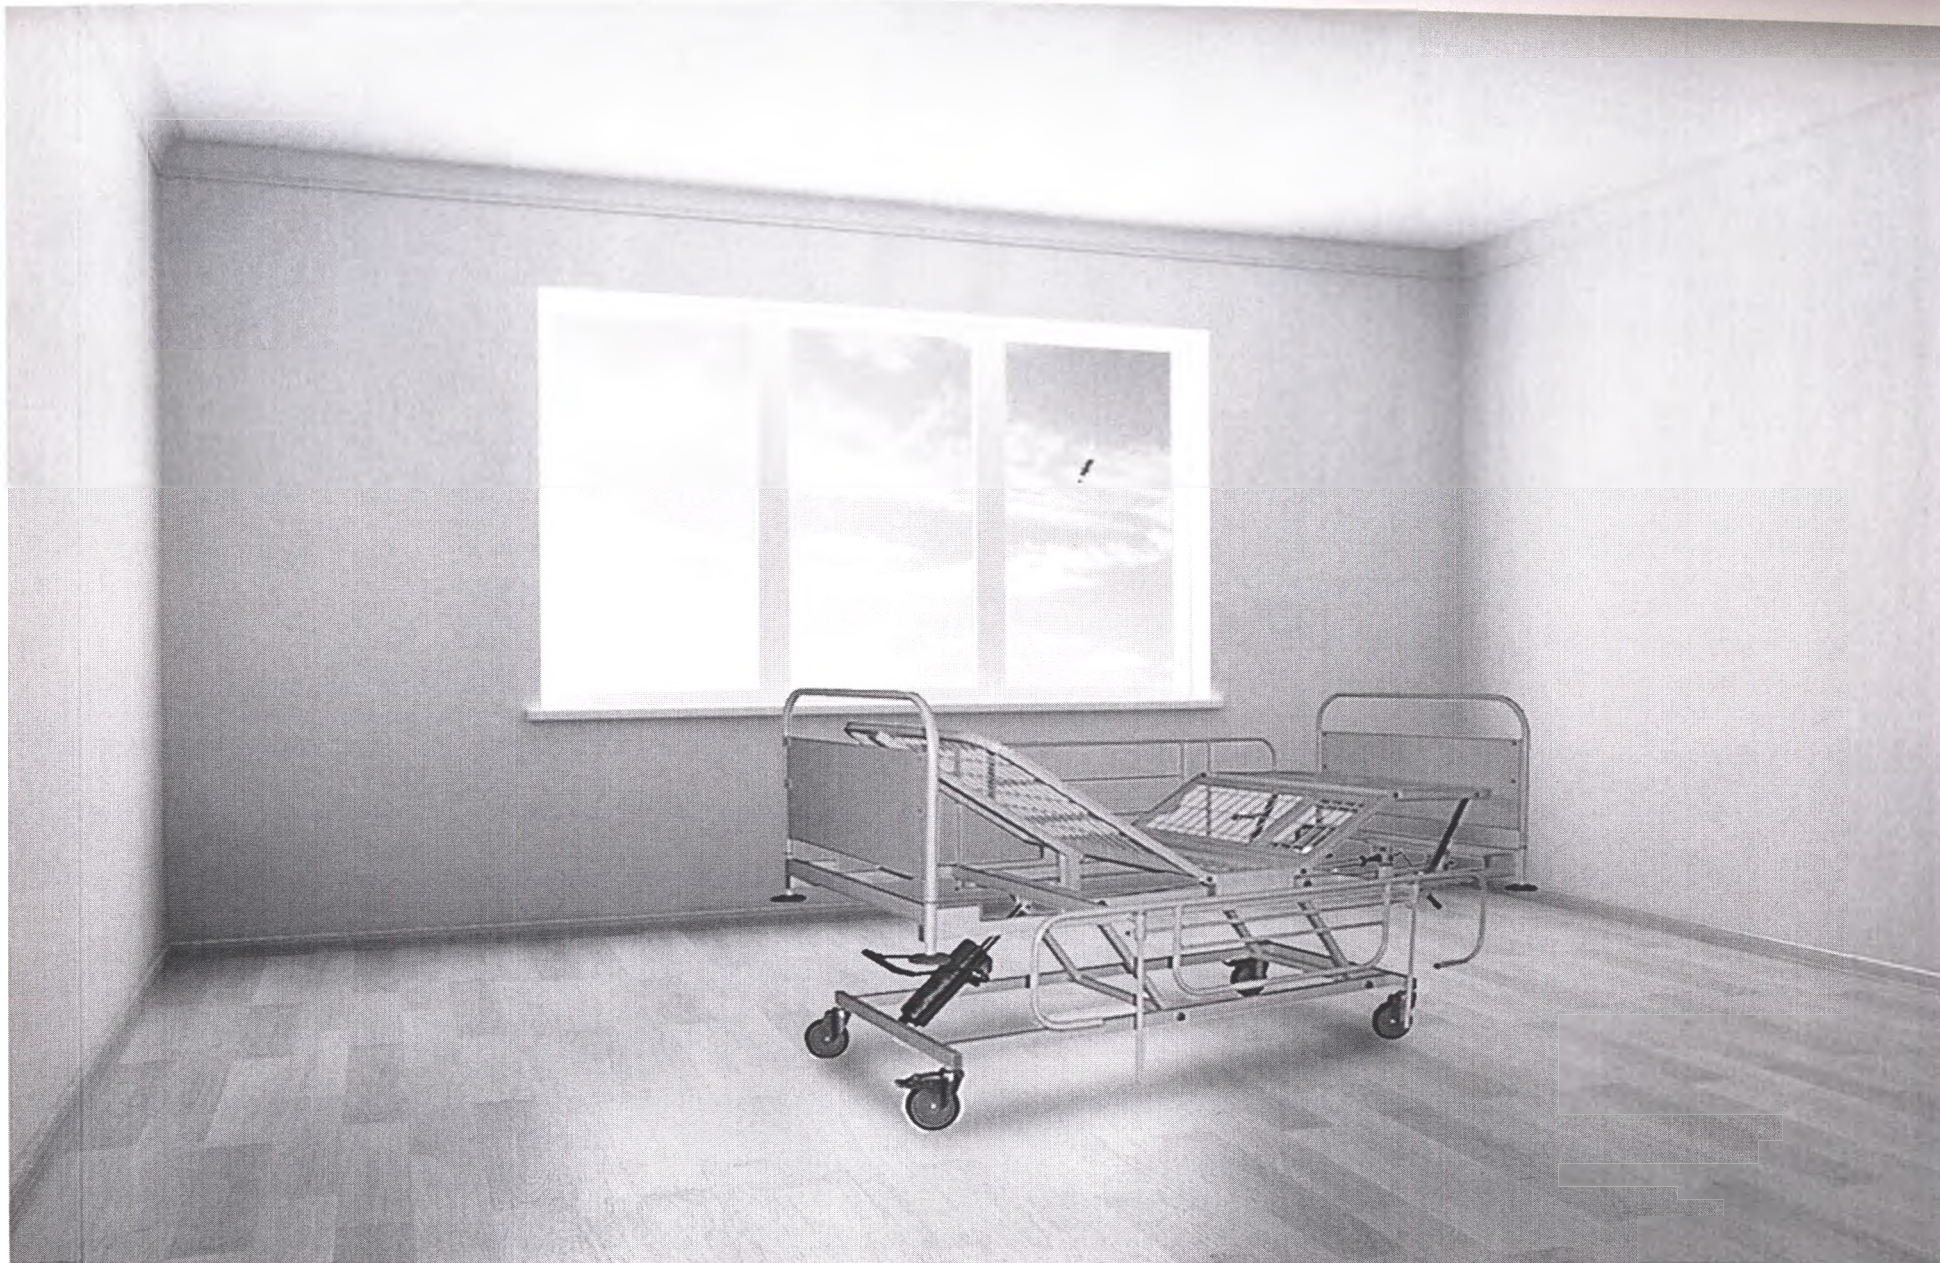


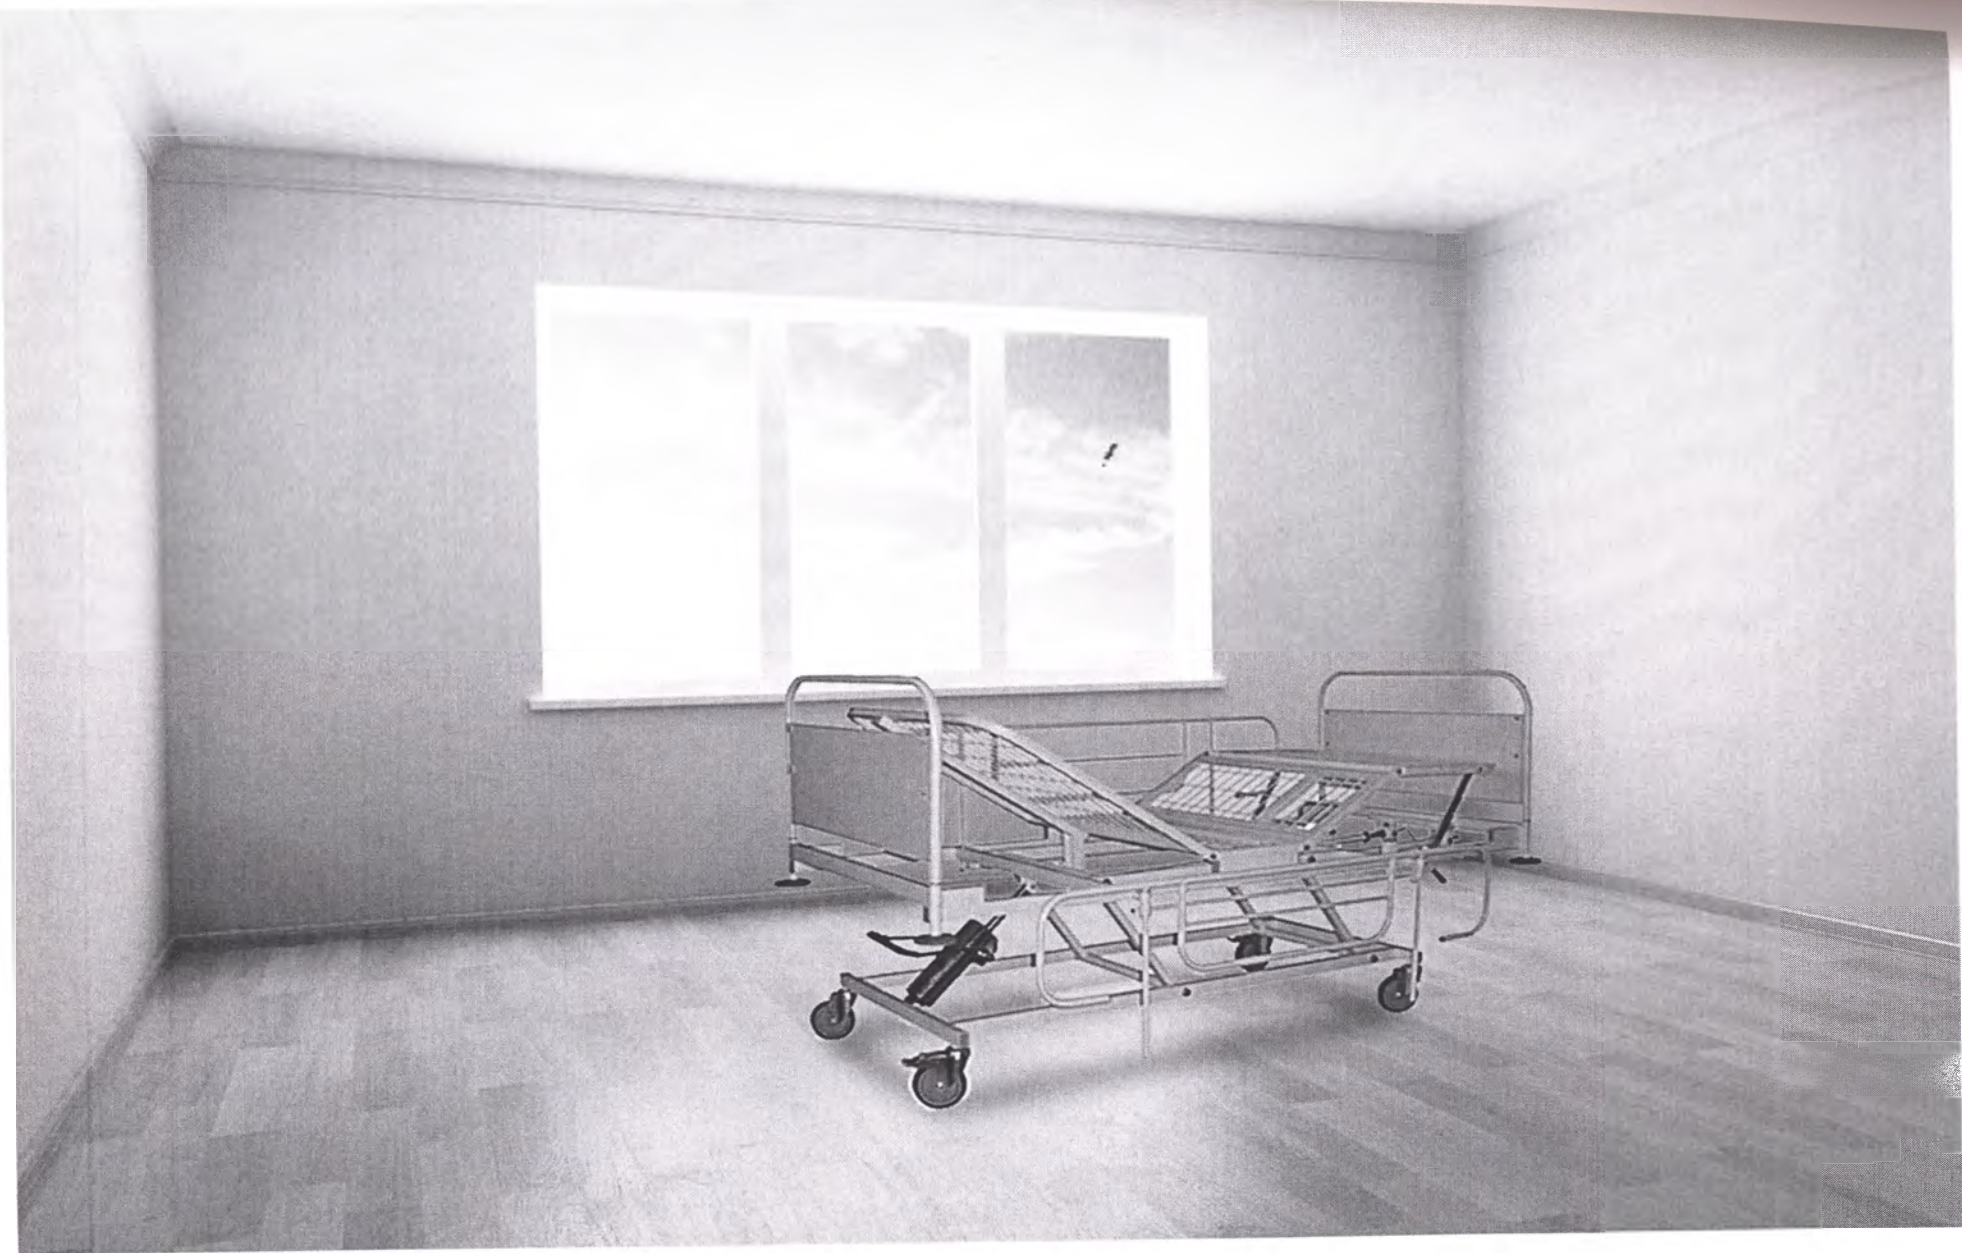


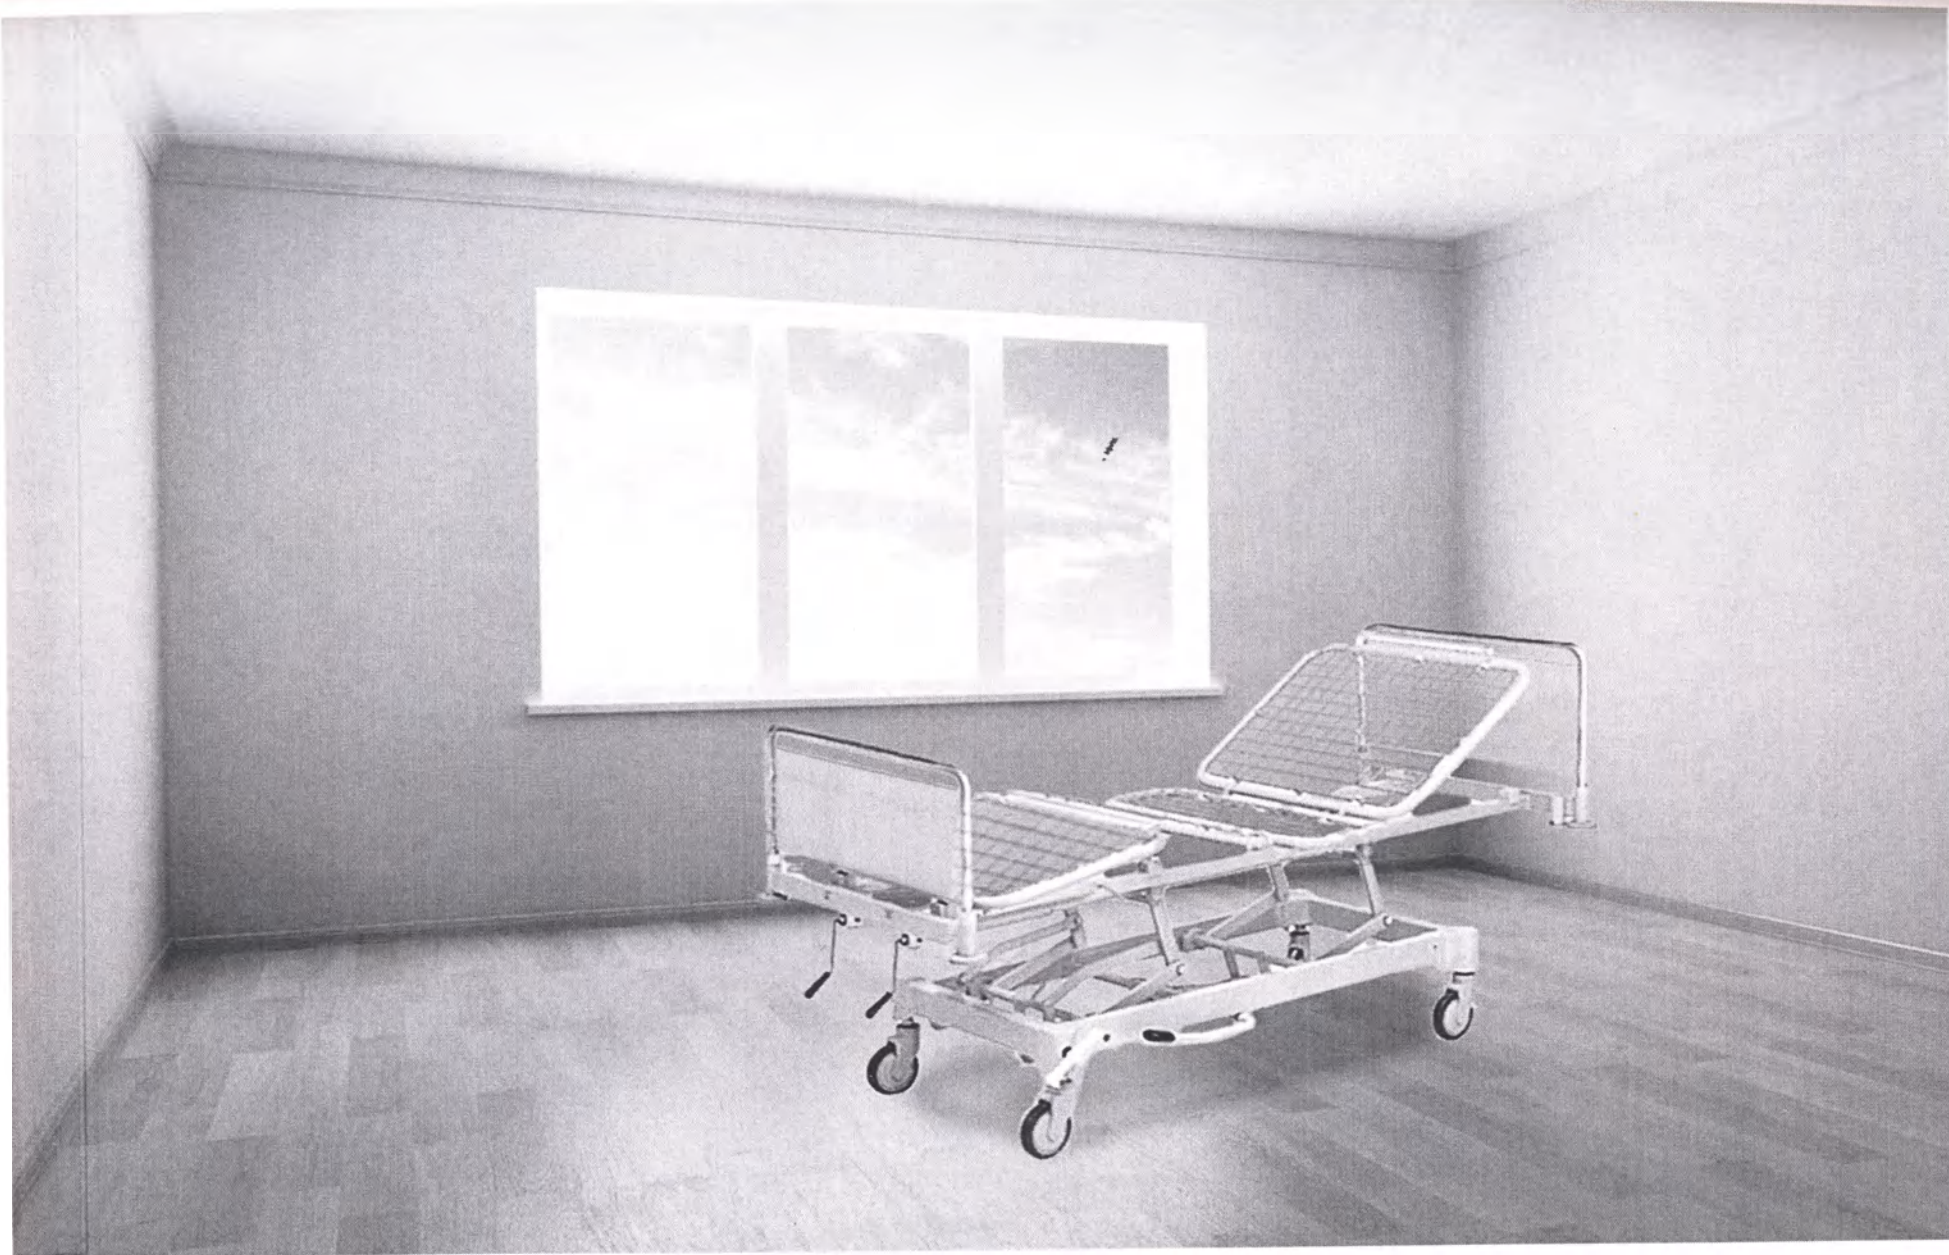


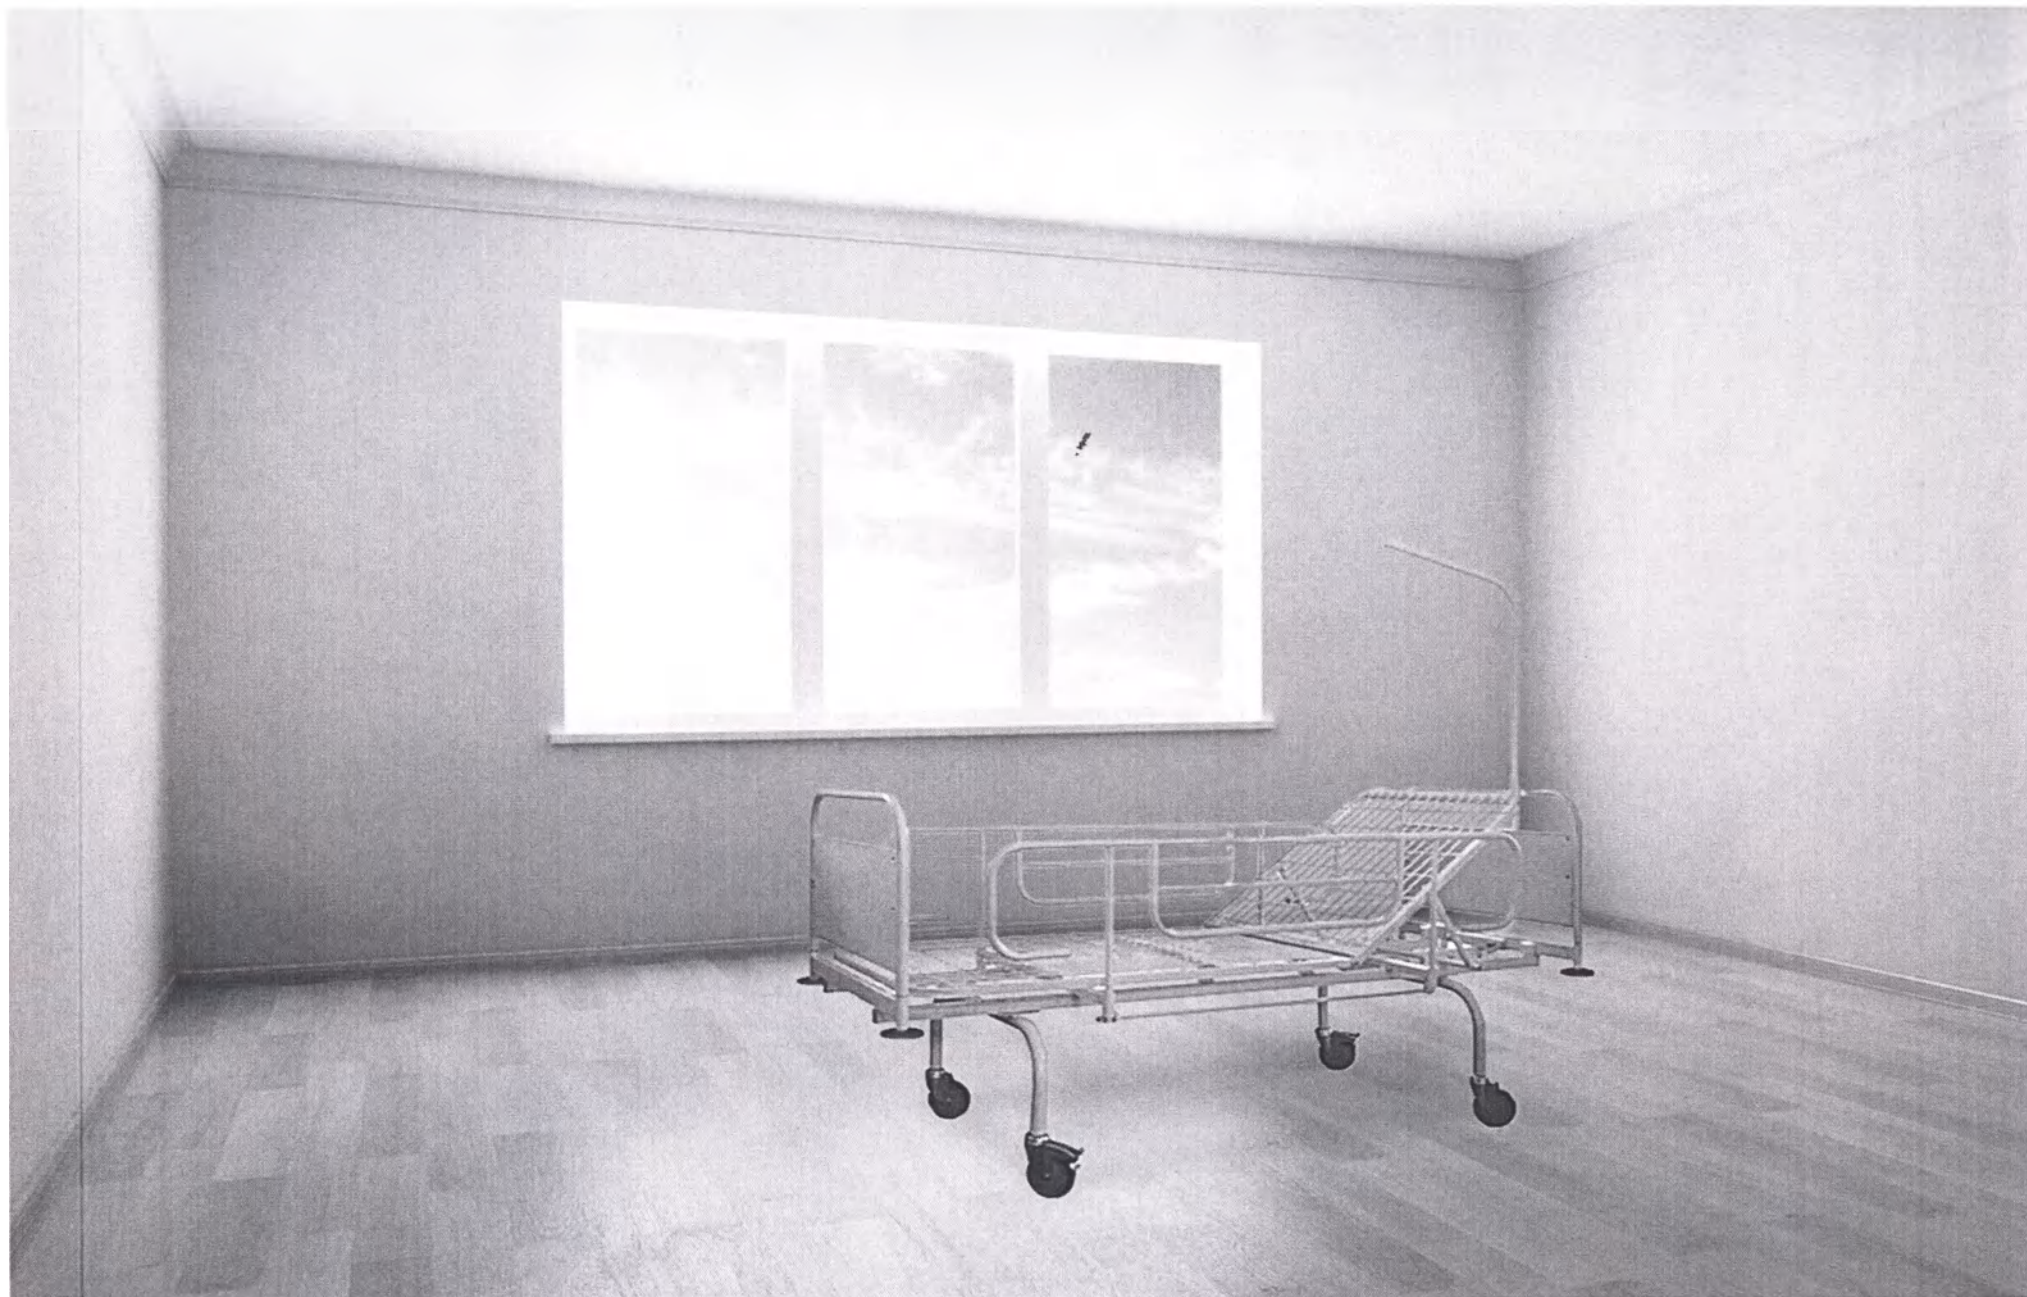

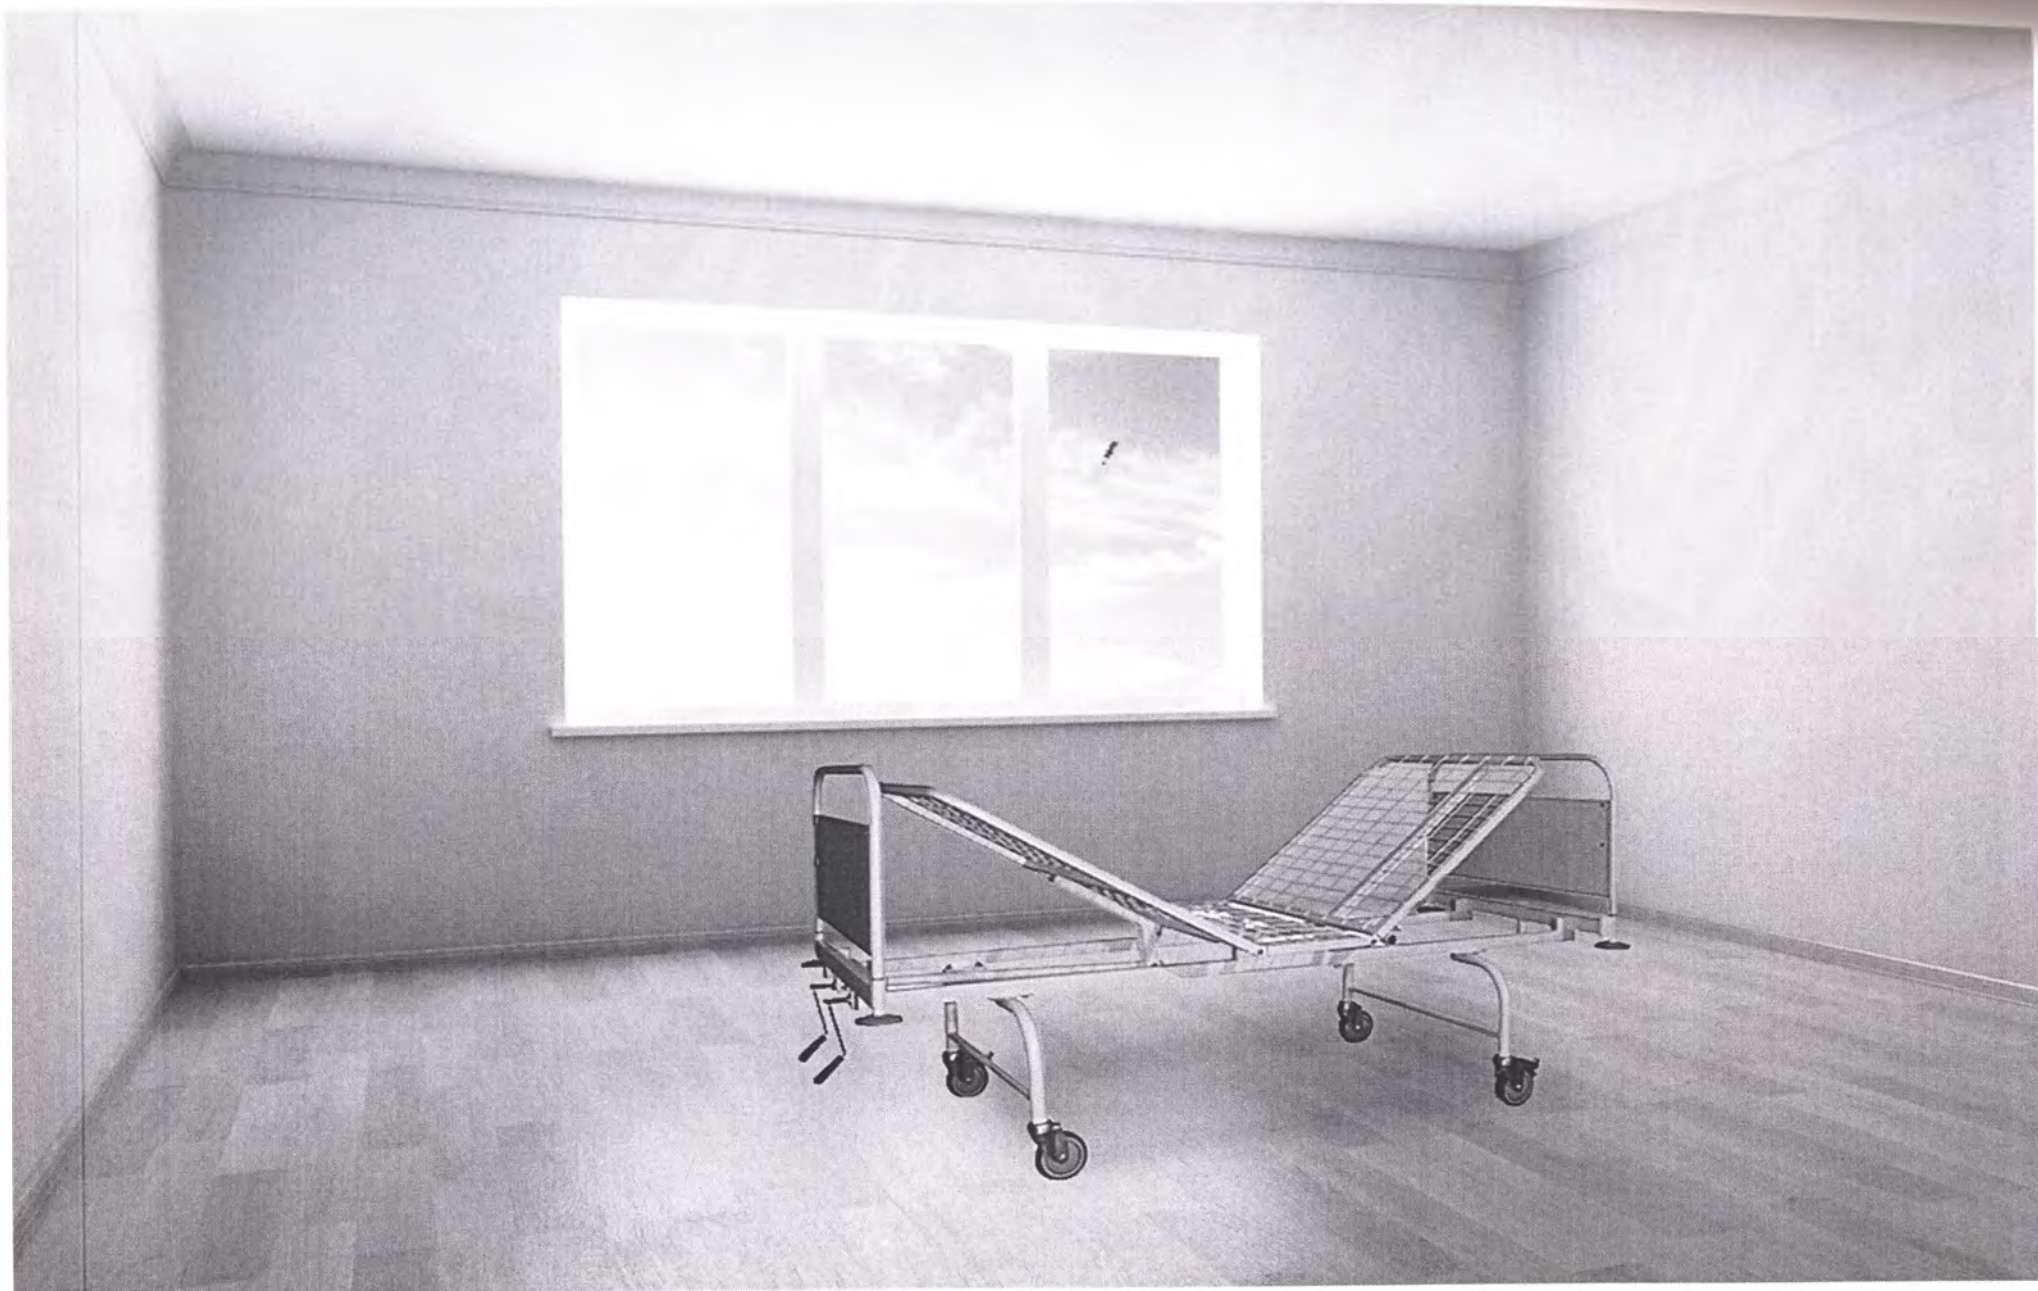

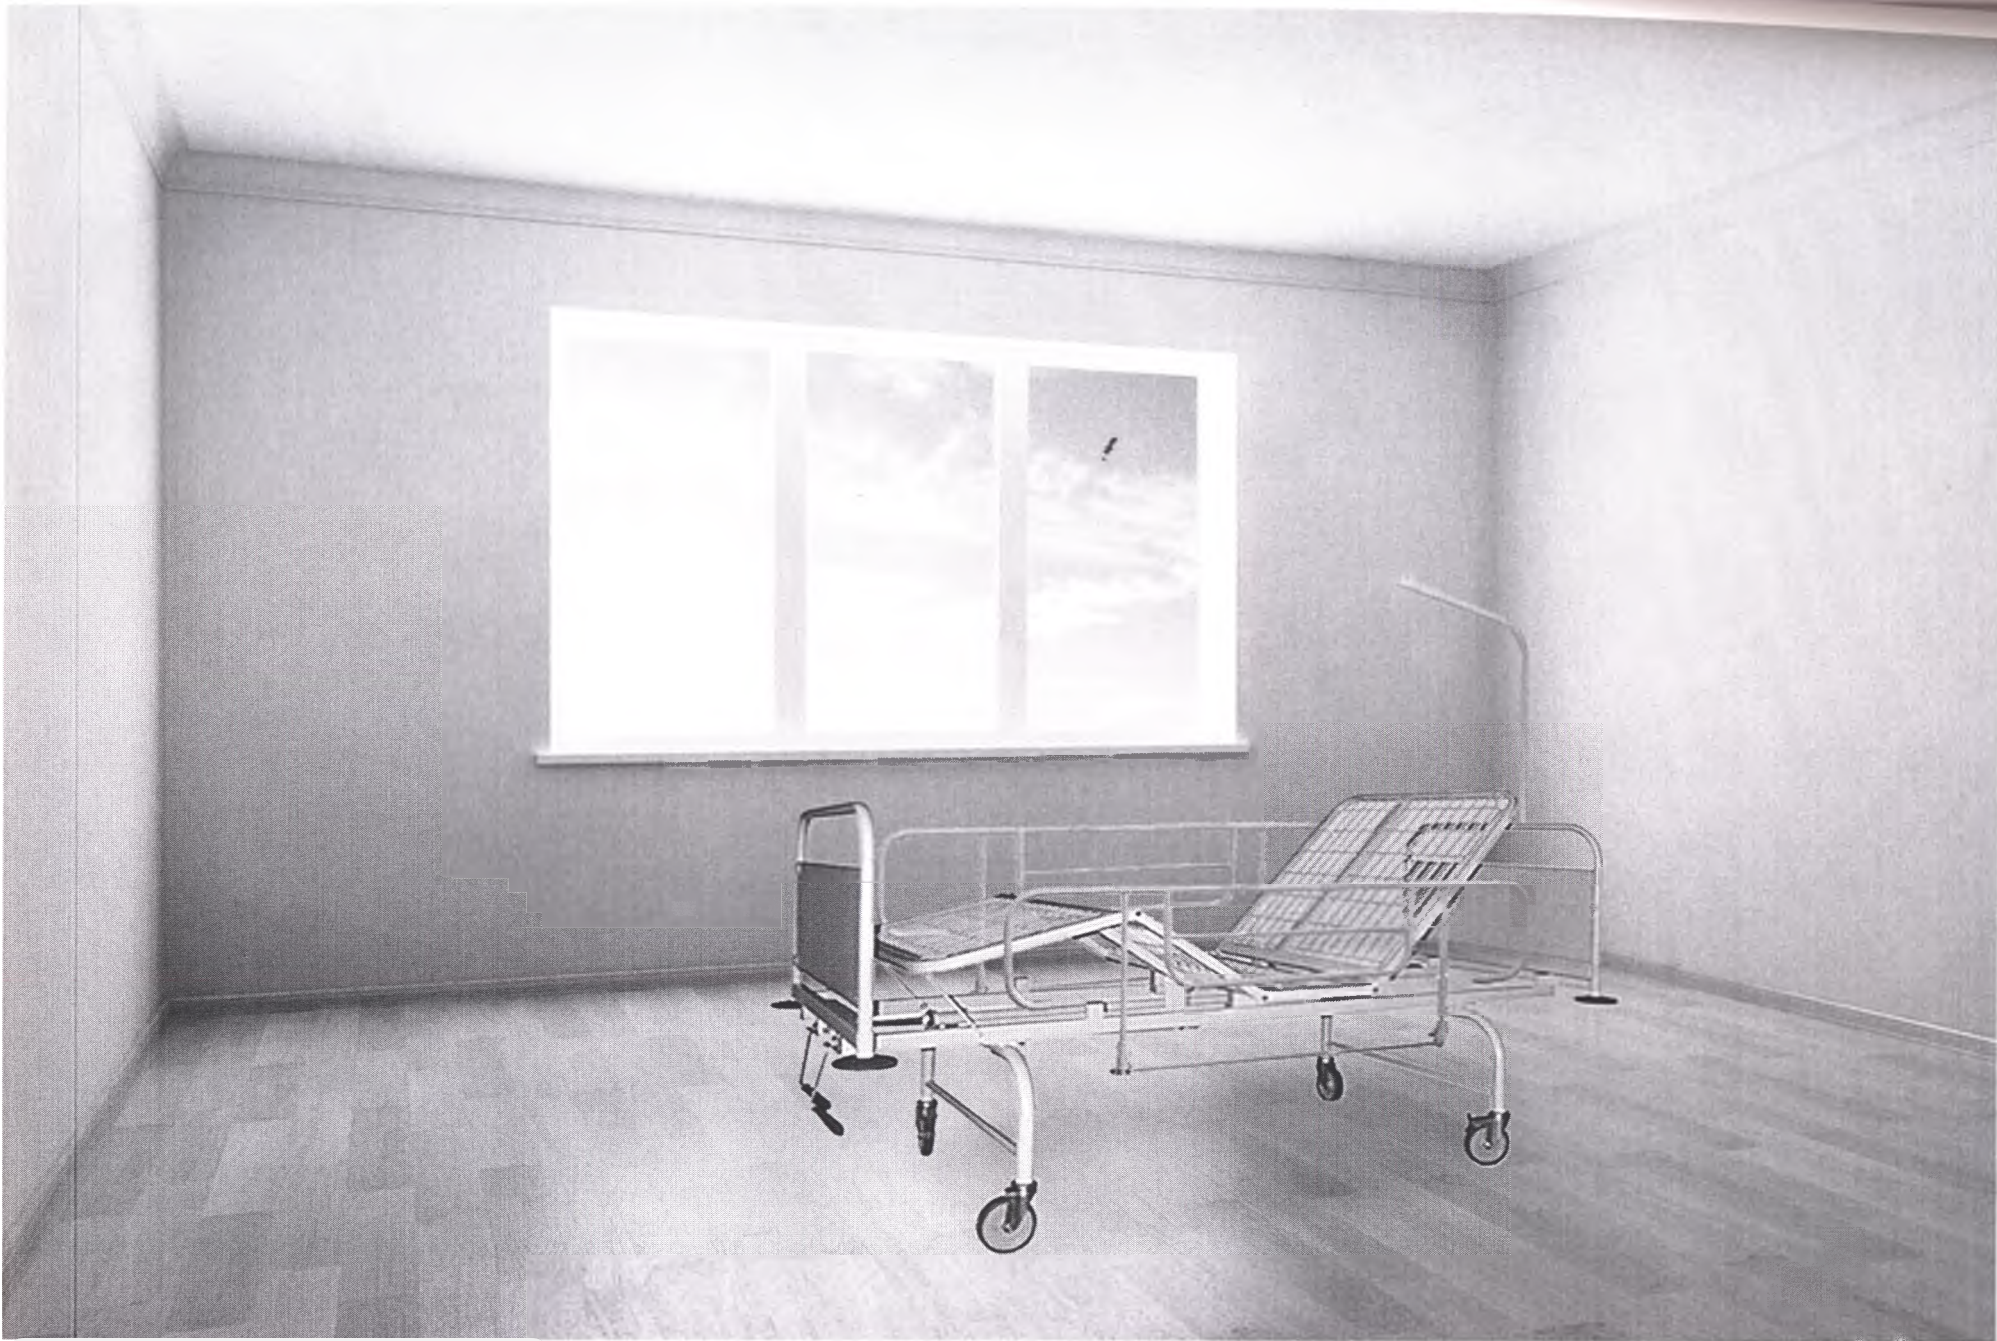


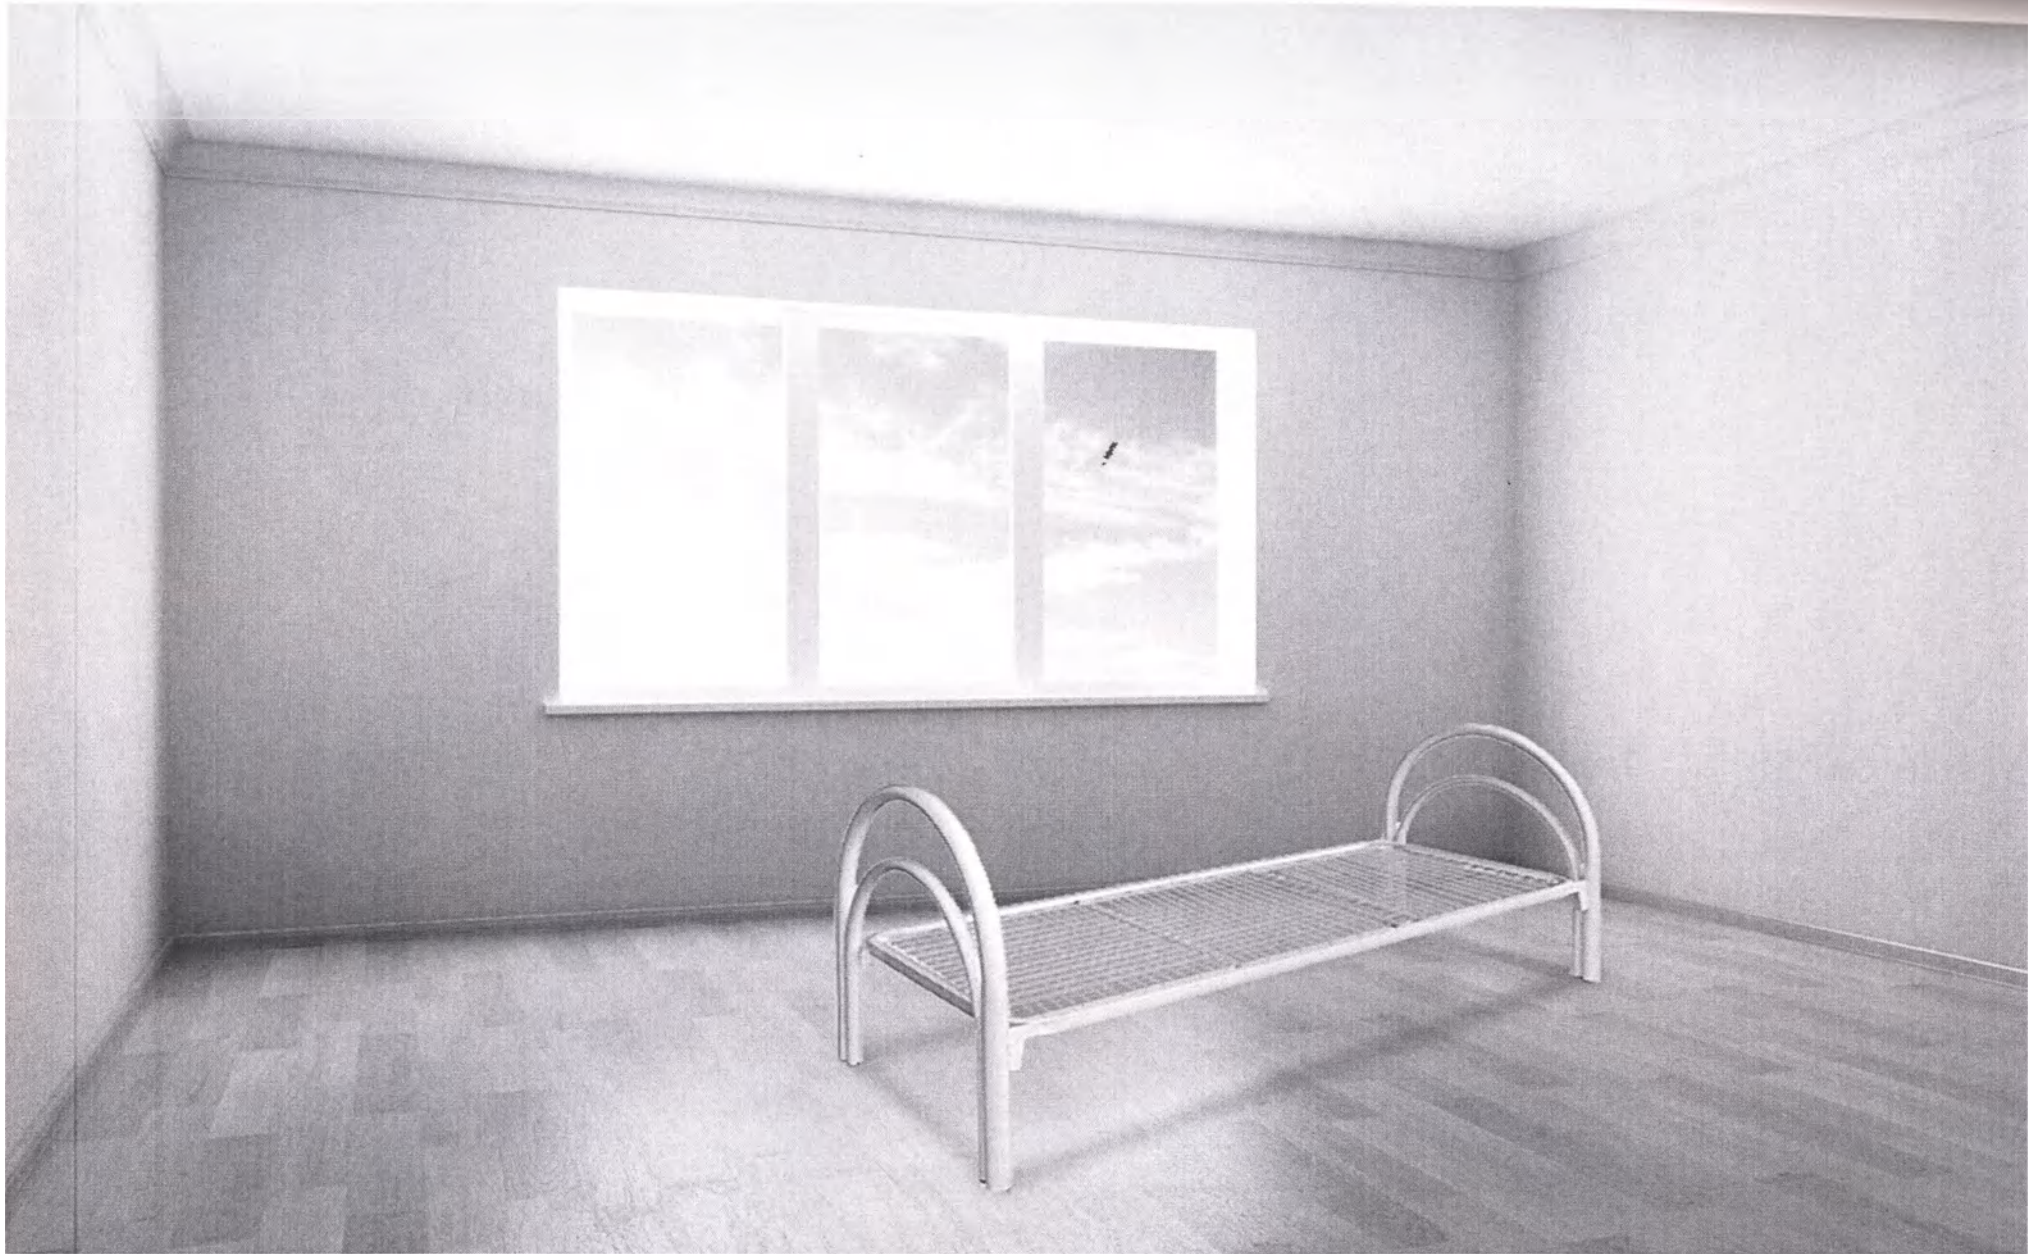

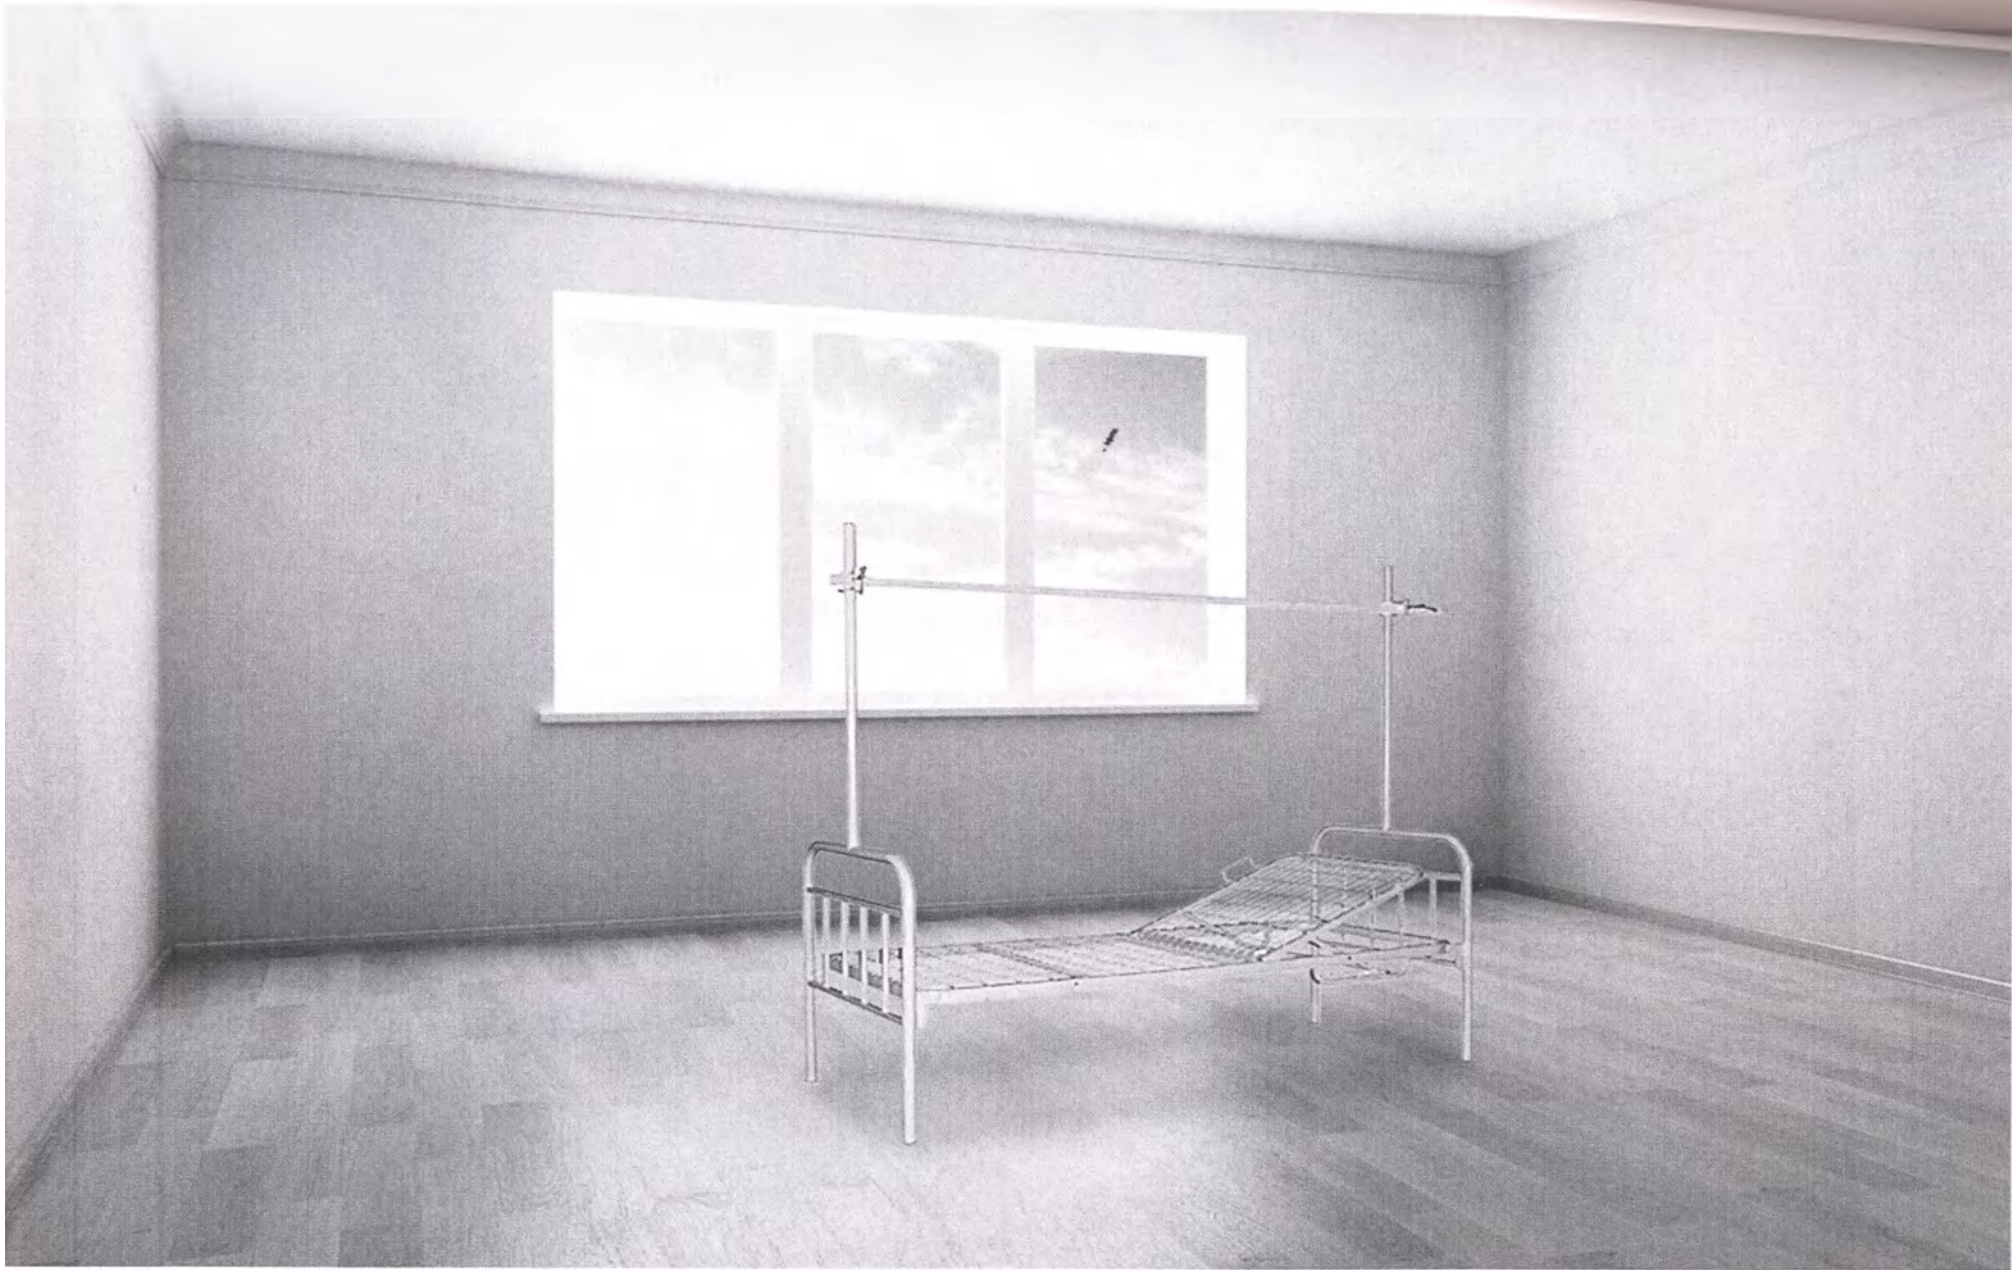



КФ - «Техстрой 6.06», КФ - «Техстрой 6.07», КФ - «Техстрой 6.08»




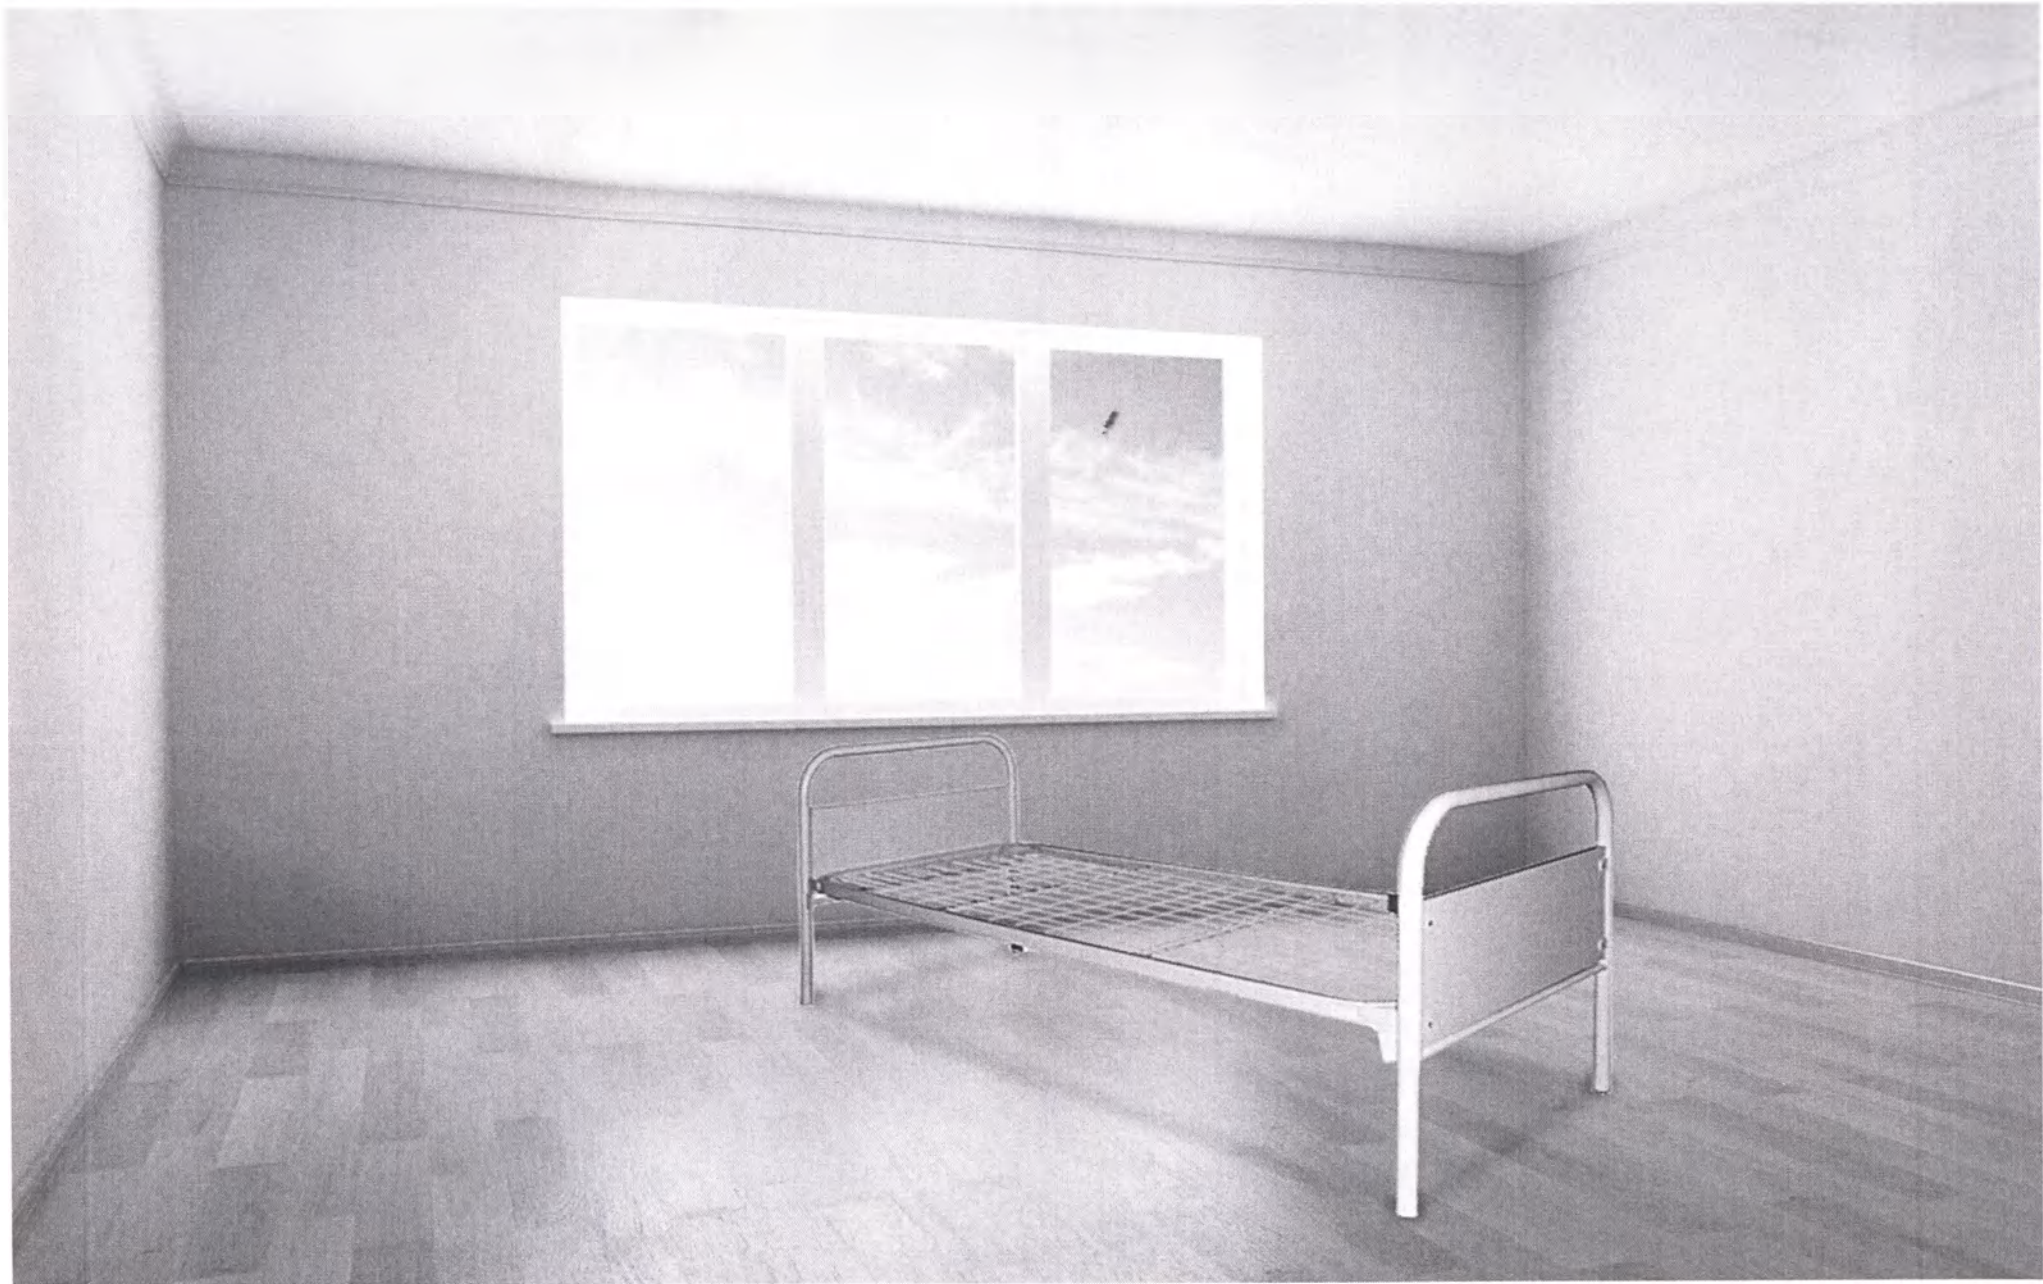





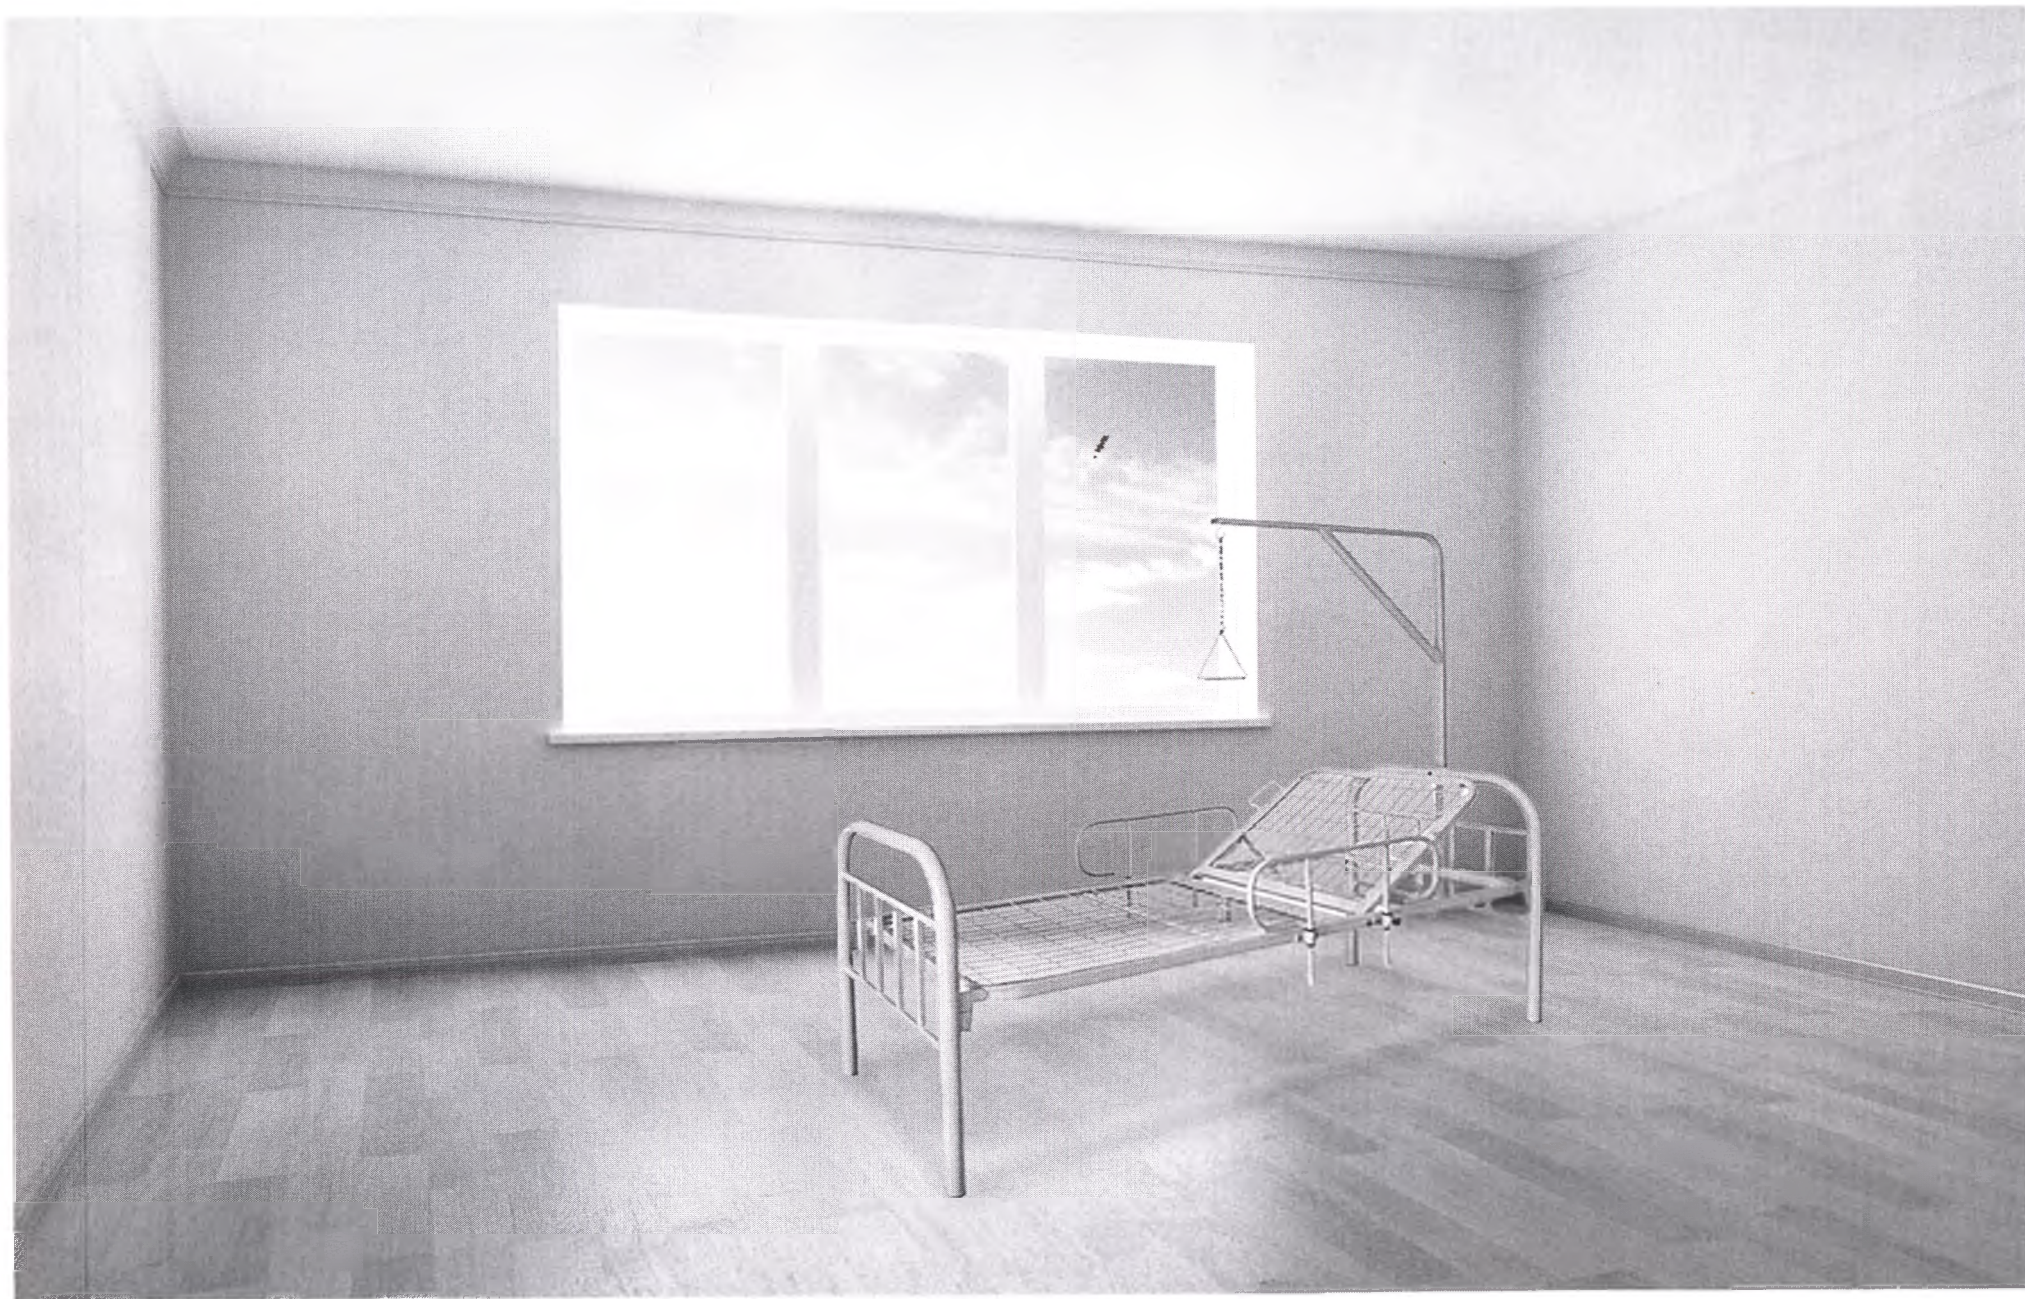

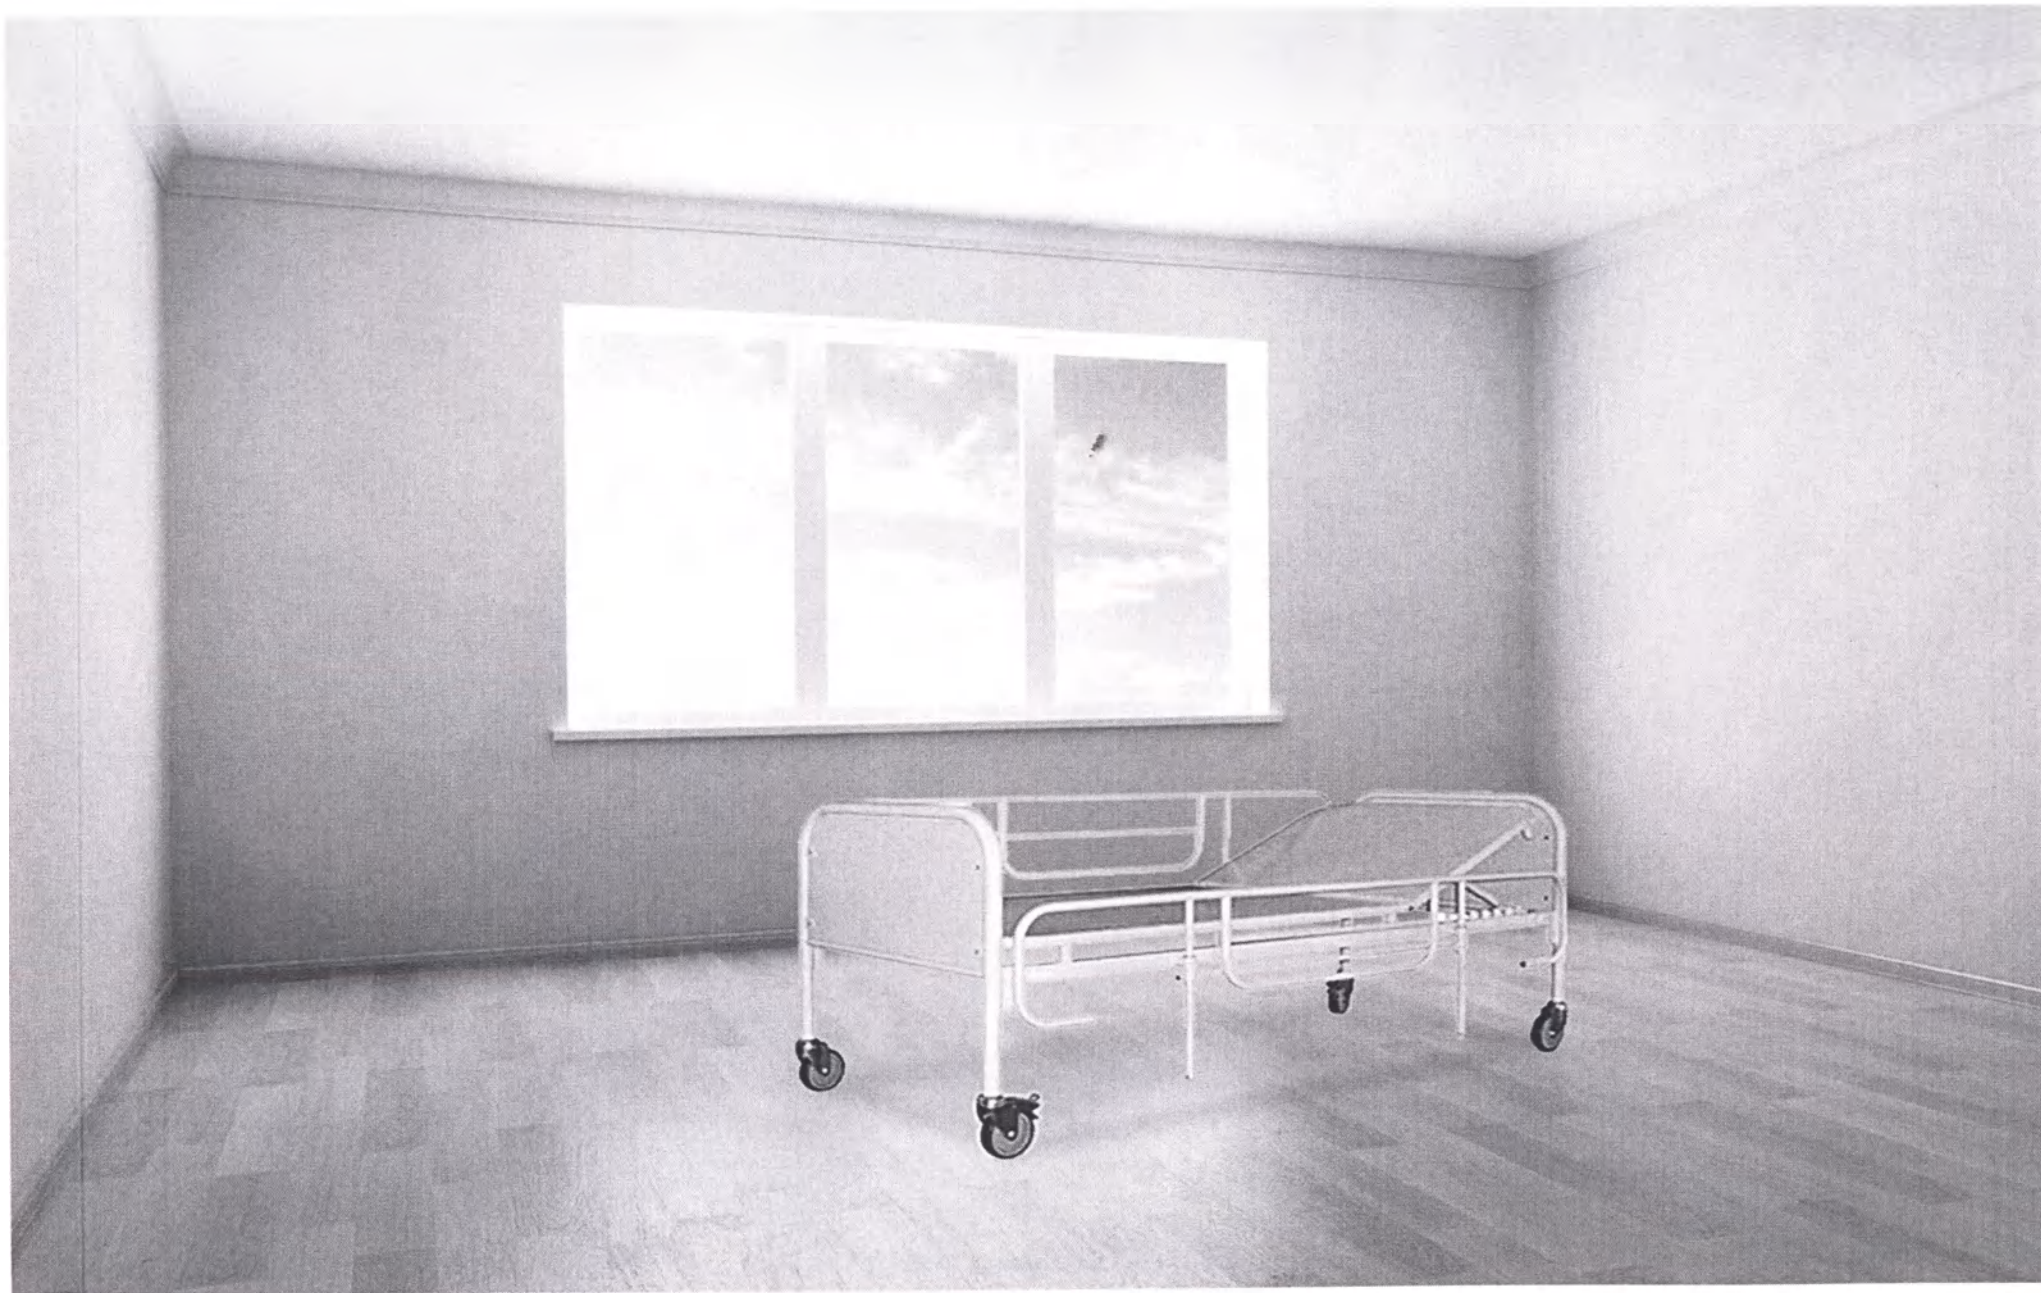

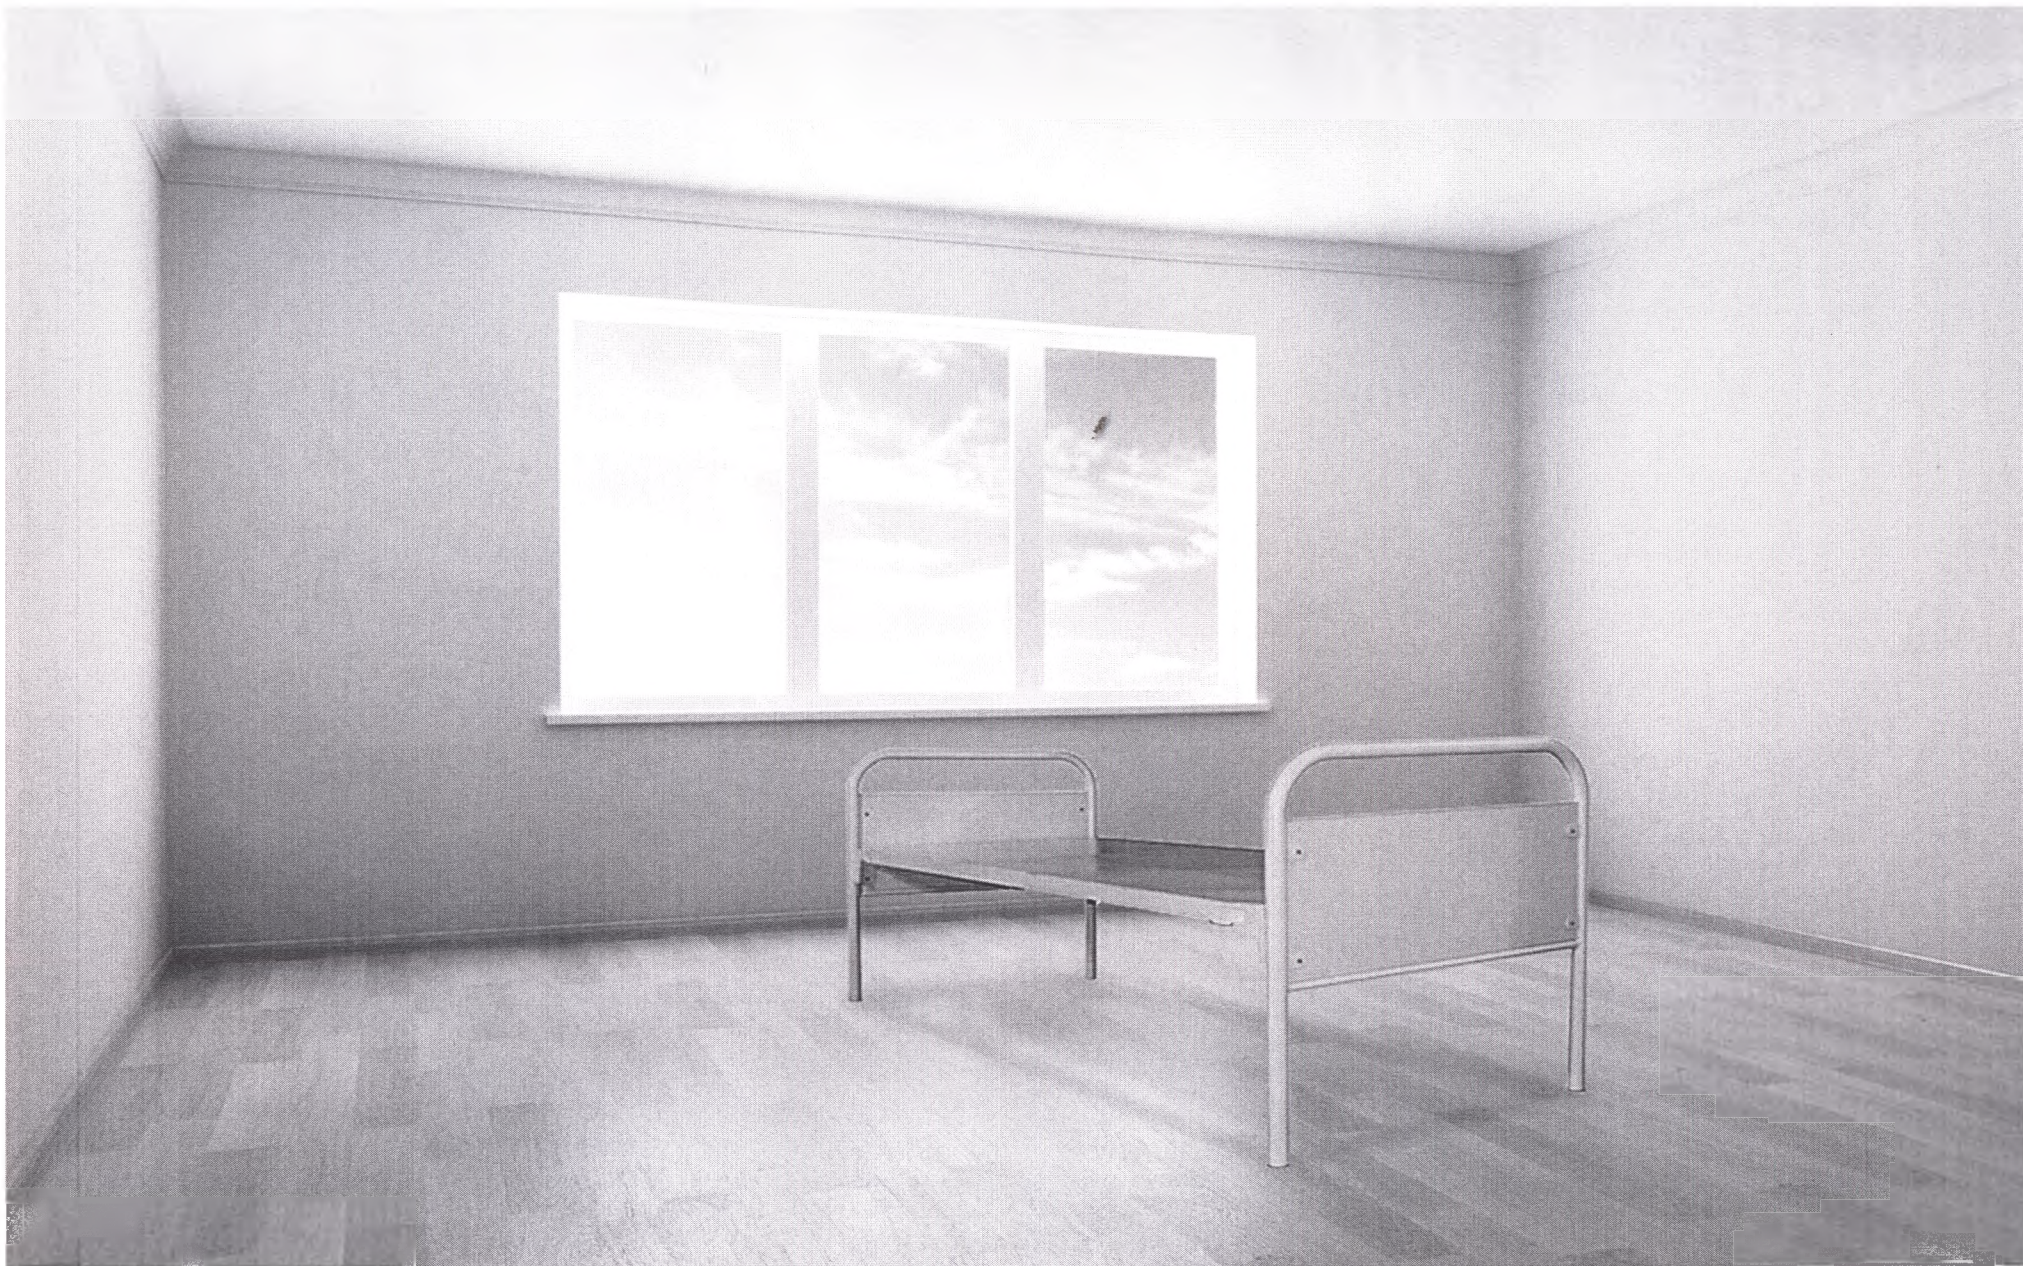

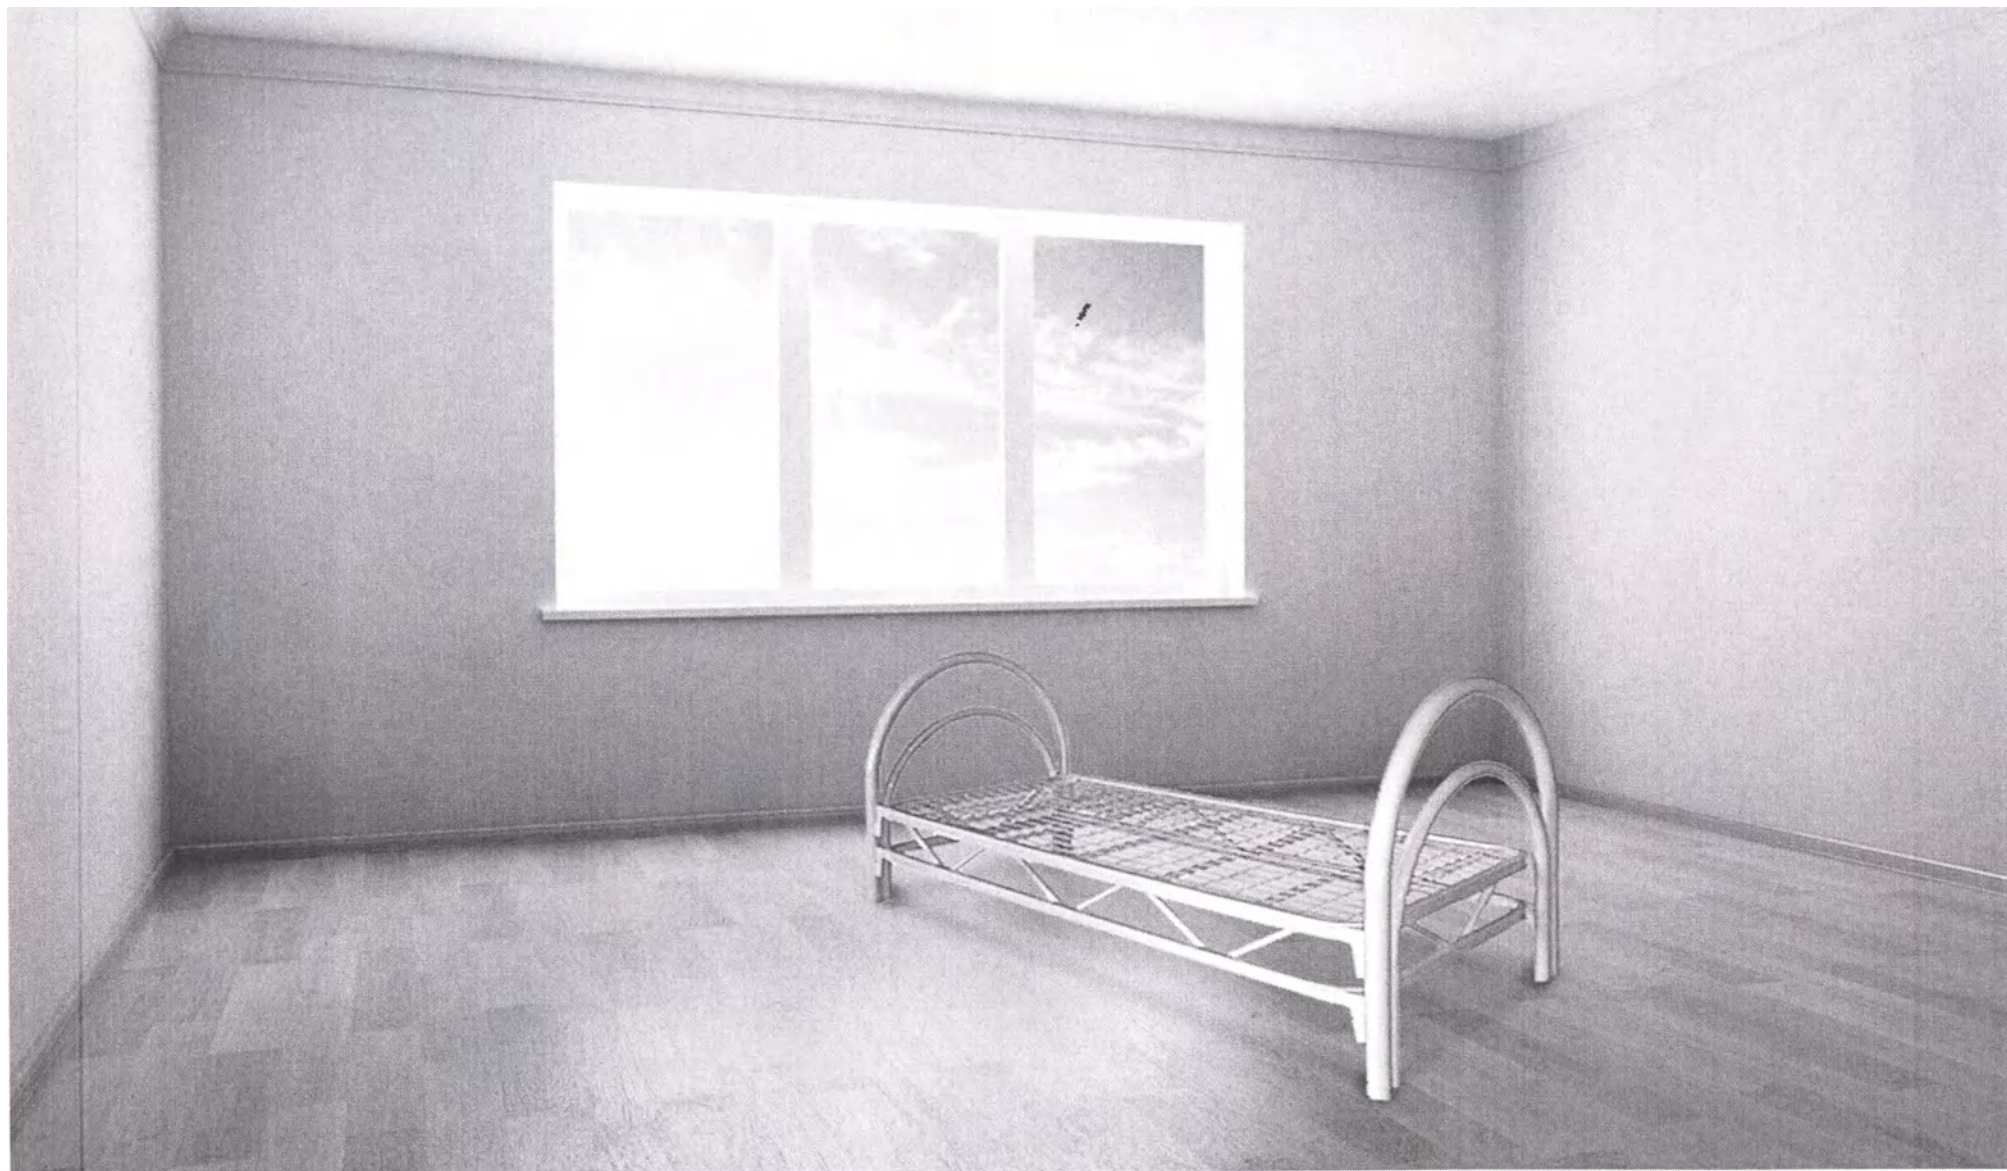

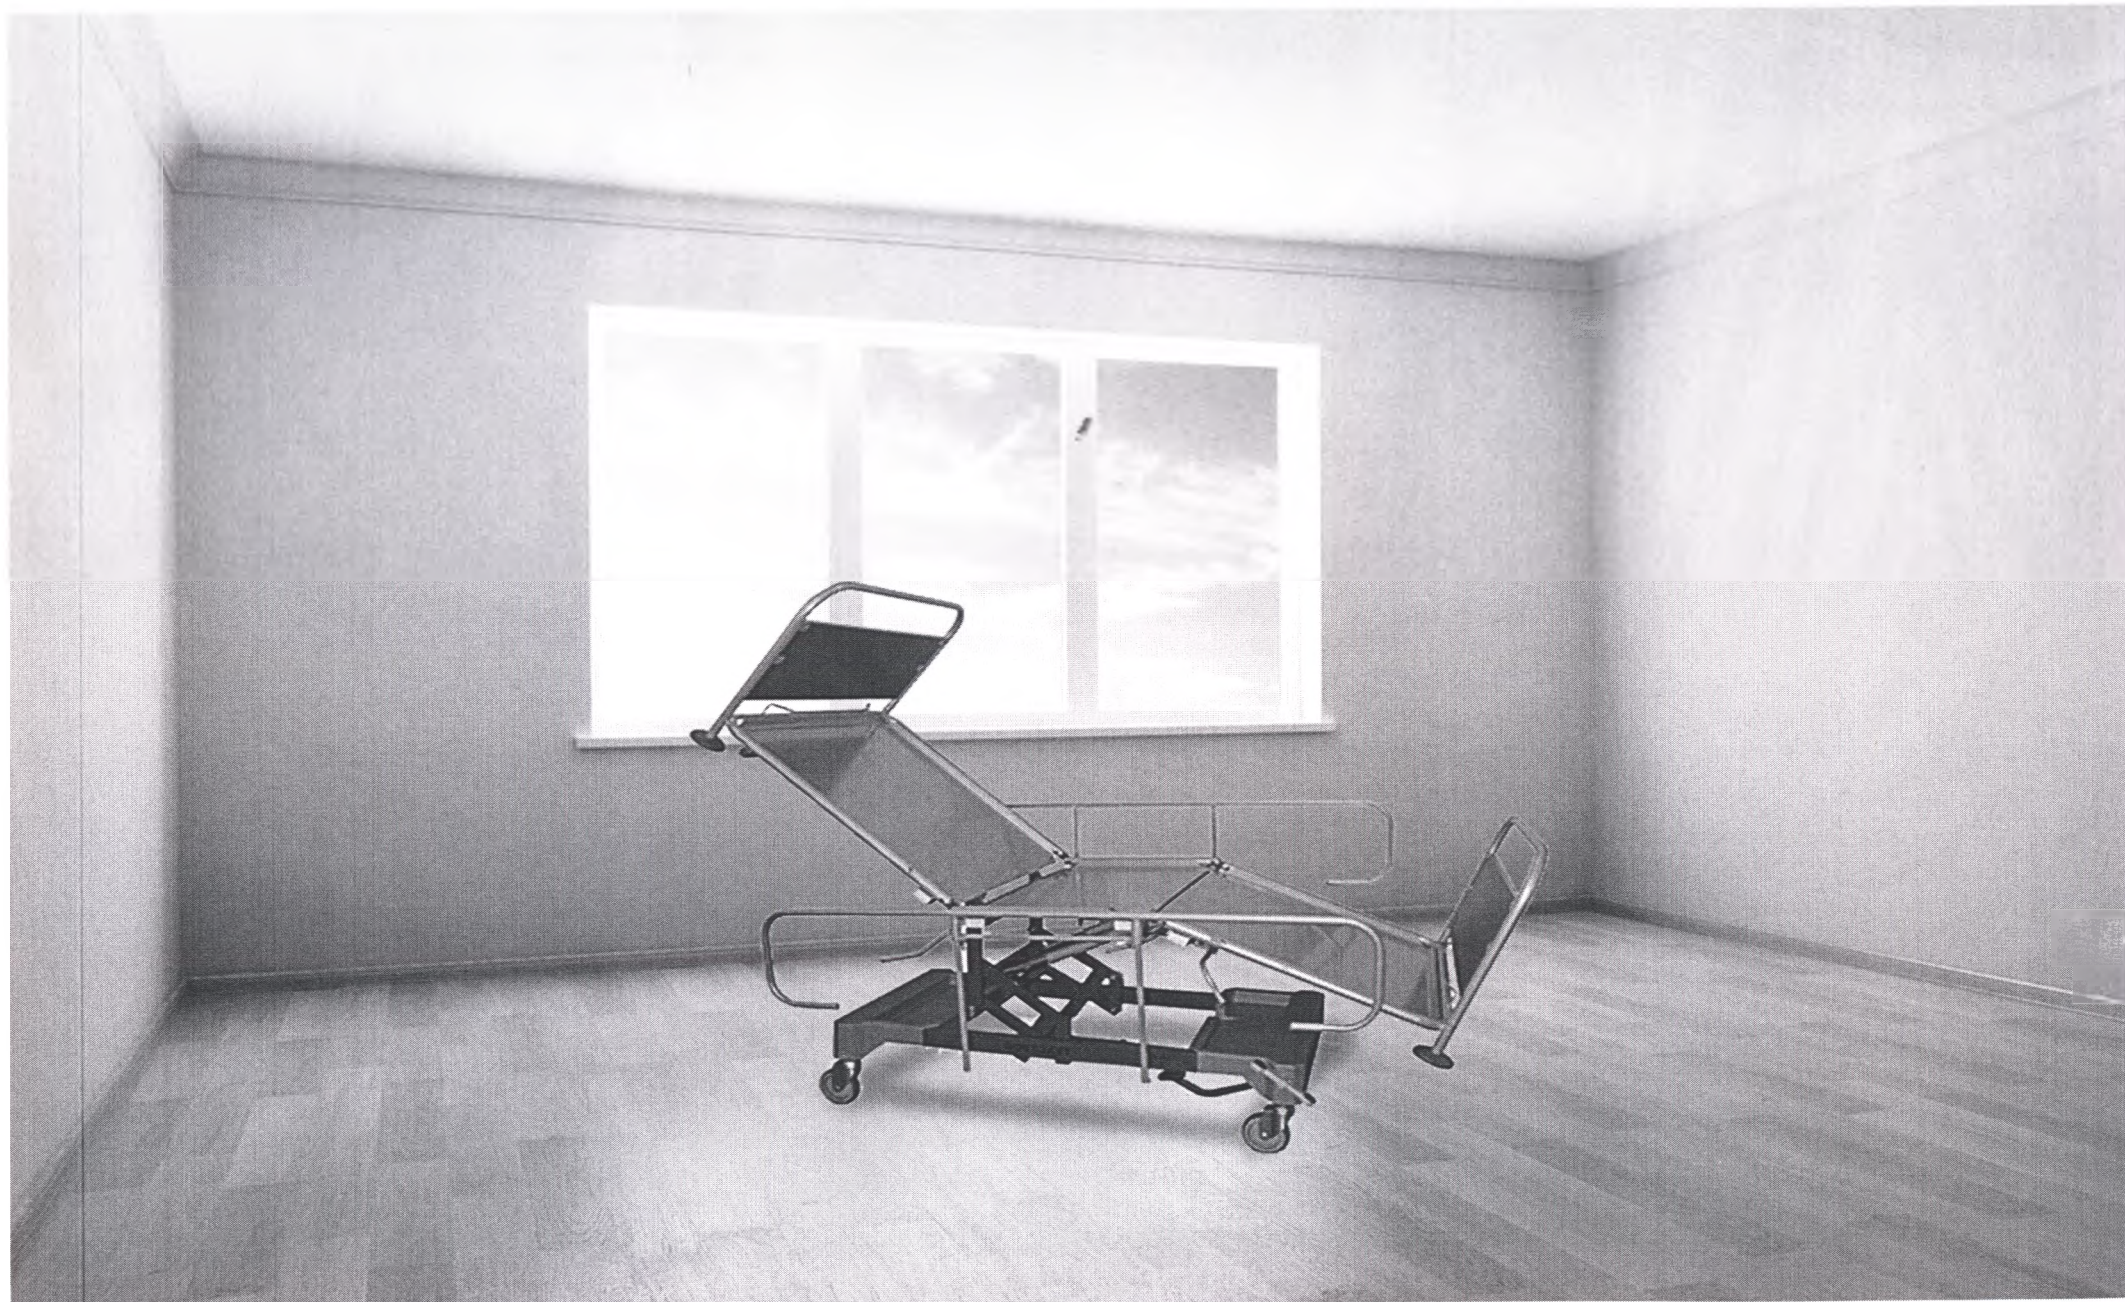





Производитель: ООО «ТехСтрой»



Адрес производства: 606440, Россия,
Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское

шоссе, д.1
Телефон/факс: (883159) 2-11-71, 2-20-36

www.techstroy-nn.ru

Наименование: Кровать функциональная для медицинских учреждений по ТУ
32.50.30-004-14692415-2018 в исполнении

Исполнение:

Исполнение	
Кровати функциональные для медицинских учреждений КФ - «ТехСтрой 2.01.01»	
Кровати функциональные для медицинских учреждений КФ - «ТехСтрой 2.03.01»	

Назначение:

Кровати функциональные для медицинских учреждений, предназначенные для кратковременного или длительного размещения пациентов и создания максимального комфорта.

Анатомическая форма кроватей и возможность секций обеспечивают необходимые удобства для пациентов в его медицинском обслуживании, способствуют эффективному снижению физических и психо-эмоциональных нагрузок пациента в лечебно-профилактическом процессе.

Хранение:

Кровать предназначена для использования в нормальном, сухом помещении при температуре от +10 до +40°C. Разрешенная температура хранения +40-50°C, влажность 30-75%.

Утилизация:

в соответствии с классом Б. Shift 2.1.7.2790-10.

Дата производства 08.2017

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца

Серийный номер 082017/08161

Номер партии 03052017

1/1/20



Всего прочито, пронумеровано и
скреплено печатью

Л.

Генеральный директор ООО «Техстрой»

А.Н.Кабикин