

Генеральный директор
ЗАО «БиоХимМак»
Н.Е.Тамм
«*Н.Е.Тамм*» 2018 г.
«*Н.Е.Тамм*» Company Limited
МОСКВА

**Фотографические изображения
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ,**
производства, Critical Care Diagnostics, Inc. (Критикал Кэа Диагностикс,
Инк.), США,

Набор контрольных материалов ST2 Presage ST2 Controls Kit

Фото 1. Набор контрольных материалов ST2 Presage ST2 Controls Kit. Индивидуальная упаковка.


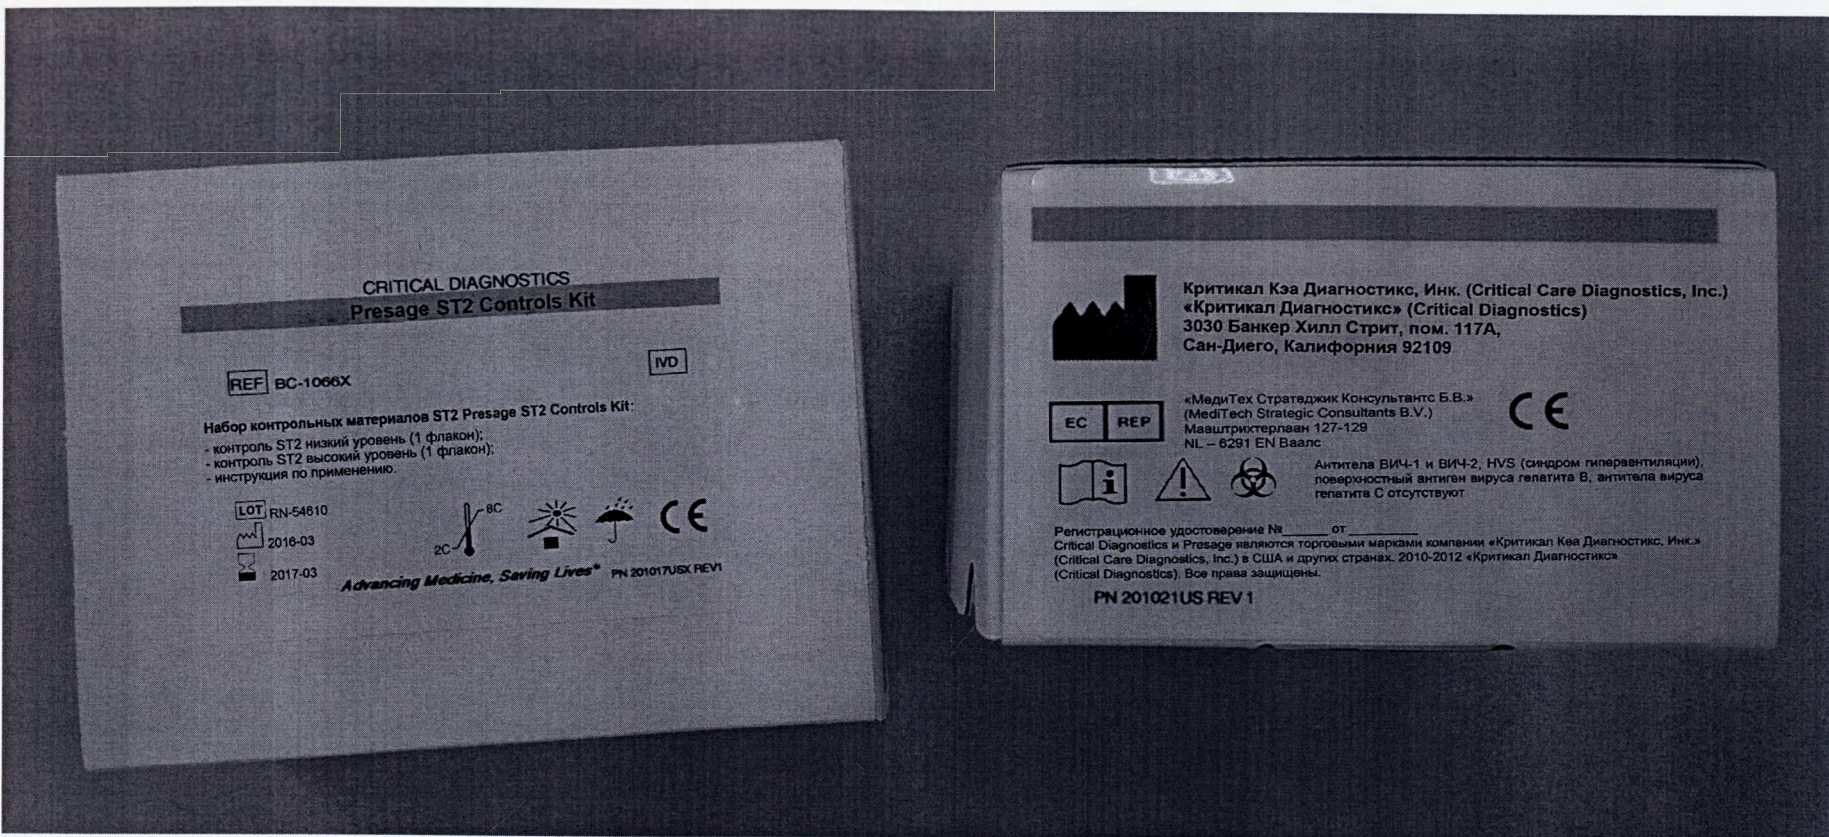


Фото 2. Набор контрольных материалов ST2 Presage ST2 Controls Kit. Составляющие набора.

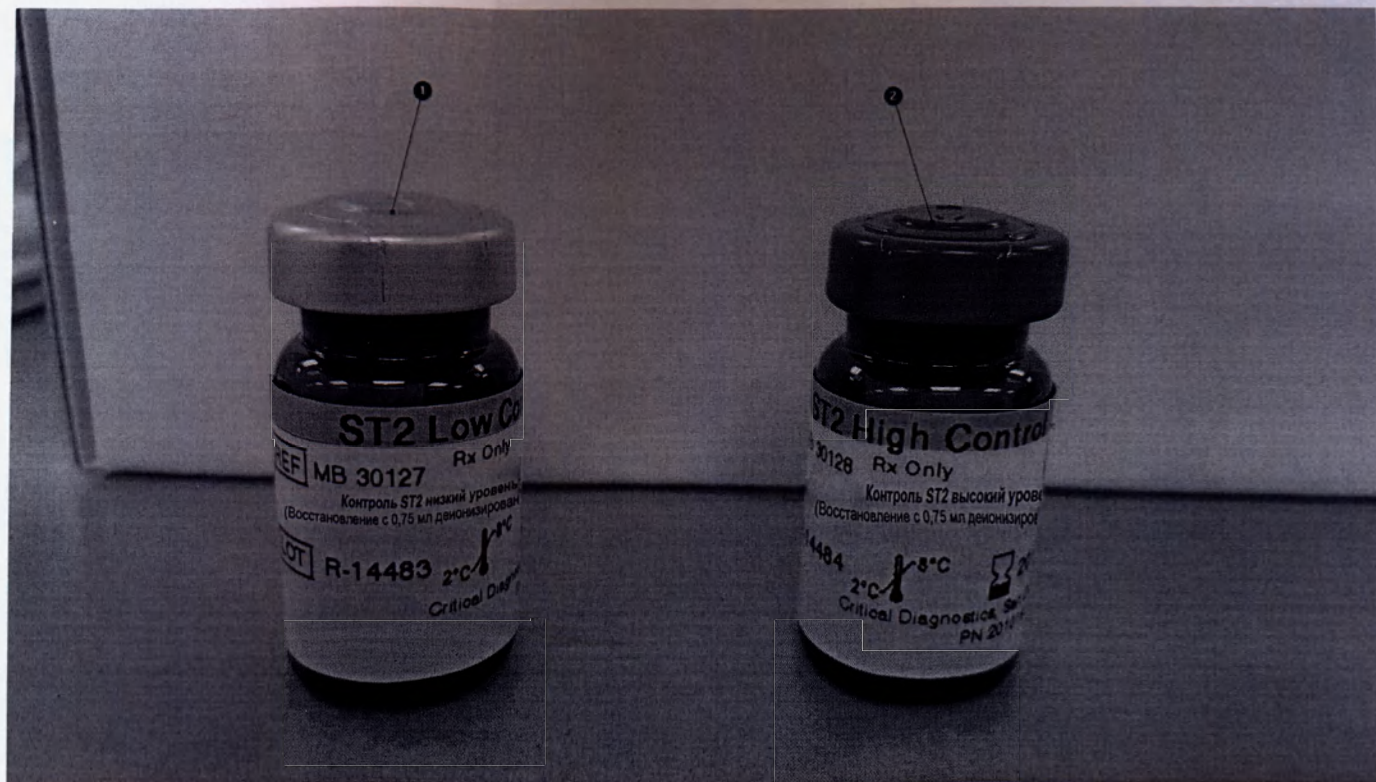

- 1 - контроль ST2 низкий уровень (1 флакон);
- 2 - контроль ST2 высокий уровень (1 флакон).

Генеральный директор

ЗАО «БиоХимМак»

Н.Е.Тамм

Прошито и пронумеровано


3

листа (ов).



Генеральный директор

ЗАО «БиоХимМак»

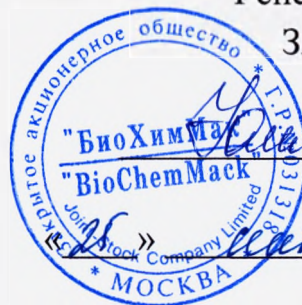

Н.Е.Тамм

20 18 г.

**Макет маркировки
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ,**

производства, Critical Care Diagnostics, Inc. (Критикал Кэа Диагностикс, Инк.),
США

Набор контрольных материалов ST2 Presage ST2 Controls Kit

Маркировка набора контрольных материалов

1. Набор контрольных материалов ST2 Presage ST2 Controls Kit. Макет маркировки на русском языке.

CRITICAL DIAGNOSTICS	
Presage ST2 Controls Kit	
REF BC-1066E	IVD
Набор контрольных материалов ST2 (Presage ST2 Controls Kit):	
- контроль ST2 низкий уровень (1 флакон) - контроль ST2 высокий уровень (1 флакон) - инструкция по применению	
LOT XXXXXXXX	
 XXXX-XX	
 XXXX-XX	
	



Критикал Кэа Диагностикас, Инк. (Critical Care Diagnostics, Inc.)
«Критикал Диагностикас» (Critical Diagnostics)
3030 Банкер Хилл Стрит, пом. 117А,
Сан-Диего, Калифорния 92109



«МедиТех Стратеджик Консультантс
Б.В.»
(MediTech Strategic Consultants B.V.)
Мааштрихтерлаан 127-129
NL – 6291 EN Ваалс




Антитела ВИЧ-1 и ВИЧ-2, HVS (синдром гипервентиляции), поверхностный антиген вируса гепатита В, антитела вируса гепатита С отсутствуют.


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Critical Diagnostics и Presage являются торговыми марками компании «Критикал Кэа Диагностикас, Инк.» (Critical Care Diagnostics, Inc.) в США и других странах.
2010-2012 «Критикал Диагностикас» (Critical Diagnostics). Все права защищены.

1.1 Контроль ST2 низкий уровень (1 флакон) Макет маркировки на русском языке.

ST2 Low Control		
REF MB 30127	IVD	
Контроль ST2 низкий уровень (Восстановление с х.х. мл деионизированной воды)		
LOT XXXXX		 
 XXXX-XX		
 XXXX-XX		
«Критикал Диагностикс» (Critical Diagnostics), Сан-Диего, Калифорния		

1.2. Контроль ST2 высокий уровень (1 флакон) Макет маркировки на русском языке.

ST2 High Control		
REF MB 30128	IVD	
Контроль ST2 высокий уровень (Восстановление с х.х. мл деионизированной воды)		
LOT XXXXX		 
 XXXX-XX		
 XXXX-XX		
«Критикал Диагностикс» (Critical Diagnostics), Сан-Диего, Калифорния		

Генеральный директор

ЗАО «БиоХимМак»

Н.Е.Тамм

Прошито и пронумеровано

3

листа (ов).

