

Фотографии медицинского изделия:

«Микроскоп стоматологический DENSIM с принадлежностями, варианты исполнения: DENSIM OPTICS, DENSIM OPTICS VARIO»

производство: DIPLOMAT DENTAL s.r.o., Vrbovská cesta 17, 921 01, Piešťany, Slovak Republic

1. Голова оптическая OPTICS;
2. Голова оптическая VARIO;
3. Бинокуляр с регулируемым углом наклона 0-195°;
4. окуляр 10х/16 мм;
5. окуляр 12.5х/16 мм;
6. линза f-200 мм;
7. линза f-250 мм;
8. линза f-300 мм;
9. линза f-400 мм;
10. Линза объектива VARIO 200-300;
11. Плечо пантографическое, длина 90 см;
12. Плечо пантографическое, длина 60 см;
13. Источник света LED;
14. Источник света XENON;

15. Источник света HALOGEN;
16. Чехол защитный;
17. Кабель сетевой;
18. -1. Штатив на мобильной основе в форме – Н – с колонной (основание);
- 18.-2. Штатив на мобильной основе в форме – Н – с колонной (колонна);
19. Штатив потолочный;
20. Штатив напольный с колонной;
21. Штатив настольный;
22. Штатив настенный;
23. Фильтр световой зеленый;
24. Фильтр световой оранжевый;
25. Фильтр для работы с лазером;
26. Удлинитель плеча, длина 28 см;
27. Удлинитель бинокля;
28. Кольцо вращения бинокля;
29. Крепление монитора;
30. Крышка линзы объектива;
31. Камера цифровая специальная с делителем луча;
32. Делитель луча;
33. Адаптер для зеркальной фотокамеры;
34. Адаптер для компактной фотокамеры;
35. Адаптер для видеокамеры;

- 36. Адаптер для монитора;
- 37. Уплотнение окуляров;
- 38. Кабель оптоволоконный;
- 39. Ручки управления биноклем;
- 40. Руководство по эксплуатации.



Рис 1. - Голова оптическая OPTICS;

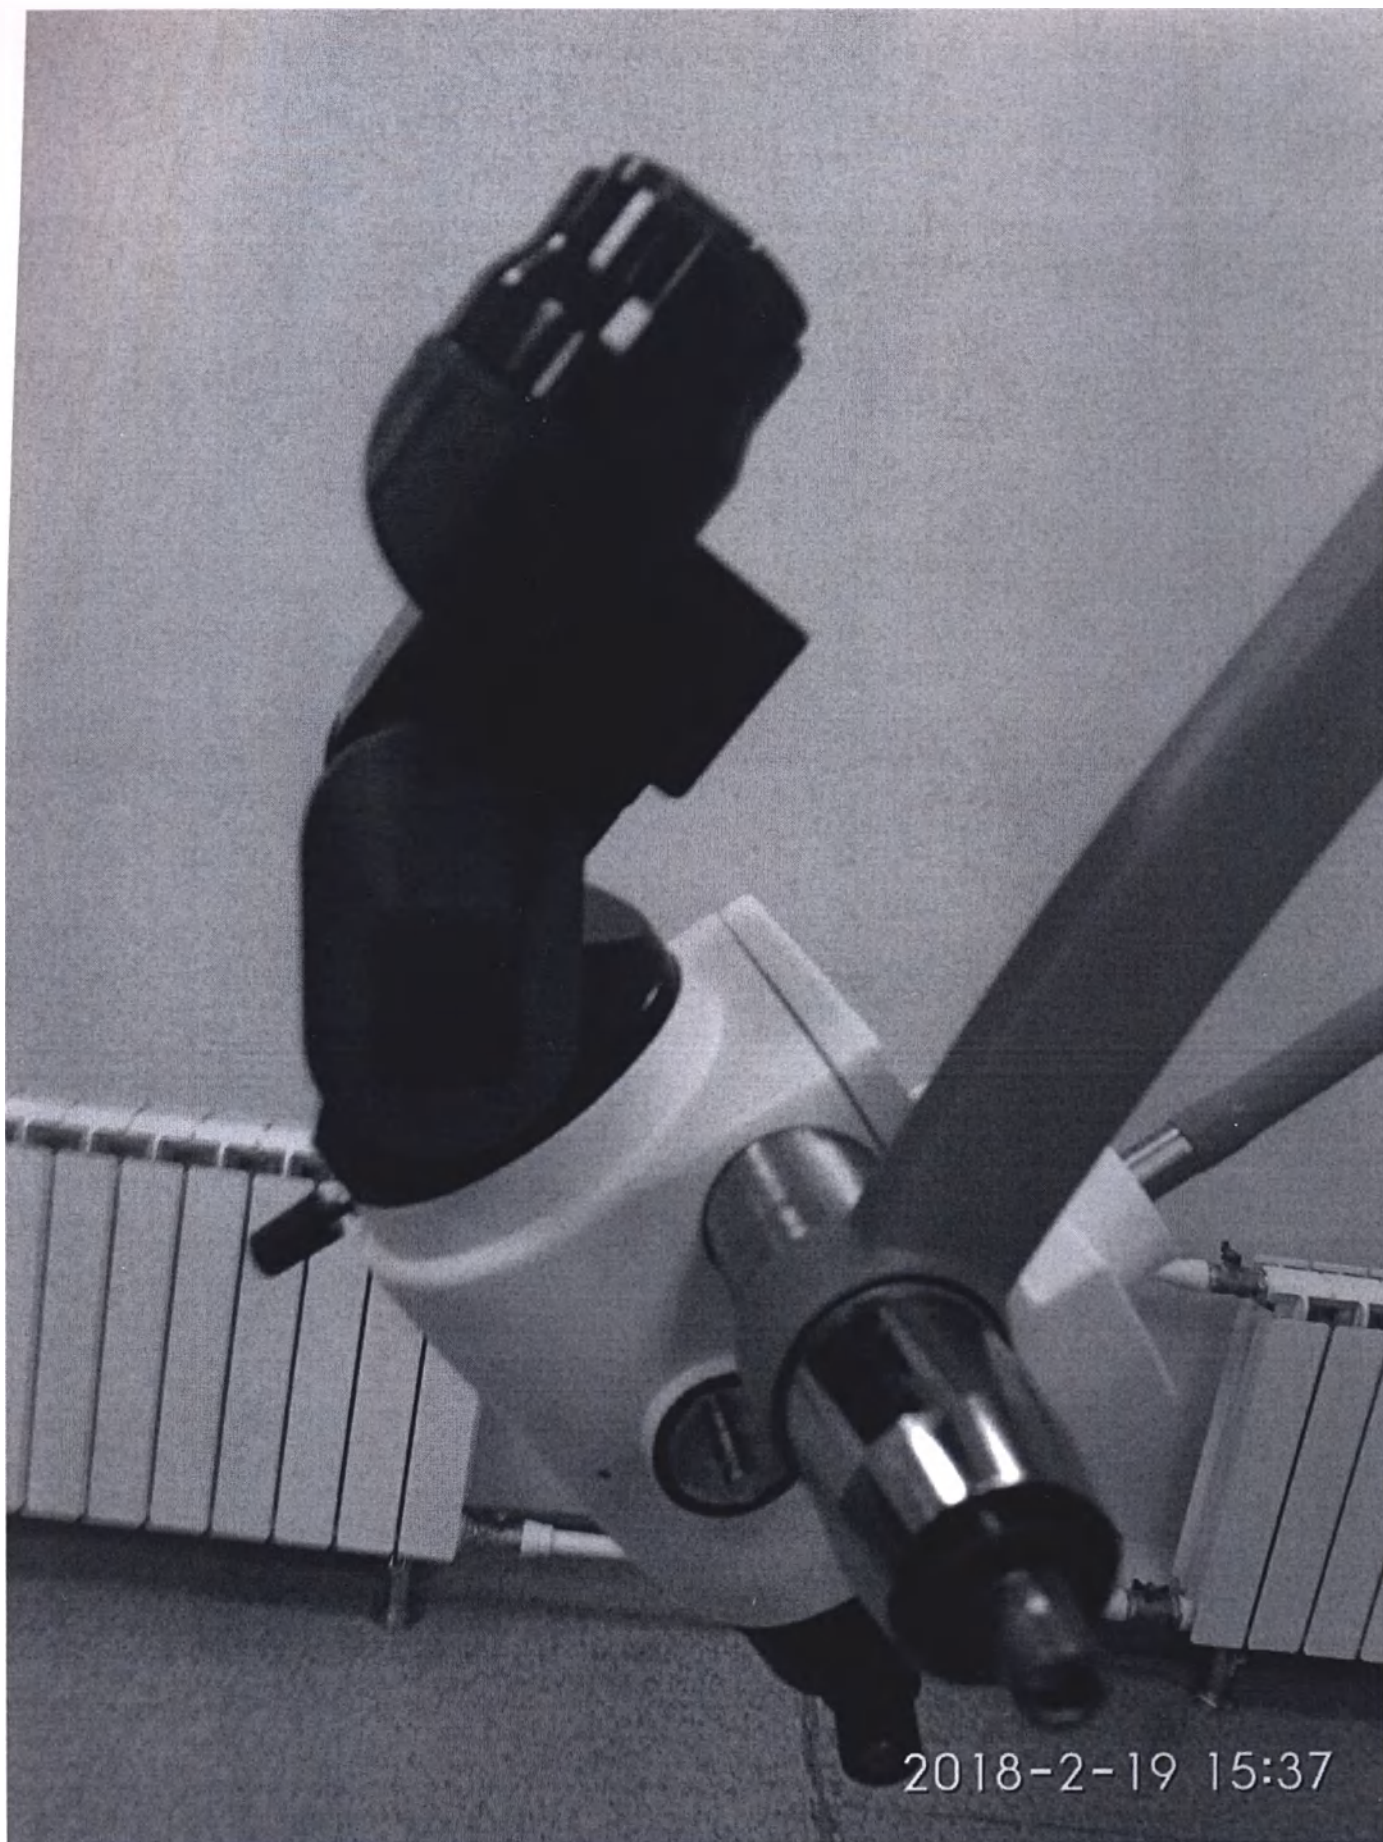


Рис 2. - Голова оптическая VARIO;

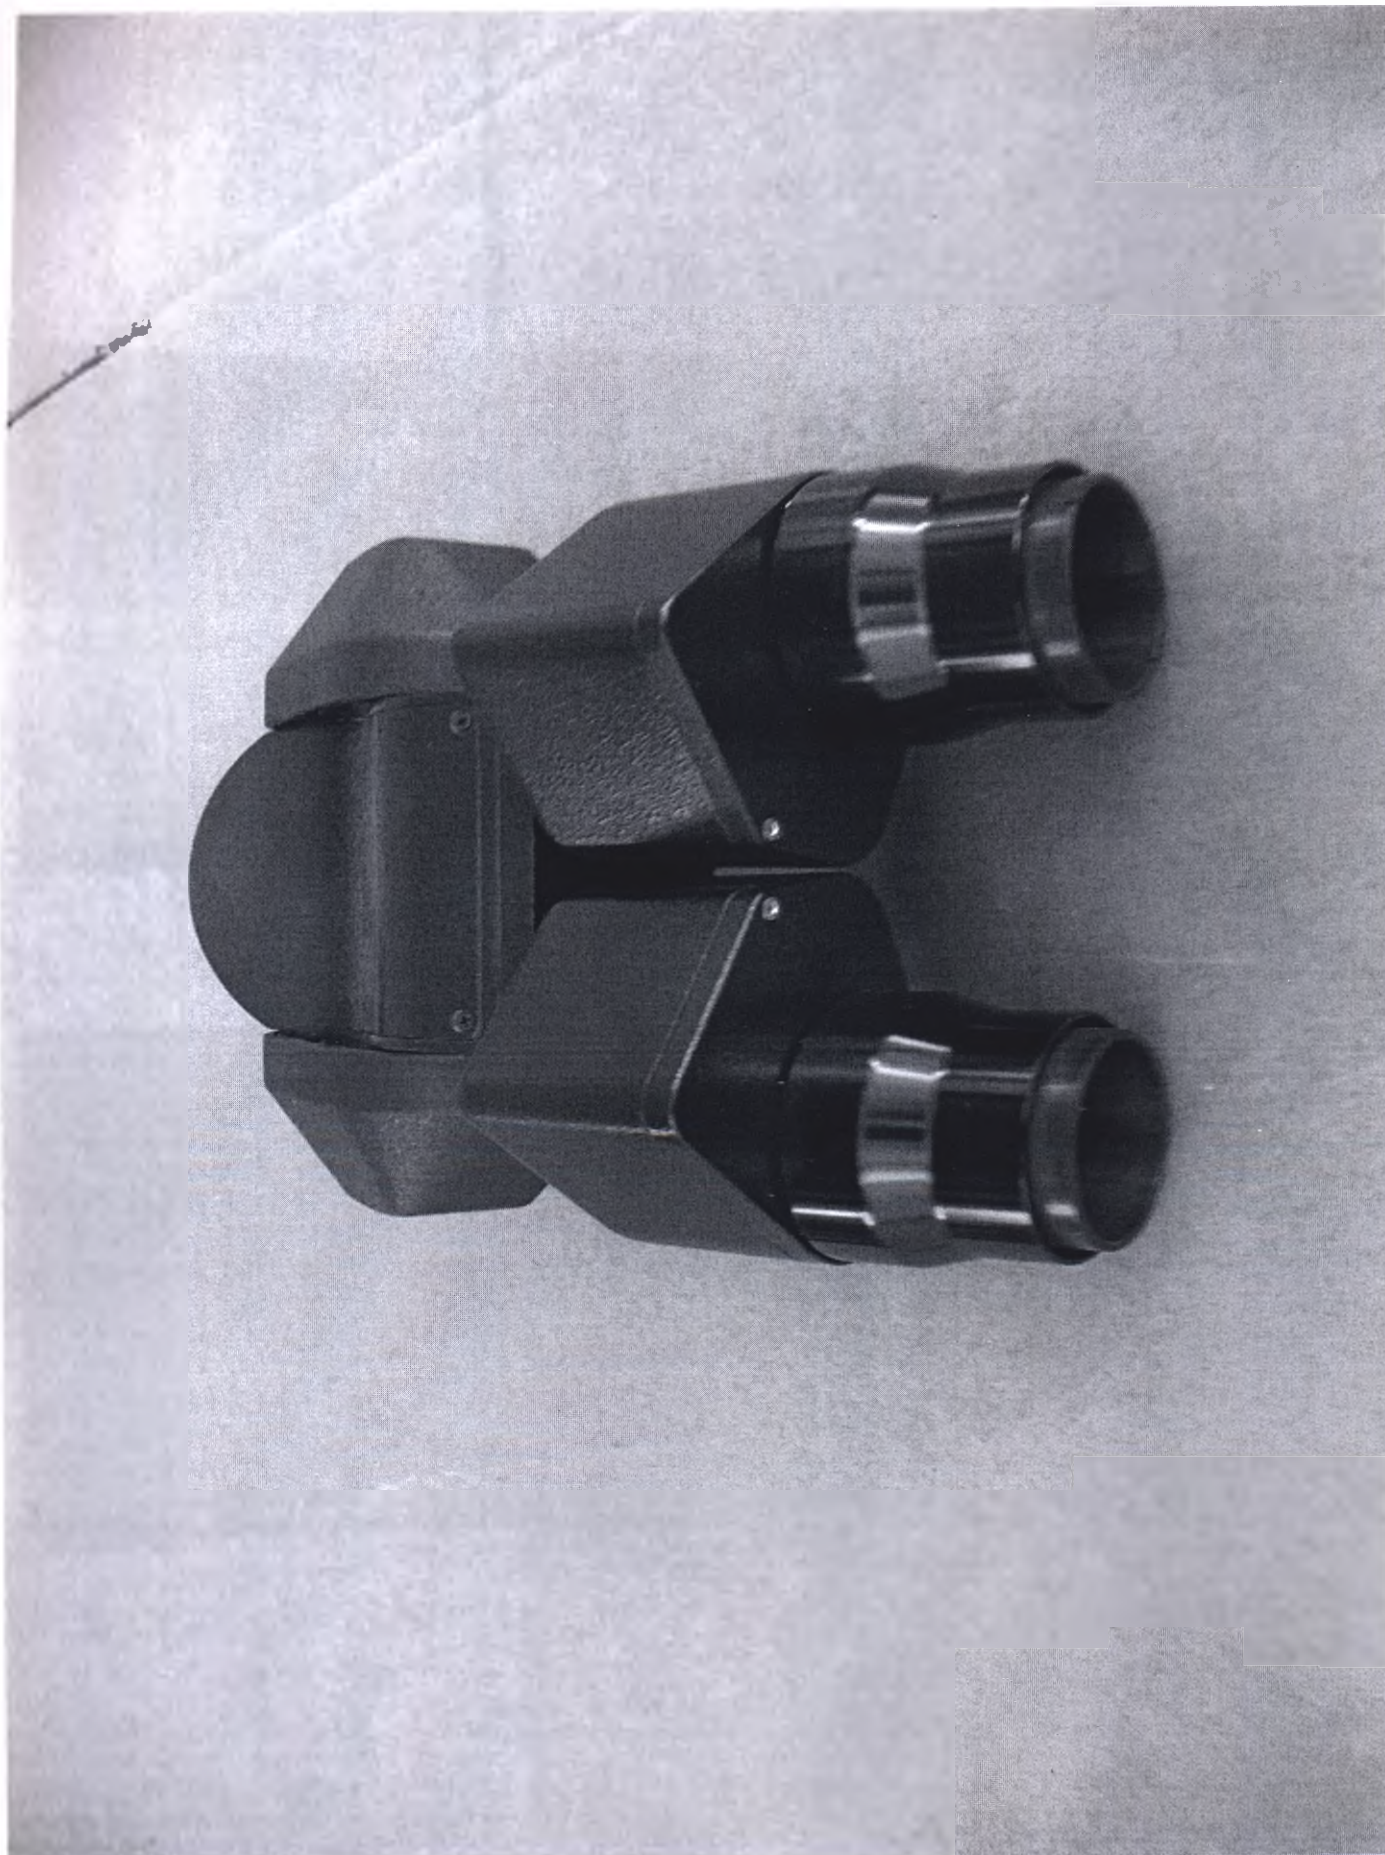


Рис 3. - Бинокляр с регулируемым углом наклона $0-195^{\circ}$;



Рис 4. - окуляр 10х/16 мм;



Рис 5. - окуляр 12.5х/16 мм;



Рис 6. - линза f-200 мм;



Рис 7. - линза f-250 мм;



Рис 8. - линза f-300 мм;



Рис 9. - линза f-400 мм;



Рис 10. - Линза объектива VARIO 200-300;

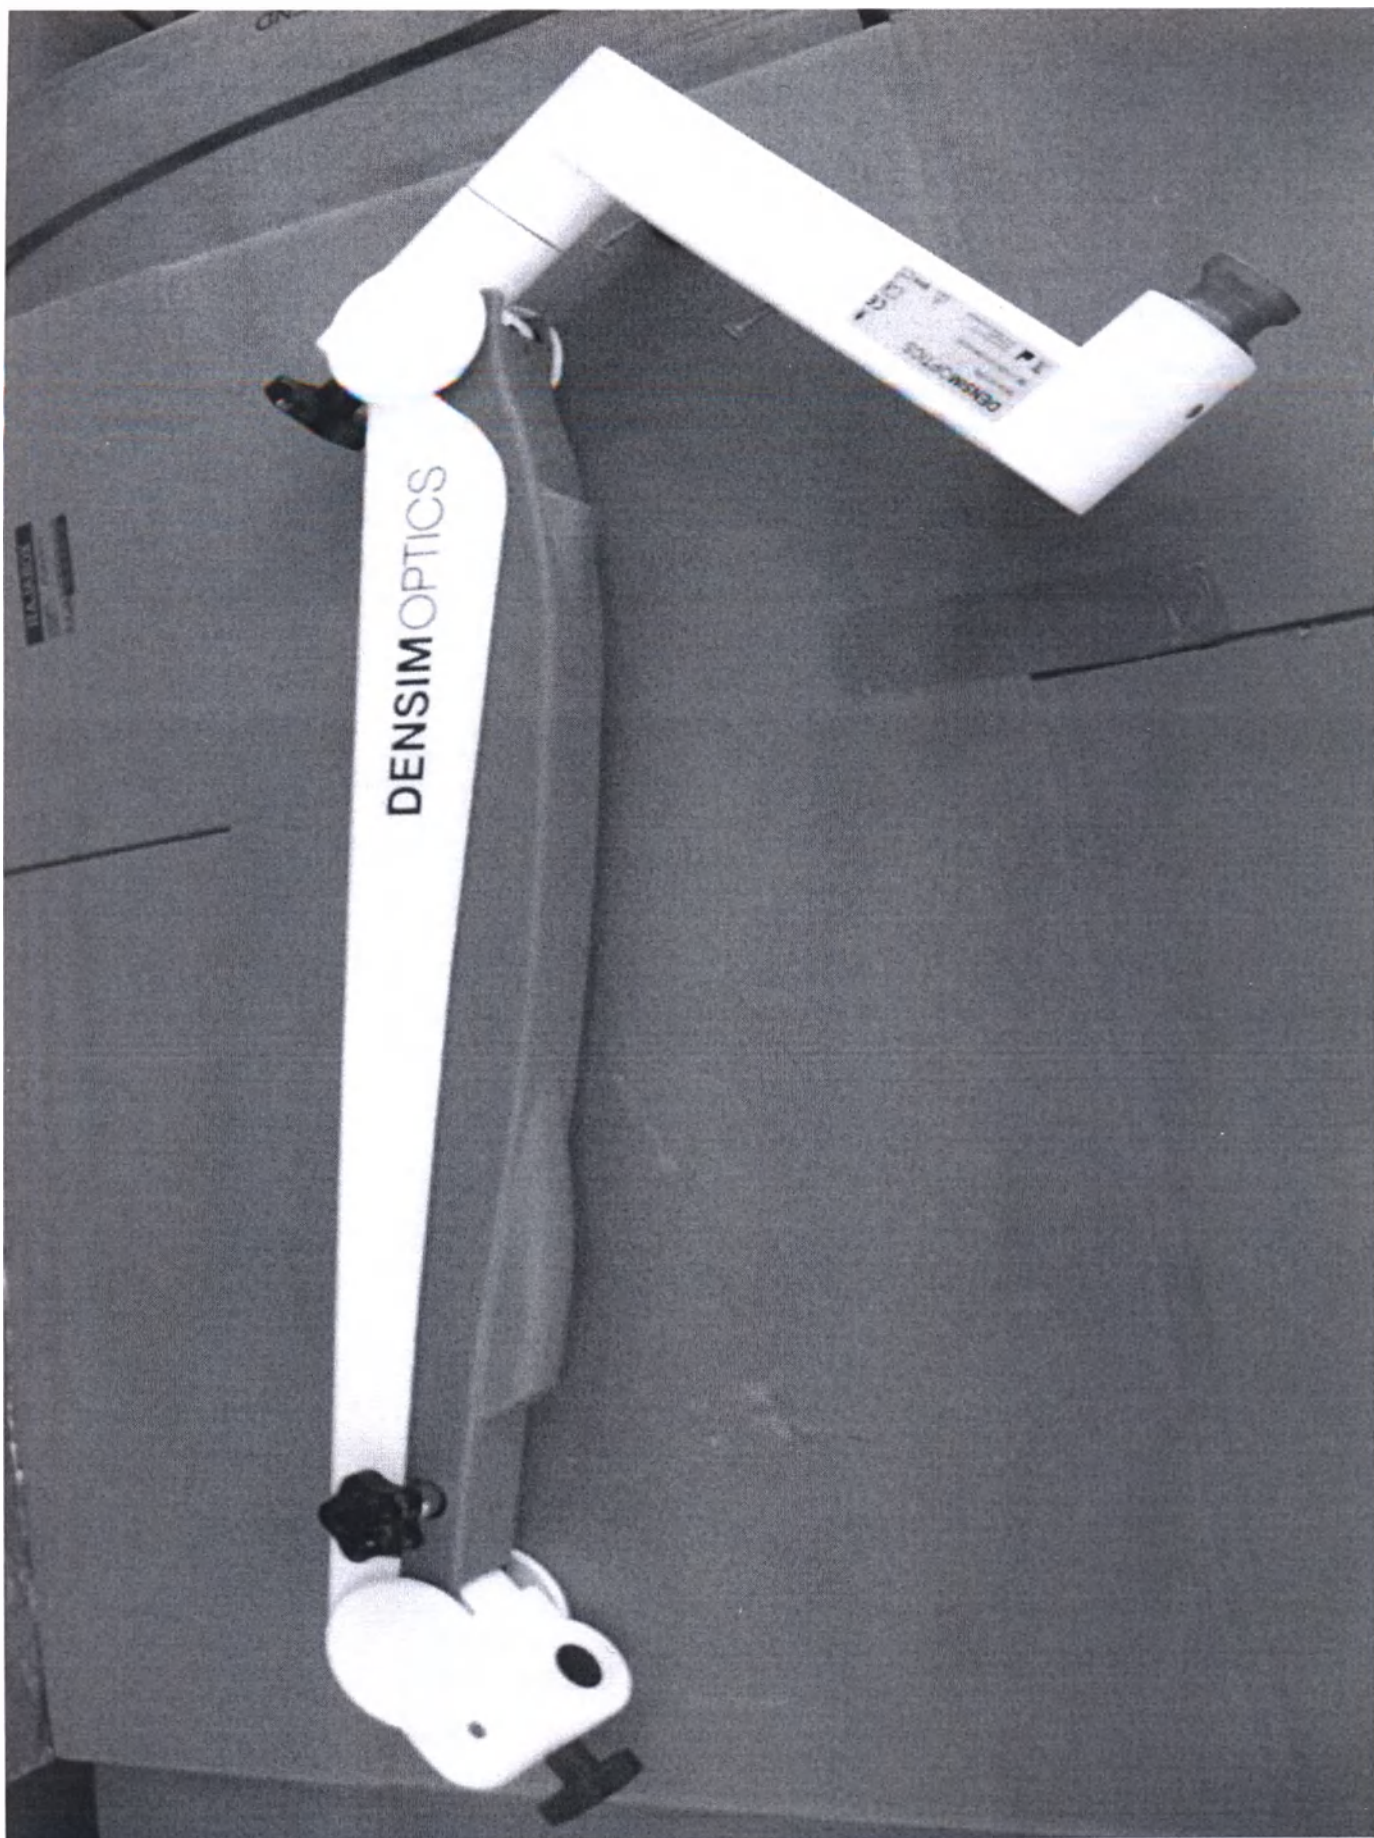


Рис 11. - Плечо пантографическое, длина 90 см;

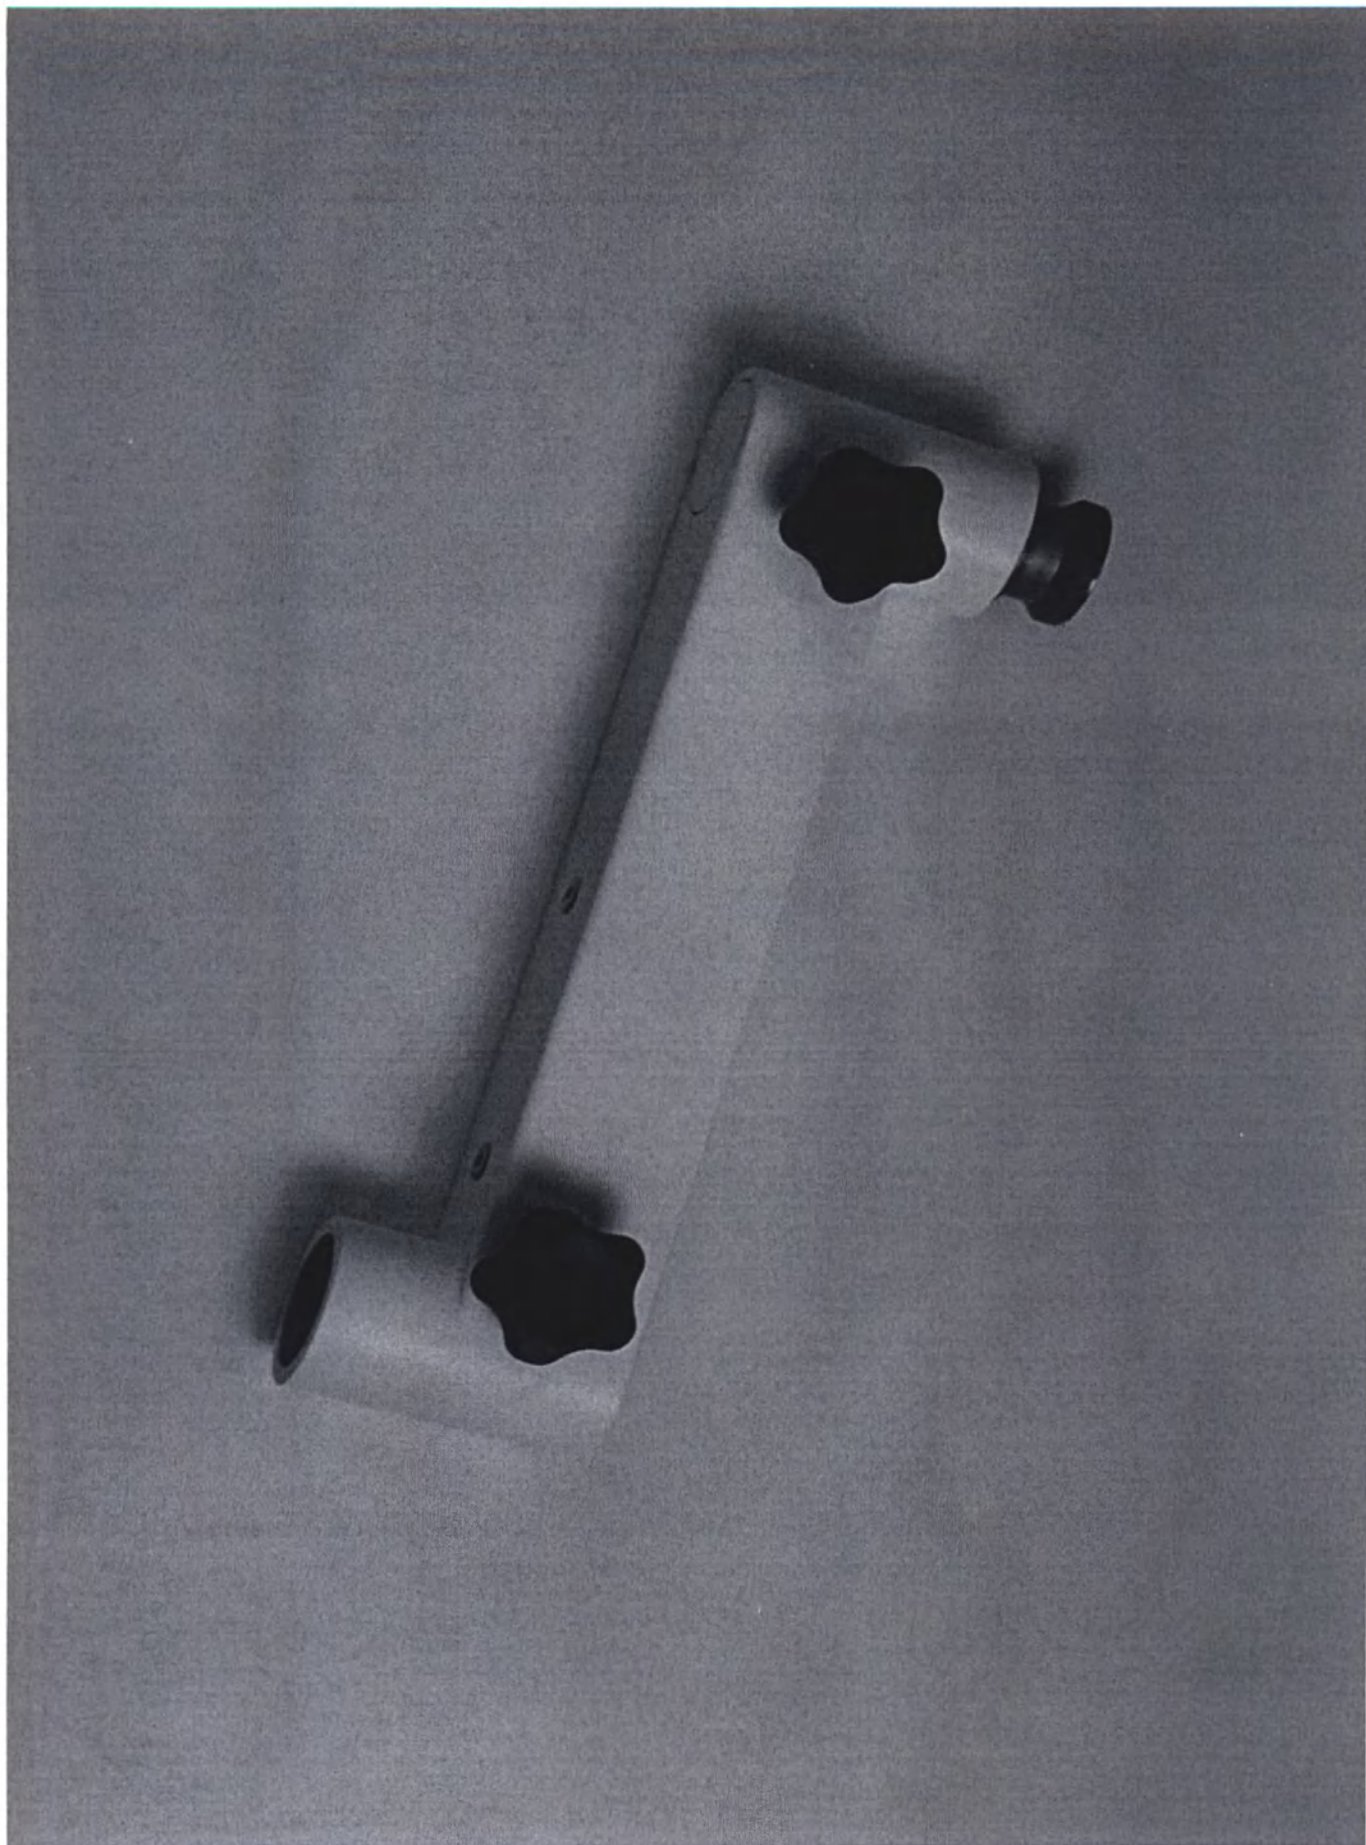


Рис 12. - Плечо пантографическое, длина 60 см;



Рис 13. - Источник света LED;



Рис 14. - Источник света XENON;



Рис 15. - Источник света HALOGEN;

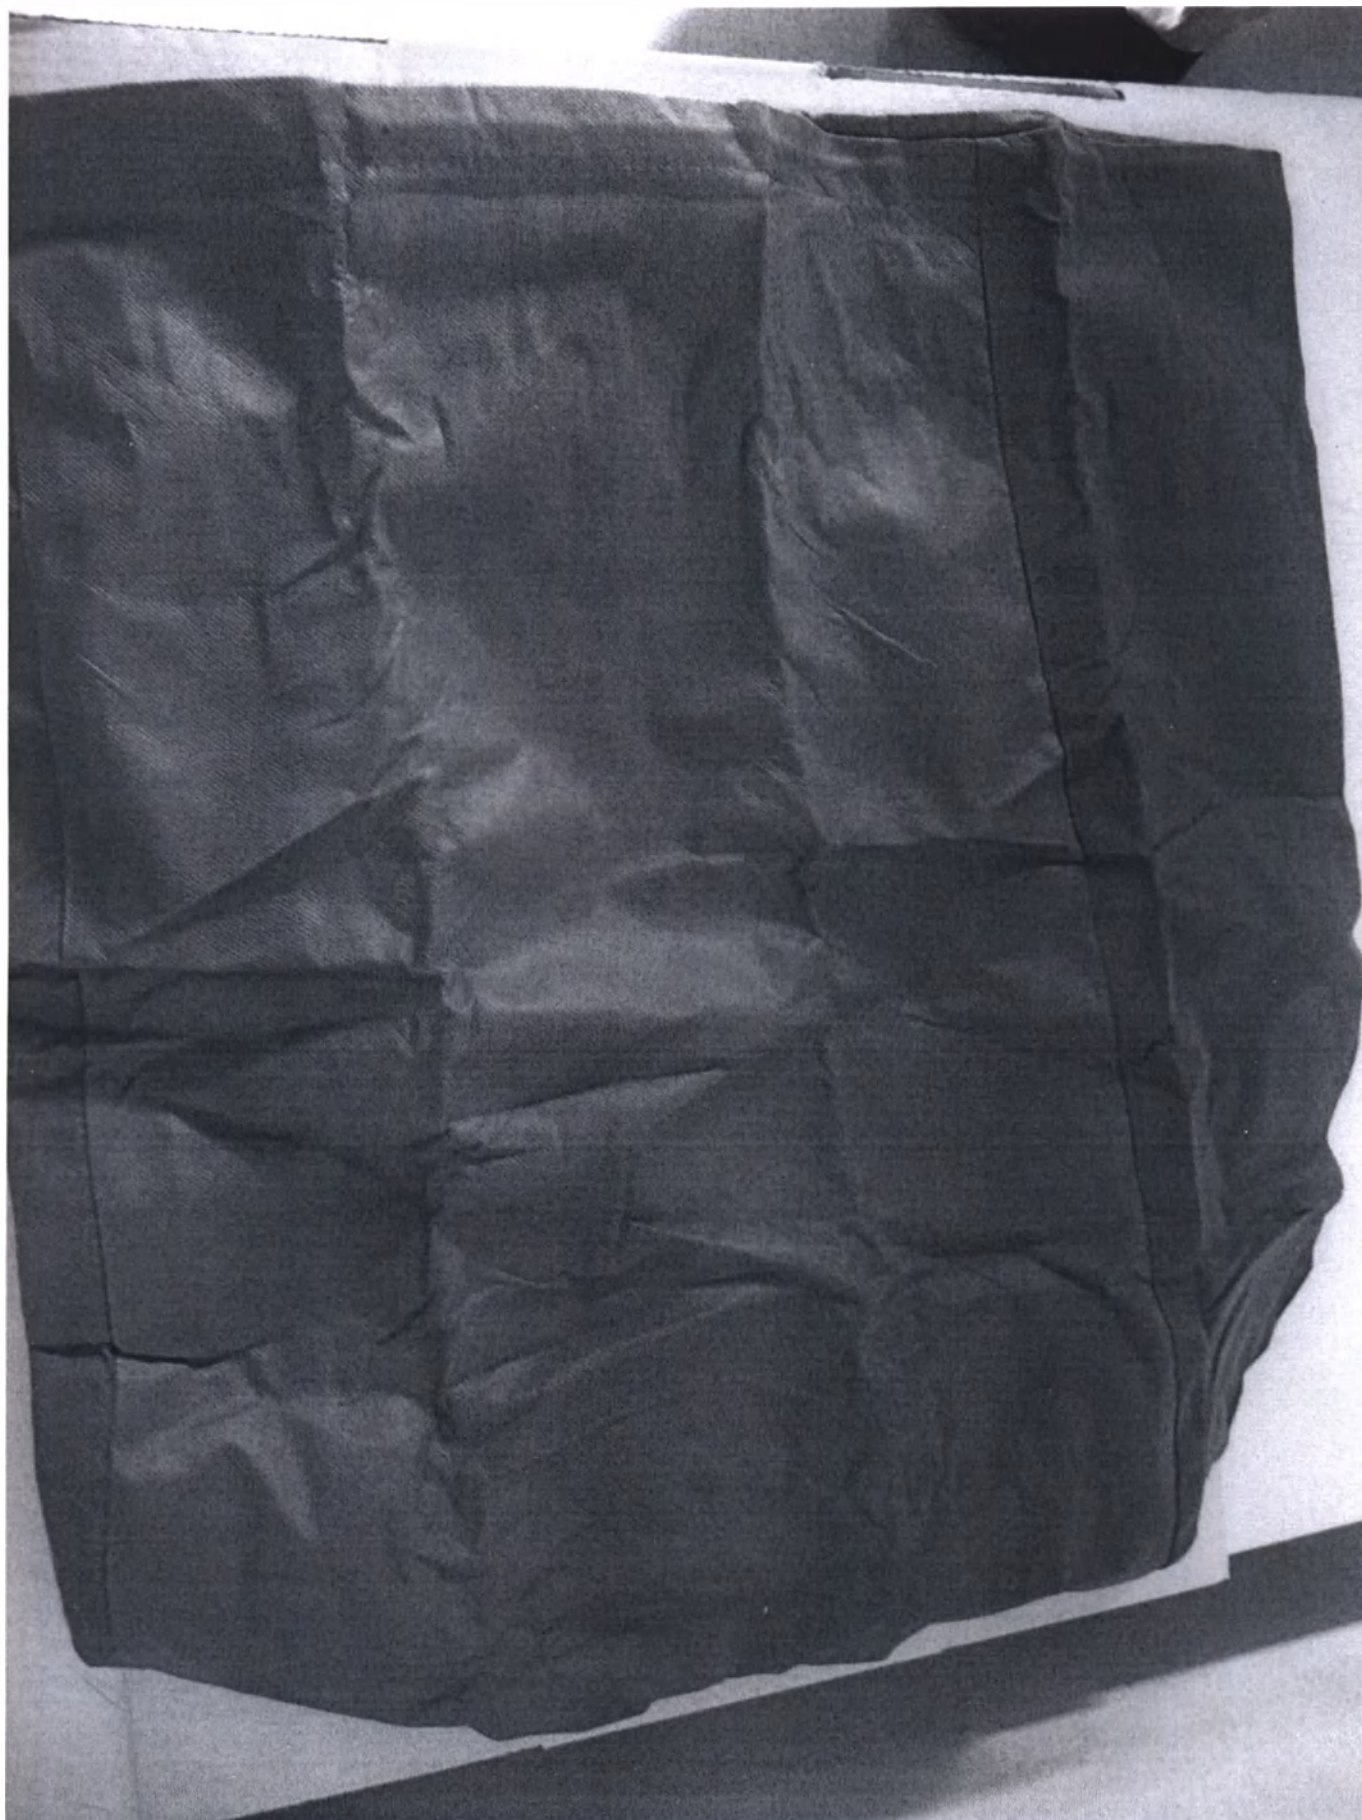


Рис 16. - Чехол защитный;

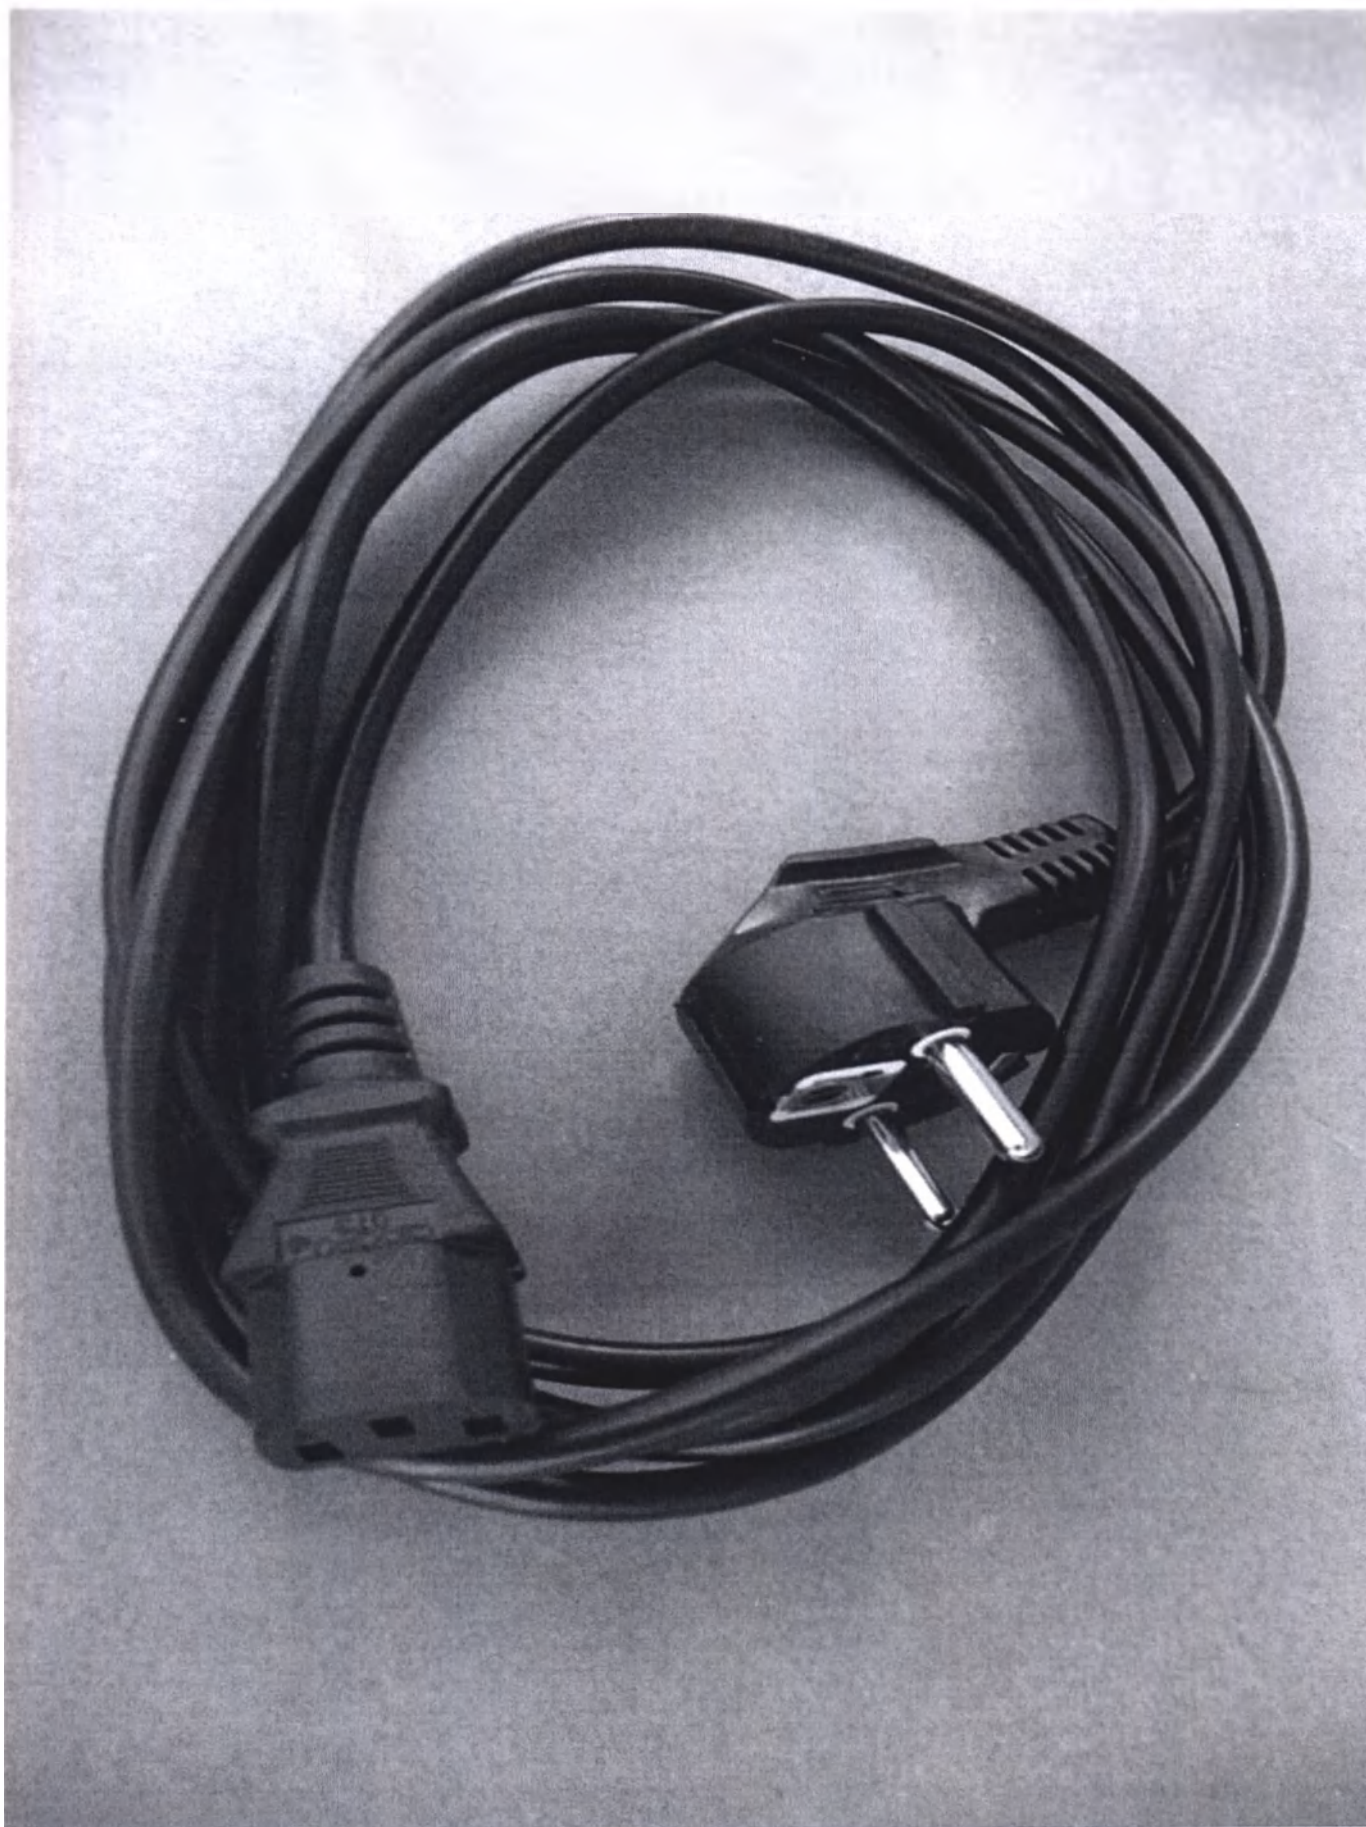


Рис 17. - Кабель сетевой;

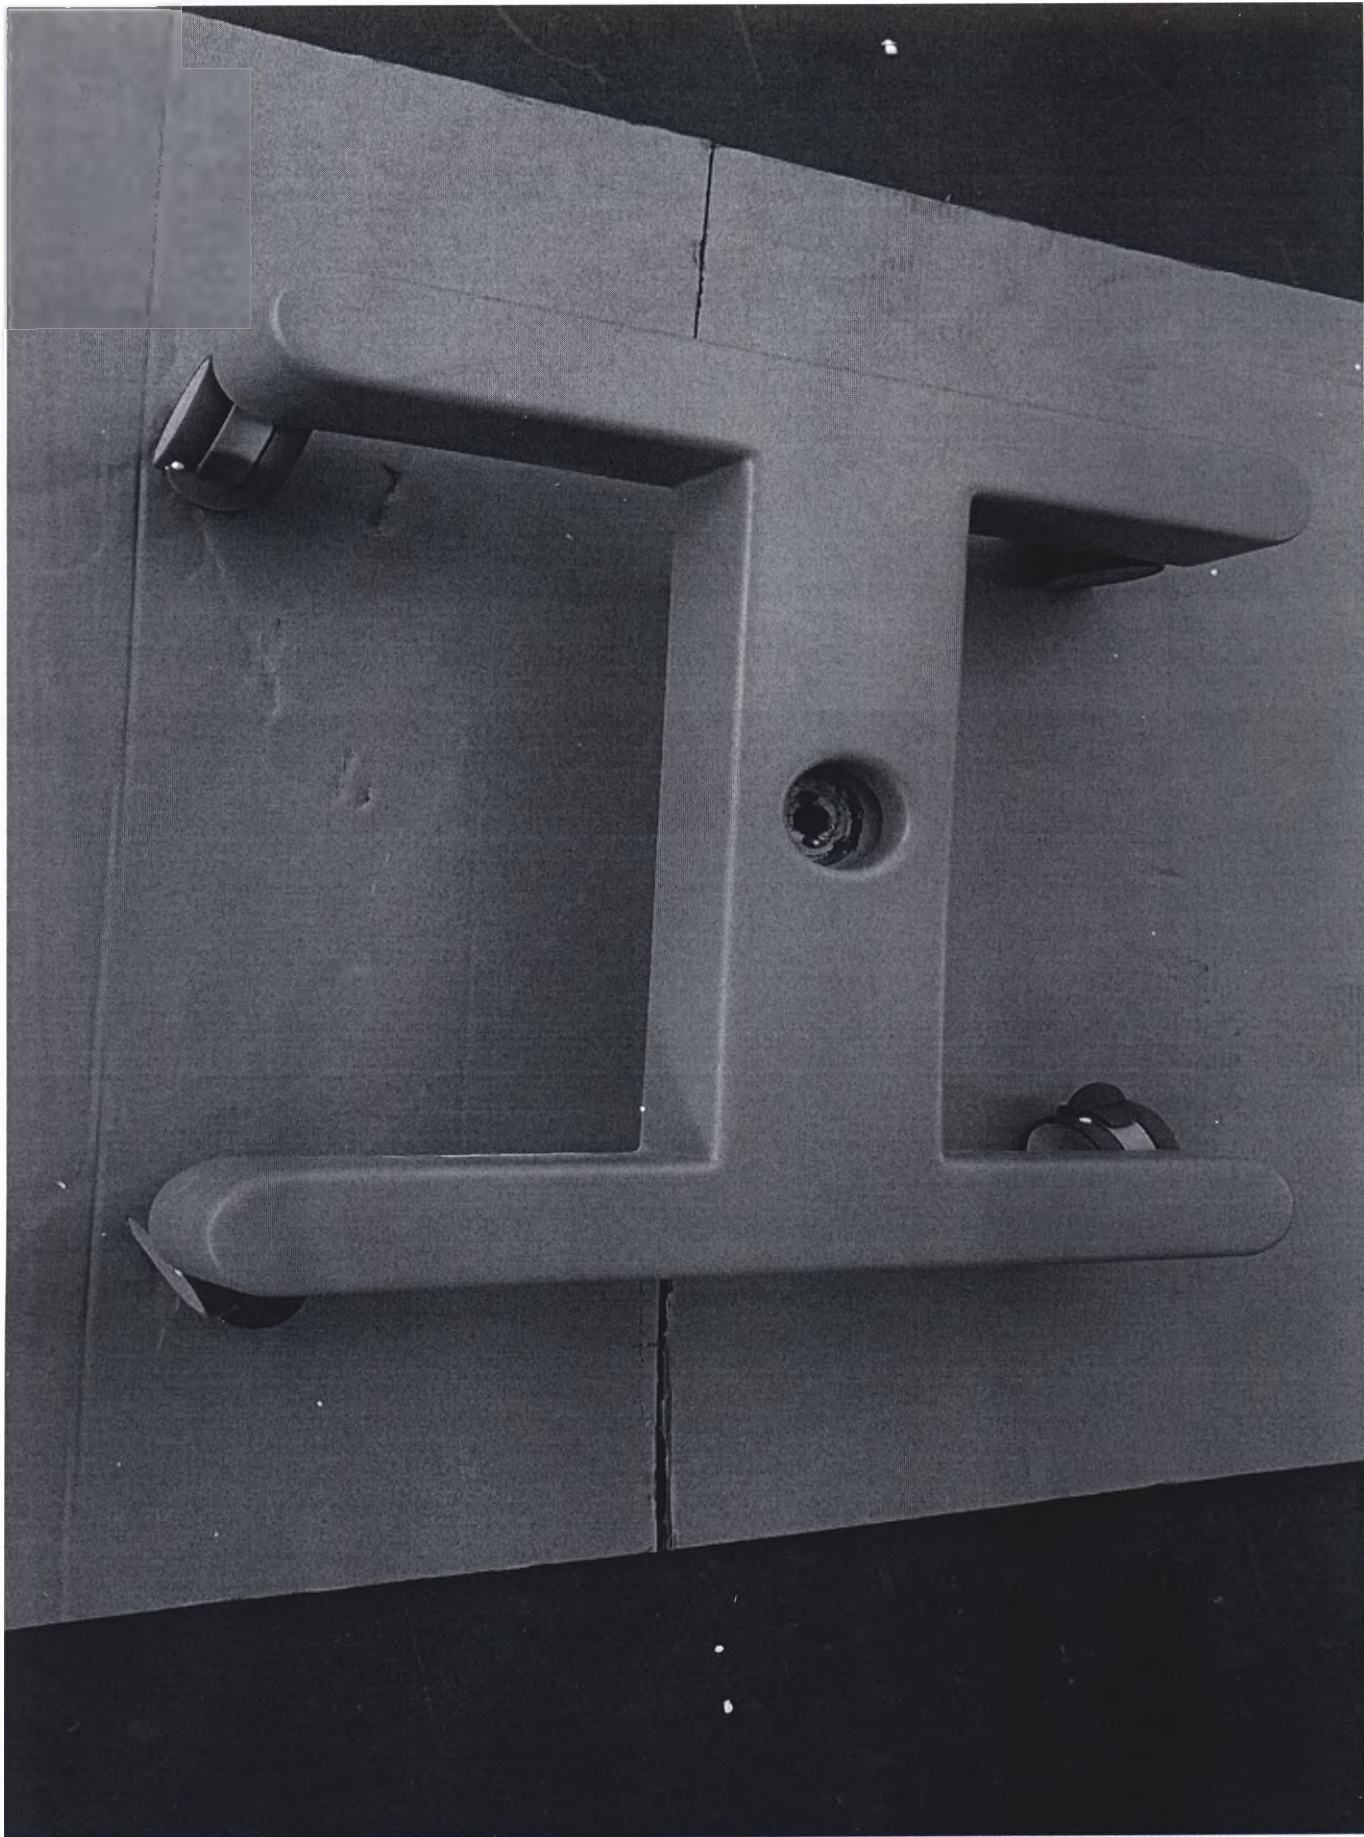


Рис 18. - 1. Штатив на мобильной основе в форме – Н – с колонной (основание);

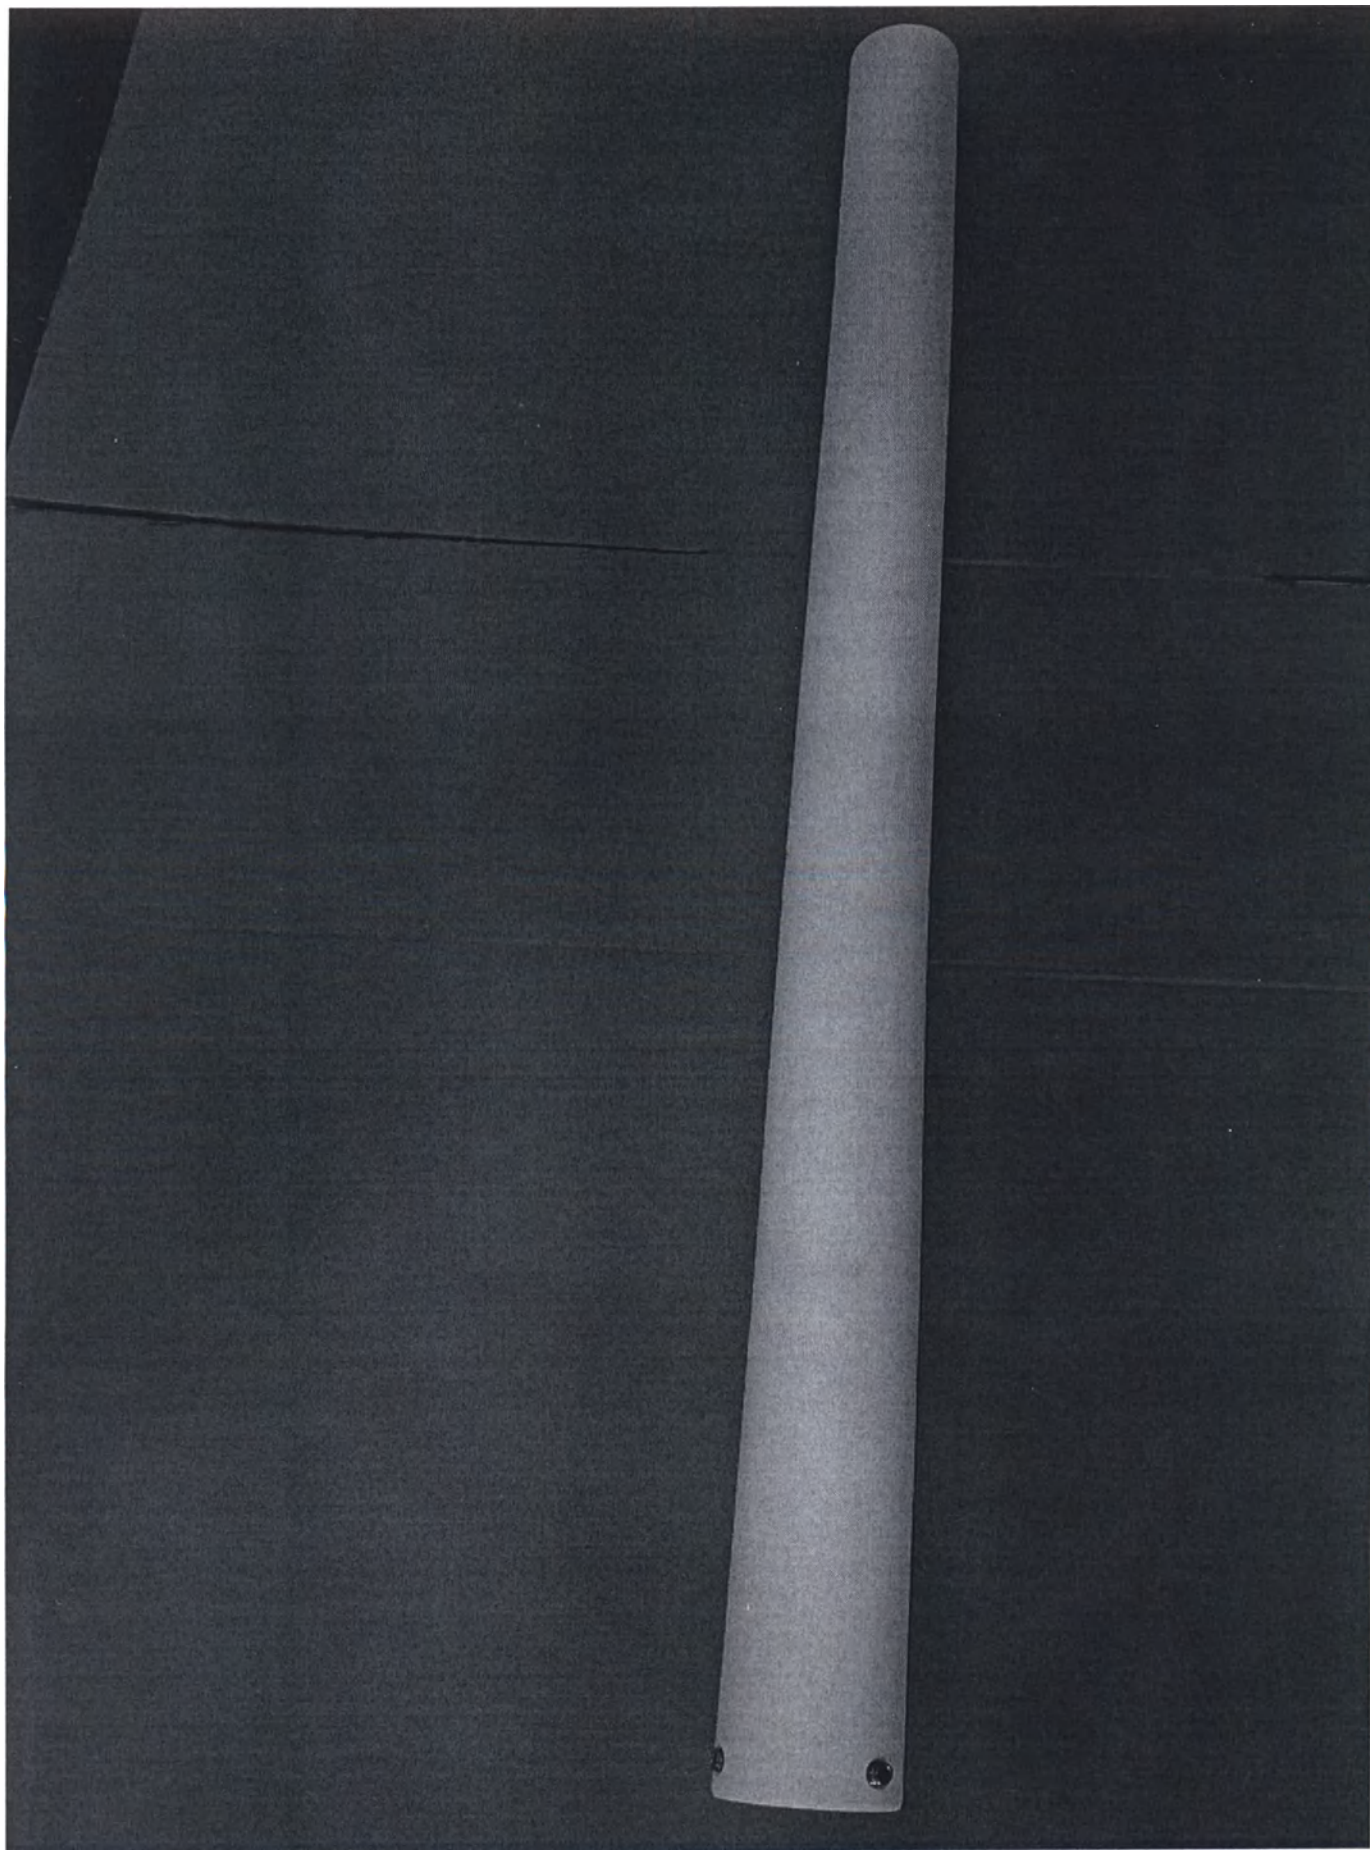


Рис 18. – 2 Штатив на мобильной основе в форме – Н – с колонной (колонна)

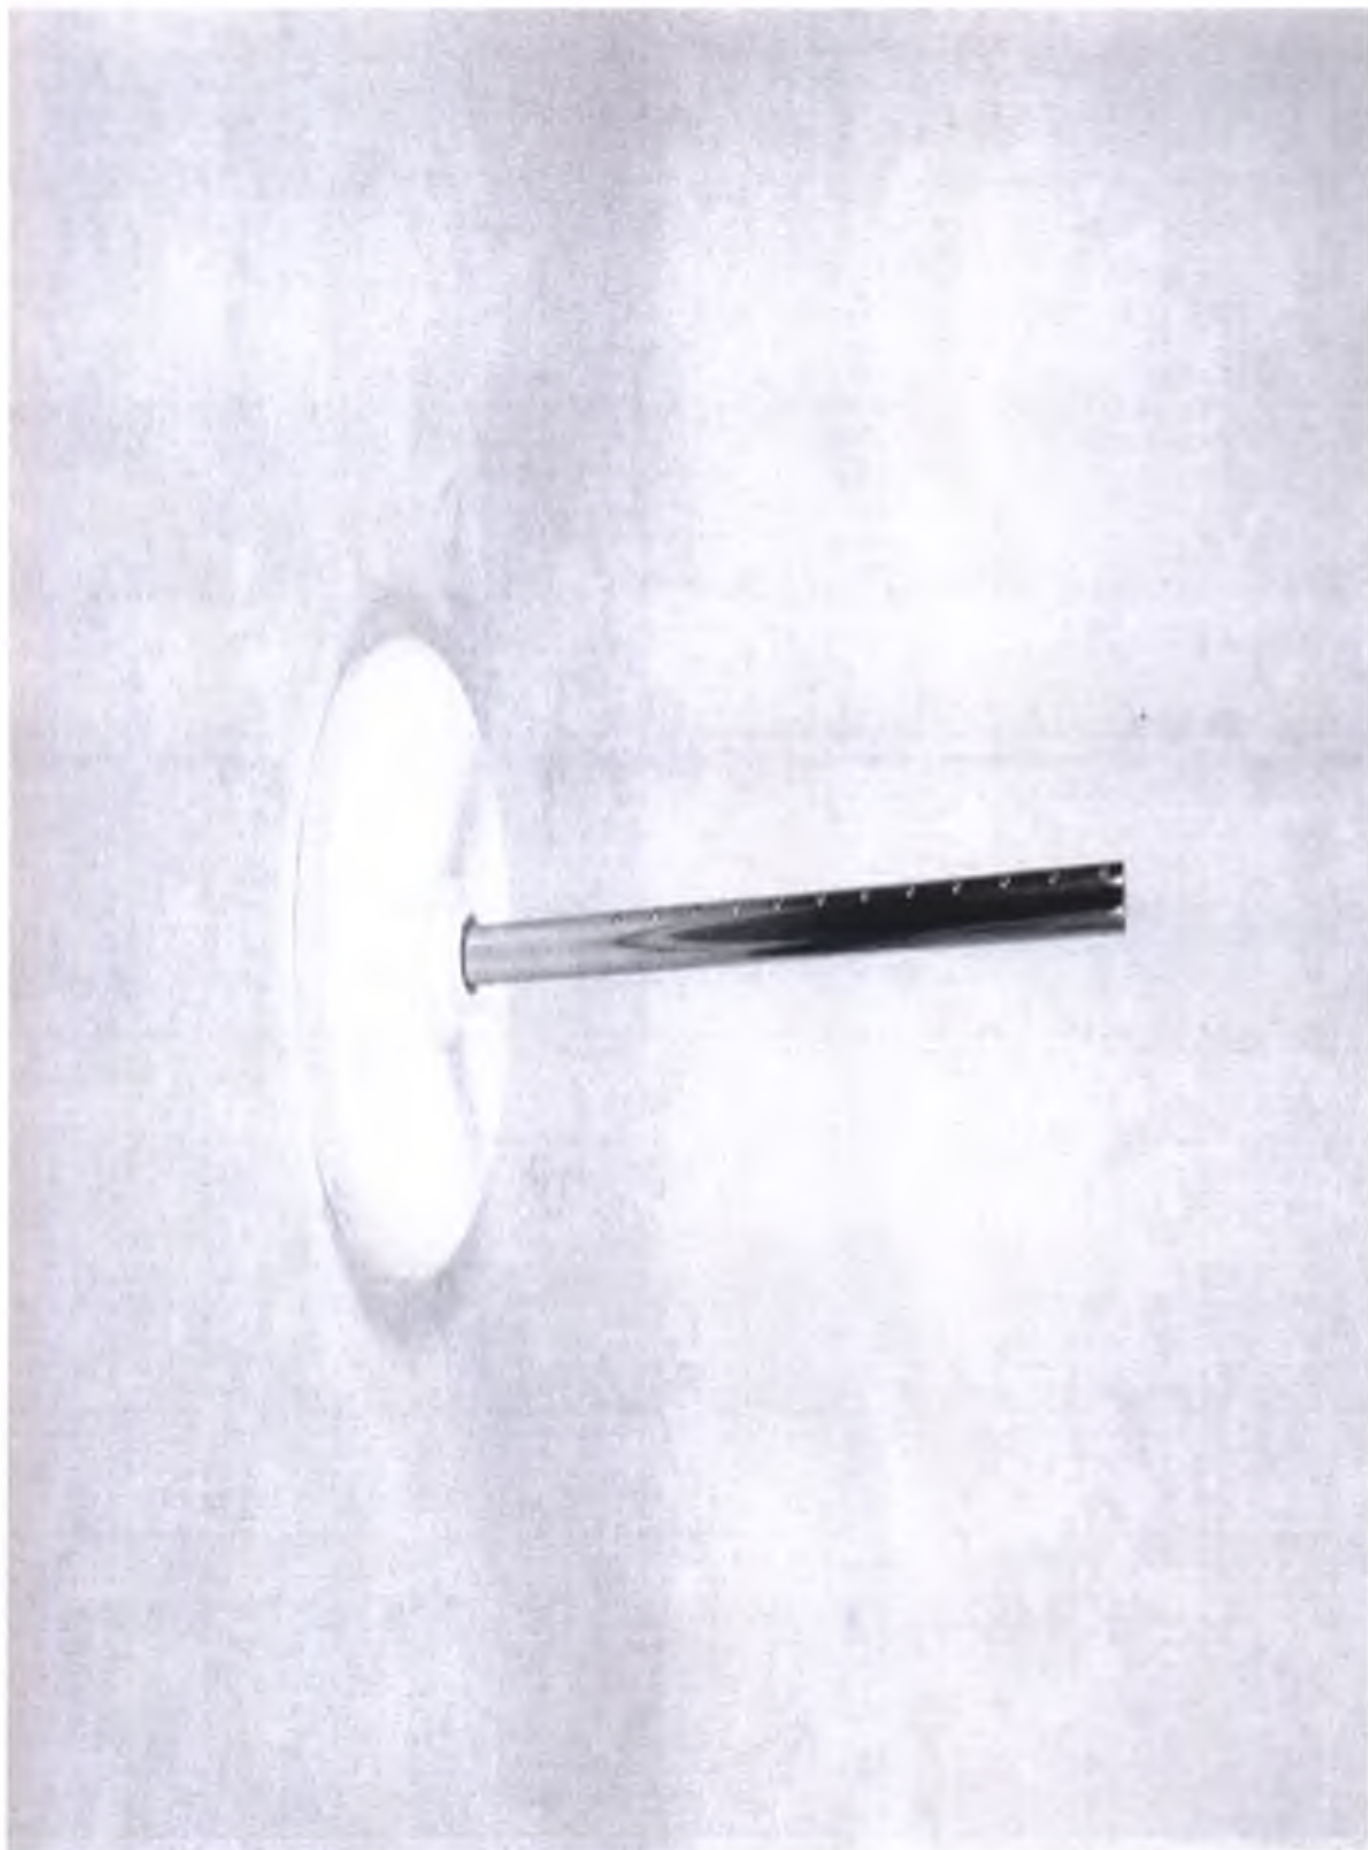


Рис 19. - Штатив потолочный;



Рис 20. - Штатив напольный с колонной;



Рис 21. - Штатив настольный;

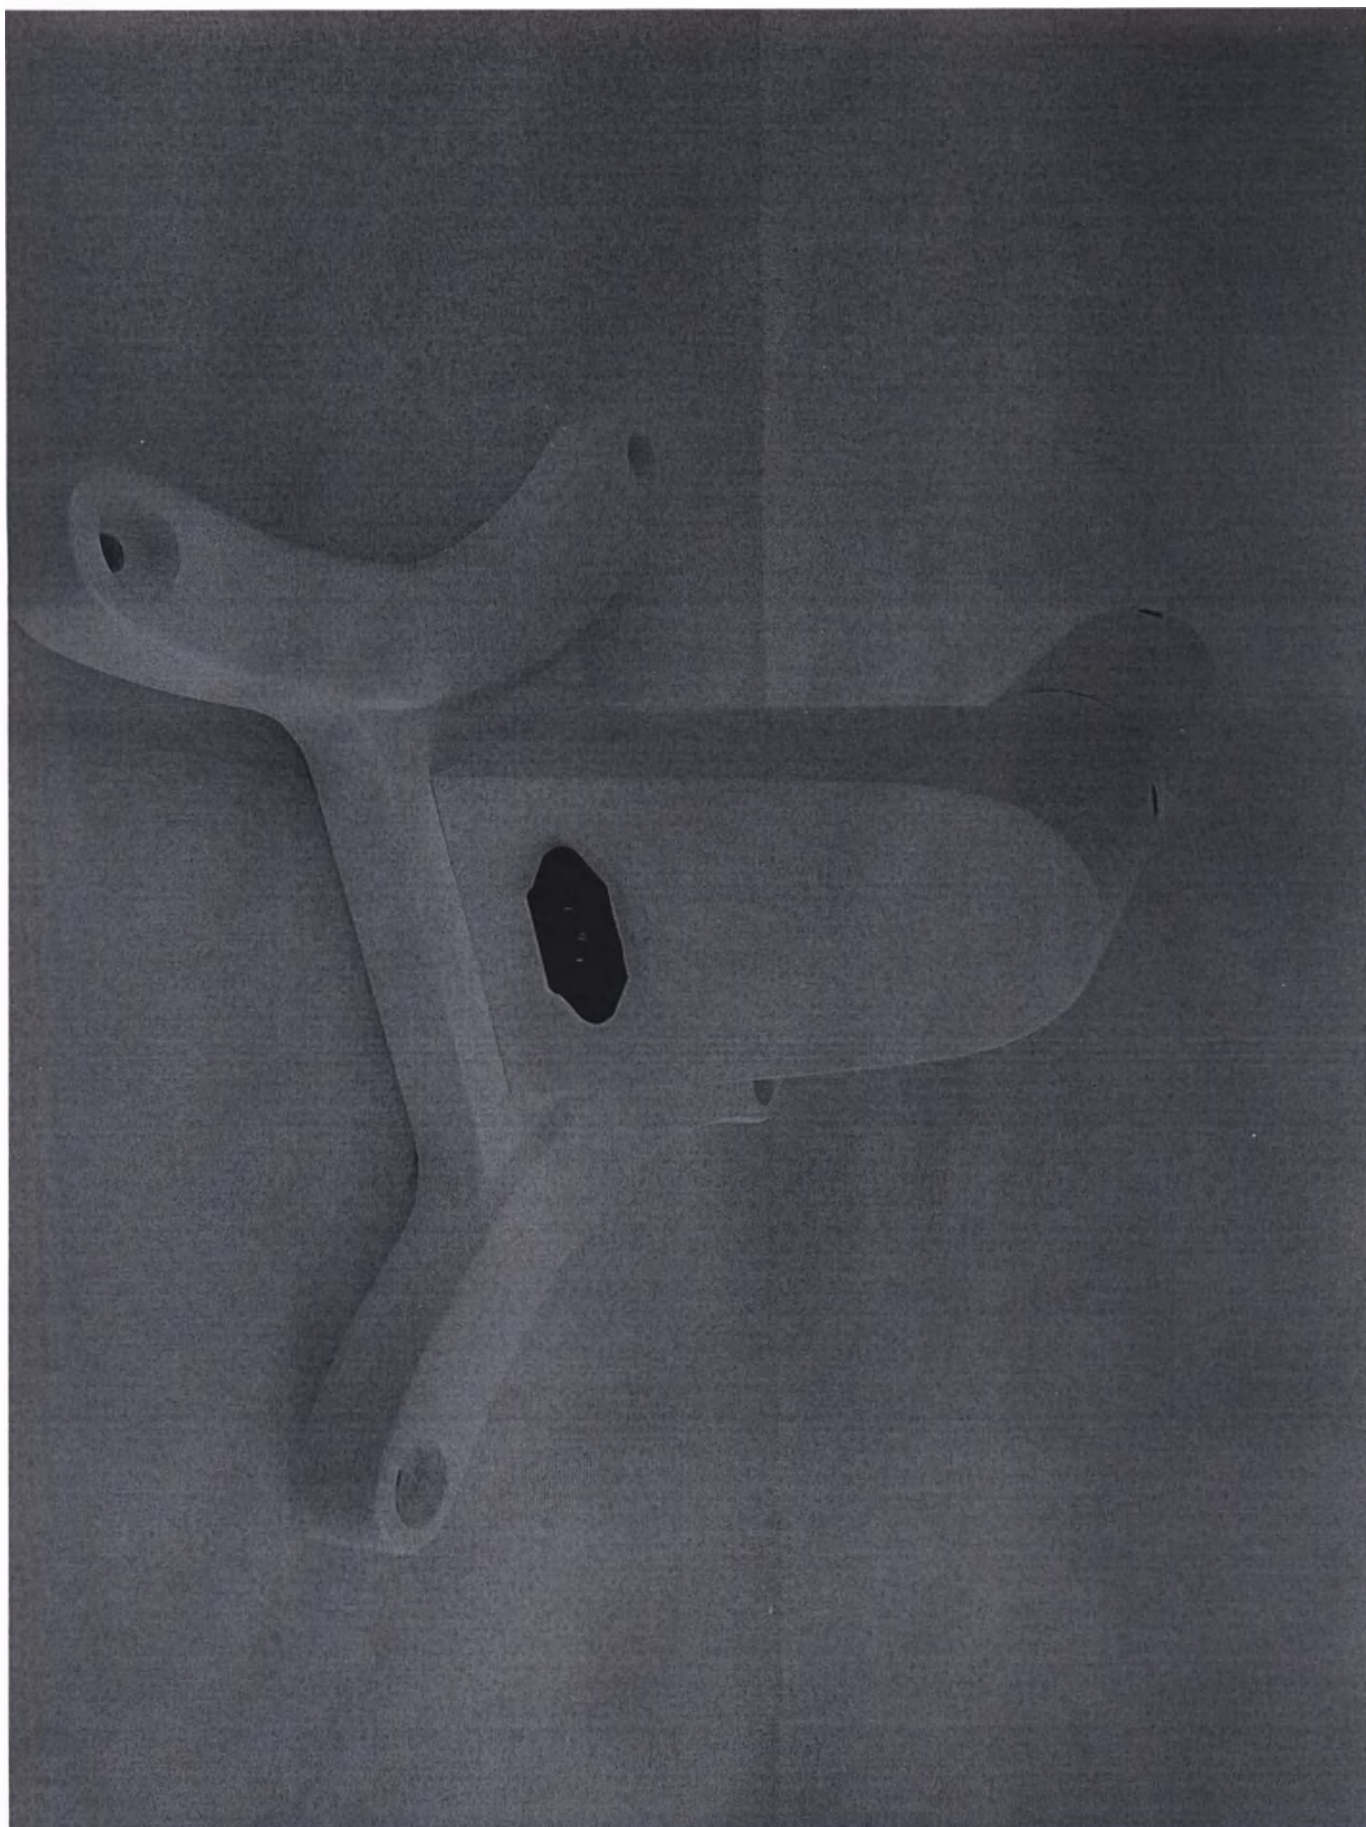


Рис 22. - Штатив настенный;

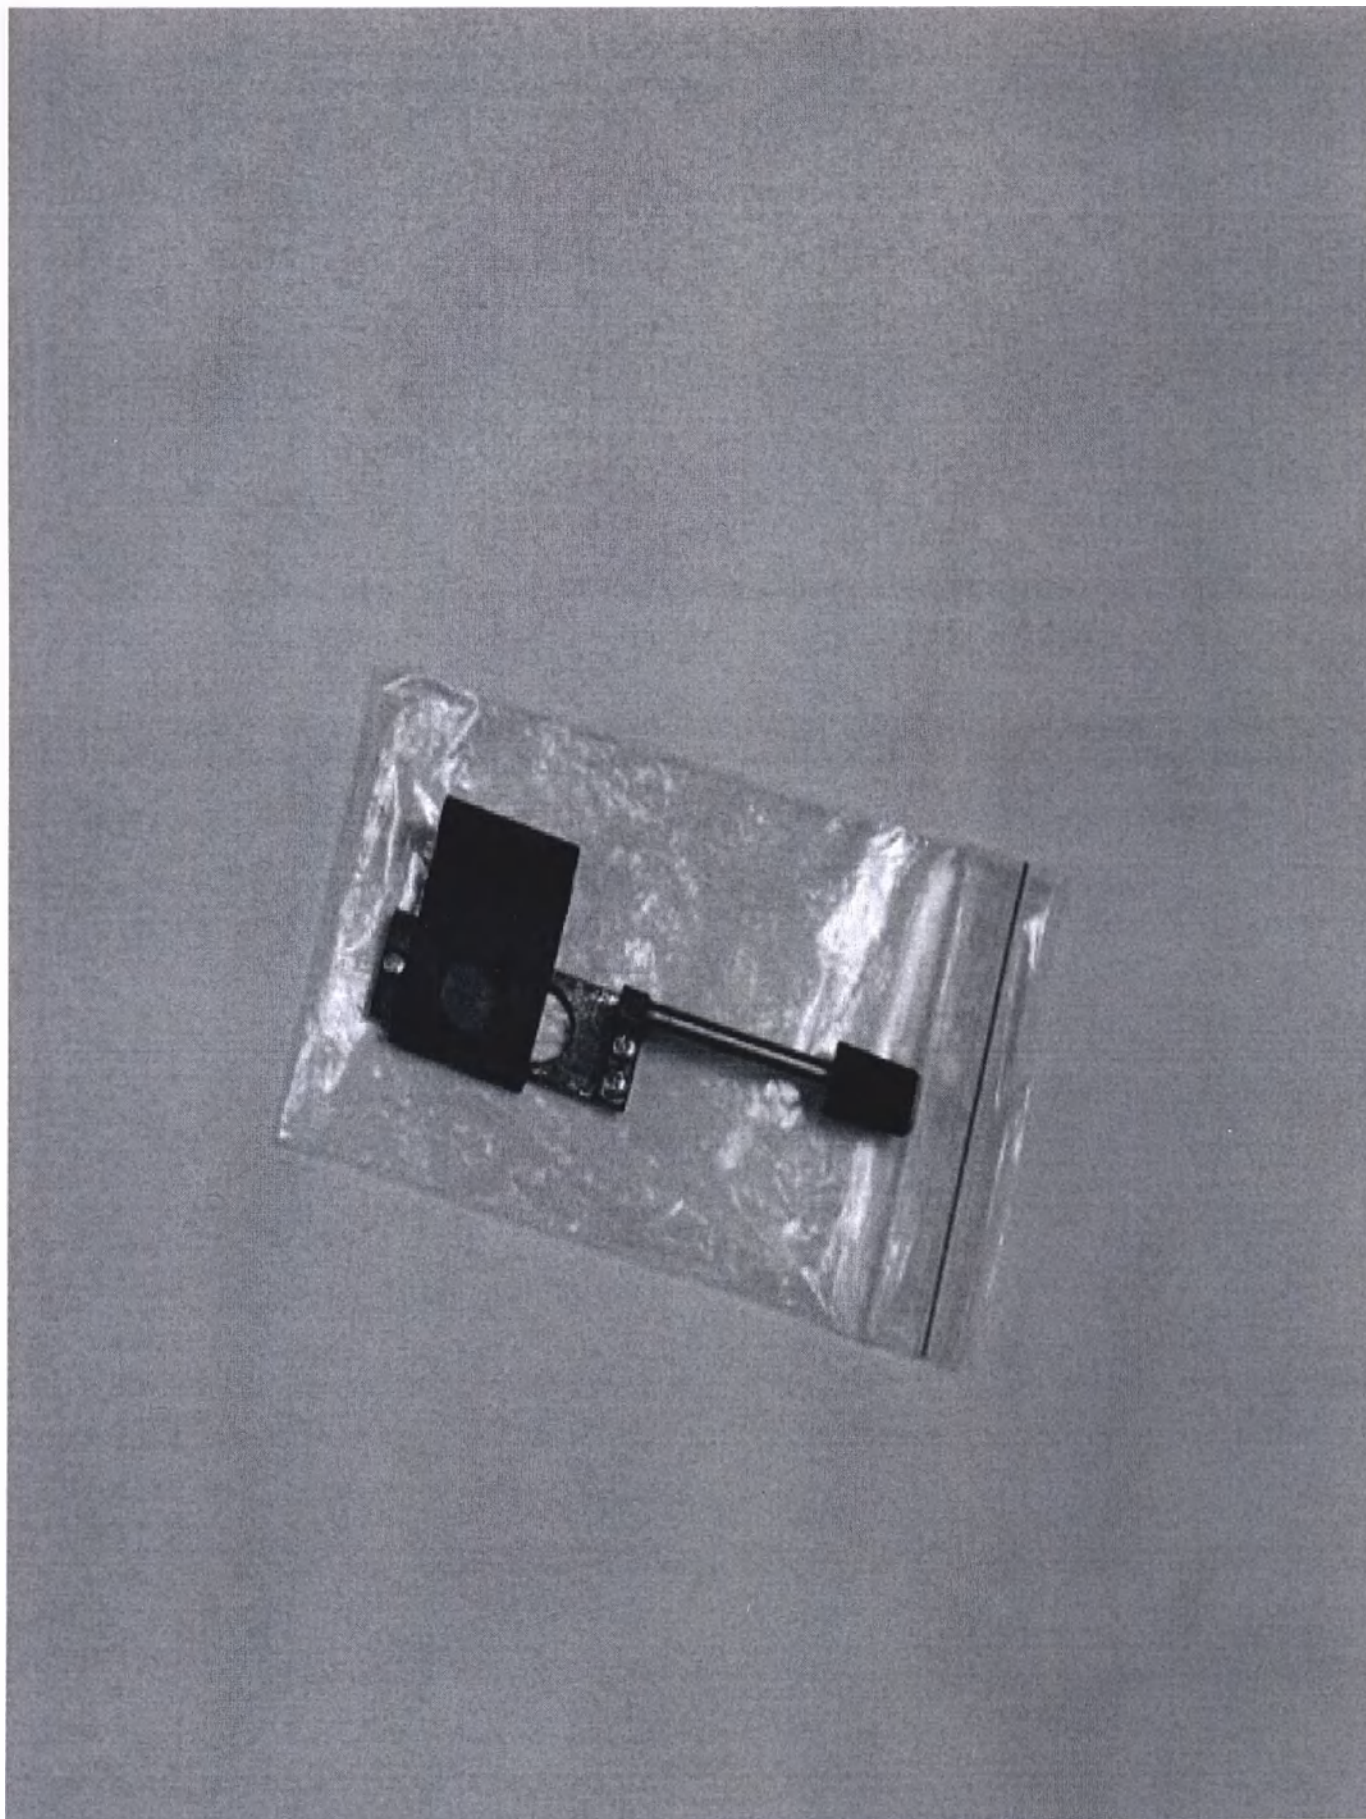


Рис 23. - Фильтр световой зеленый;



Рис 24. - Фильтр световой оранжевый;



Рис 25. - Фильтр для работы с лазером;

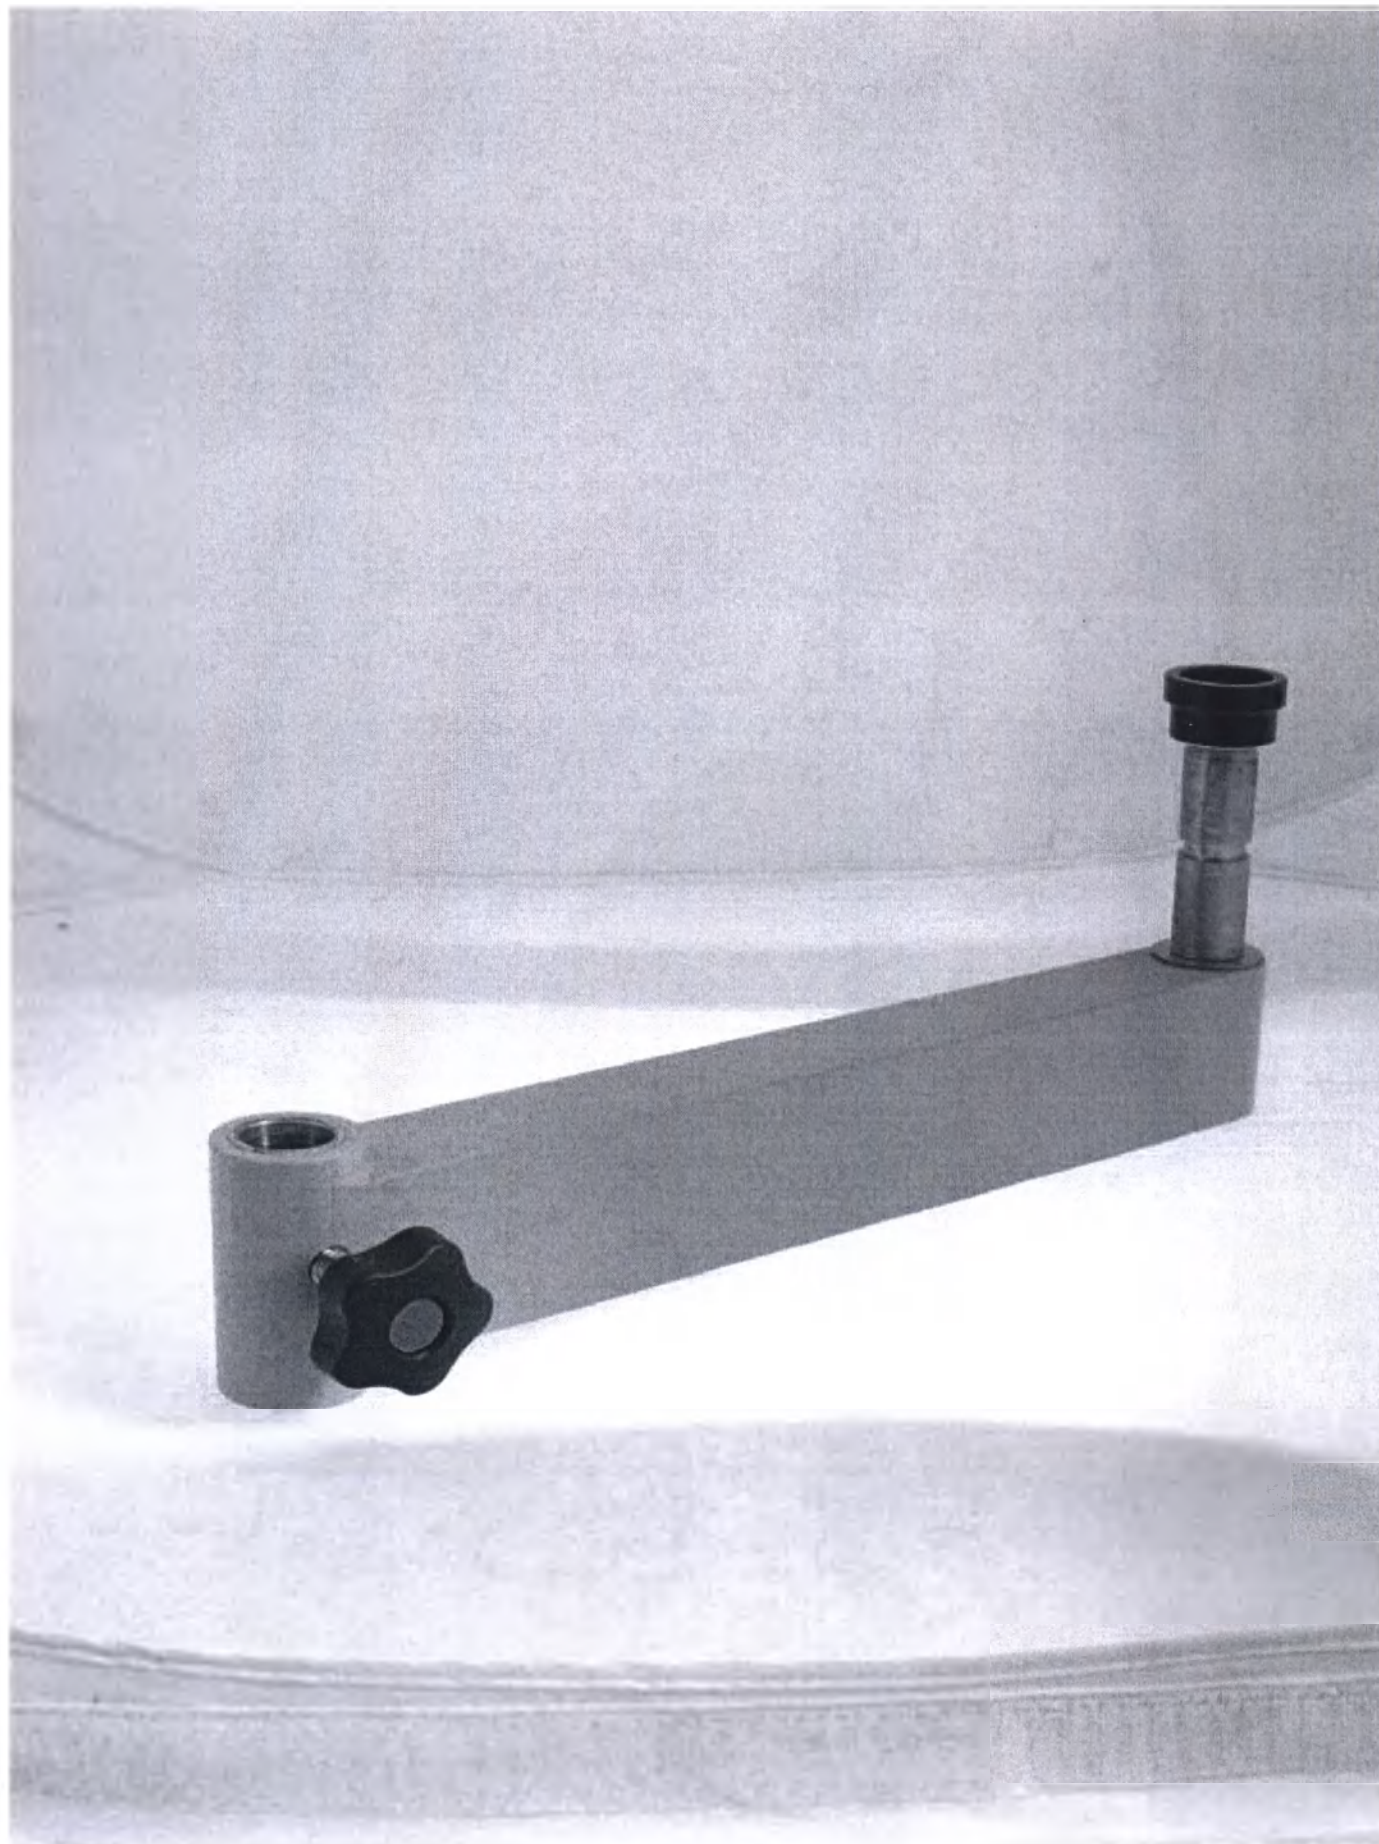


Рис 26. - Удлинитель плеча, длина 28 см;

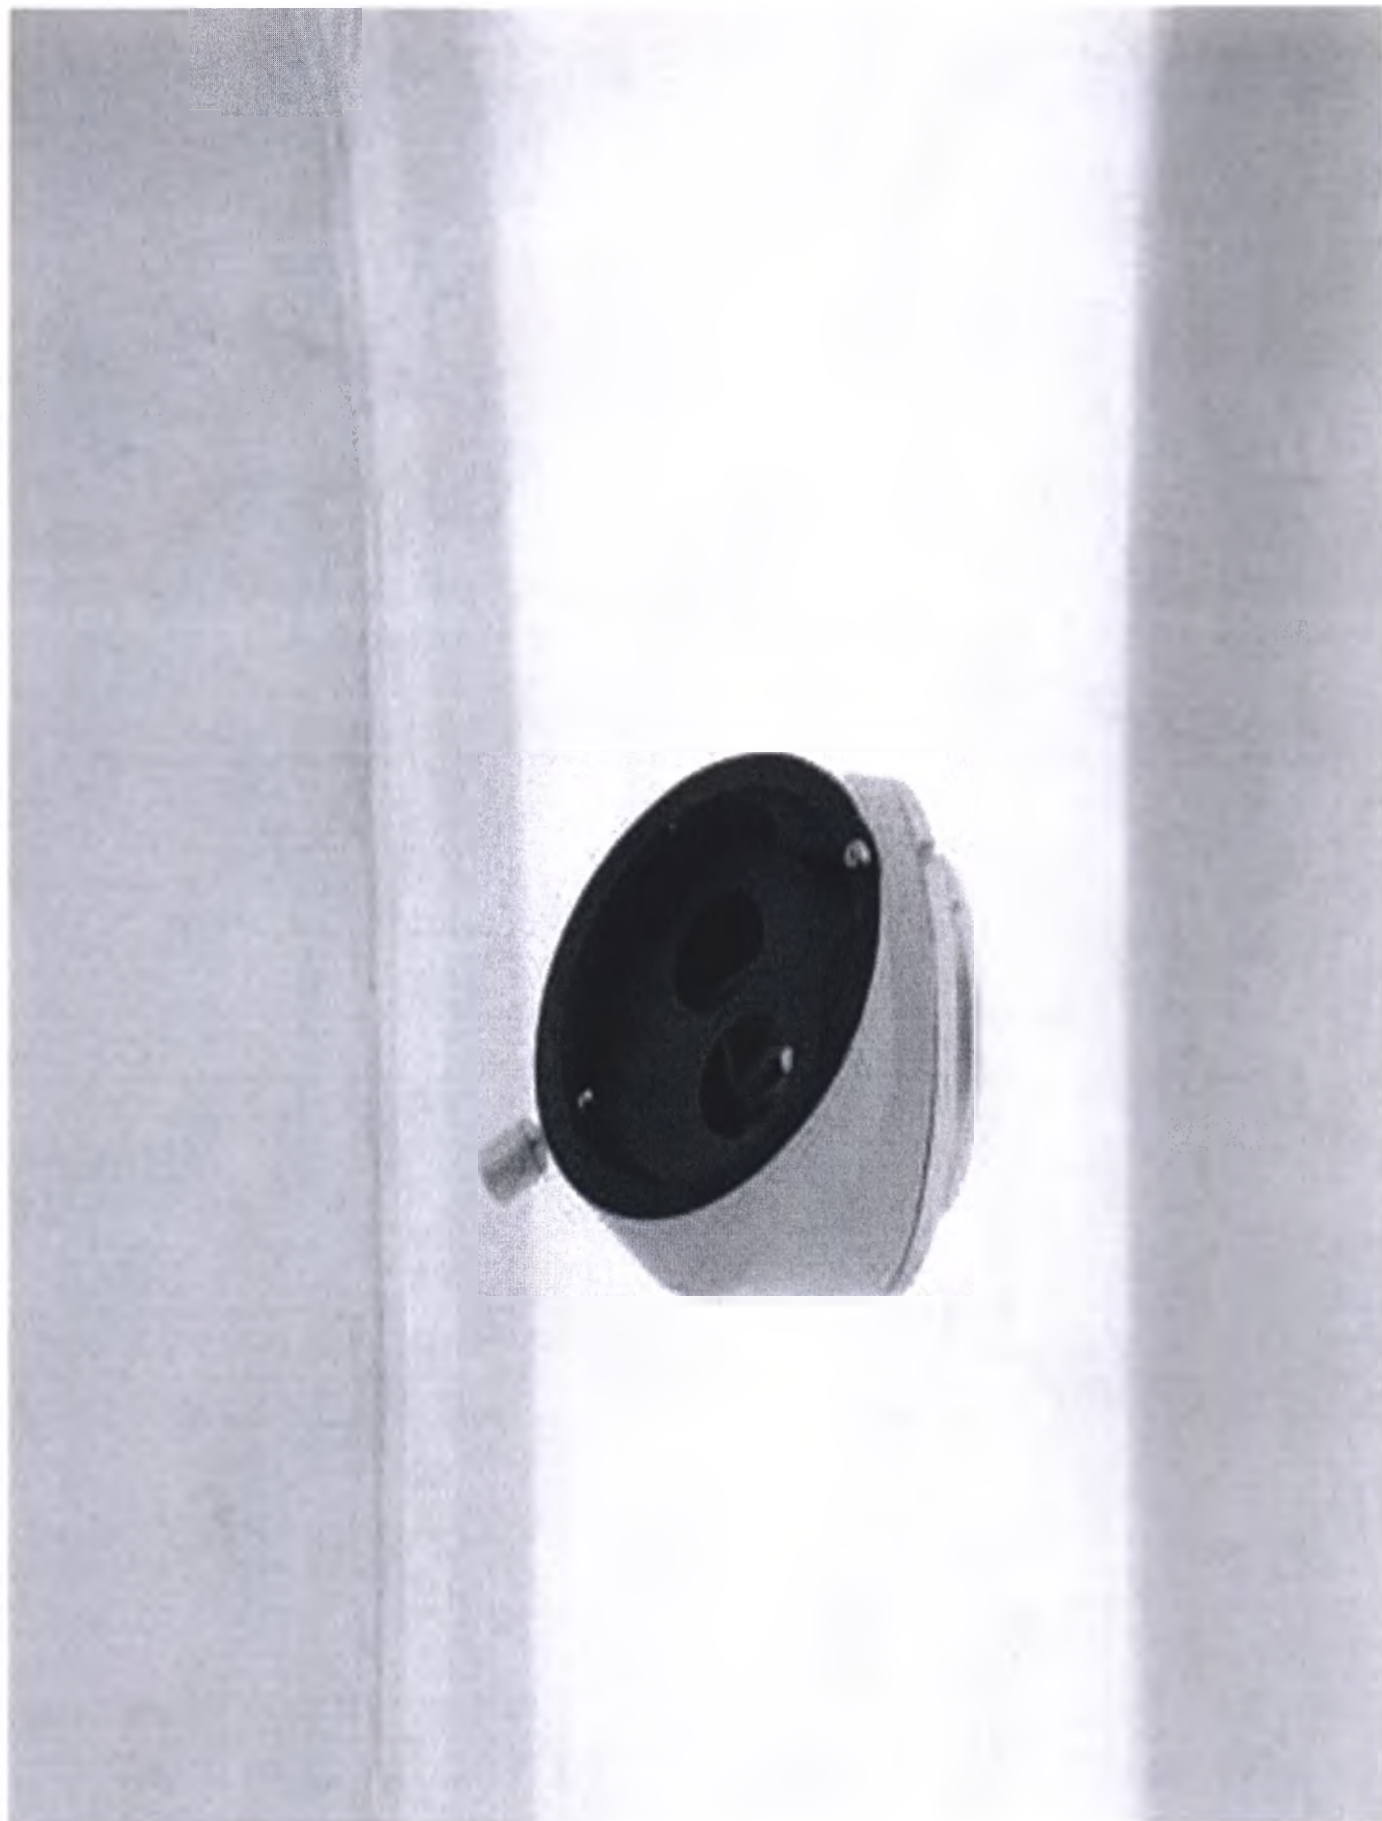


Рис 27. - Удлинитель бинокля;



Рис 28. - Кольцо вращения бинокля;

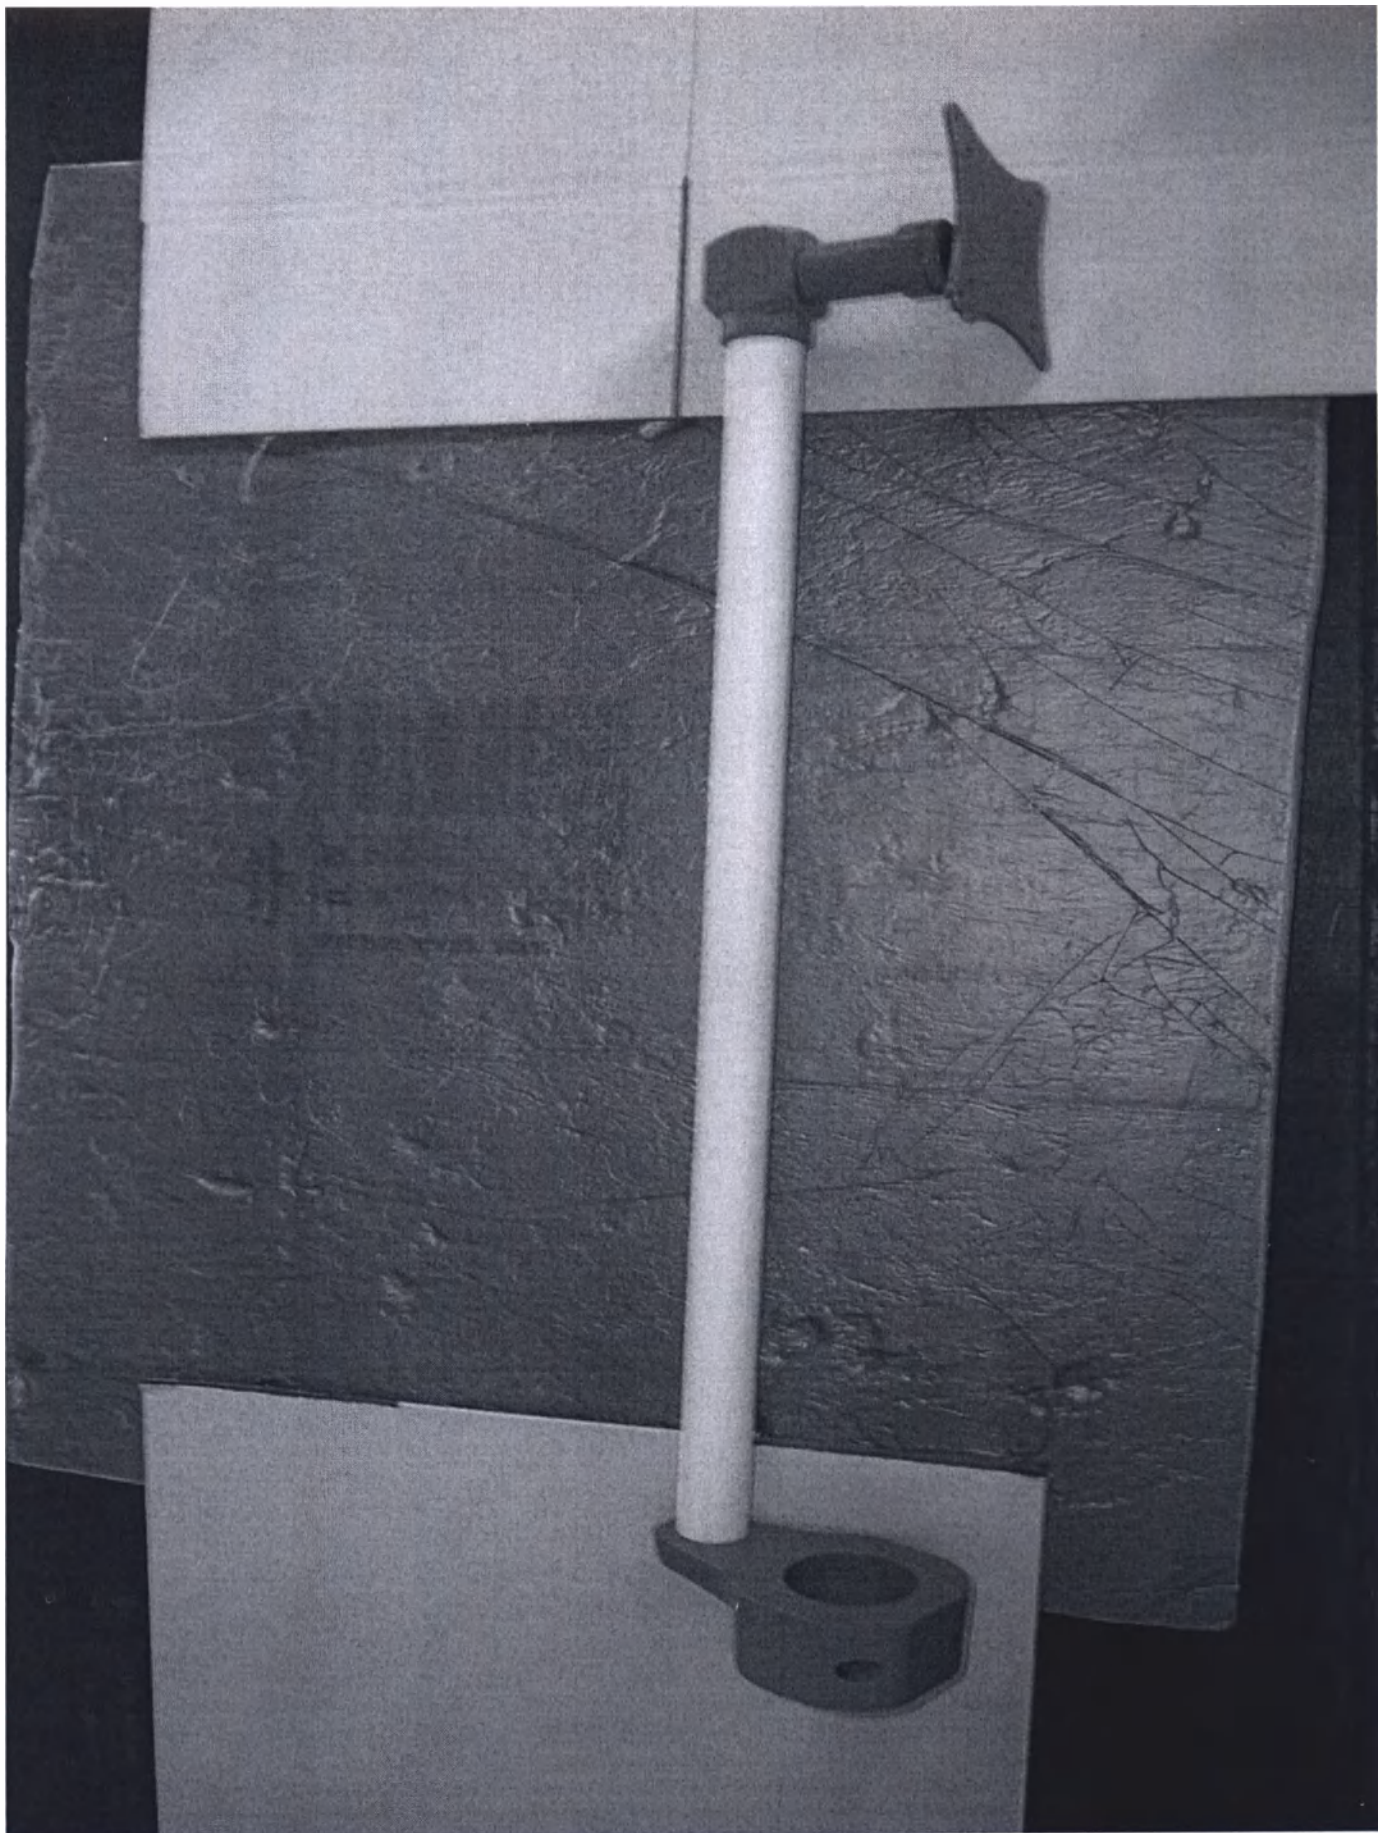


Рис 29. - Крепление монитора;

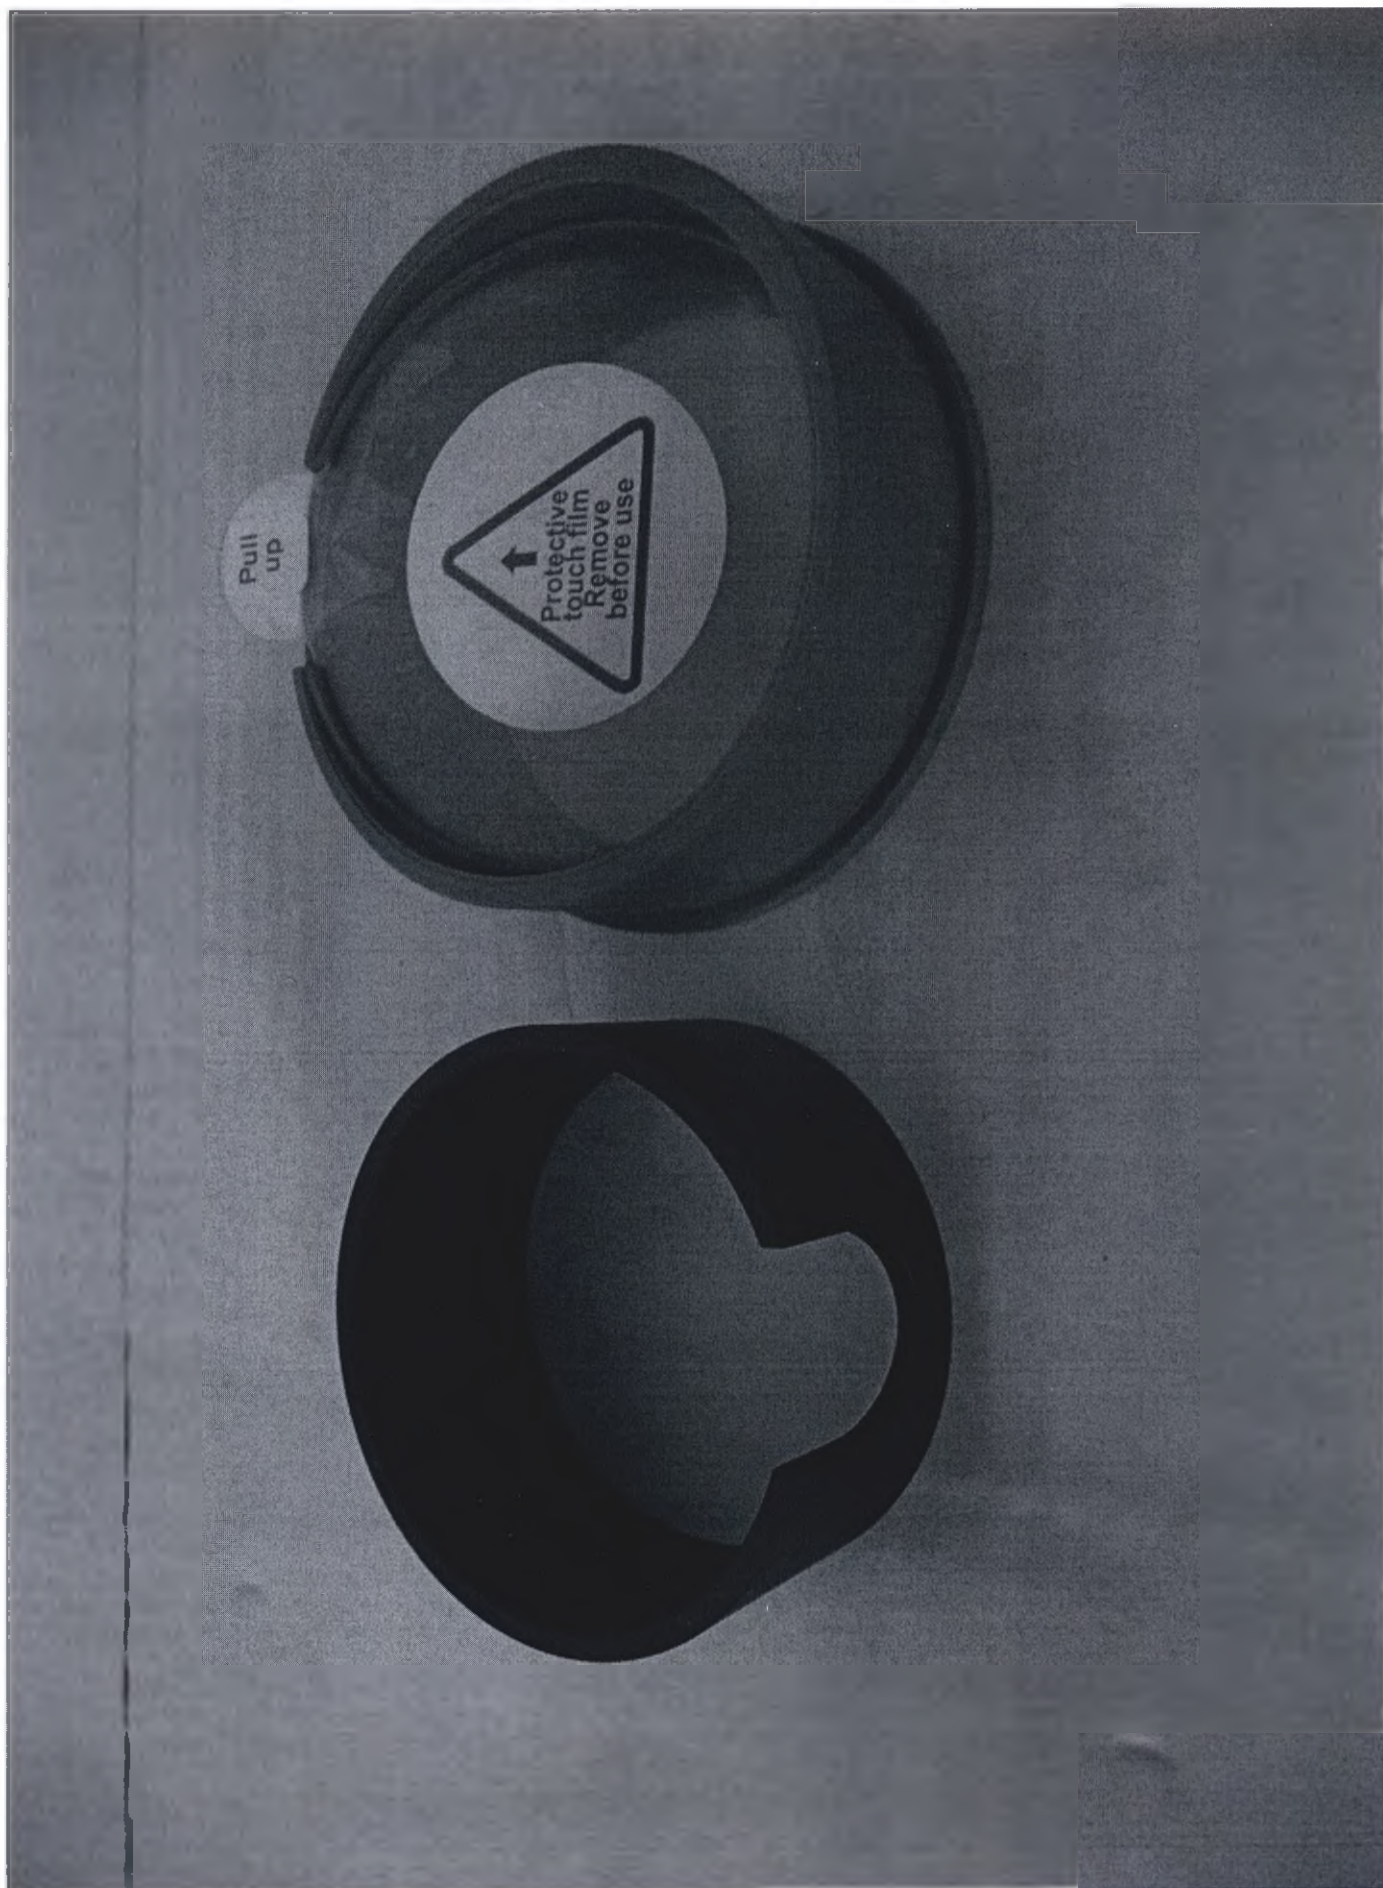


Рис 30. - Крышка линзы объектива;



Рис 31. - Камера цифровая специальная с делителем луча;

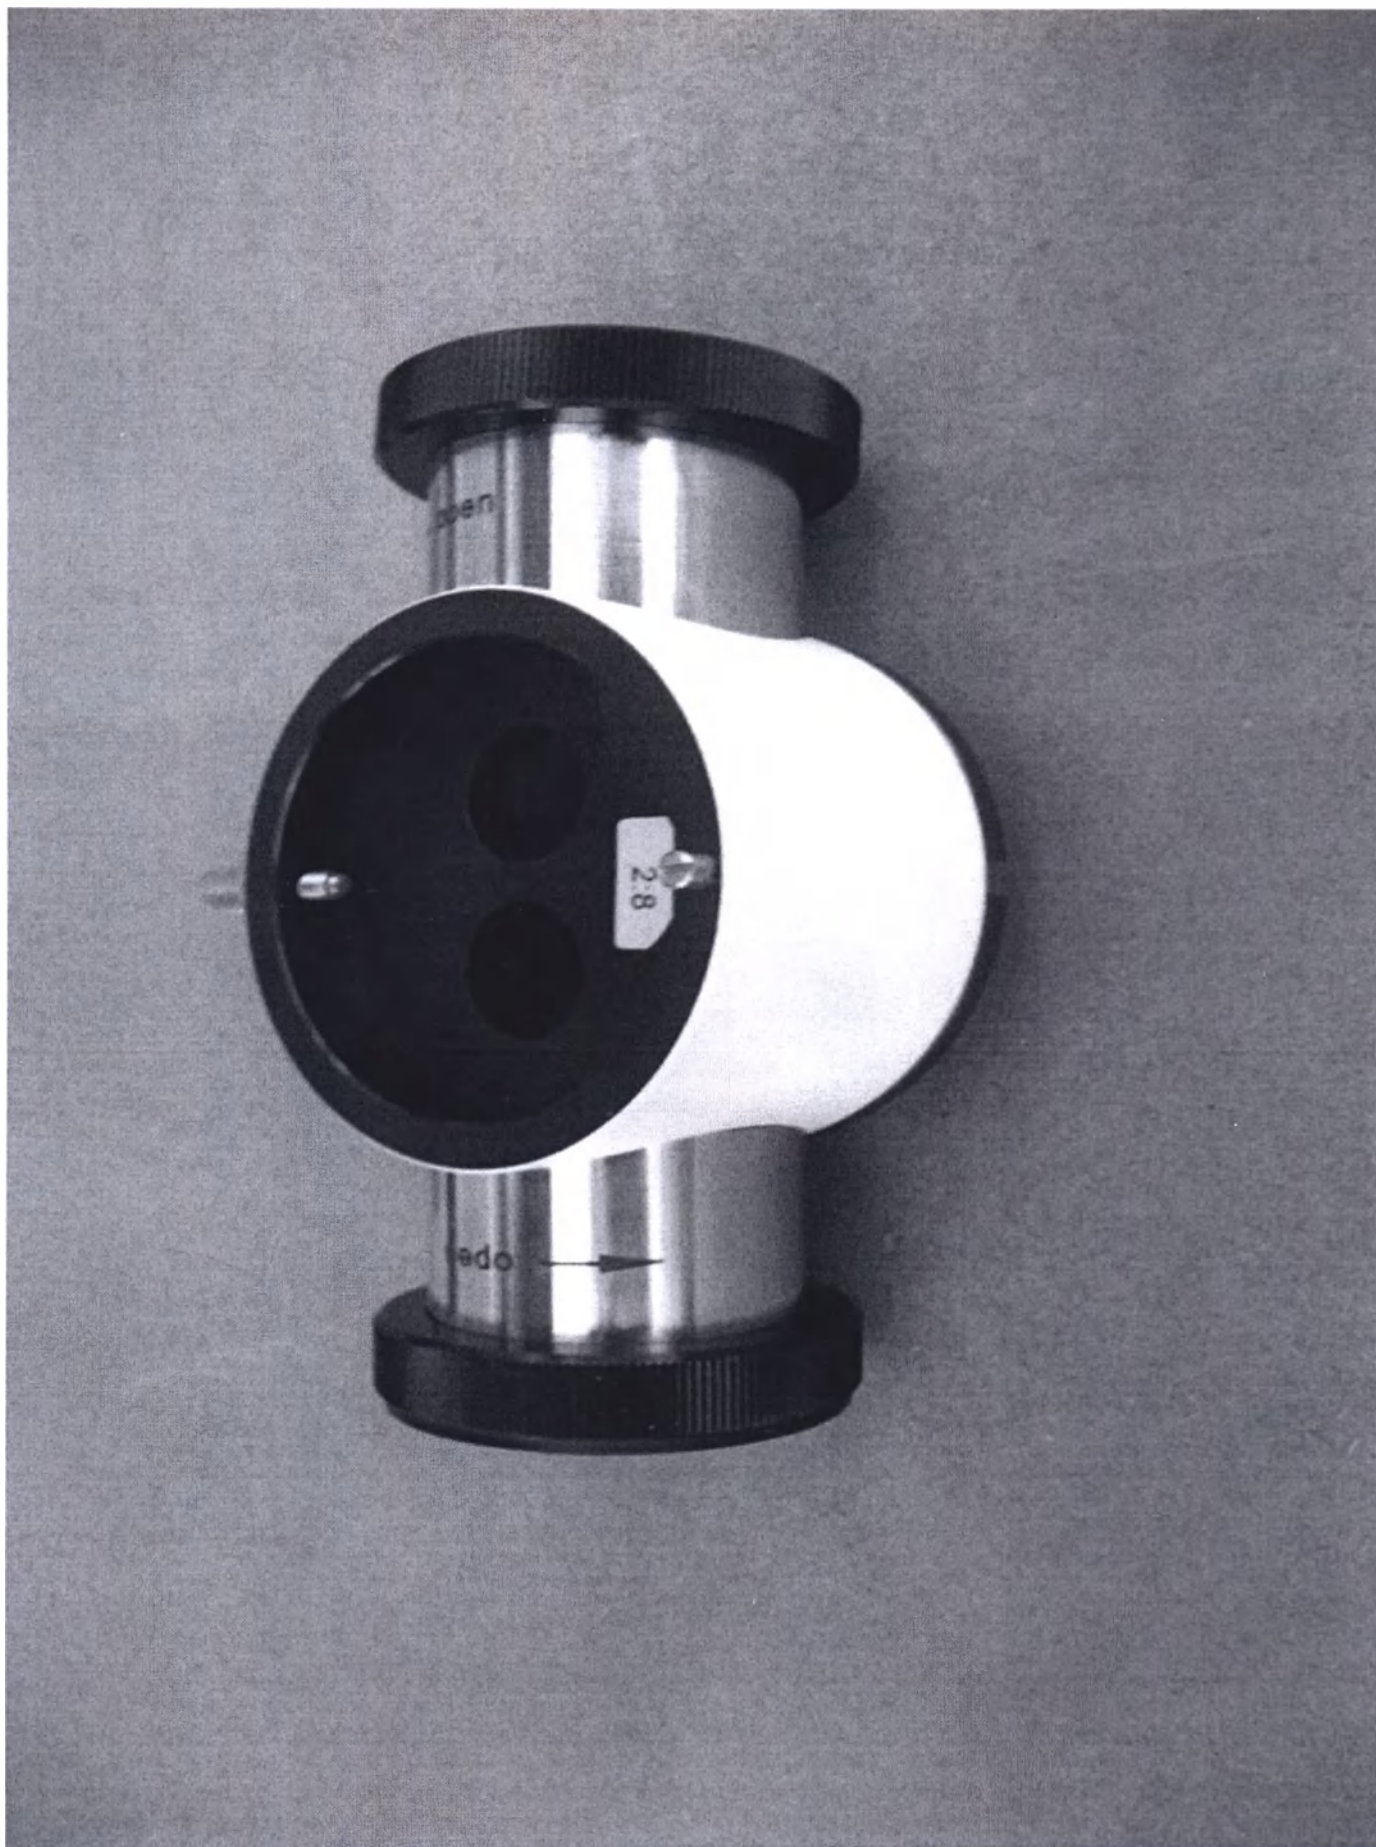


Рис 32. - Делитель луча;



Рис 33. - Адаптер для зеркальной фотокамеры;



Рис 34. - Адаптер для компактной фотокамеры;



Рис 35. - Адаптер для видеокамеры;

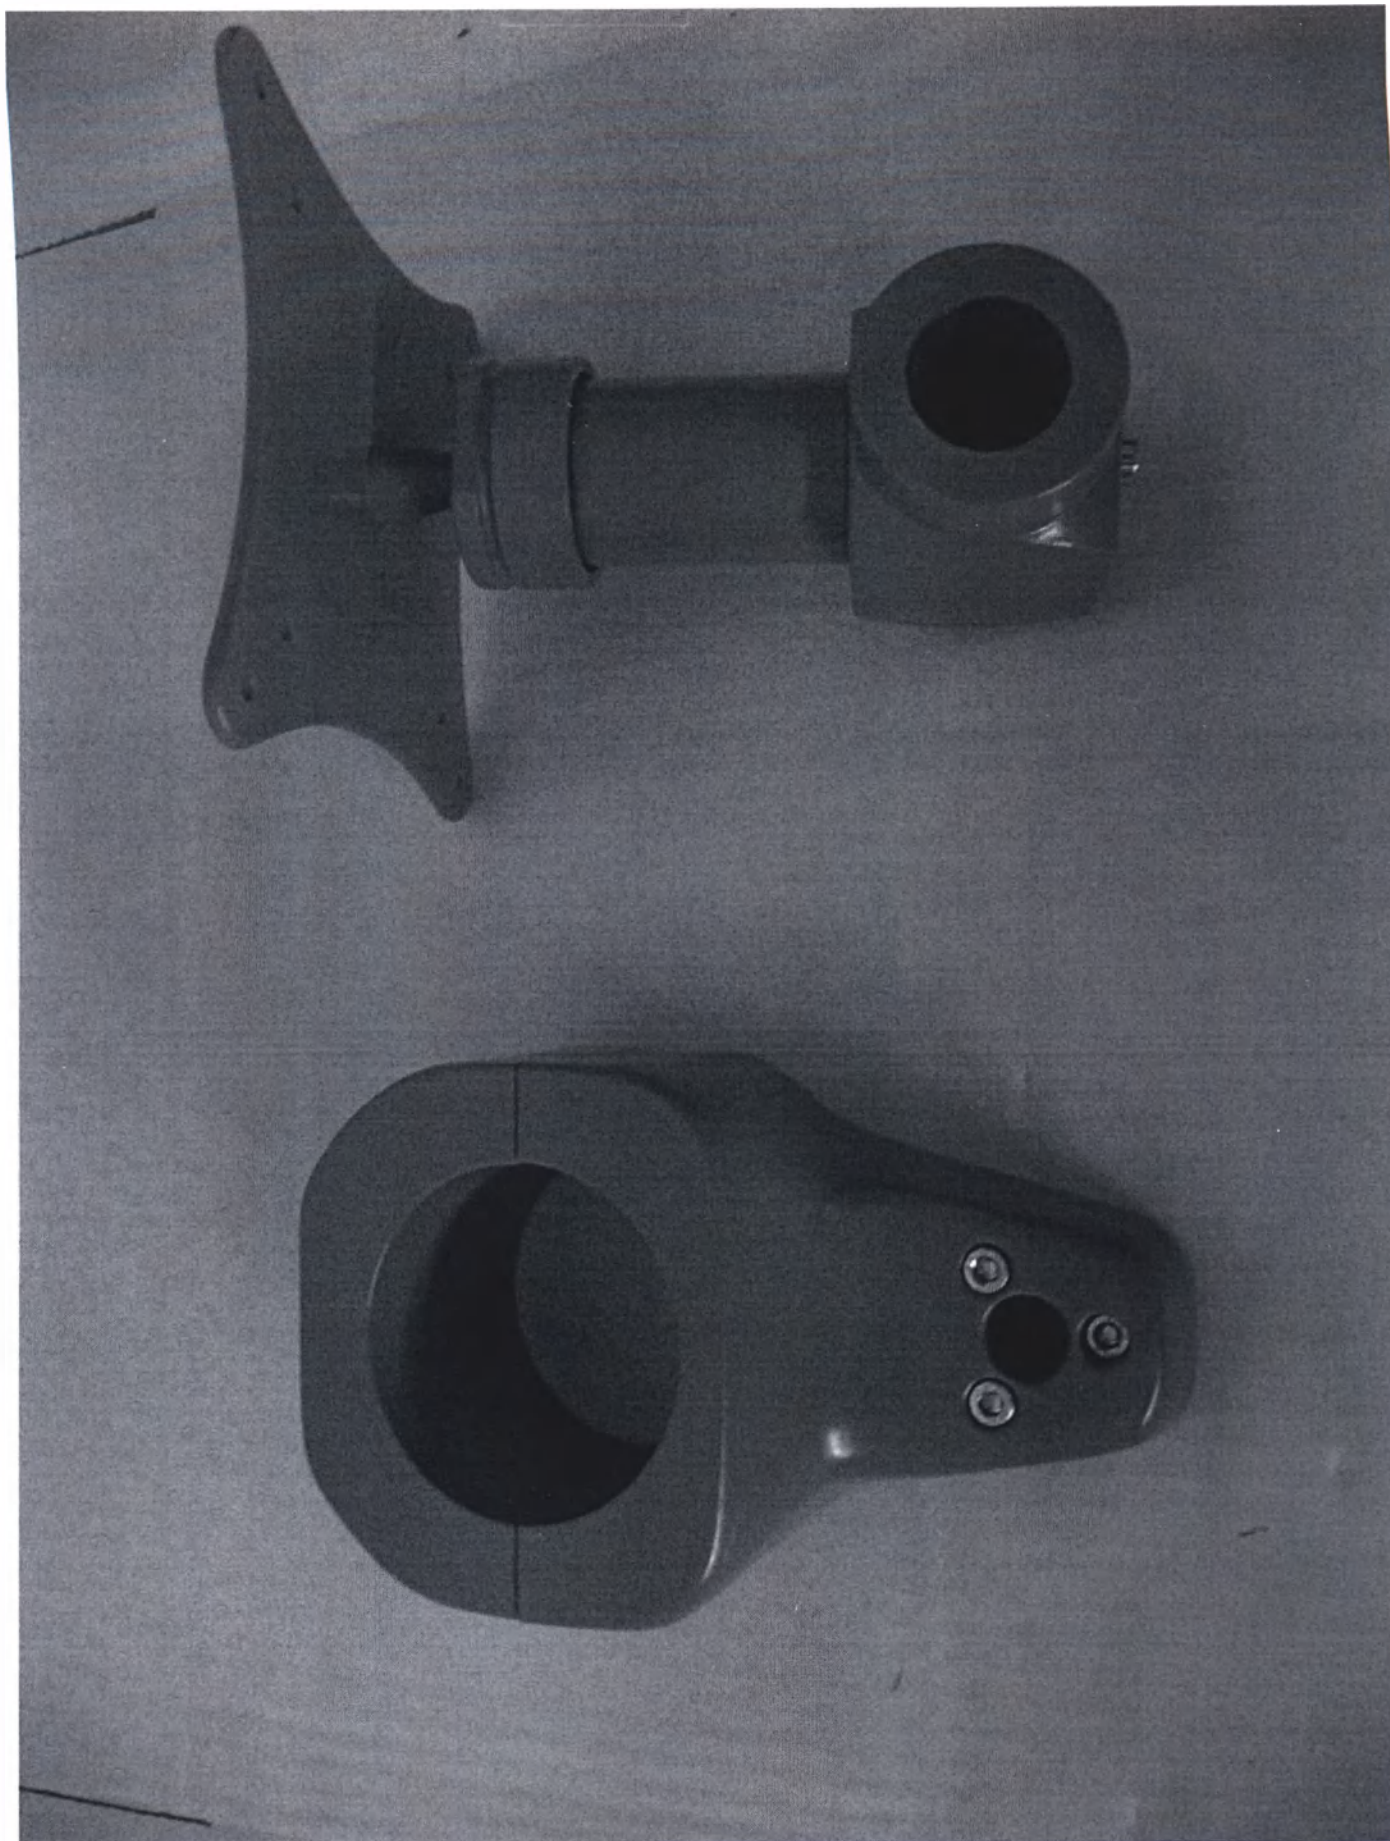


Рис 36. - Адаптер для монитора;



Рис 37. - Уплотнение окуляров;



Рис 38. - Кабель оптоволоконный;

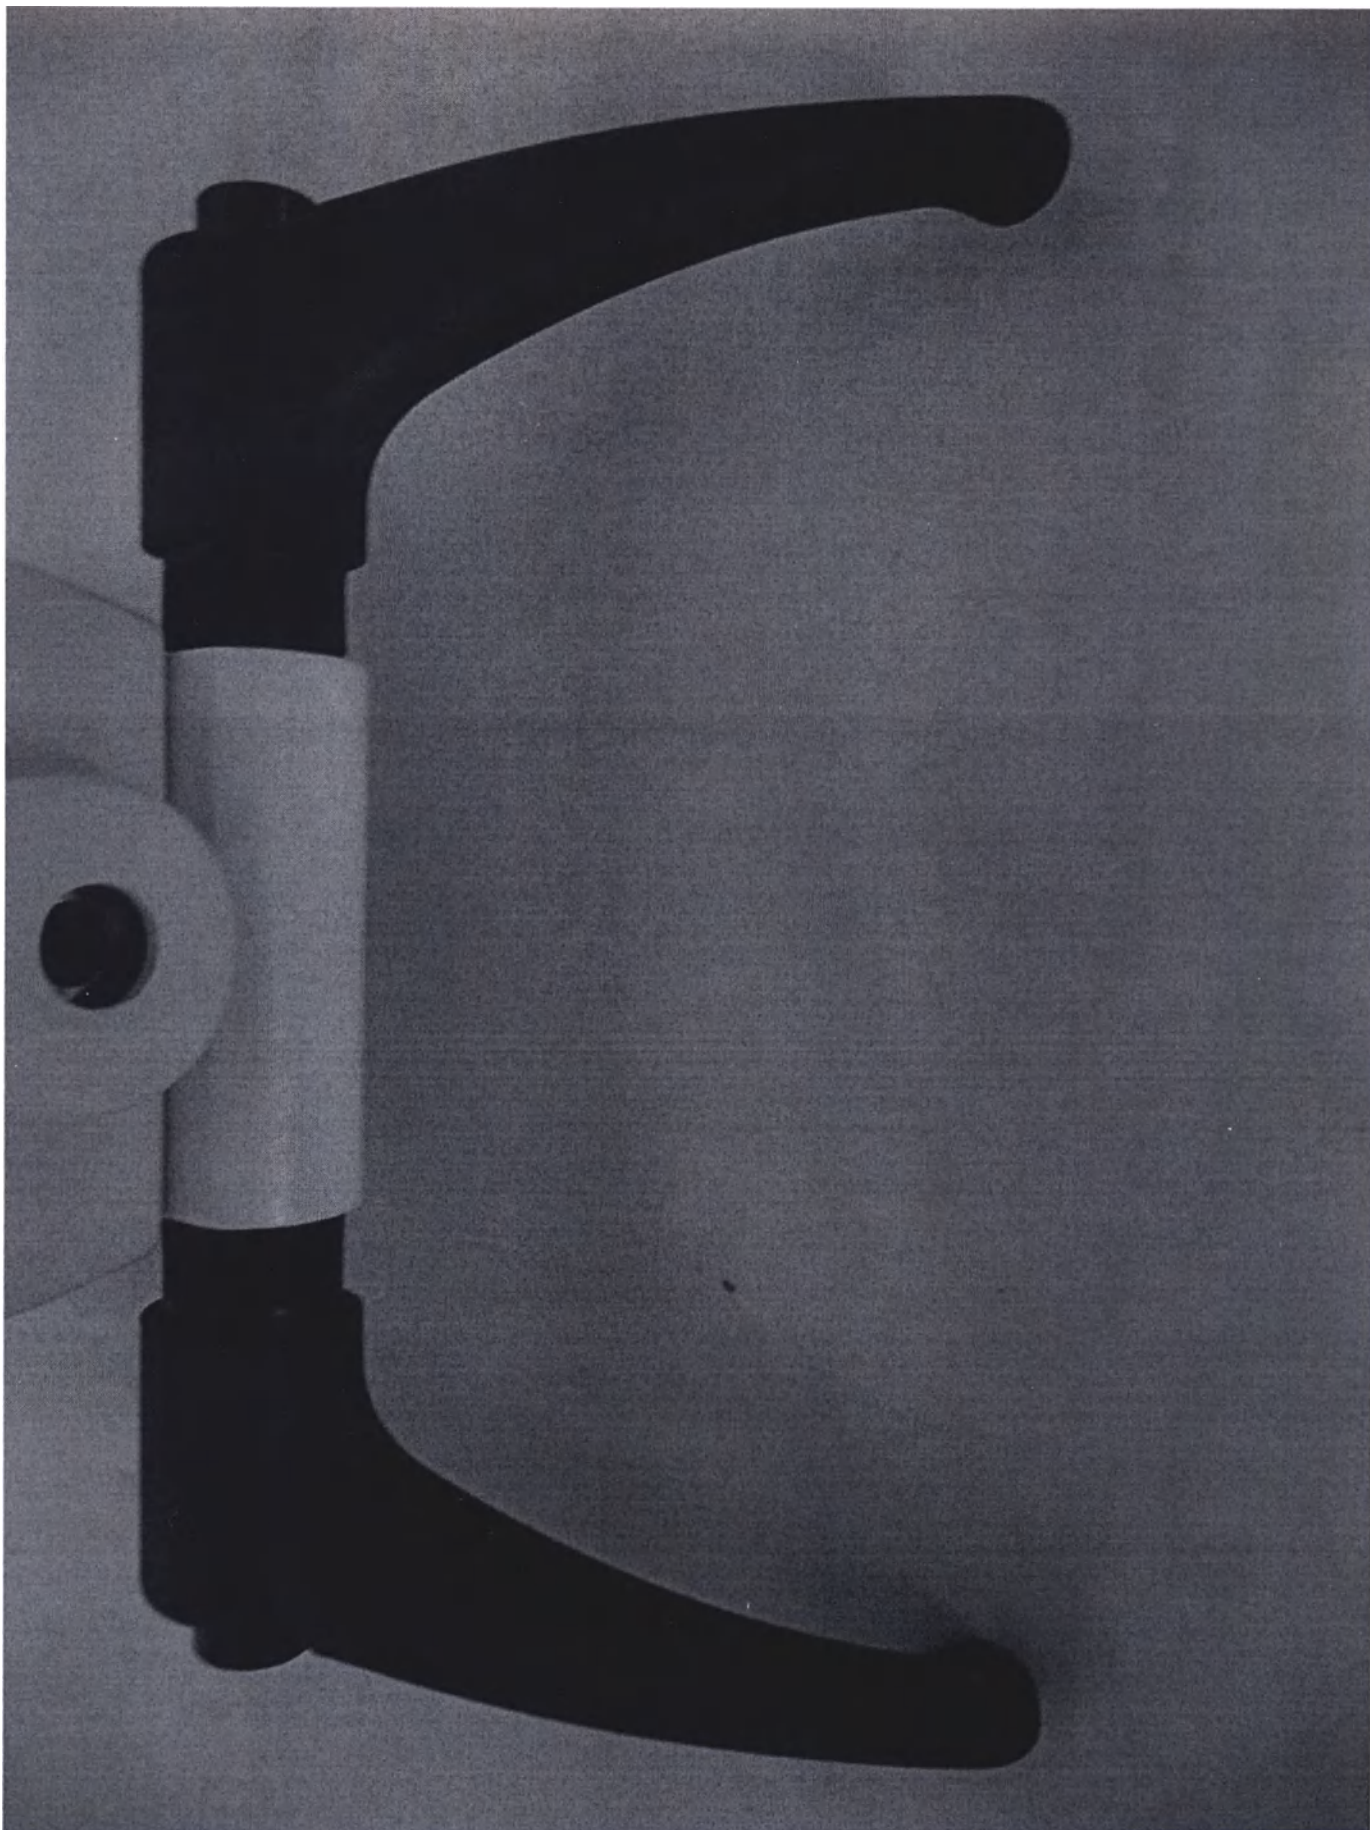


Рис 39. - Ручки управления бинокляром;

DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01, Piešťany
Tel.: 00421/33/7954111
IČO: 36 222 009, IČ DPH: SK2020168807

**«Микроскоп стоматологический DENSIM с
принадлежностями, варианты исполнения:
DENSIM OPTICS, DENSIM OPTICS VARIO»**

Производитель: DIPLOMAT DENTAL s.r.o., Vrbovská cesta 17, 921
01, Piešťany, Slovak Republic, tel/fax: +421 33 7954 111 / +421 33 7726 326,
E-mail: info@diplomat-dental.com.

Руководство по эксплуатации

Рис 40. - Руководство по эксплуатации.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 544 лист(ов)
Генеральный директор АО «ЭУР-МЕД
Денталдепо» _____ С.Г. Козлов

