

Аппарат для терапии оксидом азота АИТ-НО-01,
ТУ 32.50.21-001-07623615-2017



Блок мониторинга NO, NO₂




Генератор



Электроблок




Блок подачи воздуха

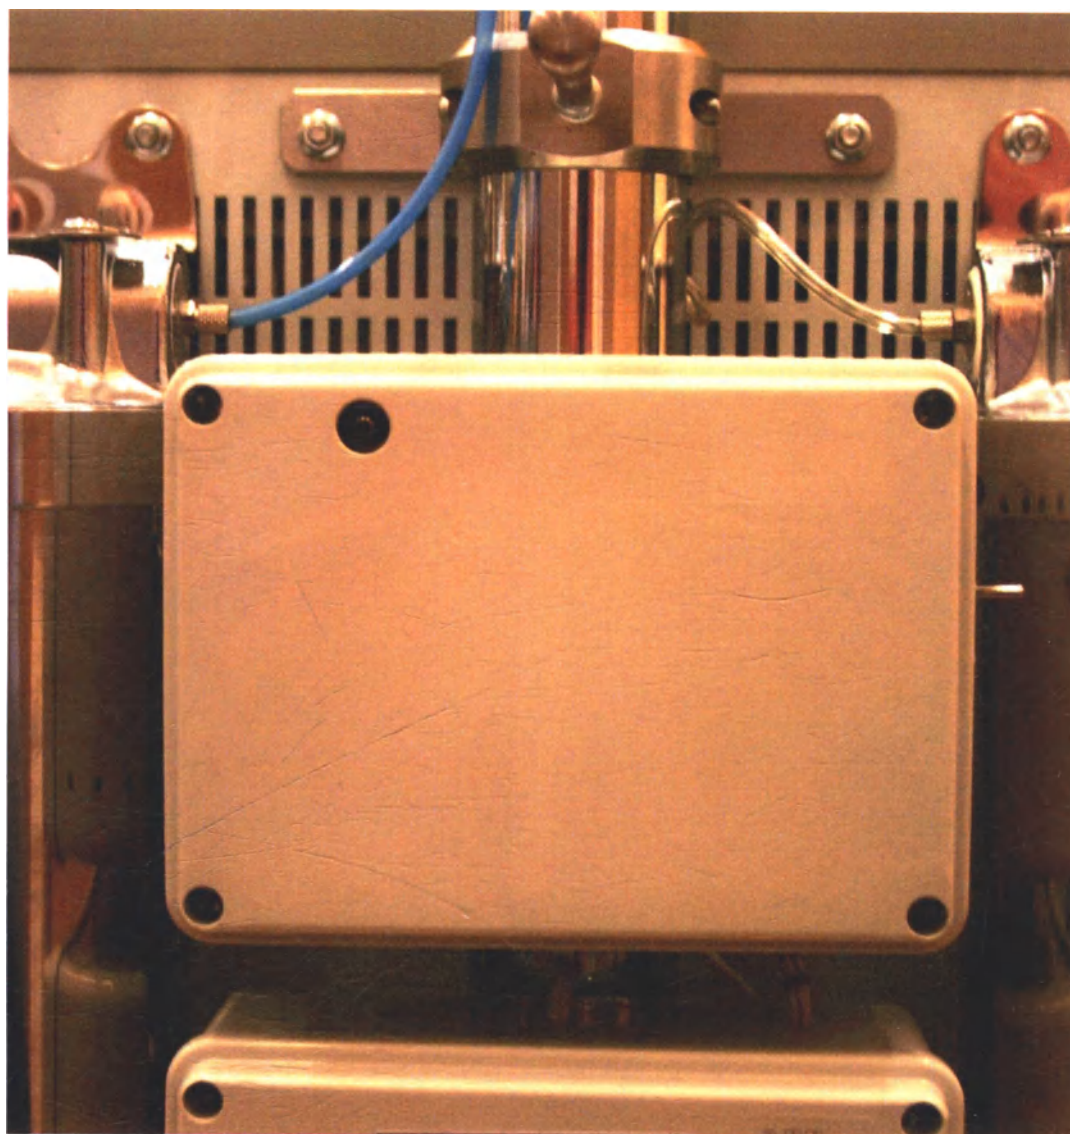

Стойка с основанием



Блок очистки

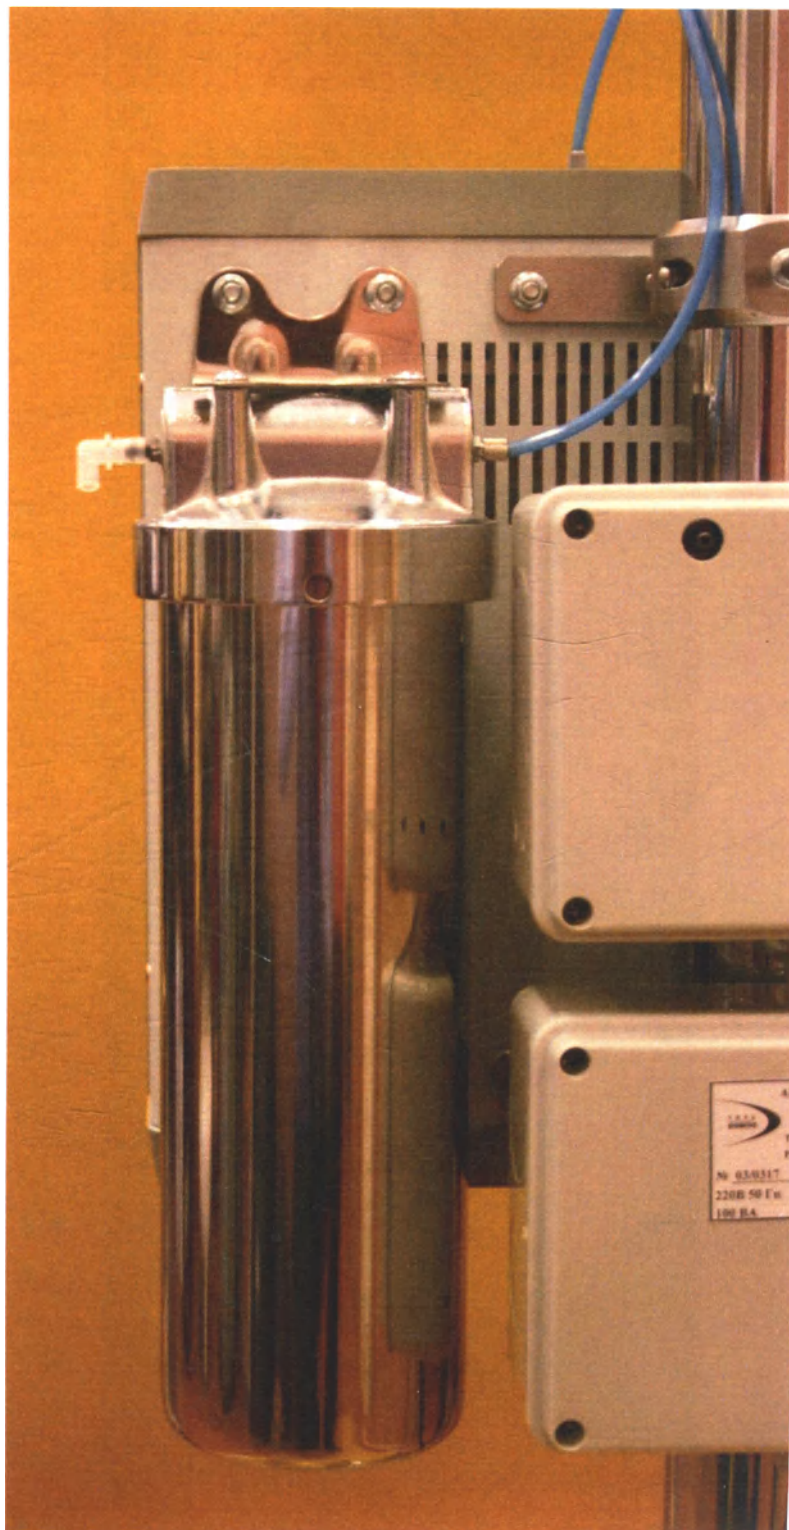

Нейтрализатор




Сумка для блока мониторинга




Ручка для снятия колбы блока очистки



Предохранитель

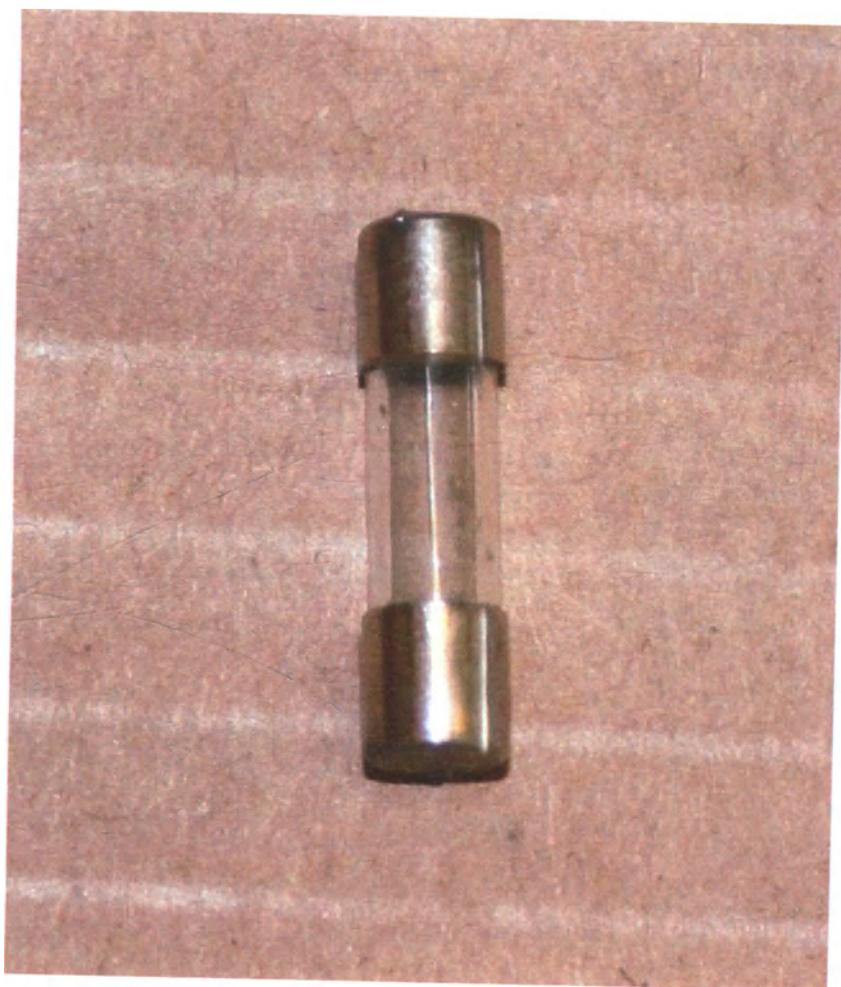

Трубки для подсоединения к дыхательному контуру

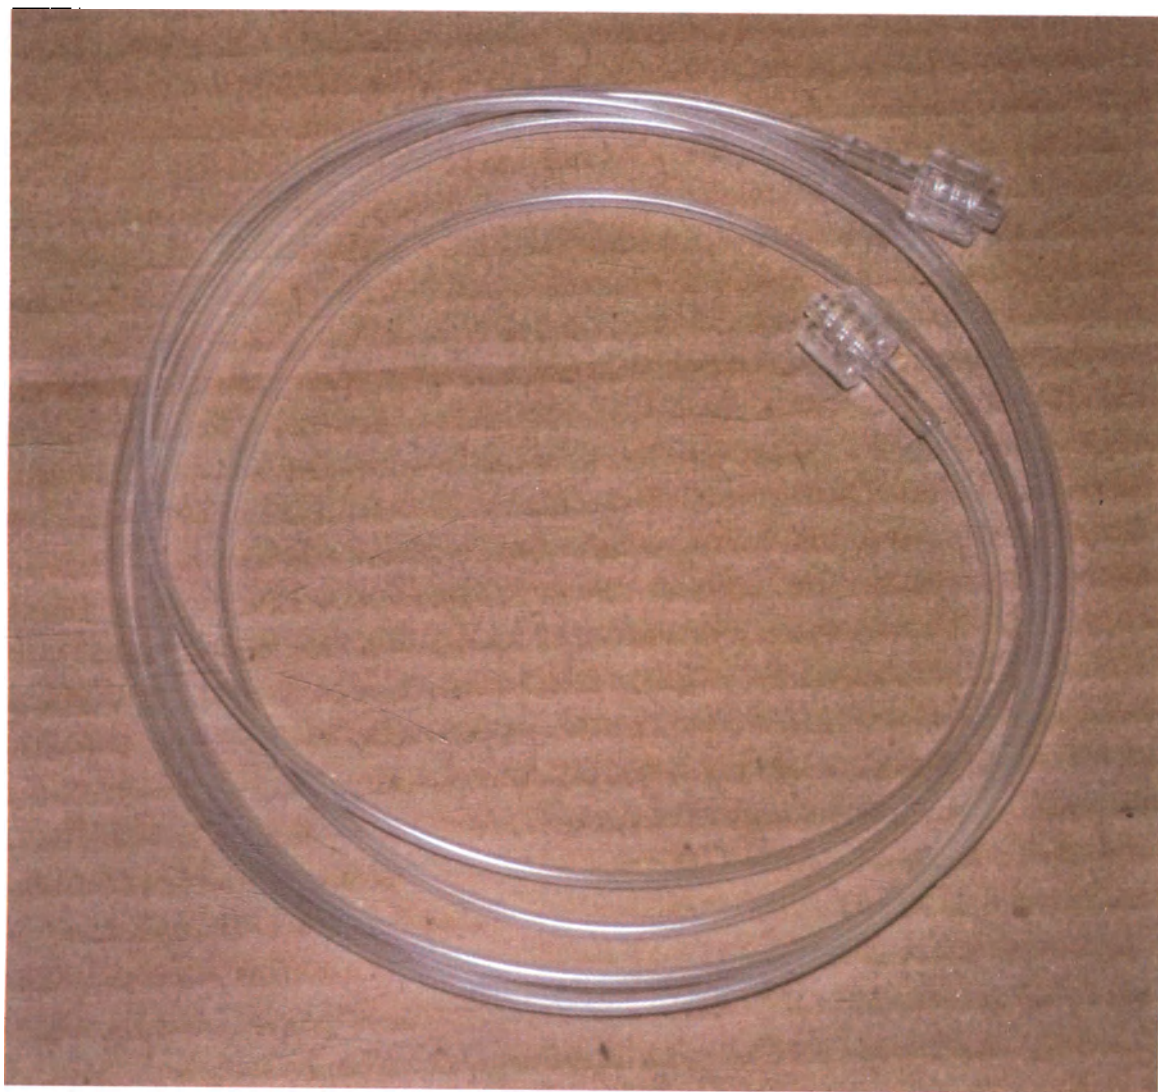

Скреплено печатью	12	ЛИСТОВ
(двенадцать)		
Должность	Директор НПЦФ ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ	
Подпись	В.Д. Селемир	

