

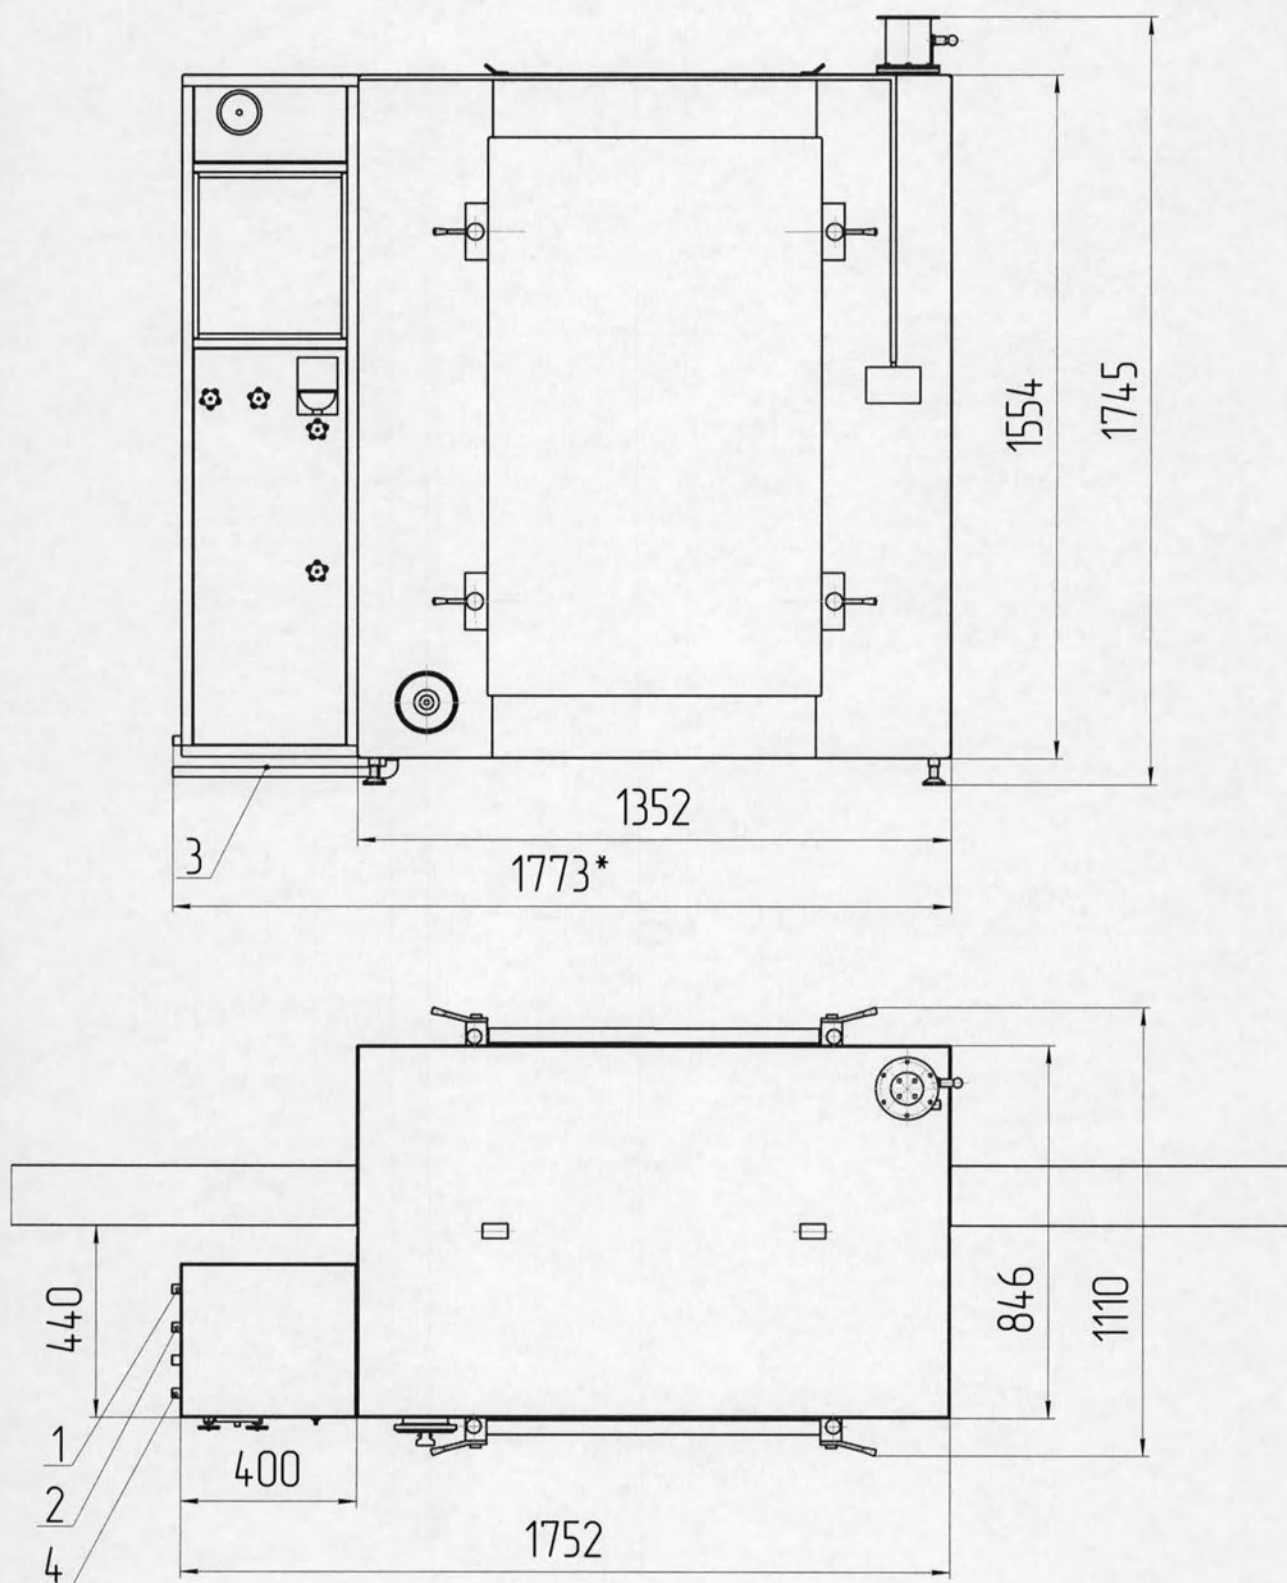



Рисунок 1 - Габаритные размеры камеры

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

мС 379.00.000 РЭ

Лист

18

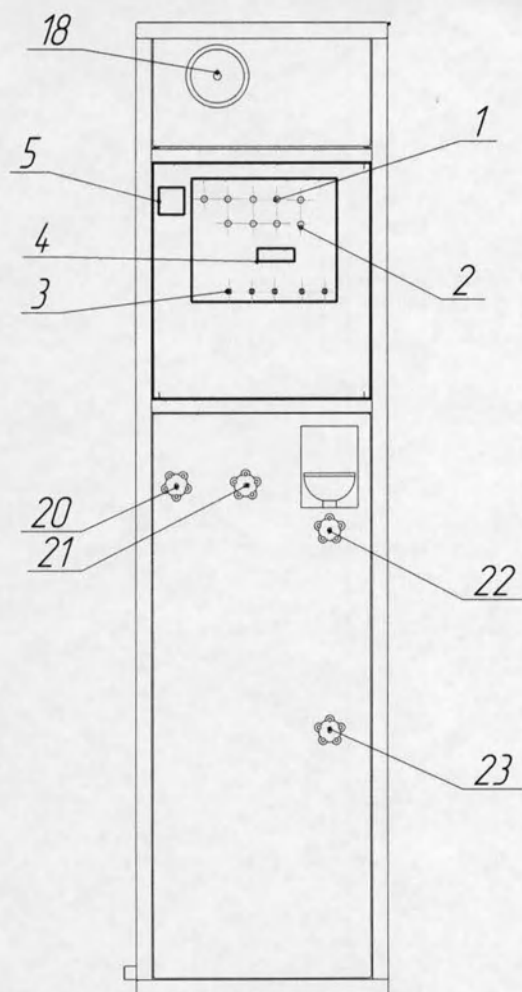

Органы индикации и управления

- 1- светосигнальная арматура
- 2- тумблеры
- 3- кнопки управления
- 4- БУДК-04
- 5- автоматический выключатель
- 18- электроконтактный манометр
- 20- вентиль разрешения автоматической подачи пара в камеру
- 21- вентиль ручной подачи пара в камеру
- 22- кран залива формалина
- 23- кран слива формалина

Рисунок 2 - Пульт управления

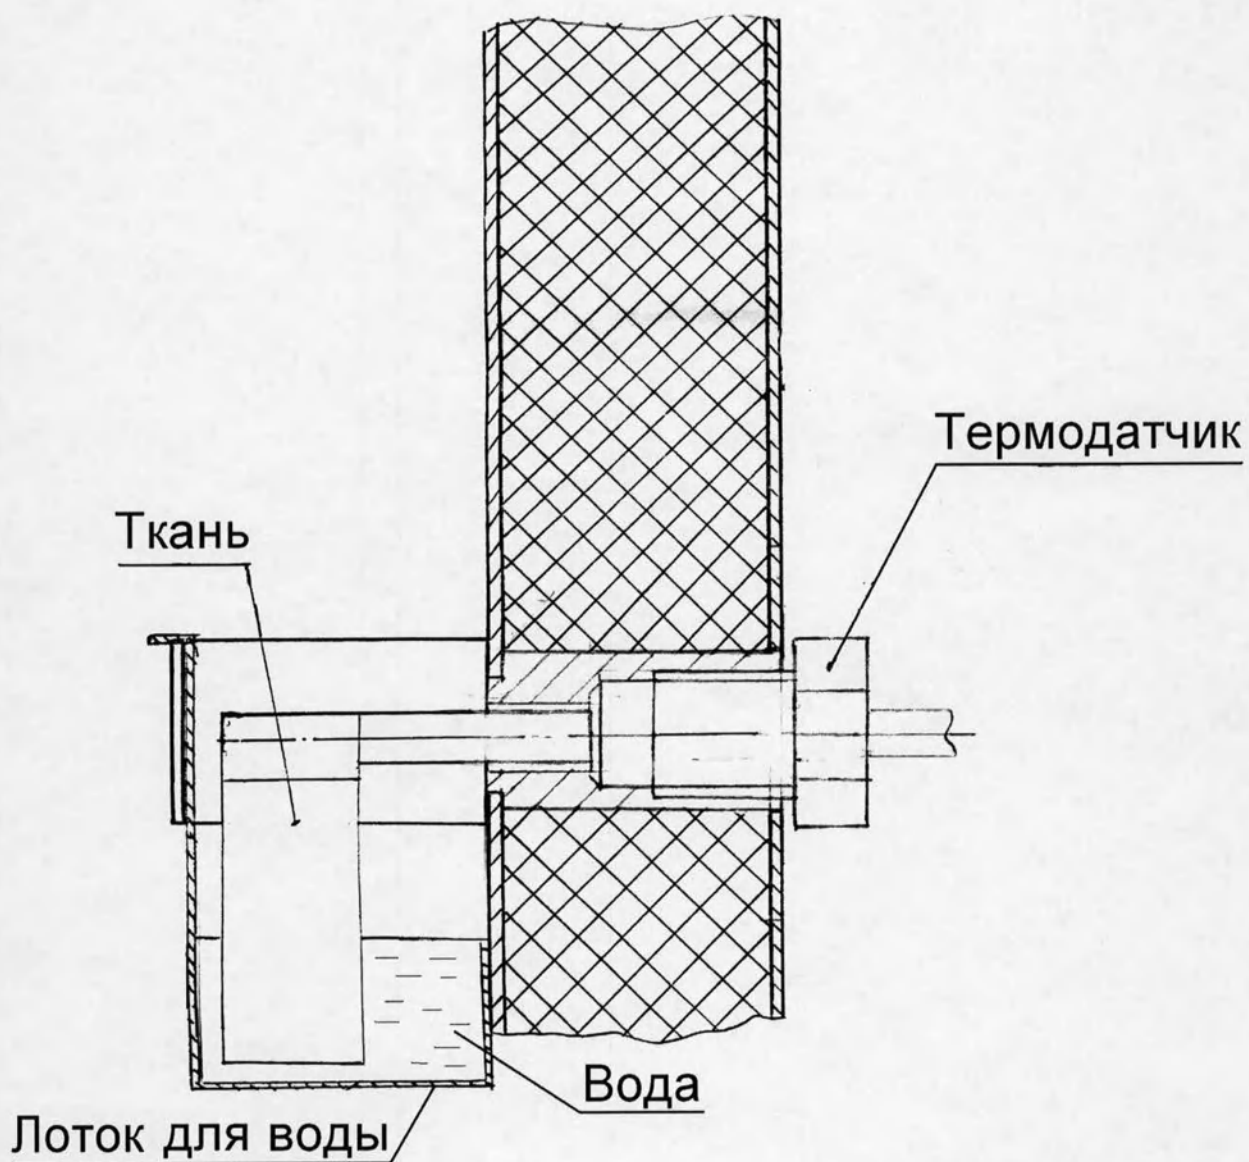


Рис. 3. Влажный термопреобразователь сопротивления.

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подпись	
Дата	

МС 379.00.000 РЭ

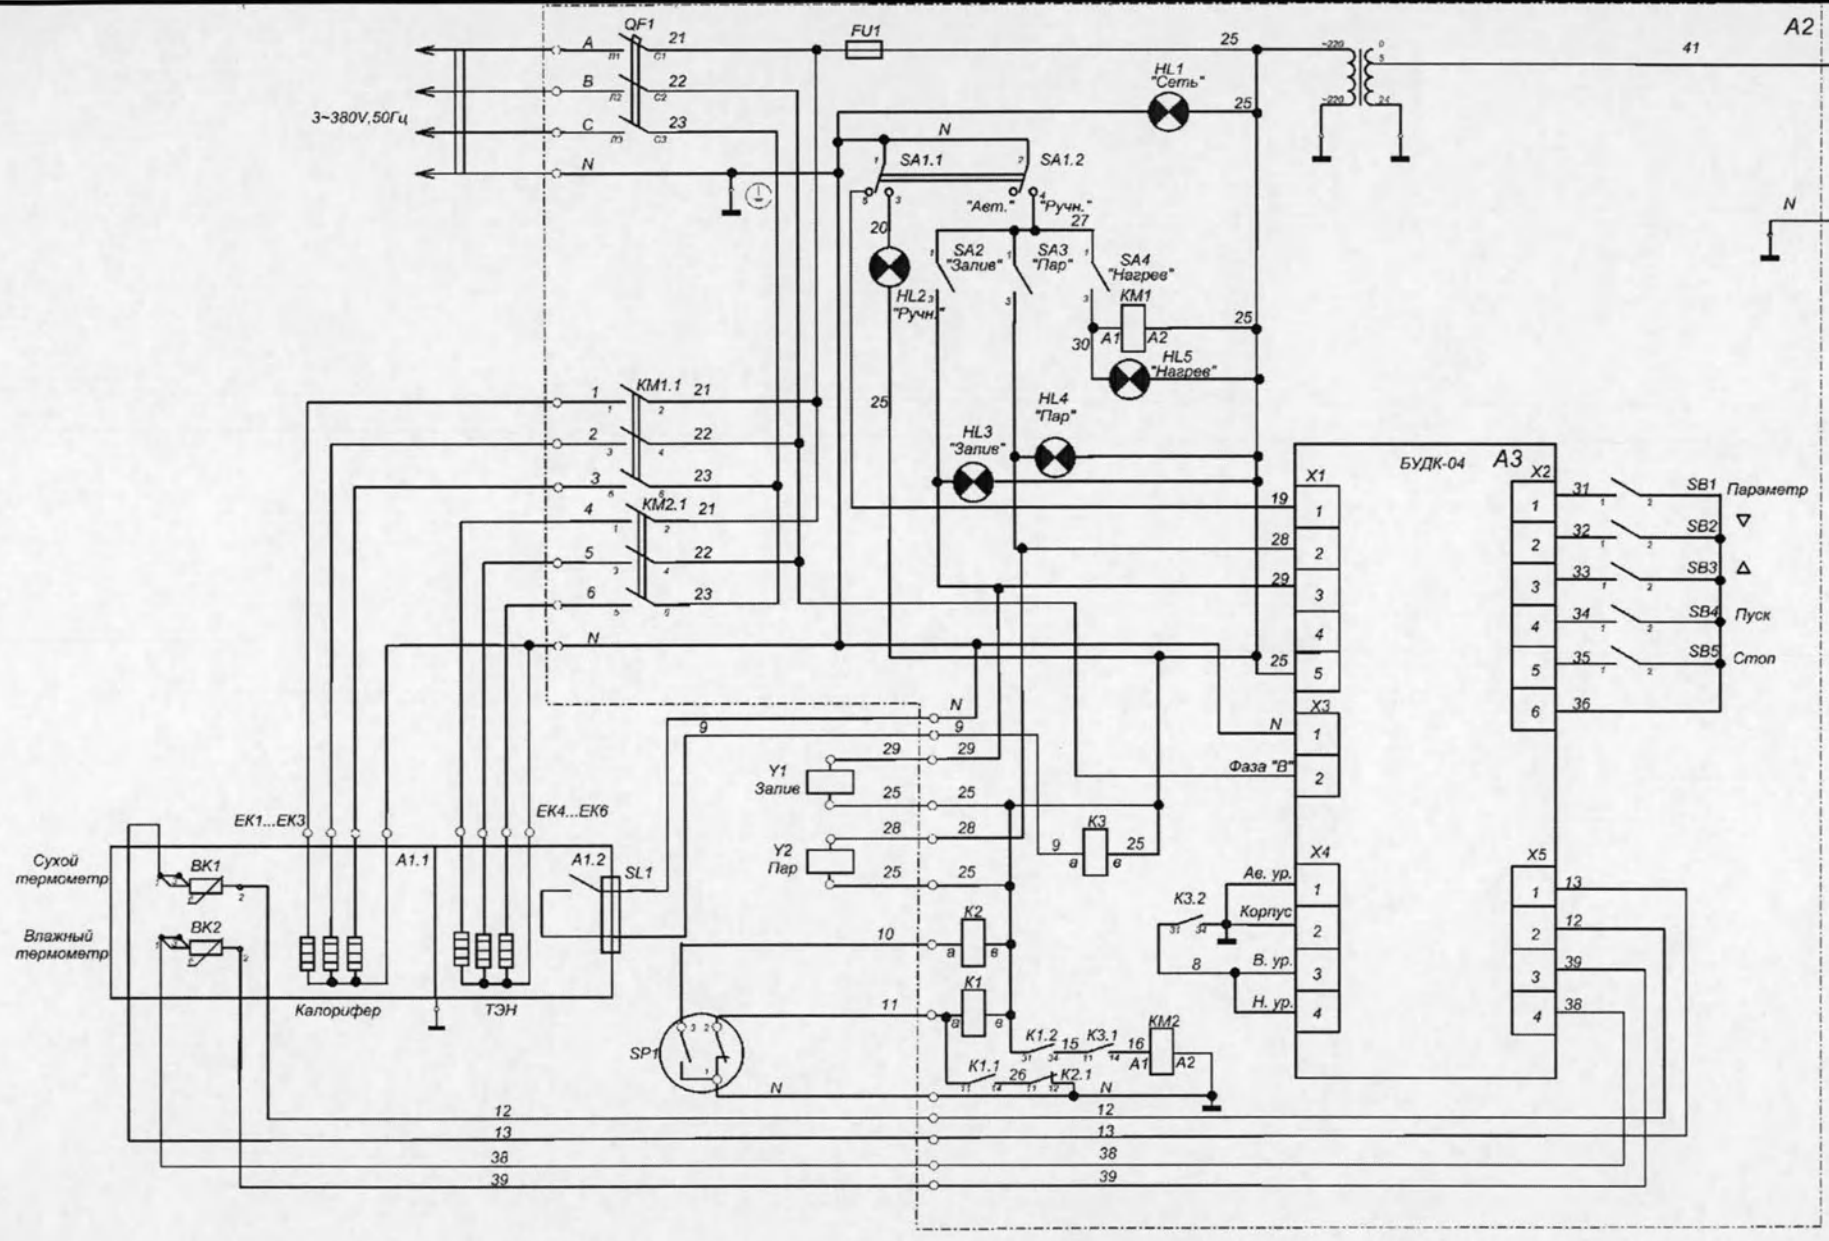


Рис. 4. Схема электрическая принципиальная
ВФЭ 1,5/1

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
Y1	Клапан электромагнитный Burkert 6213A10,0	1	
	FPM MS G1/2 PN 0-10bar 230V 50Hz 8W		
Y2	Клапан электромагнитный Burkert 6213A10,0	1	
	EPDM MS G1/2 PN 0-10bar 230V 50Hz 8W		
SP1	Манометр показывающий регулирующий	1	
	ДМ 2010 С4 Исп.5 Р=0-4 кг/см ²		
	Клеммный блок КБ 25-04	1	
A1	<u>Дезинфекционная камера</u>		
BK1, BK2	Термопреобразователь сопротивления	2	L=100мм
	TSM 012-011.2.1.1 ВЗ		
SL1	Датчик уровня жидкости RSF 46 Y 200 K1	1	Траб.=120°С импорт
EK1-EK3	ТЭН 100А13/0,5-0-220 ТУ16-531.690-80	3	
ЕК4-ЕК6	РУСТЭН Р 2кВт 220В	3	
A4	<u>Подсветка стекла водомера</u>		
R1	Резистор С2-33-0,5-1,2 кОм±10%	1	
HL7...HL9	Светодиод высокой яркости КИГД40 У20-Л5-П7	3	Зеленый
A2	<u>Электрощит</u>		
A3	БУДК-04		
QF1	Выключатель ВА47-29 С16 ГОСТР 50345	1	I _{ном} =16А, трехфазный
SA1...SA4	Тумблер ТЗ-1 АГО.360.407 ТУ	4	
SB1...SB5	Кнопка КМ1-1 ОЮО.360.011 ТУ	5	
FU1	Вставка плавкая ВП 1-1 АГО 481.303 ТУ	1	I _н =1 А
	Держатель вставки плавкой ДВП-4 СНКЖ 646120.004 ТУ	1	
K1...K3	Реле РП-21-003 220В 50Гц ТУ 16-523.593-80	3	
HL1...HL5	Светосигнальная арматура ЭСА12К ТУ16-676.001-83	5	Цвет сигнала красный
KM1, KM2	Пускатель ПМ-12-010 100 УХЛ4В (1э)	2	U _{кат} =220В; 50Гц
	ТУ 16-89 ИГФР 644.236.033 ТУ		I _н =10А
T1	Трансформатор ОСМ1-0,063 УЗ ТУ 16-717.137-83	1	220В / 0-5-24В
X1, X2	Клеммная колодка WAGO 2-хпроводная серии 261	2	8 клемм

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

тс 379.00.000 РЭ

Лист

22